

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.


М.П.





Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный Т3» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный Т3, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

2023

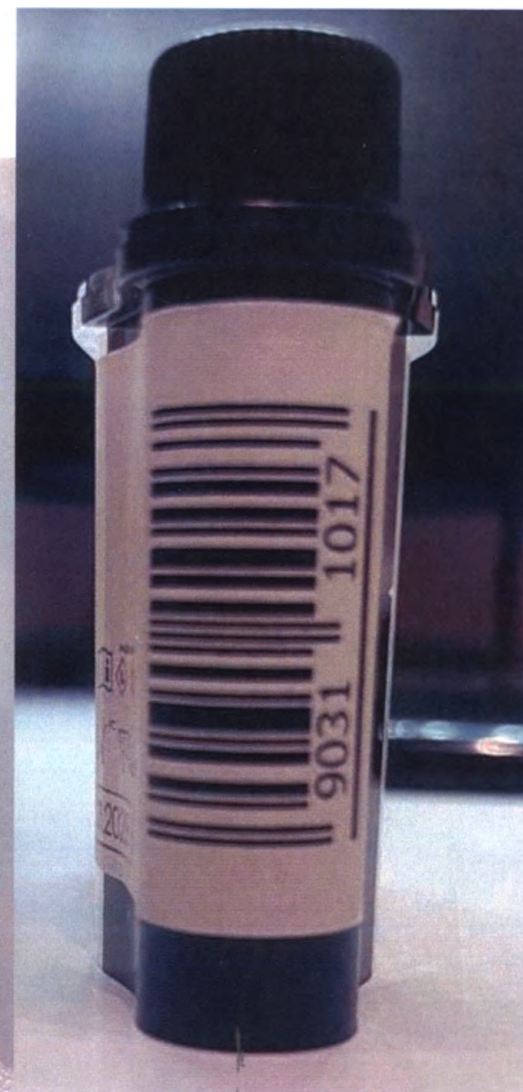

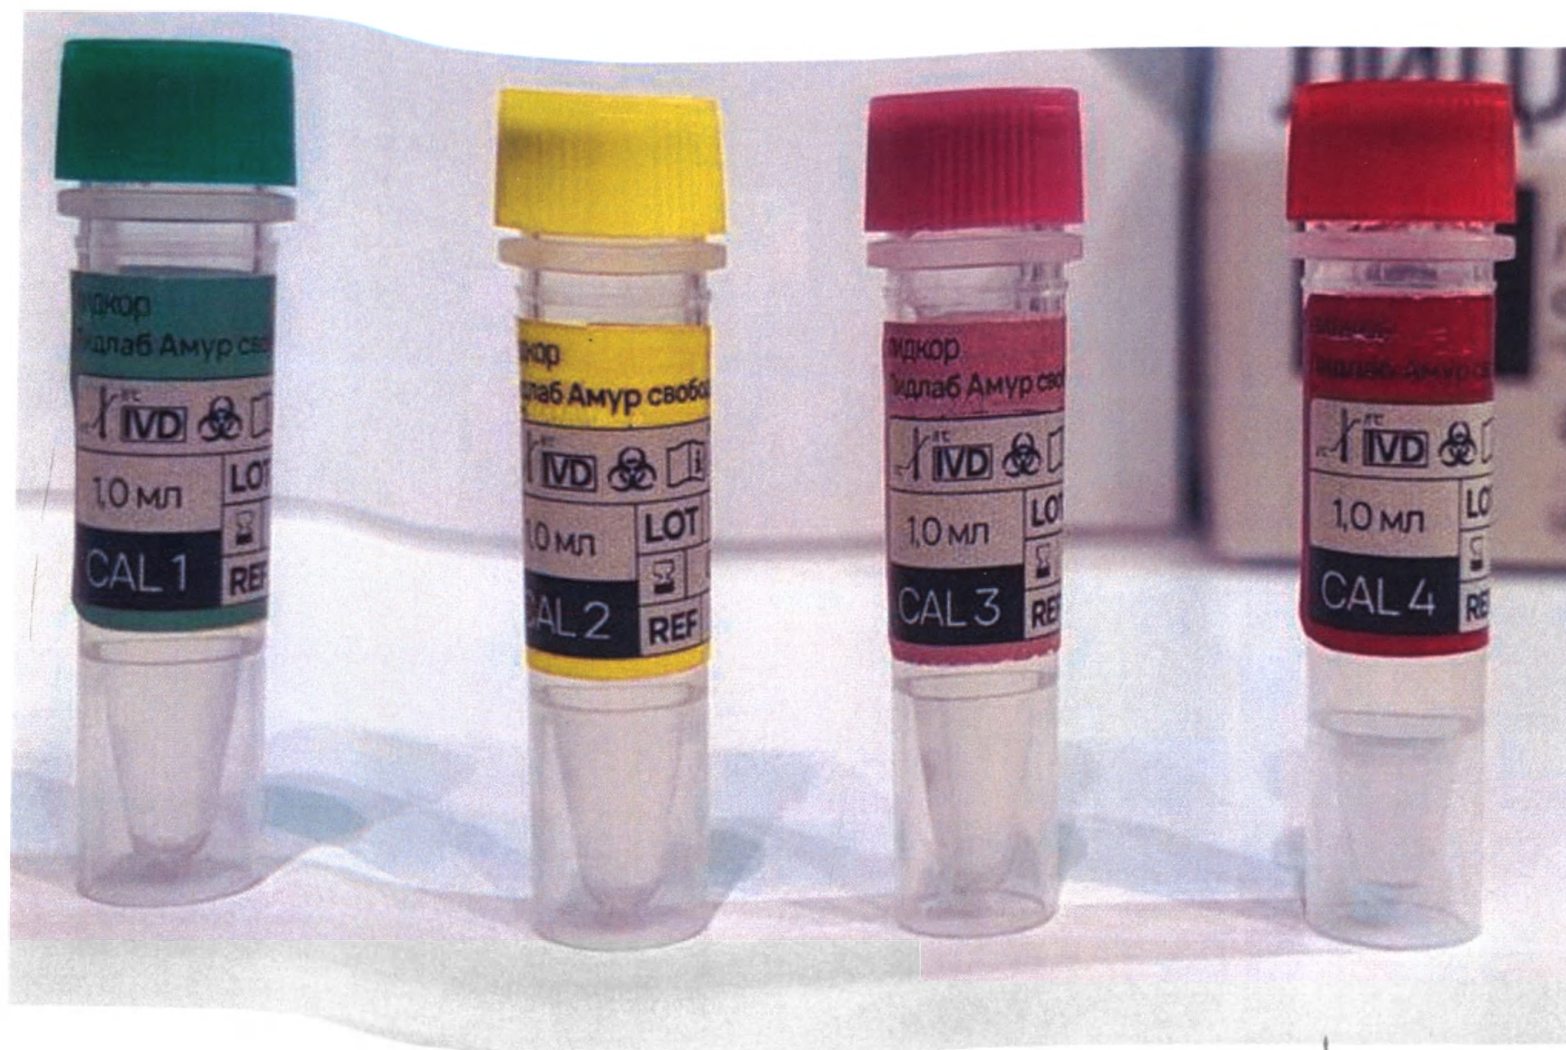

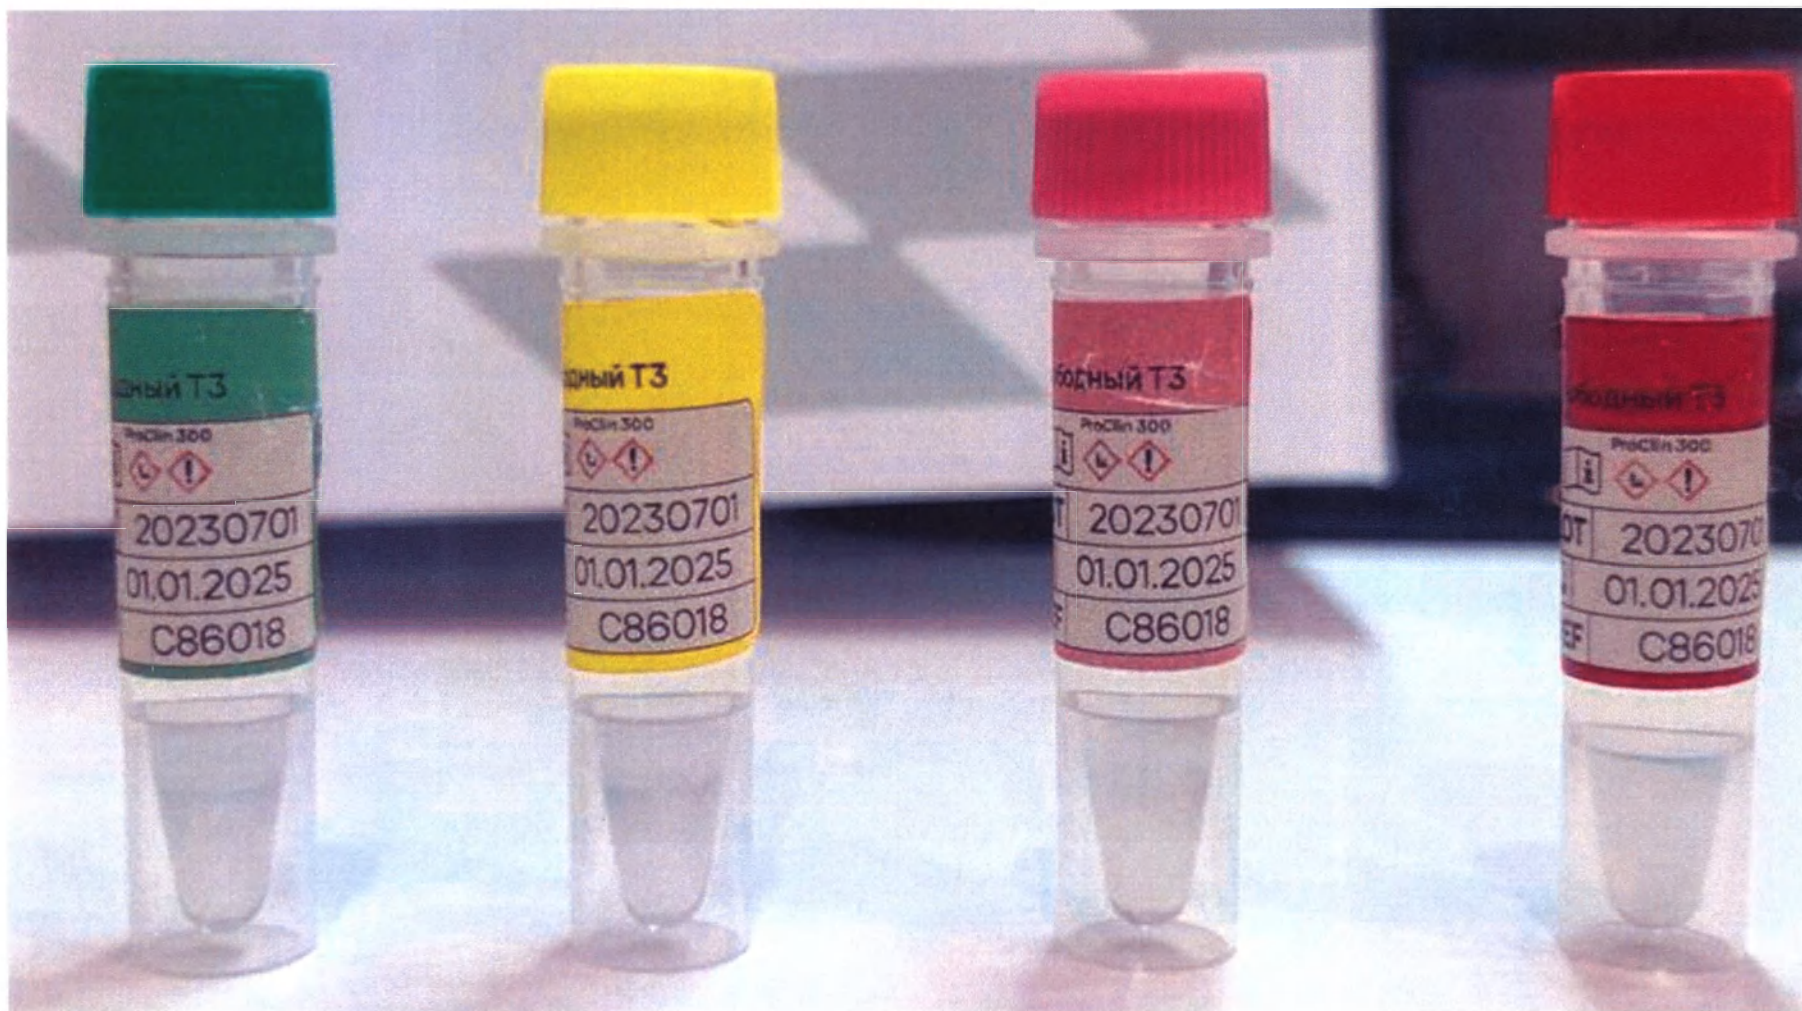

лидкор

Лидлаб Амур свободный ТЗ

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

IVD



01.01.2025

REF

C86018



лидлаб


лидкор



Лидлаб Амур свободный Т3

Набор реагентов на 100 тестов

YNLO

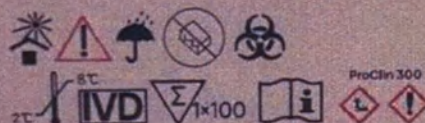

LOT	20230701	01.01.2025	REF	C86018
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов «Лидкоб Амур свободный ТЗ»
для количественного определения свободного
триглицерина (свободный ТЗ, fTG) в
сыворотке и плазме крови человека методом
иммунотурбидиметрического анализа
(ИХТЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохимическом «Лидкоб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов.


Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Придорожниковая, 3а

лидкор

Для профессионального применения

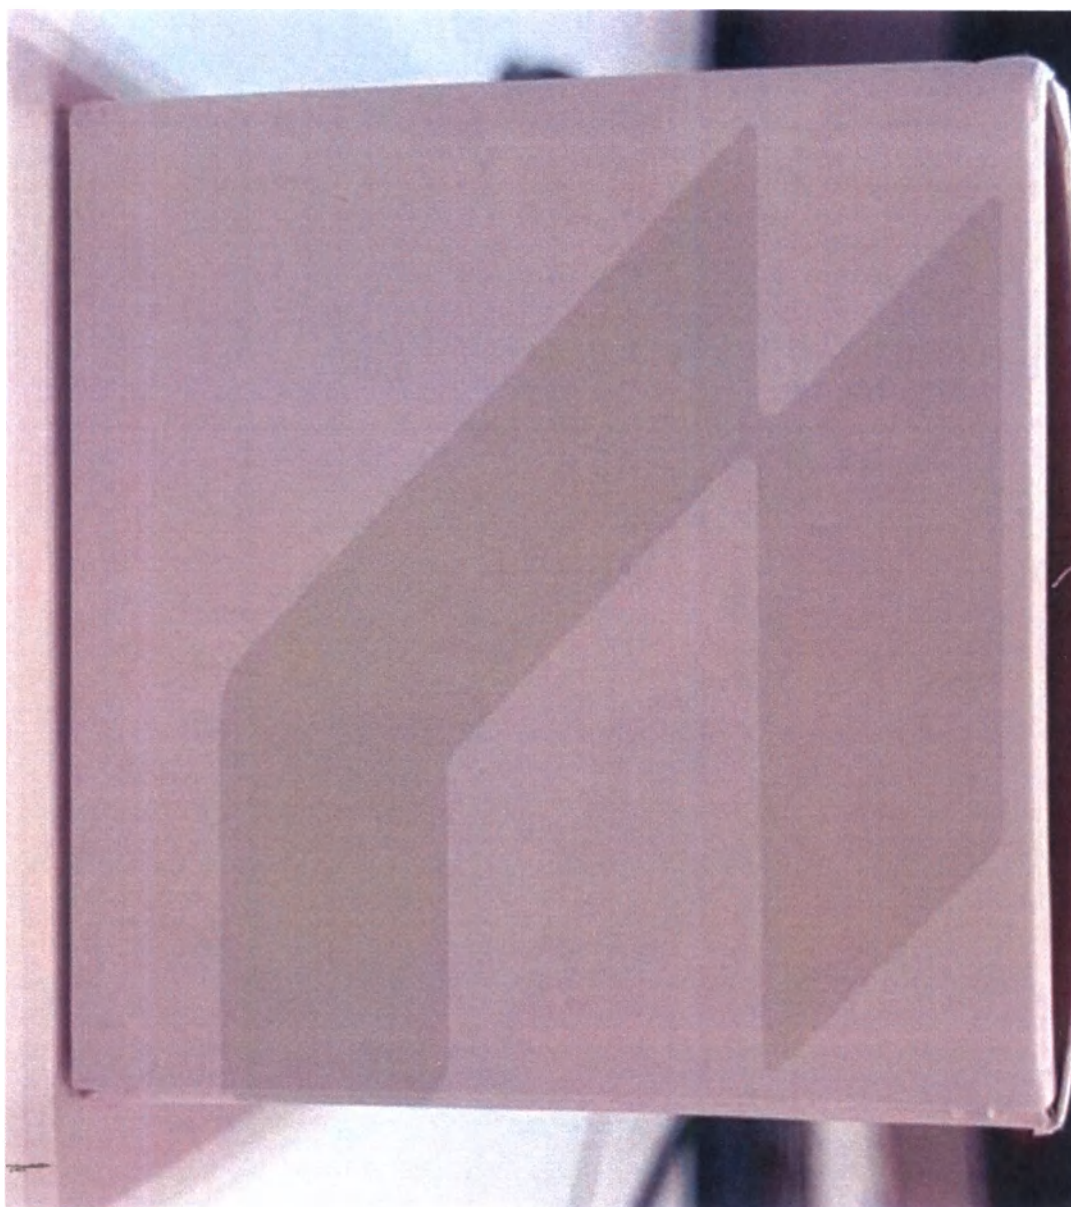


лидлаб



Лидлаб Амур свободный ТЗ

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO



ProCin 300

01.07.2023

LOT 20230701 01.01.2025 REF C86018

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп.; Реагент-биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный ТЗ»
для количественного определения свободного
трийодтиронина (свободный ТЗ, fT3) в
сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-
2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

лидкор





Для профессионального применения



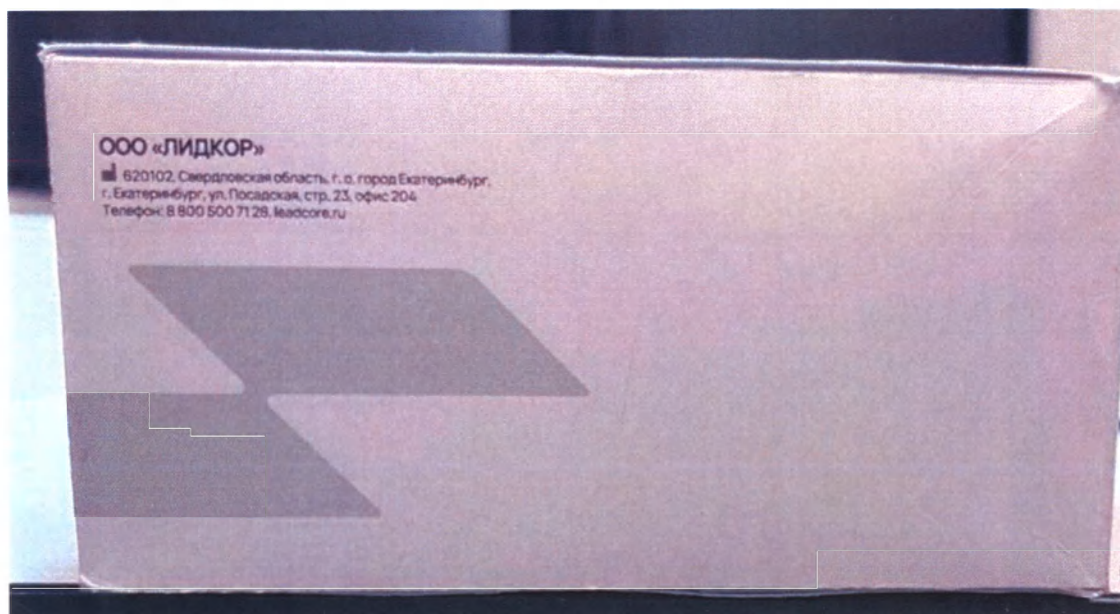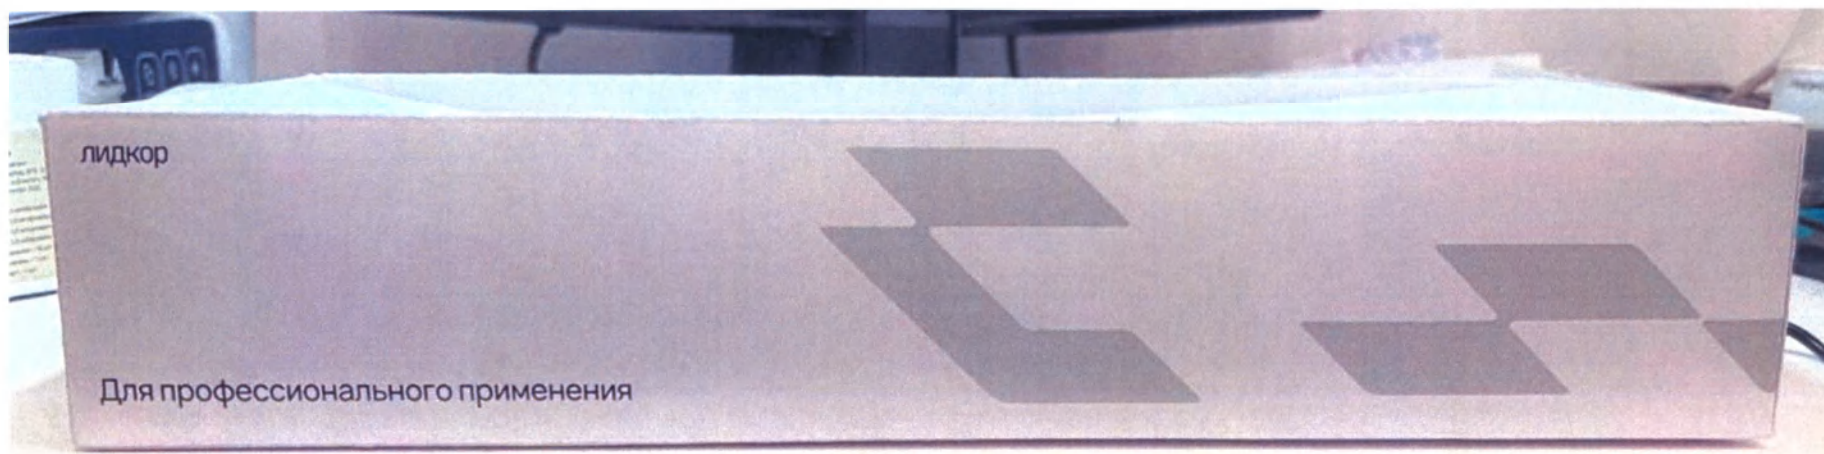


☐ 000-11902030, Россия, 625003, Екатеринбург
ул. 19-я линия, 7. Контрагентство по Контрагентствам и УС



- [illegible]

ООО «ЛИДКОР»


■ 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

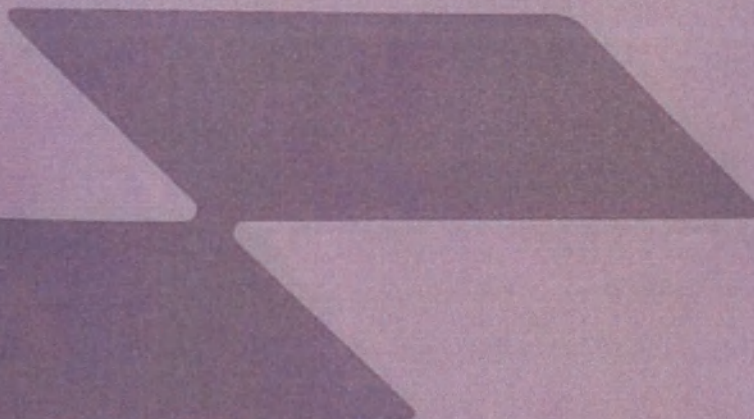

лидкор



Для профессионального
применения

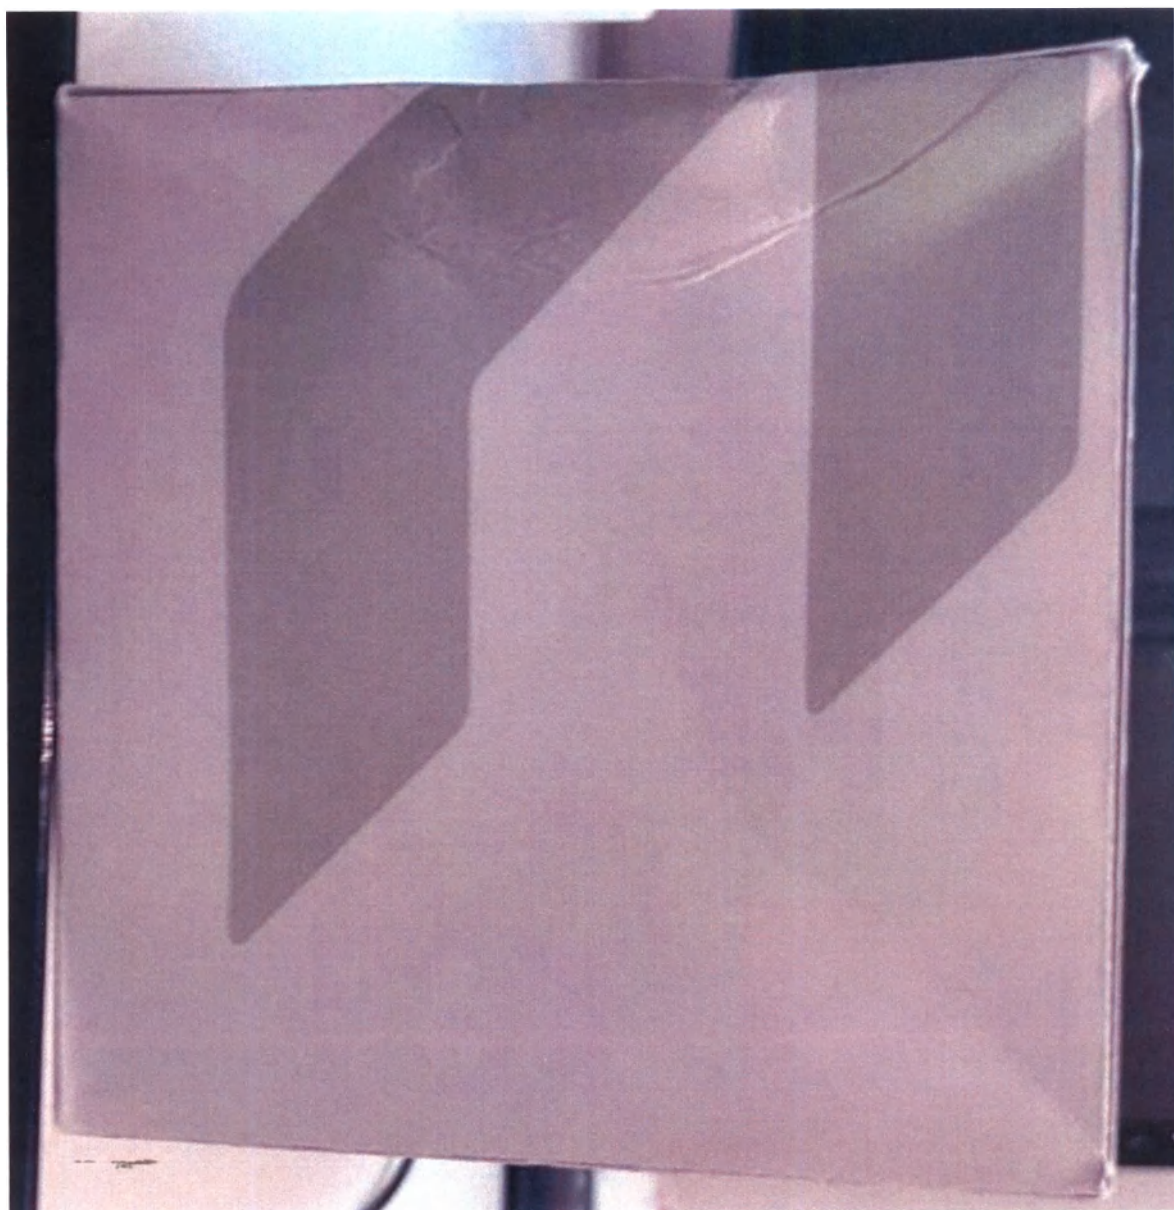







Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный Т3» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный Т3, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022




Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023	
LOT	20230701	01.01.2025	REF	C86018	




Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный ТЗ» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный ТЗ, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

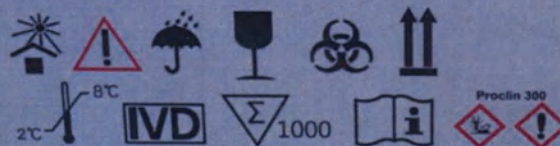


Для профессионального применения

		ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.д. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86018	



Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный ТЗ» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный ТЗ, fТЗ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

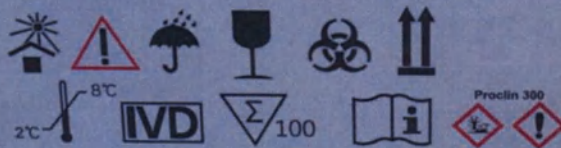


Для профессионального применения

		ООО «Гвидок», Россия 620102, Свердловская область, г.д. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		 01.07.2023	
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86018



Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный ТЗ» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный ТЗ, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

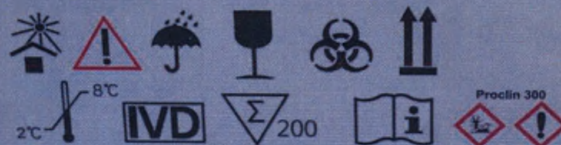

IVD

Σ 200



Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023	
LOT	20230701	01.01.2025	REF	C86018	

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (двадцать)



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный Т3» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный Т3, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный Т3» для количественного определения свободного трипта тирозина (свободный Т3, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614.693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛМДХСР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красnodарская, д. 15
☐ ООО «ЛМДХСР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленников, 3а

Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный Т3» для количественного определения свободного трипта тирозина (свободный Т3, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614.693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛМДХСР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красnodарская, д. 15
☐ ООО «ЛМДХСР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленников, 3а



Лидлаб Амур свободный Т3

Набор реагентов на 100 тестов

УНЛО

LOT 20230701 01.01.2025 REF C86018

- ### Состав изделия
1. Картридж (в составе: Реагент парамгнитных микрочастиц (P1), 3.5 мл/шт.; Реагент-конъюгат (P2), 4.0 мл/шт.; Реагент биотинилированных антител (P3), 4.0 мл/шт.) - 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1.0 мл/флакон - 1 шт.;
6. Пароксизольонные крышки - 8 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;
8. Аналитический паспорт - 1 шт.



Лидлаб Амур свободный Т3

Набор реагентов на 200 тестов

УНЛО

LOT 20230701 01.01.2025 REF C86018

- ### Состав изделия
1. Картридж (в составе: Реагент парамгнитных микрочастиц (P1), 3.5 мл/шт.; Реагент-конъюгат (P2), 4.0 мл/шт.; Реагент биотинилированных антител (P3), 4.0 мл/шт.) - 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 2 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1.0 мл/флакон - 2 шт.;
6. Пароксизольонные крышки - 16 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;
8. Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный Т3» для количественного определения свободного триглицеридина (свободный ТГ, fTG) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
ру № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «Лидкор», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный Т3» для количественного определения свободного триглицеридина (свободный ТГ, fTG) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматического иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
ру № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «Лидкор», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур свободный Т3

Набор реагентов на 500 тестов

УНЛО

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент паразитических микроорганизмов (R1), 3,5 мл/шт.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/шт.; Реагент биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/шт.) - 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 10 мл/флакон - 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 10 мл/флакон - 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 10 мл/флакон - 5 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 10 мл/флакон - 5 шт.;
6. Порошкообразные крышки - 40 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;
8. Аналитический паспорт - 1 шт.



Индикация

ЛОТ 20230701 01.01.2025 REF C86018



Лидлаб Амур свободный Т3

Набор реагентов на 1000 тестов

УНЛО

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент паразитических микроорганизмов (R1), 3,5 мл/шт.; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/шт.; Реагент биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/шт.) - 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 10 мл/флакон - 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 10 мл/флакон - 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 10 мл/флакон - 10 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 10 мл/флакон - 10 шт.;
6. Порошкообразные крышки - 80 шт.;
7. Инструкция по применению - 1 шт.;
8. Аналитический паспорт - 1 шт.



Индикация

ЛОТ 20230701 01.01.2025 REF C86018

лидкор **YNLO**

**Лидлаб Амур
свободный ТЗ**

IVD   ProClin 300  

3,5мл	4,0 мл	4,0мл
R 1	R 2	R 3

2°C  8°C  1×50

LOT	20230701		01.01.2025
-----	----------	---	------------

 1017 9031

лидкор

Лидлаб Амур свободный ТЗ

2°C  8°C **IVD**   ProClin 300  

1,0 мл	LOT	20230701
CAL 1		01.01.2025
	REF	C86018

лидкор

Лидлаб Амур свободный ТЗ

2°C  8°C **IVD**   ProClin 300  

1,0 мл	LOT	20230701
CAL 2		01.01.2025
	REF	C86018

лидкор
Лидлаб Амур свободный Т3

ProClin 300		
2°C	8°C	IVD
   		
1,0 мл	LOT	20230701
		01.01.2025
CAL 3	REF	C86018

лидкор
Лидлаб Амур свободный Т3

ProClin 300		
2°C	8°C	IVD
   		
1,0 мл	LOT	20230701
		01.01.2025
CAL 4	REF	C86018

лидкор
Лидлаб Амур
свободный Т3


Пароизоляционные крышки – 4 шт.		
LOT	20230701	IVD
	01.01.2025	
REF	C86018	




Лидлаб Амур свободный ТЗ



LOT 20230701 EXP 01.01.2025

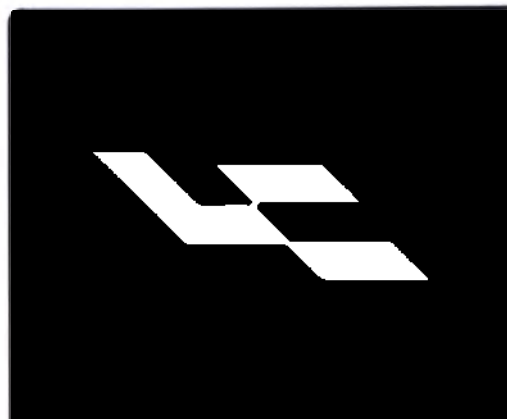


Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный ТЗ» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный ТЗ, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

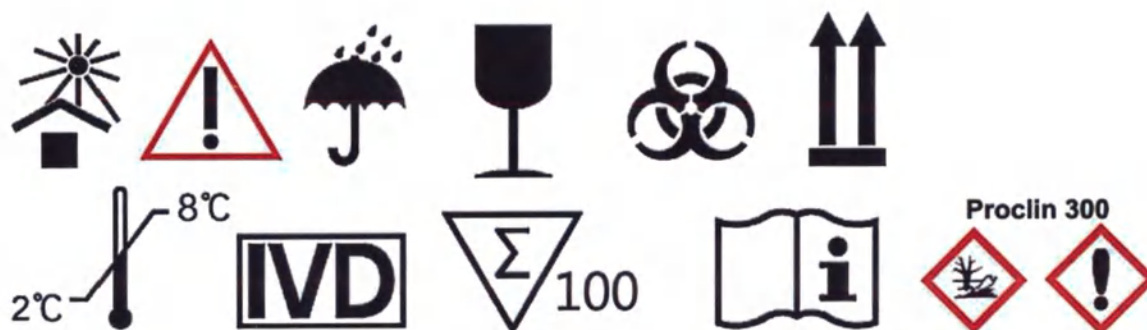


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86018

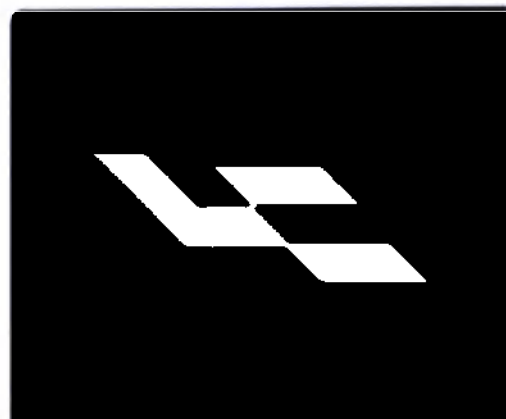


Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный ТЗ» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный ТЗ, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

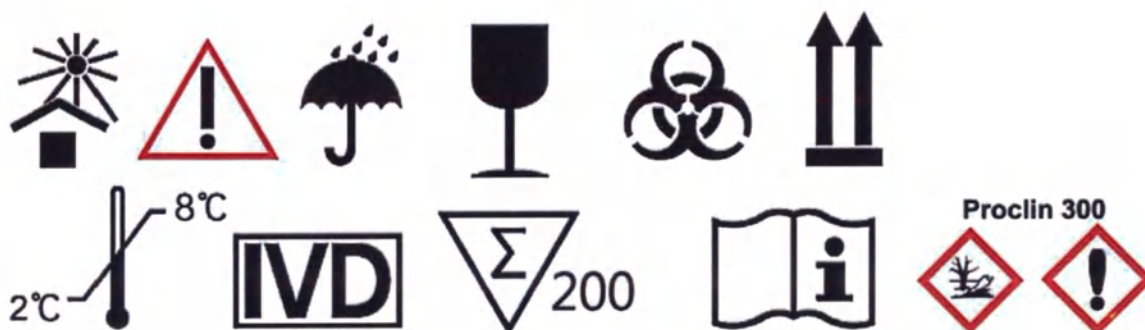


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86018

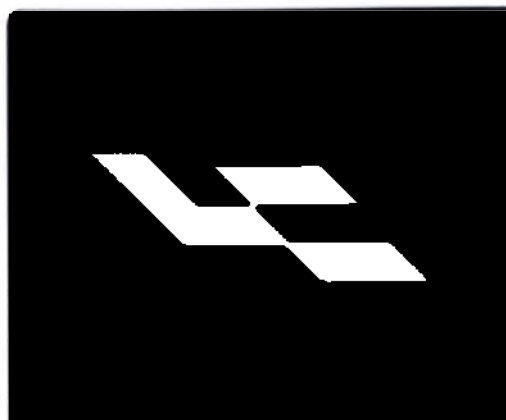


Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный ТЗ» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный ТЗ, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

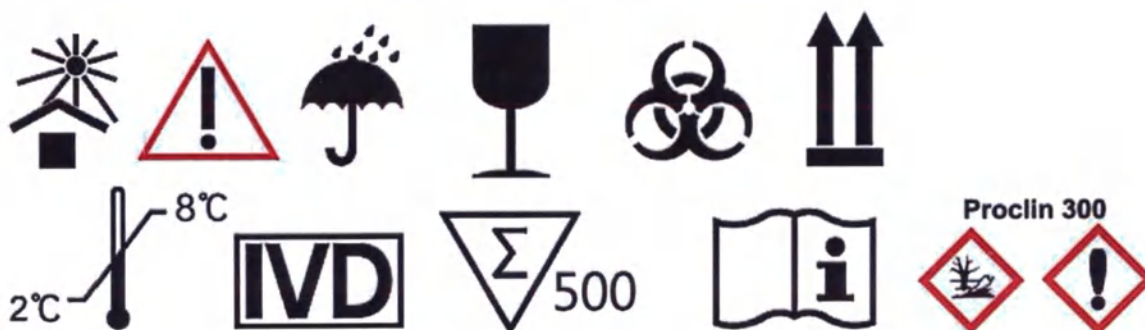


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86018

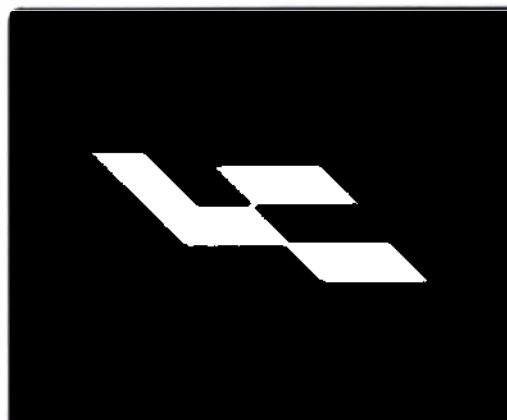



Набор реагентов «Лидлаб Амур свободный ТЗ» для количественного определения свободного трийодтиронина (свободный ТЗ, fT3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-229-65614693-2022

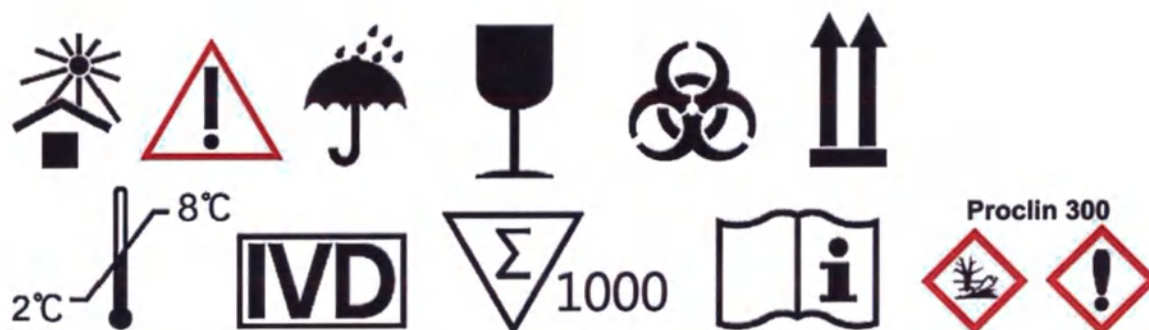

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86018

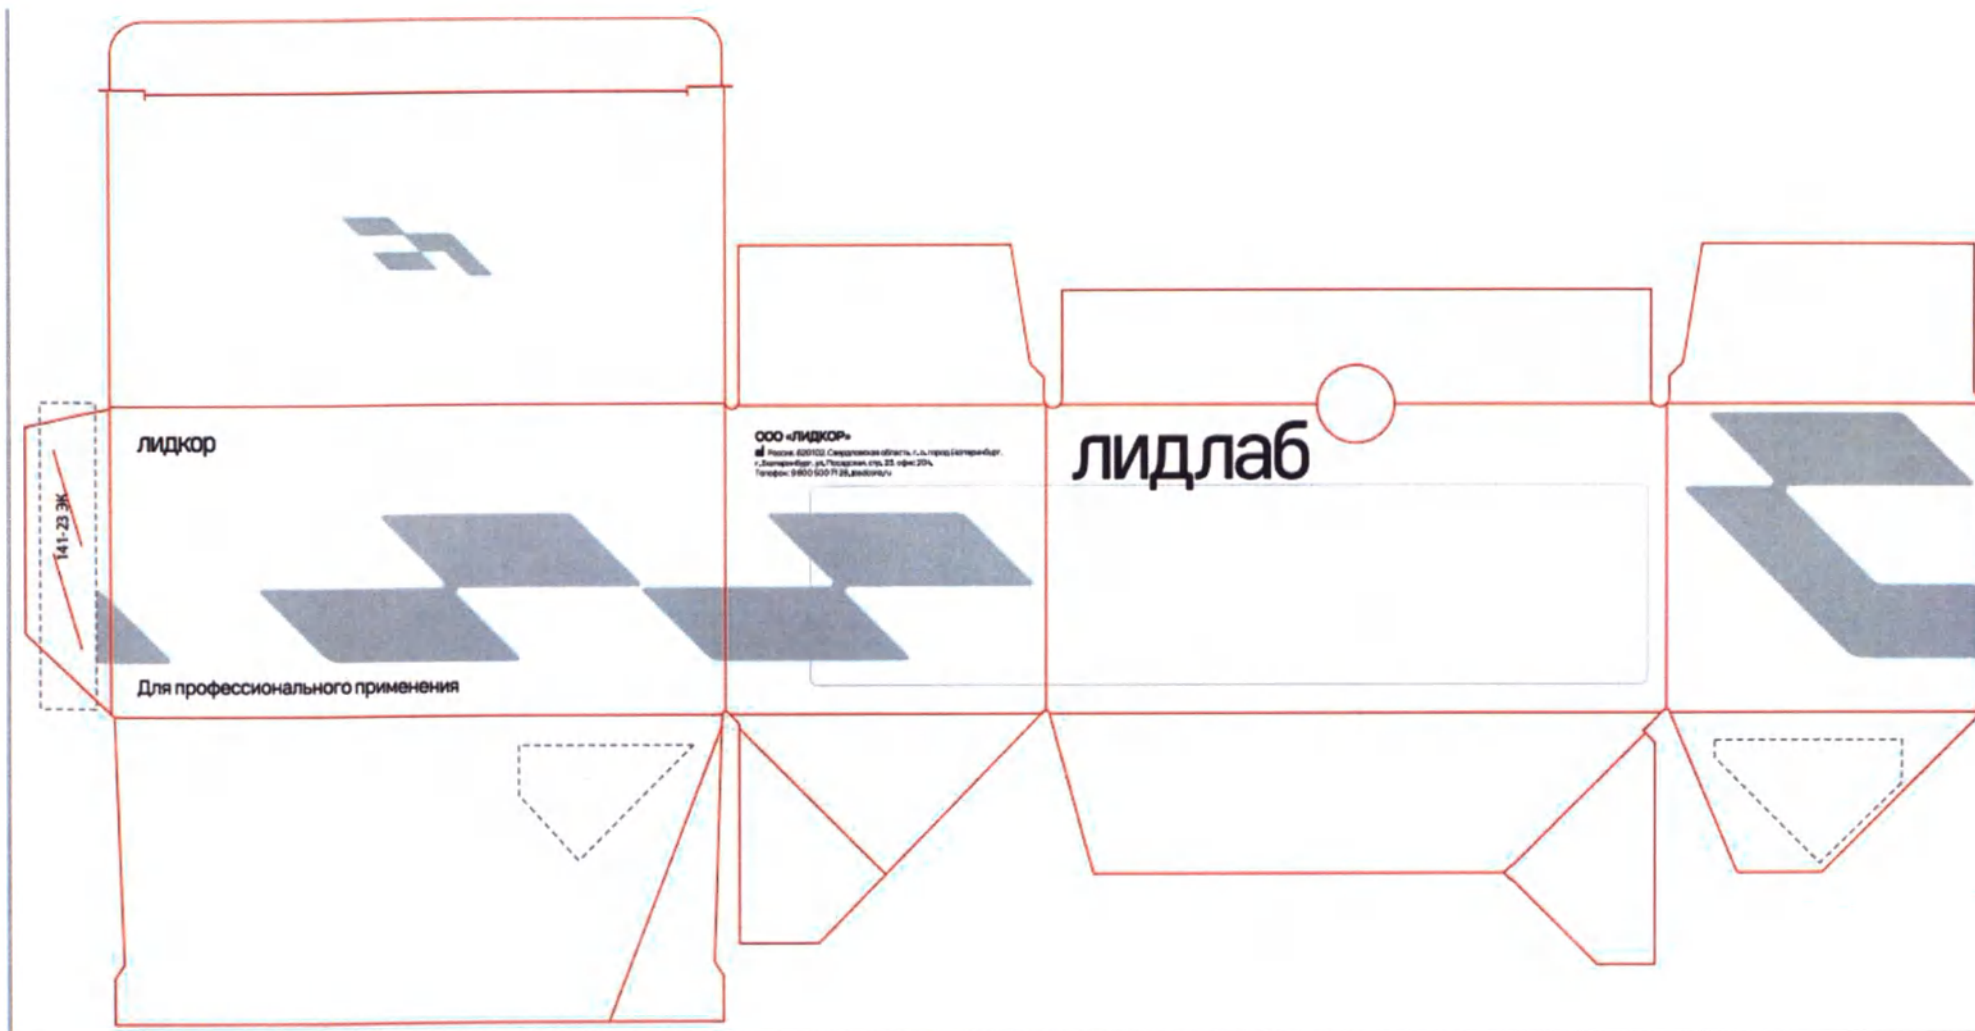

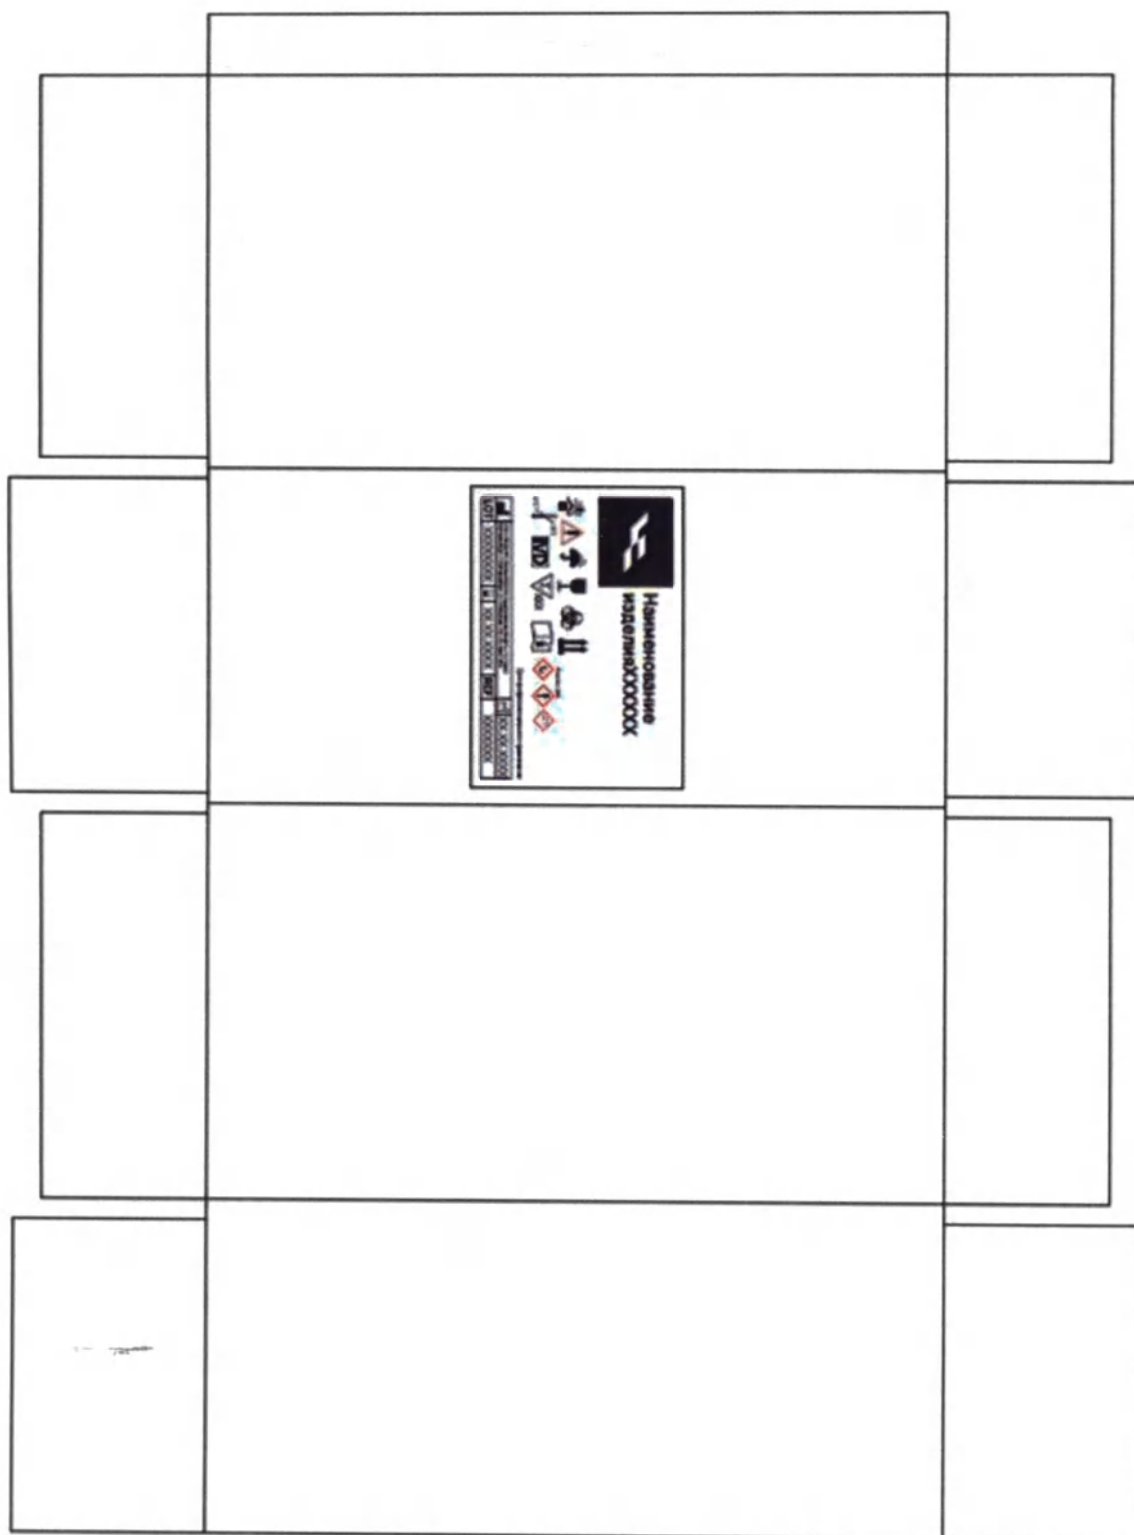

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
12 (двенадцать) л.

Директор
ООО «ТИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

