

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

«07» октября 2024 г.



Извещение № 1

об изменении проекта маркировки

**Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения
in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин
репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности
«β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022**

Все изменения производить путем замены образцов маркировки на актуальные.

1. Изменения маркировки потребительской упаковки Комплекта № 3 (дизайн s3):

Комплект № 3 дизайн s3

Было (сторона 1)

FEAtest 1 ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ

Изготовитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbjan.ru.

Срок годности: 36 месяцев в заводской упаковке. Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °C не более 10 суток.

РУ № РЗН 2023/19945

FEAtest

ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ

1 ТЕСТ-
ПОЛОСКА

Express

С 1-го дня задержки



ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ
FEAtest 1

Стало (сторона 1)

(изменение фона (изображение цветка) на лицевой стороне потребительской упаковки)

FEAtest 1 ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ

Изготовитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbjan.ru.

Срок годности: 36 месяцев в заводской упаковке. Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

РУ № РЗН 2023/19945

FEAtest

ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ

1 ТЕСТ-
ПОЛОСКА

Express

С 1-го дня задержки



ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ
FEAtest 1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «В-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022.
Комплект № 3 Тест для определения беременности на ранних сроках.

- Тест-полоска, чувствительность 25 мМЕ/мл – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.




АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 25 мМЕ/мл
Экспресс-тест для определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 100 %
Определение беременности с первого дня задержки менструации.
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ И ЯСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Результат известен уже через 1-5 минут.

*Результат анализа предвостановлен и не должен рассматриваться как единственное основание для постановки диагноза. Отрицательный результат теста не исключает вероятность беременности.



- СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
- ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ**
- Вскрыть упаковку и применить экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входить в контакт).
- Извлечь тест-полоску из индивидуальной упаковки непосредственно перед проведением анализа, промаркировать, при необходимости, опустить вертикально стрелками вниз $\uparrow\uparrow$ в емкость с мочой не менее 5 мл до линии (MAX) на 10 секунд.
 - Извлечь тест-полоску из емкости с мочой и положить на сухую горизонтальную поверхность.
 - Оценить результат через 1-5 минут. Не интерпретировать результаты позднее 10 минут после внесения образца мочи.




FEAtest

REF

WR-009/1.3-53

Стало (сторона 2)

(изменение поля для нанесения переменной информации на оборотной стороне потребительской упаковки)

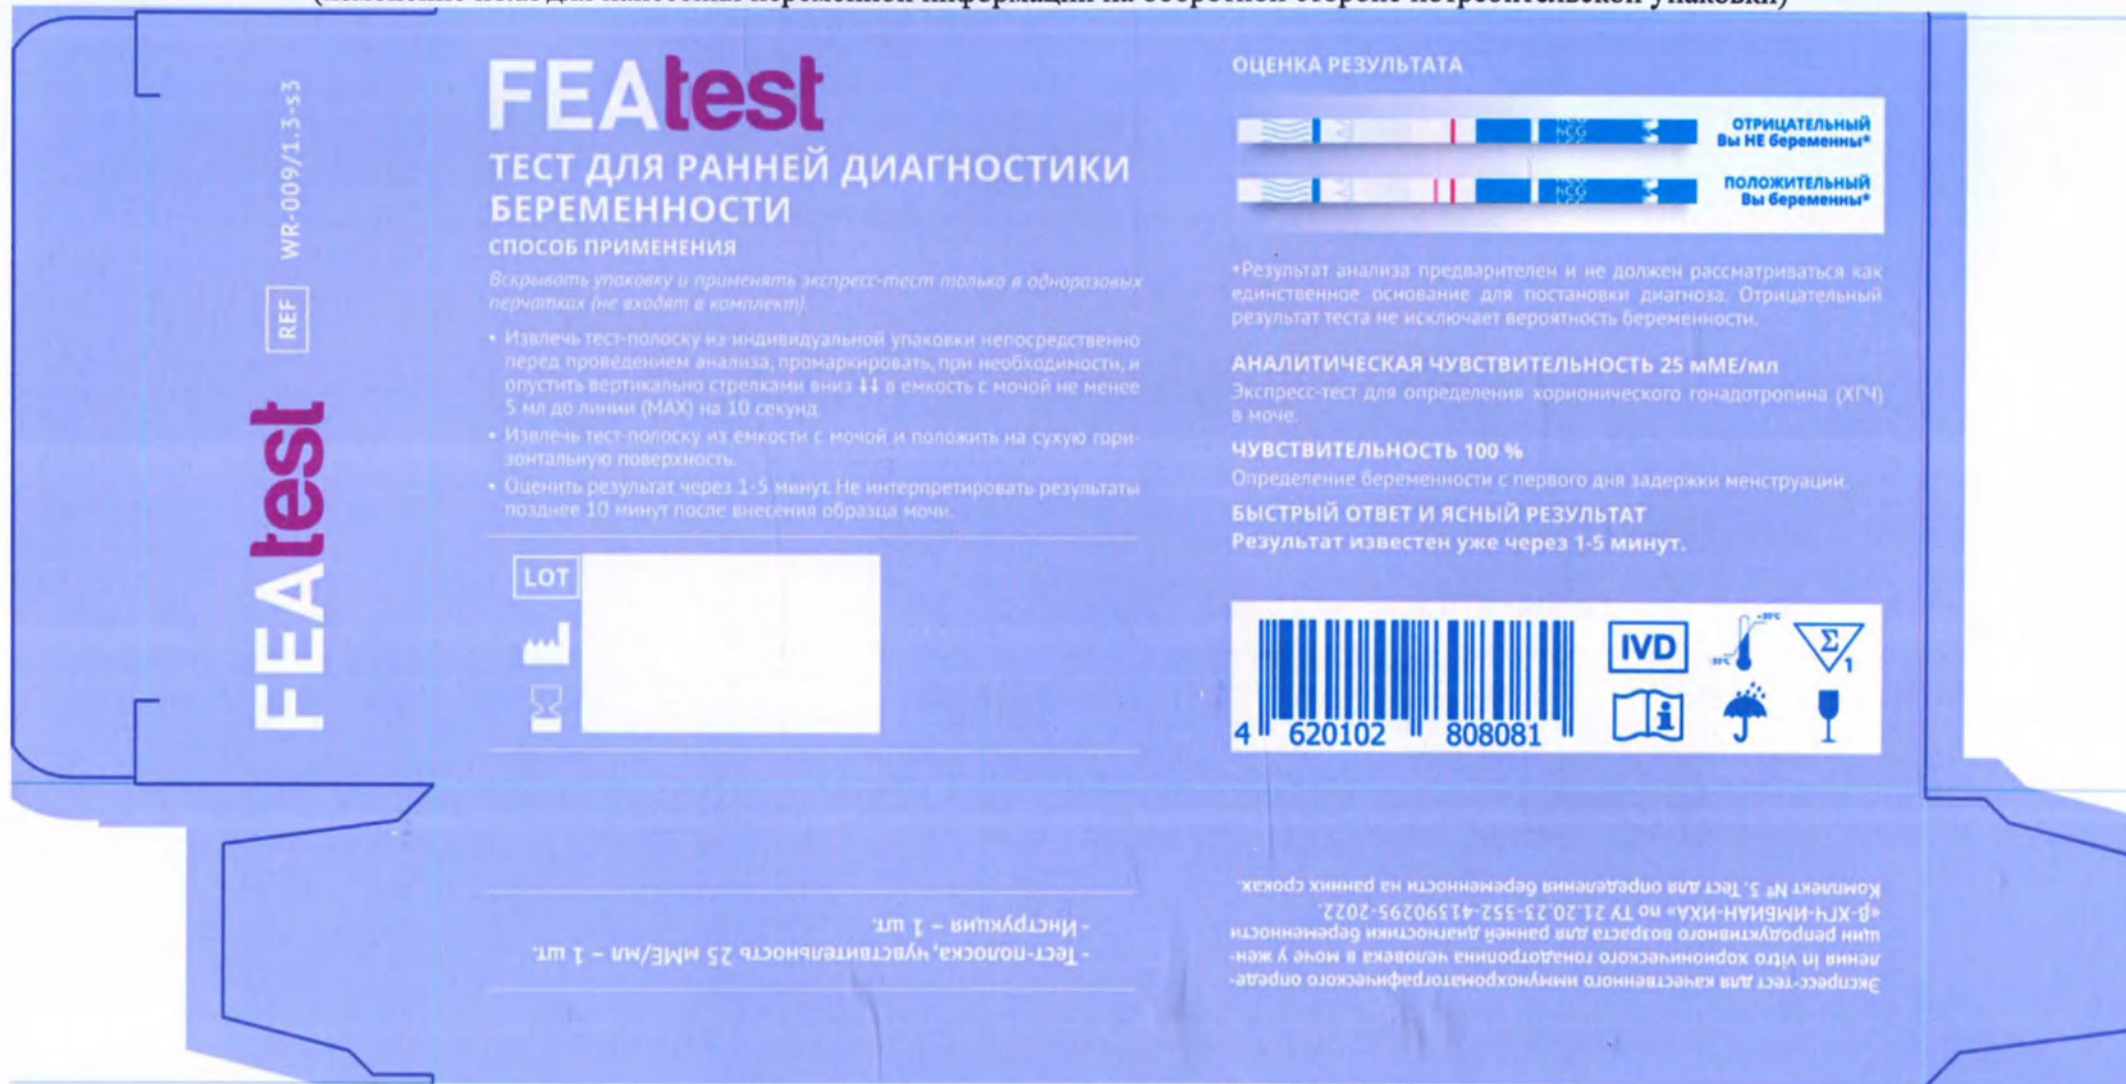

На листе 15 маркировку потребительской упаковки Комплекта № 3 (дизайн s3) заменить на следующую:



2. Изменения маркировки потребительской упаковки Комплекта № 12 (дизайн s3):
Комплект № 12 дизайн s3
Было (сторона 1)

FEAtest 2 ТЕСТА ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ

Изготовитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2., +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbjan.ru.

Срок годности: 36 месяцев в заводской упаковке. Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

РУ № РЗН 2023/19945

FEAtest

ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ

2 ТЕСТ-
ПОЛОСКИ

Express

С 1-го дня задержки



ТЕСТА ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ
FEAtest 2

Стало (сторона 1)

(изменение фона (изображение цветка) на лицевой стороне потребительской упаковки)

FEAtest 2 ТЕСТА ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ

Изготовитель: ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbian.ru.

Срок годности: 36 месяцев в заводской упаковке. Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

РУ № РЗН 2023/19945

FEAtest

ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ

2 ТЕСТ-
ПОЛОСКИ

Express

С 1-го дня задержки

ТЕСТА ДЛЯ РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКИ
БЕРЕМЕННОСТИ
FEAtest 2



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022.
Комплект № 12 Тест для определения беременности на ранних сроках.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 25 мМЕ/мл
Экспресс-тест для определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 100 %
Определение беременности с первого дня задержки менструации.
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ И ЯСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Результат известен уже через 1-5 минут.

*Результат анализа предварителен и не должен рассматриваться как единственное основание для постановки диагноза. Отрицательный результат теста не исключает вероятность беременности.



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

- Тест-полоска, чувствительность 25 мМЕ/мл – 2 шт.
- Инструкция – 1 шт.

FEAtest

ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ

Способ применения

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входить в комплект).

- Извлечь тест-полоску из индивидуальной упаковки непосредственно перед проведением анализа, промаркировать, при необходимости, и опустить вертикально стрелками вниз в емкость с мочой не менее 5 мл до линии (MAX) на 10 секунд.
- Извлечь тест-полоску из емкости с мочой и положить на сухую горизонтальную поверхность.
- Оценить результат через 1-5 минут. Не интерпретировать результаты позднее 10 минут после внесения образца мочи.

REF

WR-009/2.12-s3

Стало (сторона 2)

(изменение поля для нанесения переменной информации на оборотной стороне потребительской упаковки)

FEAtest

ТЕСТ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вскрыть упаковку и применить экспресс-тест только в однократных перчатках (не входят в комплект).

- Извлечь тест-полоску из индивидуальной упаковки непосредственно перед проведением анализа, промаркировать, при необходимости, и опустить вертикально стрелками вниз $\uparrow\downarrow$ в емкость с мочой не менее 5 мл до линии (MAX) на 10 секунд.
- Извлечь тест-полоску из емкости с мочой и положить на сухую горизонтальную поверхность.
- Оценить результат через 1-5 минут. Не интерпретировать результаты позднее 10 минут после внесения образца мочи.



FEAtest

REF

WR-009/2.12-53

- Тест-полоска, чувствительность 25 мМЕ/мл – 2 шт.
- Инструкция – 1 шт.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022. Комплект № 12. Тест для определения беременности на ранних сроках.



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА



• Результат анализа предвешен и не должен рассматриваться как единственное основание для постановки диагноза. Отрицательный результат теста не исключает вероятность беременности.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 25 мМЕ/мл

Экспресс-тест для определения хорионического гонадотропина (ХГЧ) в моче.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 100 %

Определение беременности с первого дня задержки менструации.

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ И ЯСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Результат известен уже через 1-5 минут.

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

11 лист 06

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова «07» 10 2024



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

«07» октября 2024 г.



Проект маркировки

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по

ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

Извещение № 1

2024 г.

Тест-полоска (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска, чувствительность
10 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT



+30°C

-30°C

IVD







или
Тест-полоска (дизайн s4)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Импловит

Тест-полоска, чувствительность
10 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT



+30°C

-30°C

IVD









Потребительская упаковка (дизайн 1)

или
Потребительская упаковка (дизайн s4)



Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт. Масса брутто

кг

Imbian

LOT




REF WR-009/1.1



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.



ИЛИ

Транспортная упаковка (дизайн s4)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество

шт. Масса брутто

кг

Импловит

LOT





REF WR-009/1.1-s4



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.



Тест-полоска (дизайн 1, s6)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска, чувствительность
15 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT













или

Тест-полоска (дизайн s4)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА 

Тест-полоска, чувствительность
15 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT















Потребительская упаковка (дизайн 1)

или

Потребительская упаковка (дизайн s4)



ИЛИ

Потребительская упаковка (дизайн s6)



Транспортная упаковка (дизайн 1)

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 2

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг

Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт.

Масса брутто

кг

Imbian

LOT




REF

WR-009/1.2



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до + 40 °С не более 10 суток.



или

Транспортная упаковка (дизайн S6)

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 2

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг

Масса нетто

кг

Количество

шт.

Масса брутто

кг

Imbian

LOT



REF

WR-009/1.2-s6



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.



Транспортная упаковка (дизайн s4)

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 2

ПУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

LOT

REF WR-009/1.2-s4

Импловит

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.л. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.

IVD

КОМПЛЕКТ № 3 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Тест-полоска (дизайн 1, s1, s2, s3, s5)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Тест-полоска, чувствительность
25 мМЕ/мл - 1 шт.

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT

IVD

Потребительская упаковка (дизайн 1)




Потребительская упаковка (дизайн s1)







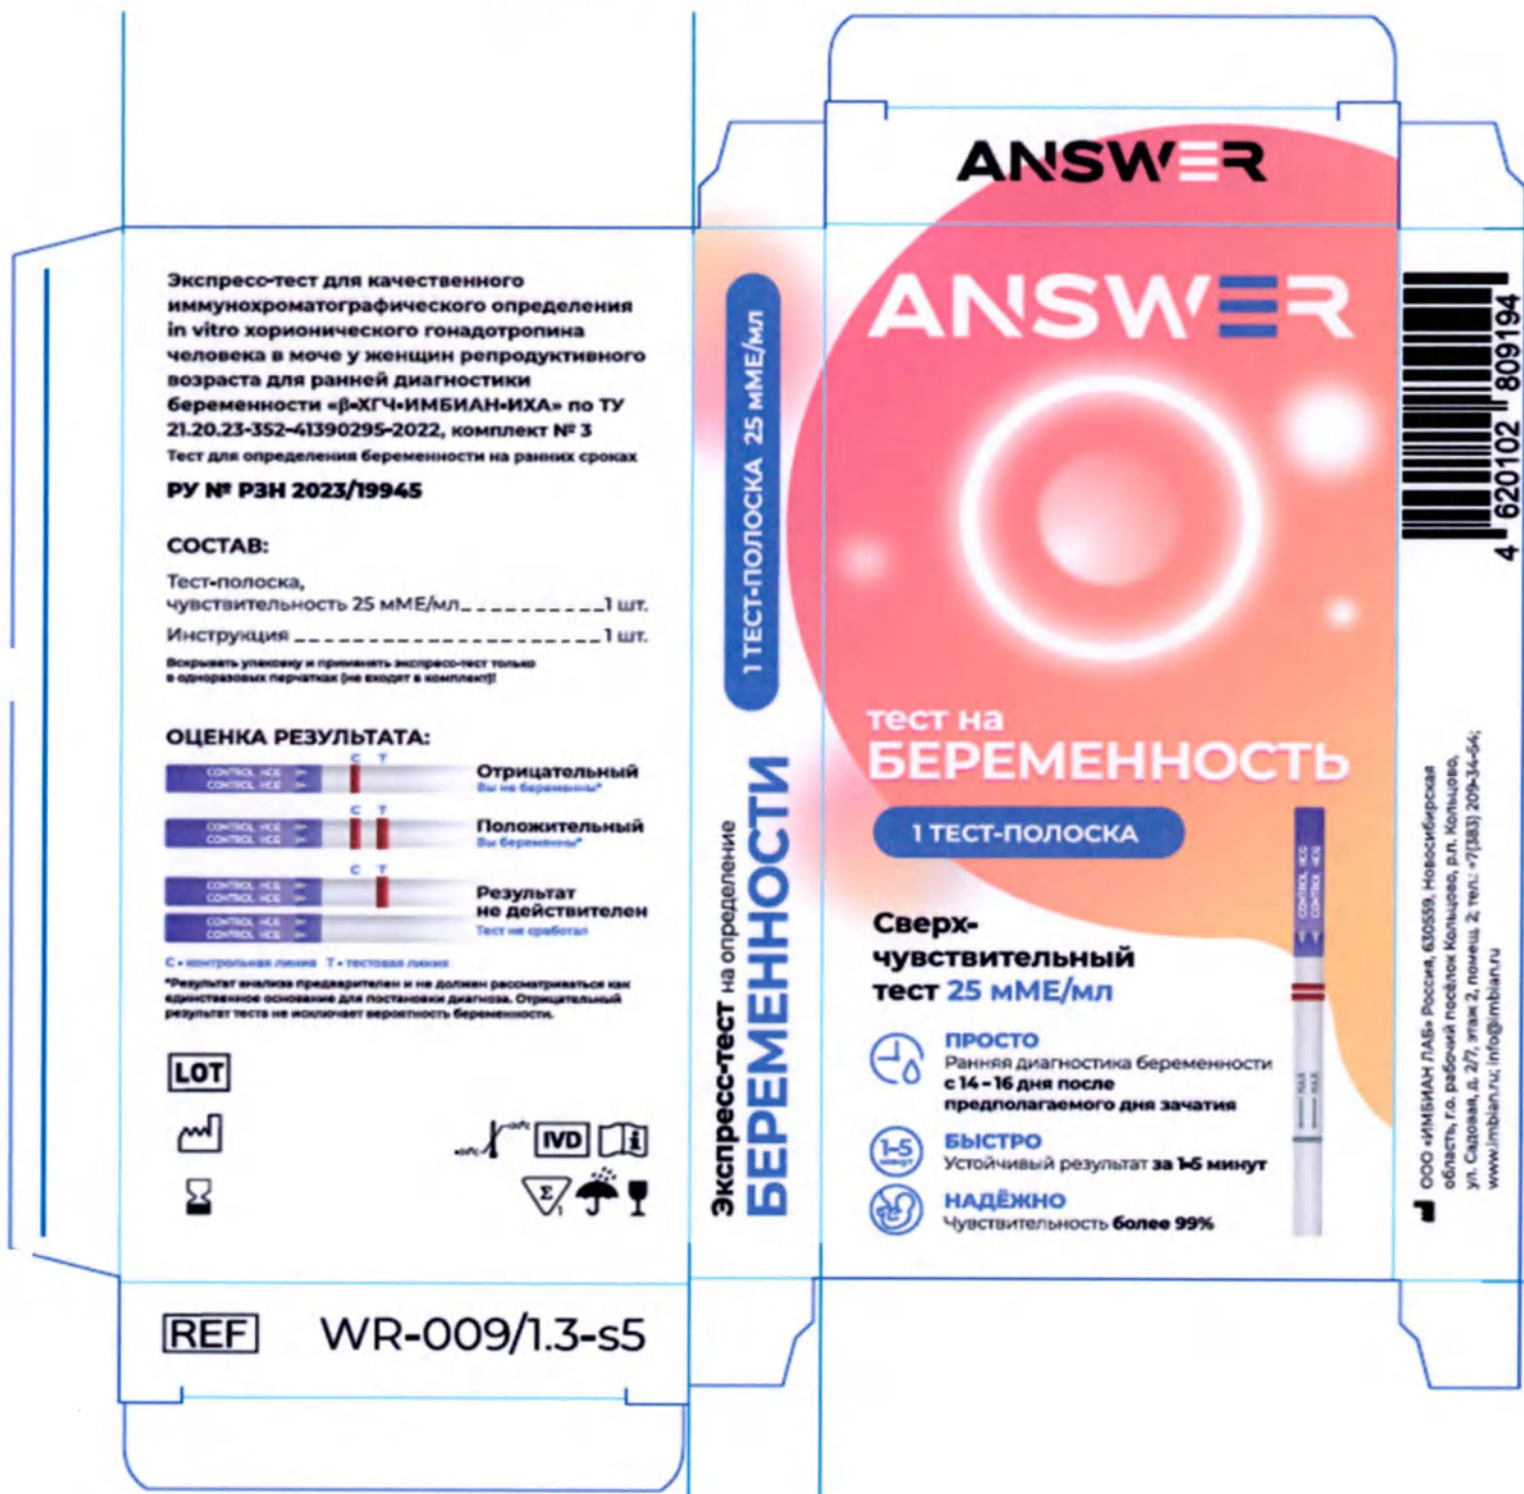


Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 3		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг

LOT REF	WR-009/1.3	 	Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbjan.ru
-------------------------------	------------	--	---

Допускается хранение и транспортирование при температуре до + 40 °С не более 10 суток.







Транспортная упаковка (дизайн s1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 3		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг

LOT REF	WR-009/3.1-s1	 	Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbjan.ru
-------------------------------	---------------	--	---

Замораживать не допускается!
ТУ 21.20.23-352-41390295-2022







Транспортная упаковка (дизайн s2)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 3		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru		    	
Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.		  	
LOT		REF WR-009/1.3-s2	

Транспортная упаковка (дизайн s3)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 3		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru		    	
Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.		  	
LOT		REF WR-009/1.3-s3	

Транспортная упаковка (дизайн s5)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Комплект № 3		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки Количество	кг шт.	Масса нетто Масса брутто	кг кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru			
Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.			

КОМПЛЕКТ № 4 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Тест-кассета (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета, чувствительность 10 мМЕ/мл - 1 шт.		ООО «ИМБИАН ЛАБ»	
LOT 			



Потребительская упаковка (дизайн 1)

Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Комплект № 4		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru		 LOT  REF WR-009/1.4   Допускается хранение и транспортирование при температуре до + 40 °С не более 10 суток.	
   			

КОМПЛЕКТ № 5 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ Тест-кассета (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета, чувствительность 15 мМЕ/мл - 1 шт.		ООО «ИМБИАН ЛАБ»	
 LOT 	    		



Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Комплект № 5		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru			
LOT			
REF WR-009/1.5			
Допускается хранение и транспортирование при температуре до + 40 °С не более 10 суток.		    	

КОМПЛЕКТ № 6 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ Тест-кассета (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»	
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета, чувствительность 25 мМЕ/мл - 1 шт.	
LOT	
	
    	



Потребительская упаковка (дизайн 1)

Транспортная упаковка (дизайн 1)

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 6

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг

Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт.

Масса брутто

кг

Imbian

LOT




REF

WR-009/1.6



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до + 40 °С не более 10 суток.



IVD



КОМПЛЕКТ № 7 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Струйный тест (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Струйный тест, чувствительность
10 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT





Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Комплект № 7		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru			
Допускается хранение и транспортирование при температуре до + 40 °С не более 10 суток.			

КОМПЛЕКТ № 8 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Струйный тест (дизайн 1, s2, s6, s7)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Струйный тест, чувствительность 15 мМЕ/мл - 1 шт.		ООО «ИМБИАН ЛАБ»	





REF WR-009/1.8-s6

REF

СТРУЙНАЯ КАСЕТА
С КОЛПАЧКОМ




Ранняя диагностика беременности,
не дожидаясь задержки
менструального цикла

KIDDYTEST
СТРУЙНЫЙ

Высокочувствительный
тест на беременность
УДОБНО • ЛЕГКО • ПРОСТО

66%
ТОЧНОСТЬ БОЛЕЕ • ТОЧНОСТЬ БОЛЕЕ • ТОЧНОСТЬ БОЛЕЕ • ТОЧНОСТЬ БОЛЕЕ



Высокочувствительный
струйный тест на беременность

СТРУЙНАЯ КАСЕТА
С КОЛПАЧКОМ

KIDDYTEST
СТРУЙНЫЙ


Высокочувствительный экспресс-тест на беременность
чувствительность 15 мМЕ/мл

- Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в одноразовых колпачках (они входят в комплект)!
- Предназначен для диагностики in vitro при профессиональном применении и самоконтроля с целью диагностики беременности на раннем сроке.

LOT



Диагностика беременности и трансформация при температуре до +40 °C не более 10 суток.

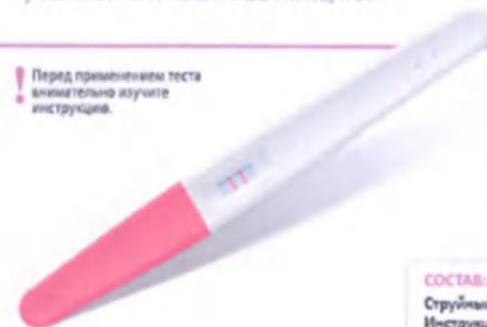

Перед применением теста
внимательно изучите
инструкцию.

Интерпретация результата

T C	НЕТ	T C	РЕЗУЛЬТАТ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
	Вы не беременны*		Тест не сработал
T C	ДА	T C	РЕЗУЛЬТАТ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
	Вы беременны*		С-контрольный элемент Т-тестовый элемент

*Результат можно подтвердить в лаборатории, исследовав кровь или мочу на содержание хГЧ. Для постановки диагноза. Отрицательный результат теста не исключает возможность беременности.

СОСТАВ:
Струйный тест, чувствительность 15 мМЕ/мл — 1 шт.
Инструкция — 1 шт.


Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «И-ХГЧ-ИМБИАН-НОА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022.
Комплект № В. Тест для определения беременности на ранних сроках.
РУ № РЗН 2023/19945

Иготовители:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630558, Россия, Новосибирская область, г.д. рабочий поселок Колырьево, р.п. Колырьево, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbjan.ru

Официальный дистрибьютор:
ООО «БТК», 194156, Санкт-Петербург, пр. Звездный, дом № 34, лит.В, пом. 14-Н btk-med.ru, sideb@mail.ru



Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 8		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru		    	
Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.		 	
LOT		REF	WR-009/1.8

Транспортная упаковка (дизайн s2)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 8		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru		    	
Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.		 	
LOT		REF	WR-009/1.8-s2

Транспортная упаковка (дизайн s6)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 8		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru			
LOT			
REF WR-009/1.8-s6			
Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.		   	


Транспортная упаковка (дизайн s7)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 8		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru			
LOT			
REF WR-009/1.8-s7			
Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.		   	

КОМПЛЕКТ № 9 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ
Струйный тест (дизайн 1, S5, s7)





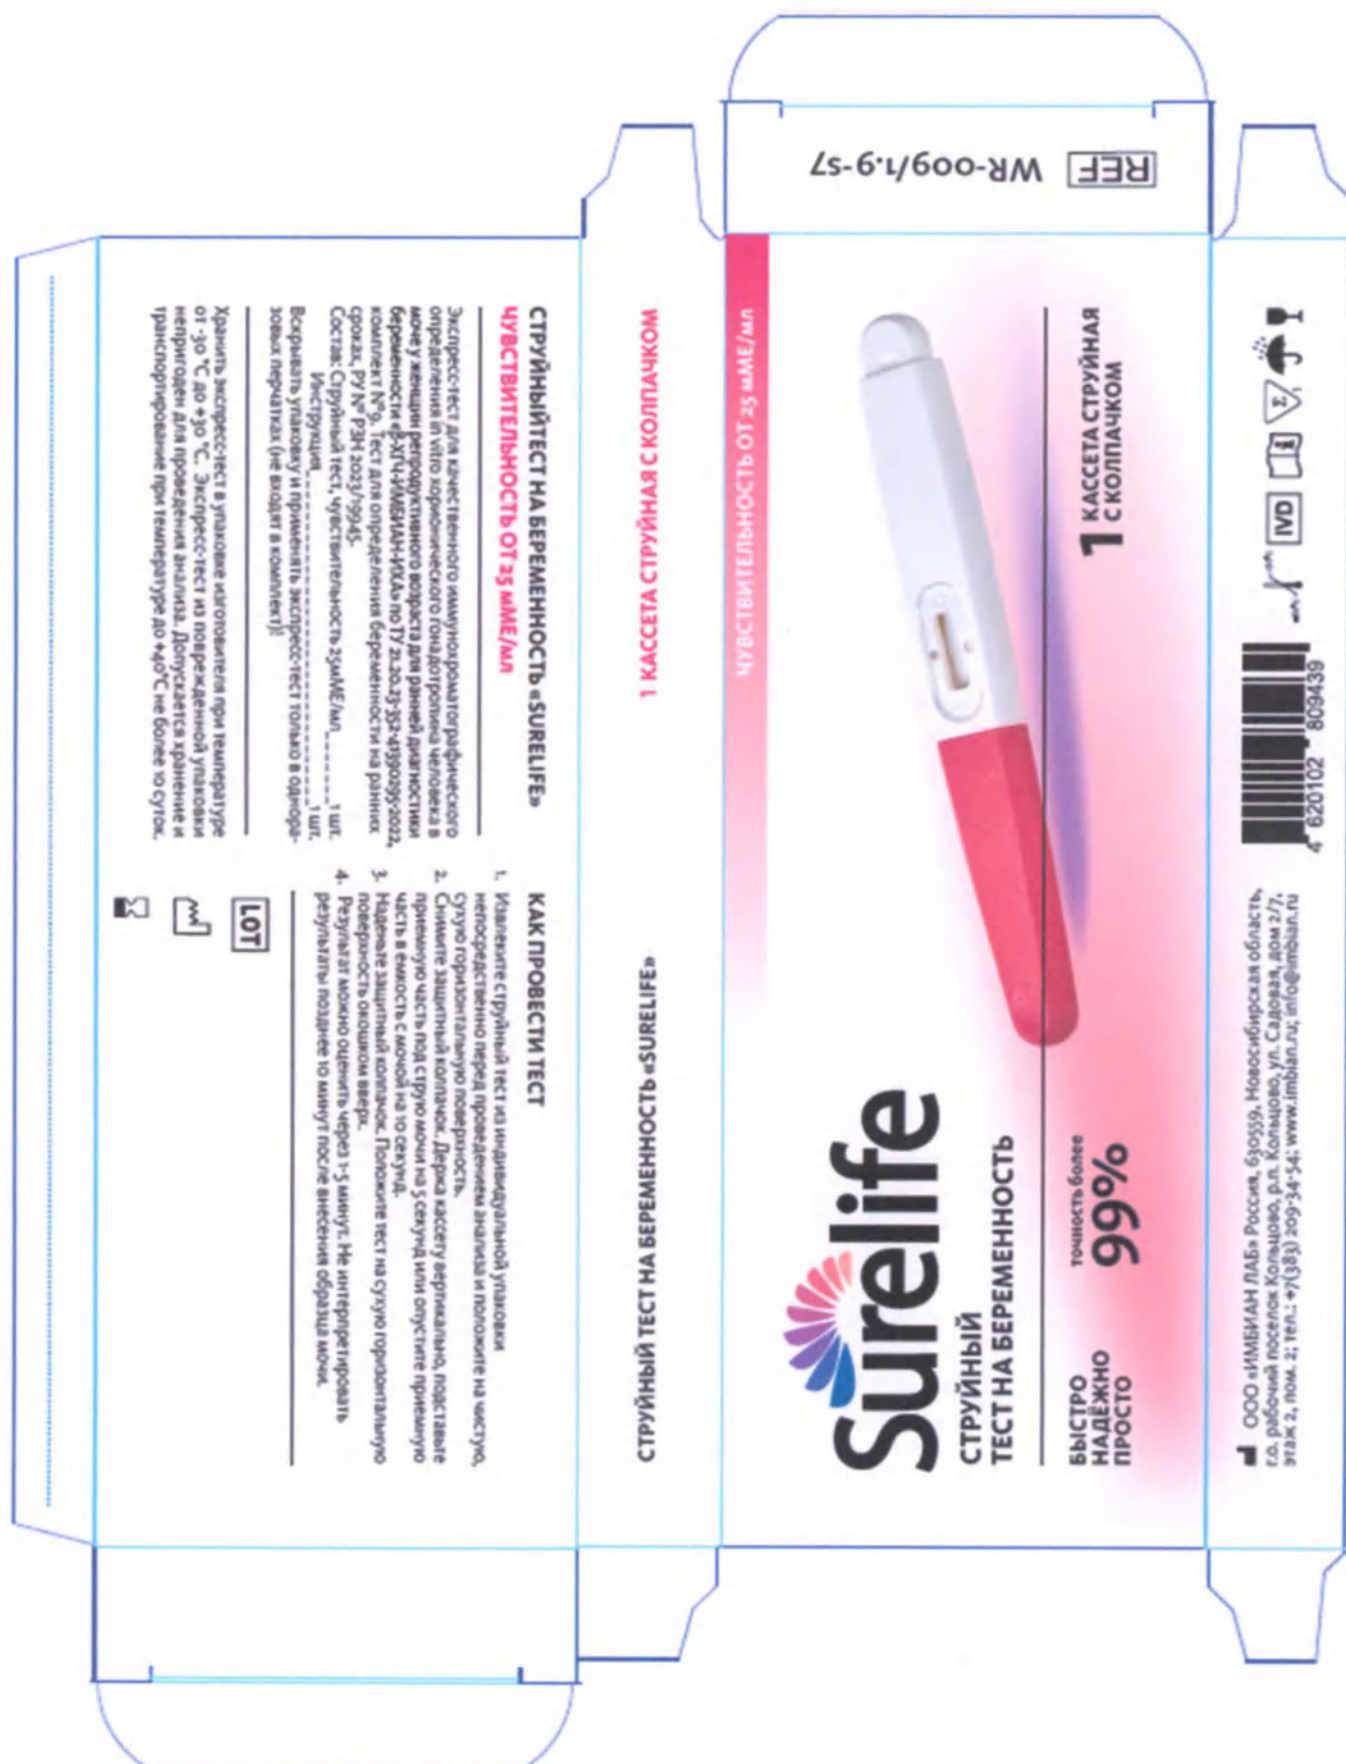

Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 9

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт. Масса брутто

кг

Imbian

LOT




REF

WR-009/1.9



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.



IVD



Транспортная упаковка (дизайн s5)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 9

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт. Масса брутто

кг

Imbian

LOT




REF

WR-009/1.9-s5



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.



IVD



Транспортная упаковка (дизайн s7)


β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Комплект № 9		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг
Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru			
LOT			
REF WR-009/1.9-s7			
Допускается хранение и транспортирование при температуре до + 40 °С не более 10 суток.		   	

КОМПЛЕКТ № 10 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Тест-полоска (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»	
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска, чувствительность 10 мМЕ/мл - 1 шт.	
LOT	
	    

Тест-полоска (дизайн s4)

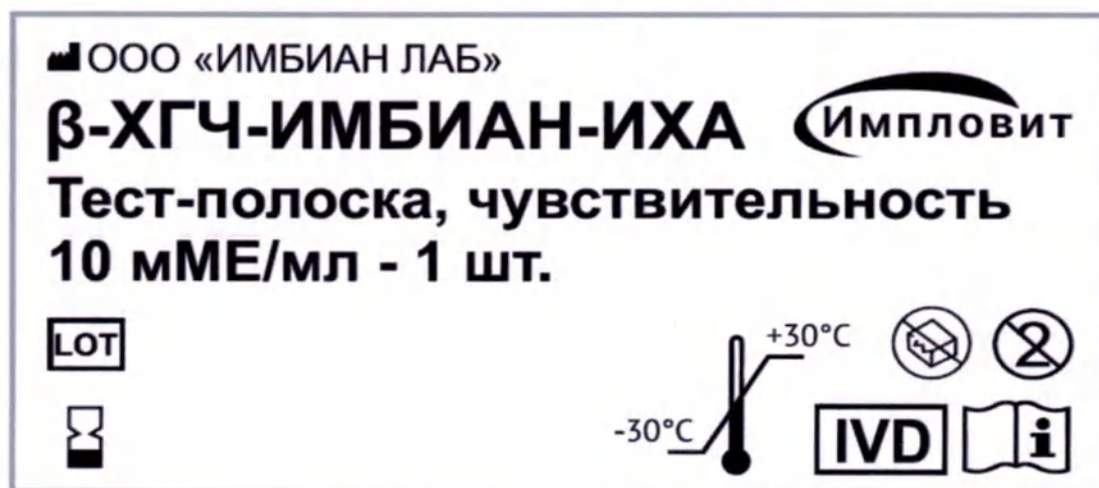

Потребительская упаковка (дизайн 1)



Потребительская упаковка (дизайн s4)



Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 10

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт. Масса брутто

кг

Imbian

LOT




REF

WR-009/2.10



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.



IVD



Транспортная упаковка (дизайн s4)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 10

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество

шт. Масса брутто

кг

Импловит

LOT




REF

WR-009/2.10-s4



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.



IVD



Тест-полоска (дизайн 1, s6)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Тест-полоска, чувствительность
15 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT







IVD 

Тест-полоска (дизайн s4)


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА 

Тест-полоска, чувствительность
15 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT







IVD 



Потребительская упаковка (дизайн s4)





Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 11		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг

LOT REF	WR-009/2.11	 	Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru
-------------------------------	-------------	--	---

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.







Транспортная упаковка (дизайн s4)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 11		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

LOT REF	WR-009/2.11-s4	 	Импловит ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru
-------------------------------	----------------	--	---

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.







Транспортная упаковка (дизайн s6)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 11

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество

шт. Масса брутто

кг

LOT



REF

WR-009/1.11-s6



Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.



IVD



Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

КОМПЛЕКТ № 12 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Тест-полоска (дизайн 1, s2, s3, s5)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска, чувствительность 25 мМЕ/мл - 1 шт.

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

LOT



IVD









Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022, комплект № 12
Тест для определения беременности на ранних сроках
РУ № РЗН 2023/19945

СОСТАВ:

Тест-полоска, чувствительность 25 мМЕ/мл 2 шт.
Инструкция 1 шт.

Вскрыть упаковку и применить экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входит в комплект)

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

CONTROL: HCG CONTROL: HCG	C T	Отрицательный Вы не беременны*
CONTROL: HCG CONTROL: HCG	C T	Положительный Вы беременны*
CONTROL: HCG CONTROL: HCG	C T	Результат не действителен Тест не работает

C - контрольная линия T - тестовая линия

*Результат анализа предварителен и не должен рассматриваться как единственное основание для постановки диагноза. Отрицательный результат теста не исключает вероятность беременности.

LOT



REF WR-009/2.12-s5

2 ТЕСТ-ПОЛОСКИ 25 мМЕ/мл

Экспресс-тест на определение
БЕРЕМЕННОСТИ

ANSWER

ANSWER

тест на
БЕРЕМЕННОСТЬ

2 ТЕСТ-ПОЛОСКИ

Сверх-чувствительный
тест 25 мМЕ/мл



ПРОСТО

Ранняя диагностика беременности с 14 - 16 дня после предполагаемого дня зачатия




БЫСТРО

Устойчивый результат за 1-5 минут



НАДЕЖНО

Чувствительность более 99%



4 620102 809231

ООО «ИМБИАН ЛАБ» Россия, 630539, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колыцово, рп. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, тел.: +7(383) 209-34-64; www.imbian.ru, info@imbjan.ru

Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 12		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

LOT		Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru
REF WR-009/2.12		

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

-30°C


IVD





Транспортная упаковка (дизайн s2)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 12		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

LOT		Imbian ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru
REF WR-009/2.12-s2		

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

-30°C


IVD





Транспортная упаковка (дизайн s3)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 12		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

LOT 

REF WR-009/2.12-s3 

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru



IVD





Транспортная упаковка (дизайн s5)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 12		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

LOT 

REF WR-009/2.12-s5 

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до +40 °С не более 10 суток.

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru




IVD





Тест-кассета (дизайн 1)

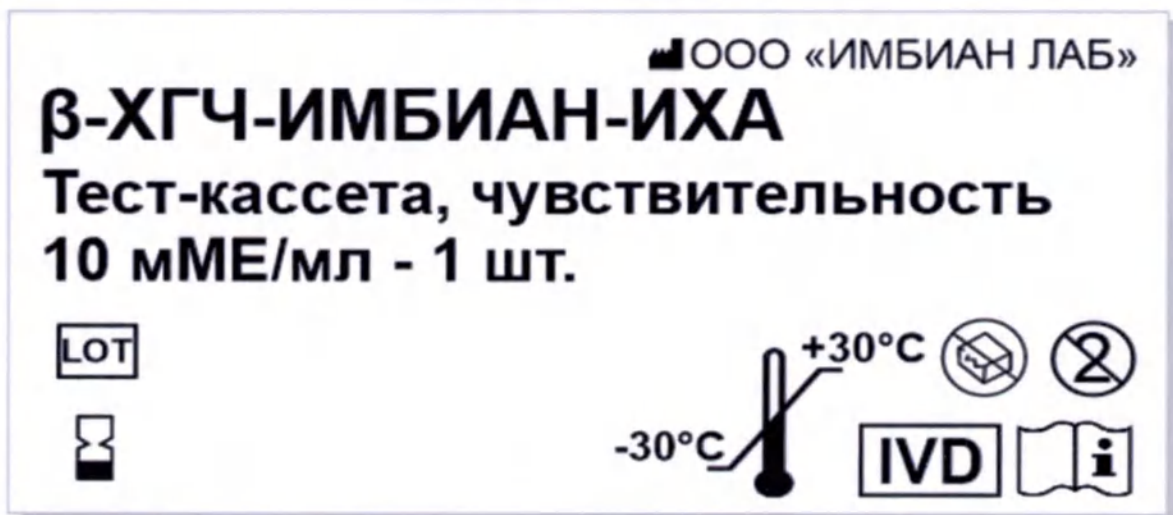


Потребительская упаковка (дизайн 1)



Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Комплект № 13		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг
LOT			
REF WR-009/2.13			
Допускается хранение и транспортирование при температуре до + 40 °С не более 10 суток.		    	
 ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru			

КОМПЛЕКТ № 14 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ
 Тест-кассета (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета, чувствительность 15 мМЕ/мл - 1 шт.		 ООО «ИМБИАН ЛАБ»	
LOT			
		 	
			



Транспортная упаковка (дизайн 1)

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 14

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто кг

Количество
наборов

шт. Масса брутто кг

Imbian

LOT



REF

WR-009/2.14



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до + 40 °С не более 10 суток.



КОМПЛЕКТ № 15 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ
Тест-кассета (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Тест-кассета, чувствительность
25 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT



Весь день о грядущем и будущем восторг и на развешенном

Aspirin is superior to placebo



КОМПЬЮТЕР № 15

ВСТАНОВЛЕНА ВЪВЕДЕНИЕ 25 МАЯ/МН

СОСТАВ:

Lot

Экспресс-тест для качественного и количественного графического определения в моче у женщин репродуктивного возраста гормонального гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ ЗБ 20.27-352-41 39 0296-2022

no ty 2 2023-32-4139 0296-2022

596615202 HED IN AD

Only 3.5% of the sample was in the 18-24 age group, and 10.5% were in the 25-34 age group. The majority of the sample (66%) was in the 35-44 age group, and 19.5% were in the 45-54 age group.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



1 620 102 809 583



Беременность

**Специализированный тест
для определения безопасности
25 name/box**

2 ТЕСТ-КАССЕТЫ



REF WR-009/2.15

Stop what's probably a type error but report the
error as a type error, regardless (as in case 3 above).

Транспортная упаковка (дизайн 1)

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 15

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт. Масса брутто

кг

Imbian

LOT



REF WR-009/2.15



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до + 40 °С не более 10 суток.



IVD



КОМПЛЕКТ № 16 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Струйный тест (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Струйный тест, чувствительность
10 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT



Потребительская упаковка (дизайн 1)



Транспортная упаковка (дизайн 1)

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 16

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт. Масса брутто

кг

Imbian

LOT



REF WR-009/2.16



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до + 40 °С не более 10 суток.



КОМПЛЕКТ № 17 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Струйный тест (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Струйный тест, чувствительность
15 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT





Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Комплект № 17		Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022	
РУ № РЗН 2023/19945			
Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг
LOT			
REF WR-009/2.17			
Допускается хранение и транспортирование при температуре до + 40 °С не более 10 суток.		    	
 ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2. +7 (383) 209-34-54 www.imbian.ru info@imbian.ru			

КОМПЛЕКТ № 18 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Струйный тест (дизайн 1)

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА Струйный тест, чувствительность 25 мМЕ/мл - 1 шт.		 ООО «ИМБИАН ЛАБ»	
LOT			 
			



Потребительская упаковка (дизайн 1)

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 18

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг

Масса нетто

кг

Количество
наборов

шт.

Масса брутто

кг

Imbian

LOT



REF

WR-009/2.18



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до + 40 °С не более 10 суток.



IVD



КОМПЛЕКТ № 19 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

Тест-кассета (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Тест-кассета, чувствительность
10 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT



IVD



Потребительская упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 19

Тест для определения беременности на ранних сроках

1. Тест-кассета, чувствительность 10 мМЕ/мл
2. Инструкция

РУ № РЗН 2023/19945

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

LOT

20 шт.
1 шт.

REF


WR-009/20.19

Imbian



4 620102 809651





Транспортная упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 19

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество наборов	шт.	Масса брутто	кг

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

LOT





20 шт.
1 шт.

REF

WR-009/20.19

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование при температуре до + 40 °С не более 10 суток.

КОМПЛЕКТ № 20 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ
Тест-кассета (дизайн 1)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА

Тест-кассета, чувствительность
10 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT



Потребительская упаковка (дизайн 1)

β-ХГЧ- ИМБИАН-ИХА Комплект № 20

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

Тест для определения беременности
на ранних сроках

1. Тест-кассета, чувствительность 10 мМЕ/мл
2. Инструкция

50 шт.
1 шт.

LOT



REF

WR-009/50.20

РУ № РЗН 2023/19945

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только
в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

Допускается хранение и транспортирование при
температуре до +40 °С не более 10 суток.

Imbian



**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 20

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Масса нетто
упаковки

кг Масса нетто кг

Количество
наборов

шт. Масса брутто кг

LOT



REF


WR-009/50.20



Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Допускается хранение и транспортирование
при температуре до + 40 °С не более 10 суток.



IVD



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

69 лист 06

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова "07" 10 2024 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



Осипова В.В.


«13» сентября 2024 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

2024 г.

В состав Комплекта № 1 входят следующие компоненты:
Тест-полоска

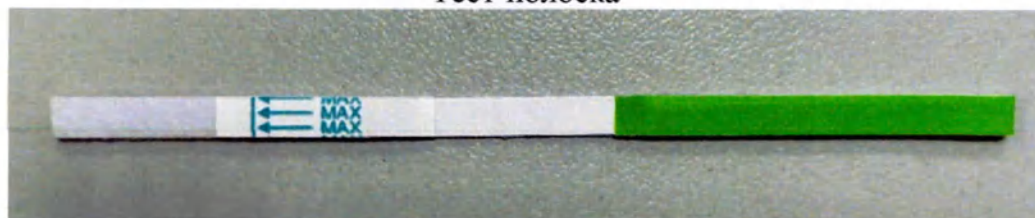


Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой
(дизайн 1)



ИЛИ
(дизайн s4)



Потребительская упаковка
(дизайн 1)

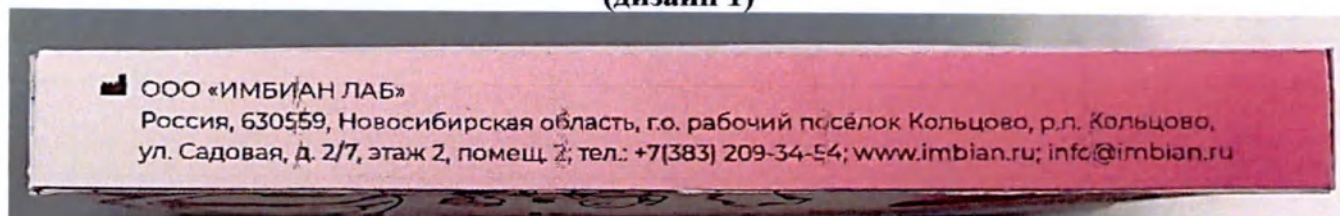




Допускается хранение и транспортирование при температуре до $+40^{\circ}\text{C}$ не более 10 суток.

2027.01.09

Тест для определения беременности на ранних сроках




Беременность

Сверхчувствительный тест
для определения беременности
10 мМЕ/мл


1 ТЕСТ-ПОЛОСКА




ЭКСПРЕСС-ТЕСТ БЕРЕМЕННОСТЬ

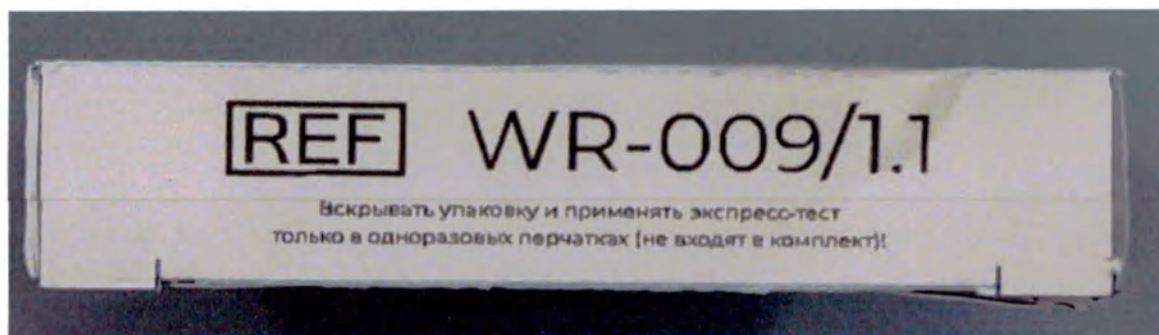

Потребительская упаковка
(дизайн s4)

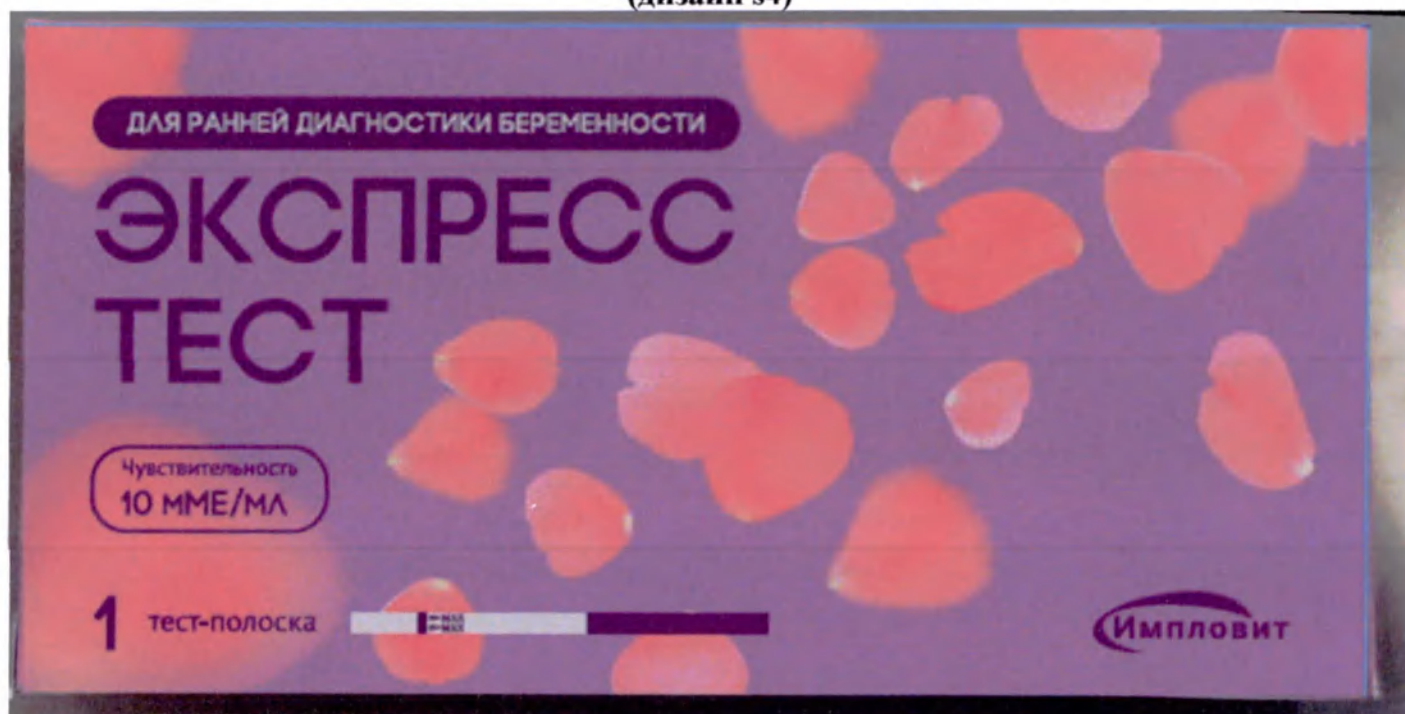


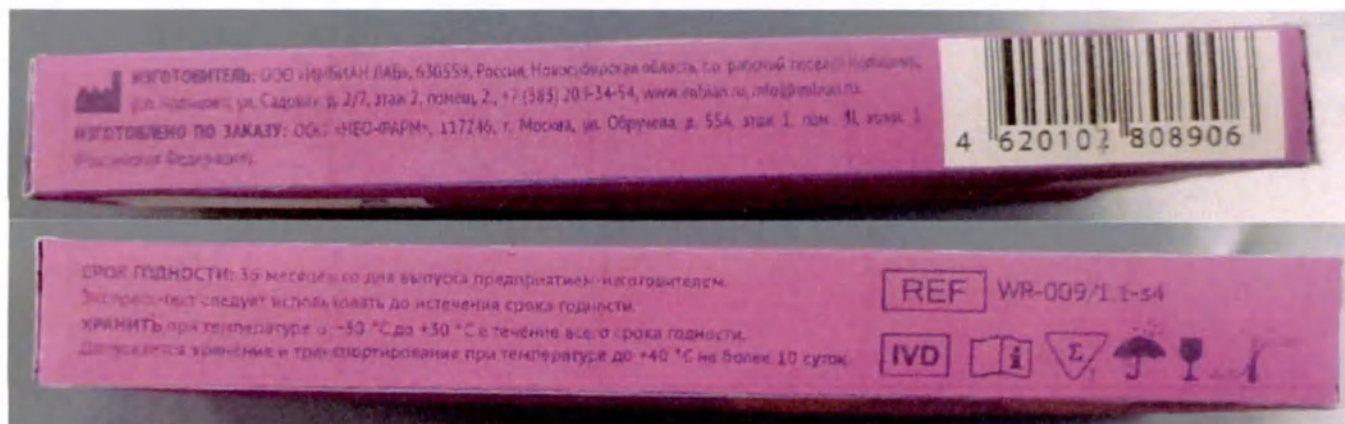

Комплект № 1 (дизайн 1)




Или
Комплект № 1 (дизайн s4)

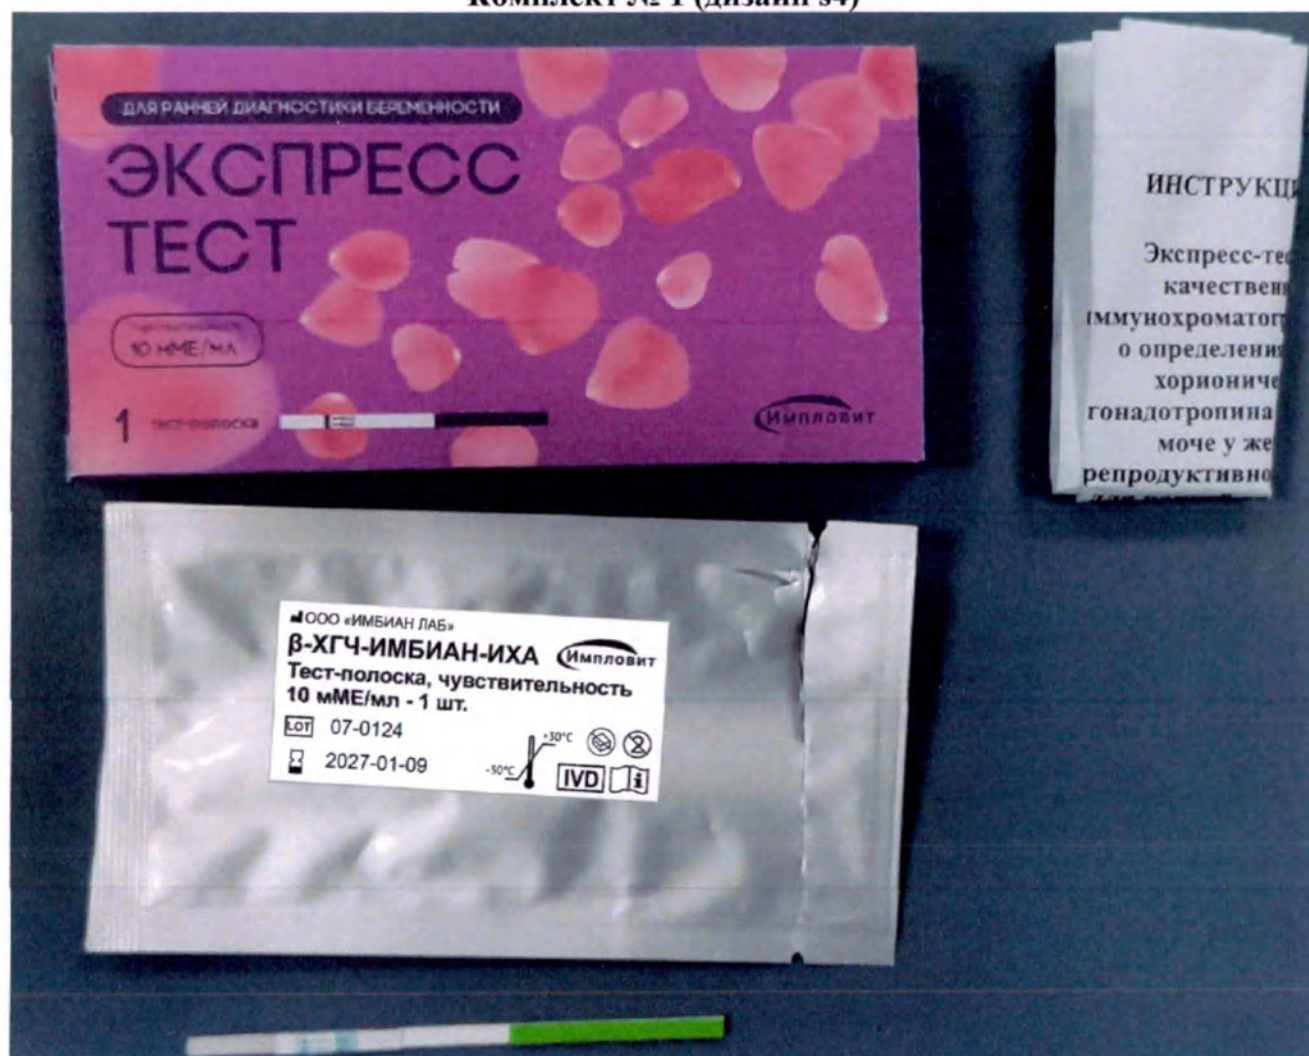

КОМПЛЕКТ № 2 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ


В состав Комплекта № 2 входят следующие компоненты:

Тест-полоска

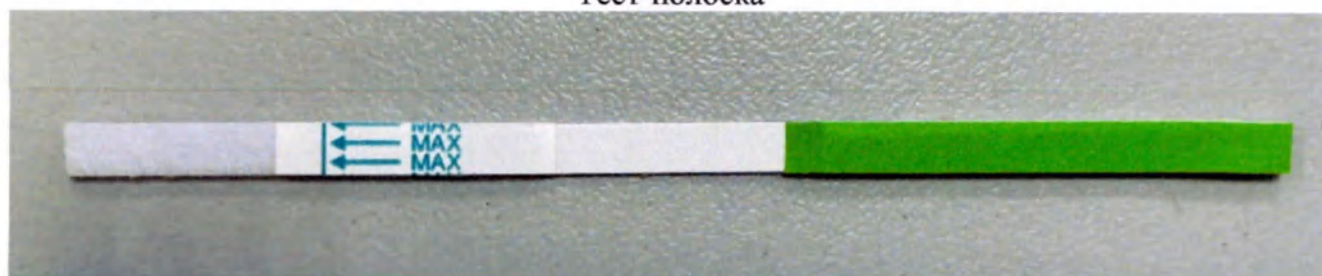

Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой

Тест-полоска (дизайн 1, s6)

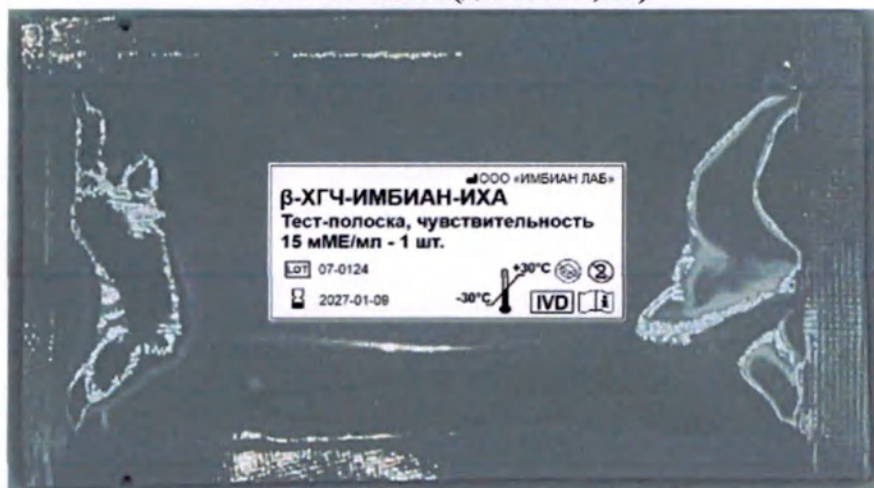


или

Тест-полоска (дизайн s4)



Потребительская упаковка
(дизайн 1)



Беременность

Сверхчувствительный тест
для определения беременности
15 мМЕ/мл

1 ТЕСТ-ПОЛОСКА



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40° С не более 10 суток

LOT 07-0124

СОСТАВ:

КОМПЛЕКТ № 2

2024-01-10


Тест-полоска, чувствительность 15 мМЕ/мл 1 шт.

Инструкция 1 шт.


2027-01-09

Результат через 1-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках




ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

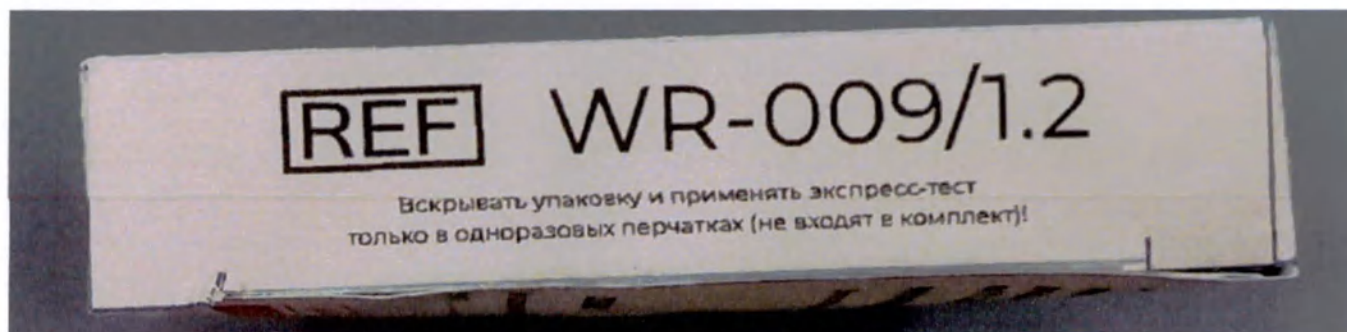

или

Потребительская упаковка (дизайн s4)



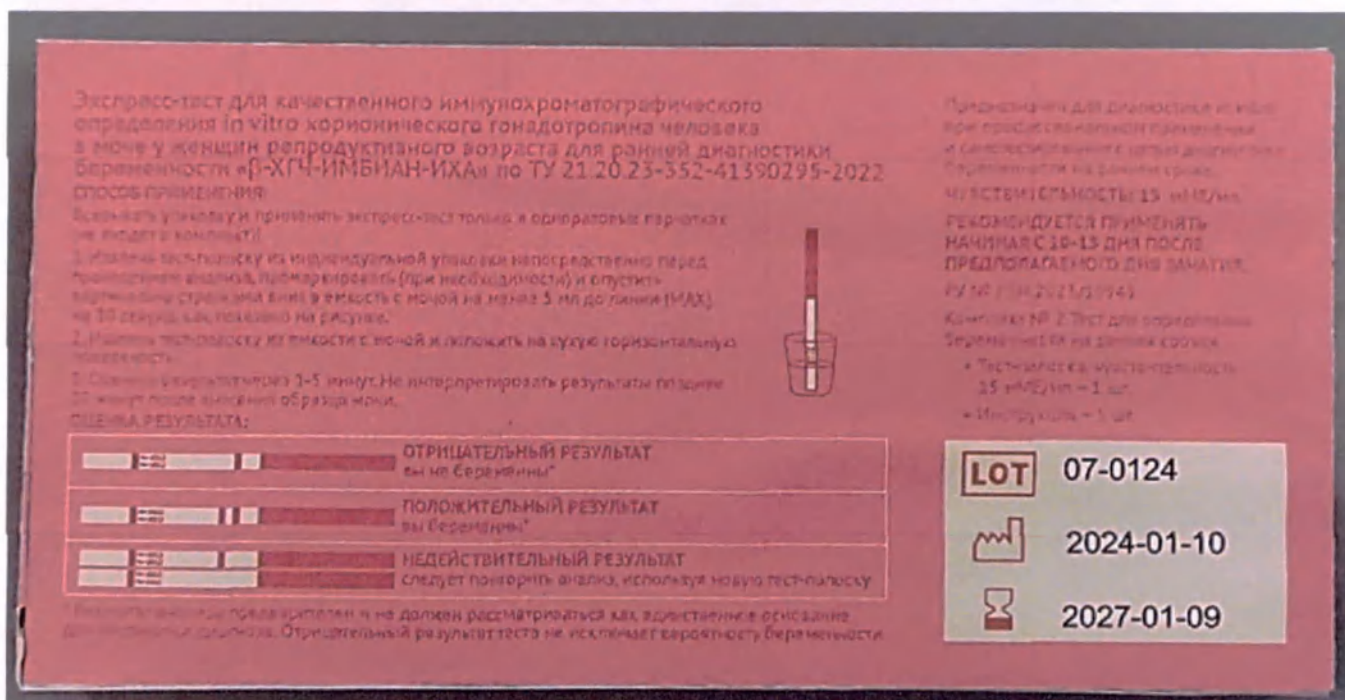

ИЛИ

Потребительская упаковка (дизайн сб)



KiDDY TEST

CLASSIC

СОСТАВ:



Тест-полоска, чувствительность 15 мМЕ/мл 1 шт.
Инструкция 1 шт.

- Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входит в комплект)!
- Предназначен для диагностики *in vitro* при профессиональном применении и самотестировании с целью диагностики беременности на раннем сроке.

LOT 07-0124

2024-01-10

2027-01-09



Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °C не более 10 суток.

Экспресс-тест на беременность
высокой точности
чувствительность 15 мМЕ/мл

- Перед применением теста внимательно изучите инструкцию.



Интерпретация результата

T C — — НЕТ Вы не беременны*	T C — — РЕЗУЛЬТАТ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН Тест не сработал
T C — — ДА Вы беременны*	T C — — C — контрольная линия T — тестовая линия

*Результат анализа предпринимать и не должен рассматриваться как единственное основание для постановки диагноза. Отрицательный результат теста не исключает вероятность беременности.

Изготовитель:


ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Колызово, р.п. Колызово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54,
www.imbian.ru, info@imbjan.ru

Официальный дистрибьютор:

ООО «БТК», 194156,
Санкт-Петербург г, пр. Энгельса,
дом № 34, лит.В, пом. 14-Н
btk-med.ru, sidek@mail.ru

1 ТЕСТ-ПОЛОСКА

Высокочувствительный
тест на беременность,
точность более 99%

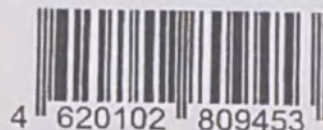


Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022. Комплект № 2. Тест для определения беременности на ранних сроках.


РУ № РЗН 2023/19945




REF WR-009/1.2-s6

Комплект № 2 (дизайн 1)

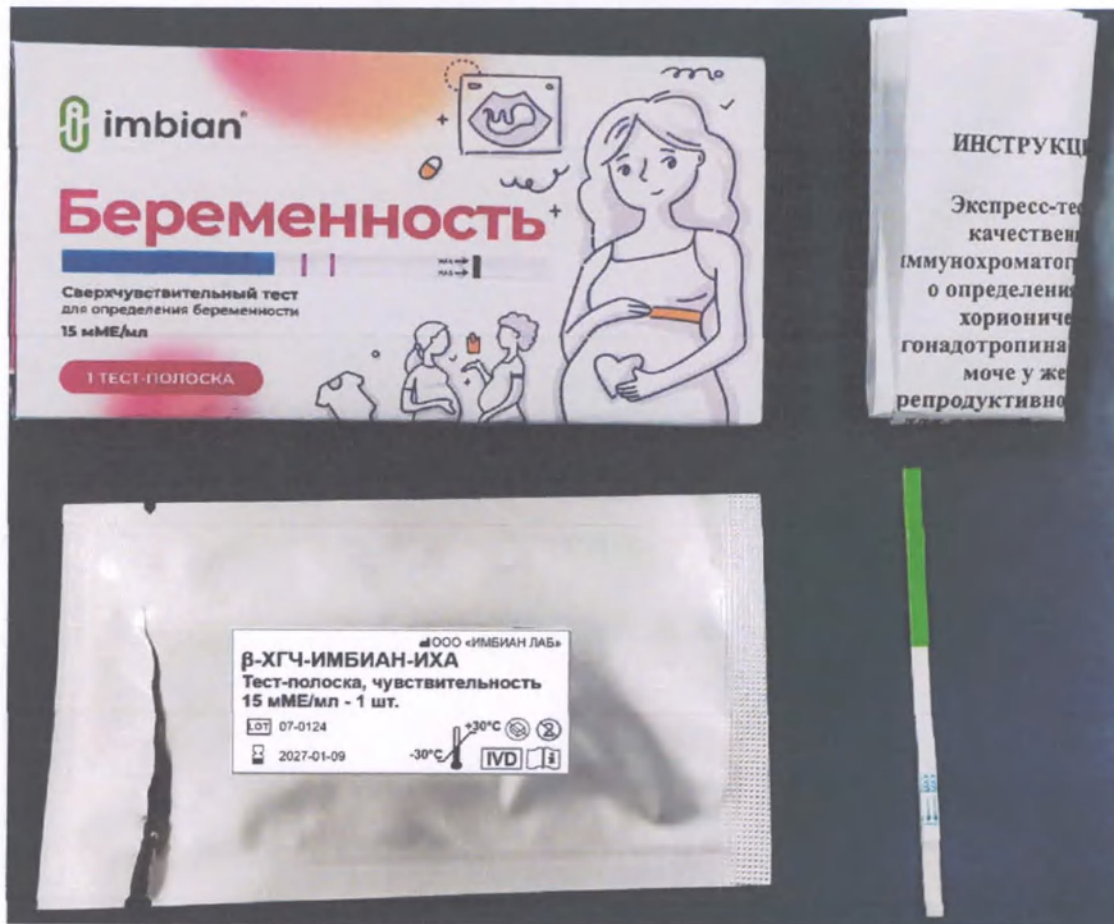

Комплект № 2 (дизайн s4)

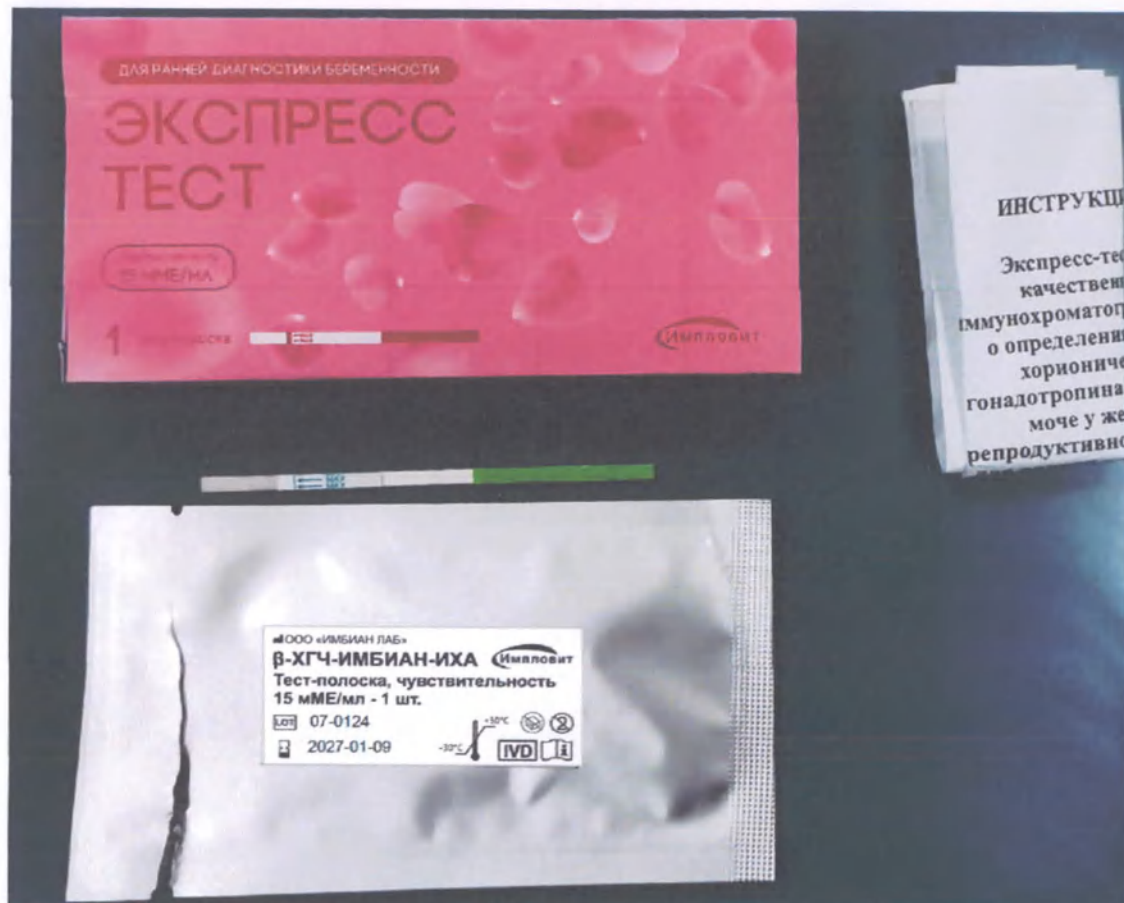


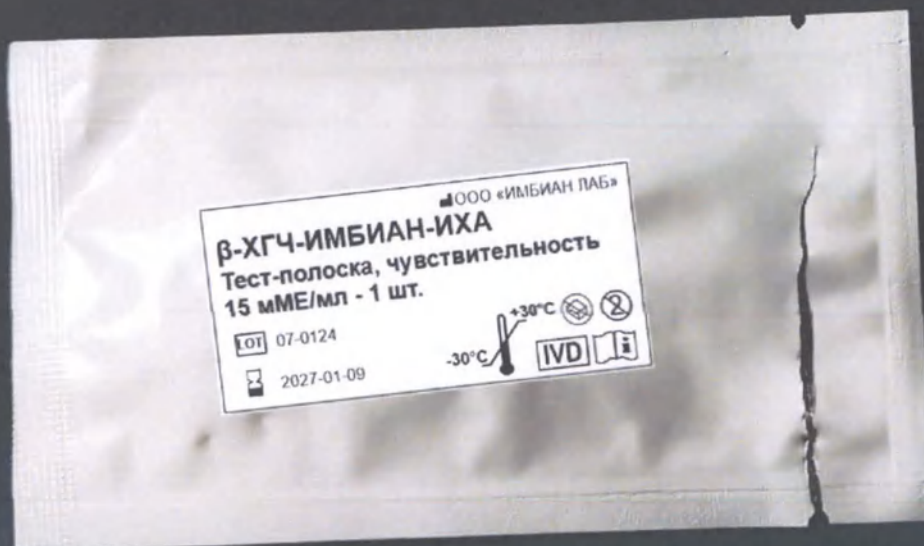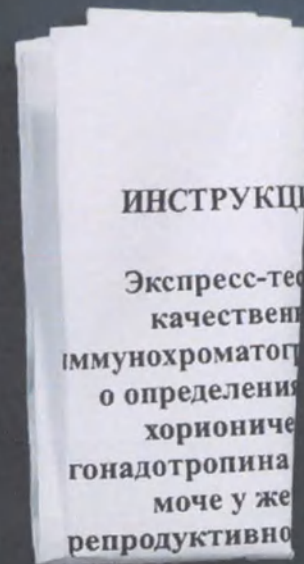

КОМПЛЕКТ № 3 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 3 входят следующие компоненты:

Тест-полоска

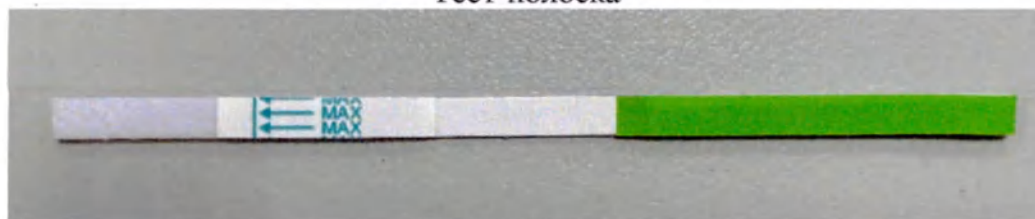

Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой

Тест-полоска (дизайн 1, s1, s2, s3, s5)



Потребительская упаковка (дизайн 1)



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.

LOT 07-0124

СОСТАВ:

КОМПЛЕКТ № 3

2024-01-10


Тест-полоска, чувствительность 25 мМЕ/мл ----- 1 шт.

2027-01-09

Инструкция ----- 1 шт.

Результат через 1-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий пос. Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbiam.ru



REF WR-009/1.3

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест
только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ

ИЛИ

Потребительская упаковка (дизайн s1)

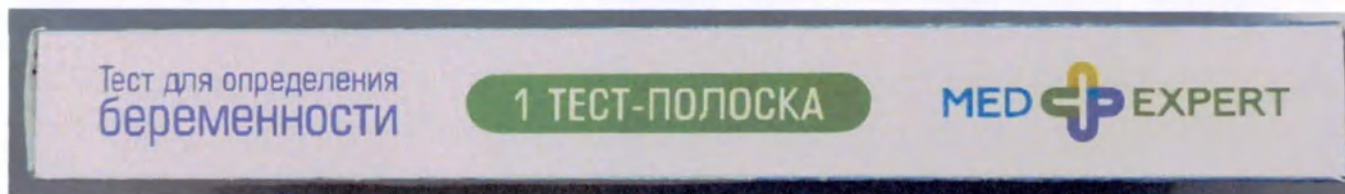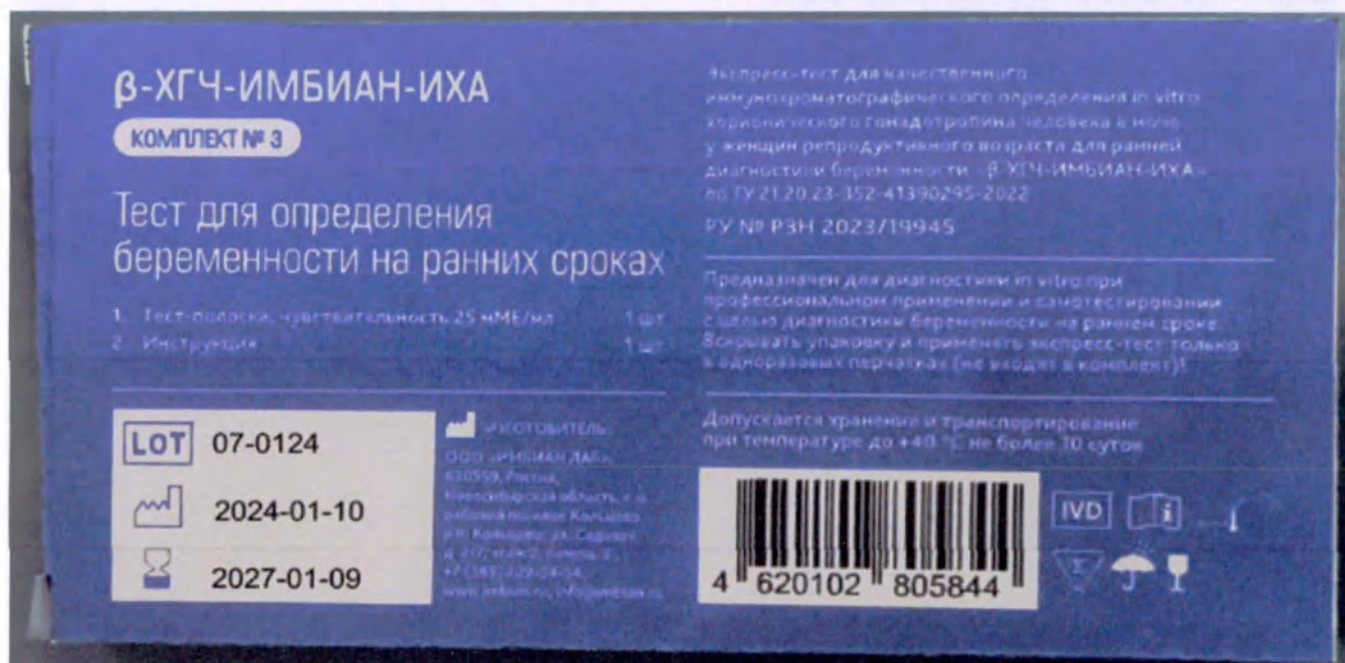



ИЛИ

Потребительская упаковка (дизайн s2)



ProGnoStick

Комплект № 3

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

- ✓ ТЕСТ-ПОЛОСКА,
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
25 мМЕ/МЛ — 1 ШТ.
- ✓ ИНСТРУКЦИЯ — 1 ШТ.

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!
Перед применением внимательно изучите инструкцию-вкладыш. Готово к использованию. Срок годности 36 месяцев.
Хранение экспресс-тестов в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от -30°C до +30°C в течение
всего срока годности. Не использовать по истечении срока годности!
Производитель/Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колыцово, р.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2.
+7 (383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbjan.ru.

07-0124 10

2027-01-09

WR-009/1.3-s2 LDT 07-0124

ПРОЦЕДУРА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА

ПРОЦЕДУРА

Погрузите
тест-полоску
вертикально
в емкость
с мочой
до отметки,
указанной
стрелками,
на 10 секунд.



РЕЗУЛЬТАТ

Вы беременны

Вы не беременны

Ошибочный


Ошибочный



ProGnoStick

ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ
С ПЕРВОГО ДНЯ ЗАДЕРЖКИ

1 ТЕСТ-ПОЛОСКА



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного
возраста для ранней диагностики беременности «В-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.25-352-41390.795-2022. РУ № РЗН 2025/19945




ProGnoStick

ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

1 ТЕСТ-
ПОЛОСКА

ИЛИ

Потребительская упаковка (дизайн s3)

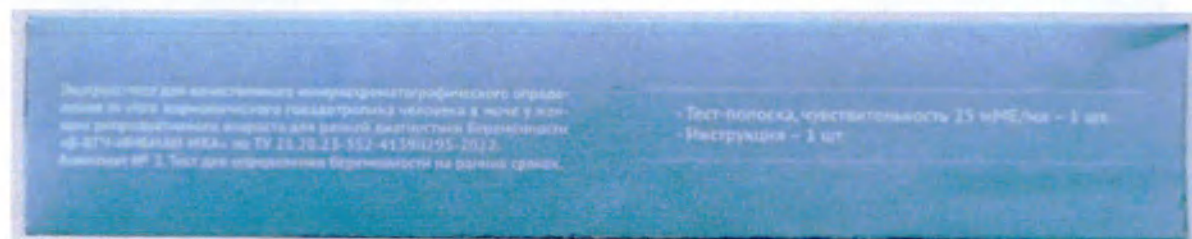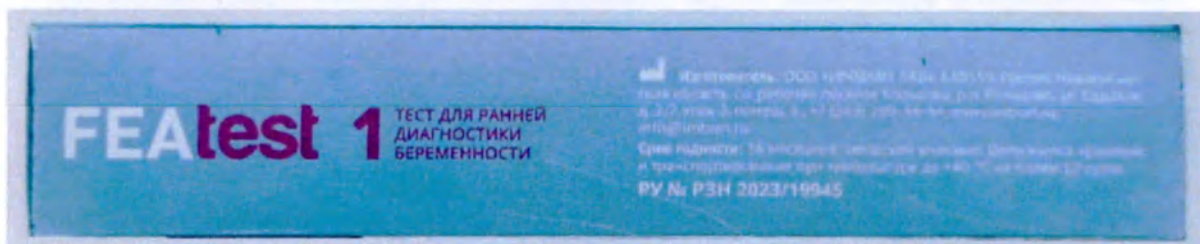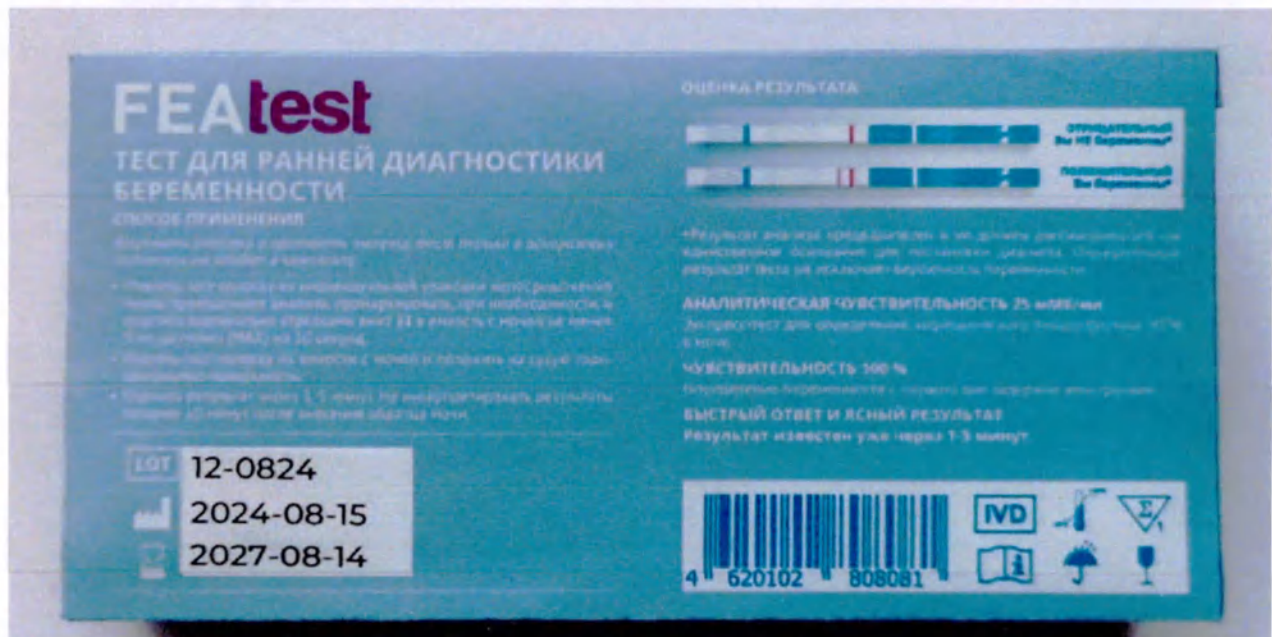



ИЛИ

Потребительская упаковка (дизайн s5)




Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro хорионического гонадотропина
человека в моче у женщин репродуктивного
возраста для ранней диагностики
беременности «Р-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ
21.20.23-352-41390295-2022, комплект № 3
Тест для определения беременности на ранних сроках
РУ № РЗН 2023/19945

СОСТАВ:

Тест-полоска,
чувствительность 25 мМЕ/мл 1 шт.
Инструкция 1 шт.

Вскрыть упаковку и применить экспресс-тест только
в соответствии с инструкцией (не выходя из упаковки)

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

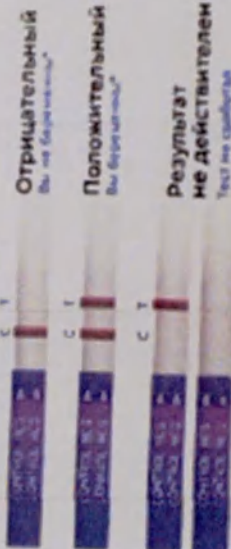


C - контрольная линия T - тестовая линия

*Результат анализа подтверждаем и не должен рассматриваться как
единственный основание для постановки диагноза. Отрицательный
результат теста не исключает вероятность беременности.

LOT 07-0124

2024-01-10

2027-01-09



ООО «ИМБИАН ЛАБ» Россия, 630559, Новосибирская
область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54;
www.imbian.ru; info@imbian.ru



Экспресс-тест на определение
БЕРЕМЕННОСТИ


1 ТЕСТ-ПОЛОСКА 25 мМЕ/мл

ANSWER

REF

WR-009/1.3-s5


Комплект № 3 (дизайн 1)

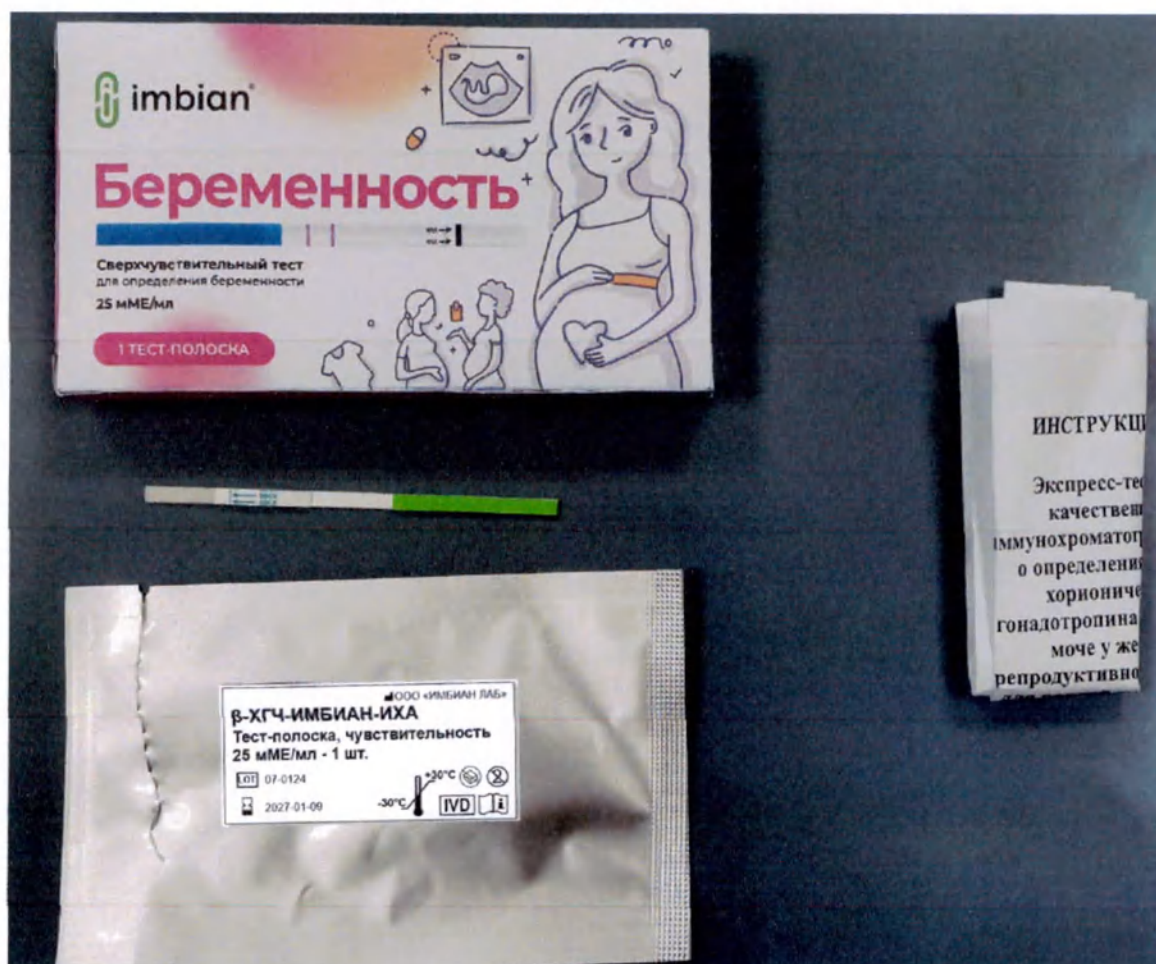


Комплект № 3 (дизайн s1)




Комплект № 3 (дизайн s2)

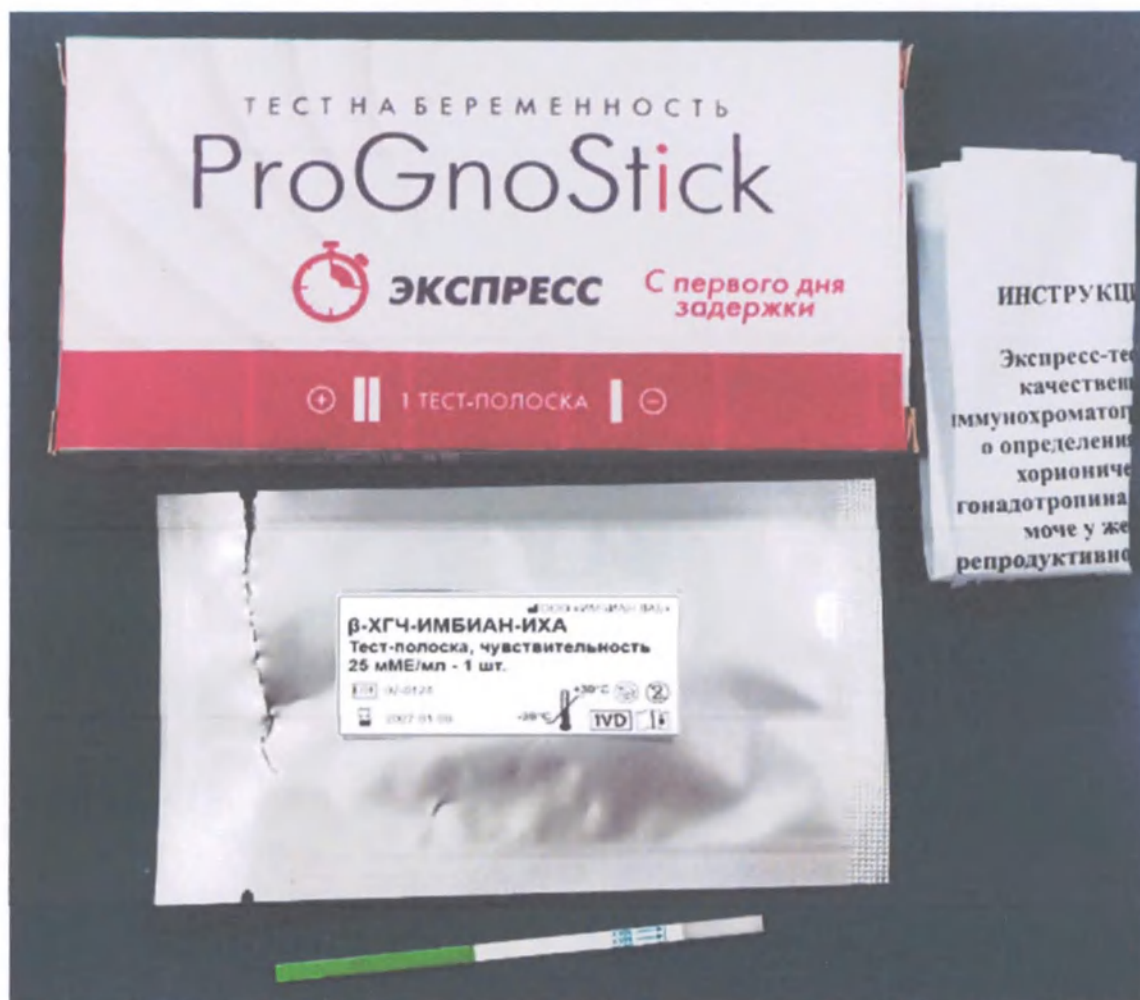

Комплект № 3 (дизайн s3)

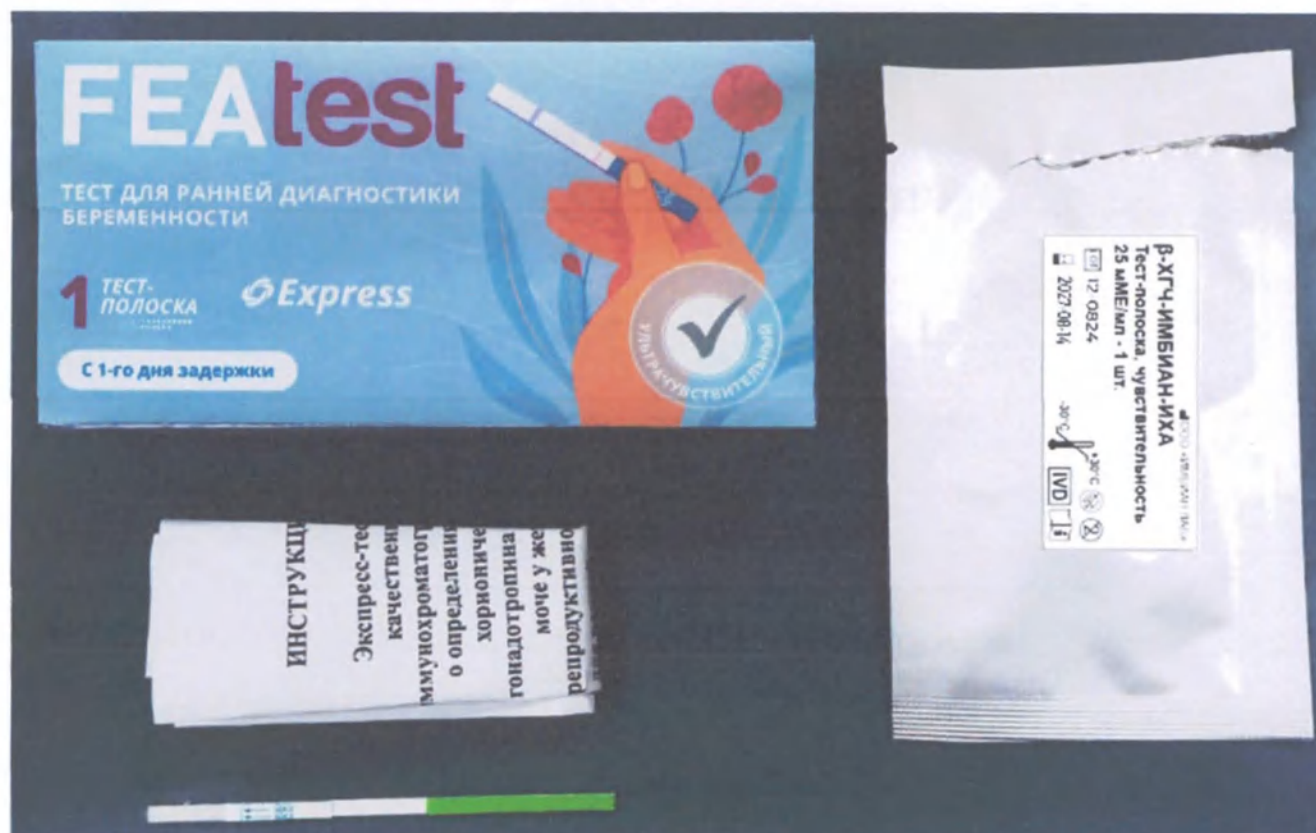


Комплект № 3 (дизайн s5)

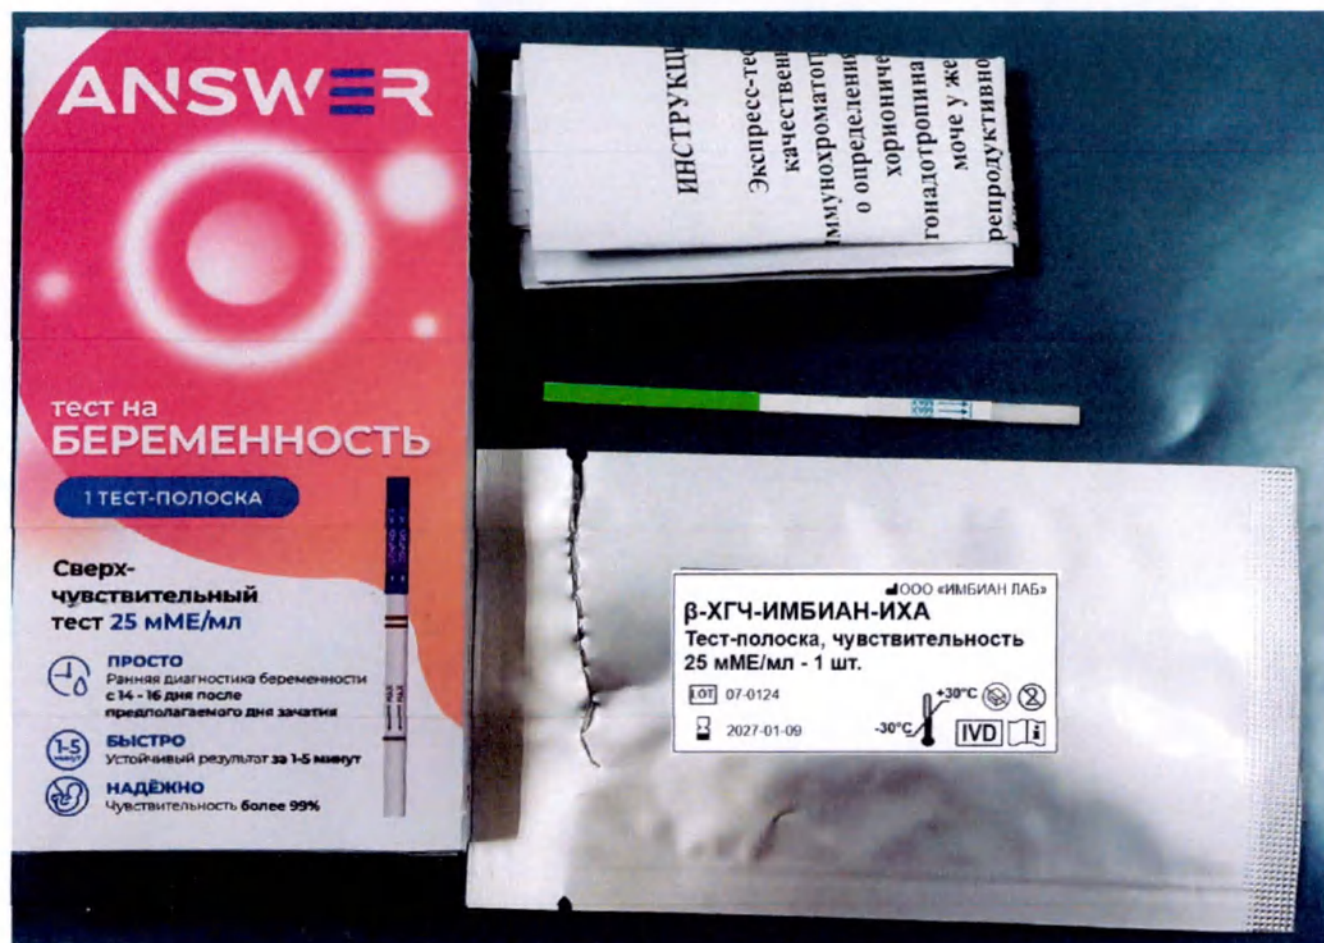

КОМПЛЕКТ № 4 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 4 входят следующие компоненты:

Тест-кассета

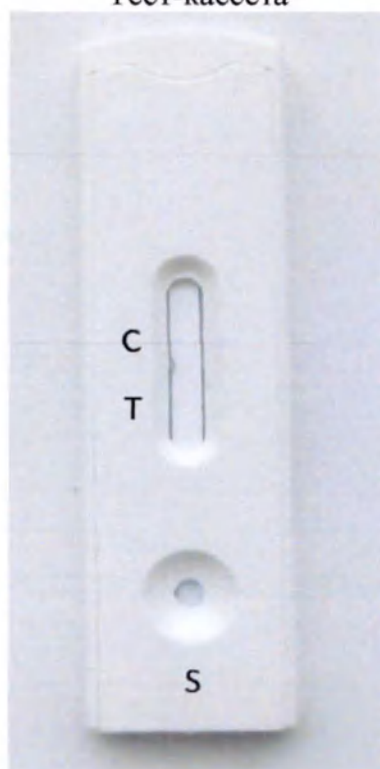

Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)



Тест-кассета (дизайн 1)



Потребительская упаковка (дизайн 1)




Комплект № 4 (дизайн 1)



КОМПЛЕКТ № 5 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 5 входят следующие компоненты:

Тест-кассета

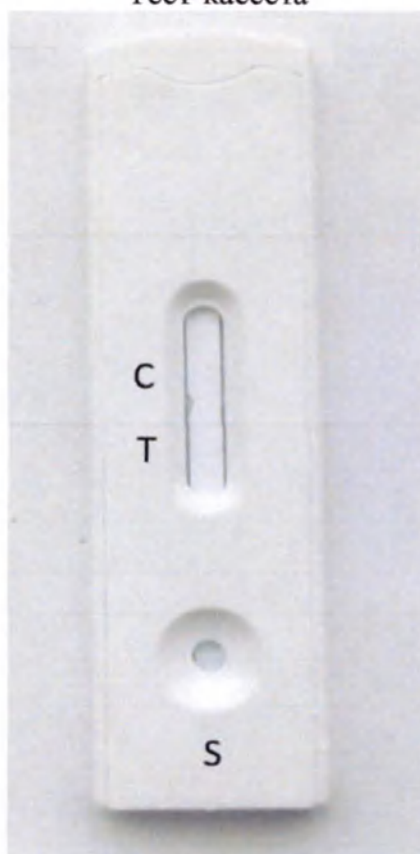

Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)



Тест-кассета (дизайн 1)



Потребительская упаковка (дизайн 1)



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.

СОСТАВ:

КОМПЛЕКТ № 5

LOT 07-0124

Тест-кассета, чувствительность 15 мМЕ/мл 1 шт.

Пипетки медицинские полимерные МикиМед
по ТУ 32.50.50-023-29508133-2019: Пипетки для переноса
жидкости (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.


Инструкция 1 шт.

 2024-01-10

 2027-01-09

Результат через 1-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

**ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ**



 **imbian**

REF WR-009/1.5

Вскрыть упаковку и применить экспресс-тест
только в одноразовых печатках (не входят в комплект)

**ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ**


Комплект № 5 (дизайн 1)



КОМПЛЕКТ № 6 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 6 входят следующие компоненты:

Тест-кассета

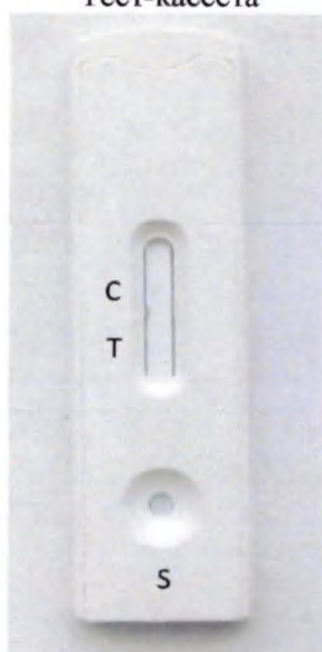

Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)



Тест-кассета (дизайн 1)



Потребительская упаковка (дизайн 1)



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.

СОСТАВ:

КОМПЛЕКТ № 6

LOT 07-0124

Тест-кассета, чувствительность 25 мМЕ/мл 1 шт.

Пипетки медицинские полимерные МиниМед
по ТУ 32.50.50-023-29508133-2019; Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера): 0,25 мл (РУ № РЗН 2019/8912)..... 1 шт.


Инструкция 1 шт.

 2024-01-10


 2027-01-09

Результат через 1-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках



**ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ**



ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

REF WR-009/1.6

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест
только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

**ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ**


Комплект № 6 (дизайн 1)

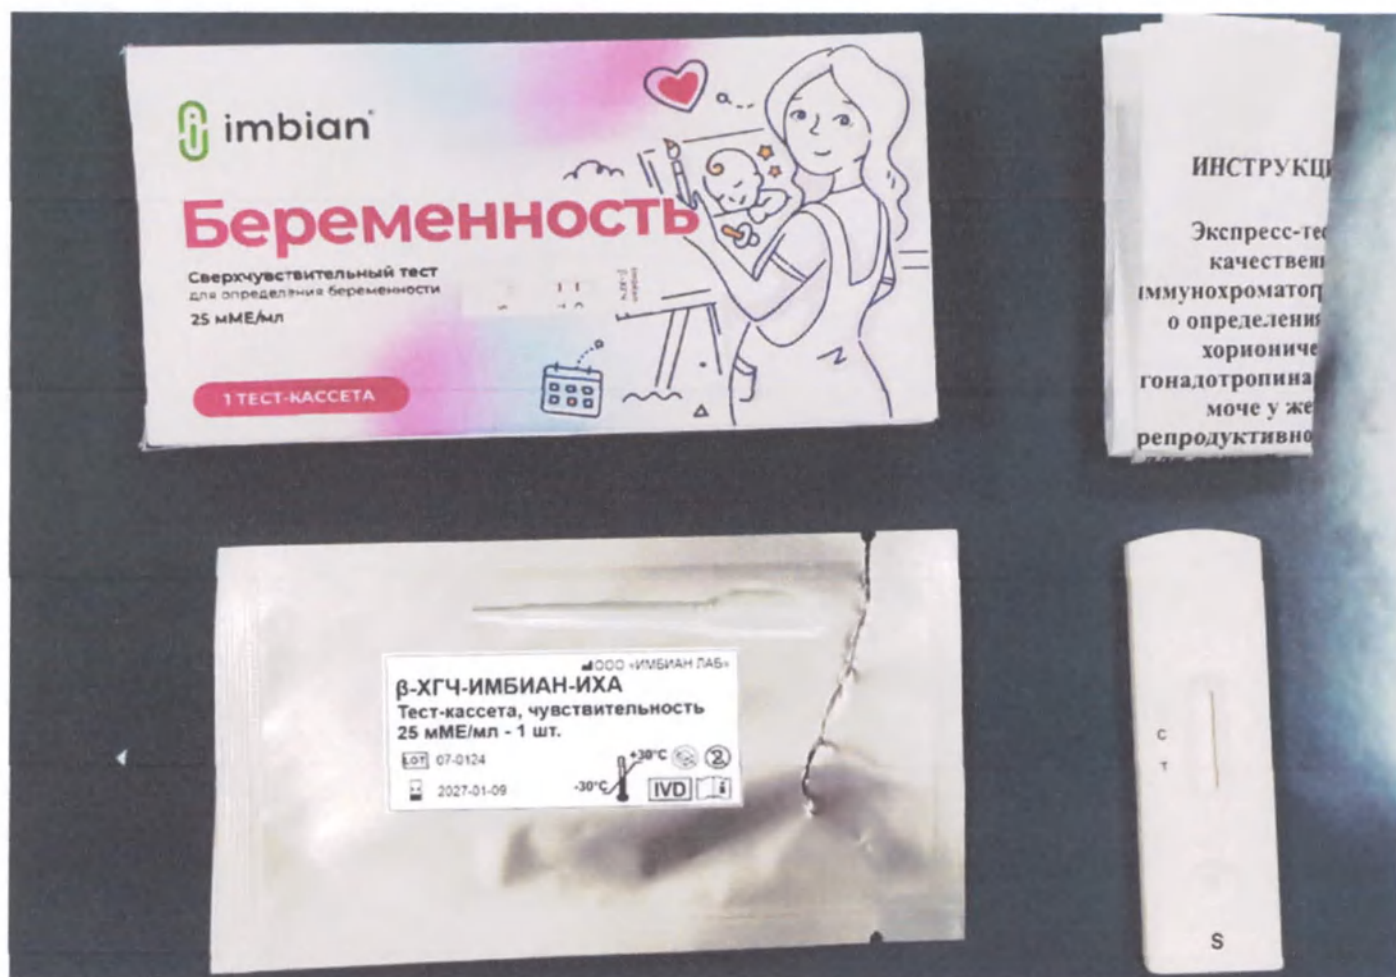

КОМПЛЕКТ № 7 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 7 входят следующие компоненты:


Струйный тест

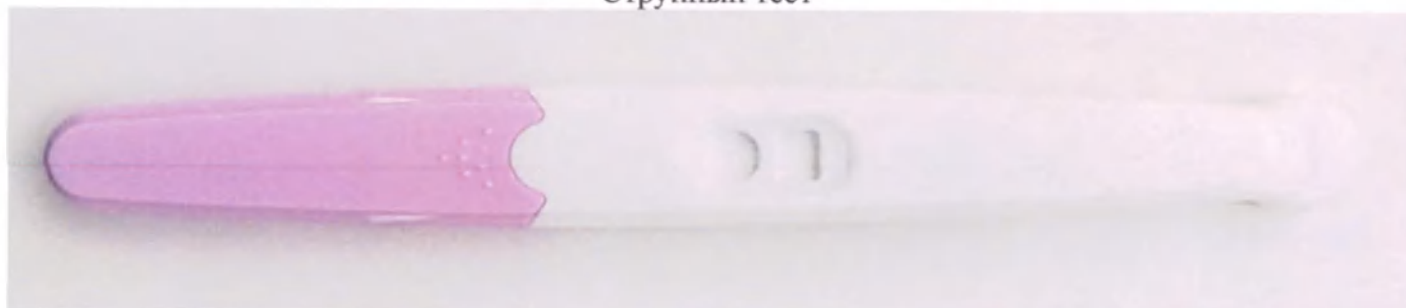




ИЛИ




Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой (дизайн 1)

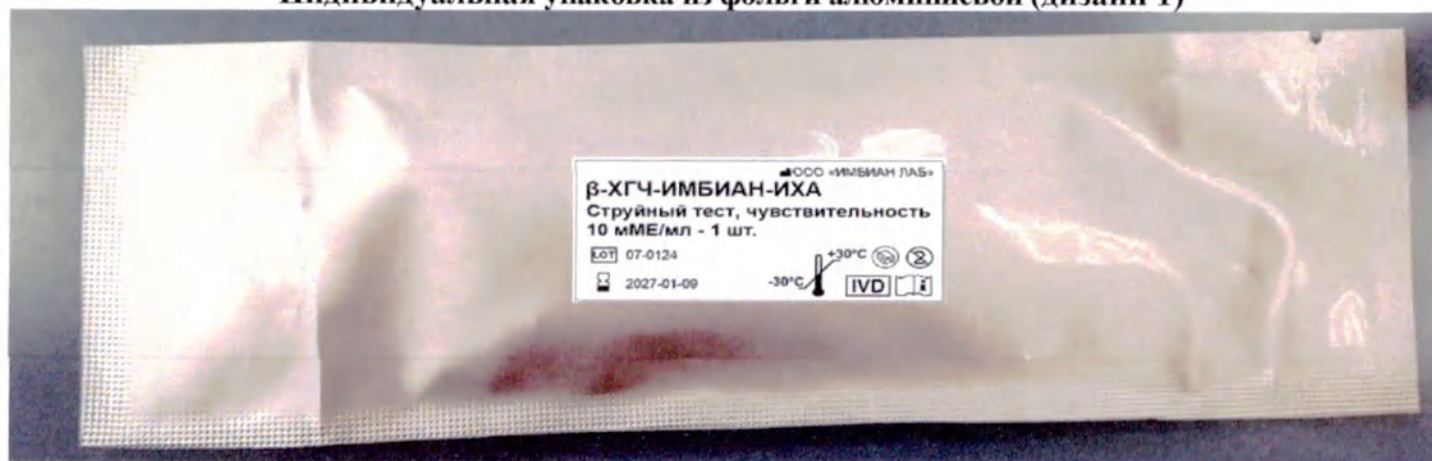

Потребительская упаковка (дизайн 1)

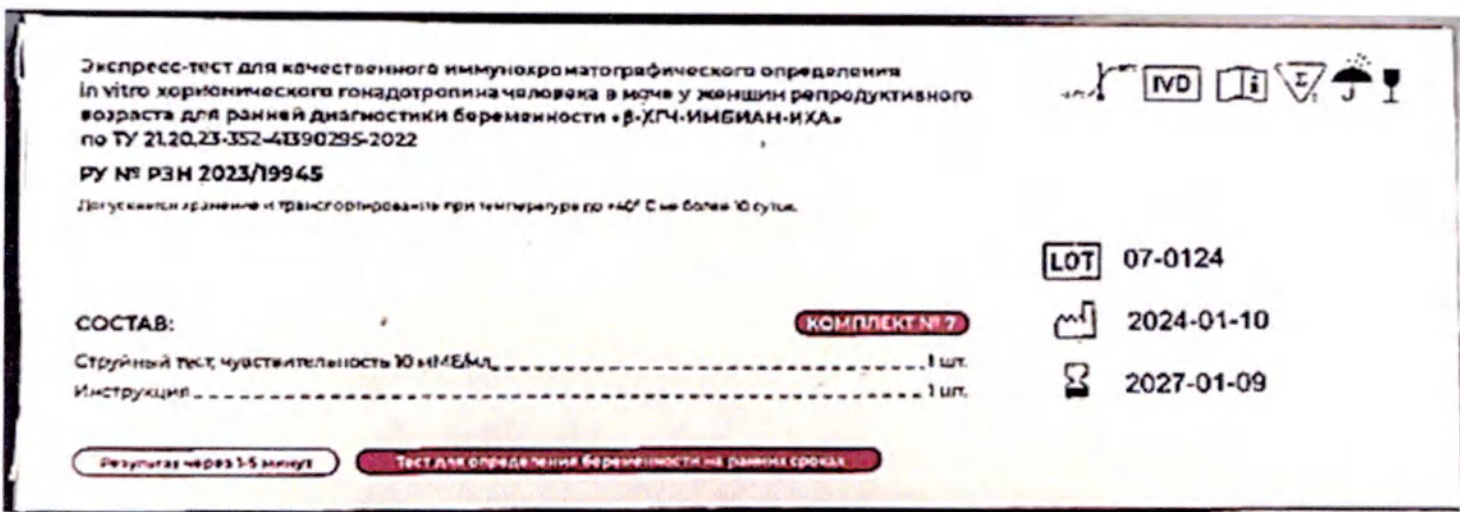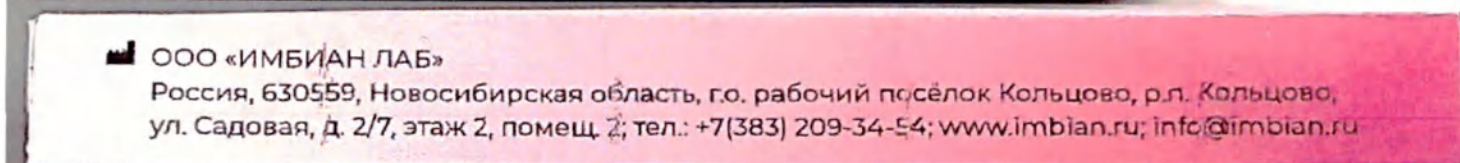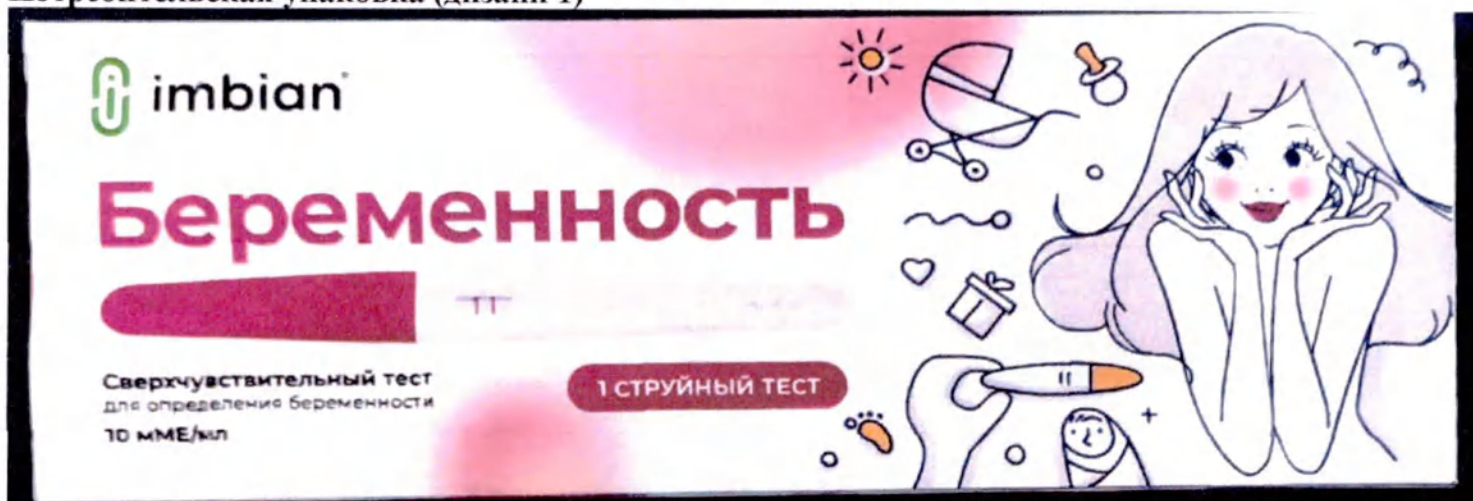

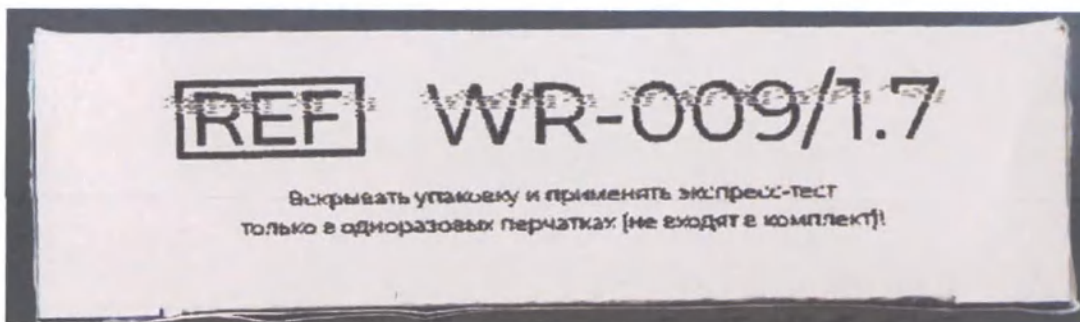

Комплект № 7 (дизайн 1)



КОМПЛЕКТ № 8 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 8 входят следующие компоненты:

Струйный тест



ИЛИ



Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой

Струйный тест (дизайн 1, s2, s6, s7)




Потребительская упаковка (дизайн 1)



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения
in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного
возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 23.20.23-353-43390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.



СОСТАВ:

Струйный тест, чувствительность 5 мМЕД/мл 1 шт.
Инструкция 1 шт.

КОМПЛЕКТ № 8

LOT



Вскрыть только в присутствии врача

Тест для определения беременности на ранних сроках

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



imbian

REF WR-009/1.8

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест
только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



KiDDY TEST

СТРУЙНЫЙ

Ранняя диагностика беременности,
не дожидаясь задержки
менструального цикла



99%

УДОБНО • ЛЕГКО • ПРОСТО

Высокочувствительный
тест на беременность

1 СТРУЙНАЯ КАССЕТА
С КОЛПАЧКОМ

KiDDY TEST

СТРУЙНЫЙ

Высокочувствительный экспресс-тест на беременность
чувствительность 15 мМЕ/мл

- Вскрыть упаковку и применить экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входит в комплект)
- Предназначен для диагностики in vitro при профессиональном применении и самонаблюдения с целью диагностики беременности на ранних сроках.


LOT 07-0124

2024-01-10


2027-01-09



IVD



Держать при температуре от +5 до +30 °C. Хранить при температуре до +32 °C не более 10 дней.

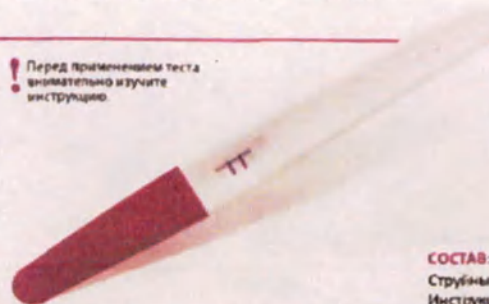

Перед применением теста
внимательно изучите
инструкцию

Интерпретация результата	
	НЕТ Вы не беременны.
	РЕЗУЛЬТАТ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН Тест не работает
	С истекшим сроком использования

* "Позитив" означает "беременность" и не означает "гестационный диабет".
Диагностика гестационного диабета проводится для беременных женщин.
Определенный уровень сахара не исключает возможности гестационного диабета.

СОСТАВ:
Струйный тест, чувствительность 15 мМЕ/мл 1 шт.
Инструкция 1 шт.

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro гормонального
гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики
беременности «В-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.23.23-352-41300295-2023.
Комплект № 8. Тест для определения беременности на ранних сроках.
РУ № РЗН 2023/19945

Изготовитель:
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская
область, г.о. рабочий поселок Колыцово, р.п. Колыцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54,
www.imbian.ru, info@imbian.ru

Официальный дистрибьютор:
ООО «БТК», 194156,
Санкт-Петербург г. пр. Звездный,
дом № 34, лит.В, пом. 14-Н
btk-med.ru, sidek@mail.ru

1 СТРУЙНАЯ КАССЕТА
С КОЛПАЧКОМ

Высокочувствительный
струйный тест на беременность

4 620102 809491

REF

WR-009/1.8-s6

Потребительская упаковка (дизайн s7)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 15 мМЕ/мл

Surelife

СТРУЙНЫЙ
ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

БЫСТРО
НАДЕЖНО
ПРОСТО

точность более
99%



1 КАСЕТА СТРУЙНАЯ
С КОЛПАЧКОМ

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ «SURELIFE» ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 15 мМЕ/мл

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «В-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022, комплект № 8. Тест для определения беременности на ранних сроках, РУ № РЗН 2023/19945.

Состав: Струйный тест, чувствительность 15 мМЕ/мл _____ 1 шт.
Инструкция _____ 1 шт.

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

Хранить экспресс-тест в упаковке изготовителя при температуре от -30 °С до +30 °С. Экспресс-тест из поврежденной упаковки непригоден для проведения анализа. Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

КАК ПРОВЕСТИ ТЕСТ


1. Извлеките струйный тест из индивидуальной упаковки непосредственно перед проведением анализа и положите на чистую, сухую горизонтальную поверхность.
2. Снимите защитный колпачок. Держа кассету вертикально, подставьте приемную часть под струю мочи на 5 секунд или опустите приемную часть в емкость с мочой на 10 секунд.
3. Наденьте защитный колпачок. Положите тест на сухую горизонтальную поверхность окошком вверх.
4. Результат можно оценить через 1-5 минут. Не интерпретировать результаты позднее 10 минут после внесения образца мочи.

LOT 07-0124

2024-01-10

2027-01-09

ООО «ИМБИАН ЛАБ» Россия, 630559, Новосибирская область,
п.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, дом 2/7,
этаж 2, пом. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru



СТРУЙНЫЙ ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ «SURELIFE»

1 КАСЕТА СТРУЙНАЯ С КОЛПАЧКОМ

REF WR-009/1.8-s7

Комплект № 8 (дизайн 1)



Комплект № 8 (дизайн s2)



Комплект № 8 (дизайн s6)



Комплект № 8 (дизайн s7)



КОМПЛЕКТ № 9 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 9 входят следующие компоненты:

Струйный тест



ИЛИ



Струйный тест (дизайн 1, S5, s7)




Потребительская упаковка (дизайн 1)



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.



LOT 07-0124

2024-01-10

2027-01-09

СОСТАВ:

КОМПЛЕКТ № 9

Струйный тест, чувствительность 25 мМЕ/мл 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Результат через 1-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

REF WR-009/1.9

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ

Потребительская упаковка (дизайн s5)

ANSWER

тест на
БЕРЕМЕННОСТЬ

1 ТЕСТ-КАССЕТА



Сверхчувствительный
струйный тест 25 мМЕ/мл

ПРОСТО
Ранняя диагностика беременности с 14 - 16 дня после предполагаемого дня зачатия

БЫСТРО
Устойчивый результат за 1-5 минут

НАДЕЖНО
Чувствительность > 99%

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *In vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «Р-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-4390295-2022, комплект № 9
Тест для определения беременности на ранних сроках
РУ № РЗН 2023/19945

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

	Отрицательный Без беременности	LOT 07-0124 2024-01-10 2027-01-09
	Положительный Без беременности	
	Результат не действителен Тест сломан или испорчен	
	Результат не действителен Тест сломан или испорчен	


С - контрольная линия, Т - тестовая линия
* Ву протест анализ, произведенный и не допущенный к использованию для диагностики беременности, результат теста не исключает возможность беременности.

СОСТАВ:
Струйный тест, чувствительность 25 мМЕ/мл 1 шт.
Инструкция 1 шт.
Безопасность упаковки и гарантия качества продукции только в оригинальной упаковке (на упаковке и коробке)

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbjan.ru

4 620102 809200

Экспресс-тест для определения БЕРЕМЕННОСТИ 1 ТЕСТ-КАССЕТА **ANSWER**

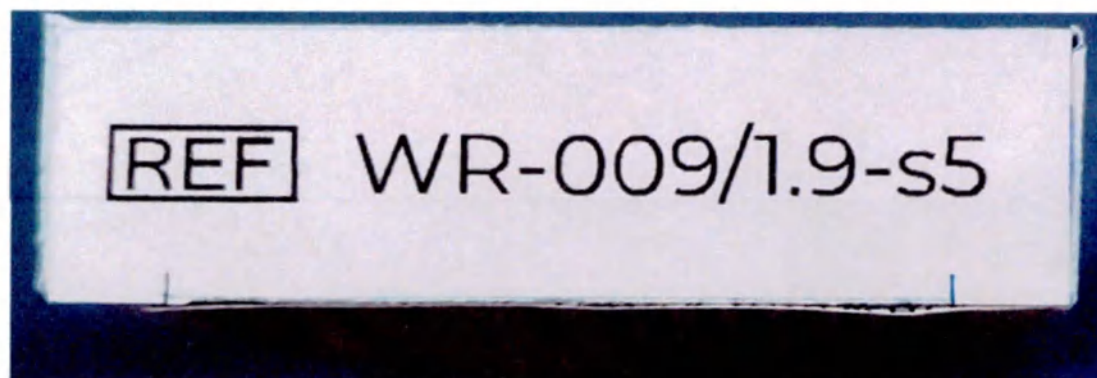

Потребительская упаковка (дизайн s7)

Surelife
СТРУЙНЫЙ ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 25 мМЕ/мл

**Быстро
Надёжно
Просто**

Точность более **99%**

1 КАССЕТА СТРУЙНАЯ С КОЛПАЧКОМ

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ «SURELIFE»
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТ 25 мМЕ/мл

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022, комплект №9. Тест для определения беременности на ранних сроках, РУ № РЗН 2023/19945.

Состав: Струйный тест, чувствительность 25 мМЕ/мл - 1 шт.
 Инструкция - 1 шт.
 Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

Хранить экспресс-тест в упаковке изготовителя при температуре от -30 °С до +30 °С. Экспресс-тест из поврежденной упаковки непригоден для проведения анализа. Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

КАК ПРОВЕСТИ ТЕСТ

1. Извлеките струйный тест из индивидуальной упаковки непосредственно перед проведением анализа и положите на чистую, сухую горизонтальную поверхность.
2. Снимите защитный колпачок. Держа кассету вертикально, подставьте приемную часть под струю мочи на 5 секунд или опустите приемную часть в емкость с мочой на 10 секунд.
3. Наденьте защитный колпачок. Положите тест на сухую горизонтальную поверхность окошком вверх.
4. Результат можно оценить через 1-5 минут. Не интерпретировать результаты позднее 10 минут после внесения образца мочи.

LOT 07-0124


2024-01-10

2027-01-09

СТРУЙНЫЙ ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ «SURELIFE»

1 КАССЕТА СТРУЙНАЯ С КОЛПАЧКОМ

ООО «ИМБИАН ЛАБ» Россия, 630559, Новосибирская область, по. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, дом 2/7, этаж 2, пом. 2; тел.: +7 (383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru



REF WR-009/1.9-s7

Комплект № 9 (дизайн 1)



Комплект № 9 (дизайн s5)




Комплект № 9 (дизайн s7)



КОМПЛЕКТ № 10 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 10 входят следующие компоненты:

Тест-полоска

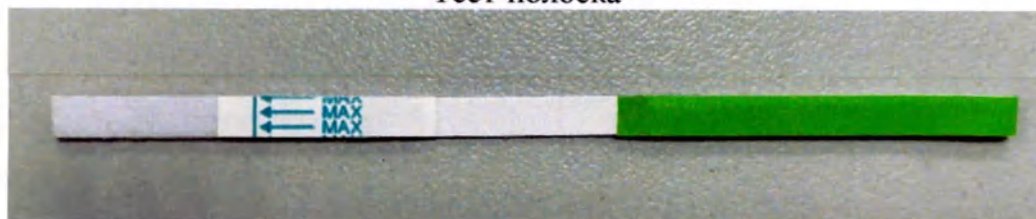




Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой
(дизайн 1)



ИЛИ
(дизайн s4)



Потребительская упаковка (дизайн 1)

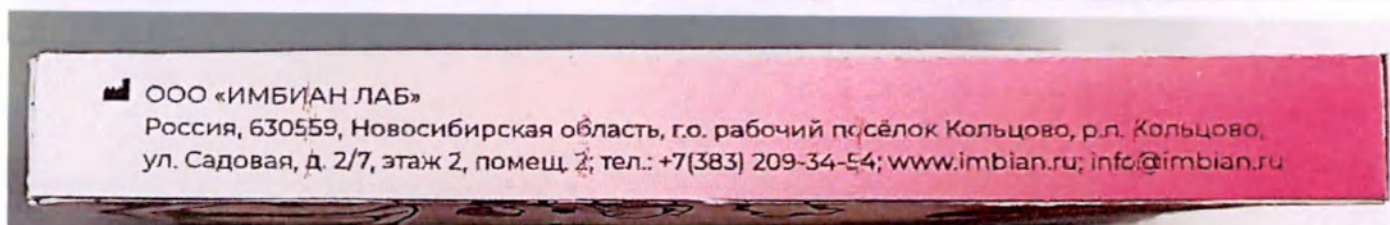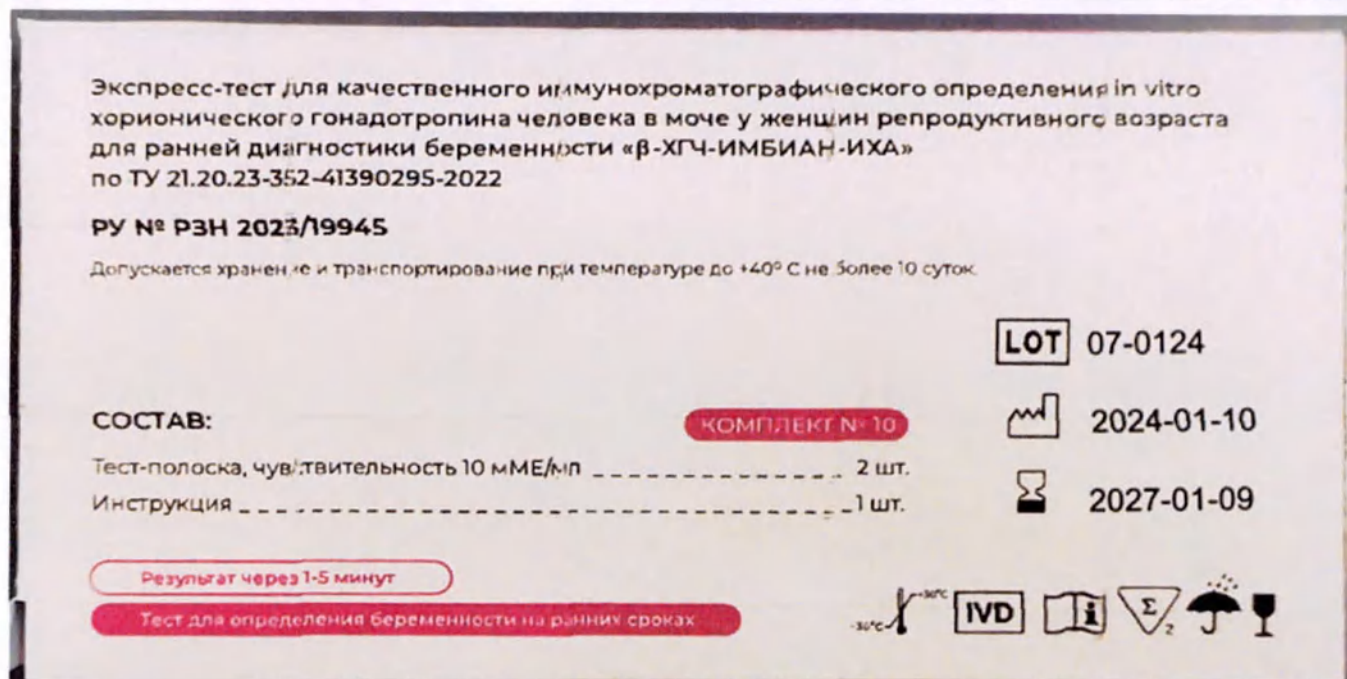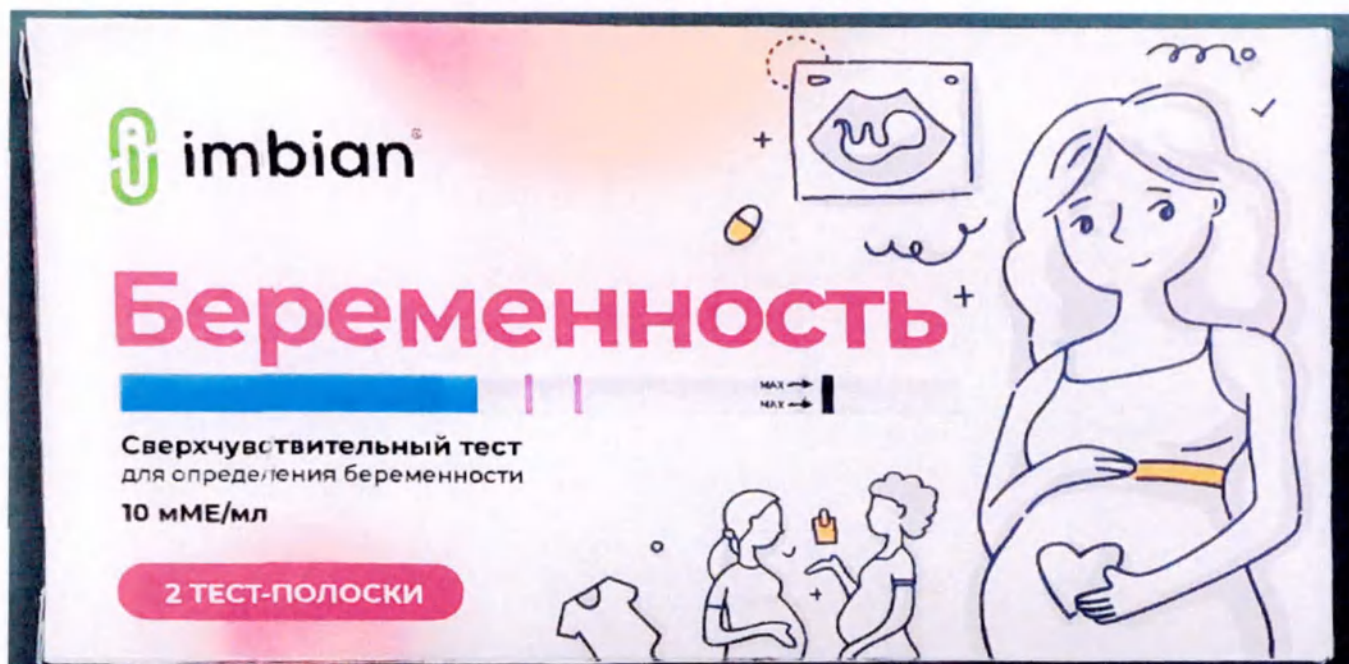

REF WR-009/2.10

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест
только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ БЕРЕМЕННОСТЬ

Потребительская упаковка (дизайн s4)

ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ

ЭКСПРЕСС ТЕСТ

Чувствительность
10 ММЕ/МЛ

2 тест-полоски



Импловит

СРОК ГОДНОСТИ: 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.

Экспресс-тест следует использовать до истечения срока годности.

ХРАНИТЬ при температуре от +30 °С до +30 °С в течение всего срока годности.

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40 °С не более 10 суток.

REF WR-009/2.10-s4

IVD



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИМБЛАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г. рабочий поселок Колыцово,
р.п. Колыцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, пом. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imblan.ru, info@imblan.ru.

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ: ООО «НЕО-ФАРМ», 117246, г. Москва, ул. Обручева, д. 55А, этаж 1, пом. 14, комн. 1
(Российская Федерация).



4 620102 809095

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Вскрыть упаковку и применить экспресс-тест только в одноразовых перчатках (не входит в комплект).

1. Испытательную полоску из индивидуальной упаковки непосредственно перед проведением анализа просматривать (при необходимости) и опустить вертикально струей мочи в емкость с мочой на уровне 5 мл до линии (МАК) на 10 секунд, как показано на рисунке.
2. Испытательную полоску из емкости с мочой и положить на сухую горизонтальную поверхность.
3. Считать результат через 1-5 минут. Не интерпретировать результаты позднее 10 минут после внесения мочи в емкость мочи.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:

	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ «вы не беременны»
	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ «вы беременны»
	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Следует повторить анализ, используя новую испытательную

* Этот продукт является одноразовым и не должен быть использован как одноразовый в следующем для повторного анализа. Отрицательный результат теста не исключает вероятность беременности.

Предназначен для диагностики *in vitro* при профиле с повышенным содержанием и самостимулирован с целью диагностики беременности на раннем сроке.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 10 мМЕ/мл.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ, НАЧИНАЯ С 7-10 ДНЯ ПОСЛЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДНЯ ЗАЧАТИЯ.
РУ № РЗН 1621/13045
Комплект ИР 10 Тест для определения беременности не входит в комплект.

- Испытательная, чувствительность: 10 мМЕ/мл - 2 шт.
- Мастер-карта - 1 шт.

LOT 07-0124
 2024-01-10
 2027-01-09

Комплект № 10 (дизайн 1)

imbian®

Беременность

Сверхчувствительный тест для определения беременности 10 мМЕ/мл

2 ТЕСТ-ПОЛОСКИ

ИНСТРУКЦИЯ
Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста

β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Тест-полоска, чувствительность 10 мМЕ/мл - 1 шт.
LOT 07-0124
2027-01-09
-30°C
IVD


Комплект № 10 (дизайн s4)



КОМПЛЕКТ № 11 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ


В состав Комплекта № 2 входят следующие компоненты:

Тест-полоска

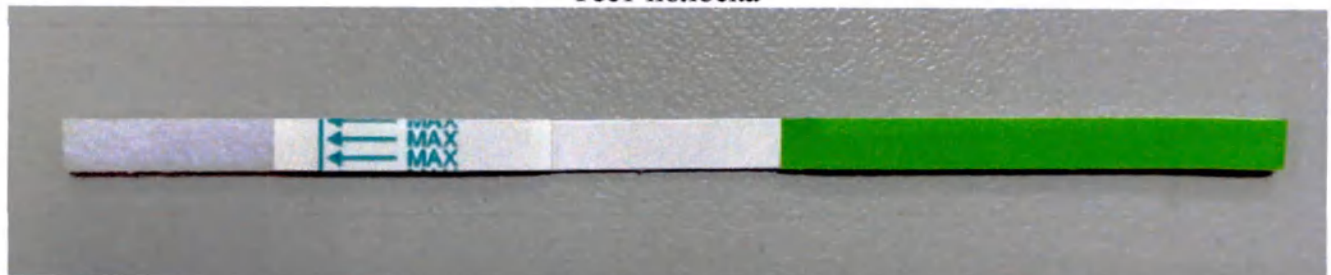

Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой

Тест-полоска (дизайн 1, s6)

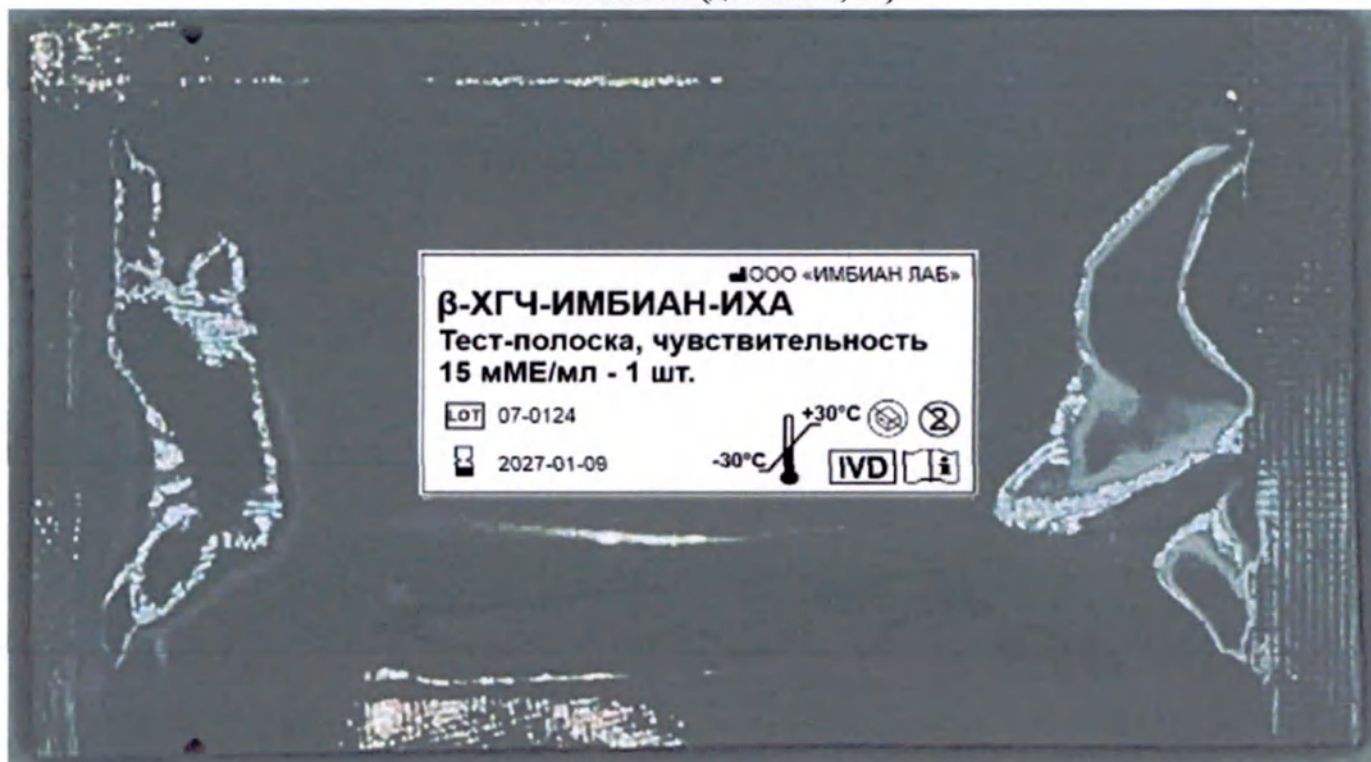

или

Тест-полоска (дизайн s4)





Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.

LOT 07-0124

СОСТАВ:

КОМПЛЕКТ № II

2024-01-10


Тест-полоска, чувствительность 15 ММЕ/мл 2 шт.

Инструкция 1 шт.

2027-01-09

Результат через 1-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках




ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ




imbian


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

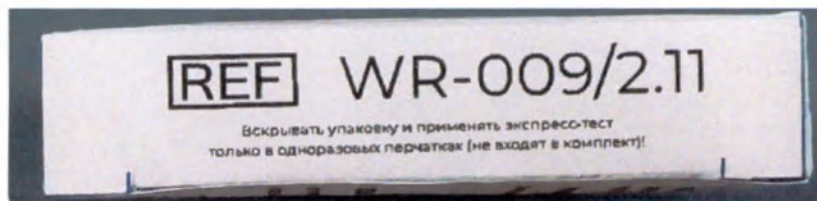




Потребительская упаковка (дизайн s4)

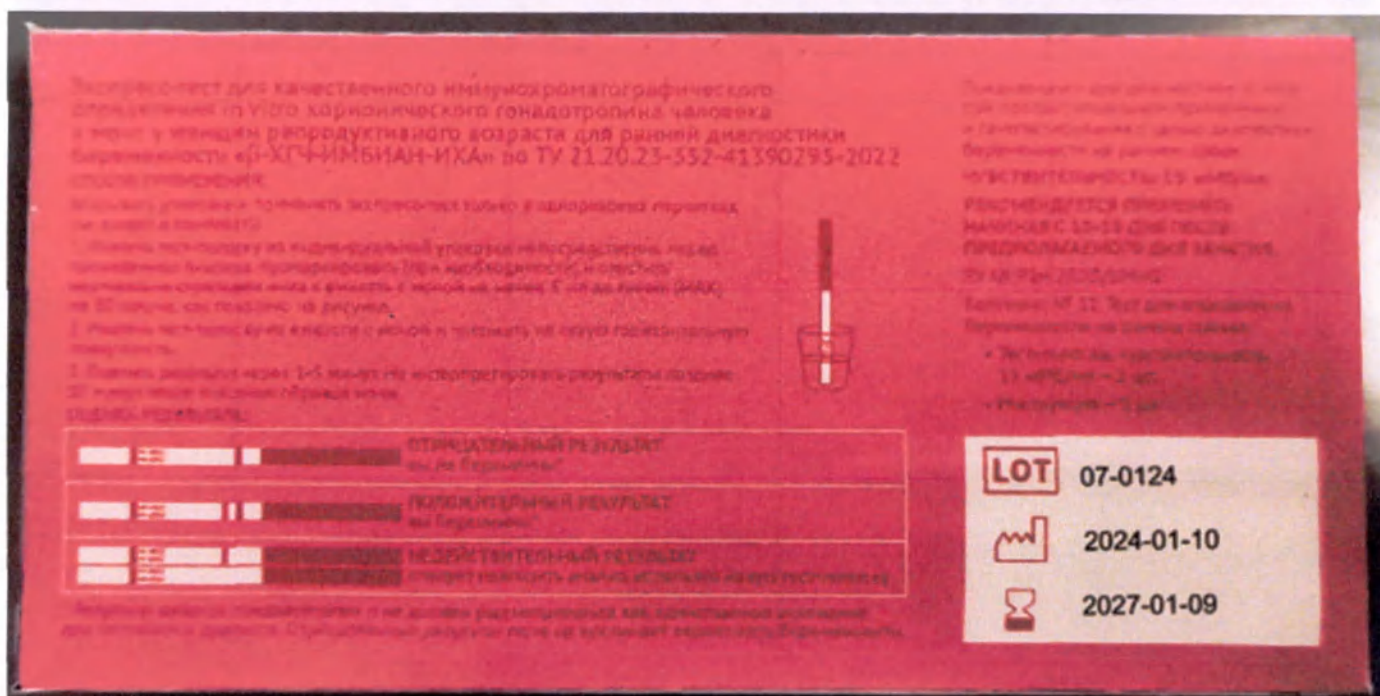

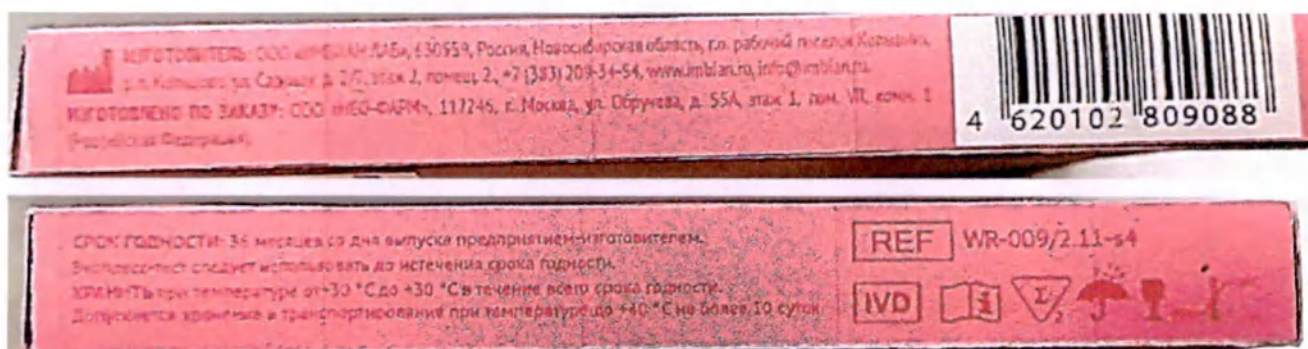


Потребительская упаковка (дизайн s6)




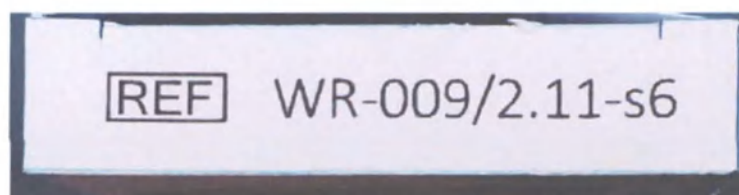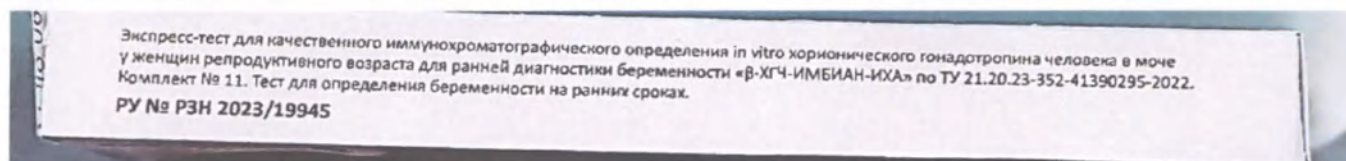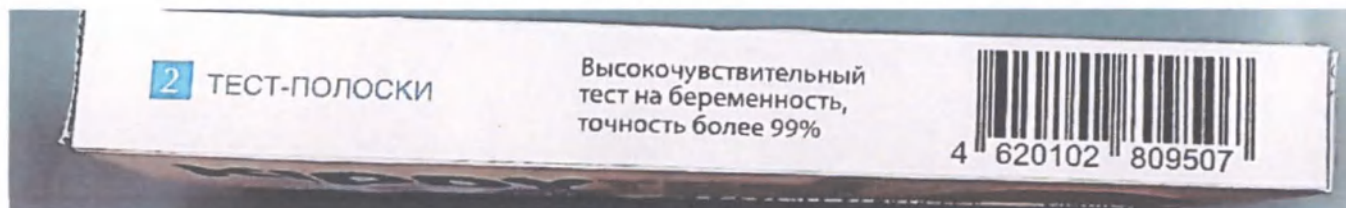

Комплект № 11 (дизайн 1)

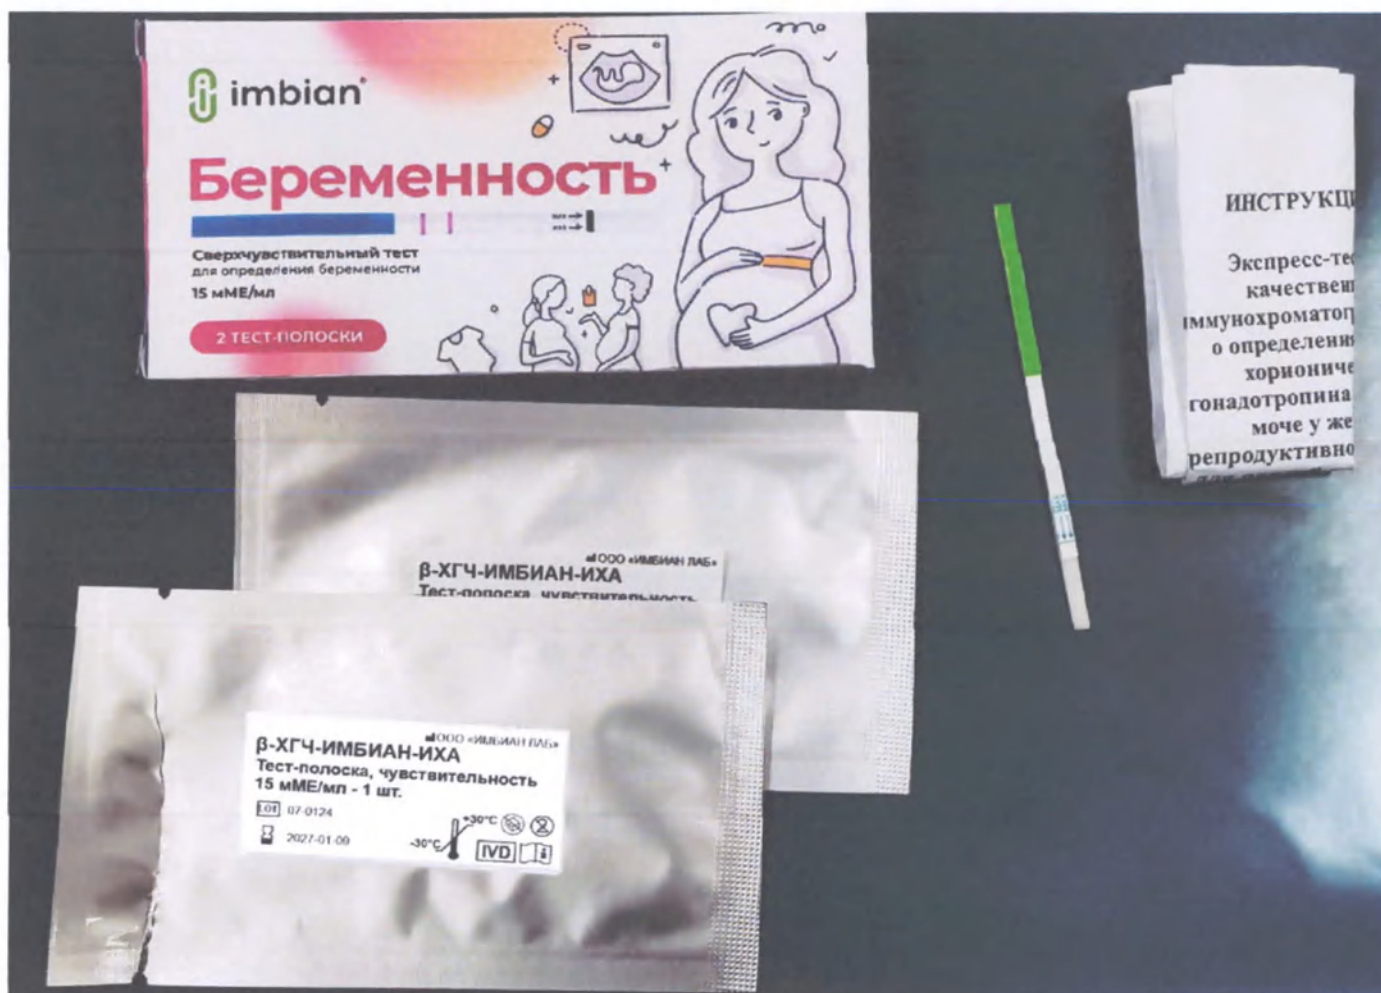

Комплект № 11 (дизайн s4)

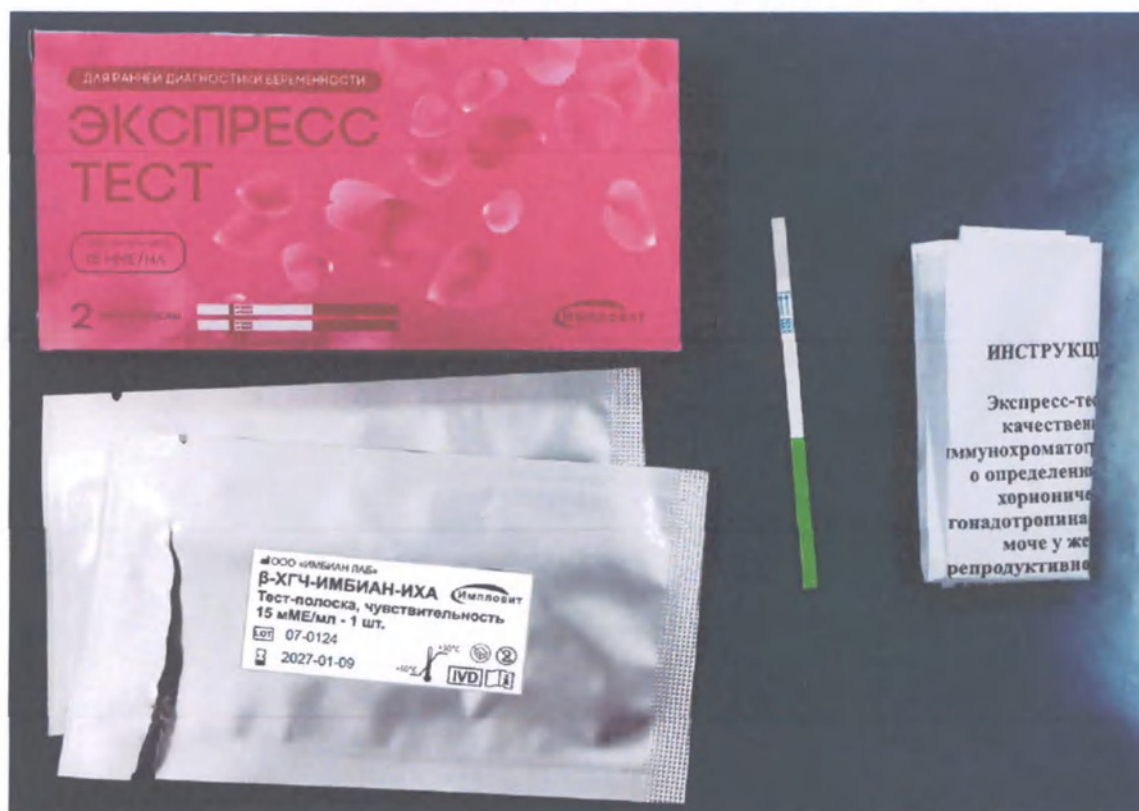

Комплект № 11 (дизайн s6)



КОМПЛЕКТ № 12 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 12 входят следующие компоненты:

Тест-полоска



Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой

Тест-полоска (дизайн 1, s2, s3, s5)



Потребительская упаковка (дизайн 1)



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.

LOT 07-0124

СОСТАВ:

КОМПЛЕКТ № 12



2024-01-10

Тест-полоска, чувствительность 25 мМЕ/мл _____ 2 шт.




2027-01-09

Инструкция _____ 1 шт.

Результат через 1-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках



IVD



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



imbian




ООО «ИМБИАН ЛАБ»



Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru


REF WR-009/2.12

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест
только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ

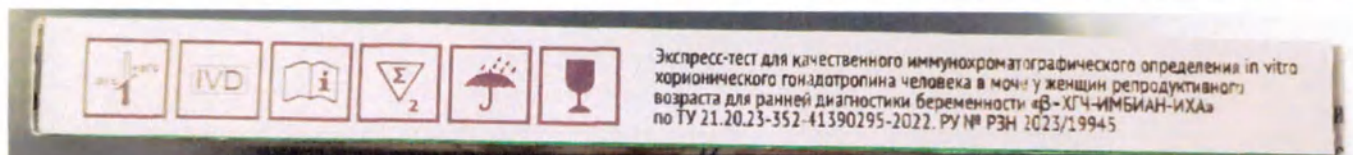
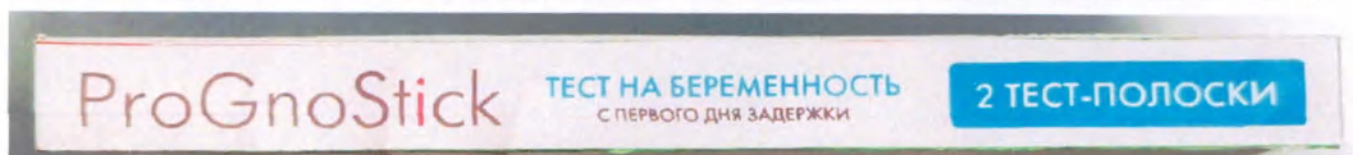
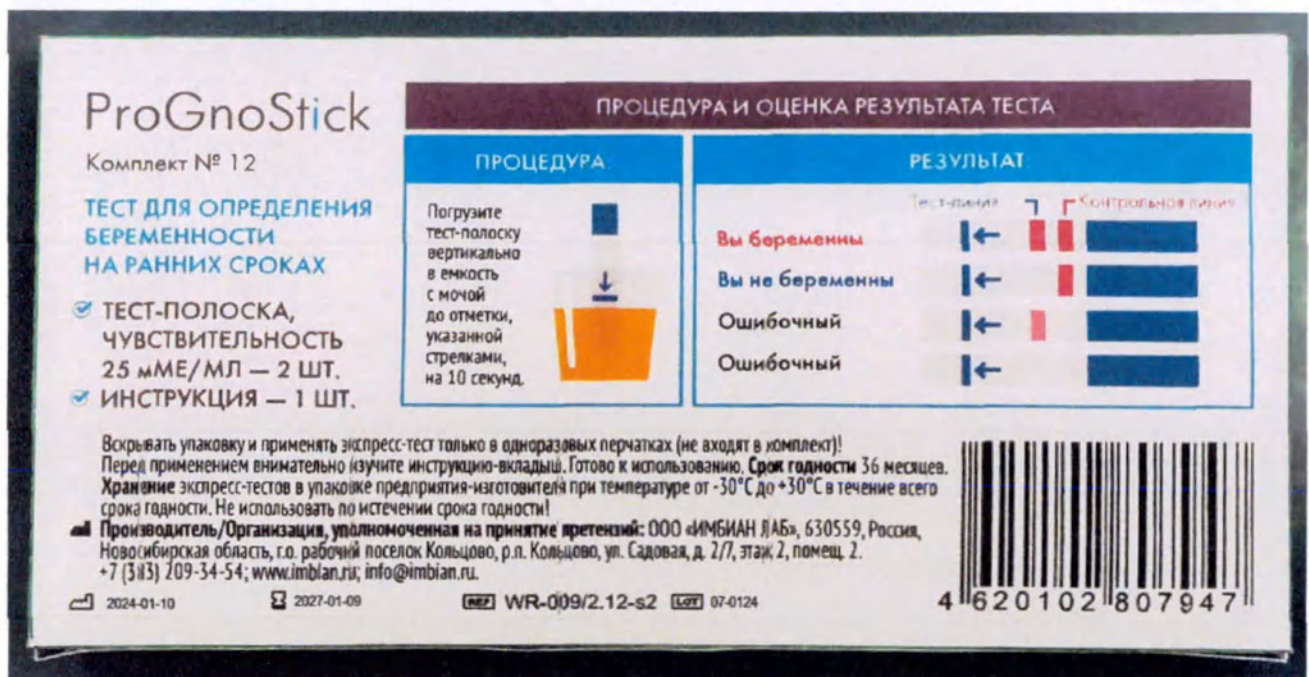


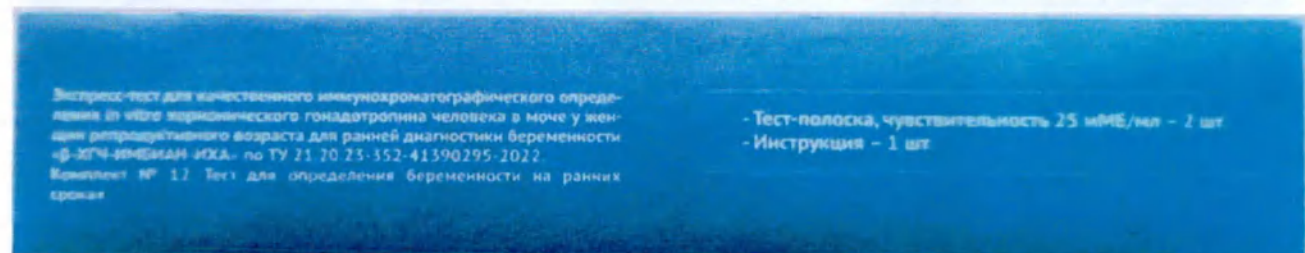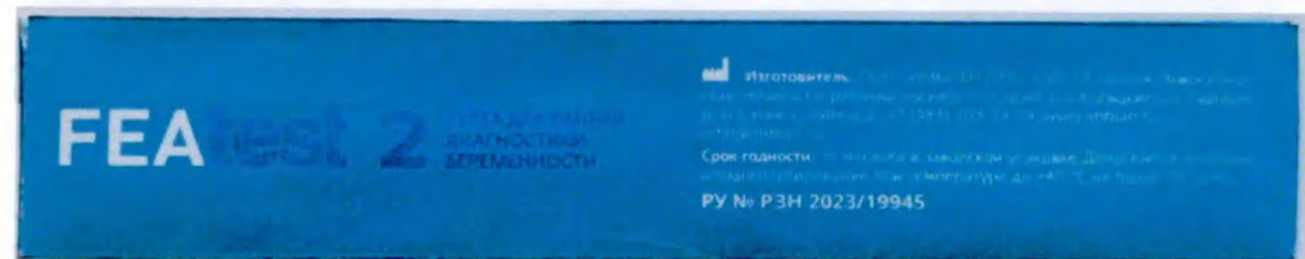

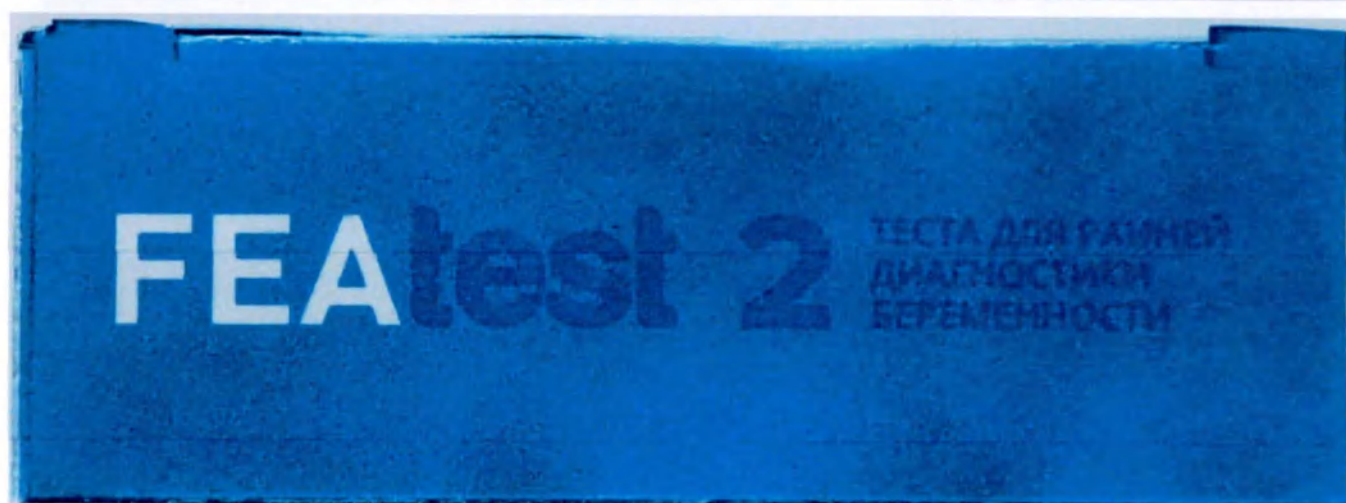


Потребительская упаковка (дизайн s5)




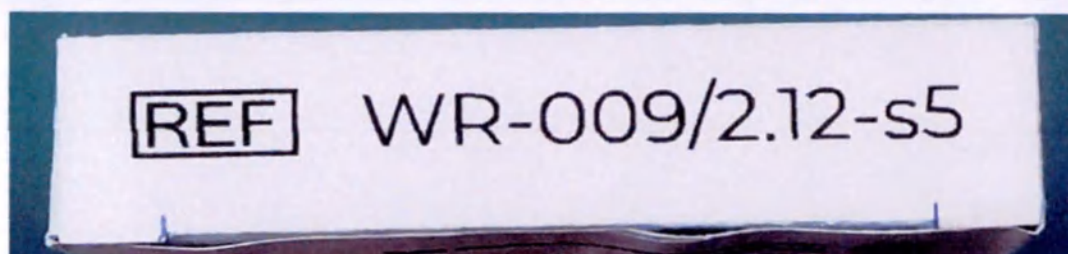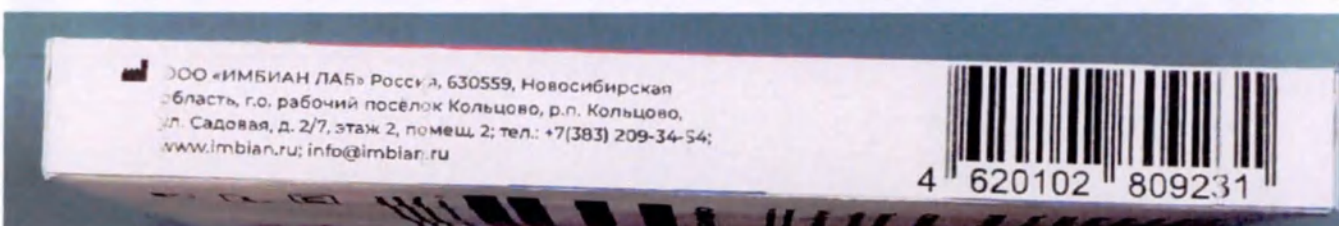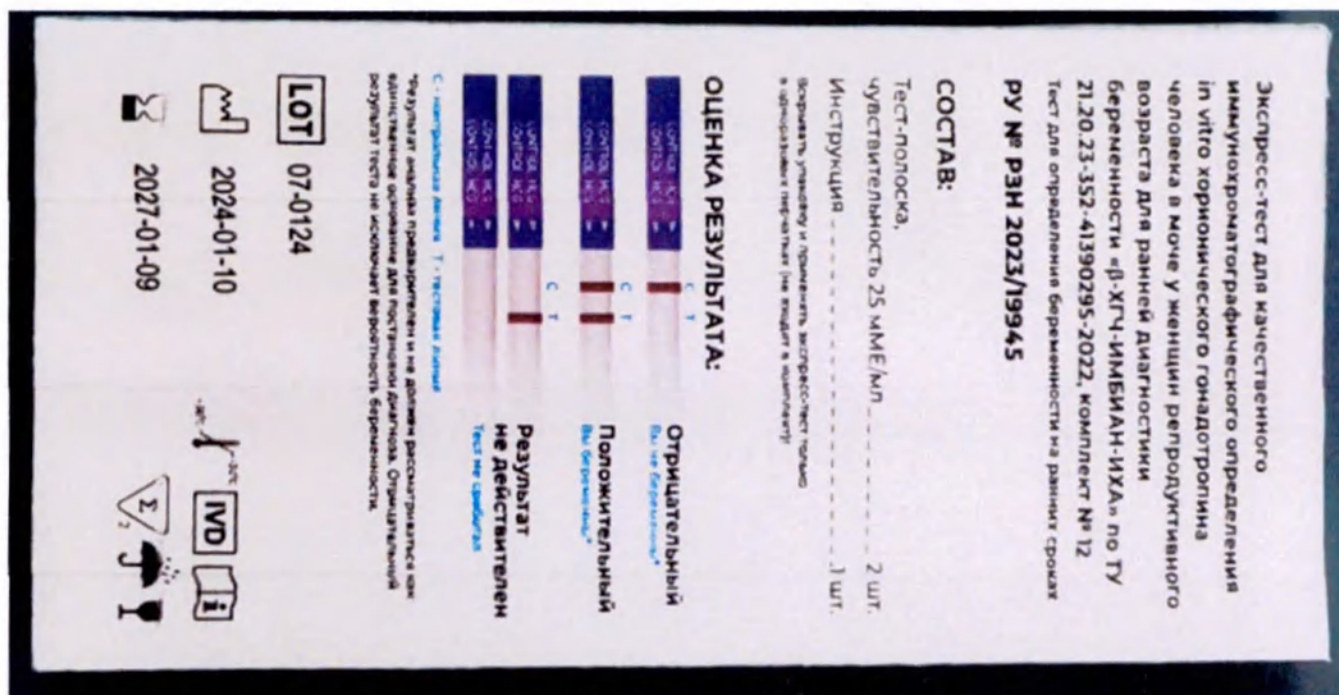

Комплект № 12 (дизайн 1)

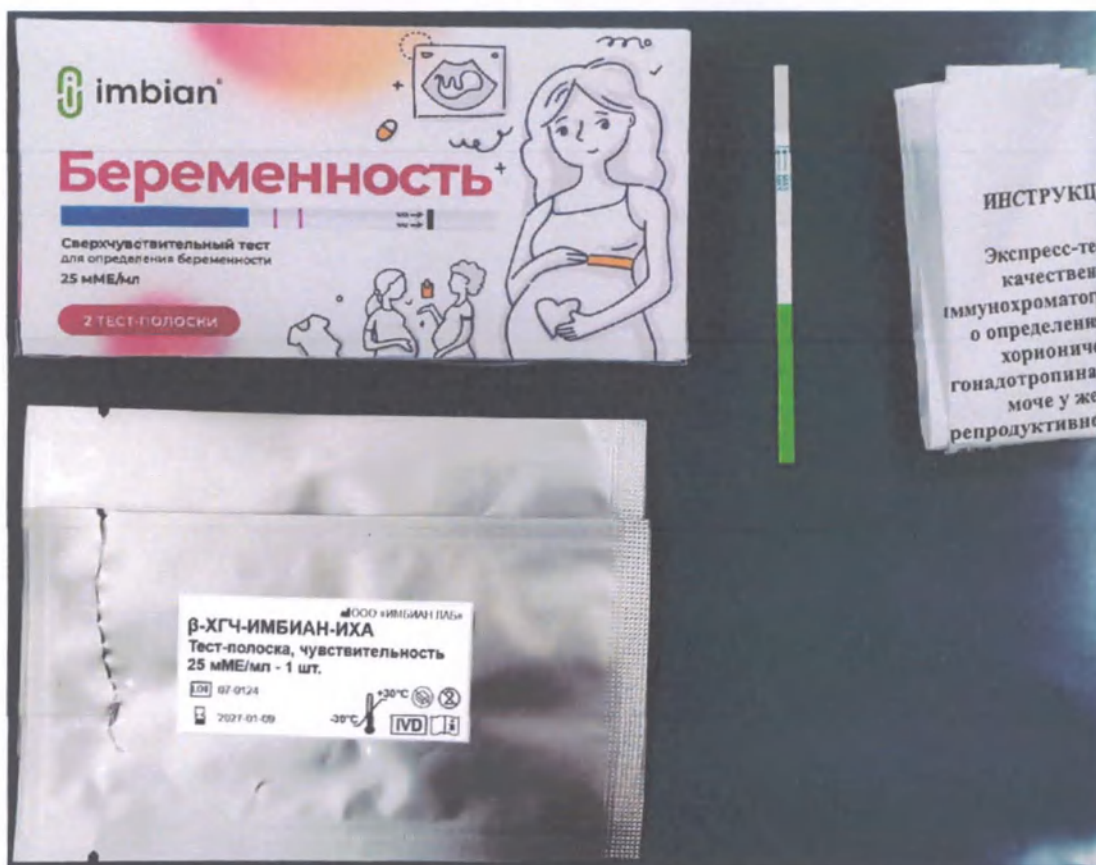

Комплект № 12 (дизайн s2)

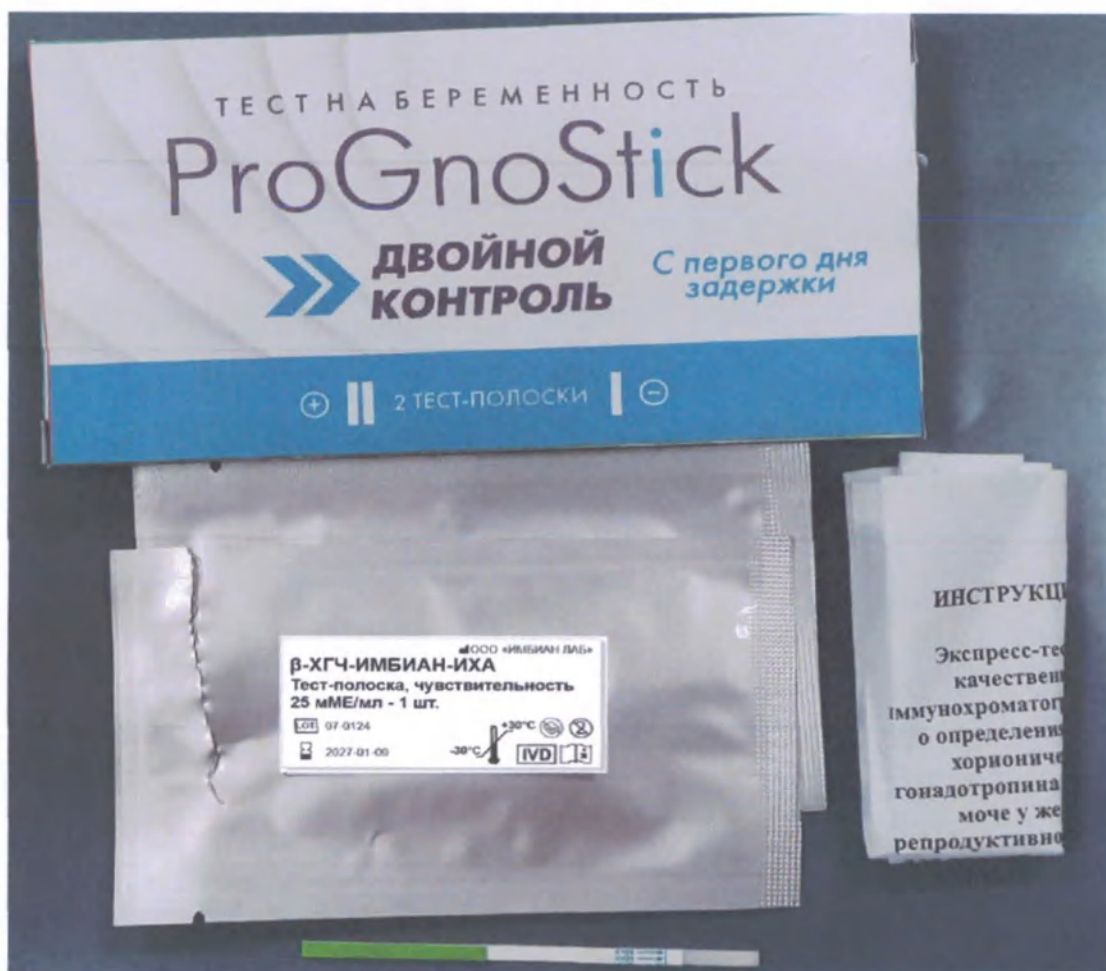

Комплект № 12 (дизайн s3)




Комплект № 12 (дизайн s5)




КОМПЛЕКТ № 13 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ



В состав Комплекта № 13 входит следующий компонент:

Тест-кассета

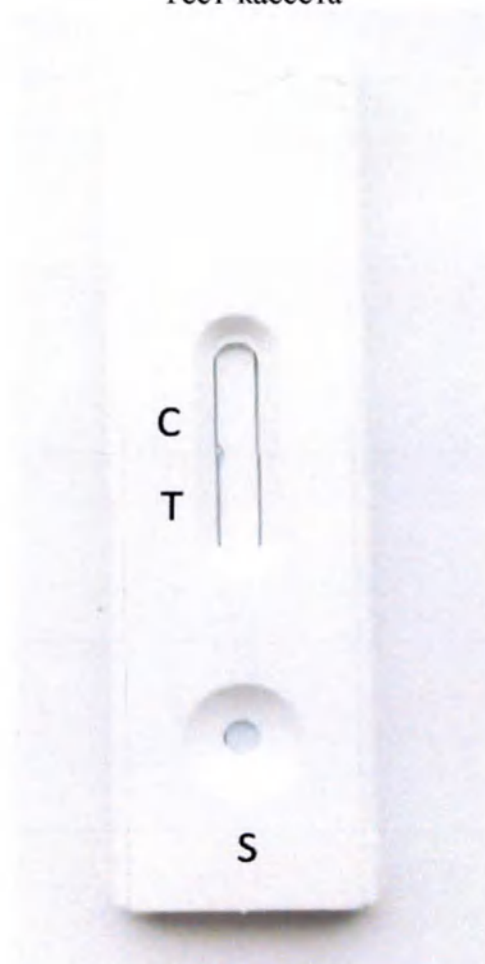

Тест-кассета (дизайн 1)

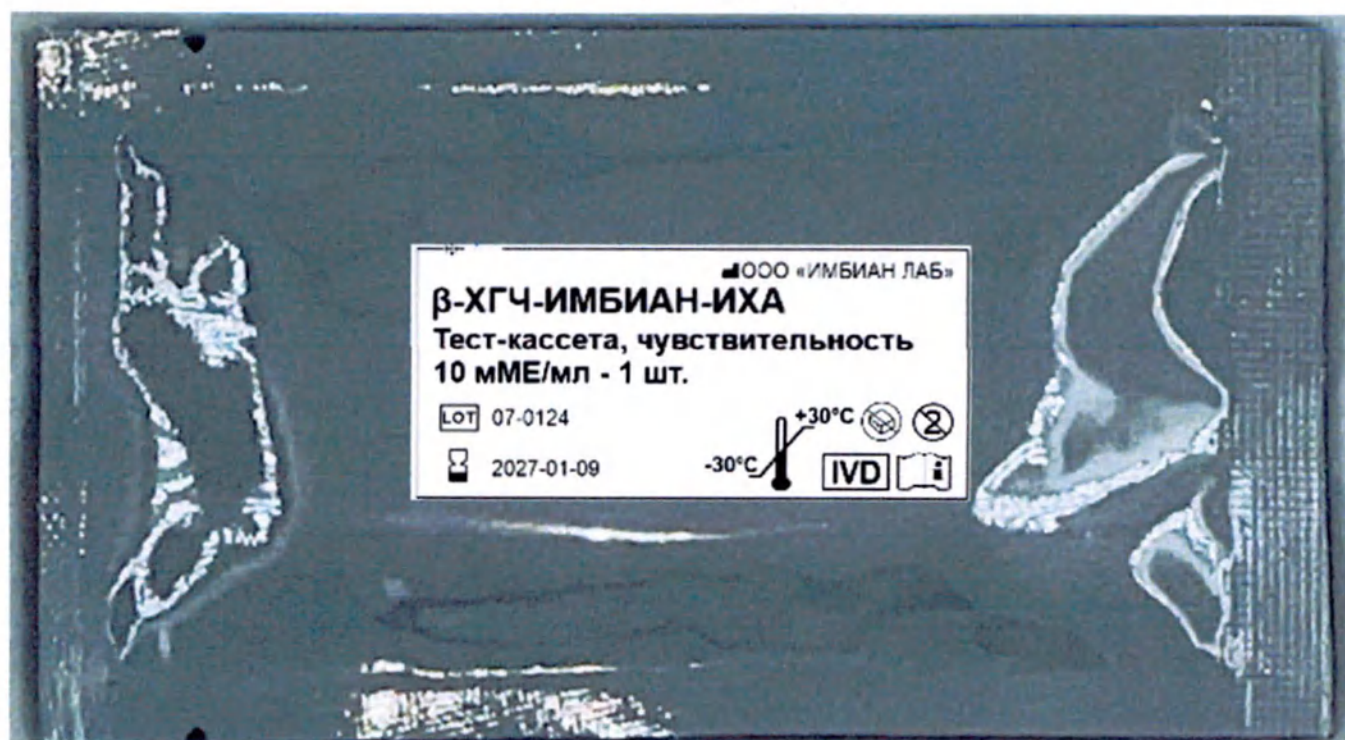

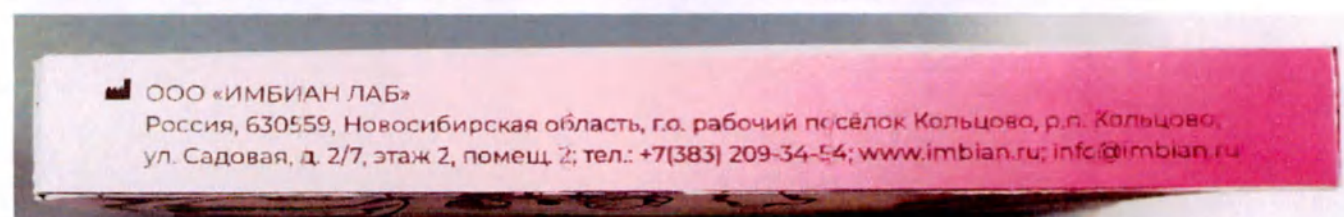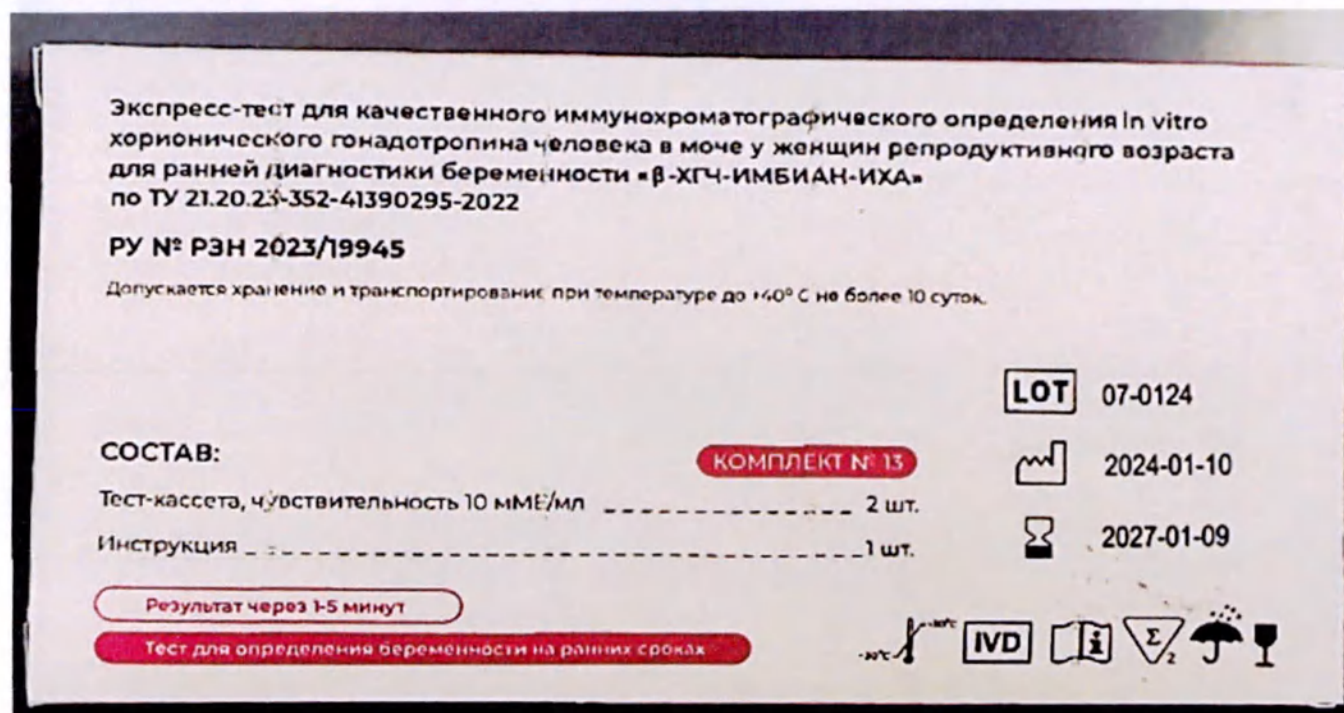

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ БЕРЕМЕННОСТЬ

REF

WR-009/2.13

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест
только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

Комплект № 13 (дизайн 1)

imbian

Беременность

Сверхчувствительный тест
для определения беременности
10 мМЕ/мл

2 ТЕСТ-КАССЕТЫ


ООО «ИМБИАН ЛАБ»
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Тест-кассета, чувствительность

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА
Тест-кассета, чувствительность
10 мМЕ/мл - 1 шт.

LOT 07-0124

2027-01-09

+30°C
-30°C
IVD

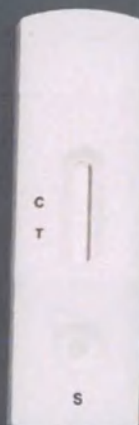


ИНСТРУКЦИЯ

Экспресс-тест
качества
иммунохроматографического
определения
хорионического
гонадотропина
моче у уже
репродуктивно

КОМПЛЕКТ № 14 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ


В состав Комплекта № 14 входят следующие компоненты:

Тест-кассета

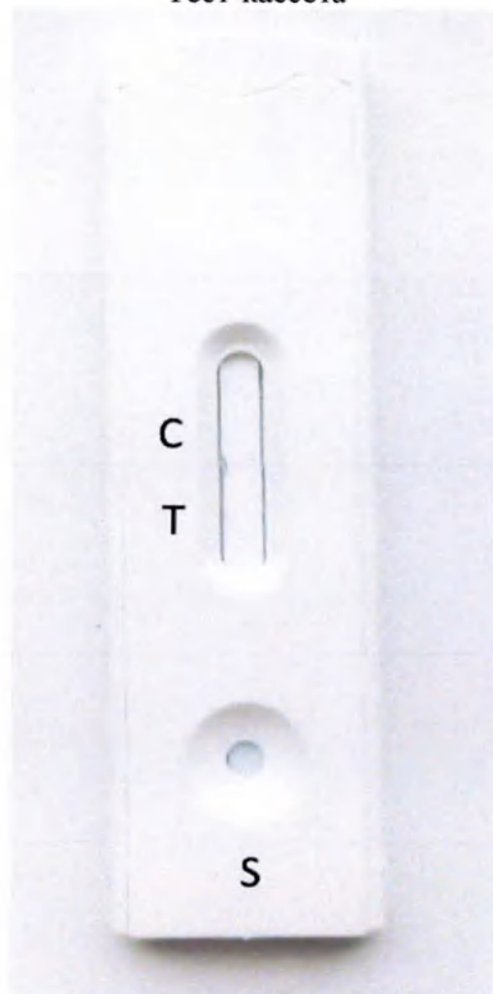

Тест-кассета (дизайн 1)



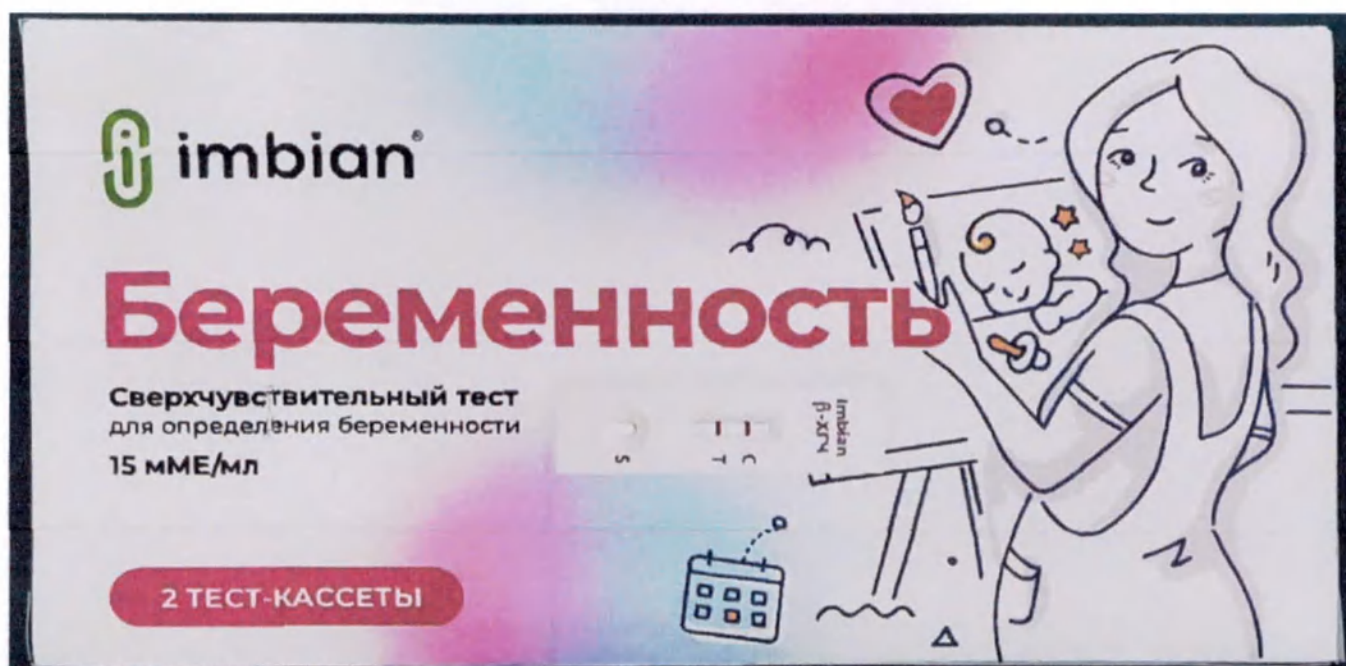

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.

СОСТАВ:

Тест-кассета, чувствительность 15 мМЕ/мл¹ ----- 2 шт.

Инструкция ----- 1 шт.

КОМПЛЕКТ N 14


LOT 07-0124

2024-01-10

2027-01-09

Результат через 1-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках




**ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ**



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

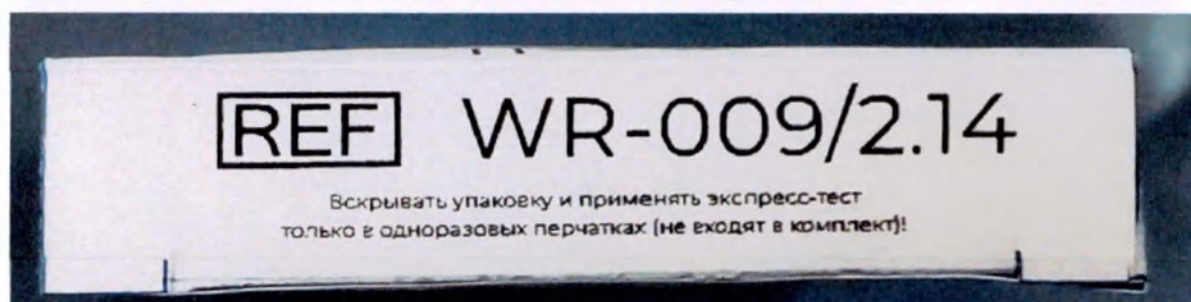


Комплект № 14 (дизайн 1)



КОМПЛЕКТ № 15 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ


В состав Комплекта № 15 входит следующий компонент:


Тест-кассета

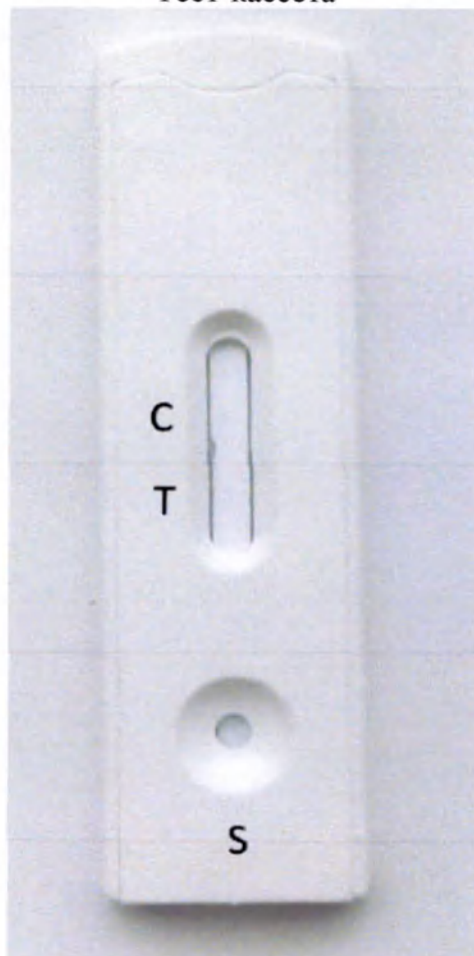

Тест-кассета (дизайн 1)



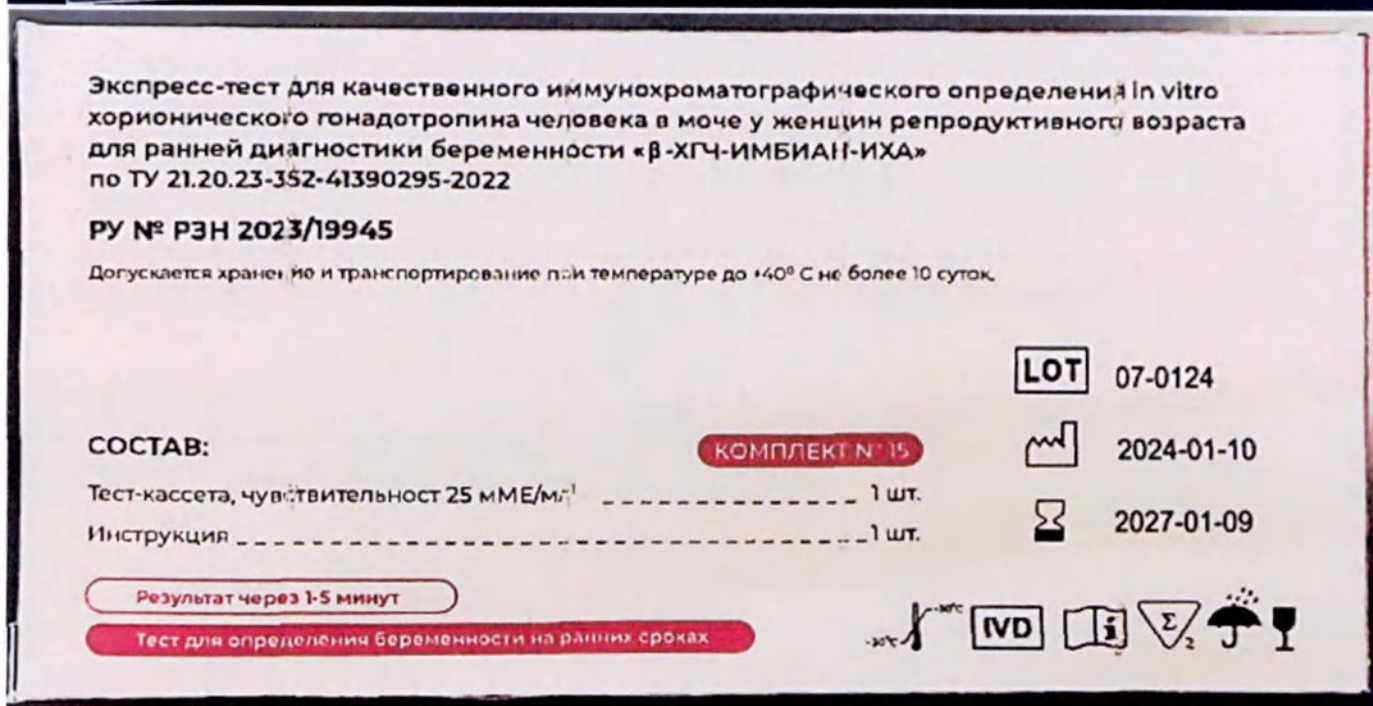

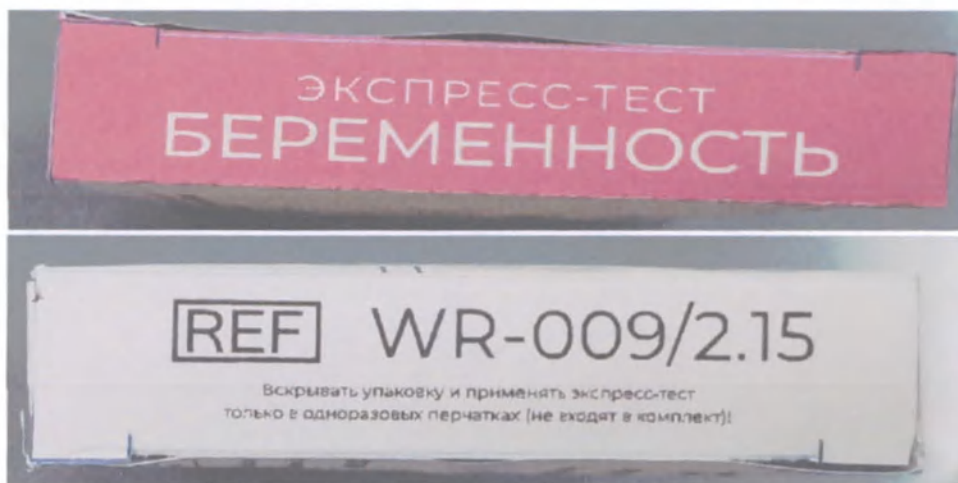


Комплект № 15 (дизайн 1)



КОМПЛЕКТ № 16 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 16 входят следующие компоненты:


Струйный тест

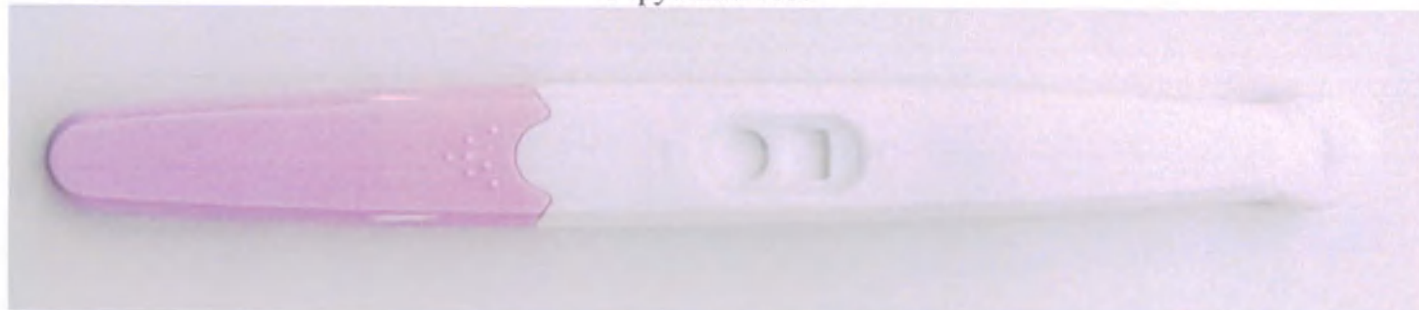

ИЛИ



Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой (дизайн 1)

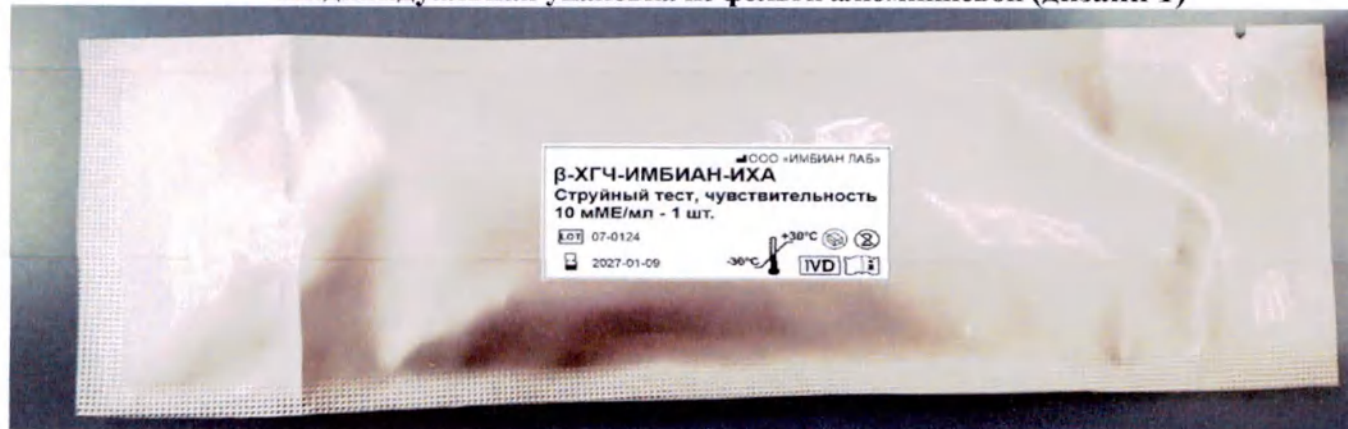

Потребительская упаковка (дизайн 1)



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



imbian®

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ

REF

WR-009/2.16

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест
только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

Комплект № 16 (дизайн 1)



КОМПЛЕКТ № 17 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 17 входят следующие компоненты:


Струйный тест



ИЛИ



Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой
Струйный тест (дизайн 1)

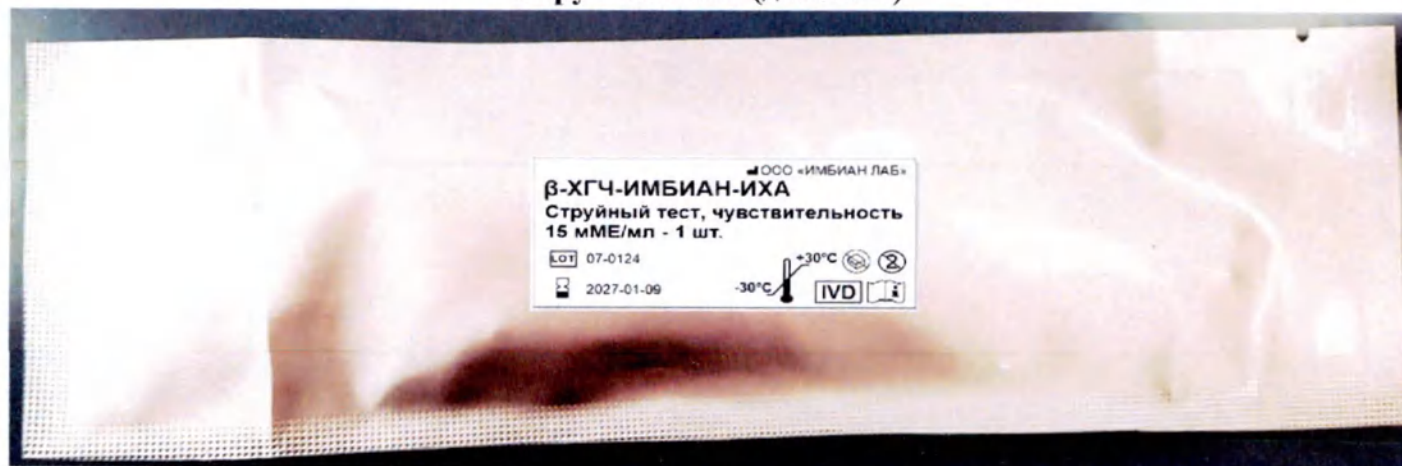


Потребительская упаковка (дизайн 1)



Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения
in vitro хорионического гонадотропина человека в моче у женщин репродуктивного
возраста для ранней диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

РУ № РЗН 2023/19945

Допускается хранение и транспортирование при температуре до +40°С не более 10 суток.



СОСТАВ:

Струйный тест, чувствительность 15 мМЕ/мл 2 шт.
Инструкция 1 шт.

КОМПЛЕКТ № 17

LOT 07-0124

2024-01-10

2027-01-09

Результат через 3-5 минут

Тест для определения беременности на ранних сроках

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ



imbian®

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Россия, 630559, Новосибирская область, г.о. рабочий посёлок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2; тел.: +7(383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
БЕРЕМЕННОСТЬ

REF WR-009/2.17

Вскрыть упаковку и применить экспресс-тест
только в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

Комплект № 17 (дизайн 1)



КОМПЛЕКТ № 18 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ


В состав Комплекта № 18 входят следующие компоненты:
Струйный тест






ИЛИ



Индивидуальная упаковка из фольги алюминиевой
Струйный тест (дизайн 1)

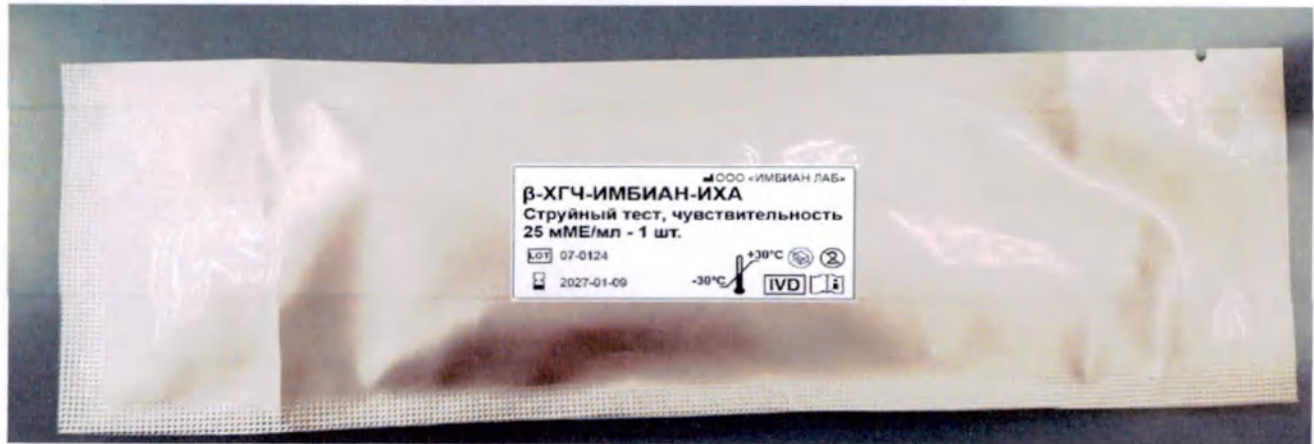

Потребительская упаковка (дизайн 1)

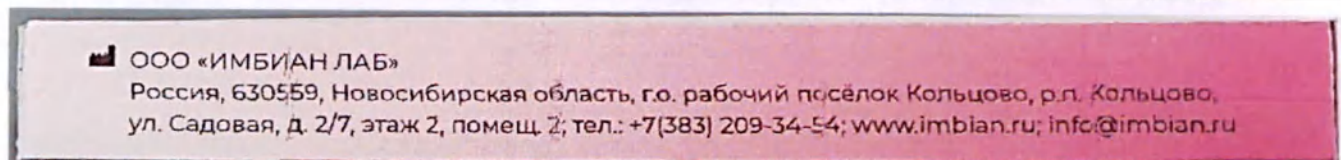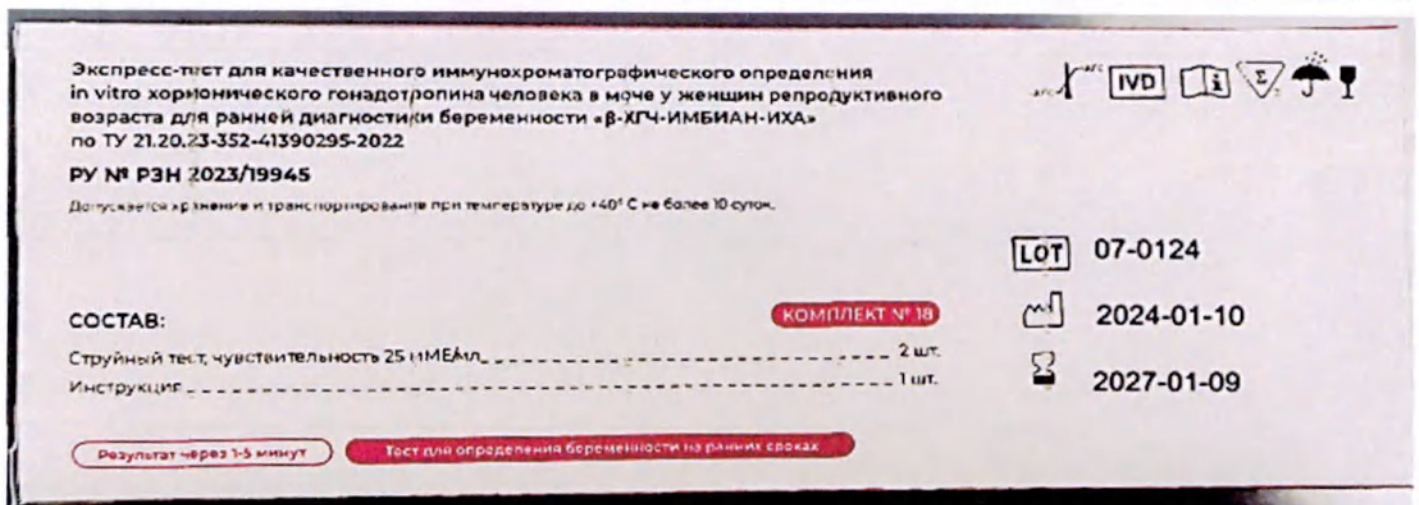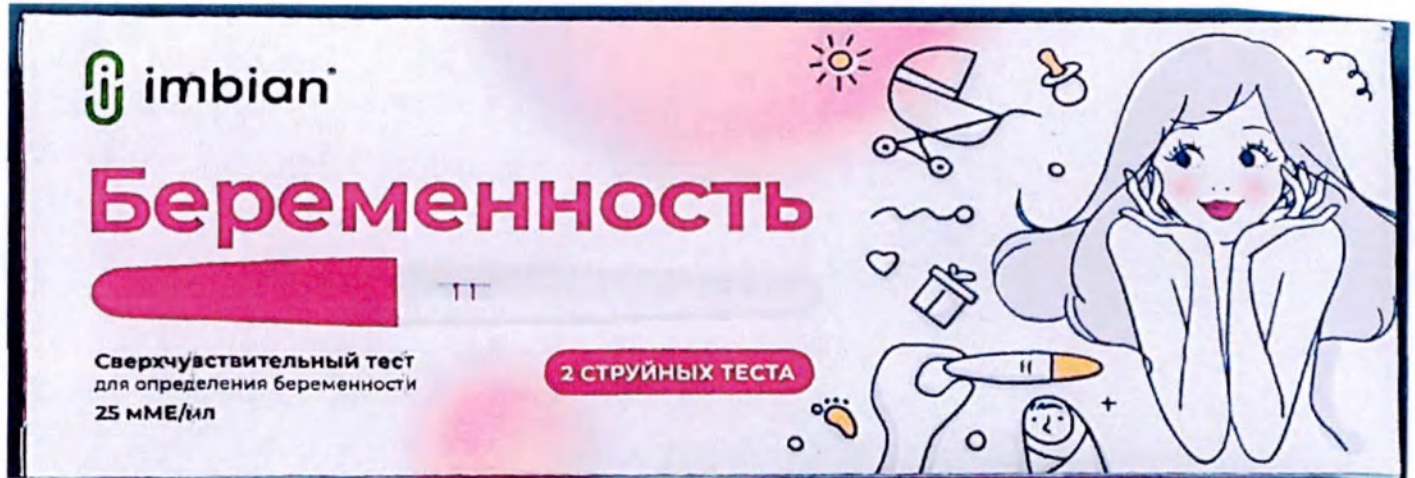




Комплект № 18 (дизайн 1)




КОМПЛЕКТ № 19 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 19 входят следующие компоненты:

Тест-кассета

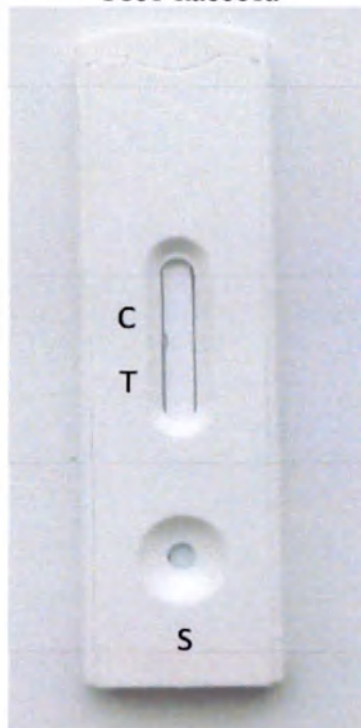

Тест-кассета (дизайн 1)

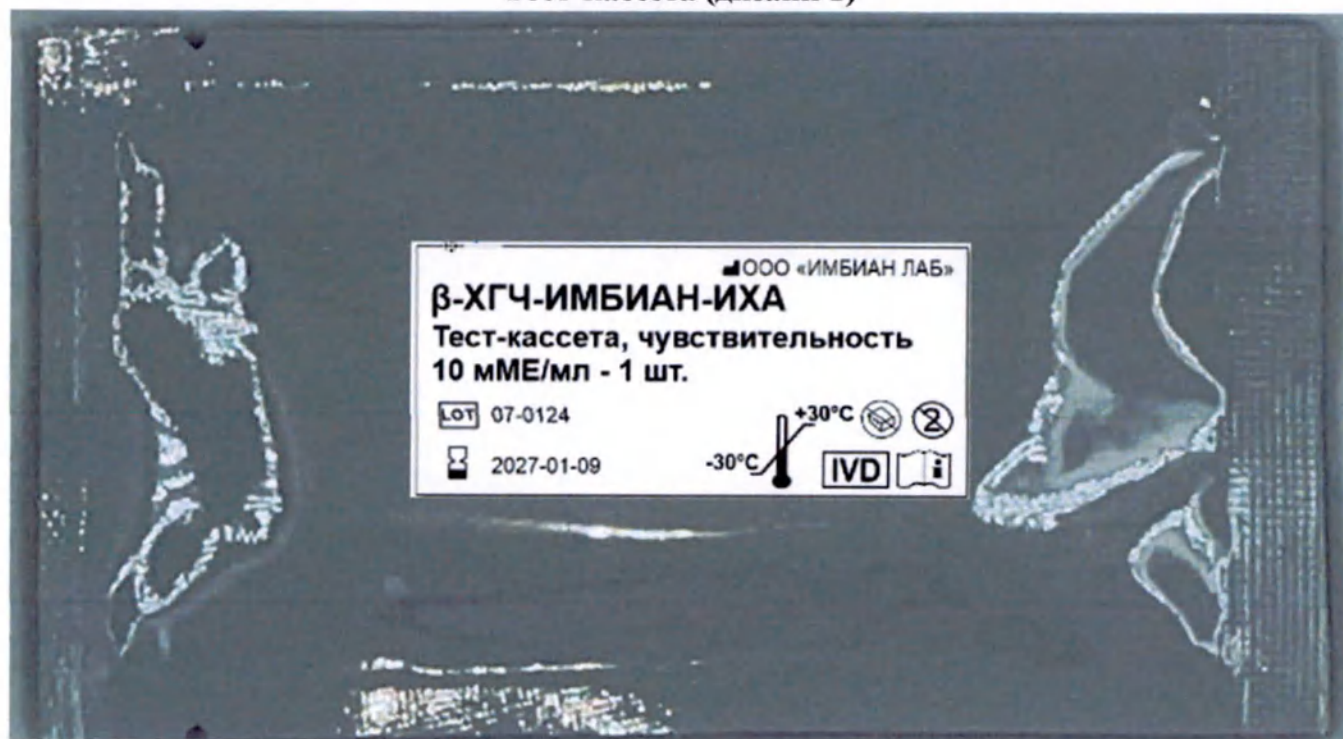

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 19

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

Тест для определения беременности
на ранних сроках

1. Тест-кассета, чувствительность 10 мМЕ/мл
2. Инструкция

20 шт.
1 шт.

LOT 07-0124

 2024-01-10

 2027-01-09


РУ № РЗН 2023/19945

Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только
в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

REF WR-009/20.19

Допускается хранение и транспортирование при
температуре до +40 °С не более 10 суток.

Imbian



Потребительская упаковка (дизайн 1)


Комплект № 19 (дизайн 1)




КОМПЛЕКТ № 20 ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА РАННИХ СРОКАХ

В состав Комплекта № 20 входят следующие компоненты:

Тест-кассета

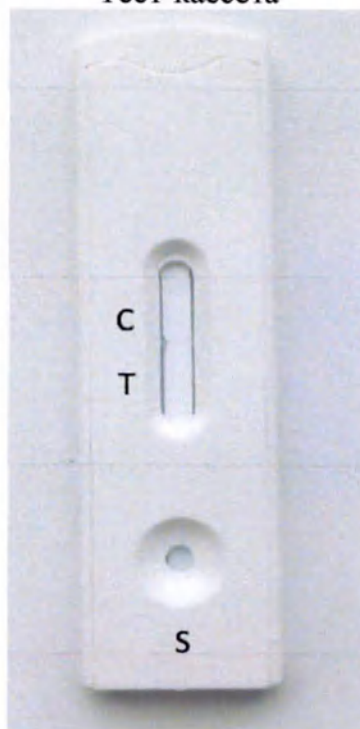

Тест-кассета (дизайн 1)

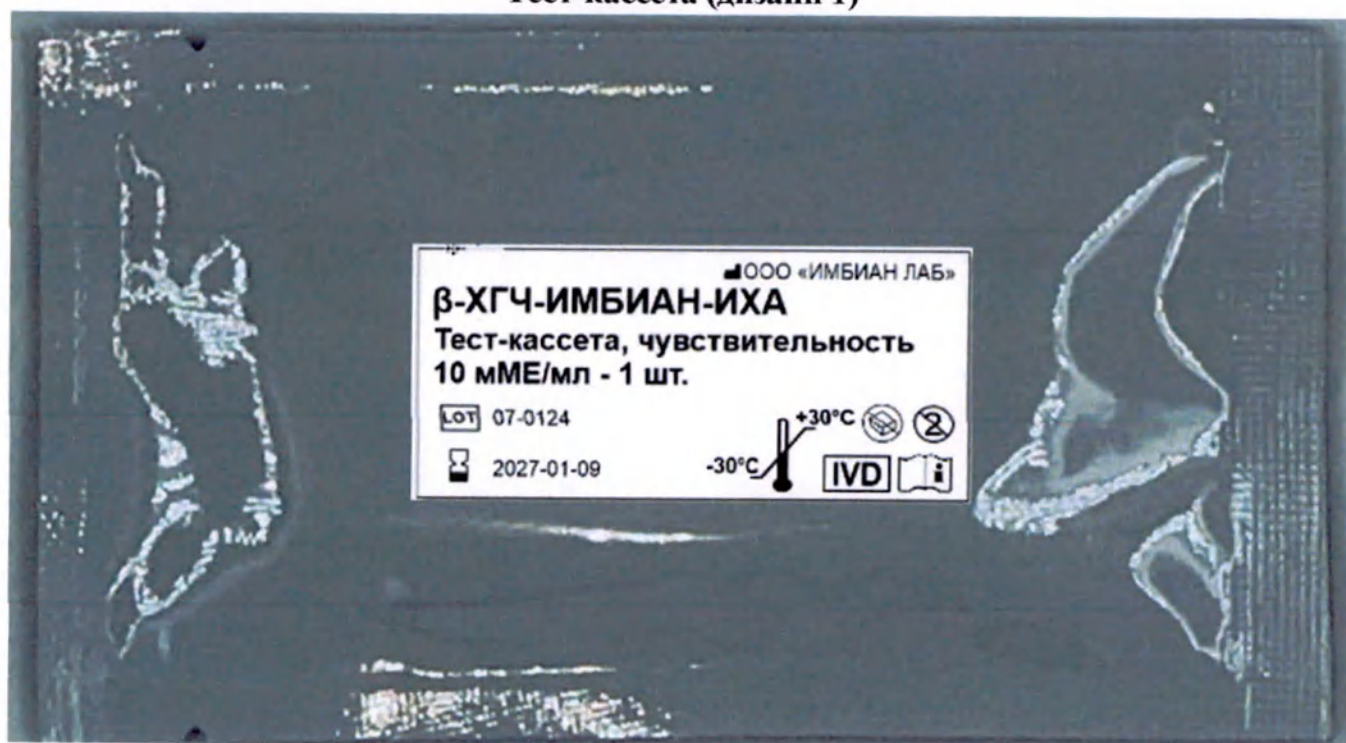

**β-ХГЧ-
ИМБИАН-ИХА**
Комплект № 20

Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения in vitro
хорионического гонадотропина человека в моче
у женщин репродуктивного возраста для ранней
диагностики беременности «β-ХГЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-352-41390295-2022

Тест для определения беременности
на ранних сроках

1. Тест-кассета, чувствительность 10 мМЕ/мл
2. Инструкция

50 шт.
1 шт.

LOT



REF

WR-009/50.20

РУ № РЗН 2023/19945


Вскрывать упаковку и применять экспресс-тест только
в одноразовых перчатках (не входят в комплект)!

Допускается хранение и транспортирование при
температуре до +40 °С не более 10 суток.

Imbian



4 620102 809682



Потребительская упаковка (дизайн 1)

Комплект № 20 (дизайн 1)



[illegible]



Пронумеровано, пронумерован
и скреплено печатью

лист 06

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В. В. Осипова "В" 09 2024 г