

Руководитель группы по
качеству и регулированию
ООО «Бекмен Культер»

Пирогов М.А.

16.11.2021

дата



Фотографии

Калибраторы для калибровки исследования С-пептида, применяемого для количественного определения концентрации С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в человеческой сыворотке, плазме и моче для диагностики *in vitro* на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, «С-пептид, калибраторы (Access C-Peptide Calibrators)», в составе:

1. С-пептид, калибраторы (Access C-Peptide Calibrators):

1.1. Калибраторы S0, S1, S2, S3, S4, S5 – 6 флаконов;

1.2. Калибровочная карта со штрих-кодами.



Фото 1. Калибраторы для калибровки исследования С-пептида, применяемого для количественного определения концентрации С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в человеческой сыворотке, плазме и моче для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, «С-пептид, калибраторы (Access C-Peptide Calibrators)», внешний вид

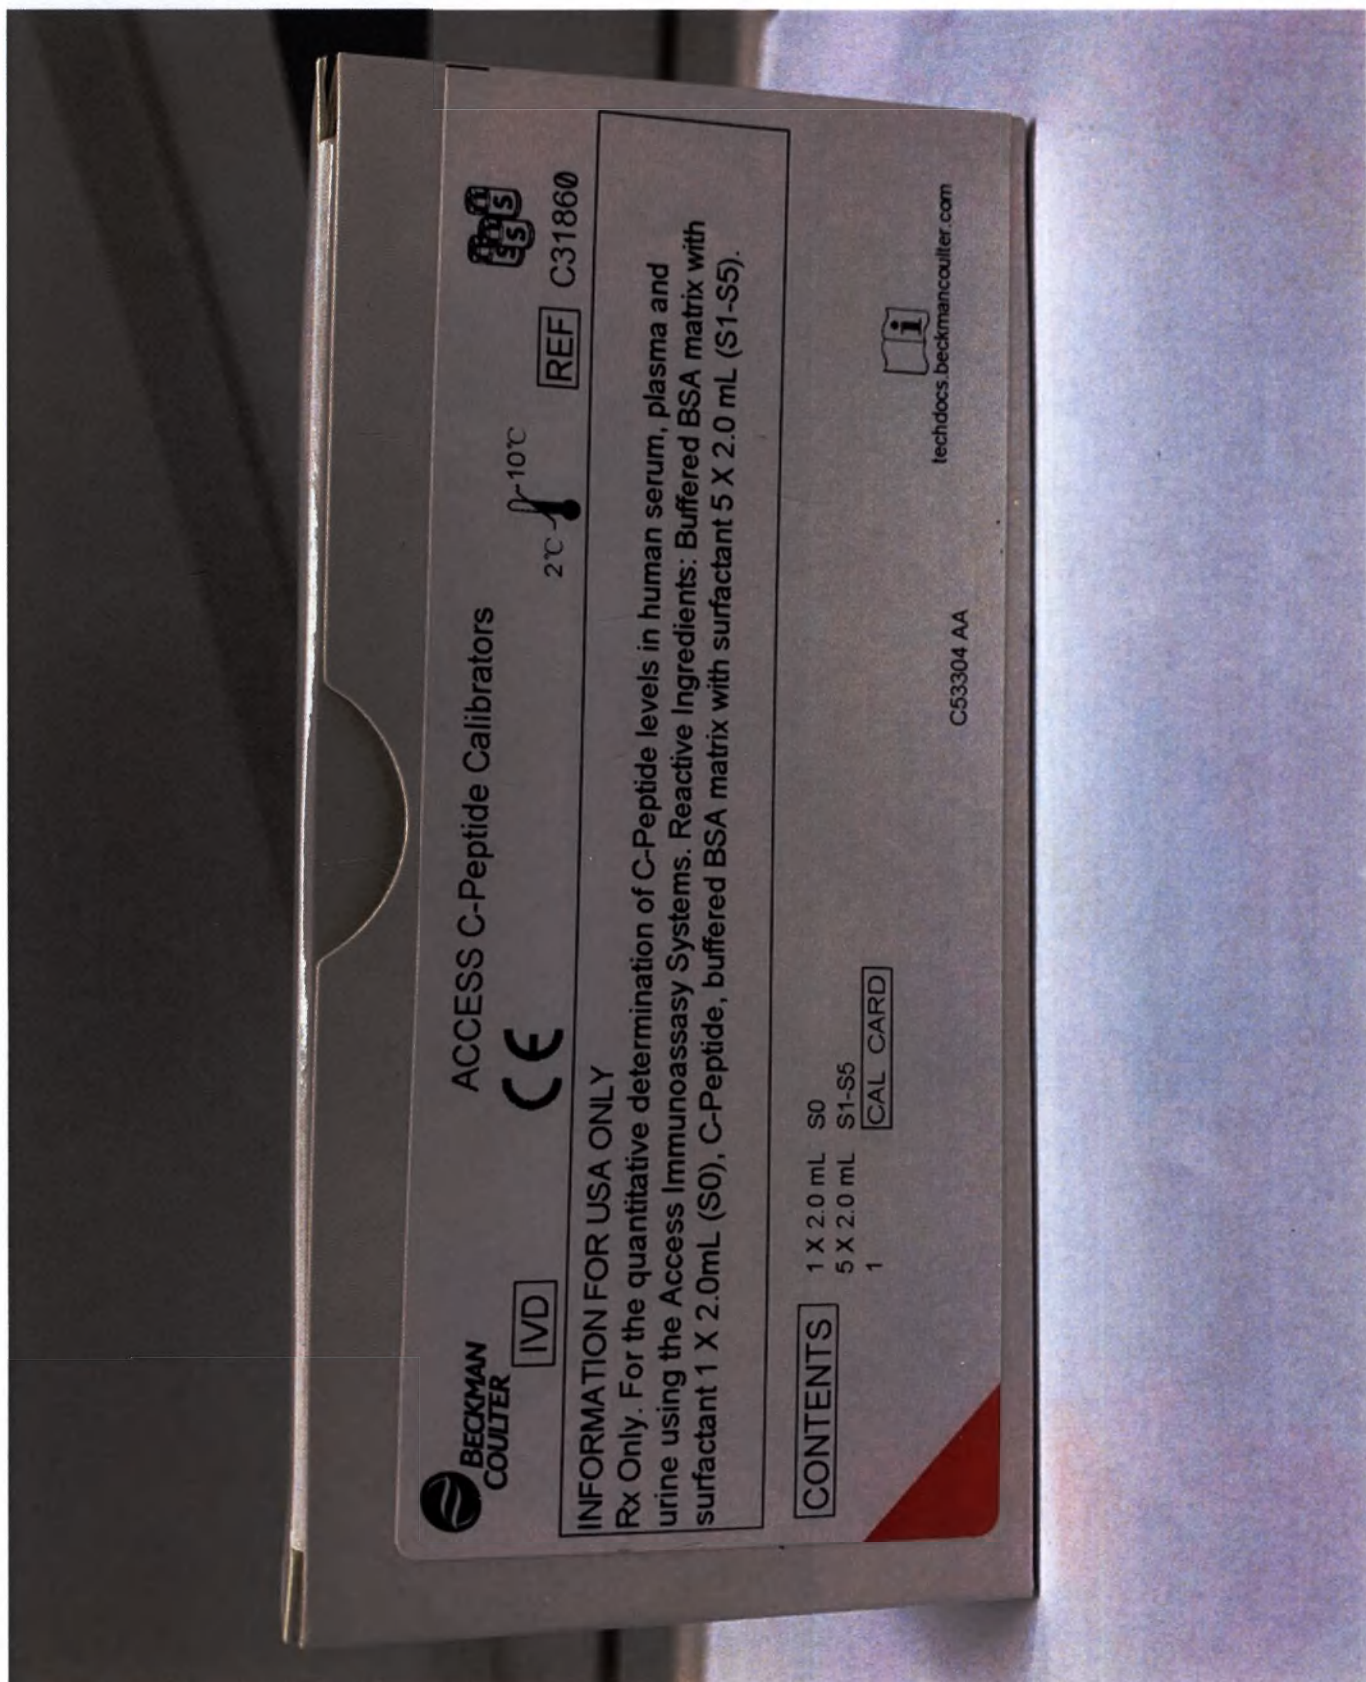


Фото 3. Калибраторы для калибровки исследования С-пептида, применяемого для количественного определения концентрации С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в человеческой сыворотке, плазме и моче для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, «С-пептид, калибраторы (Access C-Peptide Calibrators)», в упаковке

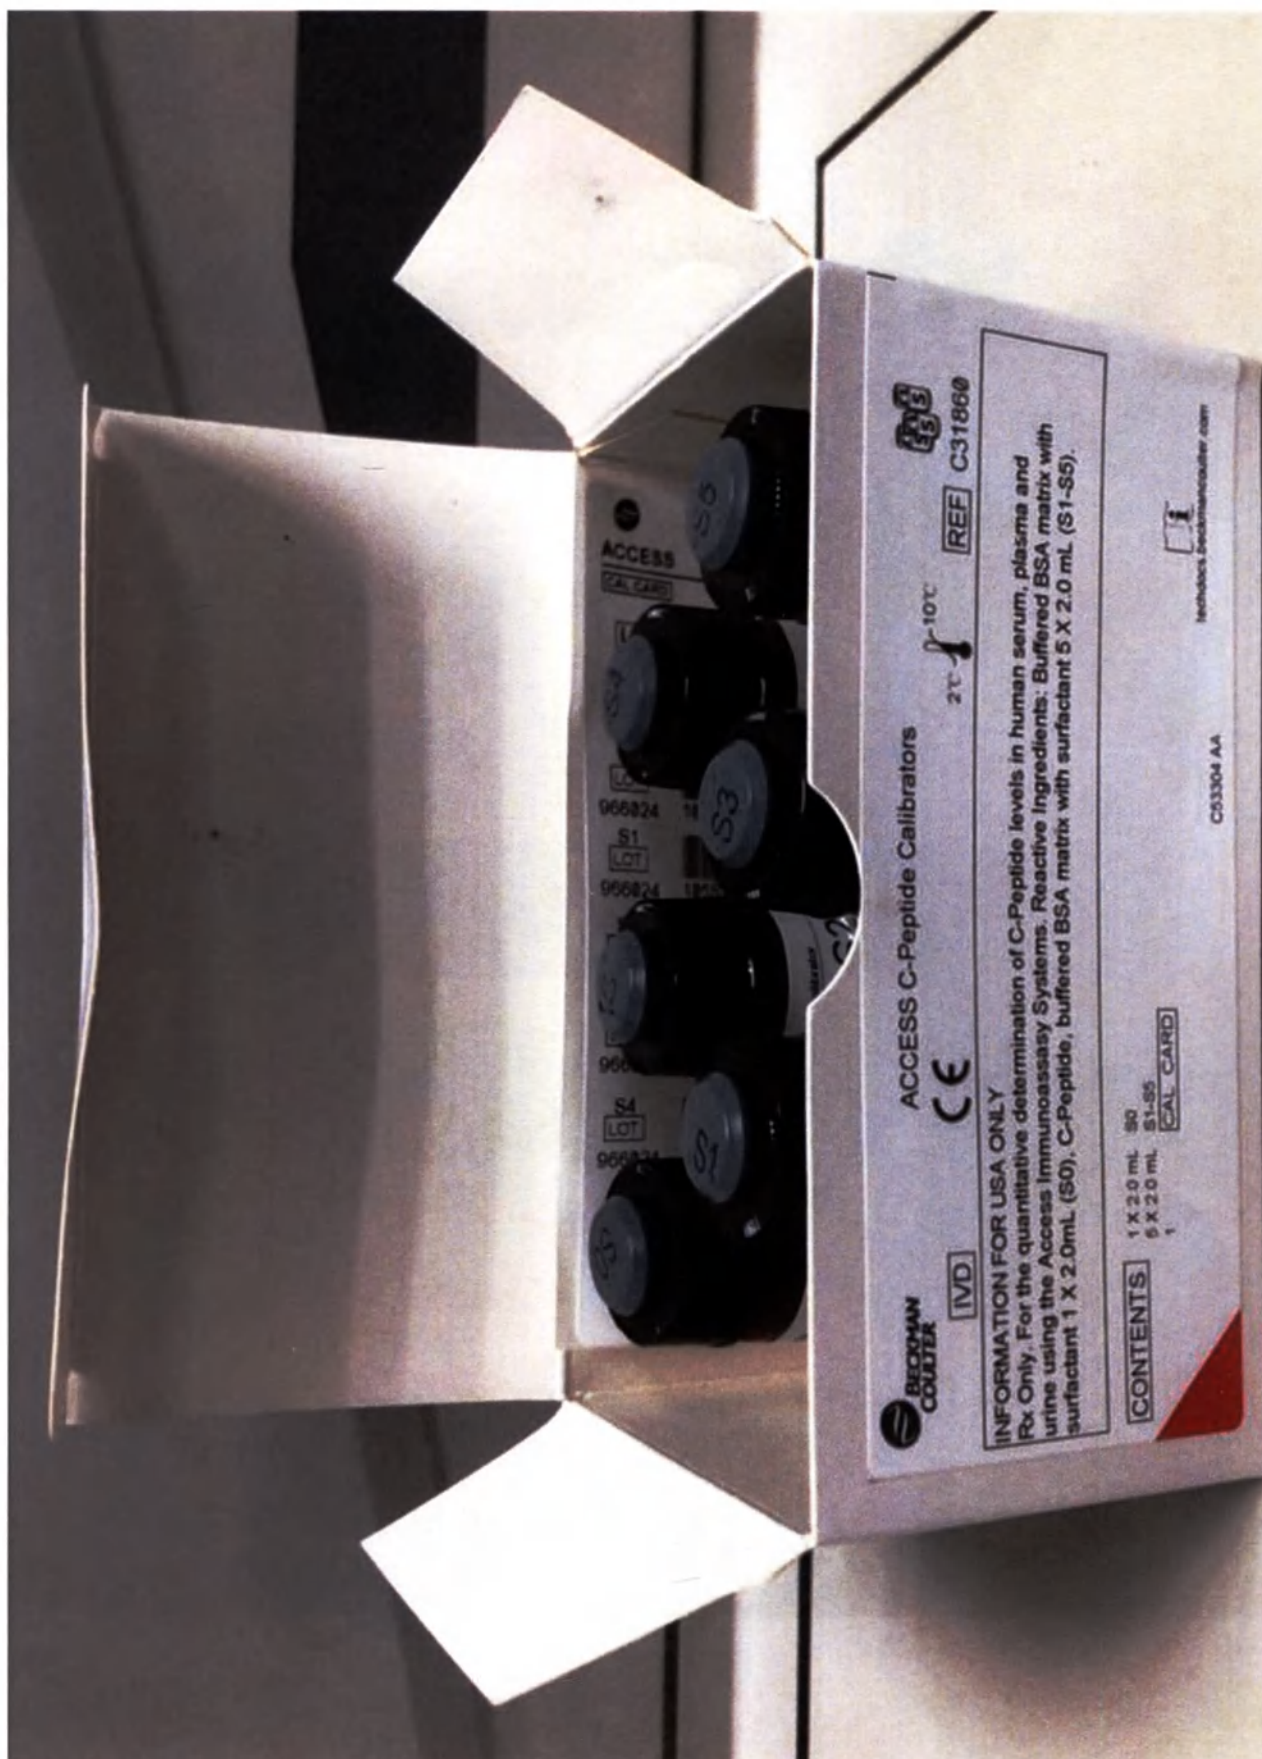


Фото 4. Калибраторы для калибровки исследования С-пептида, применяемого для количественного определения концентрации С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в человеческой сыворотке, плазме и моче для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, «С-пептид, калибраторы (Access C-Peptide Calibrators)» в открытой упаковке



ACCESS C-Peptide
Calibrators



2021-05-16

LOT


966029



+H628C318601J



+\$\$2051621966029JF



(01)15099590733360

(11)201118

(17)210516

(10)966029



2020-11-18

B98406 1.0

Фото 5. Калибраторы для калибровки исследования С-пептида, применяемого для количественного определения концентрации С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в человеческой сыворотке, плазме и моче для диагностики in vitro на анализаторах иммунохимических серии ACCESS system, «С-пептид, калибраторы (Access C-Peptide Calibrators)»

ПРОШЕГО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

6 ЛИСТОВ

