



«УТВЕРЖДАЮ»

**Менеджер по регистрации
медицинских изделий**

АО «БАЙЕР»

Тихонова М.А.

«20» октября 2020 г.



////////////////

АО «БАЙЕР»


107113, Россия, Москва
ул. 3-я Рыбинская д.18, стр.2

Тел.: (495) 234 20 00


www.bayer.ru

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система инъекционная MEDRAD Salient с принадлежностями

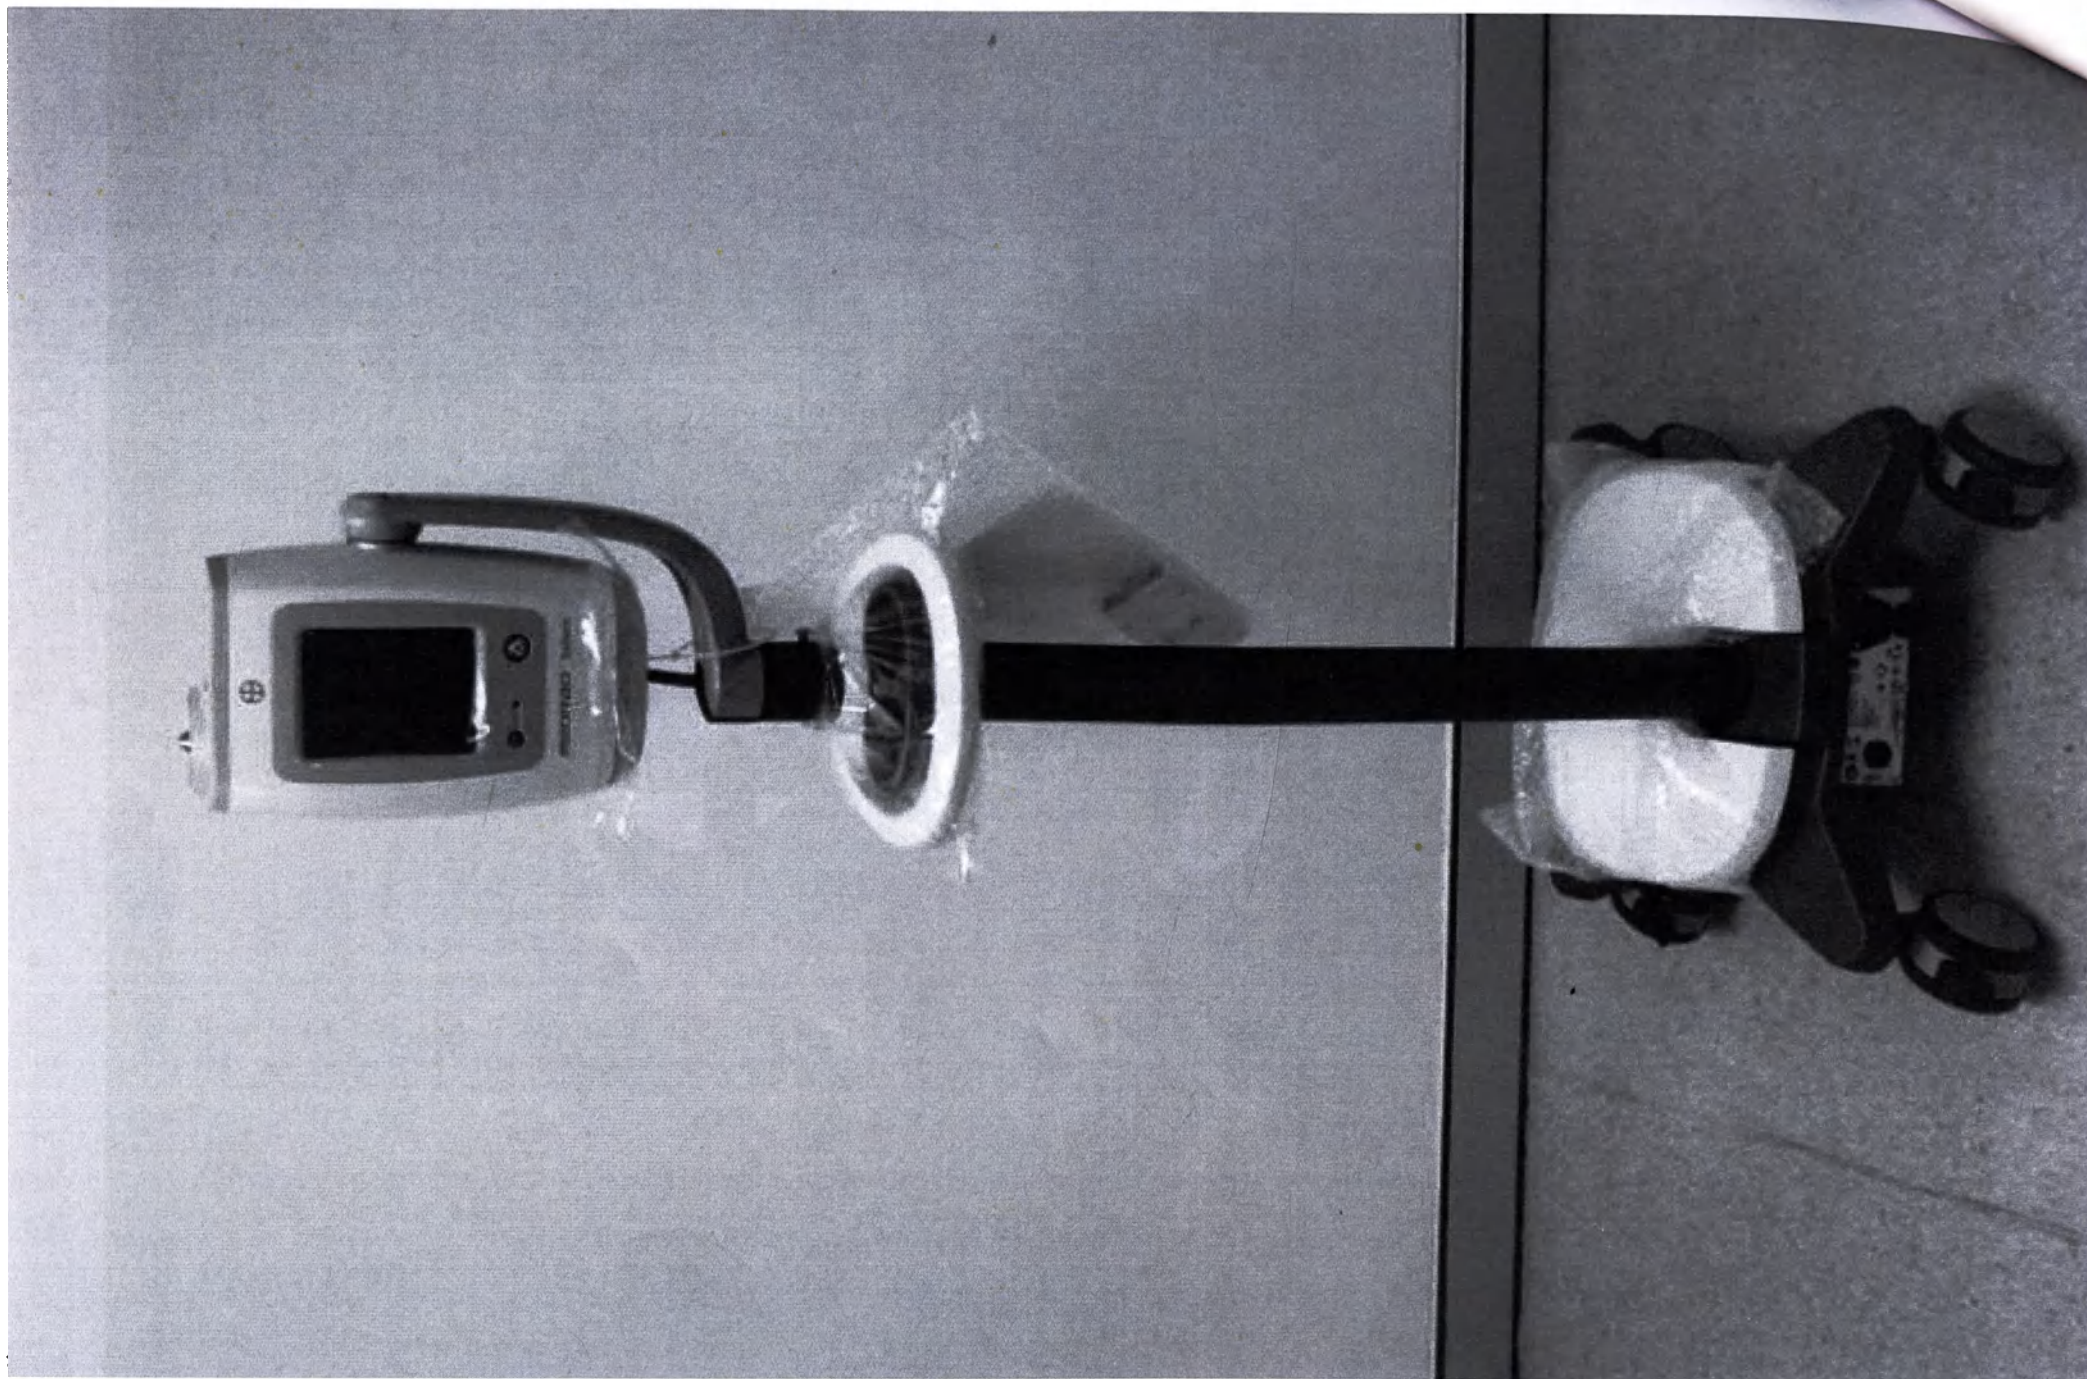


Одноемкостный иньектор для контраста / Одноемкостный иньектор для контраста с беспроводным блоком дистанционного управления

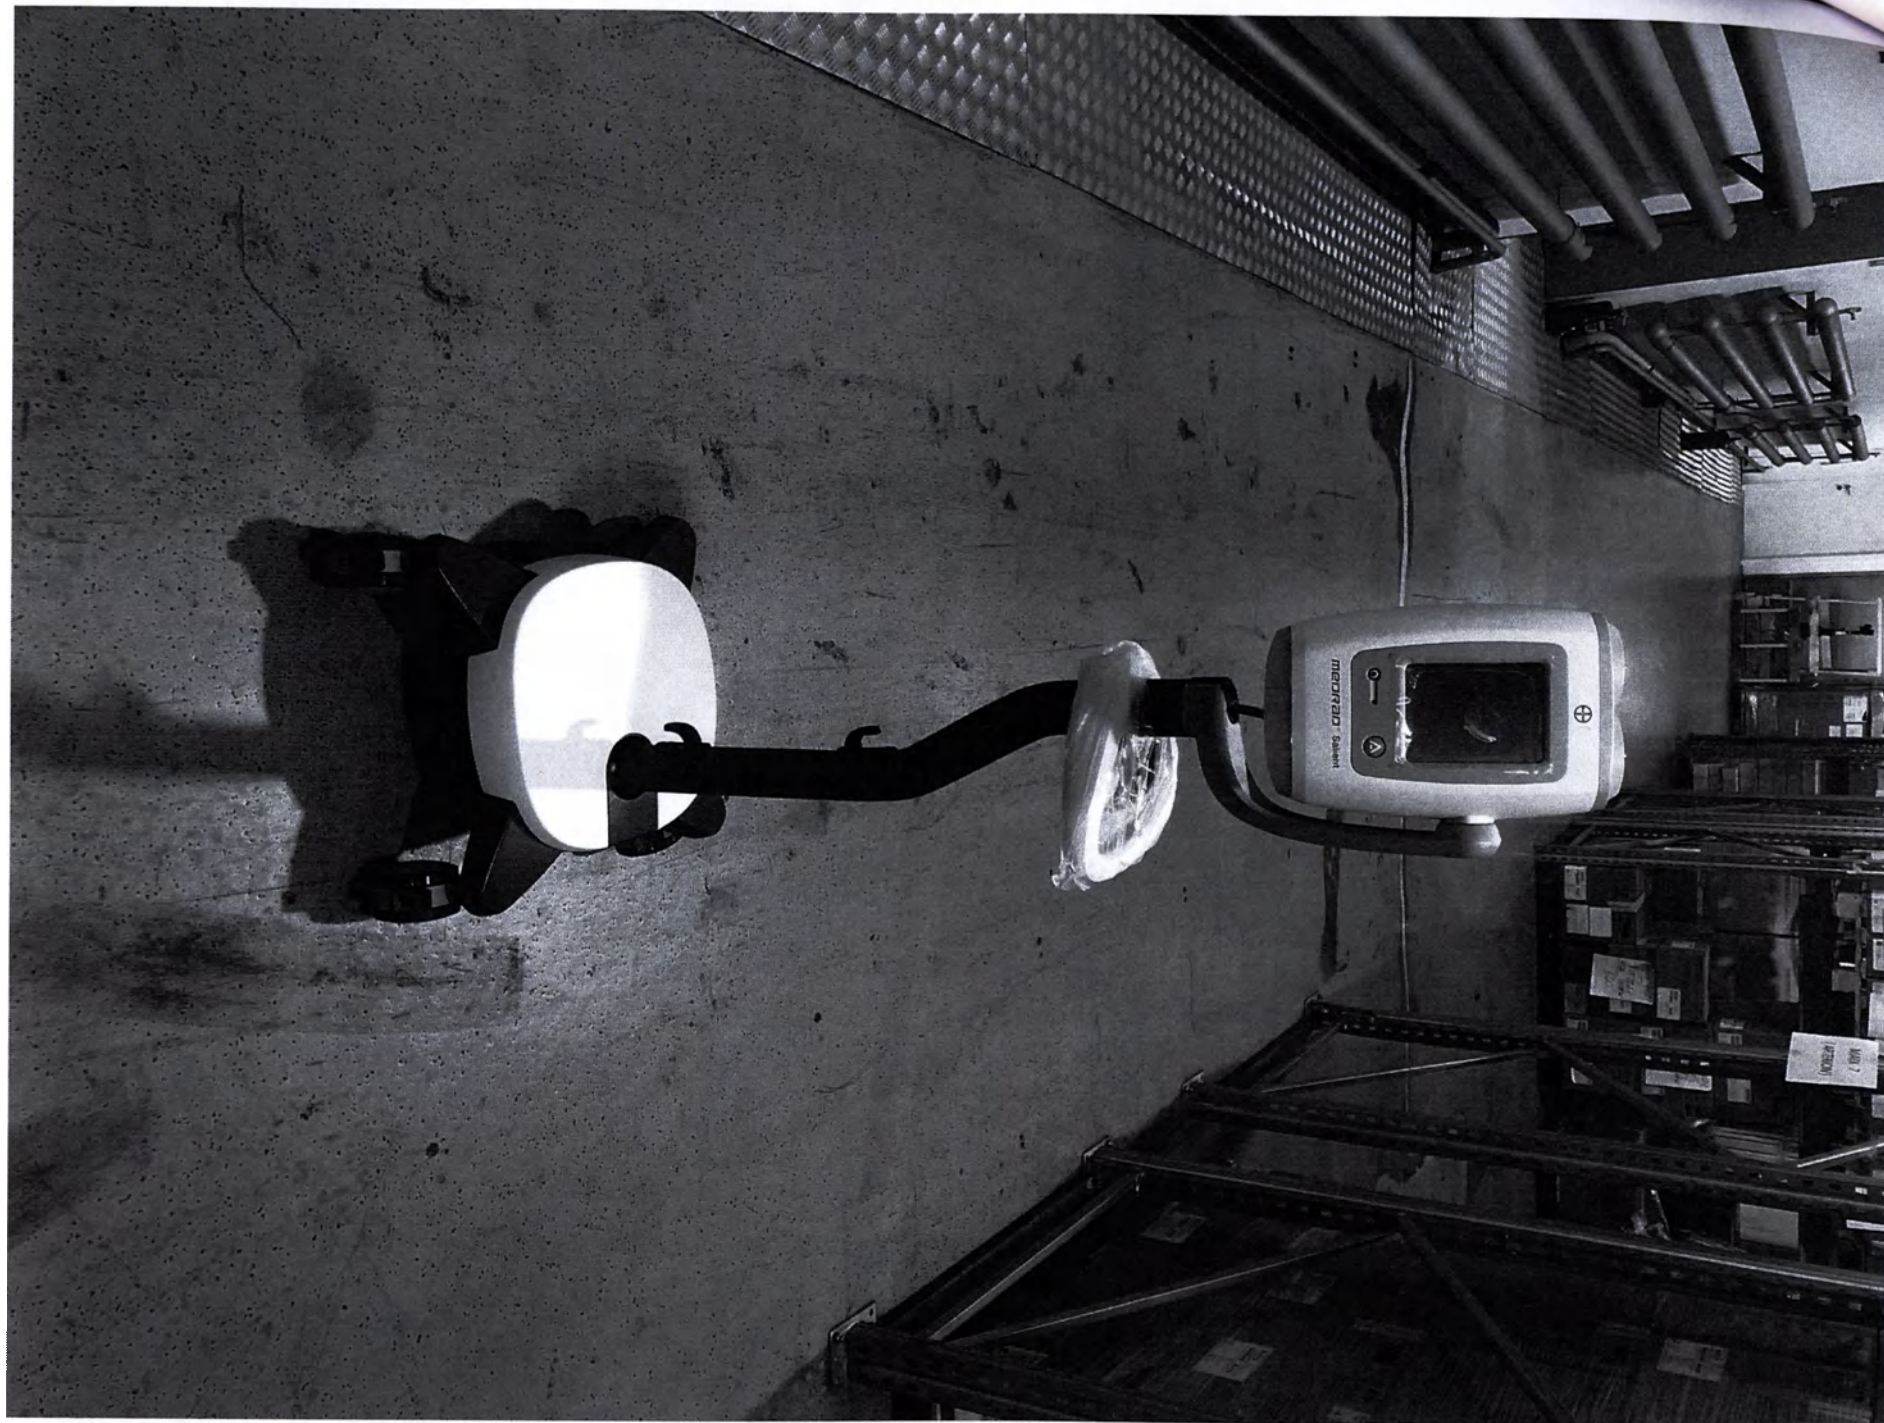



Инъекционная головка

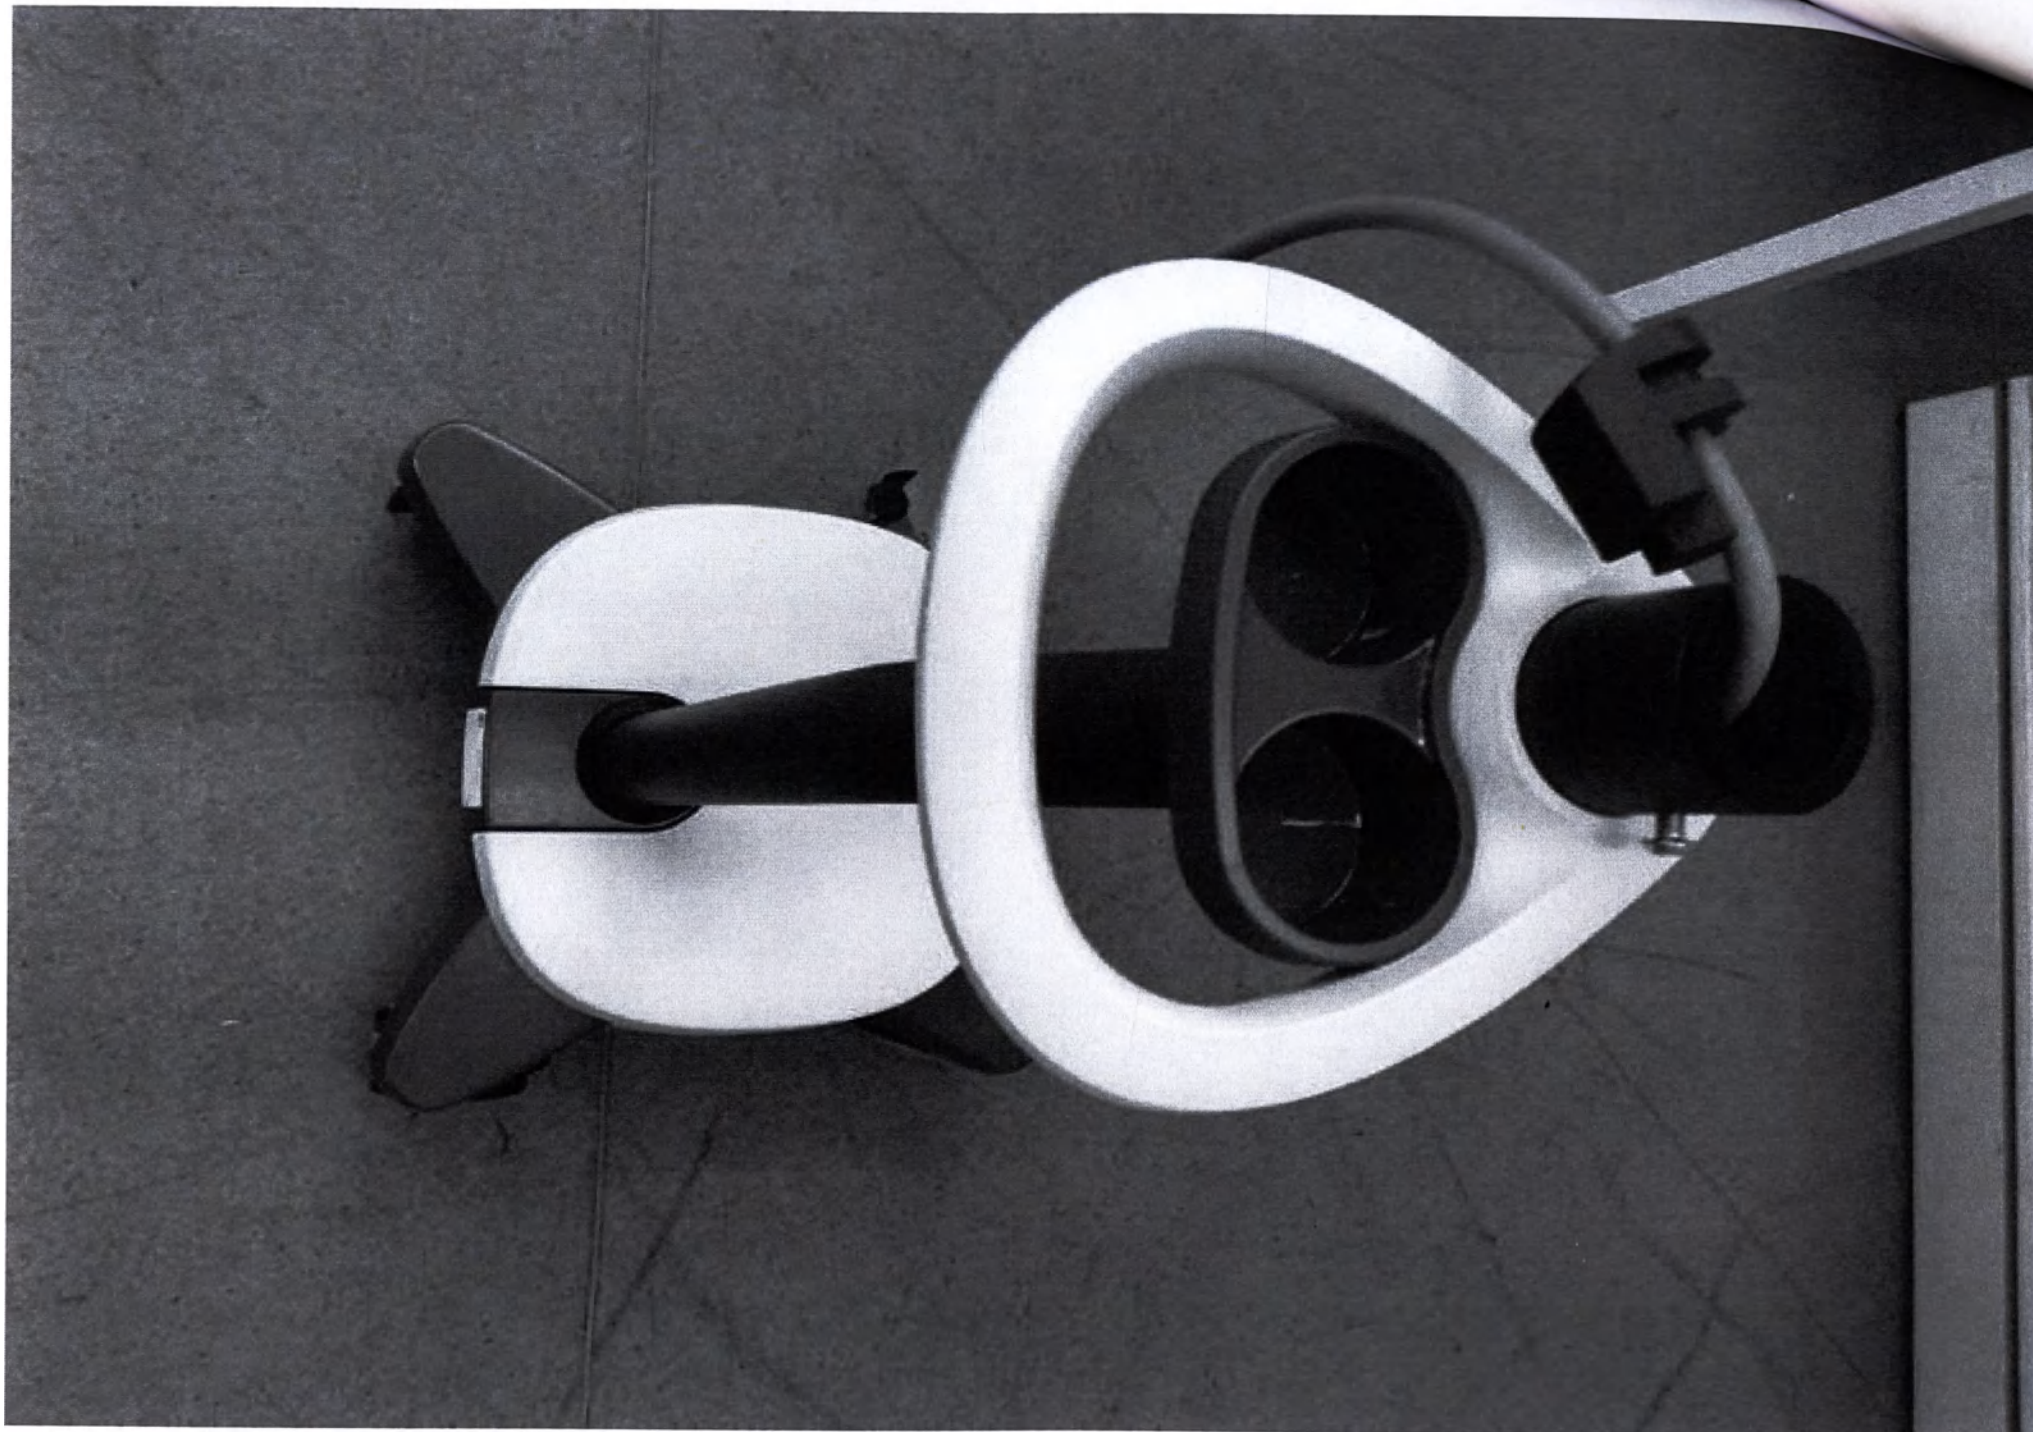


Пьедестал



Беспроводной блок дистанционного управления (только для вариантов исполнения с беспроводным блоком дистанционного управления)
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





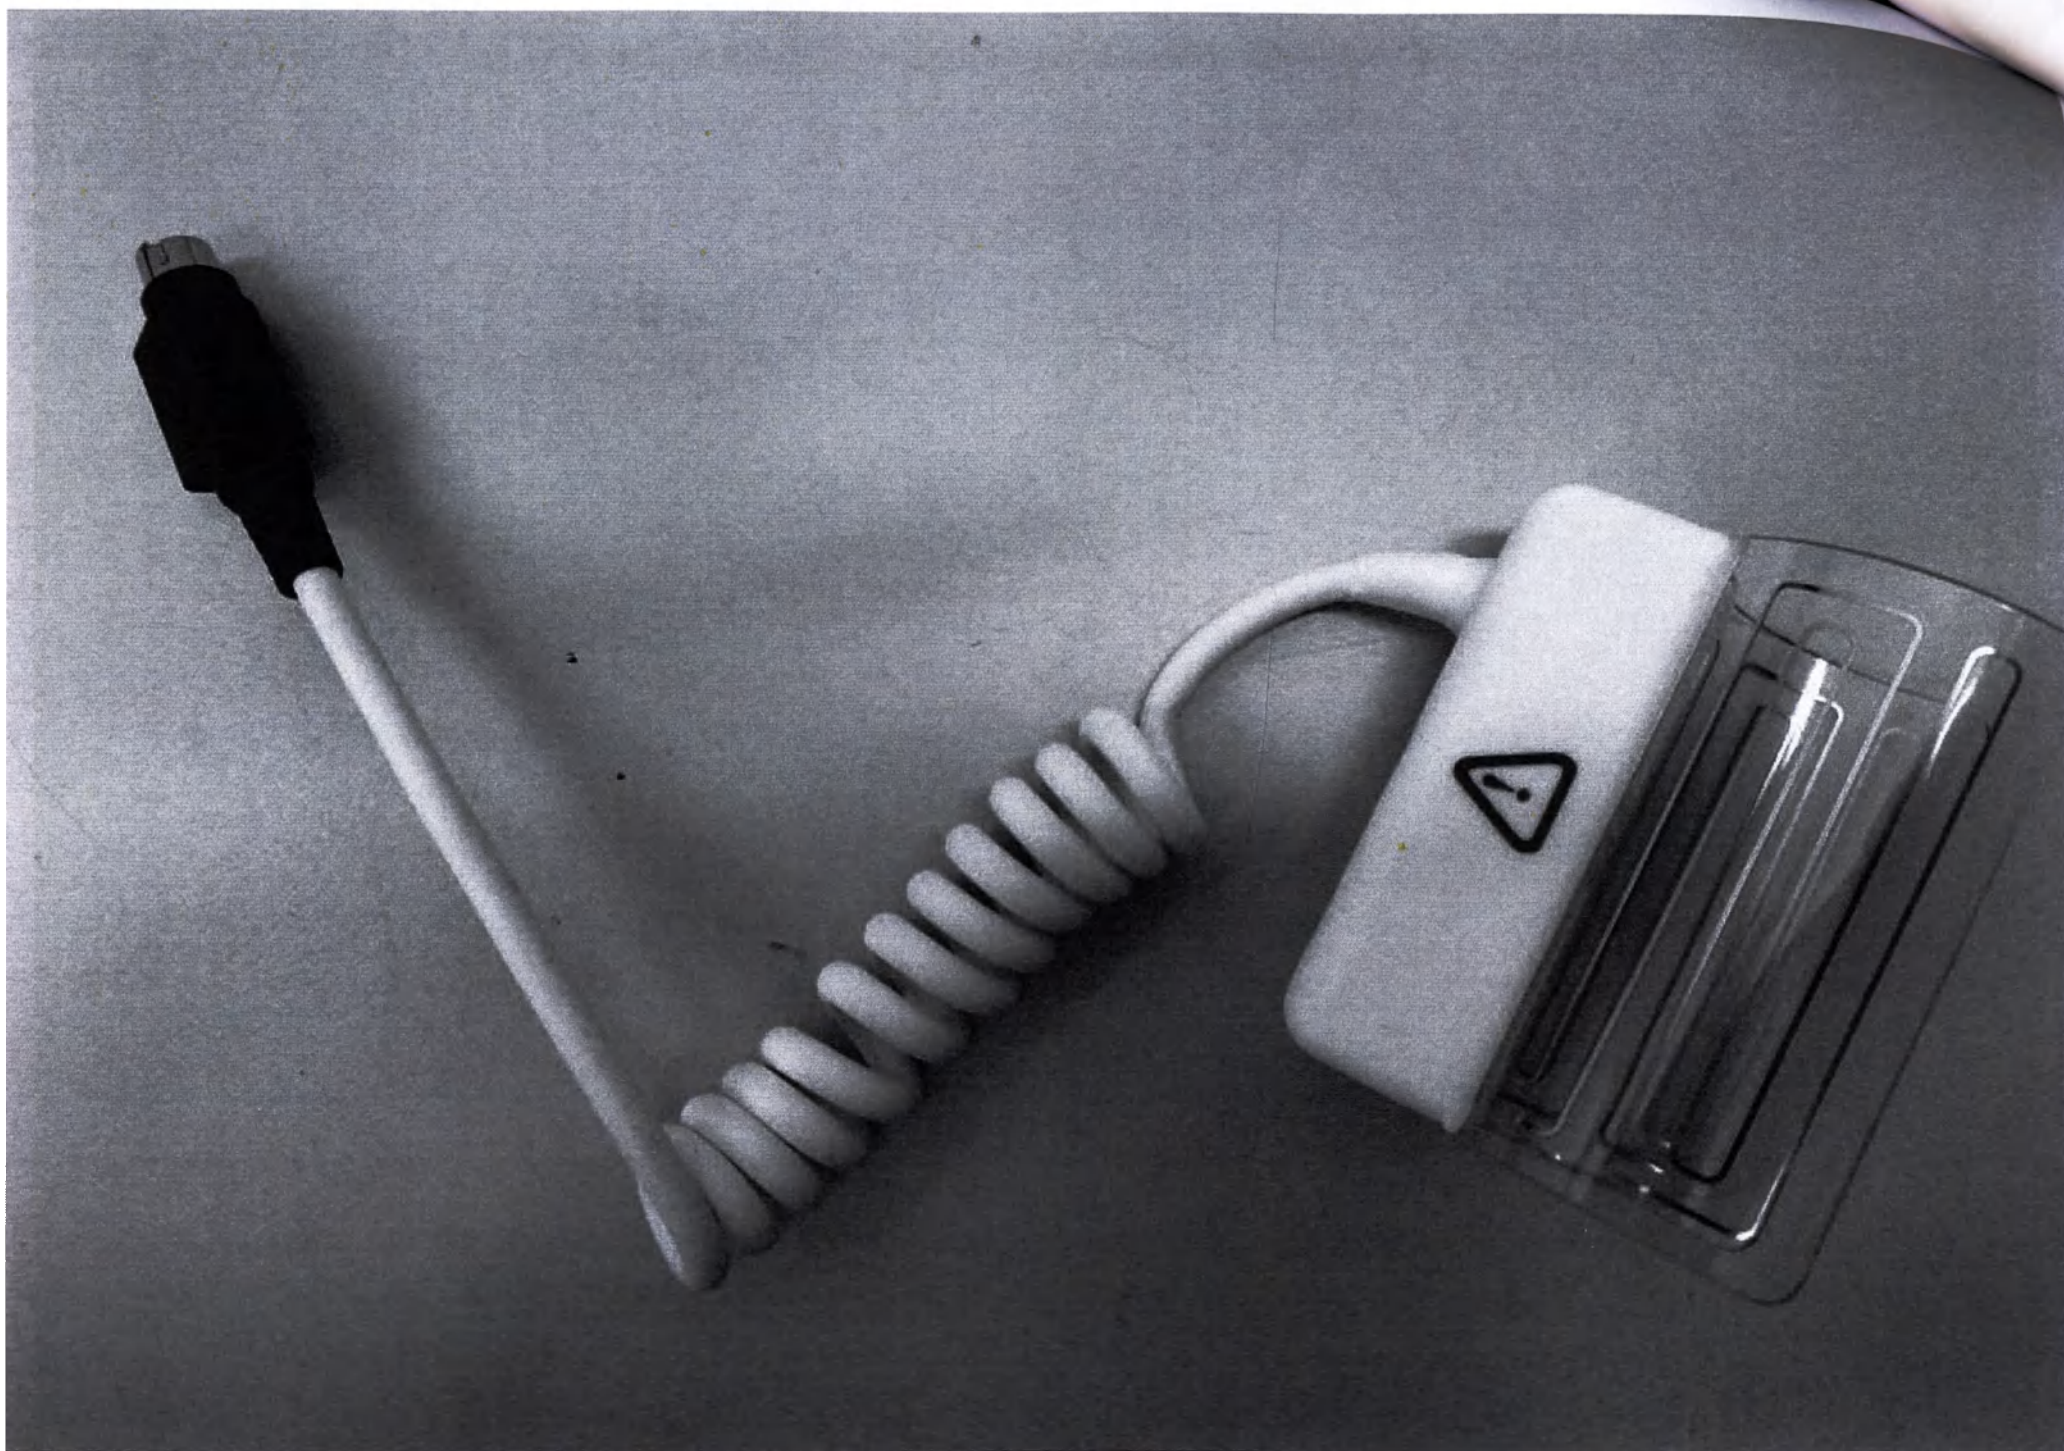



Руководство по эксплуатации

medrad® Salient
Система инъекционная

OPERATION MANUAL USB

VL50065-01


technology for performance, safety and



Усилитель сигнала Wi-Fi






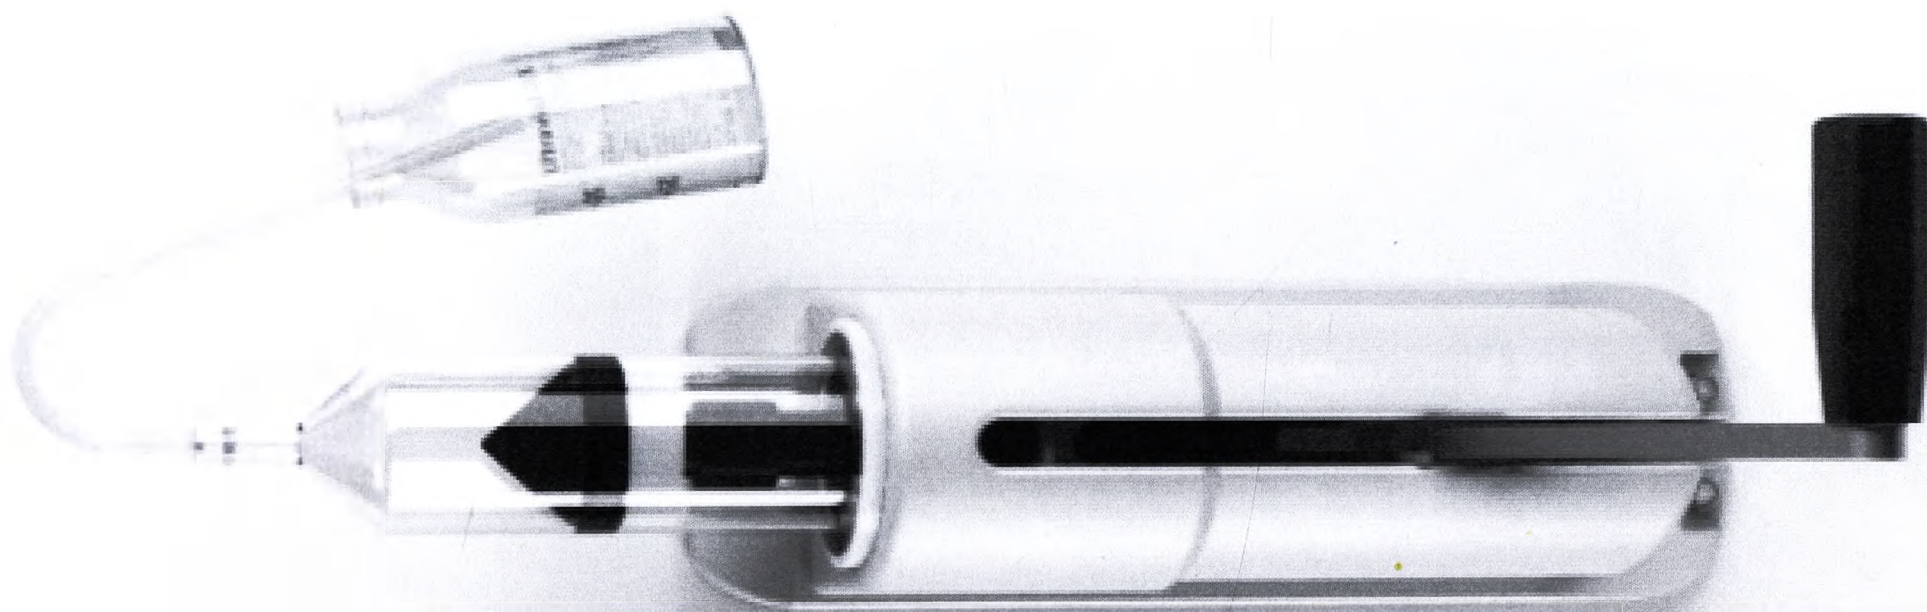



Автономный загрузчик шприца




Блок интерфейса сканера

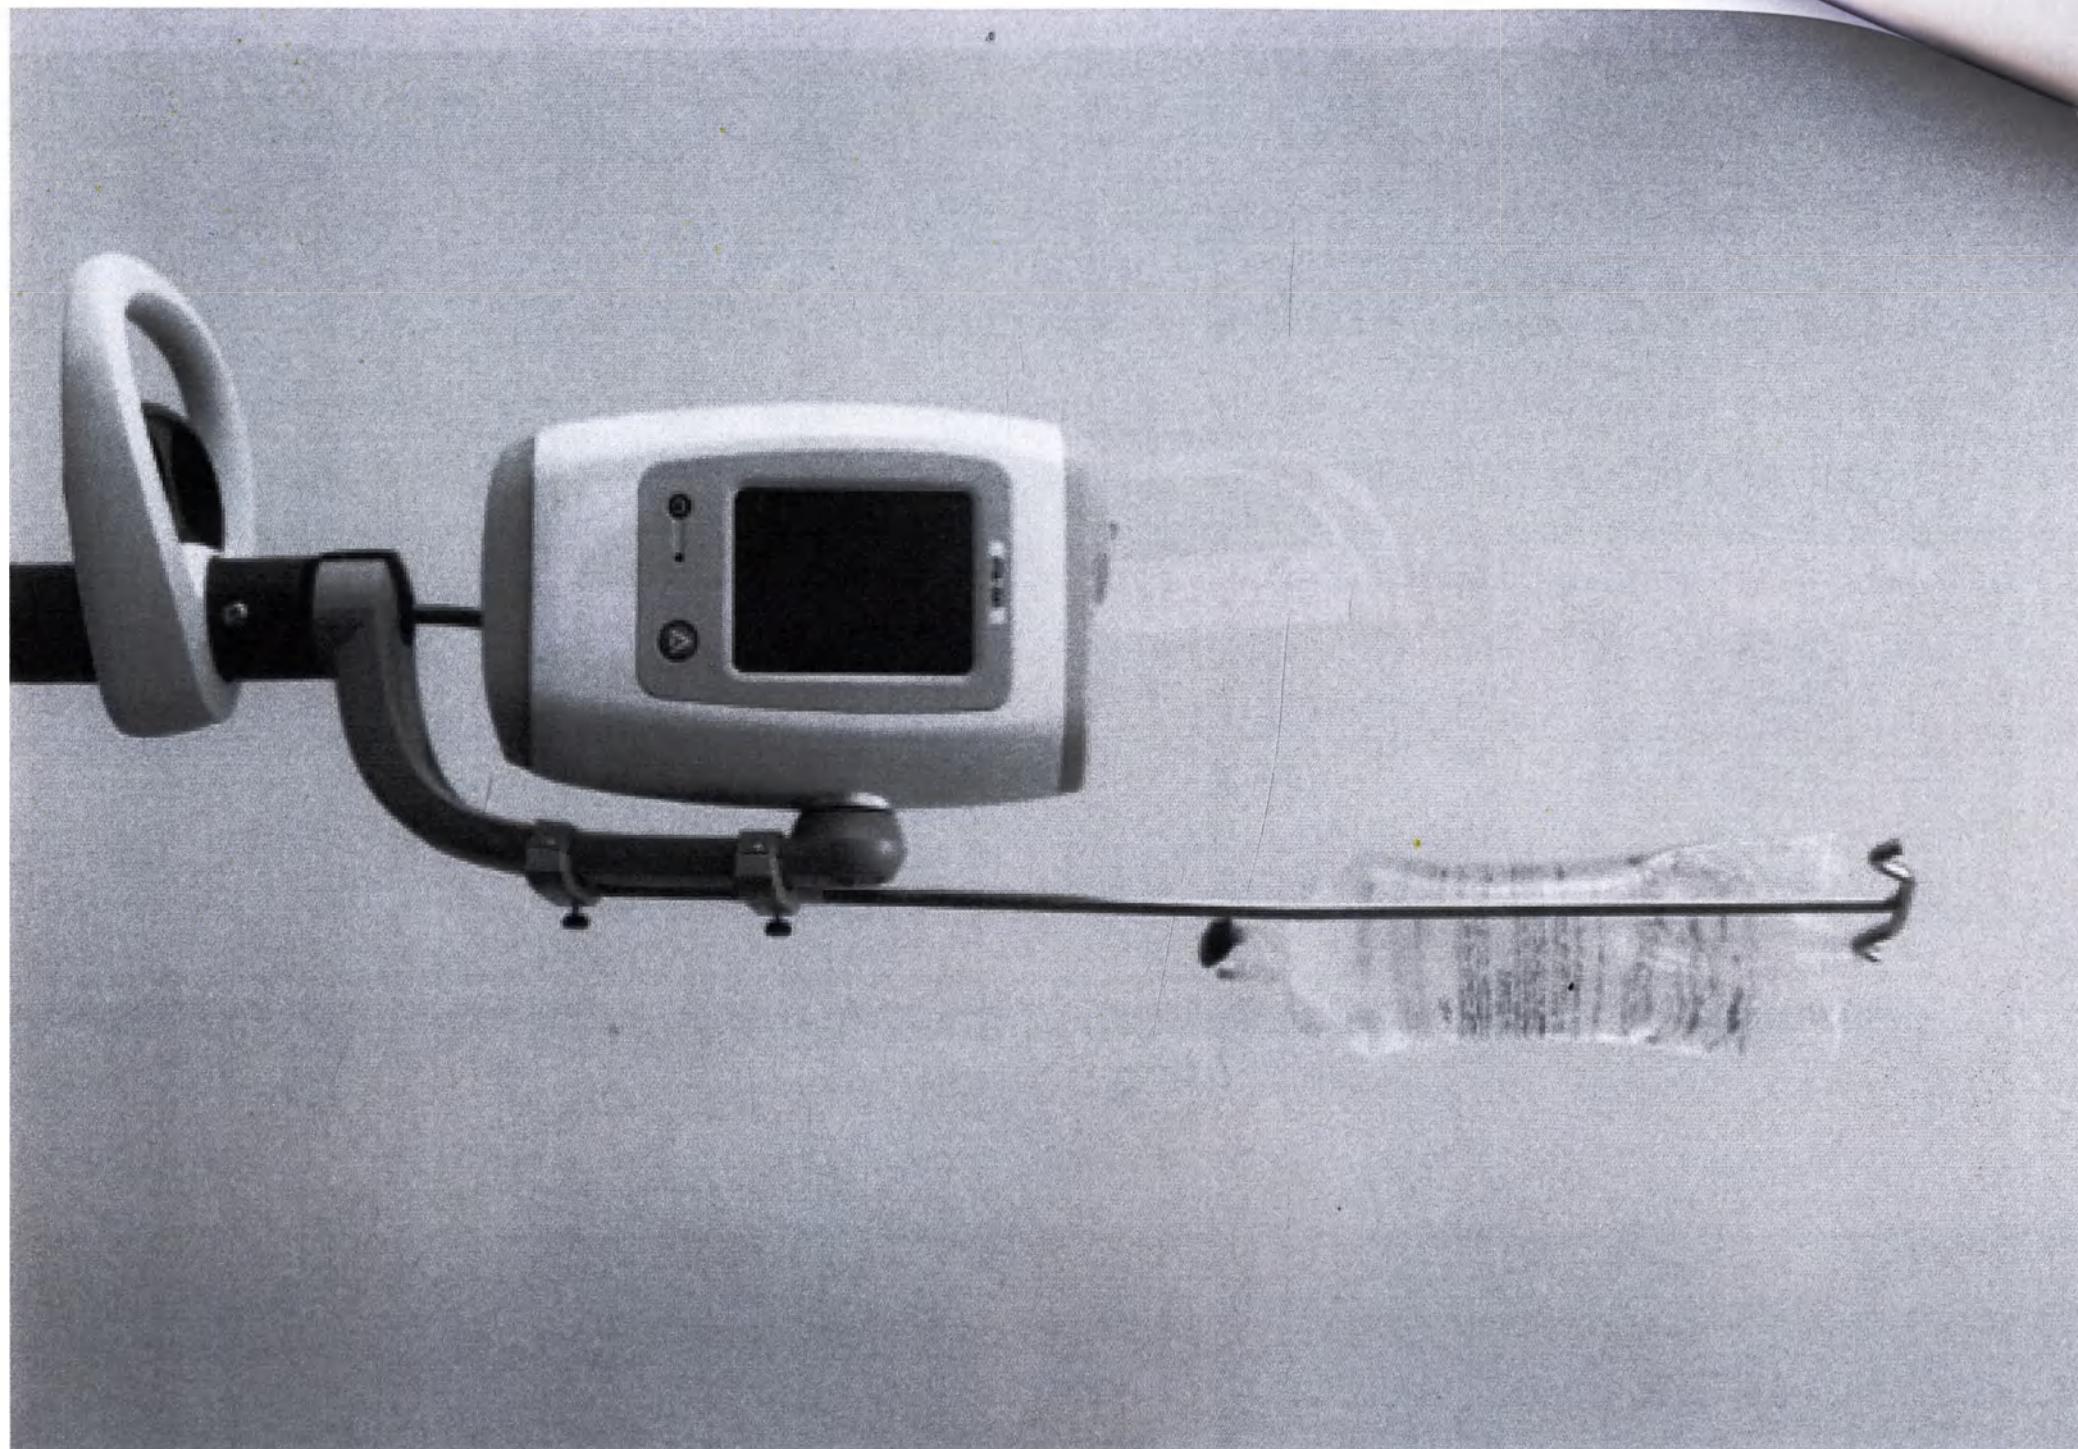

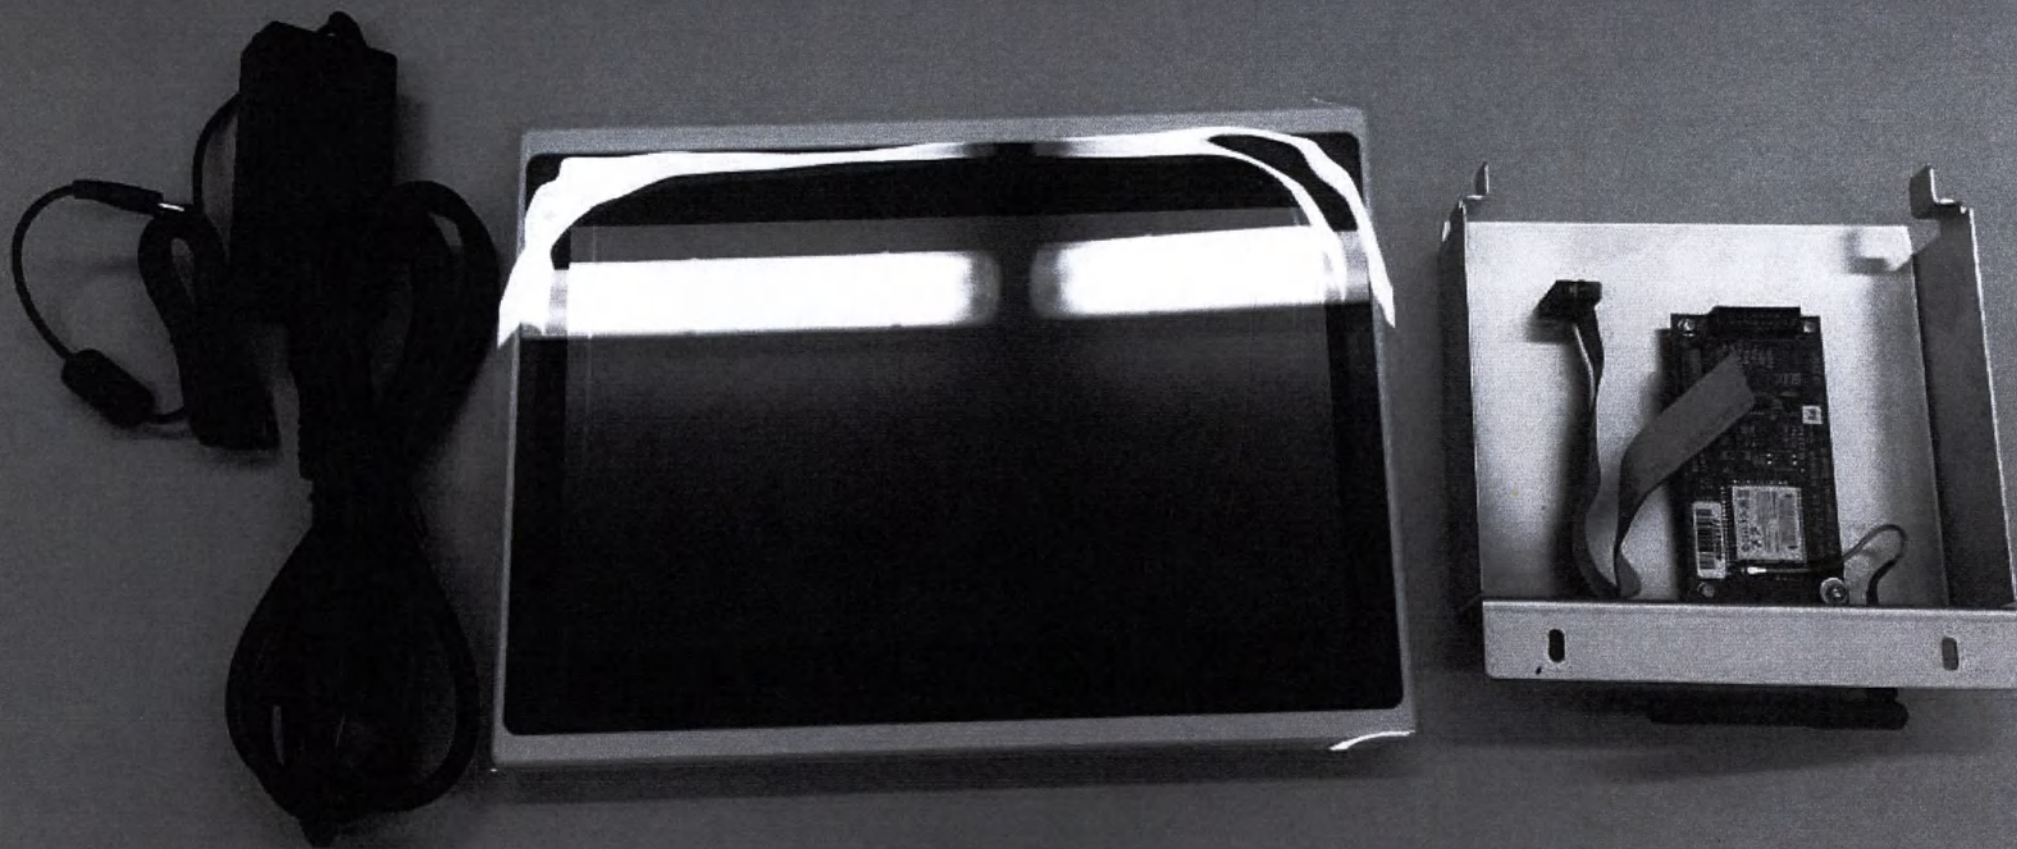

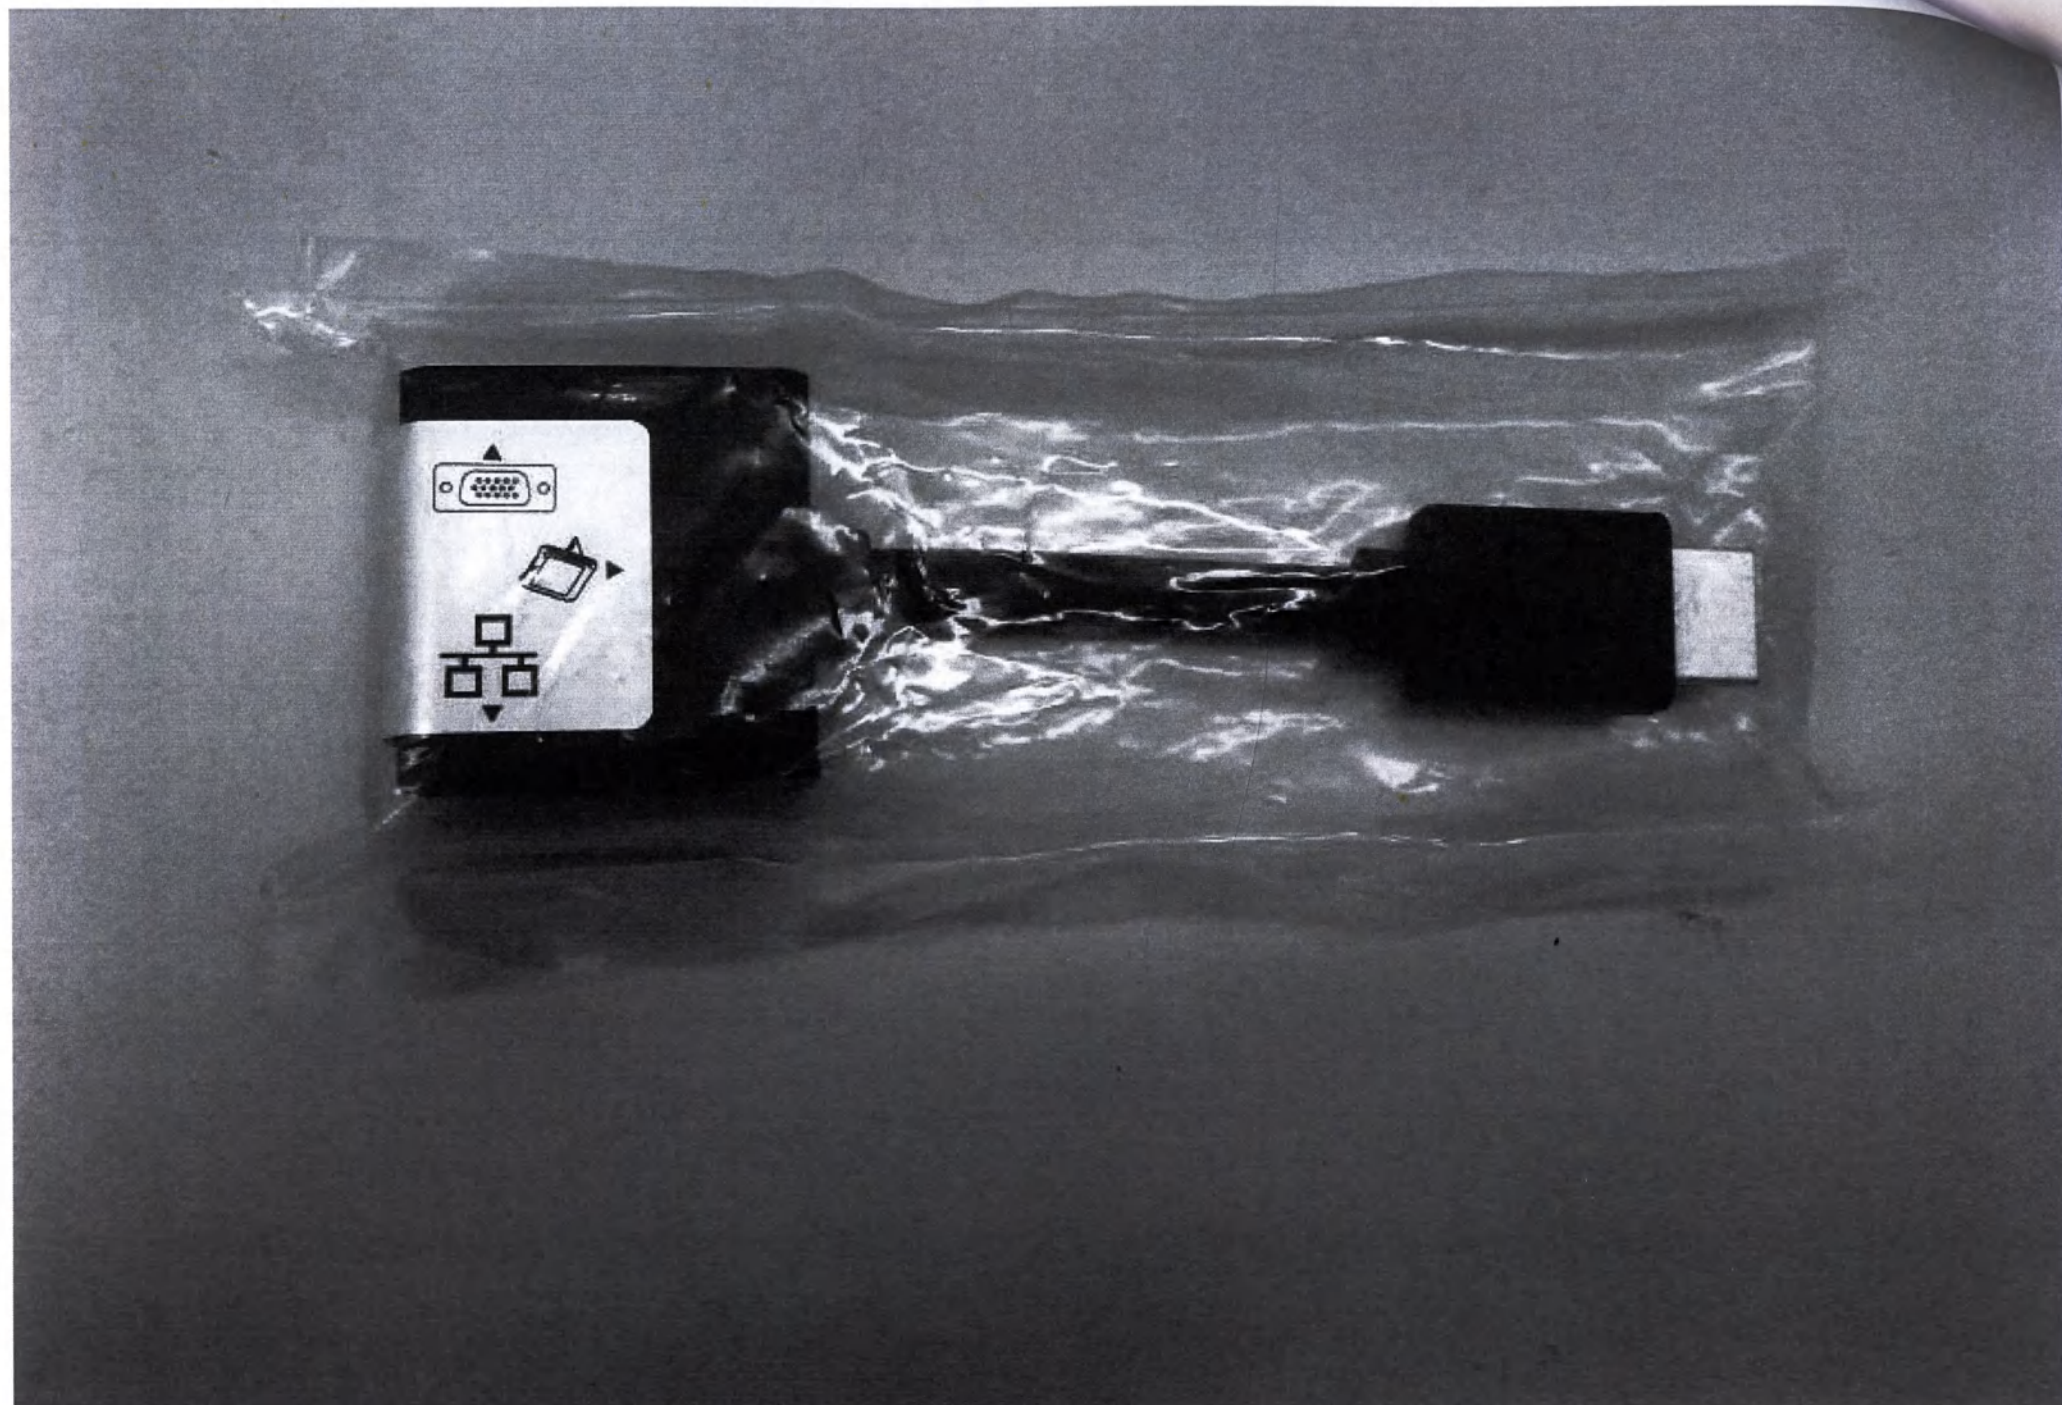

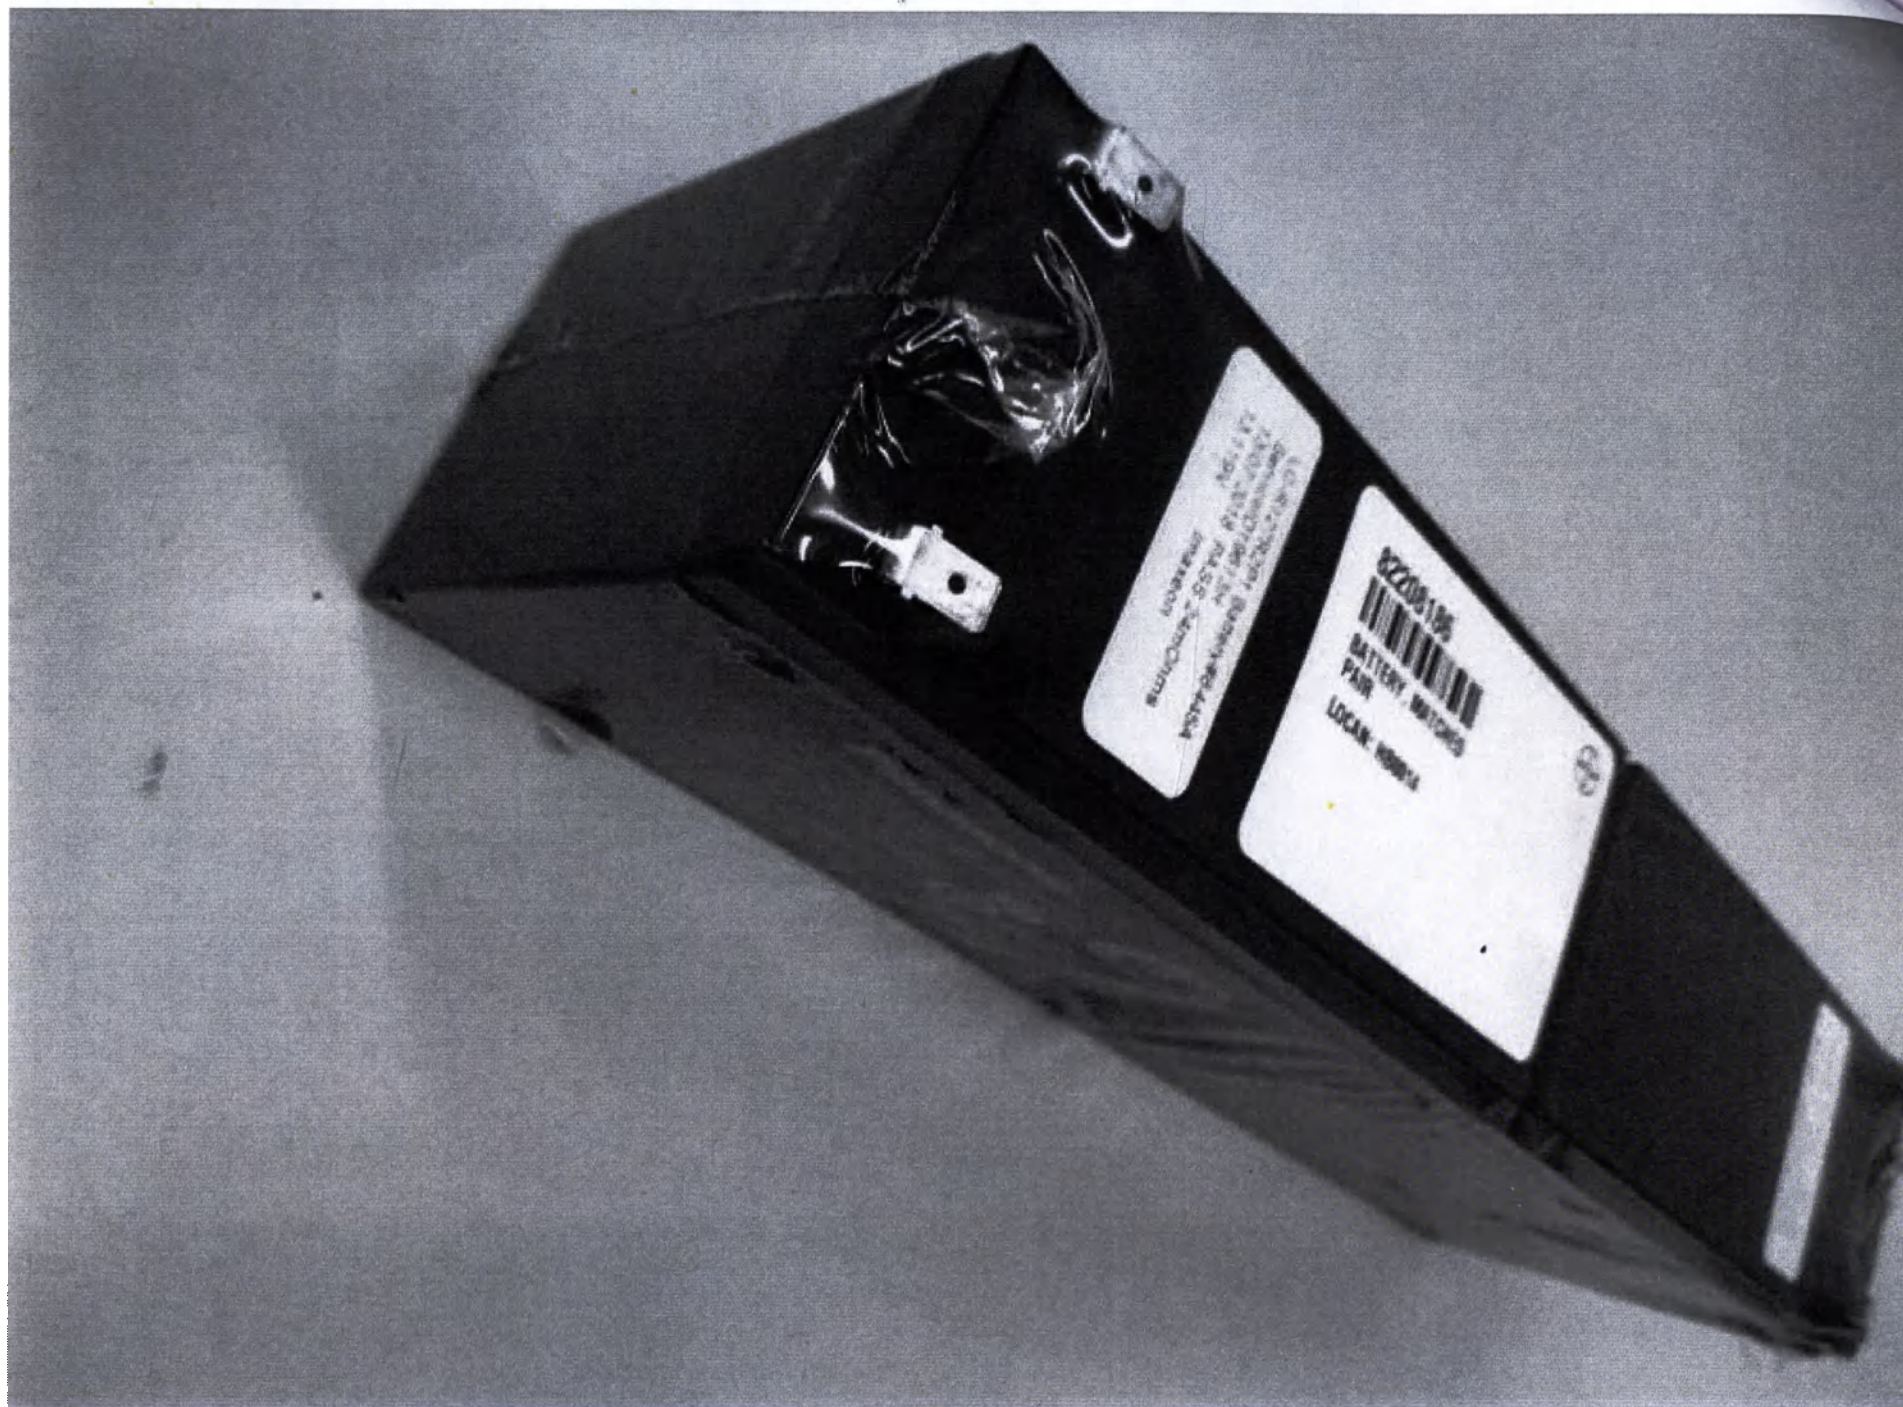



Service Manual

SM040001-21

Salient Service Manual

Steve Carruthers, Chi Nguyen

Name: SM040001 Rev: 1 Status: Released

Abstract: This document defines the service procedures for the Salient Contrast Injector.

©2017, Imaxeon Pty Ltd. All rights reserved.

This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Imaxeon Pty Ltd. Reproduction of this document is strictly prohibited without express written consent of Imaxeon Pty Ltd.

Hardcopy effective until 29-Jun-18 unless stamped Controlled Copy

2 of 39

Disclaimer - Prior to use, it is your responsibility to confirm this is the appropriate revision for intended use and all content is available when printed.





Эквипотенциальный кабель

