

Фотографические изображения

**Имплантаты стоматологические TS SA,
производства Osstem Implant Co., Ltd.
(Осстем Имплант Ко., Лтд.), Корея**




Имплантат TS II SA NoMount, вариант исполнения TS2M3508S

Варианты исполнения TS2M3508S, TS2M3510S, TS2M3511S, TS2M3513S, TS2S4007S, TS2S4008S, TS2S4010S, TS2S4011S, TS2S4013S, TS2S4507S, TS2S4508S, TS2S4510S, TS2S4511S, TS2S4513S, TS2S5006S, TS2S5007S, TS2S5008S, TS2S5010S, TS2S5011S, TS2S5013S, TS2M3515S, TS2M3518S, TS2S4015S, TS2S4018S, TS2S4515S, TS2S4518S, TS2S5015S, TS2S5018S имеют идентичный внешний вид, различие только в размерах имплантата




Имплантат TS II SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS2S4510S (имплантат с установочным адаптером)

Варианты исполнения BTS2S4007S, BTS2S4008S, BTS2S4010S, BTS2S4011S, BTS2S4013S, BTS2S4507S, BTS2S4508S, BTS2S4510S, BTS2S4511S, BTS2S4513S, BTS2S5006S, BTS2S5007S, BTS2S5008S, BTS2S5010S, BTS2S5011S, BTS2S5013S, BTS2S4015S, BTS2S4018S, BTS2S4515S, BTS2S4518S, BTS2S5015S, BTS2S5018S имеют одинаковый внешний вид и установочный адаптер, различие только в размерах имплантата.

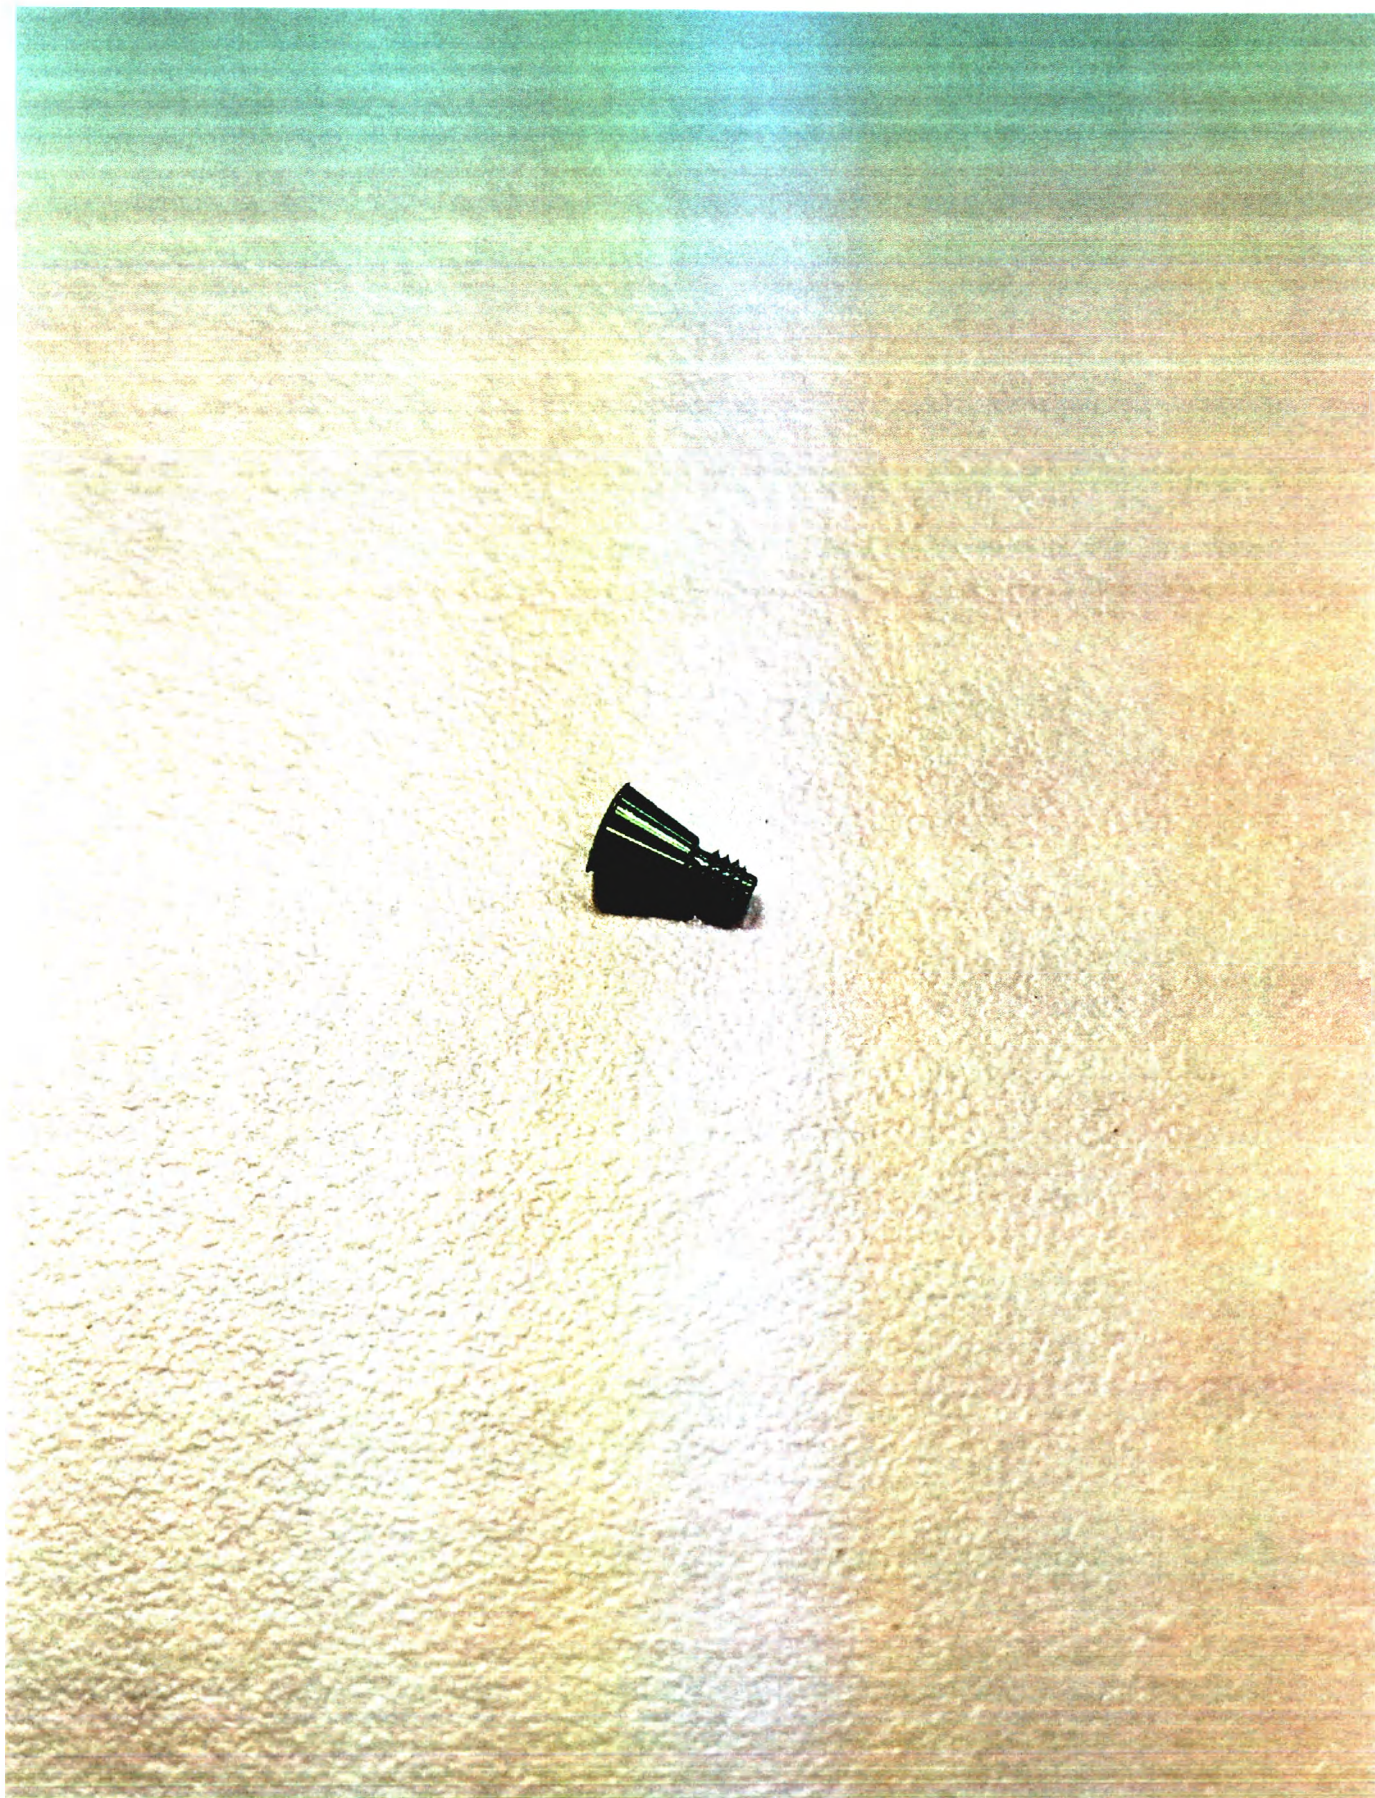

Имплантат TS II SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS2S4510S (винт-заглушка)

Варианты исполнения *BTS2S4007S, BTS2S4008S, BTS2S4010S, BTS2S4011S, BTS2S4013S, BTS2S4507S, BTS2S4508S, BTS2S4510S, BTS2S4511S, BTS2S4513S, BTS2S5006S, BTS2S5007S, BTS2S5008S, BTS2S5010S, BTS2S5011S, BTS2S5013S, BTS2S4015S, BTS2S4018S, BTS2S4515S, BTS2S4518S, BTS2S5015S, BTS2S5018S* имеют одинаковые винты-заглушки.

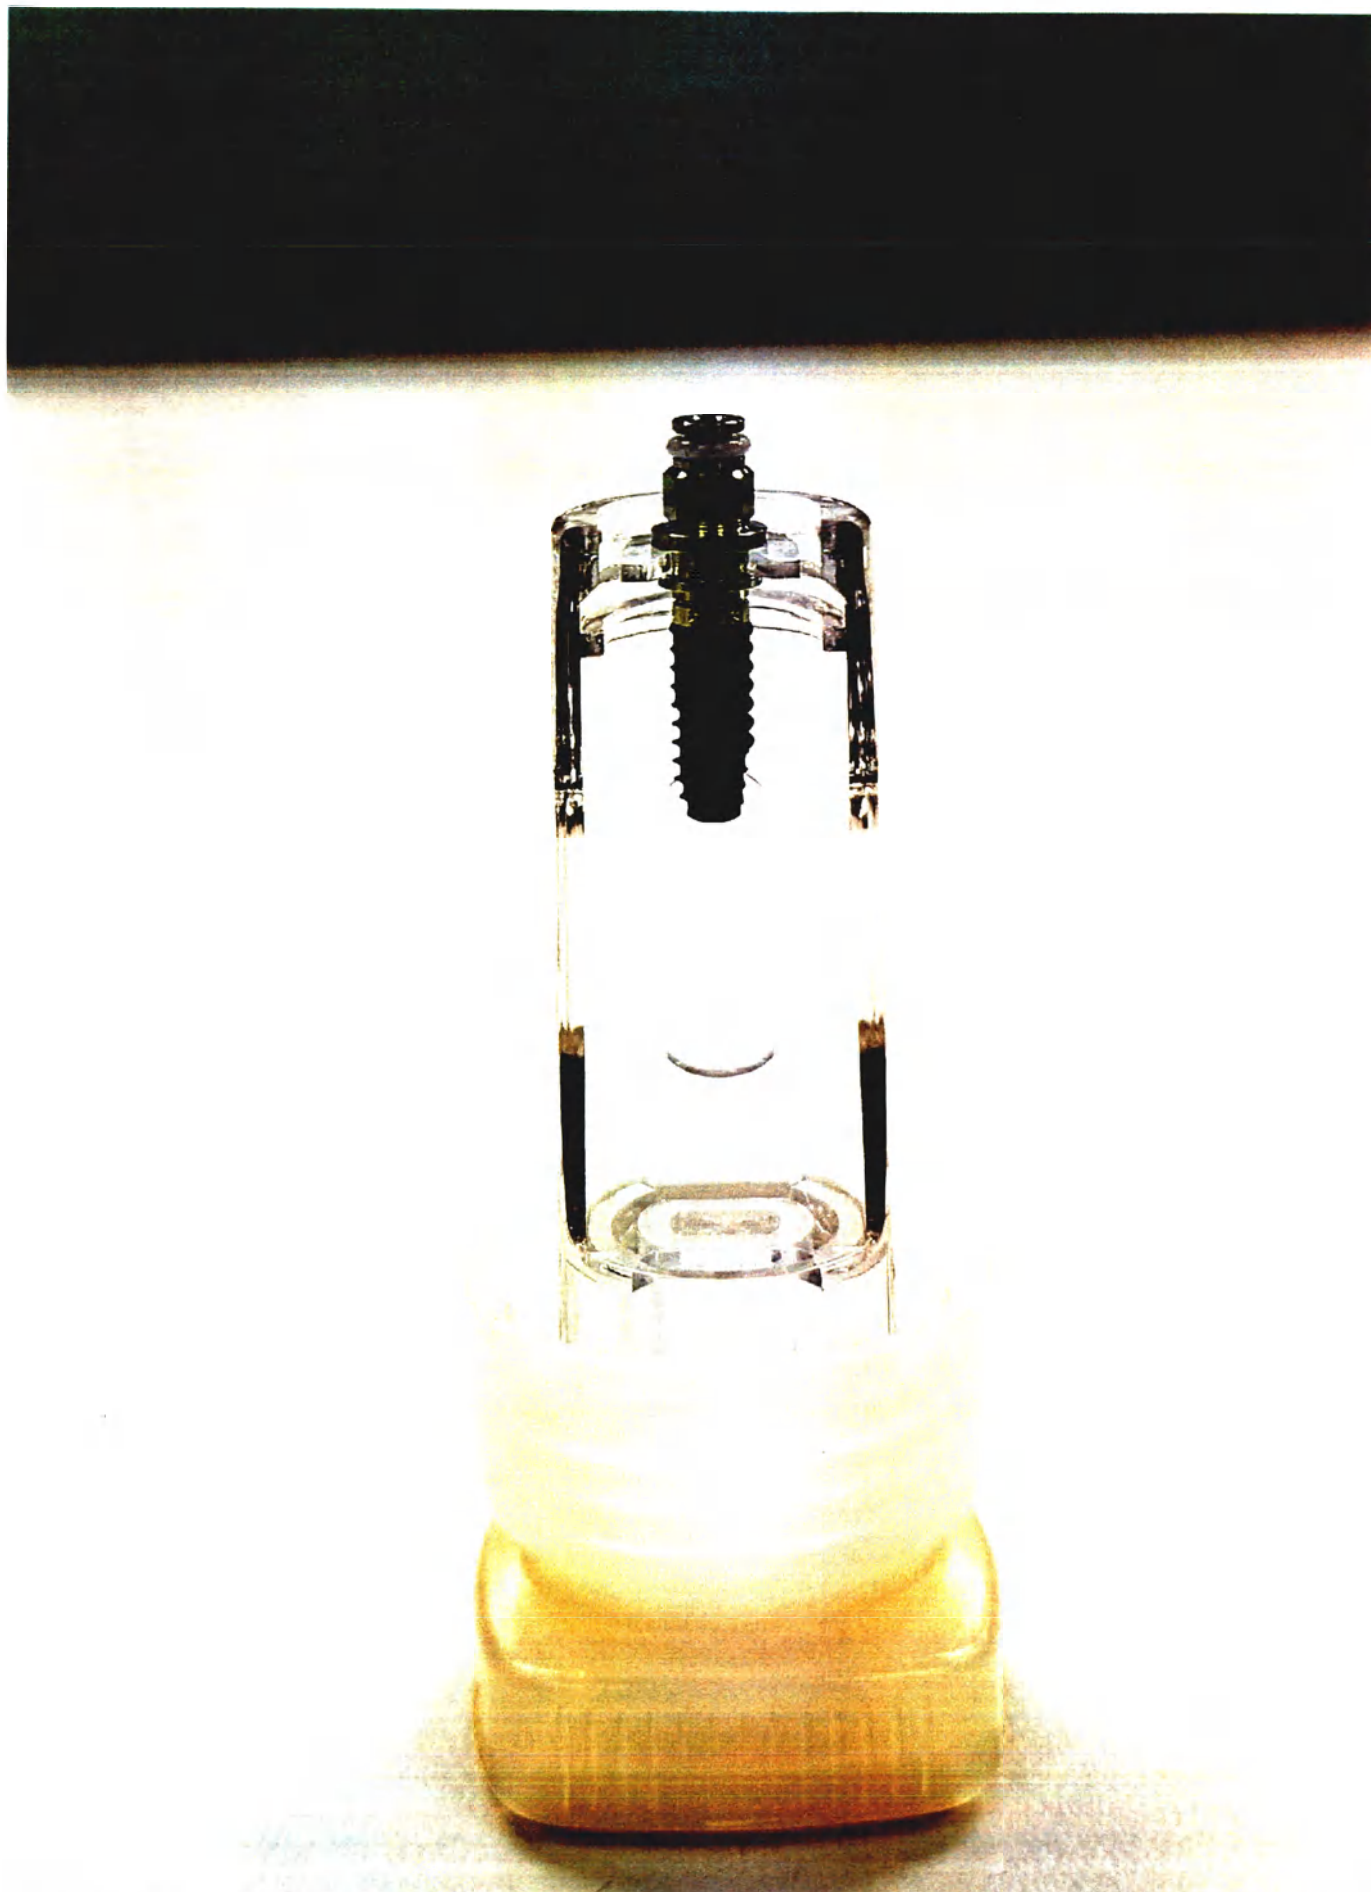

Имплантат TS II SA Pre-Mounted: BTS2M3508S (имплантат с установочным адаптером)
Варианты исполнения *BTS2M3508S, BTS2M3510S, BTS2M3511S, BTS2M3513S, BTS2M3515S, BTS2M3518S*
имеют идентичный внешний вид и установочный адаптер, различие только в размерах имплантата.



Имплантат TS II SA Pre-Mounted: BTS2M3508S (винт-заглушка)

Варианты исполнения BTS2M3508S, BTS2M3510S, BTS2M3511S, BTS2M3513S, BTS2M3515S, BTS2M3518S имеют одинаковые винты-заглушки.



Имплантат TS III SA NoMount, вариант исполнения TS3S3015S


Варианты исполнения TS3M3008S, TS3M3010S, TS3M3011S, TS3M3013S, TS3M3508S, TS3M3510S, TS3M3511S, TS3M3513S, TS3M3515S, TS3S4006S, TS3S4007S, TS3S4008S, TS3S4010S, TS3S4011S, TS3S4013S, TS3S4015S, TS3S4506S, TS3S4507S, TS3S4508S, TS3S4510S, TS3S4511S, TS3S4513S, TS3S4515S, TS3S5004S, TS3S5005S, TS3S5006S, TS3S5007S, TS3S5008S, TS3S5010S, TS3S5011S, TS3S5013S, TS3S5015S, TS3S5506S, TS3S5507S, TS3S5508S, TS3S5510S, TS3S5511S, TS3S5513S, TS3S5515S, TS3M3015S, TS3M3518S, TS3S4018S, TS3S4518S, TS3S5018S имеют идентичный внешний вид, различие только в размерах имплантата.

Имплантаты TS III SA Ultra-Wide NoMount TS3S6006S

Варианты исполнения TS3S6006S, TS3S6007S, TS3S6008S, TS3S6010S, TS3S6011S, TS3S6013S, TS3S7006S, TS3S7007S, TS3S7008S, TS3S7010S, TS3S7011S, TS3S7013S имеют идентичный внешний вид.



различие только в размерах

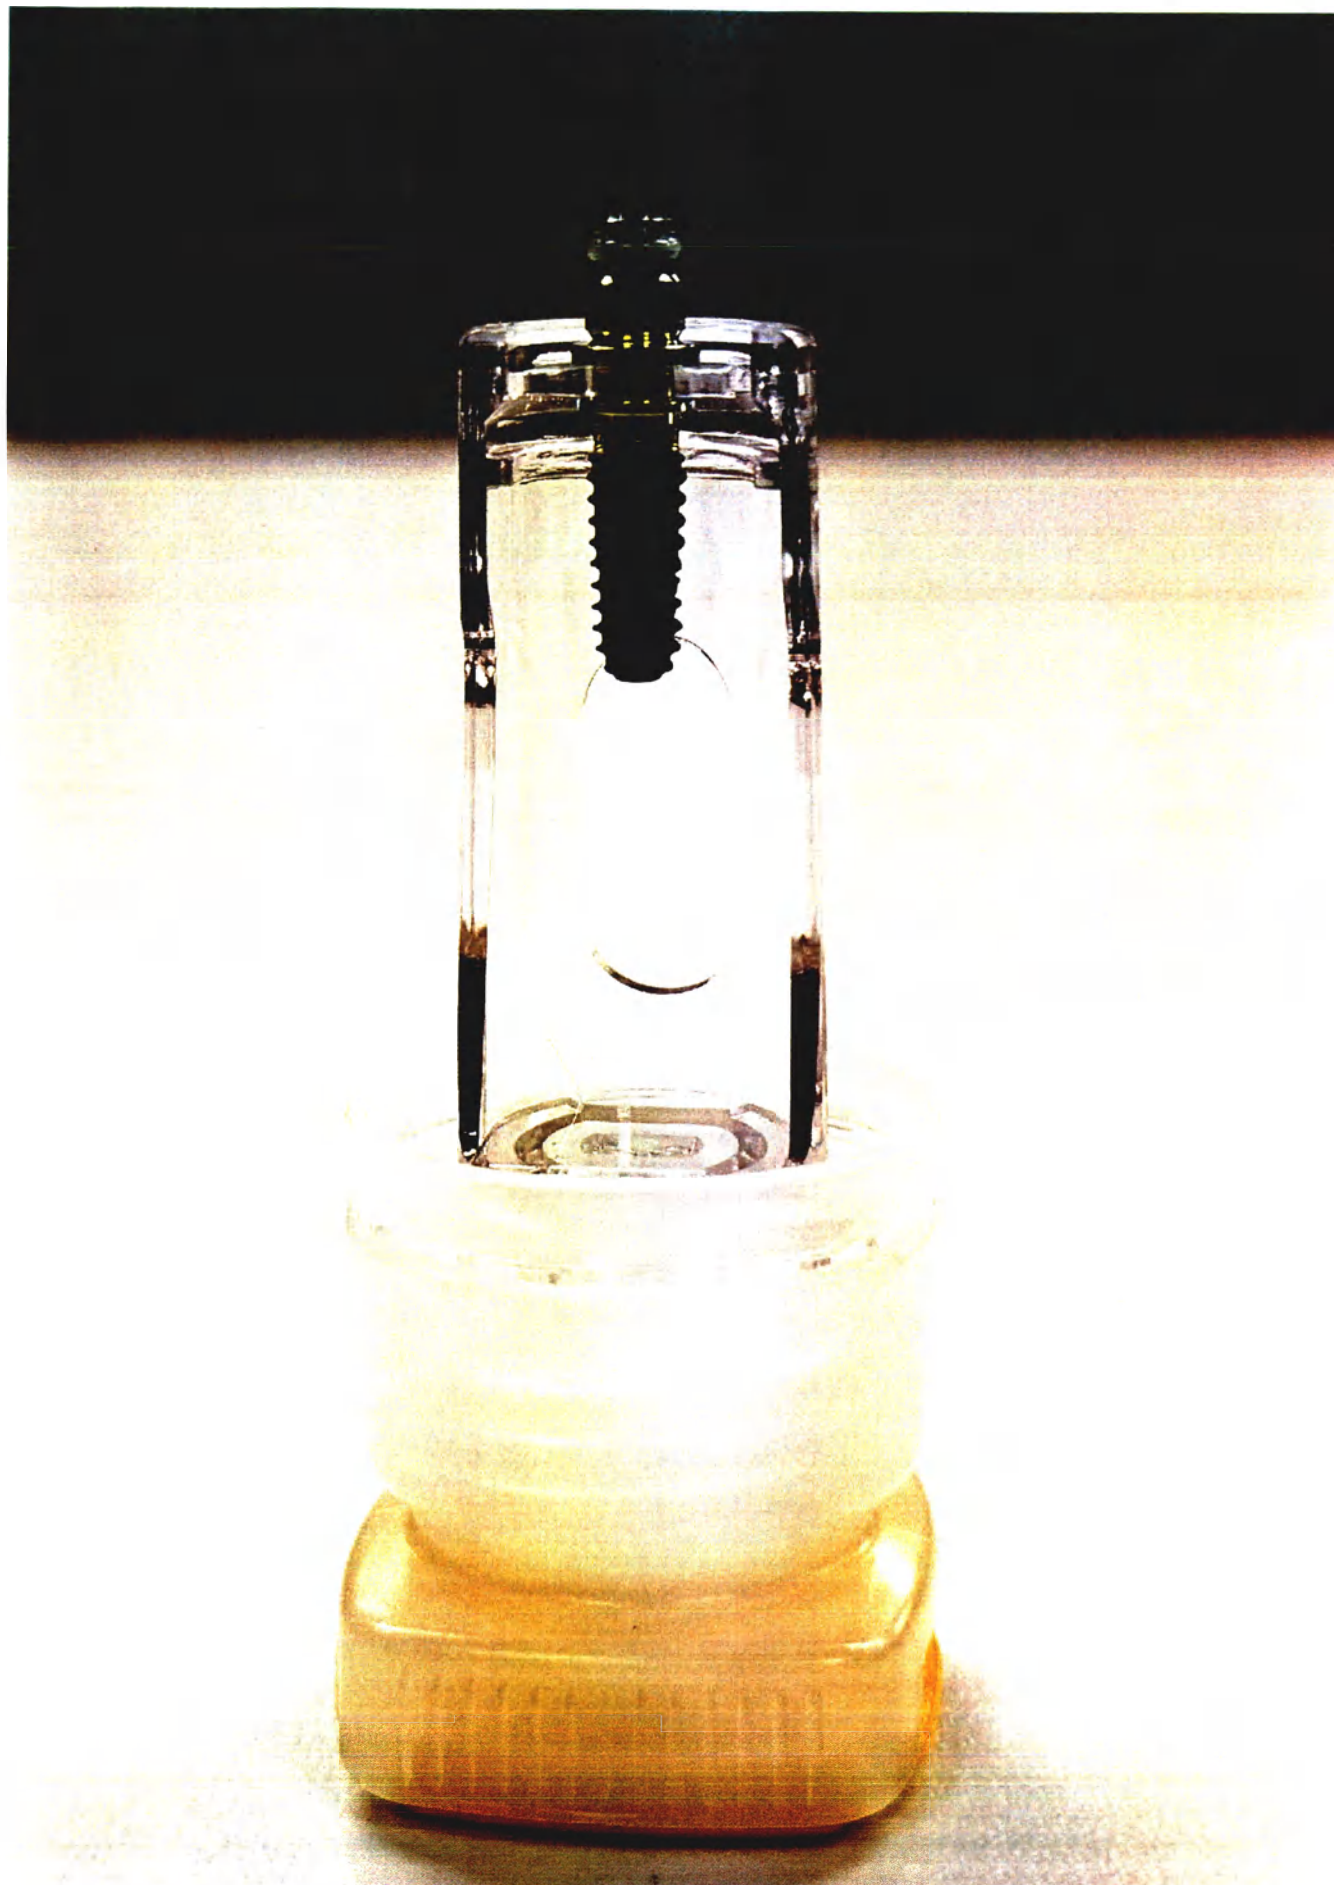


Имплантат TS III SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS3M3508S (имплантат с установочным адаптером)

Варианты исполнения BTS3M3508S, BTS3M3510S, BTS3M3511S, BTS3M3513S, BTS3M3515S, BTS3M3518S имеют одинаковый внешний вид и установочный адаптер, различие только в размерах имплантата.



Имплантат TS III SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS3M3508S (винт-заглушка)
Варианты исполнения *BTS3M3508S*, *BTS3M3510S*, *BTS3M3511S*, *BTS3M3513S*, *BTS3M3515S*, *BTS3M3518S*
имеют одинаковые винты-заглушки

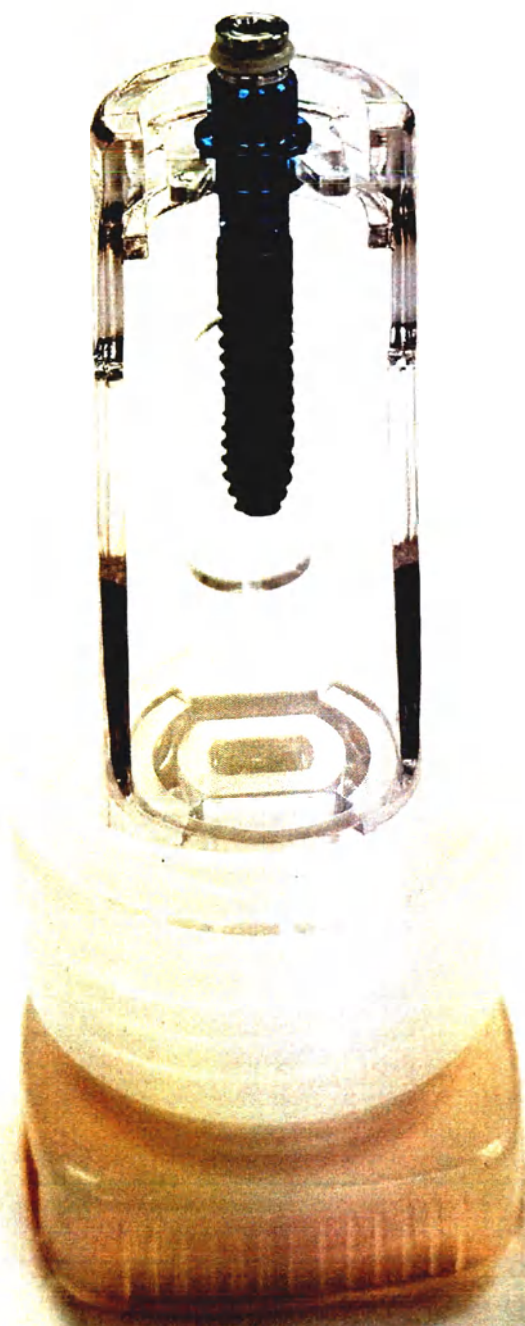

Имплантат TS III SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS3M3013S (имплантат с установочным адаптером)

Варианты исполнения BTS3M3008S, BTS3M3010S, BTS3M3011S, BTS3M3013S, BTS3M3015S имеют одинаковый внешний вид и установочный адаптер, различие только в размерах имплантата



Имплантат TS III SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS3M3013S (винт-заглушка)
Варианты исполнения BTS3M3008S, BTS3M3010S, BTS3M3011S, BTS3M3013S, BTS3M3015S имеют одинаковые винты-заглушки




Имплантат TS III SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS3S4006S (имплантат с установочным адаптером)

Варианты исполнения BTS3S4007S, BTS3S4008S, BTS3S4010S, BTS3S4011S, BTS3S4013S, BTS3S4015S, BTS3S4506S, BTS3S4507S, BTS3S4508S, BTS3S4510S, BTS3S4511S, BTS3S4513S, BTS3S4515S, BTS3S5004S, BTS3S5005S, BTS3S5006S, BTS3S5007S, BTS3S5008S, BTS3S5010S, BTS3S5011S, BTS3S5013S, BTS3S5015S, BTS3S5506S, BTS3S5507S, BTS3S5508S, BTS3S5510S, BTS3S5511S, BTS3S5513S, BTS3S5515S, BTS3S4018S, BTS3S4518S, BTS3S5018S имеют одинаковый внешний вид и установочный адаптер, различие только в размерах имплантата.



Имплантат TS III SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS3S4006S (винт-заглушка)

Варианты исполнения BTS3S4007S, BTS3S4008S, BTS3S4010S, BTS3S4011S, BTS3S4013S, BTS3S4015S, BTS3S4506S, BTS3S4507S, BTS3S4508S, BTS3S4510S, BTS3S4511S, BTS3S4513S, BTS3S4515S, BTS3S5004S, BTS3S5005S, BTS3S5006S, BTS3S5007S, BTS3S5008S, BTS3S5010S, BTS3S5011S, BTS3S5013S, BTS3S5015S, BTS3S5506S, BTS3S5507S, BTS3S5508S, BTS3S5510S, BTS3S5511S, BTS3S5513S, BTS3S5515S, BTS3S4018S, BTS3S4518S, BTS3S5018S имеют одинаковые винты-заглушки.

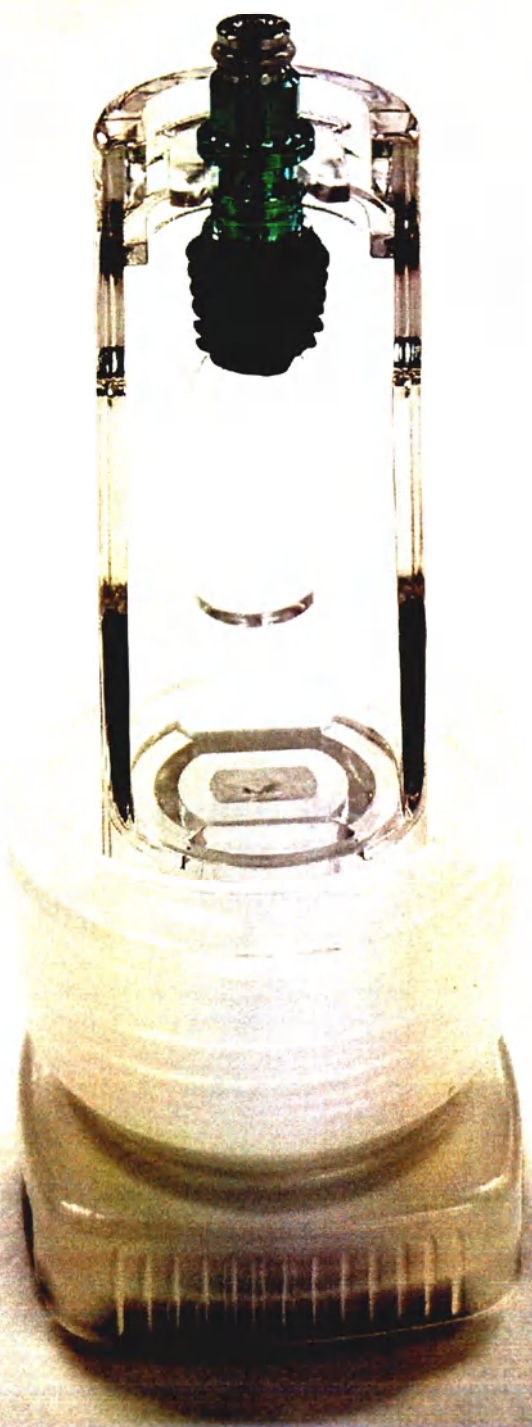

Имплантат TS III SA Ultra-Wide Pre-Mounted, варианты исполнения BTS3S6006S (имплантат с установочным адаптером)

Варианты исполнения BTS3S6006S, BTS3S6007S, BTS3S6008S, BTS3S6010S, BTS3S6011S, BTS3S6013S, BTS3S7006S, BTS3S7007S, BTS3S7008S, BTS3S7010S, BTS3S7011S, BTS3S7013S имеют одинаковый внешний вид и установочный адаптер, различие только в размерах имплантата




Имплантат TS III SA Ultra-Wide Pre-Mounted, варианты исполнения BTS3S6006S (винт-заглушка)

Варианты исполнения BTS3S6006S, BTS3S6007S, BTS3S6008S, BTS3S6010S, BTS3S6011S, BTS3S6013S, BTS3S7006S, BTS3S7007S, BTS3S7008S, BTS3S7010S, BTS3S7011S, BTS3S7013S одинаковые винты-заглушки




Имплантат TS IV SA NoMount, вариант исполнения TS4S4008S

Варианты исполнения TS4S4007S, TS4S4008S, TS4S4010S, TS4S4011S, TS4S4013S, TS4S4507S, TS4S4508S, TS4S4510S, TS4S4511S, TS4S4513S, TS4S5007S, TS4S5008S, TS4S5010S, TS4S5011S, TS4S5013S имеют одинаковый внешний вид, различие только в размерах имплантата.

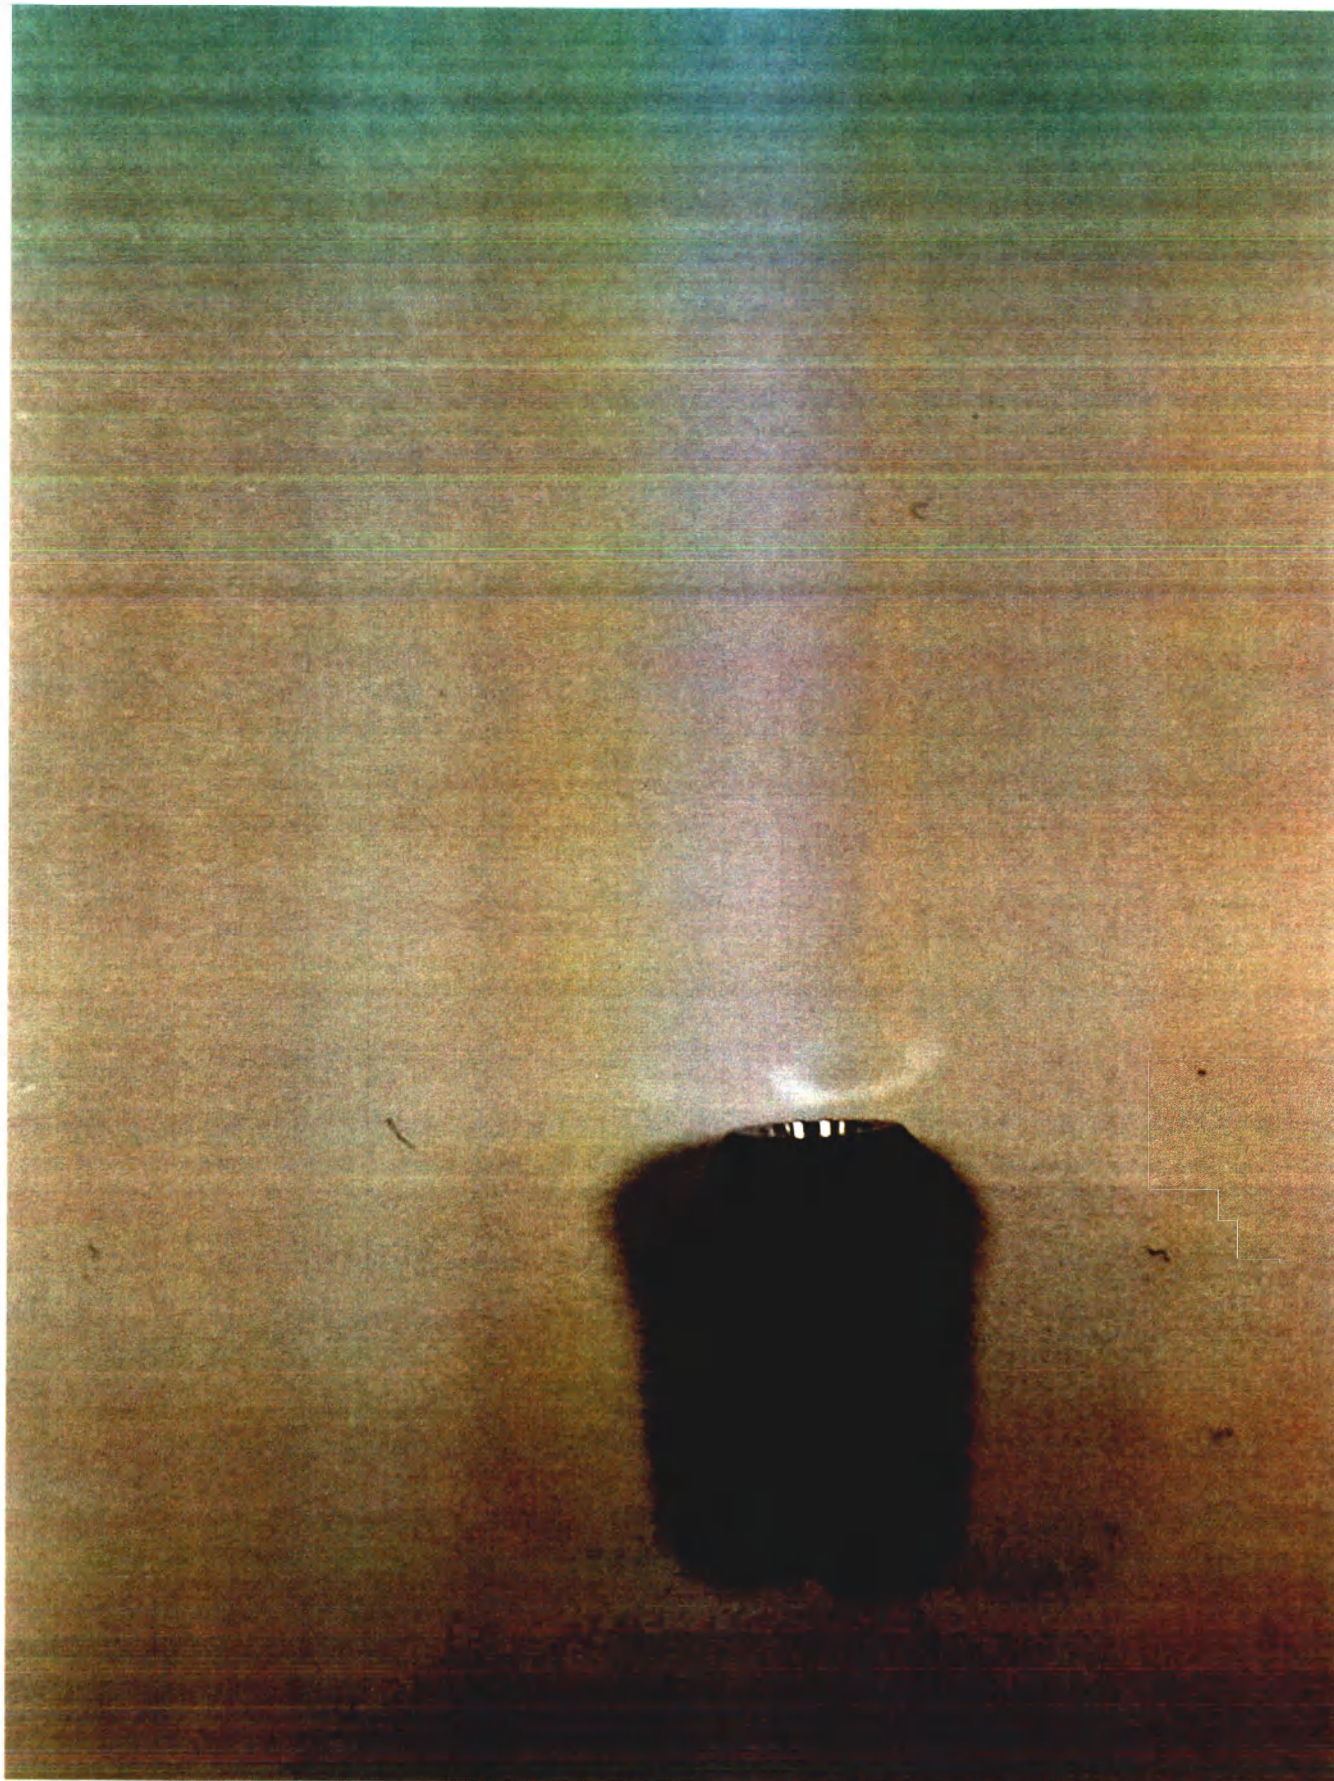


Имплантаты TS IV SA Ultra-Wide NoMount, вариант исполнения TS4S7013S

Варианты исполнения: TS4S6007S, TS4S6008S, TS4S6010S, TS4S6011S, TS4S6013S, TS4S7007S, TS4S7008S, TS4S7010S, TS4S7011S, TS4S7013S имеют идентичный внешний вид, различие только в размерах имплантата.

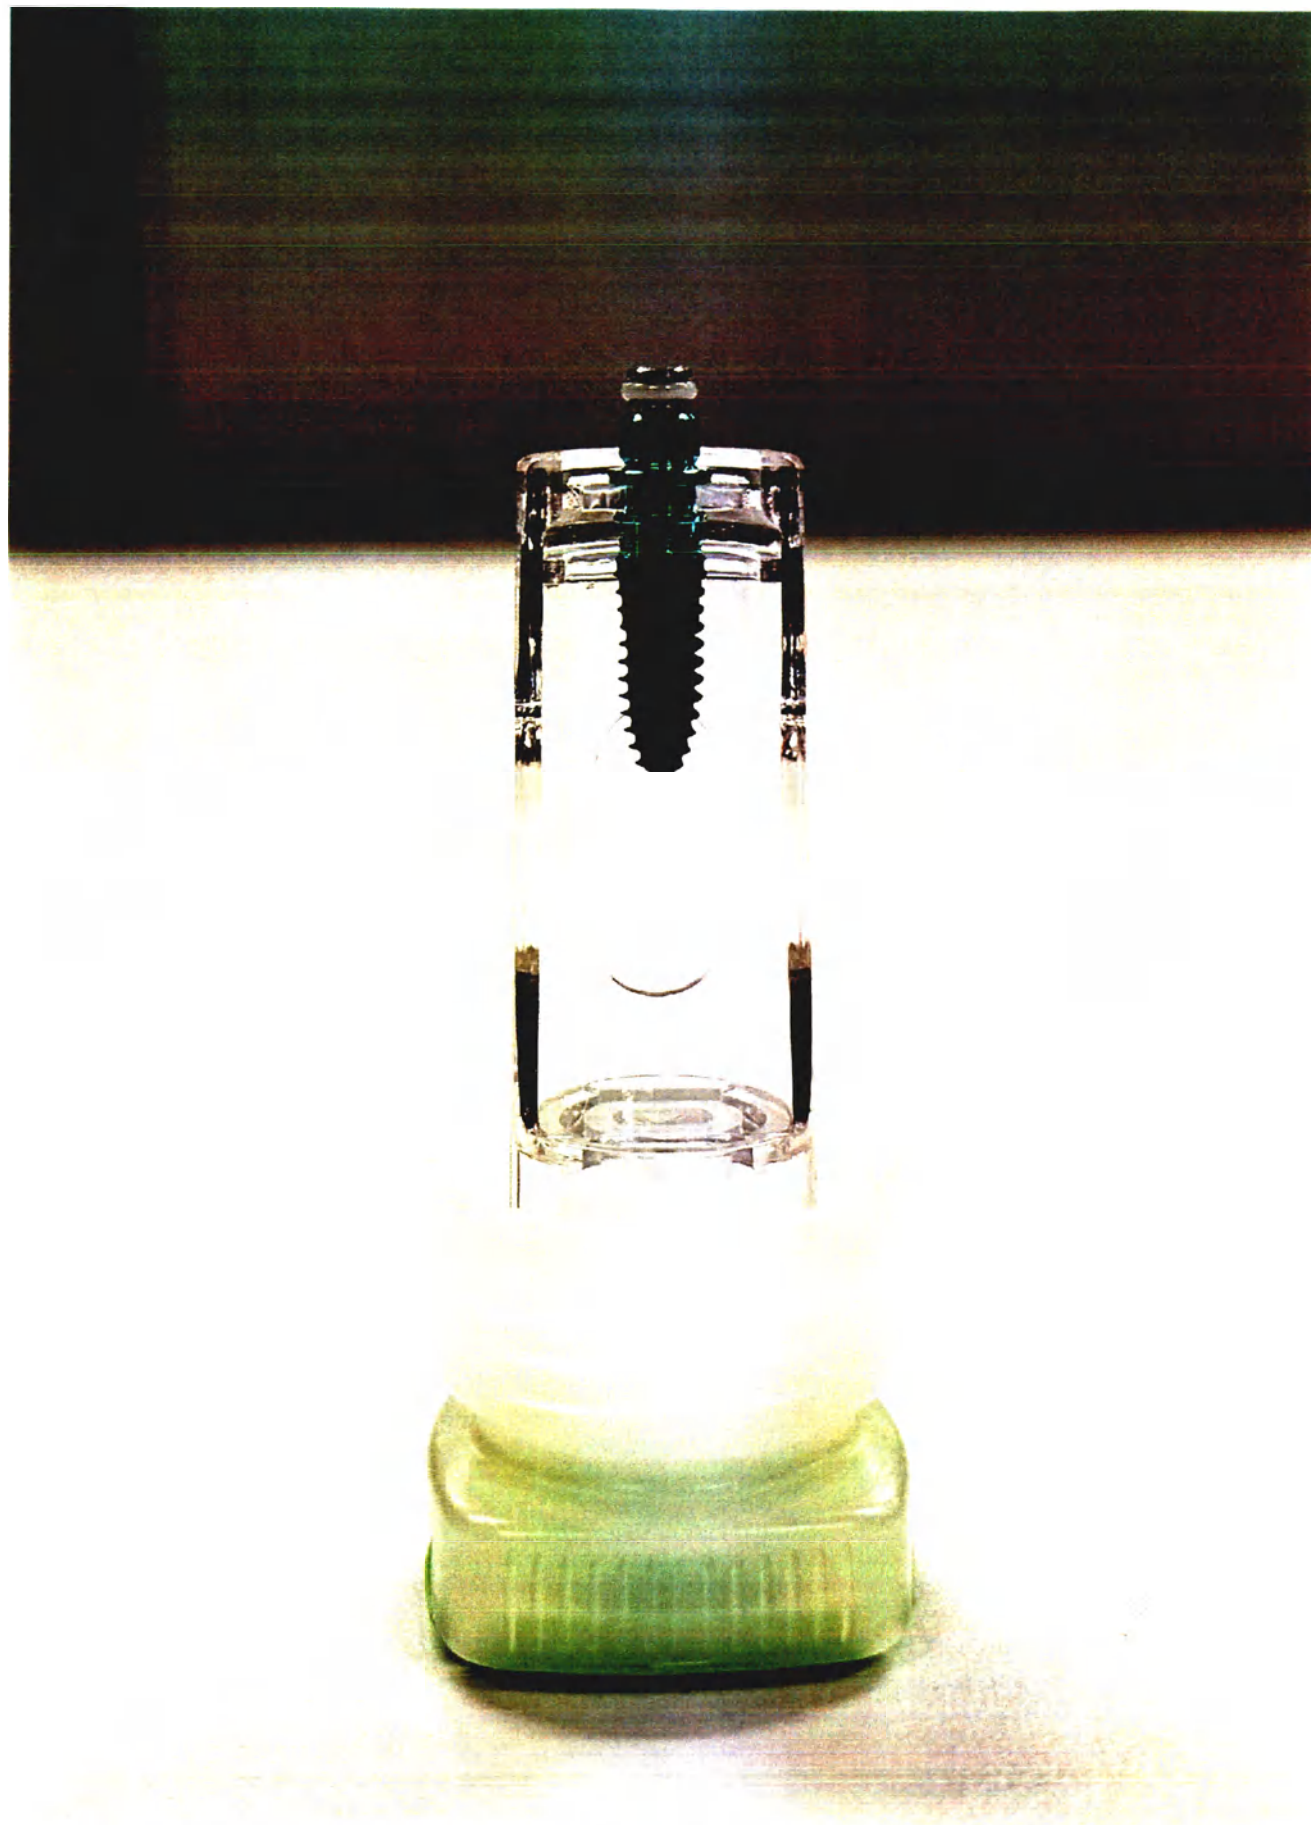


Имплантат TS IV SA Pre-Mounted, вариант исполнения BTS4S4010S (имплантат с установочным адаптером)

Варианты исполнения BTS4S4007S, BTS4S4008S, BTS4S4010S, BTS4S4011S, BTS4S4013S, BTS4S4507S, BTS4S4508S, BTS4S4510S, BTS4S4511S, BTS4S4513S, BTS4S5007S, BTS4S5008S, BTS4S5010S, BTS4S5011S, BTS4S5013S имеют идентичный внешний вид и установочный адаптер, различие только в размерах имплантата

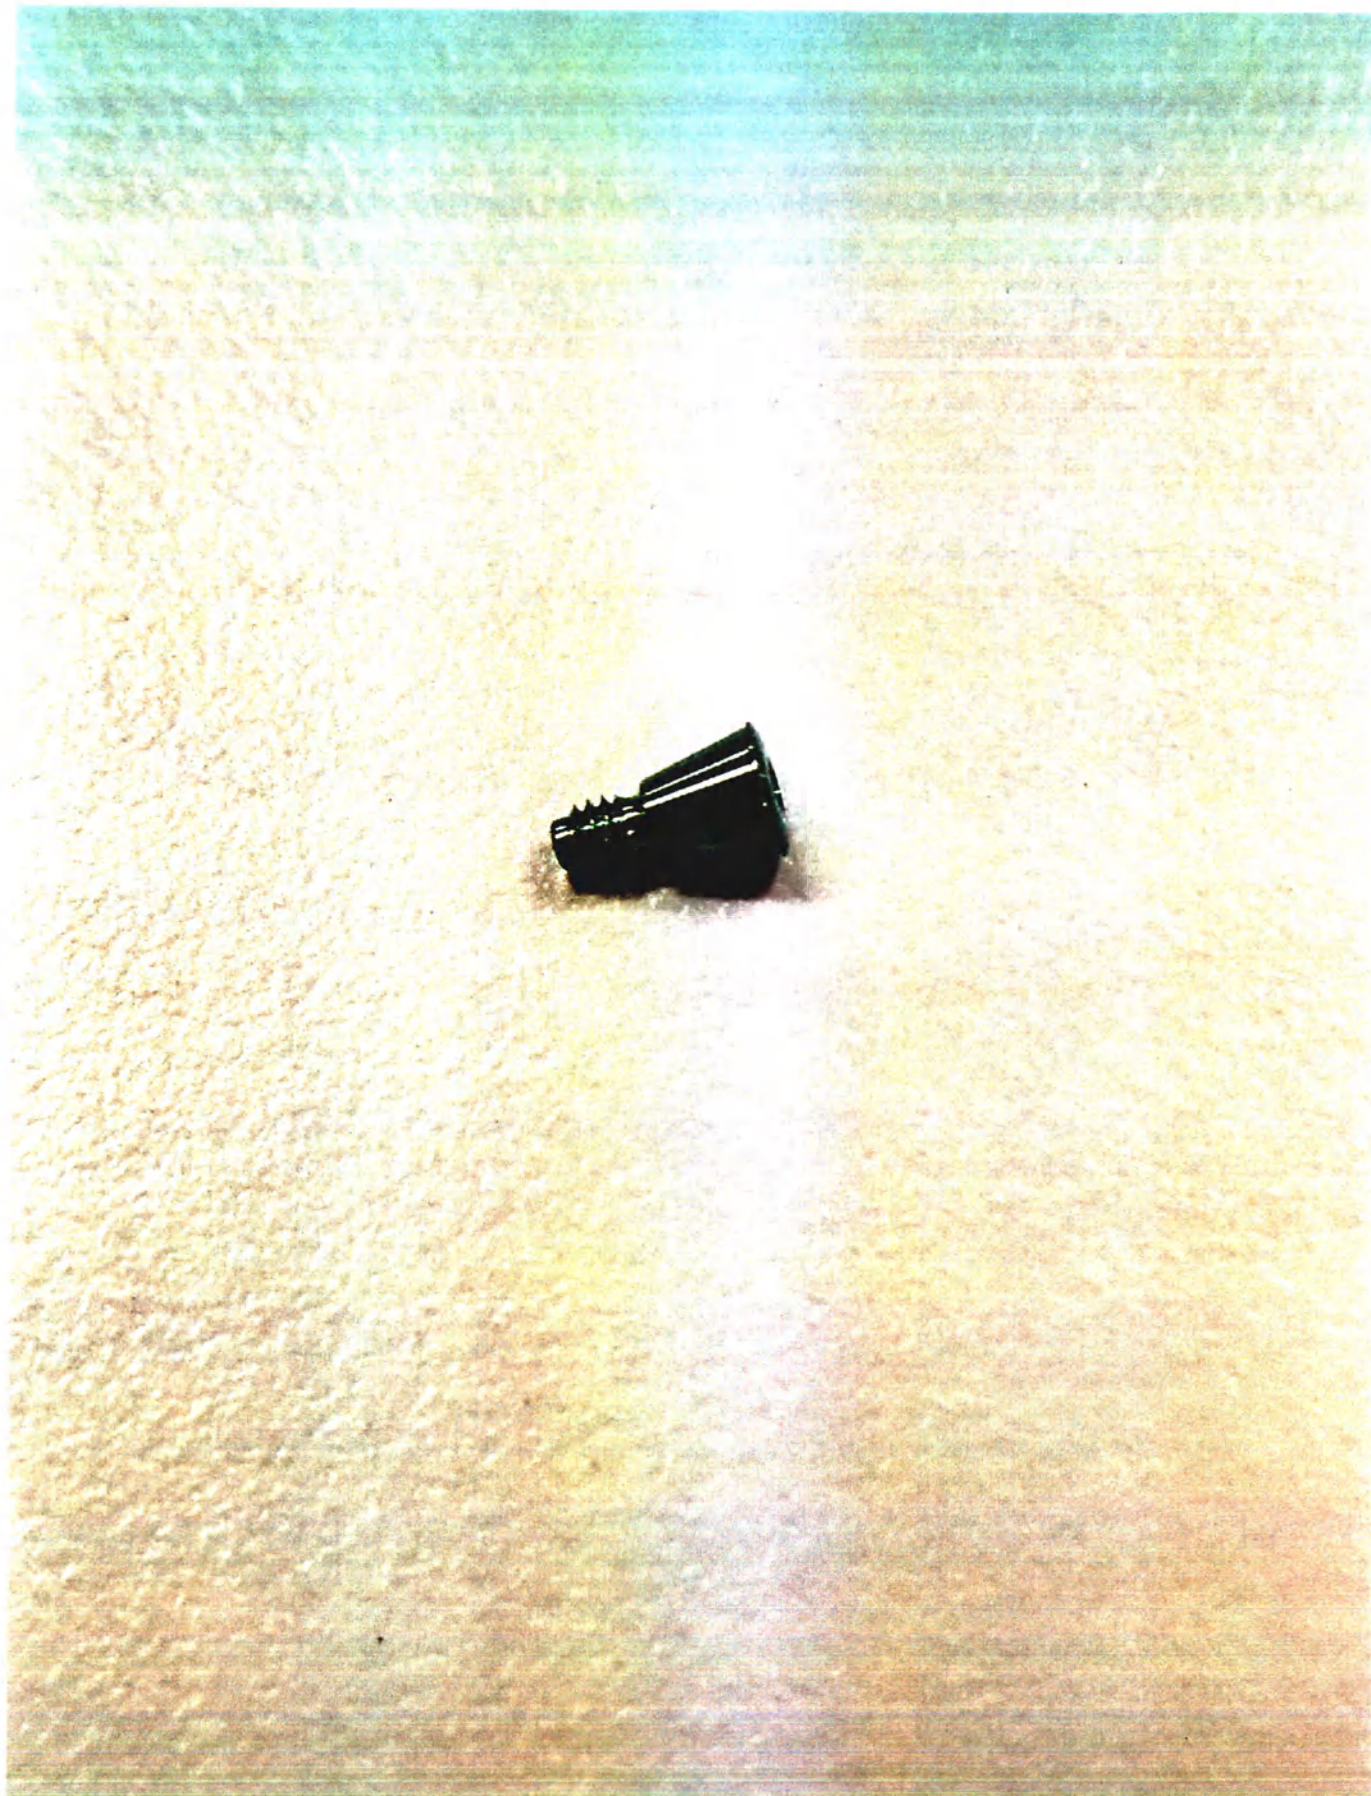

Имплантат TS IV SA Pre-Mounted вариант исполнения BTS4S4010S (винт-заглушка)
Варианты исполнения *BTS4S4007S, BTS4S4008S, BTS4S4010S, BTS4S4011S, BTS4S4013S, BTS4S4507S, BTS4S4508S, BTS4S4510S, BTS4S4511S, BTS4S4513S, BTS4S5007S, BTS4S5008S, BTS4S5010S, BTS4S5011S, BTS4S5013S* имеют одинаковый винт-заглушку

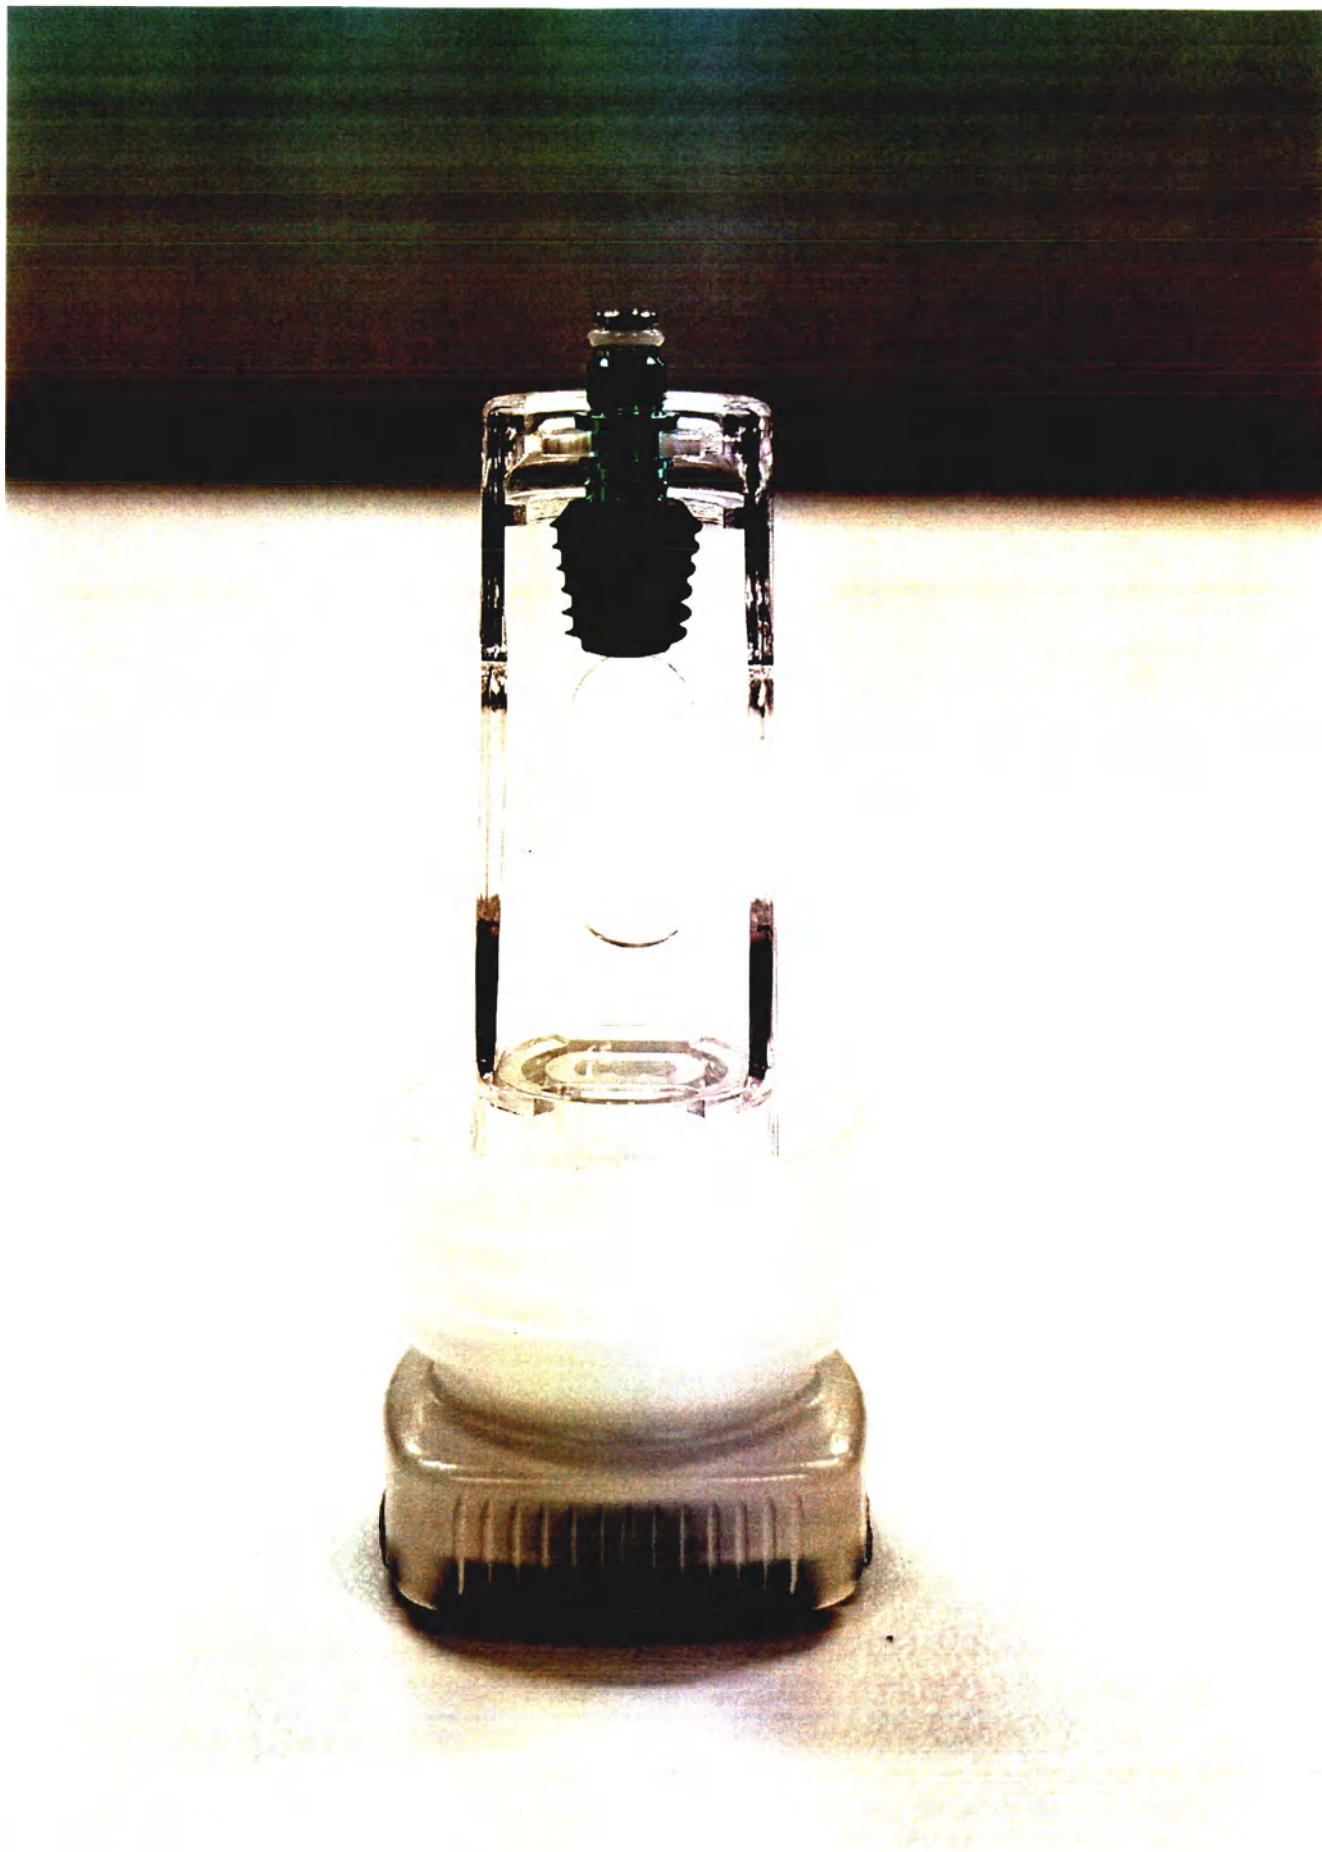

Имплантаты TS IV SA Ultra-Wide Pre-Mounted вариант исполнения BTS4S7007S (имплантат с установочным адаптером)

Варианты исполнения BTS4S6007S, BTS4S6008S, BTS4S6010S, BTS4S6011S, BTS4S6013S, BTS4S7007S, BTS4S7008S, BTS4S7010S, BTS4S7011S, BTS4S7013S имеют идентичный внешний вид и установочный адаптер, различие только в размерах имплантата.



Имплантаты TS IV SA Ultra-Wide Pre-Mounted вариант исполнения BTS4S7007S (винт-заглушка)

Варианты исполнения BTS4S6007S, BTS4S6008S, BTS4S6010S, BTS4S6011S, BTS4S6013S, BTS4S7007S, BTS4S7008S, BTS4S7010S, BTS4S7011S, BTS4S7013S имеют одинаковый винт-заглушку.



Винт-заглушка Cover Screw: GSCS30




Винт-заглушка Cover Screw: GSCS30M




Винт-заглушка Cover Screw: GSCS30L



Винт-заглушка Cover Screw: GSCS35

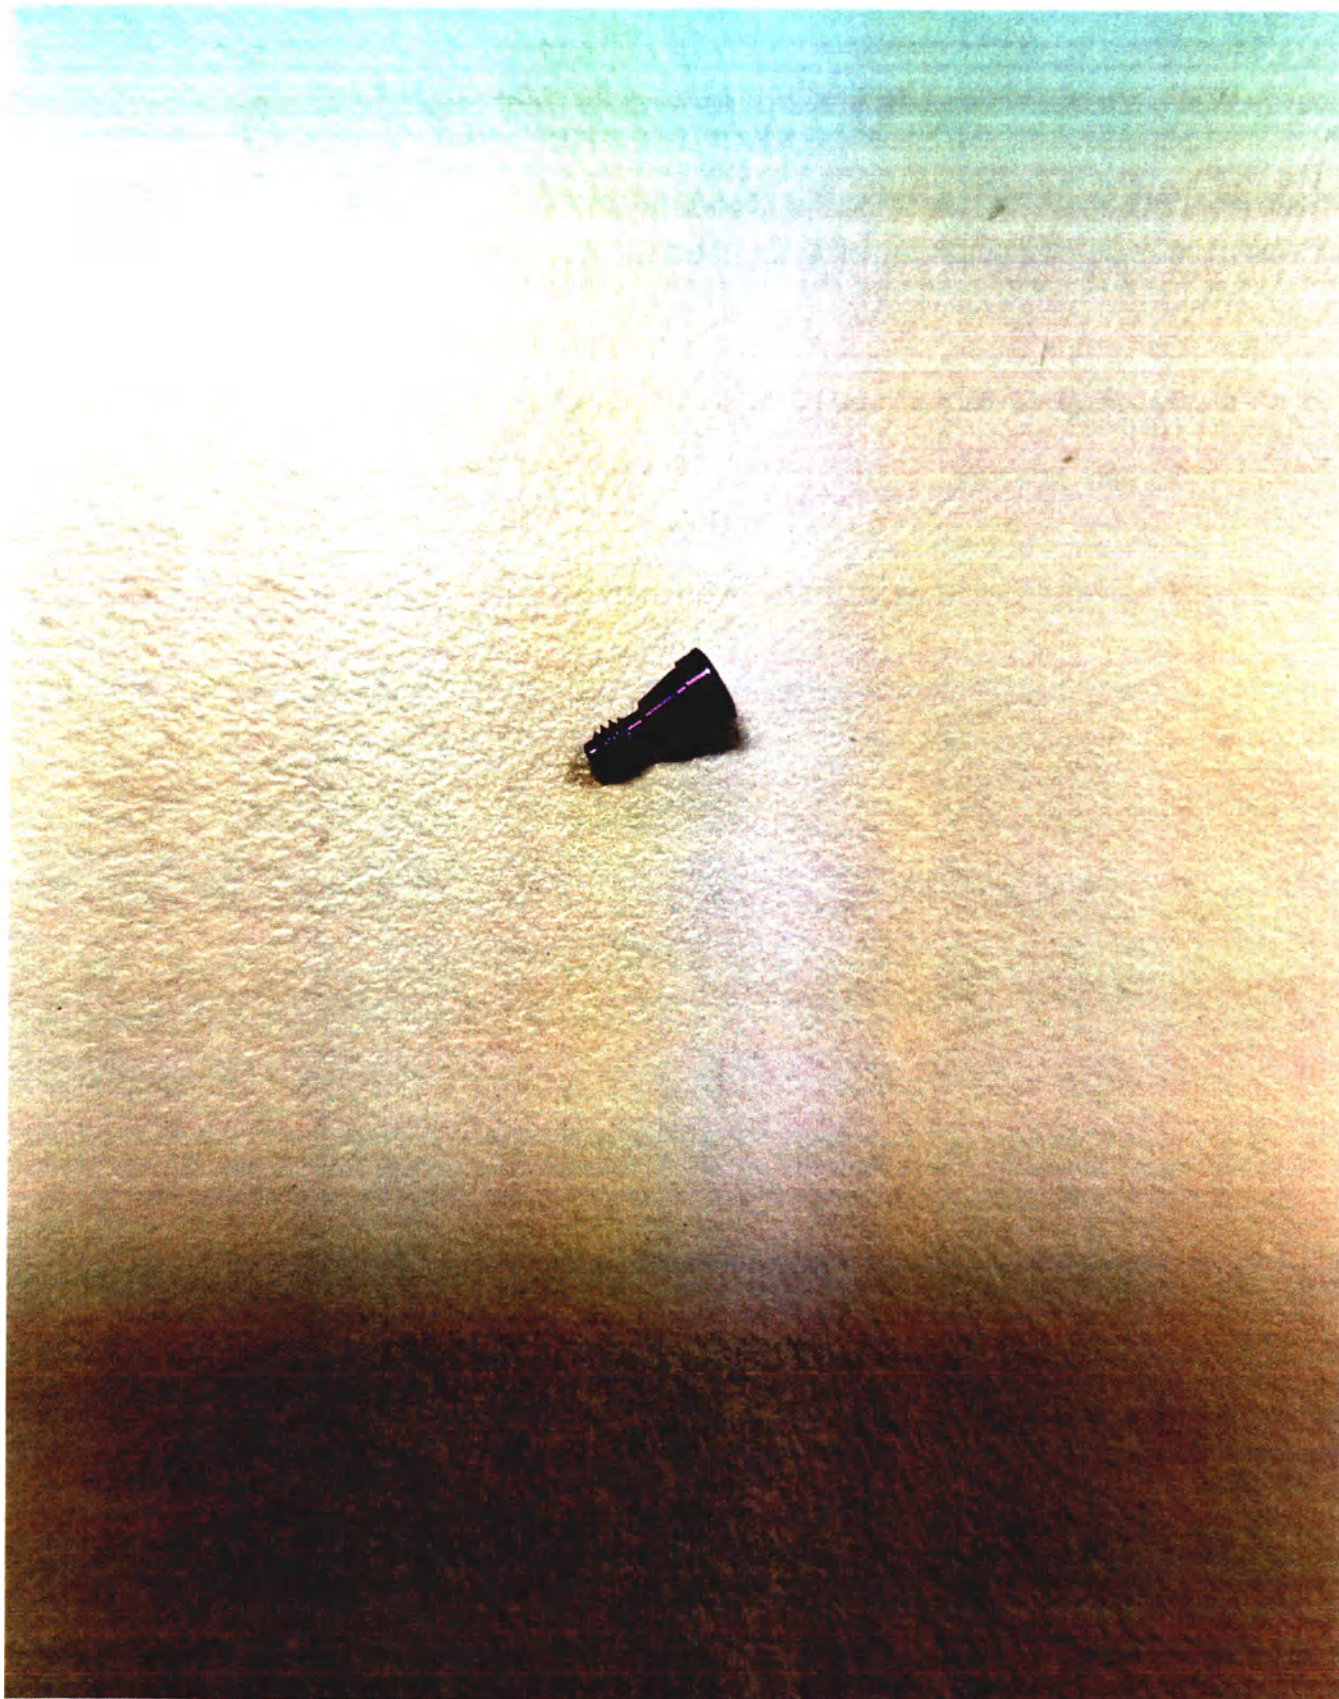


Винт-заглушка Cover Screw: GSCS35M

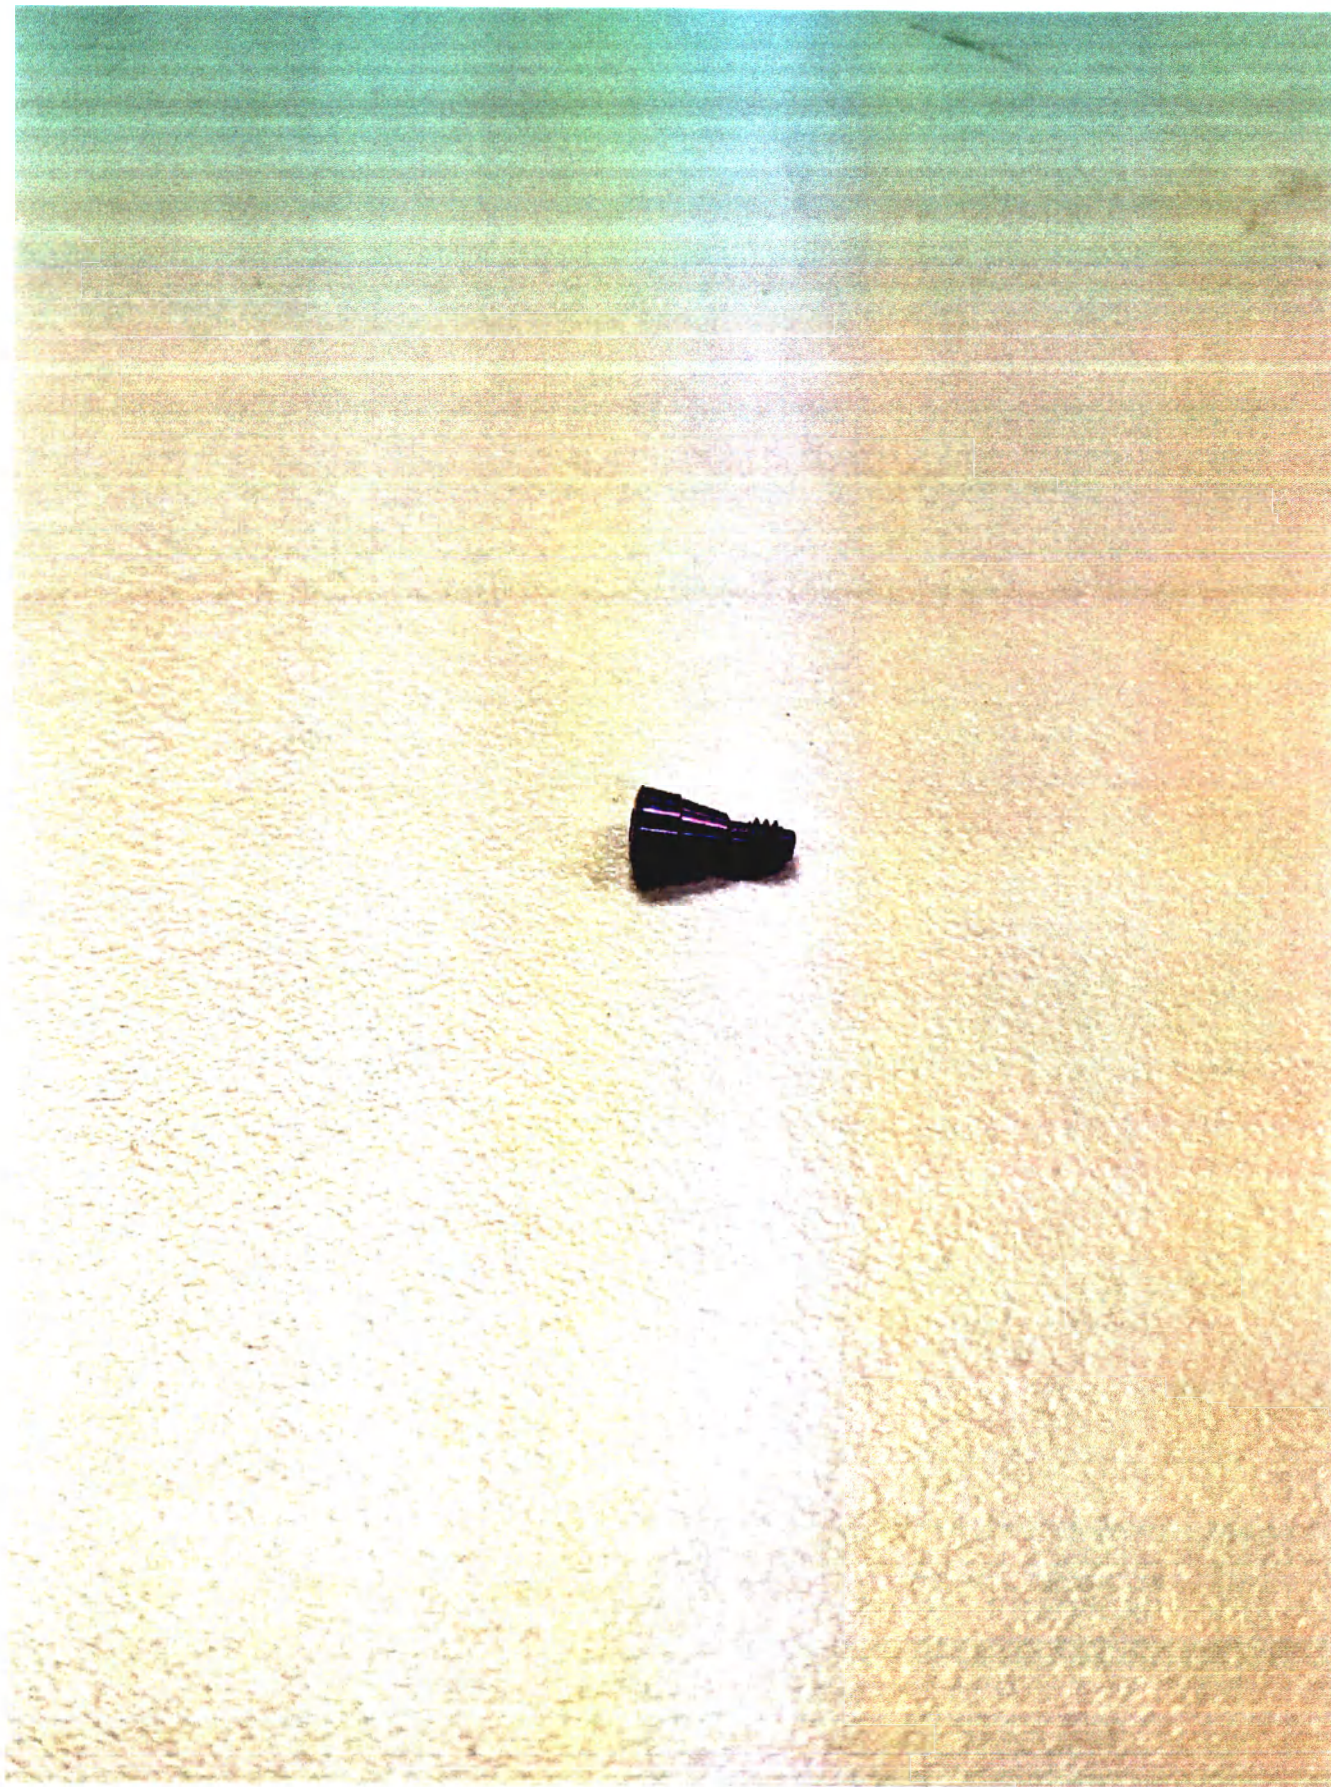

Винт-заглушка Cover Screw: GSCS35L




Винт-заглушка Cover Screw: GSCS40S-G

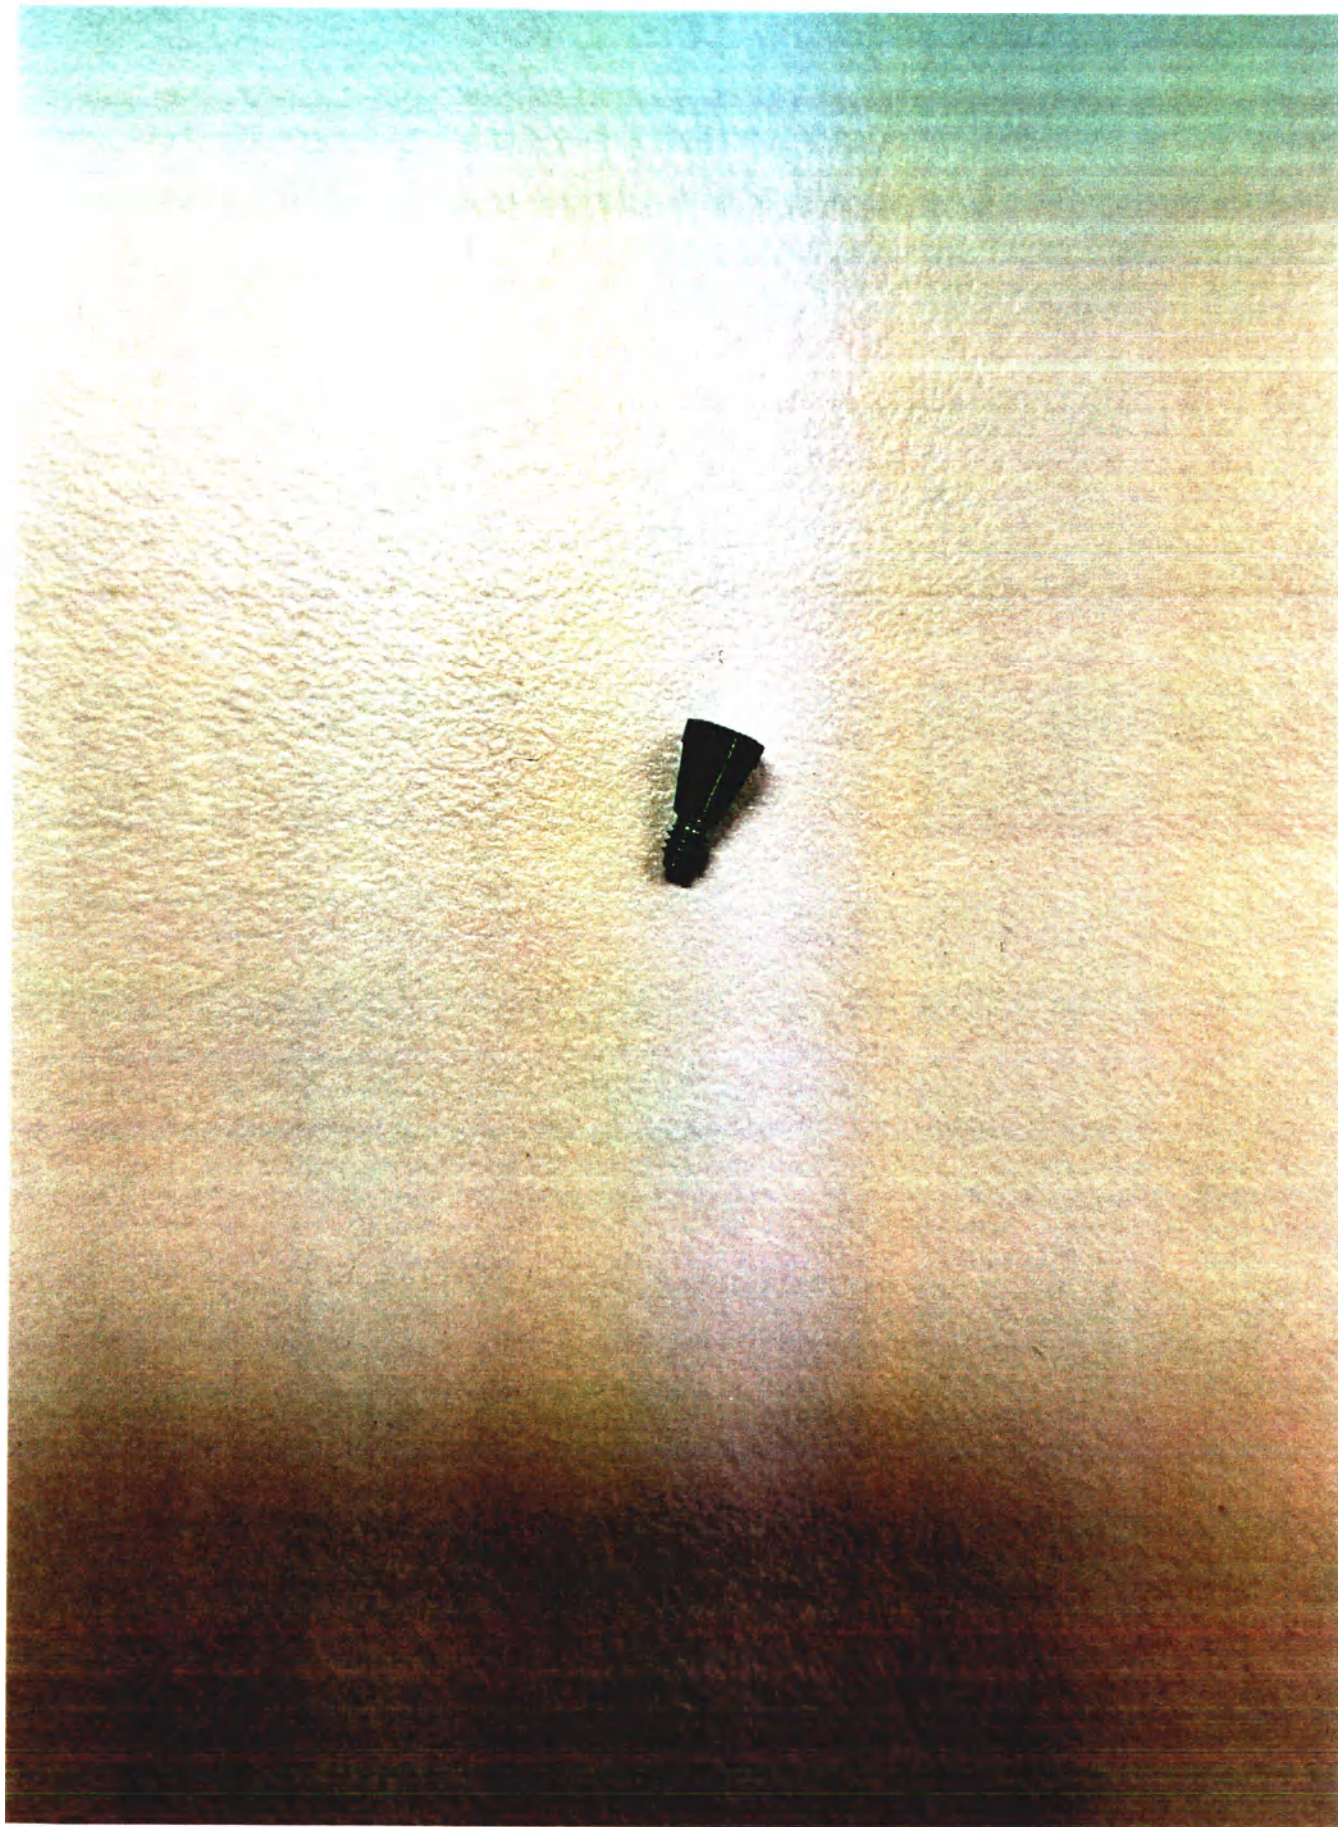


Винт-заглушка Cover Screw: GSCS40M-G



Винт-заглушка Cover Screw: GSCS40L-G

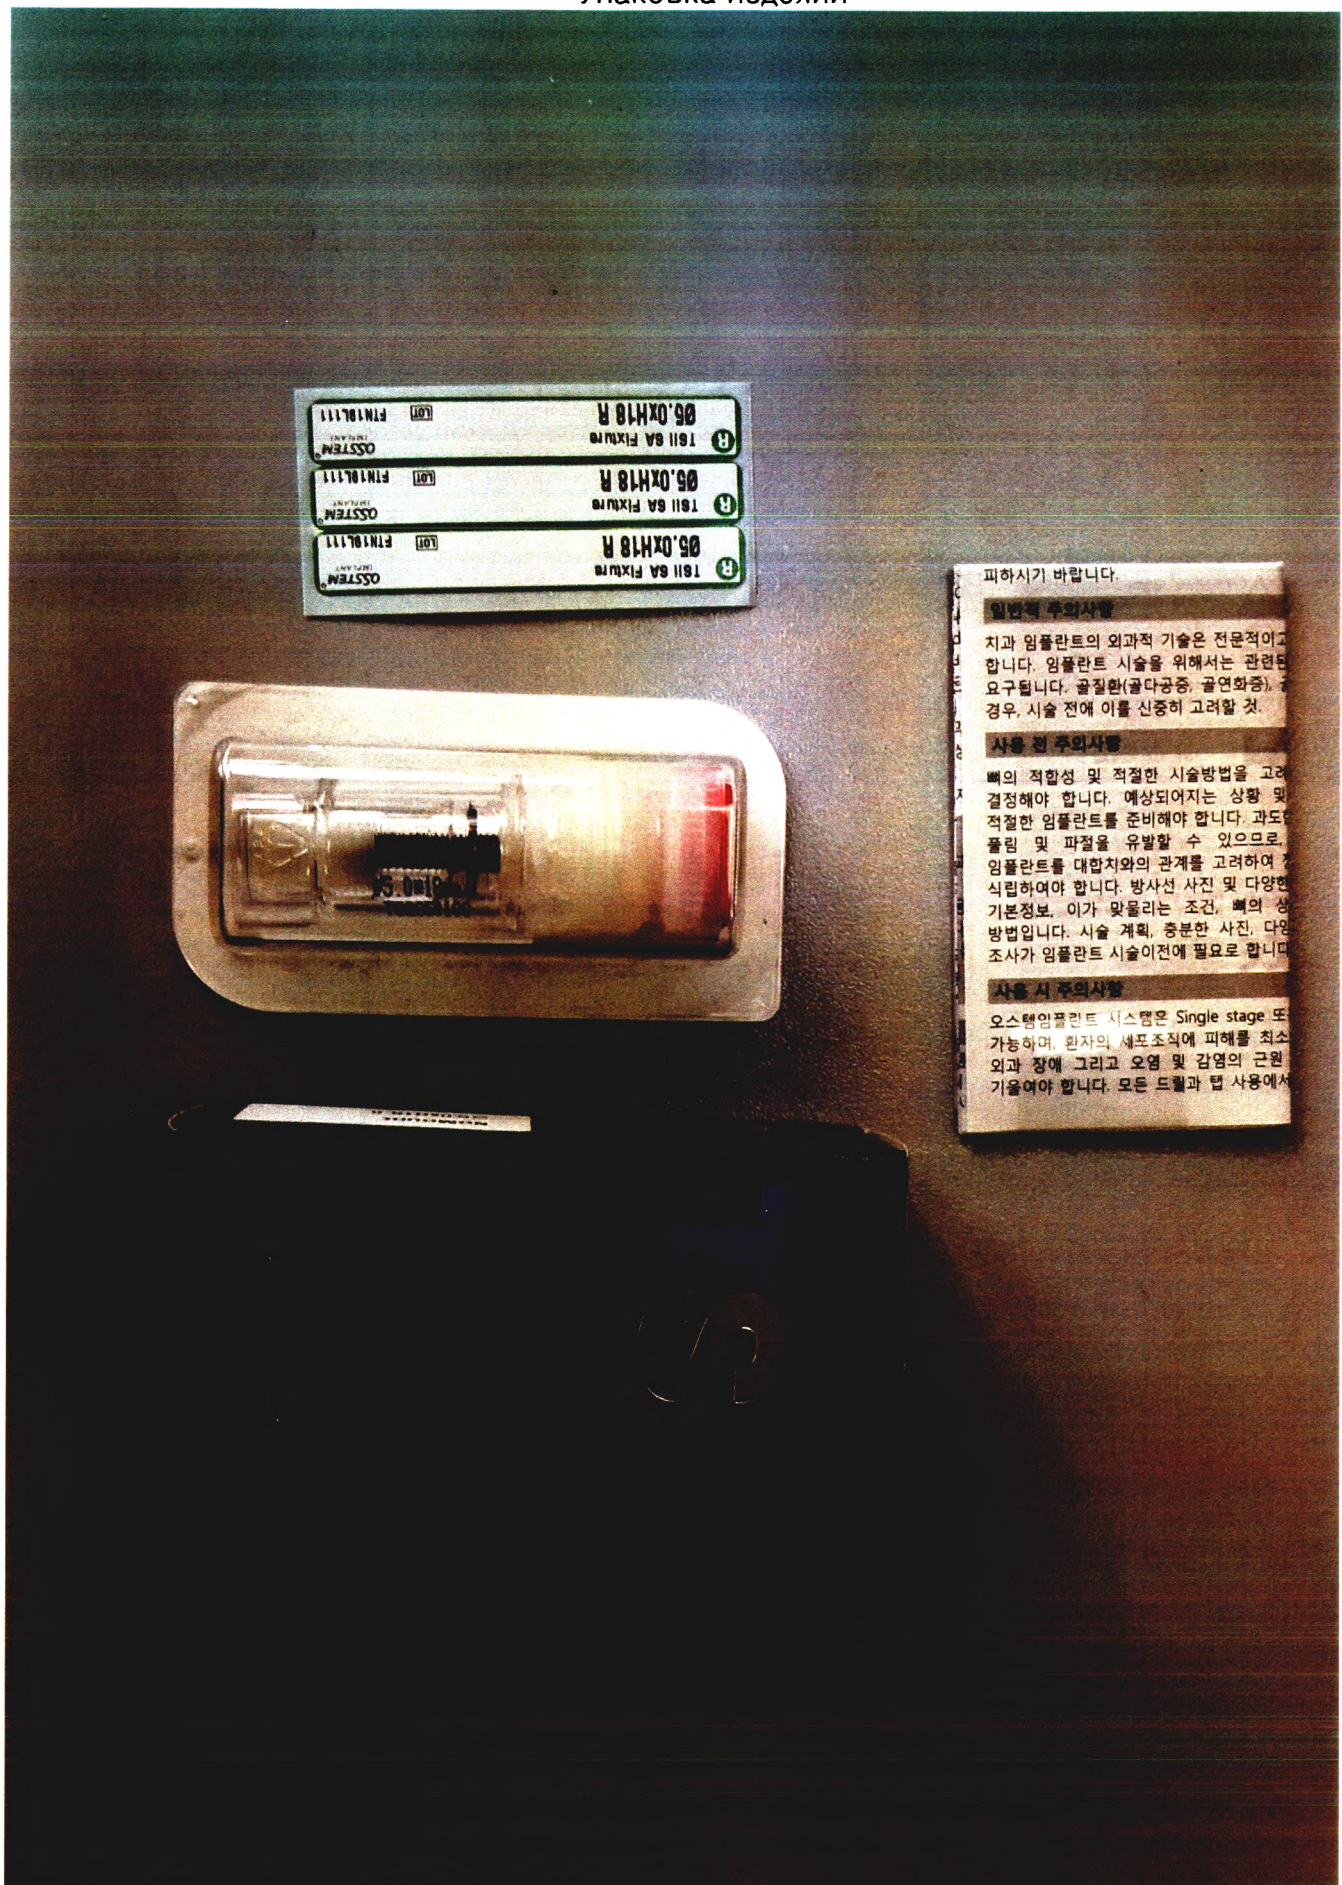

Сверху вниз: Стерильная ампула с имплантатом в герметичном блистере, инструкция по применению, наклейки для медицинской карты пациента, картонная коробка (внешний вид всех упаковок всех вариантов исполнения имплантатов идентичен)

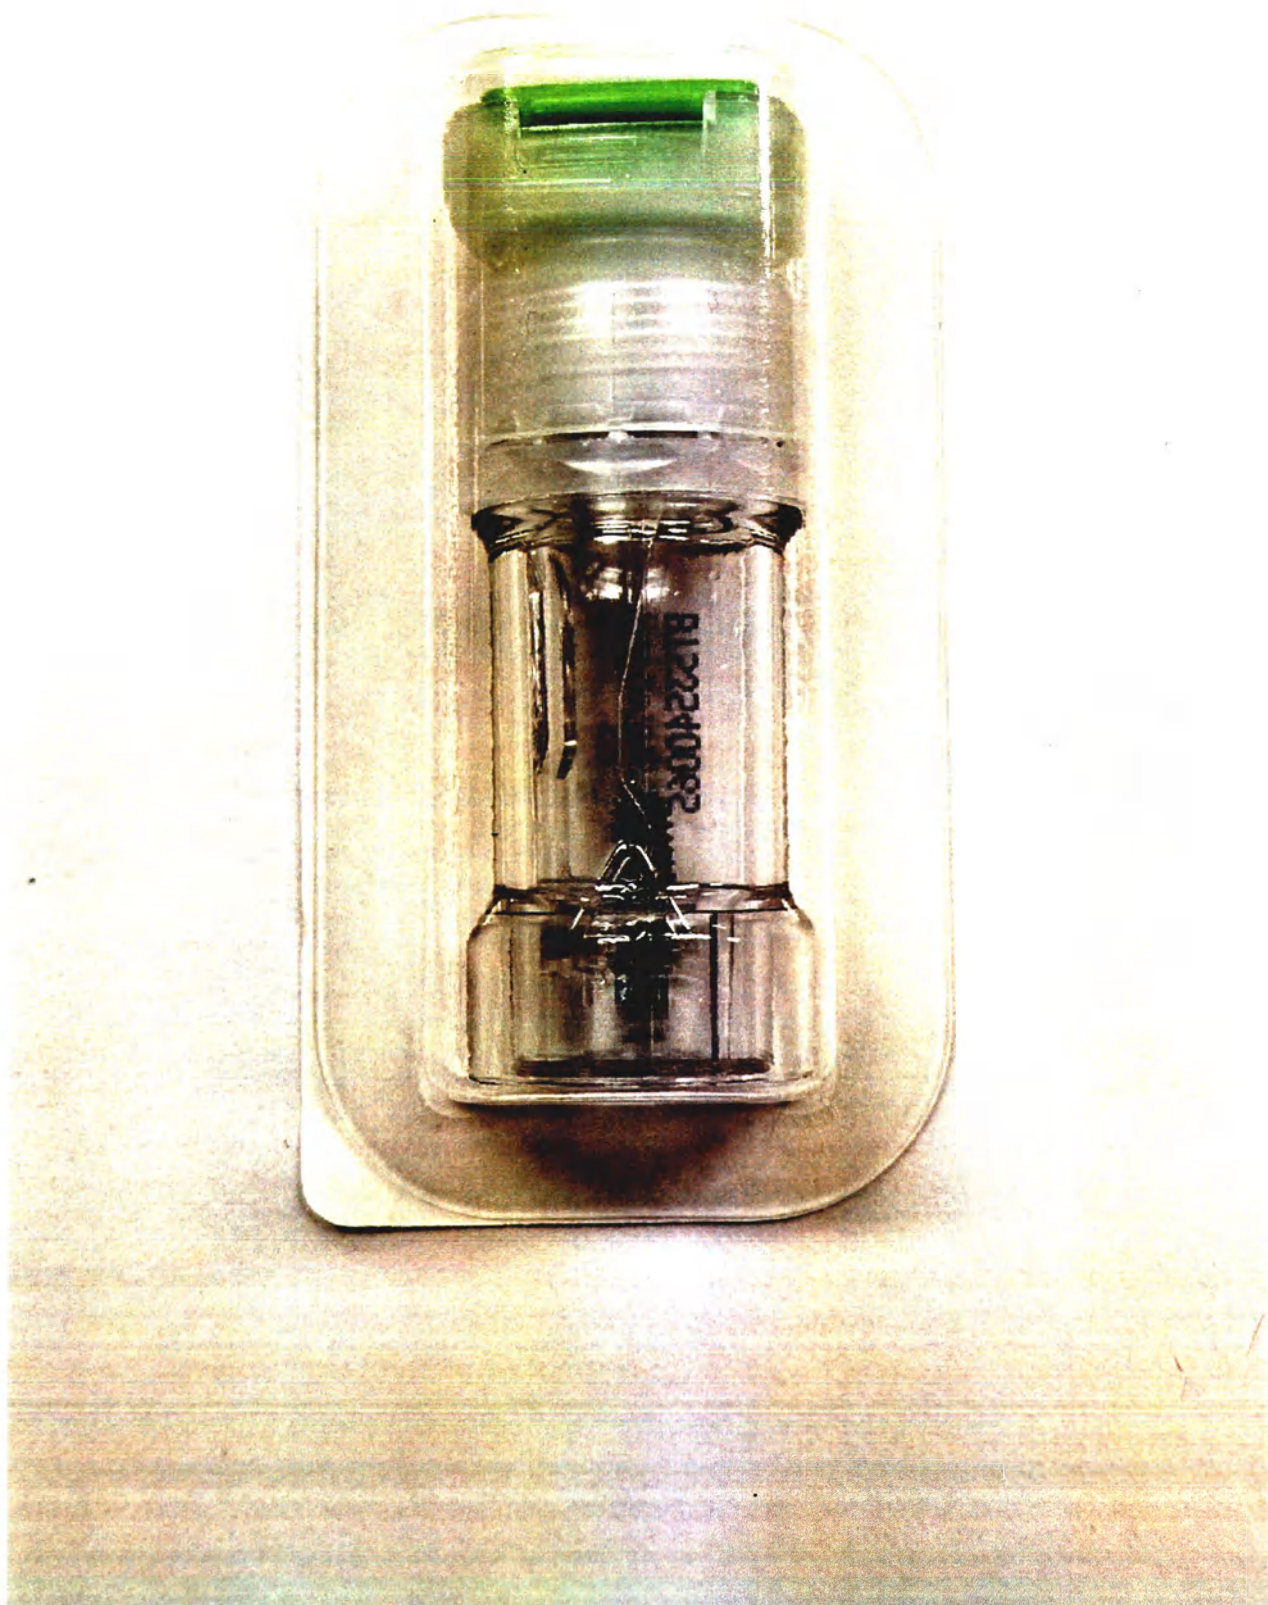

Стерильная ампула с имплантатом внутри в герметичном блистере (*внешний вид ампулы и блистера идентичен для всех вариантов исполнения*)



Расположение винта-заглушки в ампуле

Только для вариантов исполнения имплантатов:

TS II SA Pre-Mounted (BTS2M3508S, BTS2M3510S, BTS2M3511S, BTS2M3513S, BTS2S4007S, BTS2S4008S, BTS2S4010S, BTS2S4011S, BTS2S4013S, BTS2S4507S, BTS2S4508S, BTS2S4510S, BTS2S4511S, BTS2S4513S, BTS2S5006S, BTS2S5007S, BTS2S5008S, BTS2S5010S, BTS2S5011S,


BTS2S5013S, BTS2M3515S, BTS2M3518S, BTS2S4015S, BTS2S4018S, BTS2S4515S, BTS2S4518S, BTS2S5015S, BTS2S5018S).

TS III SA Pre-Mounted (BTS3M3008S, BTS3M3010S, BTS3M3011S, BTS3M3013S, BTS3M3508S, BTS3M3510S, BTS3M3511S, BTS3M3513S, BTS3M3515S, BTS3S4006S, BTS3S4007S, BTS3S4008S, BTS3S4010S, BTS3S4011S, BTS3S4013S, BTS3S4015S, BTS3S4506S, BTS3S4507S, BTS3S4508S, BTS3S4510S, BTS3S4511S, BTS3S4513S, BTS3S4515S, BTS3S5004S, BTS3S5005S, BTS3S5006S, BTS3S5007S, BTS3S5008S, BTS3S5010S, BTS3S5011S, BTS3S5013S, BTS3S5015S, BTS3S5506S, BTS3S5507S, BTS3S5508S, BTS3S5510S, BTS3S5511S, BTS3S5513S, BTS3S5515S, BTS3M3015S, BTS3M3518S, BTS3S4018S, BTS3S4518S, BTS3S5018S).

TS III SA Ultra-Wide Pre-Mounted (BTS3S6006S, BTS3S6007S, BTS3S6008S, BTS3S6010S, BTS3S6011S, BTS3S6013S, BTS3S7006S, BTS3S7007S, BTS3S7008S, BTS3S7010S, BTS3S7011S, BTS3S7013S).

TS IV SA Pre-Mounted (BTS4S4007S, BTS4S4008S, BTS4S4010S, BTS4S4011S, BTS4S4013S, BTS4S4507S, BTS4S4508S, BTS4S4510S, BTS4S4511S, BTS4S4513S, BTS4S5007S, BTS4S5008S, BTS4S5010S, BTS4S5011S, BTS4S5013S).

TS IV SA Ultra-Wide Pre-Mounted (BTS4S6007S, BTS4S6008S, BTS4S6010S, BTS4S6011S, BTS4S6013S, BTS4S7007S, BTS4S7008S, BTS4S7010S, BTS4S7011S, BTS4S7013S)

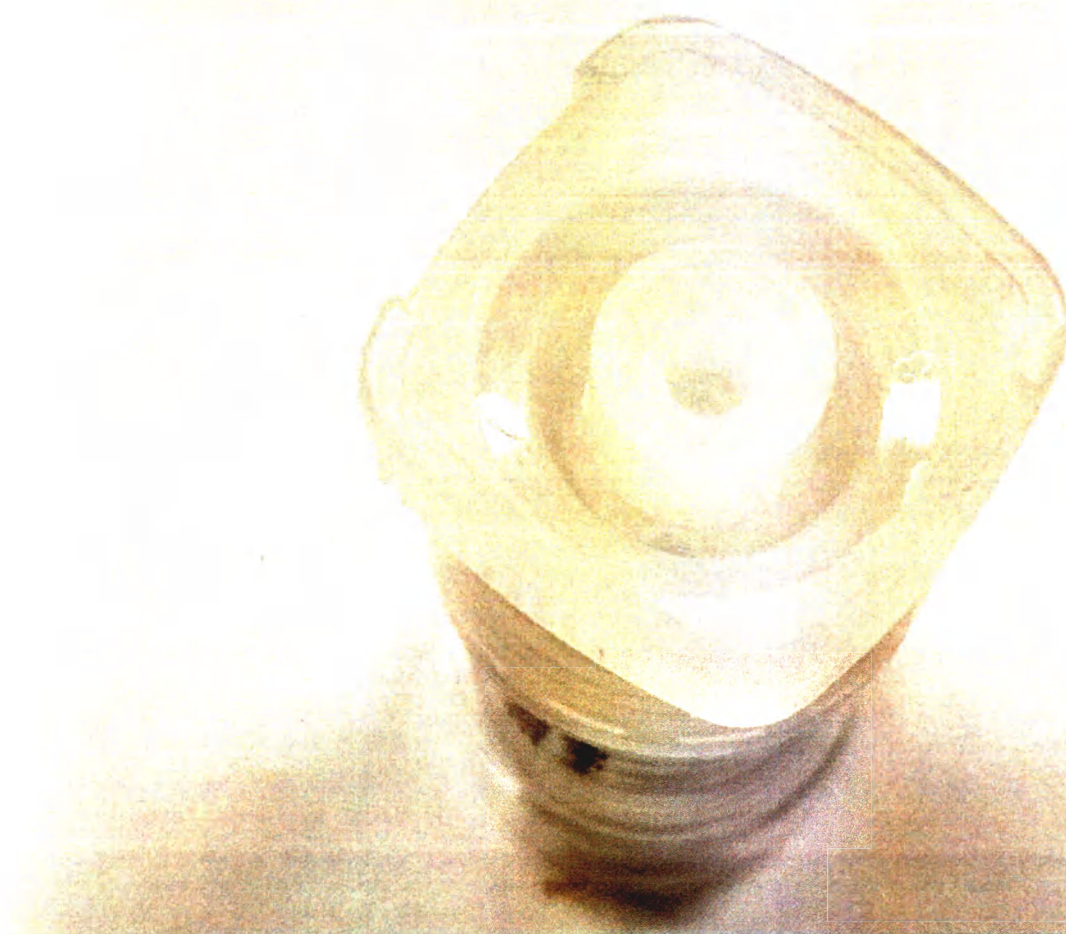


Ампула без винта-заглушки


Только для вариантов исполнения имплантатов:

TS II SA NoMount (TS2M3508S, TS2M3510S, TS2M3511S, TS2M3513S, TS2S4007S, TS2S4008S, TS2S4010S, TS2S4011S, TS2S4013S, TS2S4507S, TS2S4508S, TS2S4510S, TS2S4511S, TS2S4513S, TS2S5006S, TS2S5007S, TS2S5008S, TS2S5010S, TS2S5011S, TS2S5013S, TS2M3515S, TS2M3518S, TS2S4015S, TS2S4018S, TS2S4515S, TS2S4518S, TS2S5015S, TS2S5018S)


TS III SA NoMount (TS3M3008S, TS3M3010S, TS3M3011S, TS3M3013S, TS3M3508S, TS3M3510S, TS3M3511S, TS3M3513S, TS3M3515S, TS3S4006S, TS3S4007S, TS3S4008S, TS3S4010S, TS3S4011S, TS3S4013S, TS3S4015S, TS3S4506S, TS3S4507S, TS3S4508S, TS3S4510S, TS3S4511S, TS3S4513S, TS3S4515S, TS3S5004S, TS3S5005S, TS3S5006S, TS3S5007S, TS3S5008S, TS3S5010S, TS3S5011S, TS3S5013S, TS3S5015S, TS3S5506S, TS3S5507S, TS3S5508S, TS3S5510S, TS3S5511S, TS3S5513S, TS3S5515S, TS3M3015S, TS3M3518S, TS3S4018S, TS3S4518S, TS3S5018S)
TS III SA Ultra-Wide NoMount (TS3S6006S, TS3S6007S, TS3S6008S, TS3S6010S, TS3S6011S, TS3S6013S, TS3S7006S, TS3S7007S, TS3S7008S, TS3S7010S, TS3S7011S, TS3S7013S)
TS IV SA NoMount (TS4S4007S, TS4S4008S, TS4S4010S, TS4S4011S, TS4S4013S, TS4S4507S, TS4S4508S, TS4S4510S, TS4S4511S, TS4S4513S, TS4S5007S, TS4S5008S, TS4S5010S, TS4S5011S, TS4S5013S)
TS IV SA Ultra-Wide NoMount (TS4S6007S, TS4S6008S, TS4S6010S, TS4S6011S, TS4S6013S, TS4S7007S, TS4S7008S, TS4S7010S, TS4S7011S, TS4S7013S)

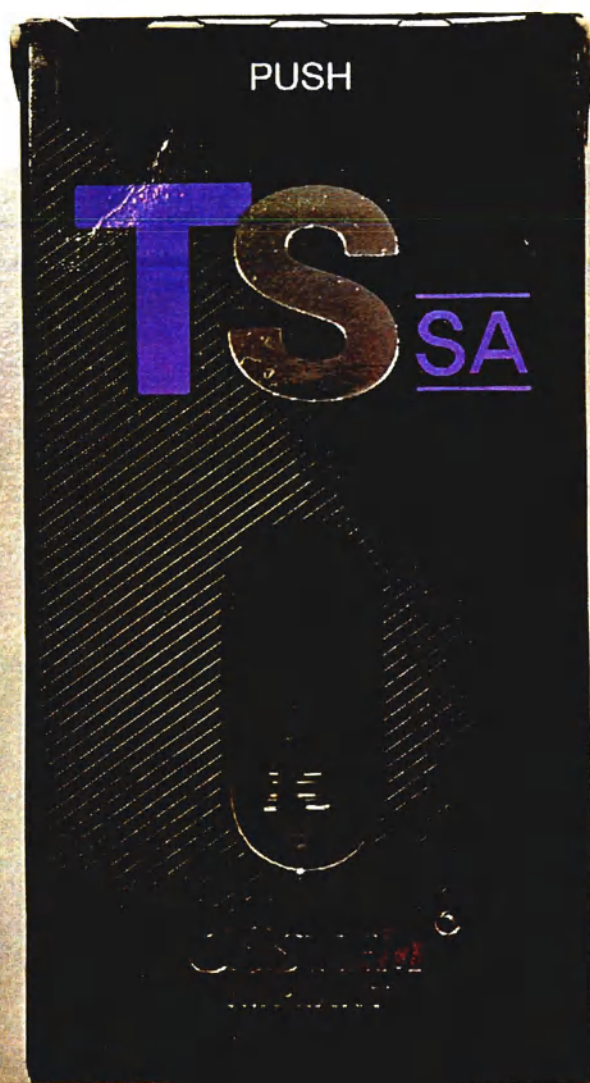

Картонная коробка (внешний вид идентичен для всех вариантов исполнения имплантатов)

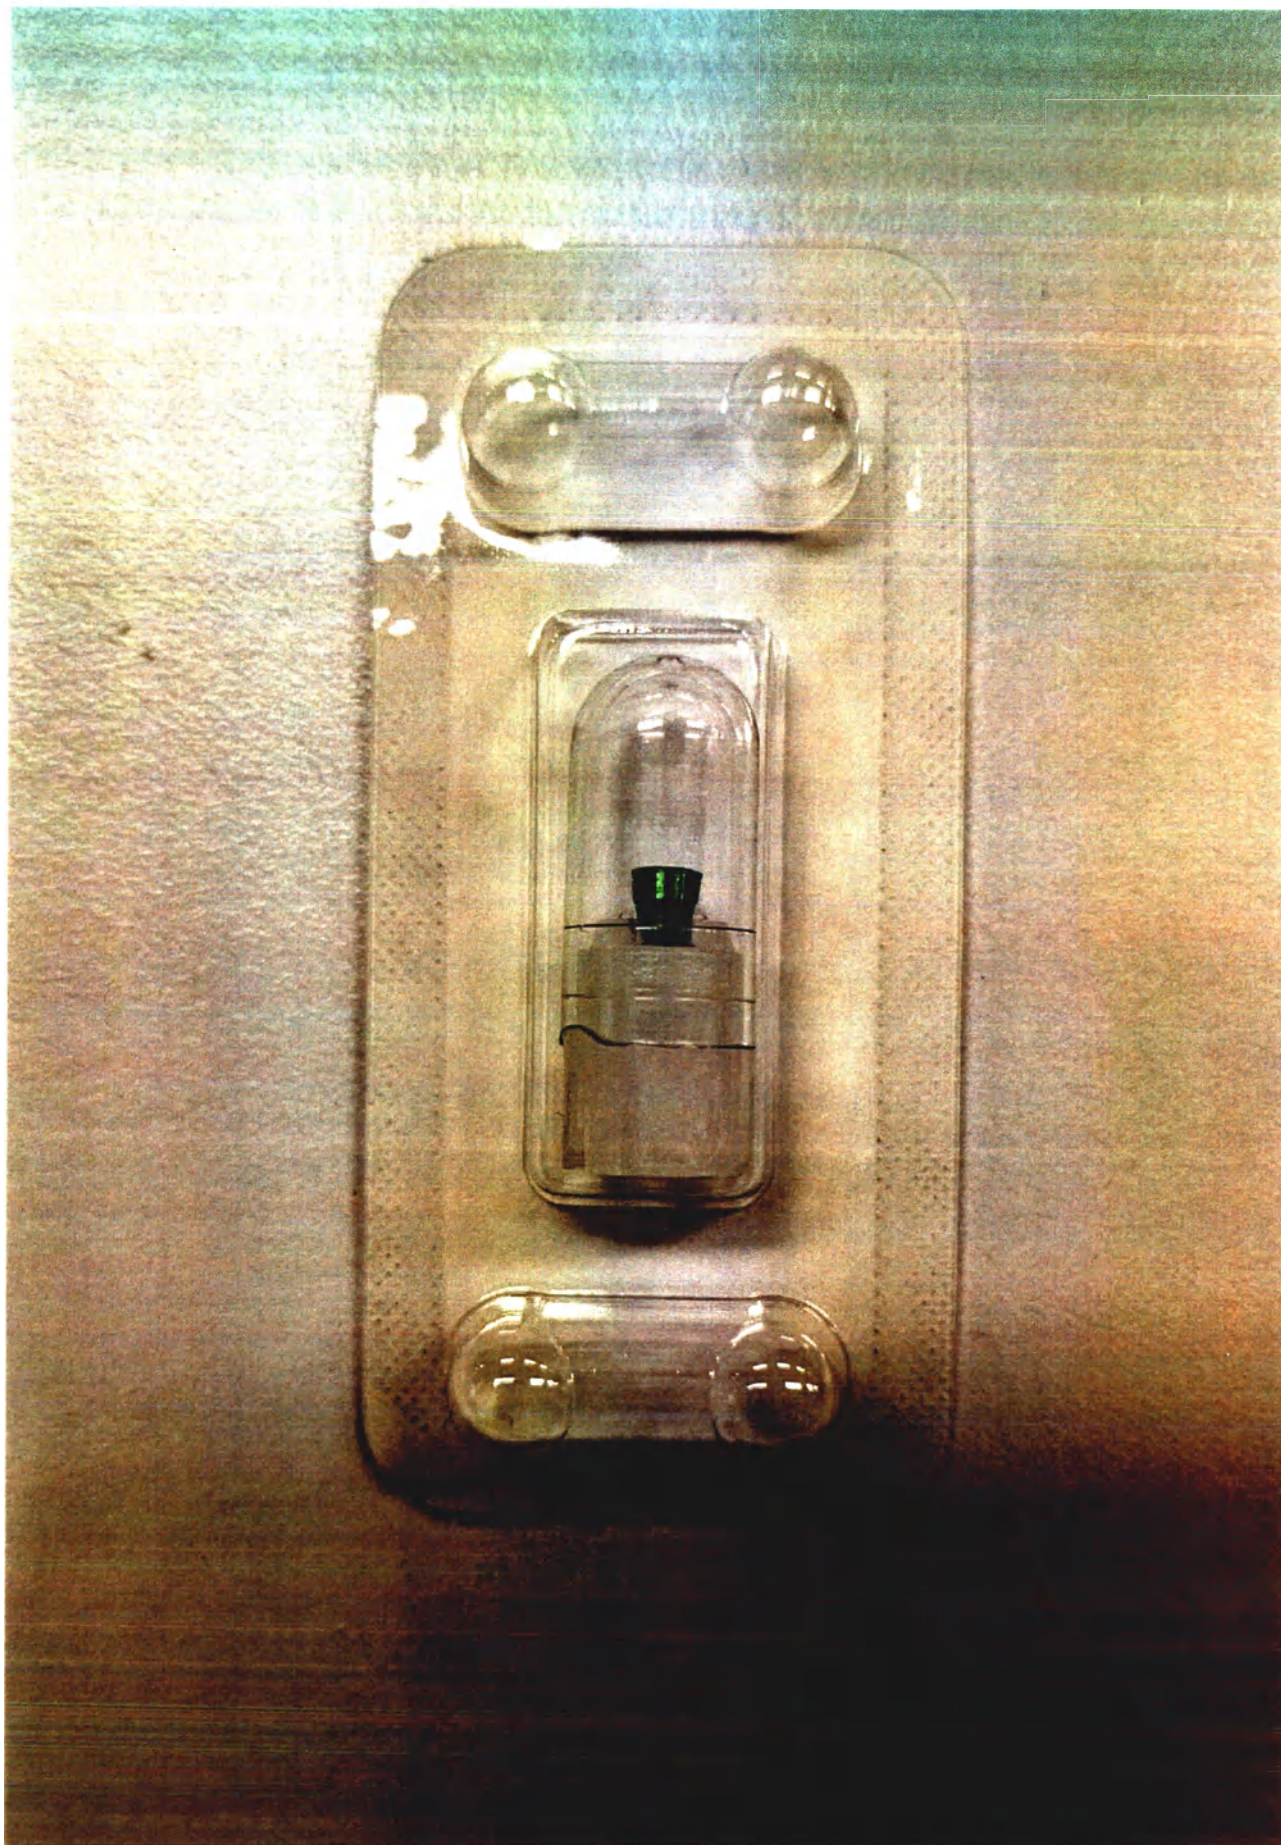

Стерильная ампула с винтом-заглушкой Cover Screw внутри в герметичном блистере (внешний вид ампулы и блистера идентичен для всех вариантов исполнения винтов-заглушек)

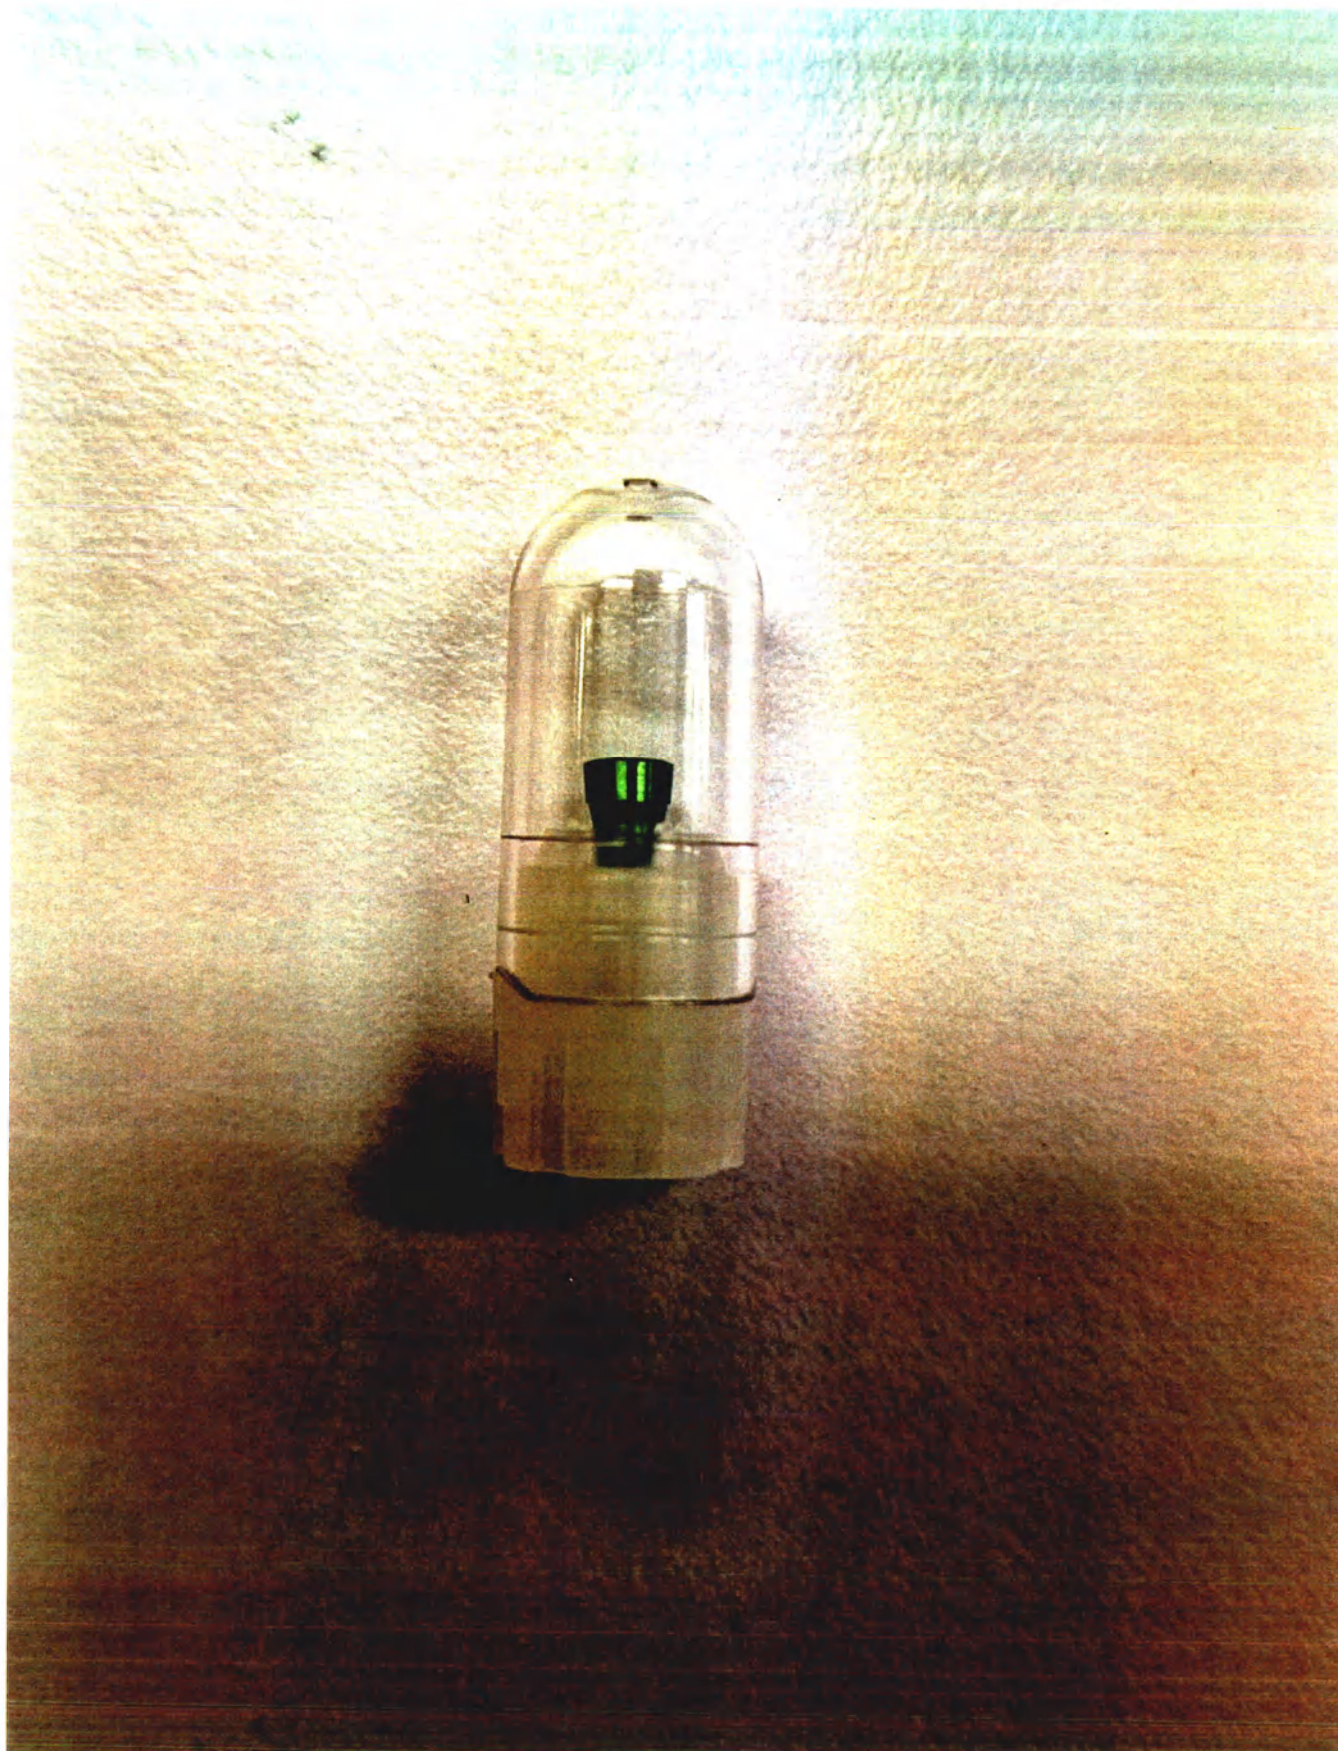

Винт-заглушка Cover Screw в стерильной ампуле (*внешний вид стерильных ампул винтов-заглушек Cover Screw идентичен*)



04 버전 2.8) - "일회용, 재사용 금지"
이식재료입니다. "Abutment의 Alloy, Polymer, Stainless steel, ceramic material이며, 보철 및 가공 재료는 오직 Titanium, Stainless steel입니다."
보철 및 가공 재료는 오직 사용할 수 있습니다. 본 제품을 혼용하여 사용할 경우에는 문제로 인하여 풀림, 파절을 생할 수 있습니다. 각 제품의 일탈로그 또는 자사 홈페이지를 고하시기 바랍니다. 제품코드, 간은 제품에 부착된 라벨을 의료기기가 아닙니다.
abutment는 세척 및 감마멸균 제품은 제품 또는 시술 부위의 멸균된 물을 사용하여 멸균된 다. 포장에 개봉 또는 파손된 제품은 사용 시 오염, 감염, 또는 폐기해야 합니다. 또한 사용에는 감염, 알러지, 실패, 등의 손상 등이 발생할 수 있습니다.

TS Prosthetics

전자첨부문서 "재사용금지"
ifu.osstem.com ZFHFHE

TS
Cover
Screw

Mini
0.4mm(H)
모델명 : GSCS35
품목명 :
치과용임플란트상부구조물
포장단위 : 1개
제조번호 : CTC24D007 V3
제조(수입)업허가번호 : 제116호
품목허가번호 : 제인06-731호
제조년월일 : 2024-04-05
유효기간 : 2032-04-04
"일회용" "멸균" "의료기기"




(01)08809917094889
(10)CTC24D007
(11)240405
(21)0447
(17)320404

Стерильная ампула с винтом-заглушкой в герметичном блистере, инструкция по применению, картонная коробка (внешний вид всех упаковок винтов-заглушек Cover Screw идентичен)




Винт-заглушка Cover Screw в картонной коробке (внешний вид всех упаковок винтов-заглушек Cover Screw идентичен)

(A)

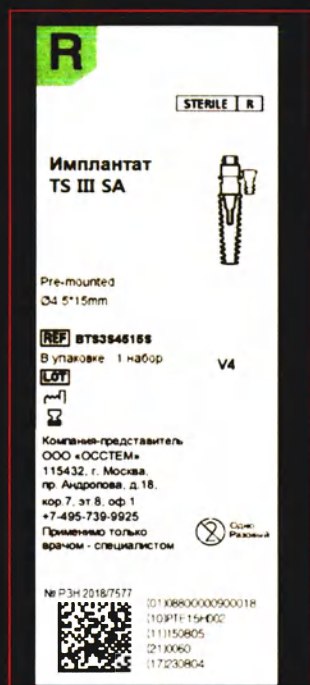

(B)

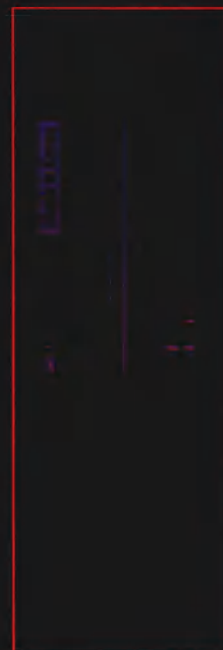

OSSTEM[®]
IMPLANT

(A)



STERILE
TREE

**Имплантат
TS II SA**

Pre-Mounted
Ø3.5*8.5mm



REF **BTS2M3508S**

В упаковке: 1 набор

LOT



Компания-представитель

ООО «ОССТЕМ»

115432, г. Москва,


пр. Андропова, д.18,

кор.7 эт.8, оф.1

+7-495-739-9925

Применимо только

врачом - специалистом



На примере варианта исполнения TS II SA Pre-Mounted, BTS2M3508S (идентична для вариантов исполнения BTS2M3508S, BTS2M3510S, BTS2M3511S, BTS2M3513S, BTS2M3515S, BTS2M3518S)



STERILE
TREF

**Имплантат
TS II SA**

Pre-Mounted
Ø4 5*10mm



REF BTS2S4510S

В упаковке 1 набор

LOT



Компания-представитель

ООО «ОССТЕМ»

115432, г. Москва,


пр. Андропова, д.18,

кор.7, эт.8, оф.1


+7-495-739-9925

Применимо только

врачом - специалистом



На примере варианта исполнения TS II SA Pre-Mounted, BTS2S4510S (идентична для вариантов исполнения BTS2S4007S, BTS2S4008S, BTS2S4010S, BTS2S4011S, BTS2S4013S, BTS2S4507S, BTS2S4508S, BTS2S4510S, BTS2S4511S, BTS2S4513S, BTS2S5006S, BTS2S5007S, BTS2S5008S, BTS2S5010S, BTS2S5011S, BTS2S5013S, BTS2S4015S, BTS2S4018S, BTS2S4515S, BTS2S4518S, BTS2S5015S, BTS2S5018S)

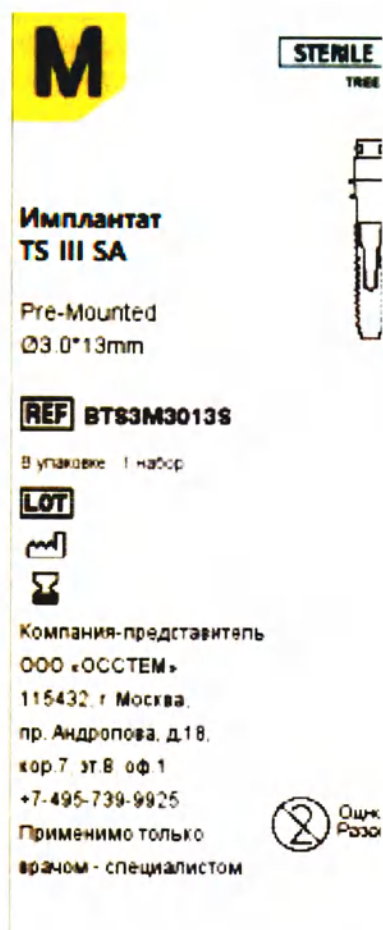


На примере варианта исполнения TS III SA Pre-Mounted, BTS3M3013S (идентична для вариантов исполнения *BTS3M3008S*, *BTS3M3010S*, *BTS3M3011S*, *BTS3M3013S*, *BTS3M3015S*)



STERILE
TPE

**Имплантат
TS III SA**

Pre-Mounted
Ø3.5*8.5mm



REF BTS3M3508S

В упаковке: 1 набор

LOT



Компания-представитель:

ООО «ОССТЕМ»

115432, г. Москва,


пр. Андропова, д. 18,

кор. 7, эт. 8, оф. 1


+7-495-739-9925

Применимо только


врачом-специалистом



На примере варианта исполнения TS III SA Pre-Mounted, BTS3M3508S (идентична для вариантов исполнения BTS3M3508S, BTS3M3510S, BTS3M3511S, BTS3M3513S, BTS3M3515S, BTS3M3518S)

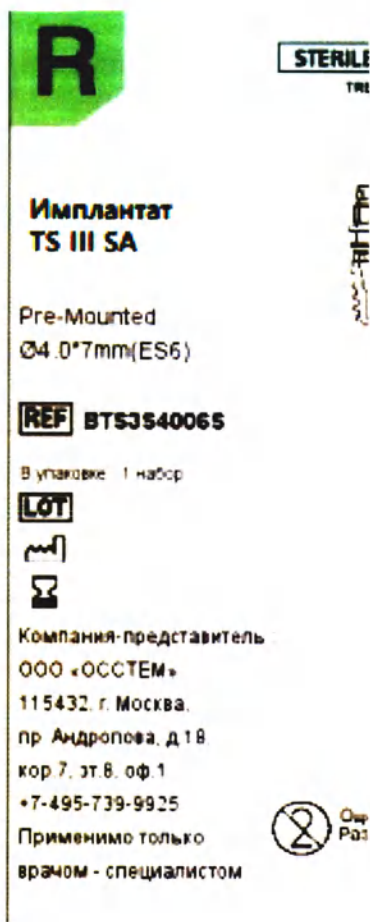

На примере варианта исполнения TS III SA Pre-Mounted, BTS3S4006S (идентична для вариантов исполнения BTS3S4006S, BTS3S4007S, BTS3S4008S, BTS3S4010S, BTS3S4011S, BTS3S4013S, BTS3S4015S, BTS3S4506S, BTS3S4507S, BTS3S4508S, BTS3S4510S, BTS3S4511S, BTS3S4513S, BTS3S4515S, BTS3S5004S, BTS3S5005S, BTS3S5006S, BTS3S5007S, BTS3S5008S, BTS3S5010S, BTS3S5011S, BTS3S5013S, BTS3S5015S, BTS3S5506S, BTS3S5507S, BTS3S5508S, BTS3S5510S, BTS3S5511S, BTS3S5513S, BTS3S5515S, BTS3S4018S, BTS3S4518S, BTS3S5018S)

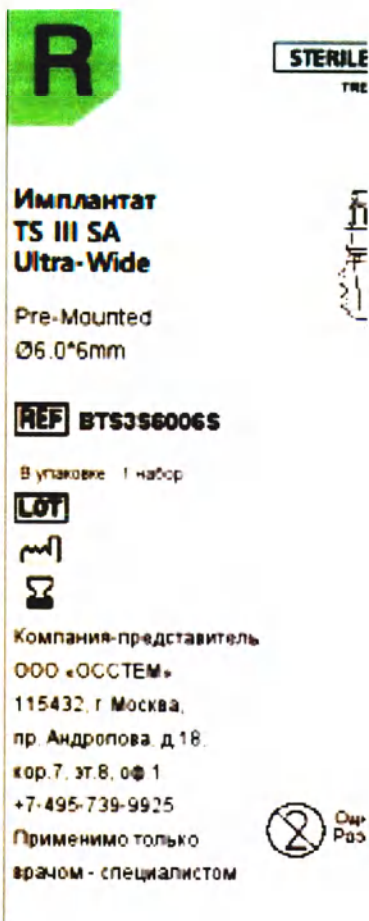

На примере варианта исполнения TS III SA Ultra-Wide Pre-Mounted, BTS3S6006S (идентична для вариантов исполнения BTS3S6006S, BTS3S6007S, BTS3S6008S, BTS3S6010S, BTS3S6011S, BTS3S6013S, BTS3S7006S, BTS3S7007S, BTS3S7008S, BTS3S7010S, BTS3S7011S, BTS3S7013S)



На примере варианта исполнения TS IV SA Pre-Mounted, BTS4S4010S (идентична для вариантов исполнения BTS4S4007S, BTS4S4008S, BTS4S4010S, BTS4S4011S, BTS4S4013S, BTS4S4507S, BTS4S4508S, BTS4S4510S, BTS4S4511S, BTS4S4513S, BTS4S5007S, BTS4S5008S, BTS4S5010S, BTS4S5011S, BTS4S5013S)



На примере варианта исполнения TS II SA NoMount, TS2M3508S (идентична для вариантов исполнения TS2M3508S, TS2M3510S, TS2M3511S, TS2M3513S, TS2S4007S, TS2S4008S, TS2S4010S, TS2S4011S, TS2S4013S, TS2S4507S, TS2S4508S, TS2S4510S, TS2S4511S, TS2S4513S, TS2S5006S, TS2S5007S, TS2S5008S, TS2S5010S, TS2S5011S, TS2S5013S, TS2M3515S, TS2M3518S, TS2S4015S, TS2S4018S, TS2S4515S, TS2S4518S, TS2S5015S, TS2S5018S)



STERILE
TPE

**Имплантат
TS IV SA**

NoMount
Ø4.0*8.5mm

REF TS4S4008S

В упаковке 1 набор

LOT



Компания-представитель

ООО «ОССТЕМ»

115432, г. Москва,


пр. Андропова, д.18,

кор.7, эт.8, оф.1


+7-495-739-9925

Применимо только

врачом - специалистом



На примере варианта исполнения TS IV SA NoMount, TS4S4008S (идентична для вариантов исполнения TS4S4007S, TS4S4008S, TS4S4010S, TS4S4011S, TS4S4013S, TS4S4507S, TS4S4508S, TS4S4510S, TS4S4511S, TS4S4513S, TS4S5007S, TS4S5008S, TS4S5010S, TS4S5011S, TS4S5013S)

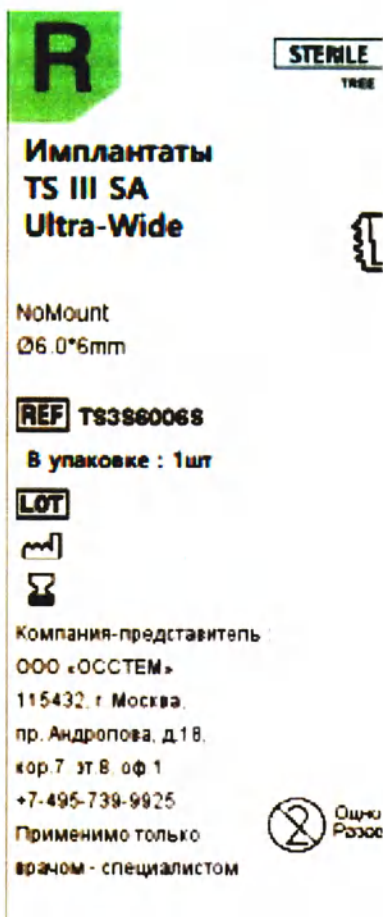

На примере варианта исполнения TS III SA Ultra-Wide NoMount, TS3S6006S (идентична для вариантов исполнения TS3S6006S, TS3S6007S, TS3S6008S, TS3S6010S, TS3S6011S, TS3S6013S, TS3S7006S, TS3S7007S, TS3S7008S, TS3S7010S, TS3S7011S, TS3S7013S)

R**STERILE**

TREE

**Имплантаты
TS IV SA
Ultra-Wide**NoMount
Ø6 D*7mm**REF** TS4S6007S

В упаковке : 1шт

LOT

Компания-представитель

ООО «ОССТЕМ»

115432, г. Москва

пр. Андропова, д.18.

кор.7, эт.8, оф.1

+7-495-739-9925


Применимо только

врачом - специалистом

Ошн
Росс

На примере варианта исполнения TS IV SA Ultra-Wide NoMount, TS4S6007S (идентична для вариантов исполнения TS4S6007S, TS4S6008S, TS4S6010S, TS4S6011S, TS4S6013S, TS4S7007S, TS4S7008S, TS4S7010S, TS4S7011S, TS4S7013S)

(В)

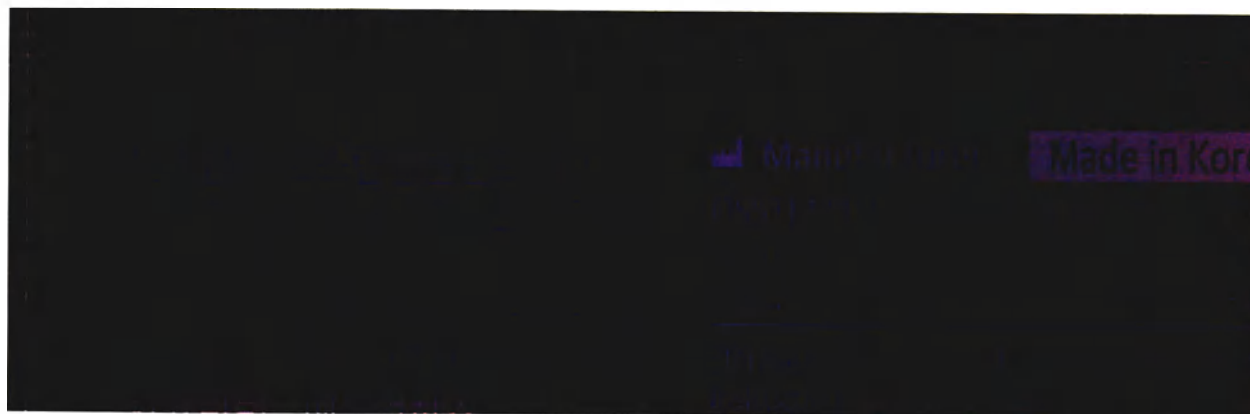**Производитель**

Osstem Implant Co., Ltd

66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Korea

Тел: 82-51-850-2500, факс:82-51-861-4693

Условия хранения: Хранить в сухом месте при комнатной температуре (1°C-30°C).


www.osstem.com

Сделано в КорееОсторожно, обратитесь к
сопроводительным
документам

Инструкция: см. руководство пользователя

Стерилизовано радиацией.

Стерильно, если упаковка не открыта или не повреждена

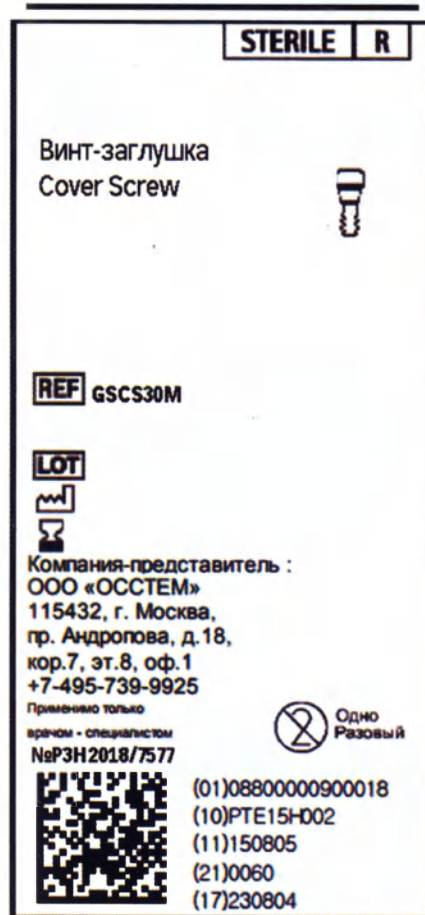

 Storage Condition: Dry place at room temperature Instruction: Refer to Manual Sterilized using irradiation Sterile unless package is opened or damaged Manufacturer OSSTEM IMPLANT Co., Ltd. 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan TEL: 82-51-850-2500 FAX: 82-51-861-4693	Условия хранения: Сухое место при комнатной температуре Инструкция: Обратить внимание на руководство пользователя Простерилизовано радиацией Стерильно пока упаковка закрыта и не повреждена Изготовитель «Осстем Имплант Ко., Лтд» (Osstem Implant Co., Ltd.), 66-16, Bansong-ro 513beon-gil, Haeundae-gu, Busan ТЕЛ: 82-51-850-2500 ФАКС: 82-51-851-4693
 보관방법: 실온의 건조한 곳(1°C-30°C) 제조업자 오스템임플란트(주) 사용방법: 매뉴얼참조 부산광역시 해운대구 반송로 513번길 66-16 Caution, Consult accompanying Documents Do Not Reuse TEL : 051-850-2500 www.osstem.com Made in Korea FAX : 051-861-4693	Условия хранения: В сухом помещении при температуре (1⁰ C – 3⁰ C) Способ использования: Согласно инструкции. Внимание, Изучите сопутствующие документы. Не допускается повторное использование Производитель Осстем Имплант Лтд г. Бусан, Р-н Хеундэ, Бансонгно, 513 Роуд , 66-16 Тел: 051 850 2500 Факс: 051 861 4693 www.osstem.com Сделано в Корее.

На примере варианта исполнения GSCS30M (маркировка для всех вариантов исполнения винта-заглушки идентична)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

55 (пятидесятью) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность главный инженер

Подпись И. И. И.

« 06 » июня 20 20

