

117246, г. Москва, Пр-д Научный, д. 20 стр. 2,
этаж 1, пом I, часть ком 13
+7 (495) 190-00-05
Info@expressm-test.ru
www.expressm-test.ru



Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛабТест»
ОГРН: 1157746600153 ИНН/КПП 7728277709/772801001

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПрофиЛабТест»

Киреев А.И.


« 08 » декабря 2023 г.



**Фотографические изображения общего вида
Набор реагентов для обнаружения реактивных антител в образцах
сыворотки и плазмы крови человека для диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»**

[illegible]

RPR-Carbon-I/VT

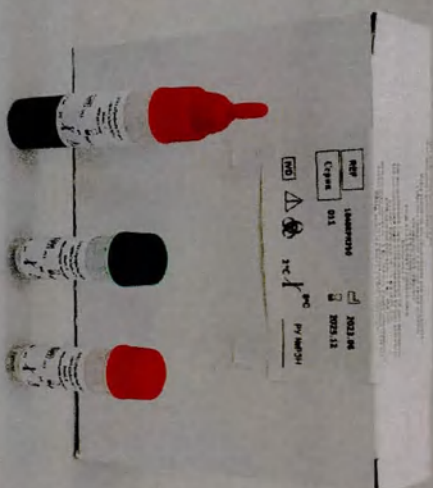

Внимание! При использовании набора для диагностики необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не использовать набор для диагностики после истечения срока годности, указанного на упаковке.

2. Не использовать набор для диагностики после вскрытия упаковки.

3. Не использовать набор для диагностики после повреждения упаковки.

4. Не использовать набор для диагностики после загрязнения упаковки.

5. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него влаги, пыли, грязи и других загрязнителей.

6. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него высоких температур.

7. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него химических веществ.

8. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него механических повреждений.

9. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него электромагнитных полей.

10. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него радиации.

11. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов окружающей среды.

12. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов человеческого фактора.

13. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов.

14. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов.

15. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов.

16. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов.

17. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов.

18. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов.

19. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов.




20. Не использовать набор для диагностики после воздействия на него других факторов.




RPR-Carbon-IVT

RPR-Carbon-IVT


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

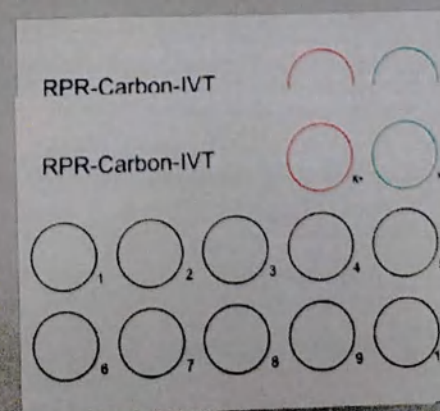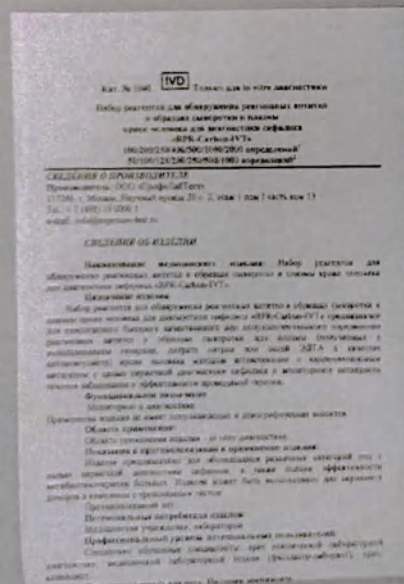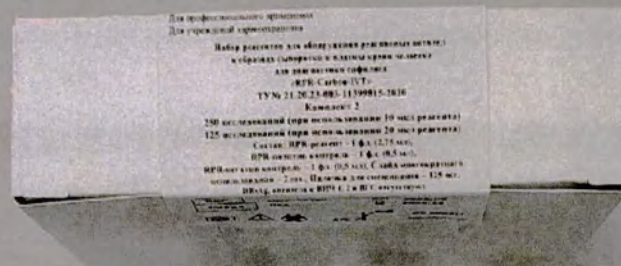

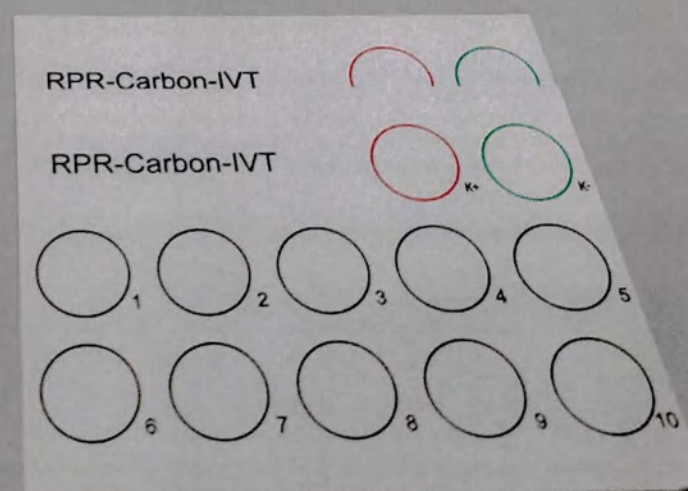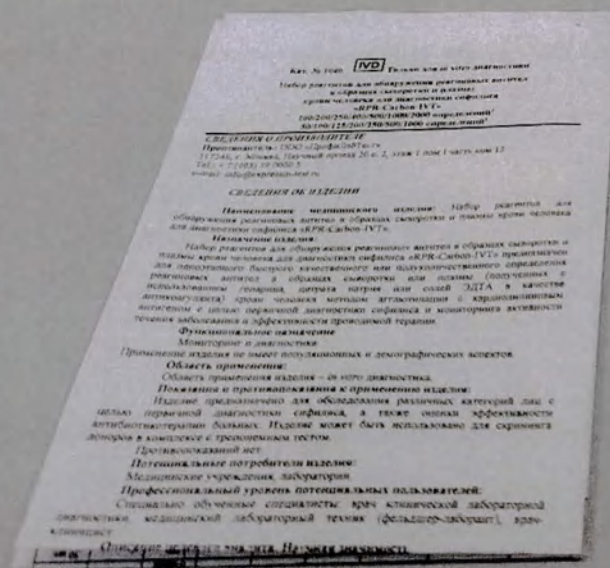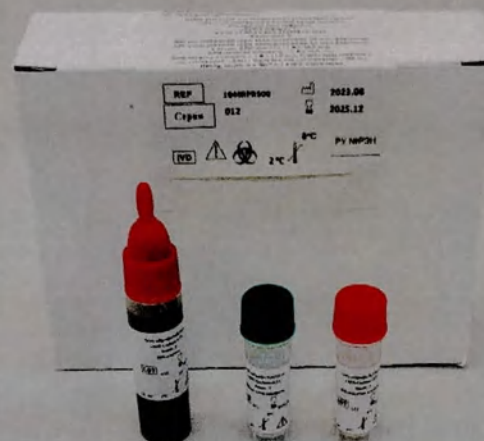

Комплект 4

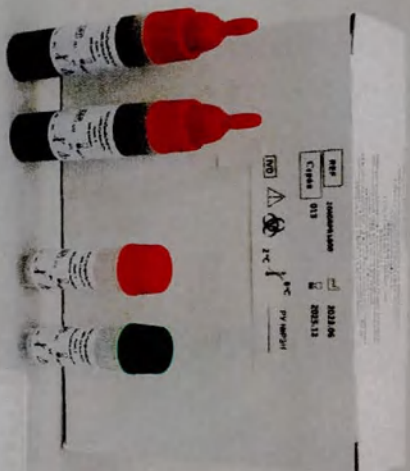

Инструкция по применению


Средство для исследования...
 1. Подготовка образца...
 2. Добавление реагента...
 3. Инкубация...
 4. Оценка результата...

RPR-Carbon-IVT




1 2 3 4 5





6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

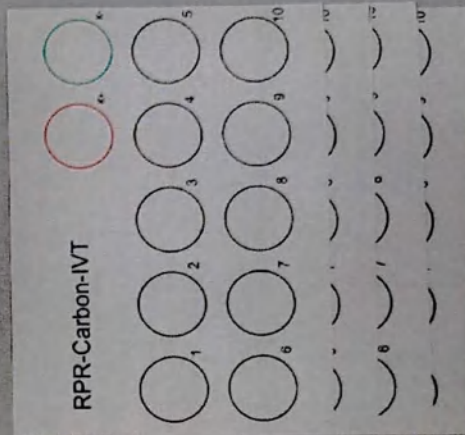


Комплект 5

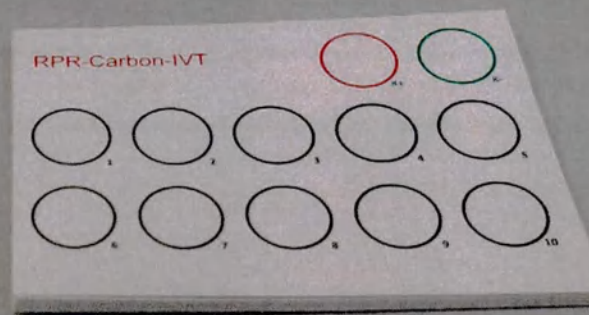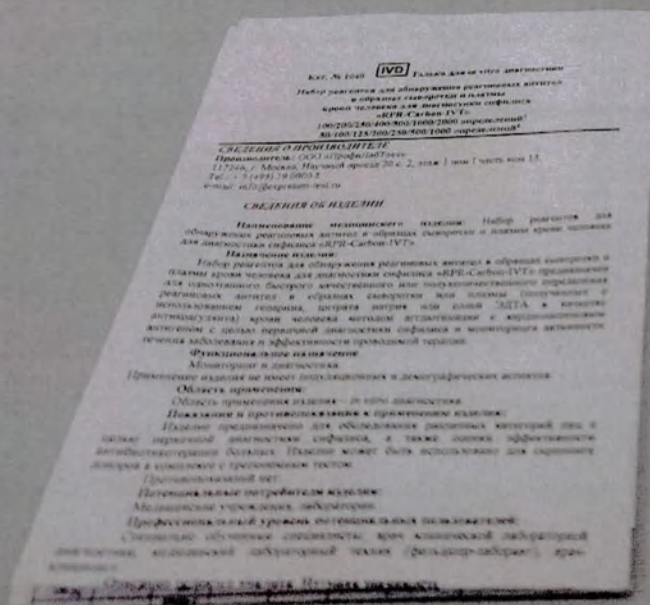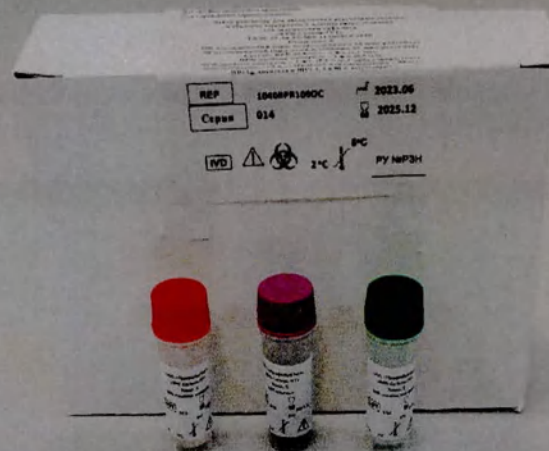

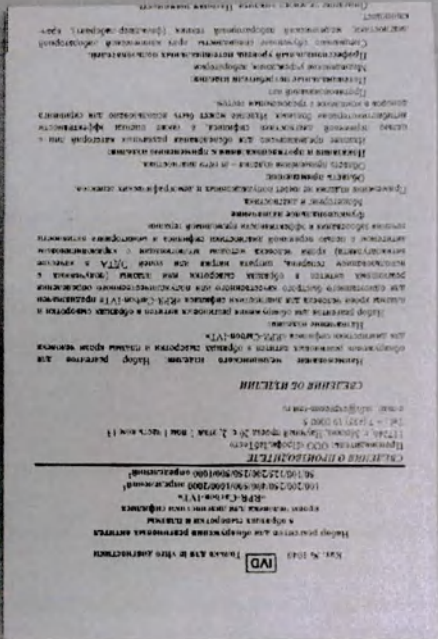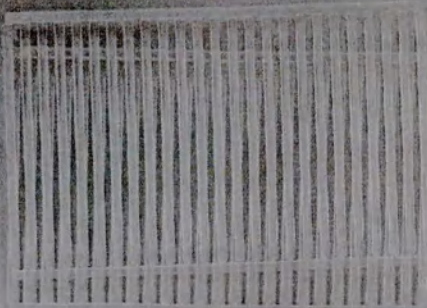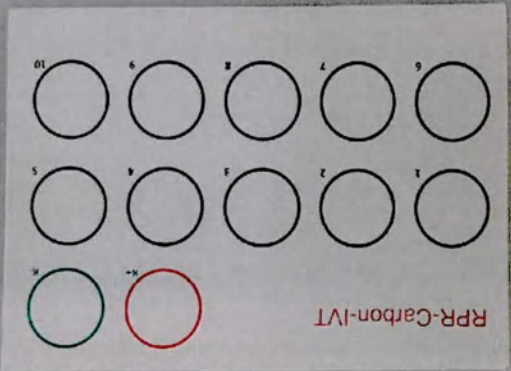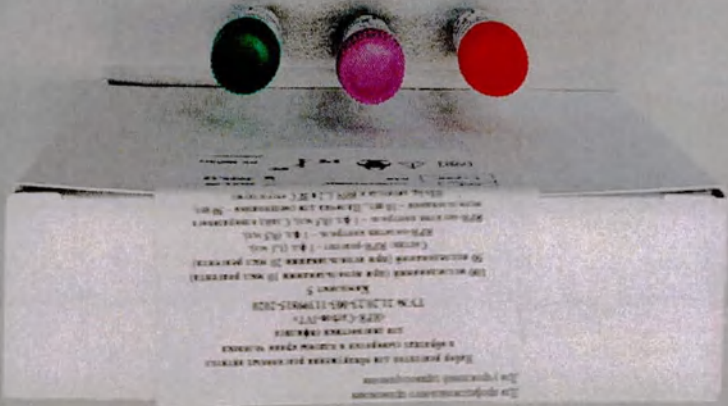

Комплект 6

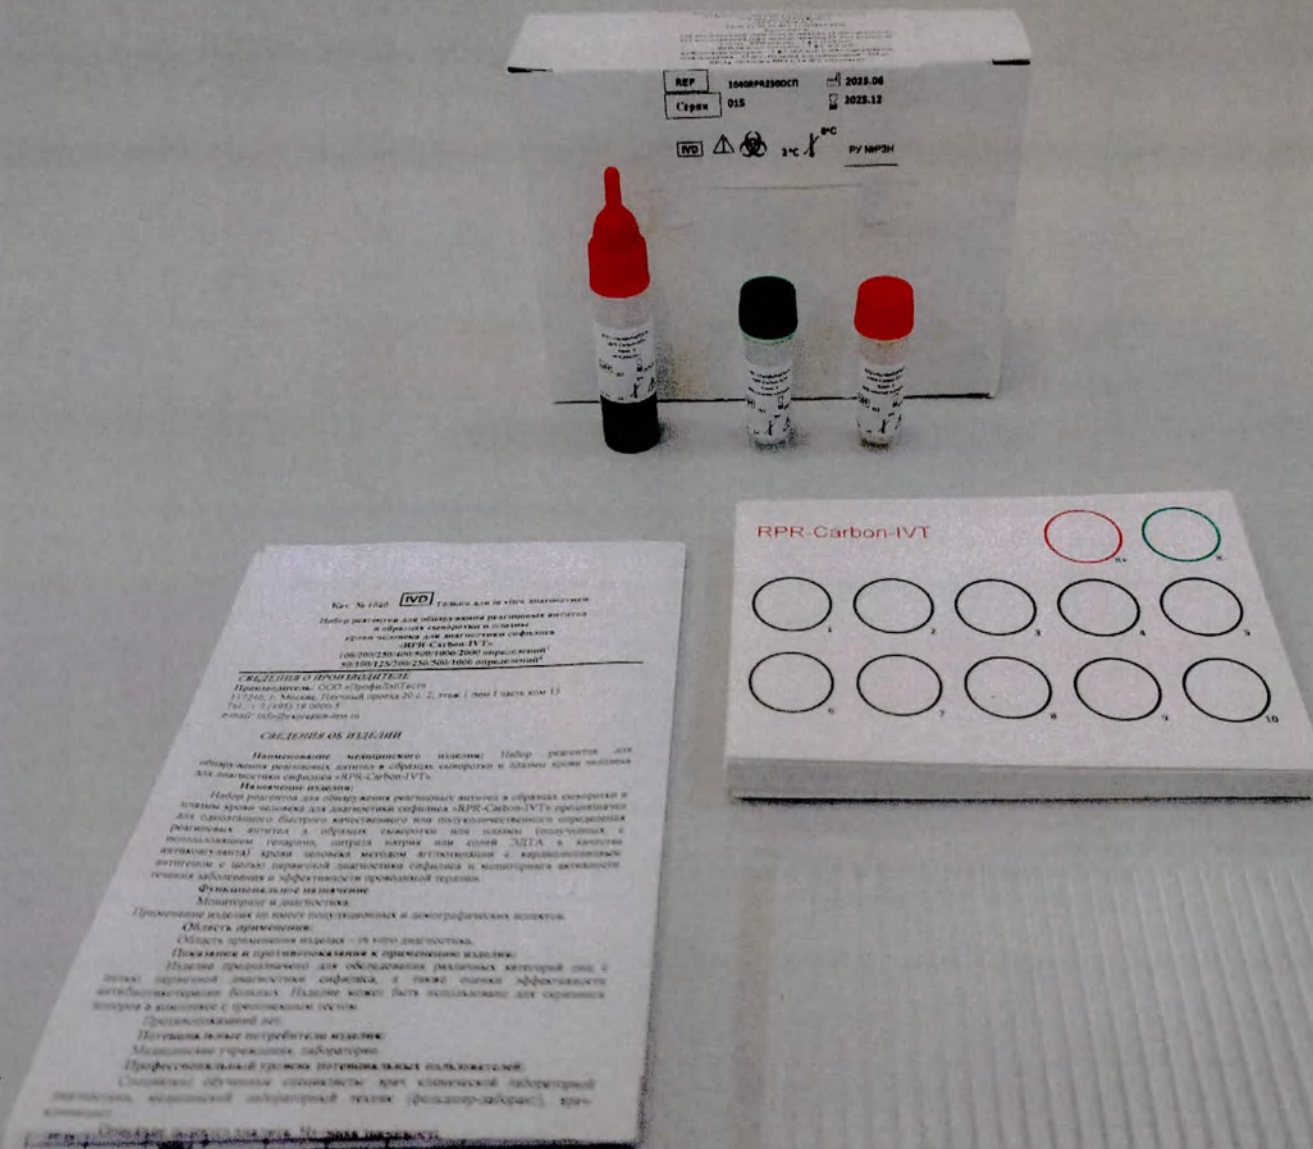






RPR-Carbon-IVT


10 numbered circles arranged in two columns. The top two circles are colored red and green, while the remaining eight are white.





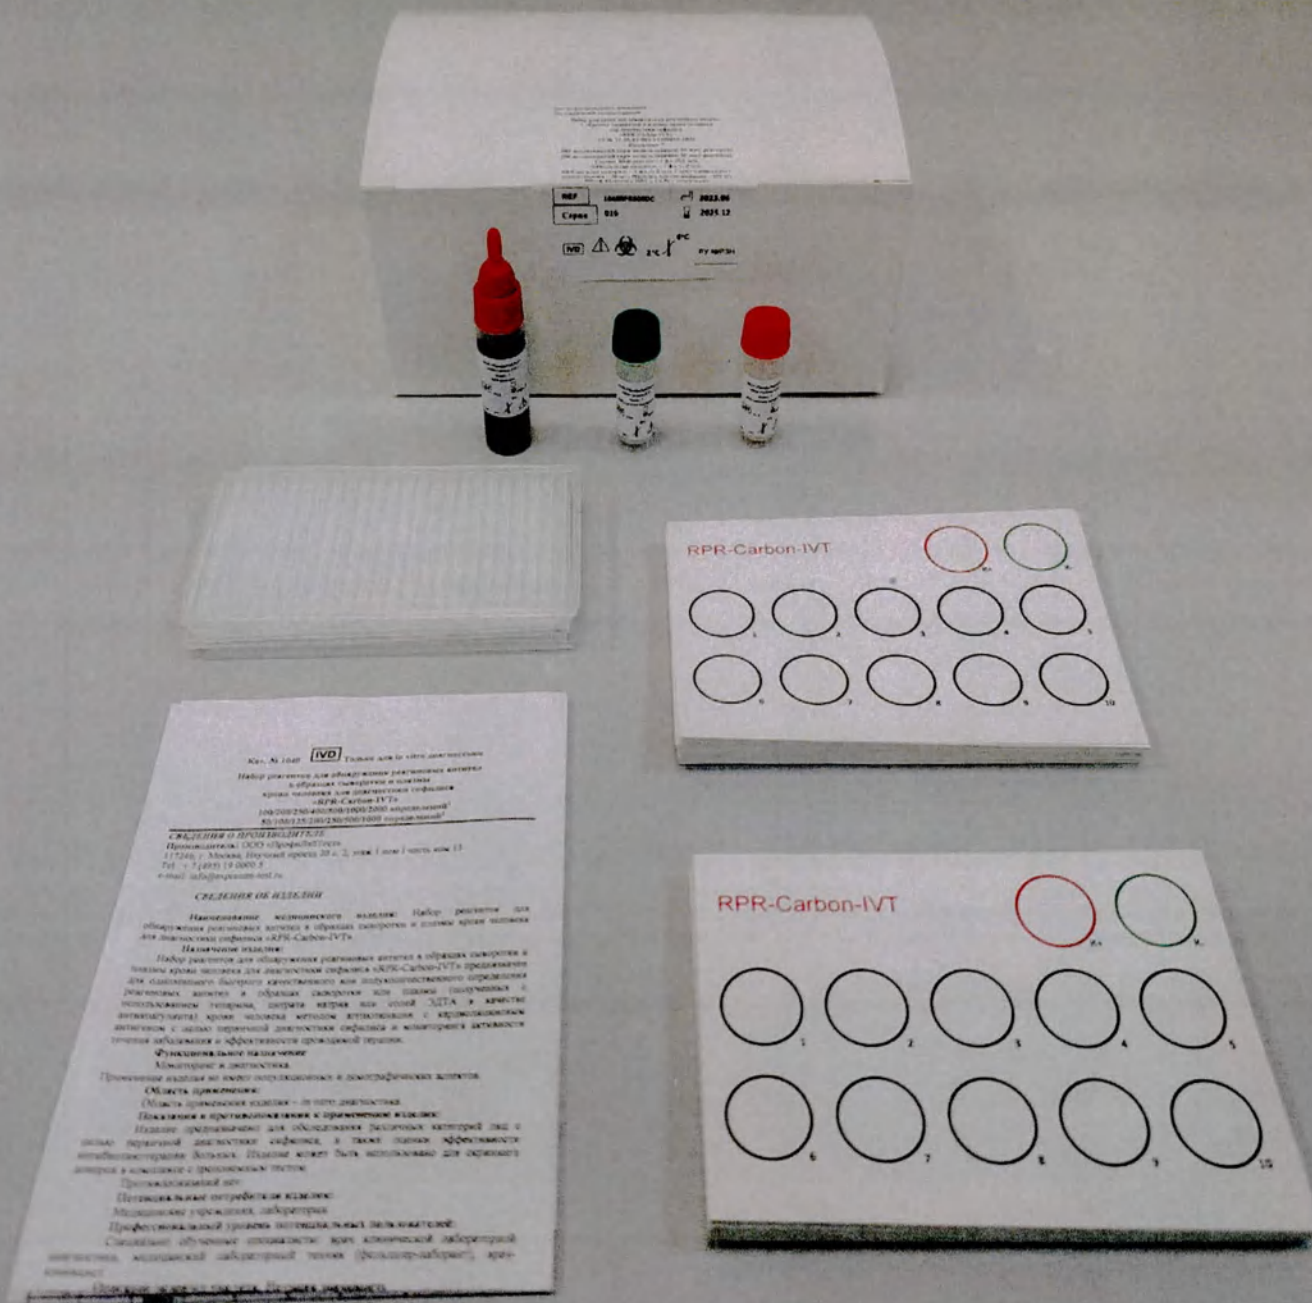


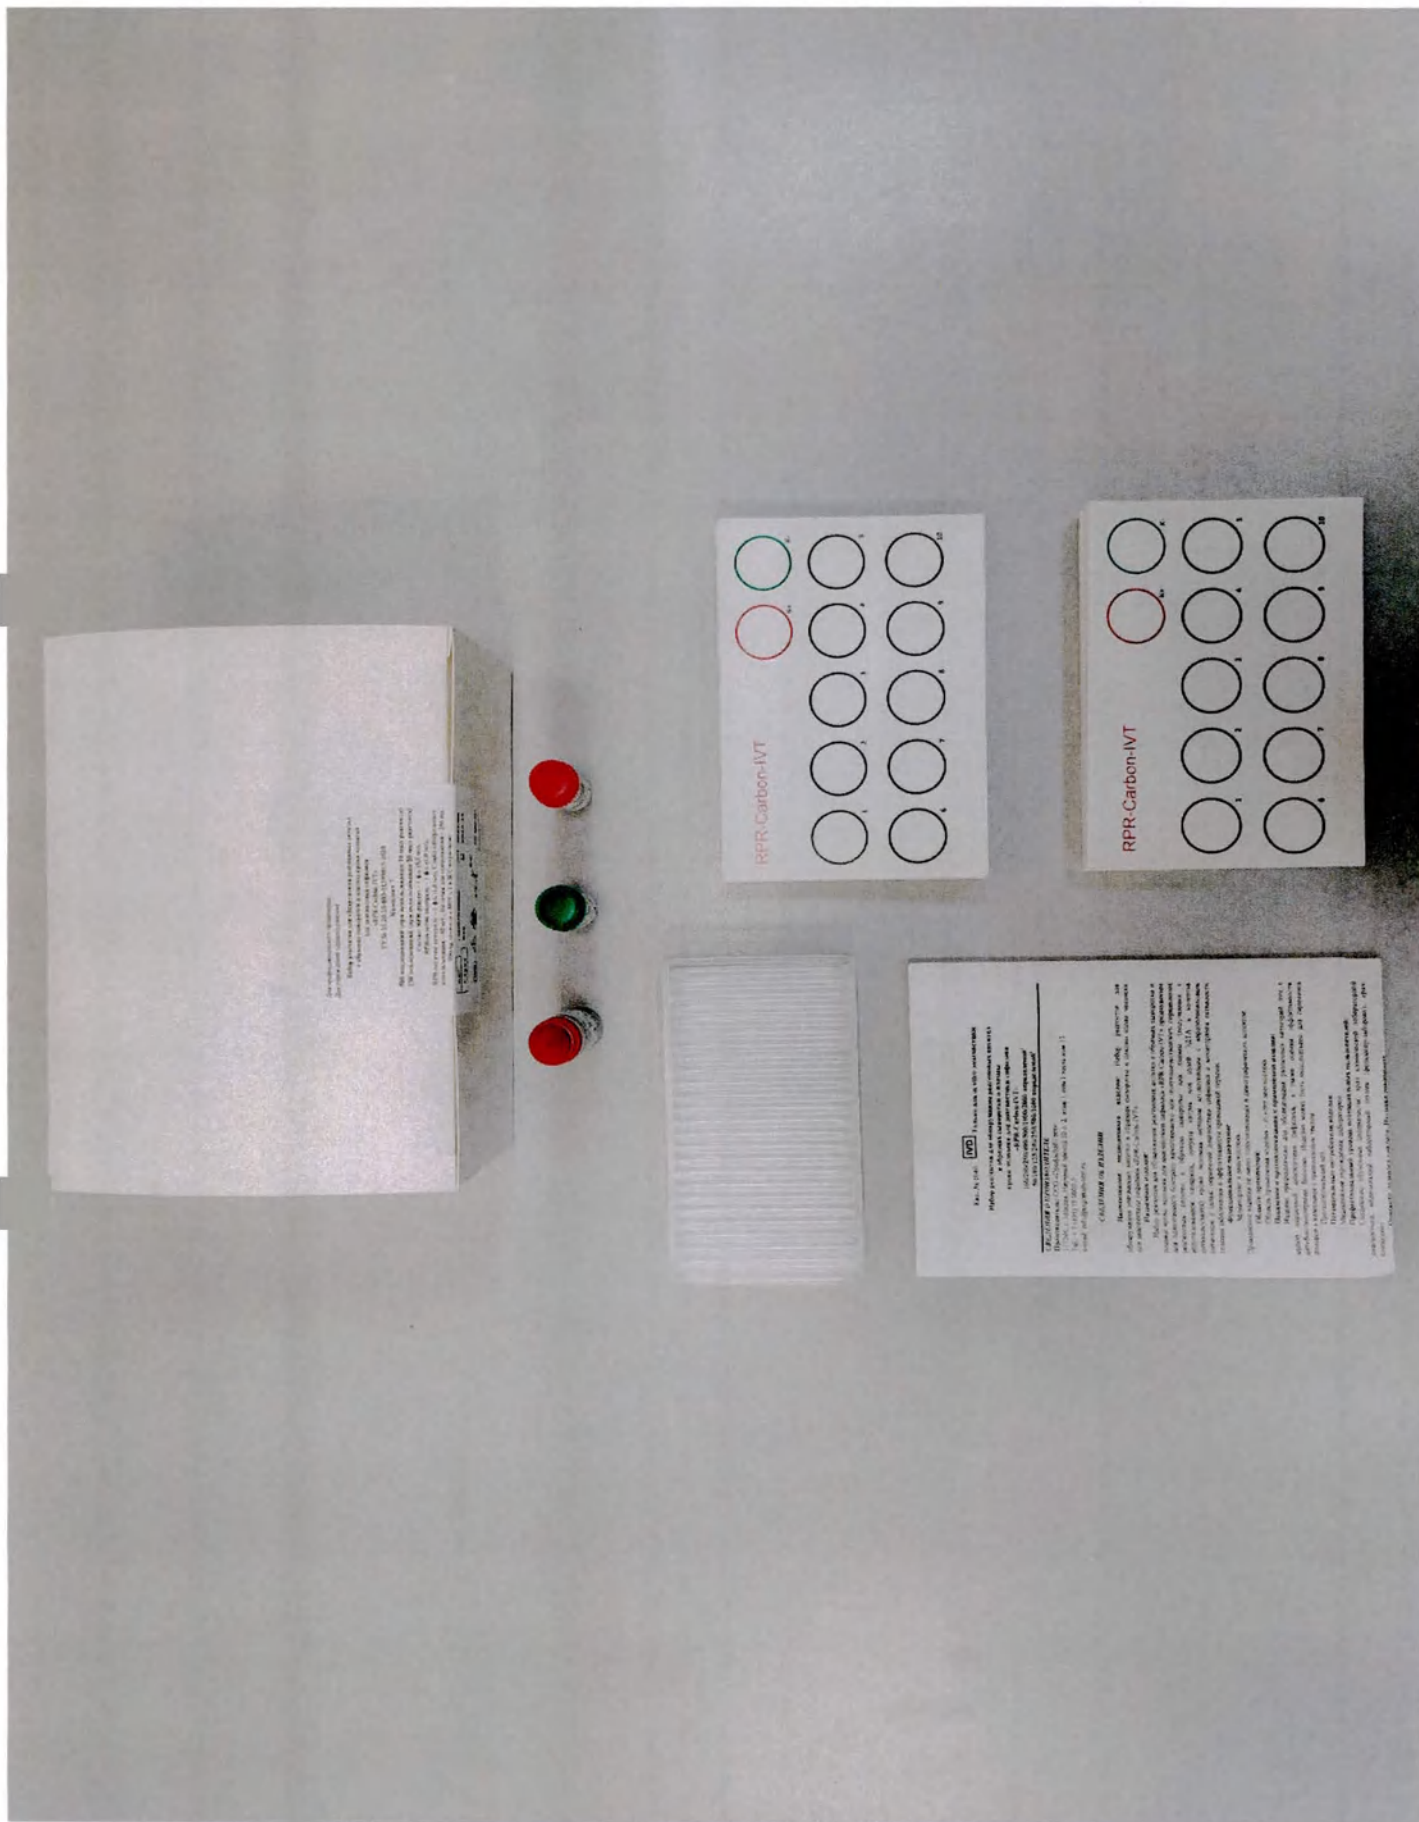



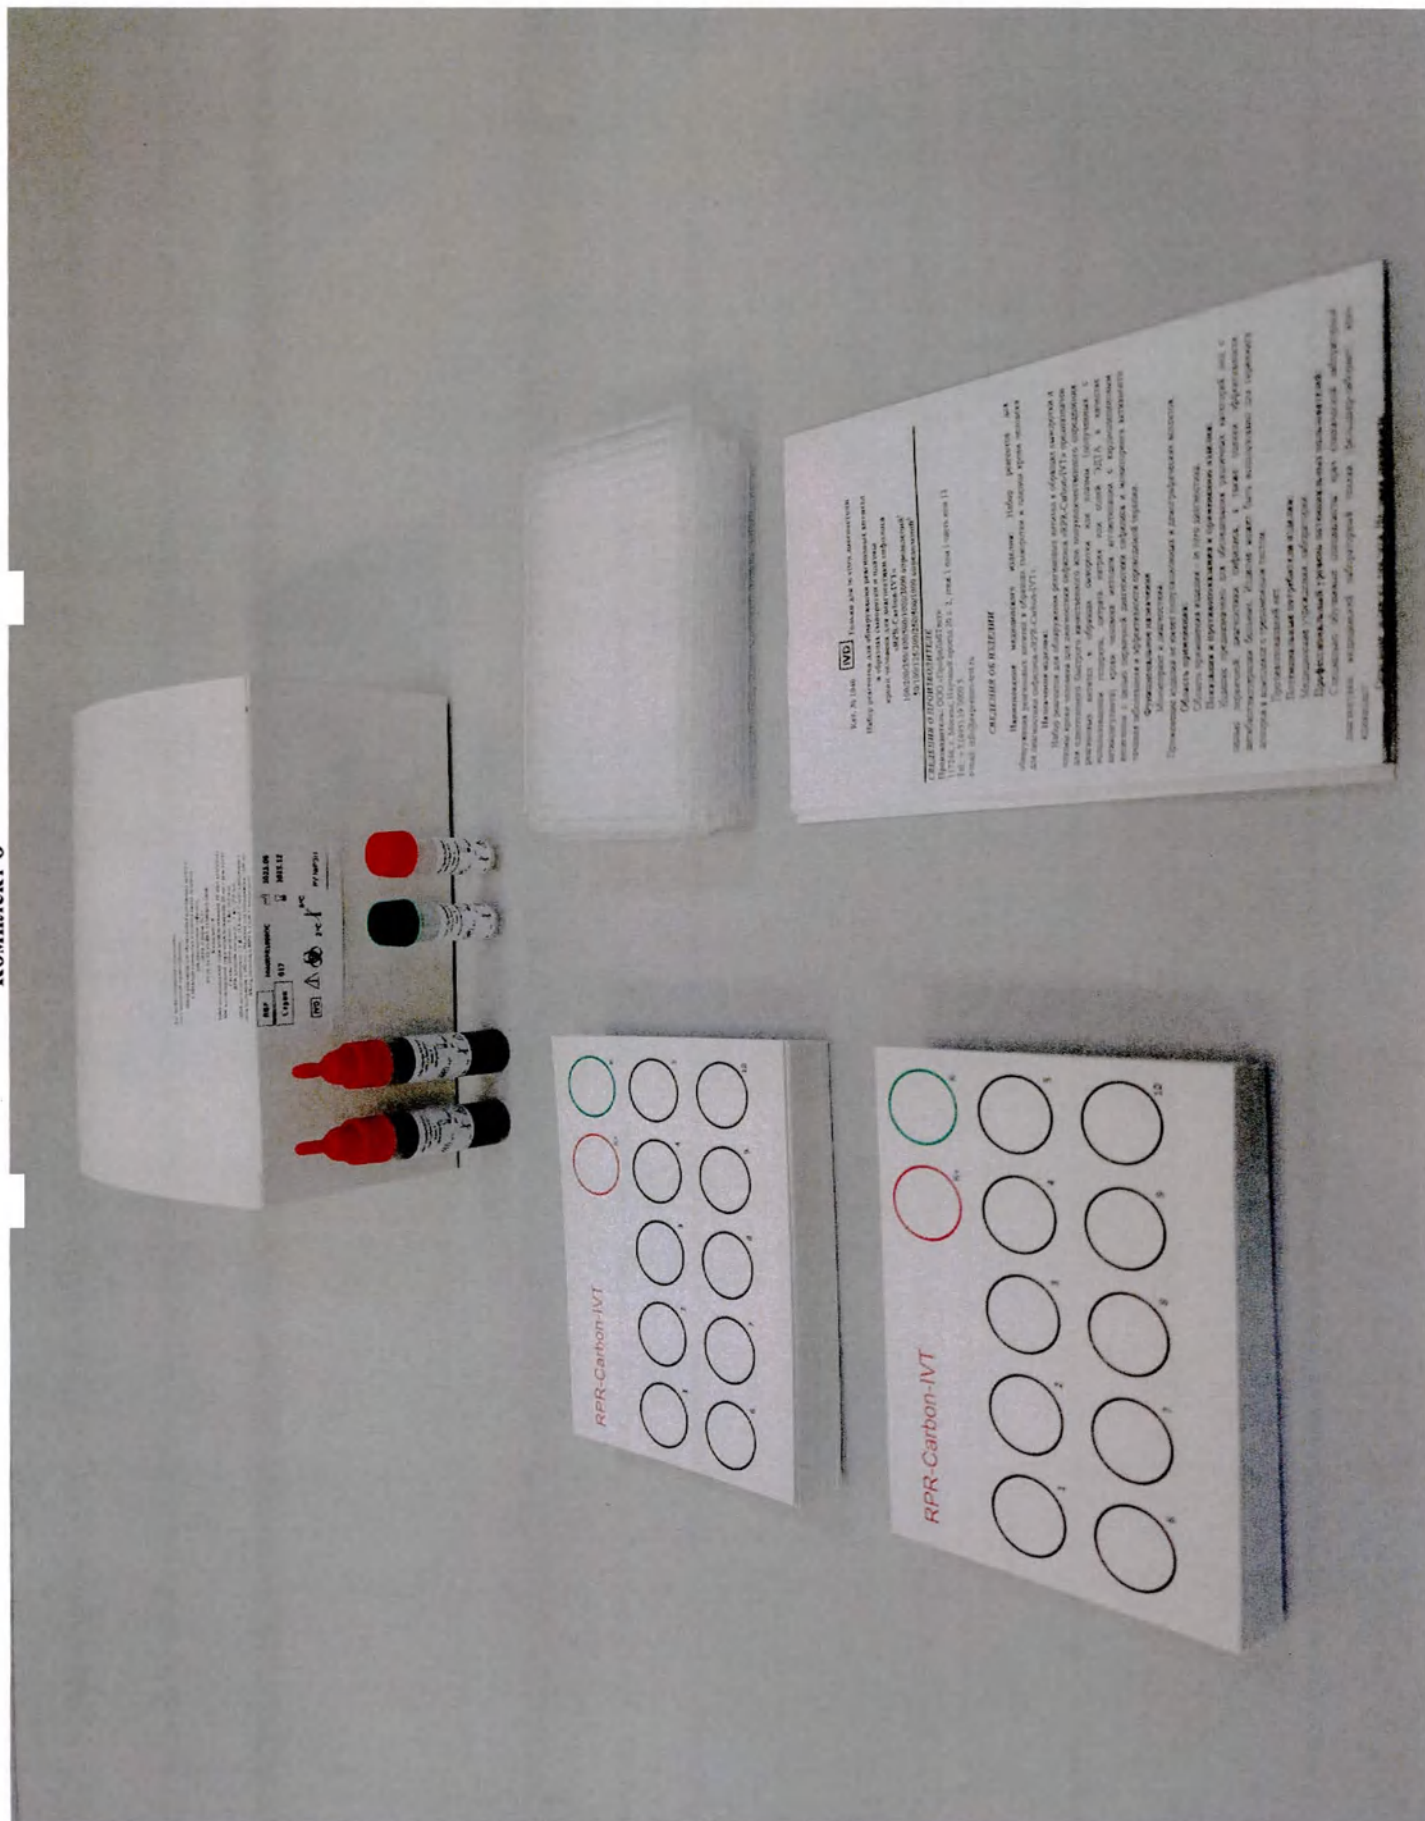


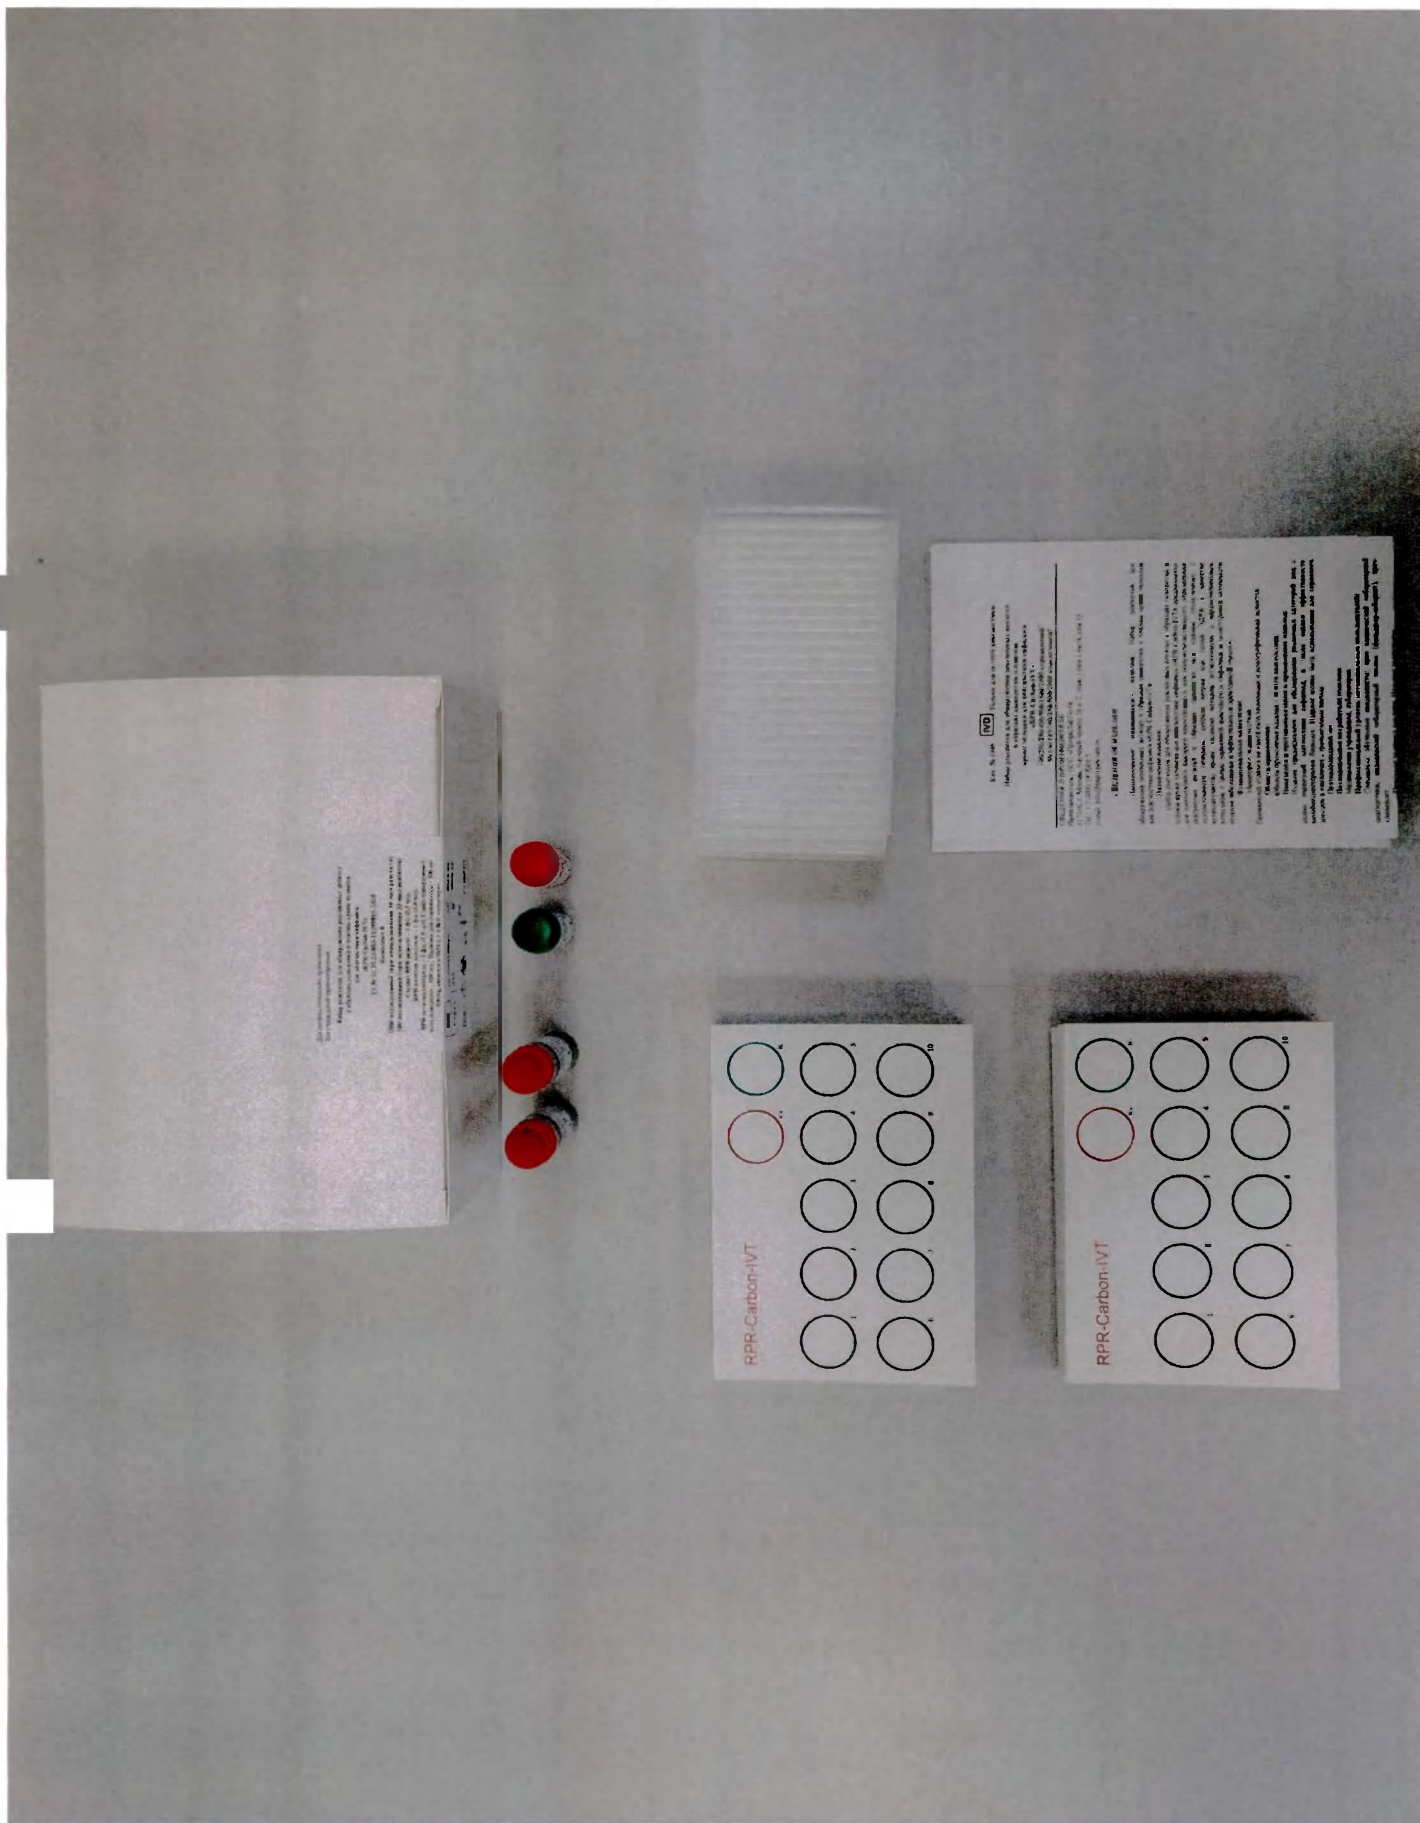


Комплект 9

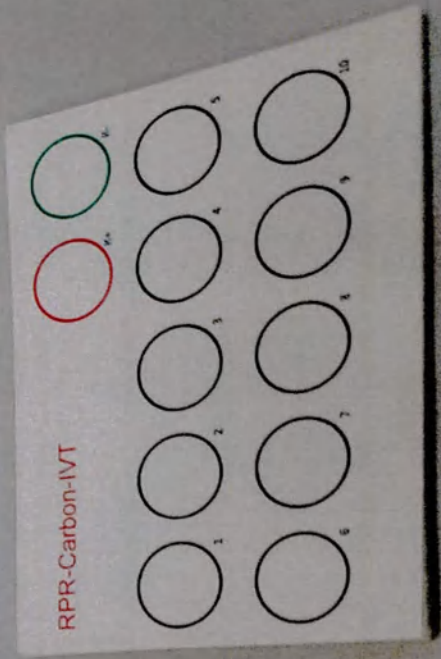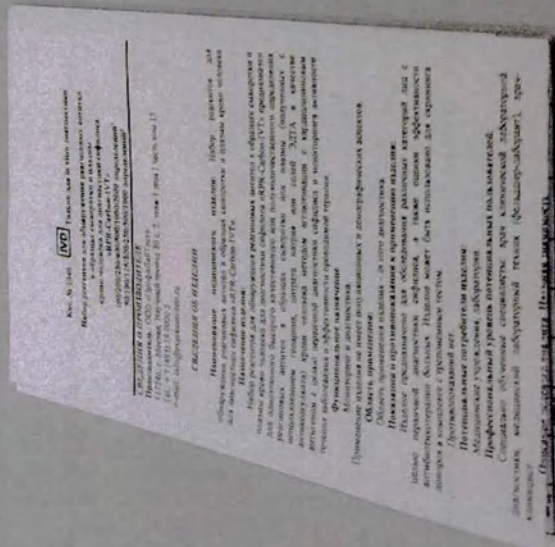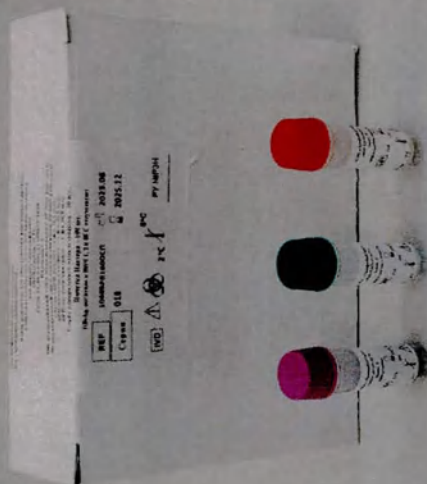




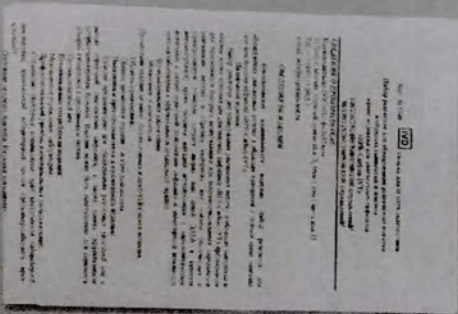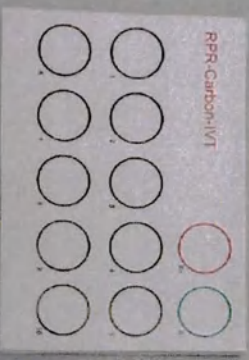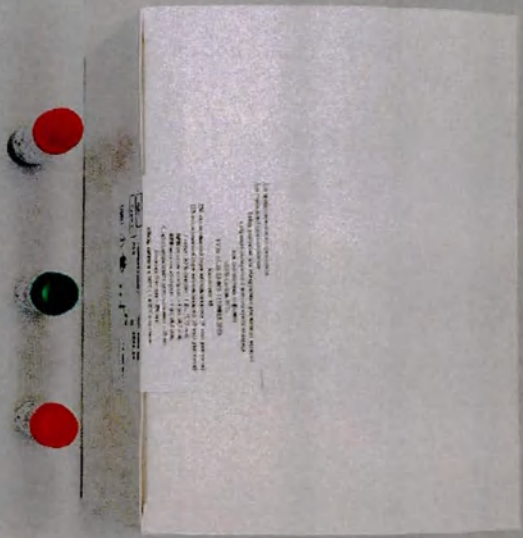



Комплект 11

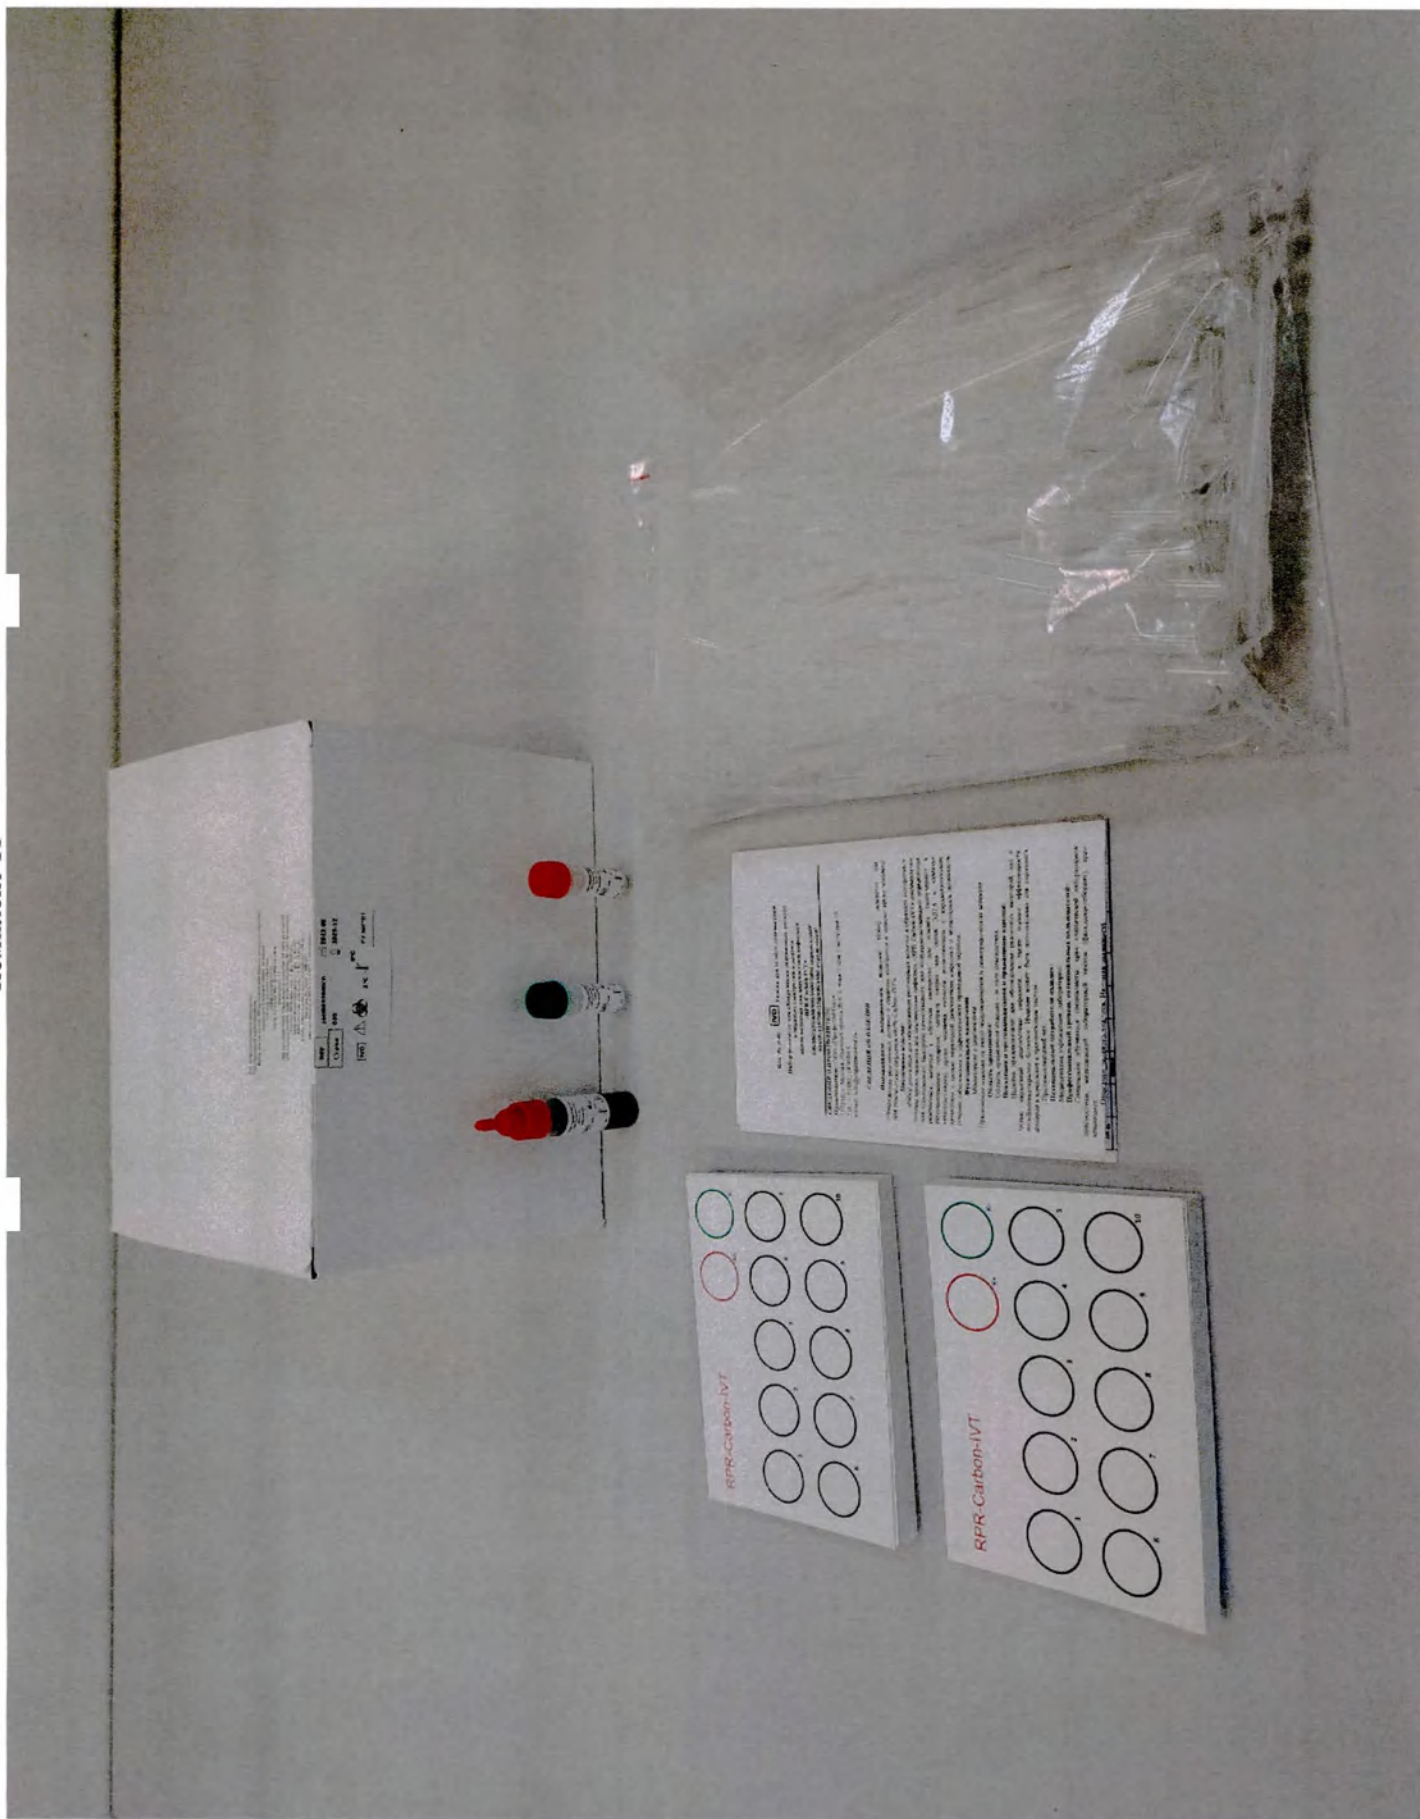


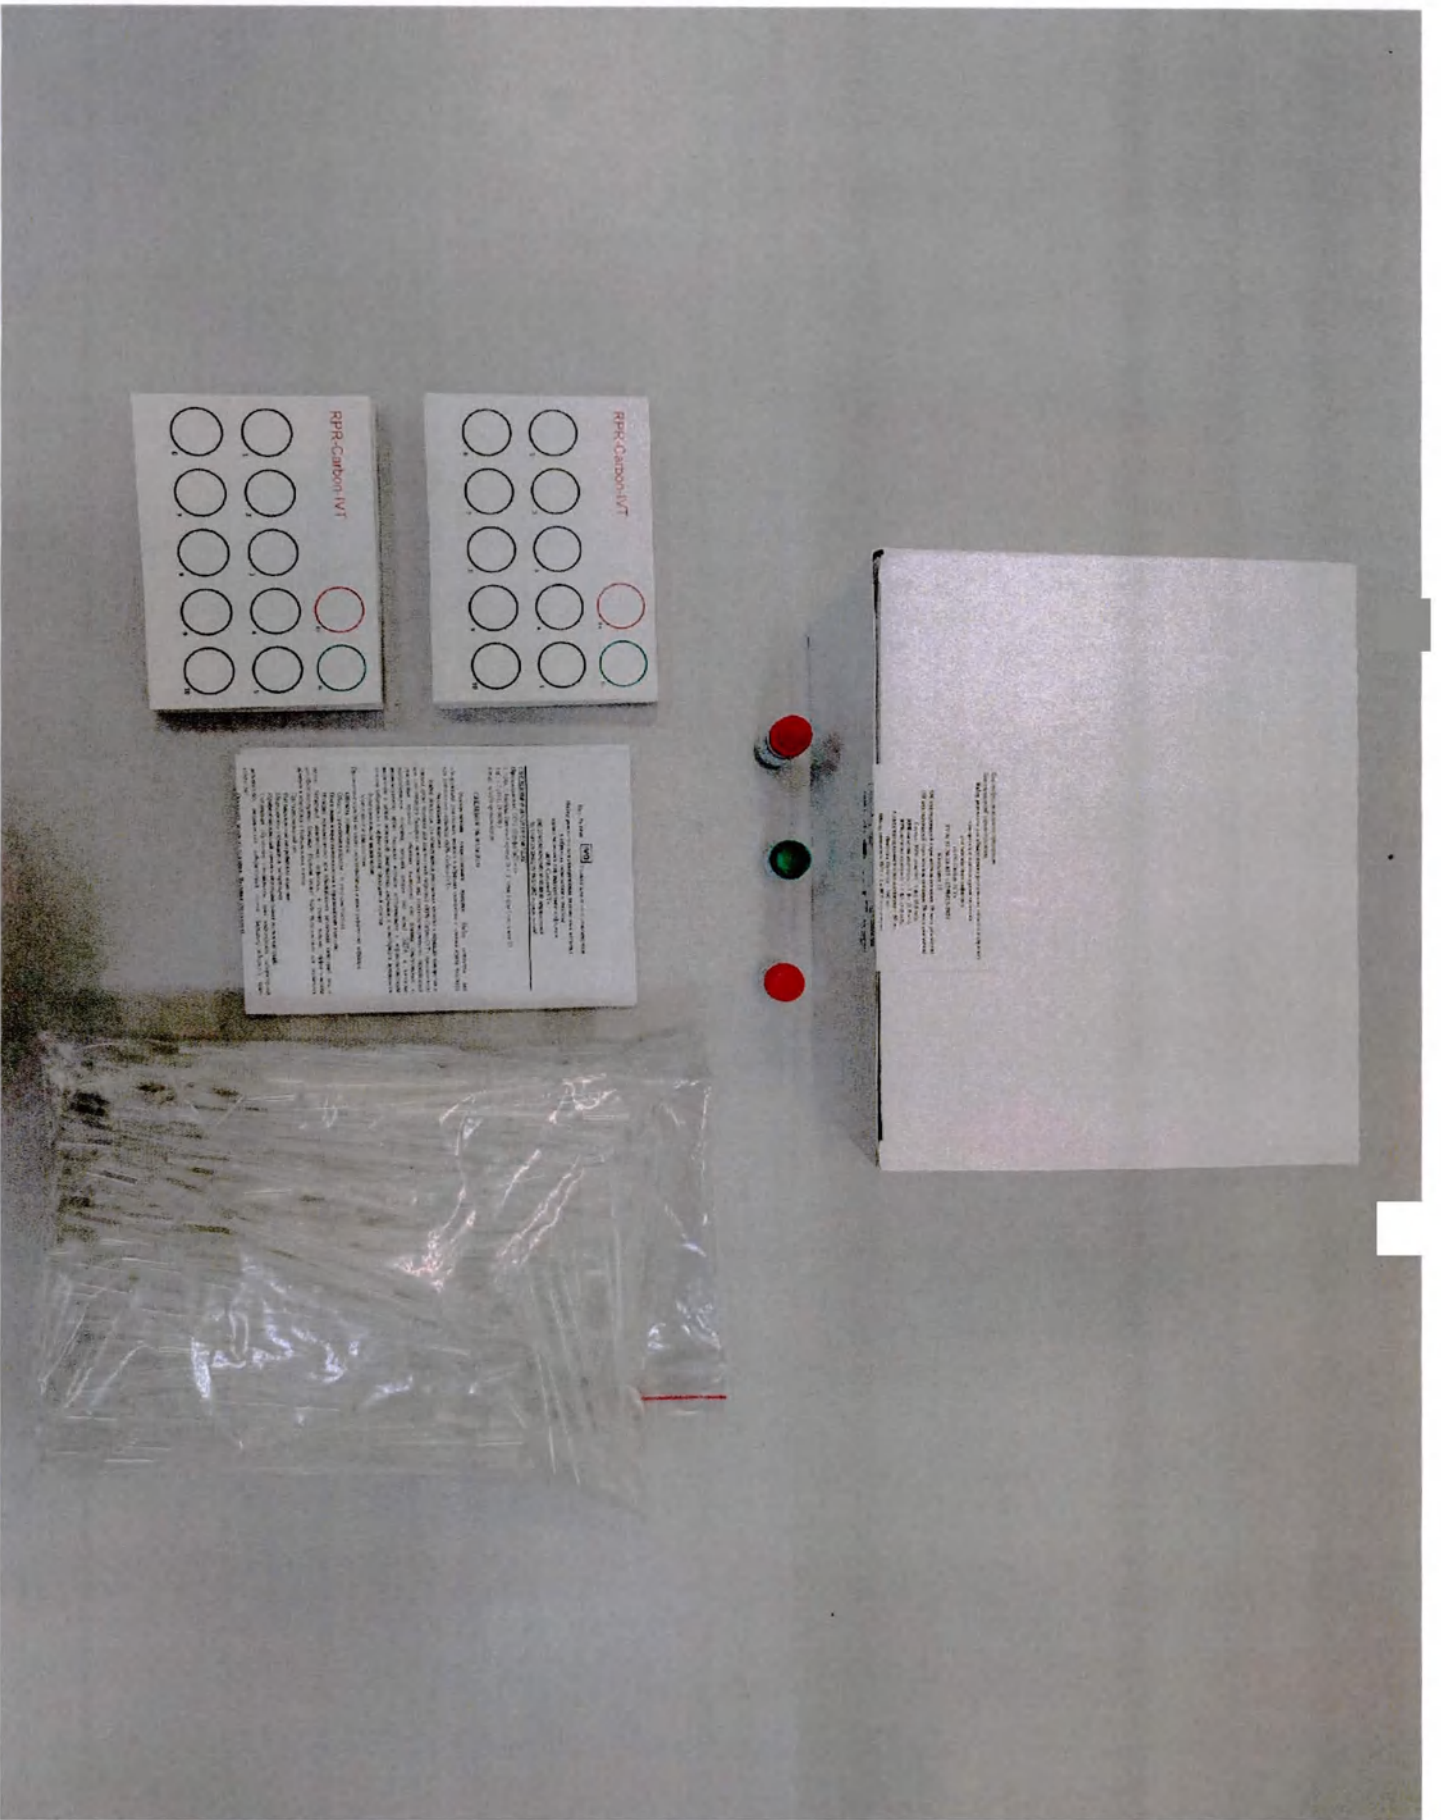

Комплект 12

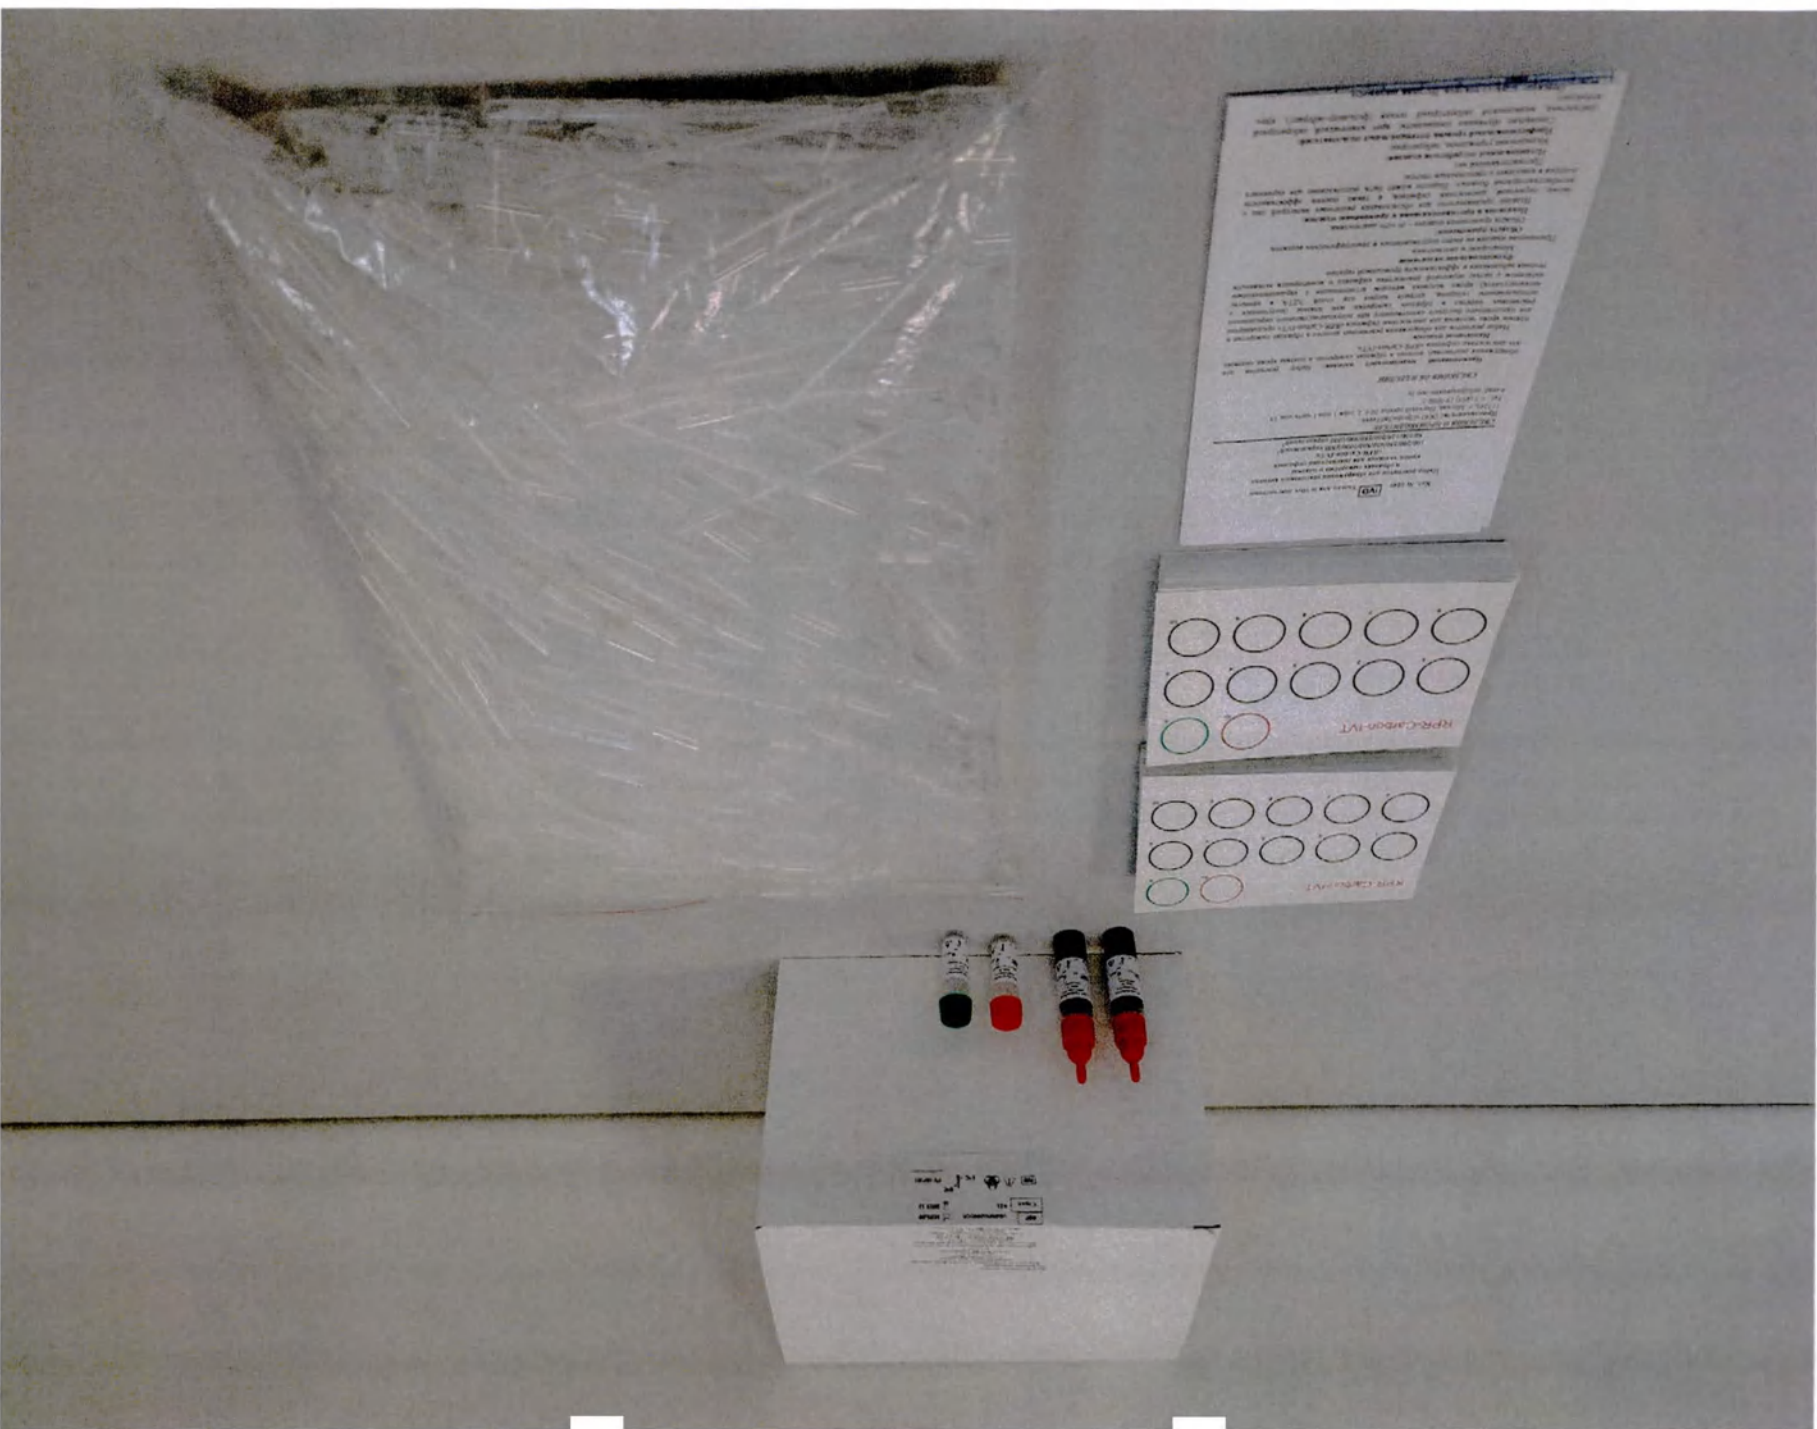

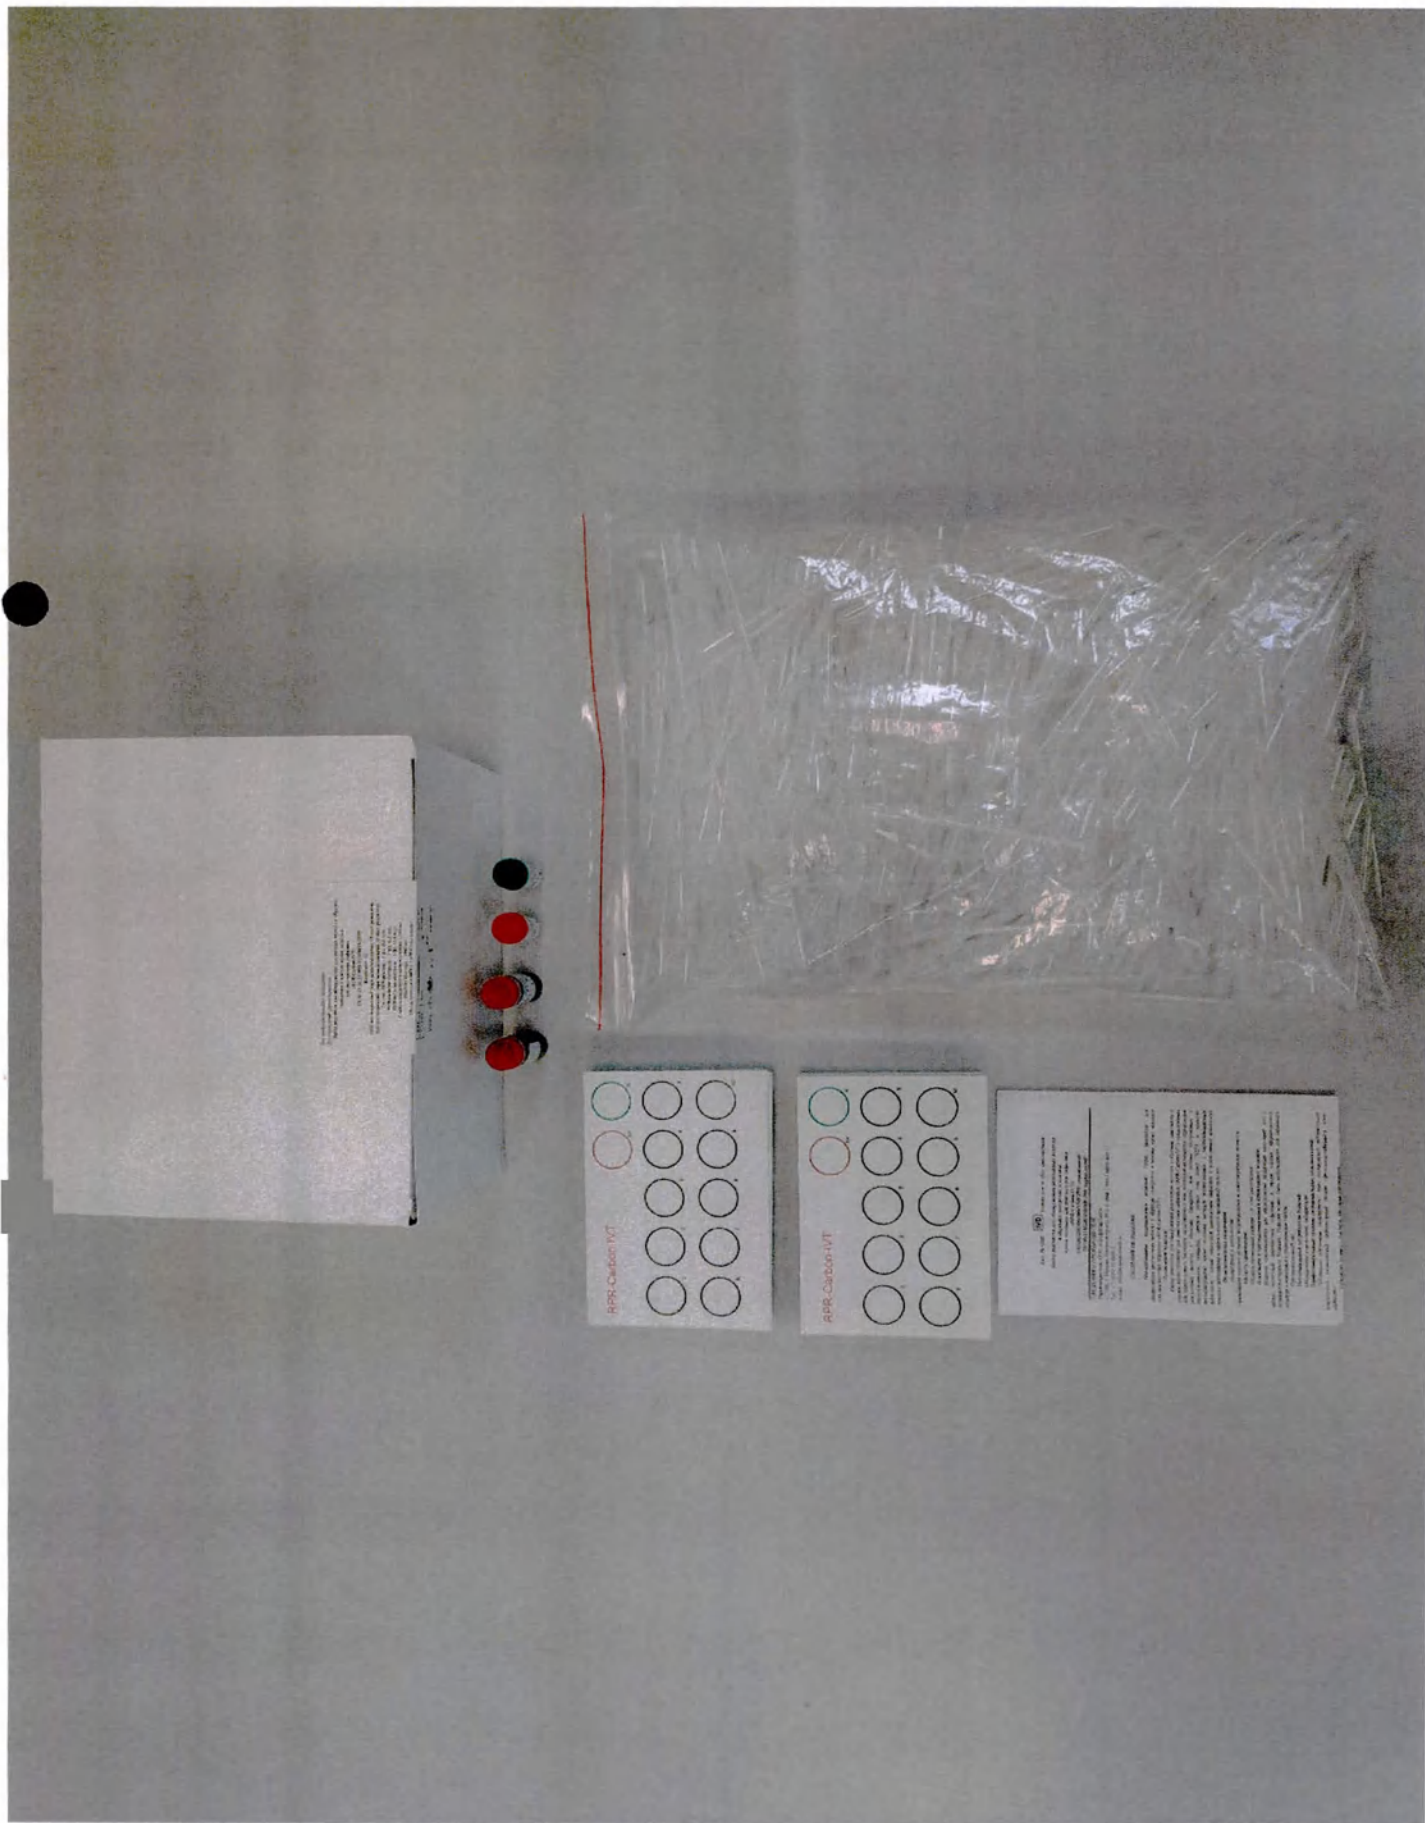

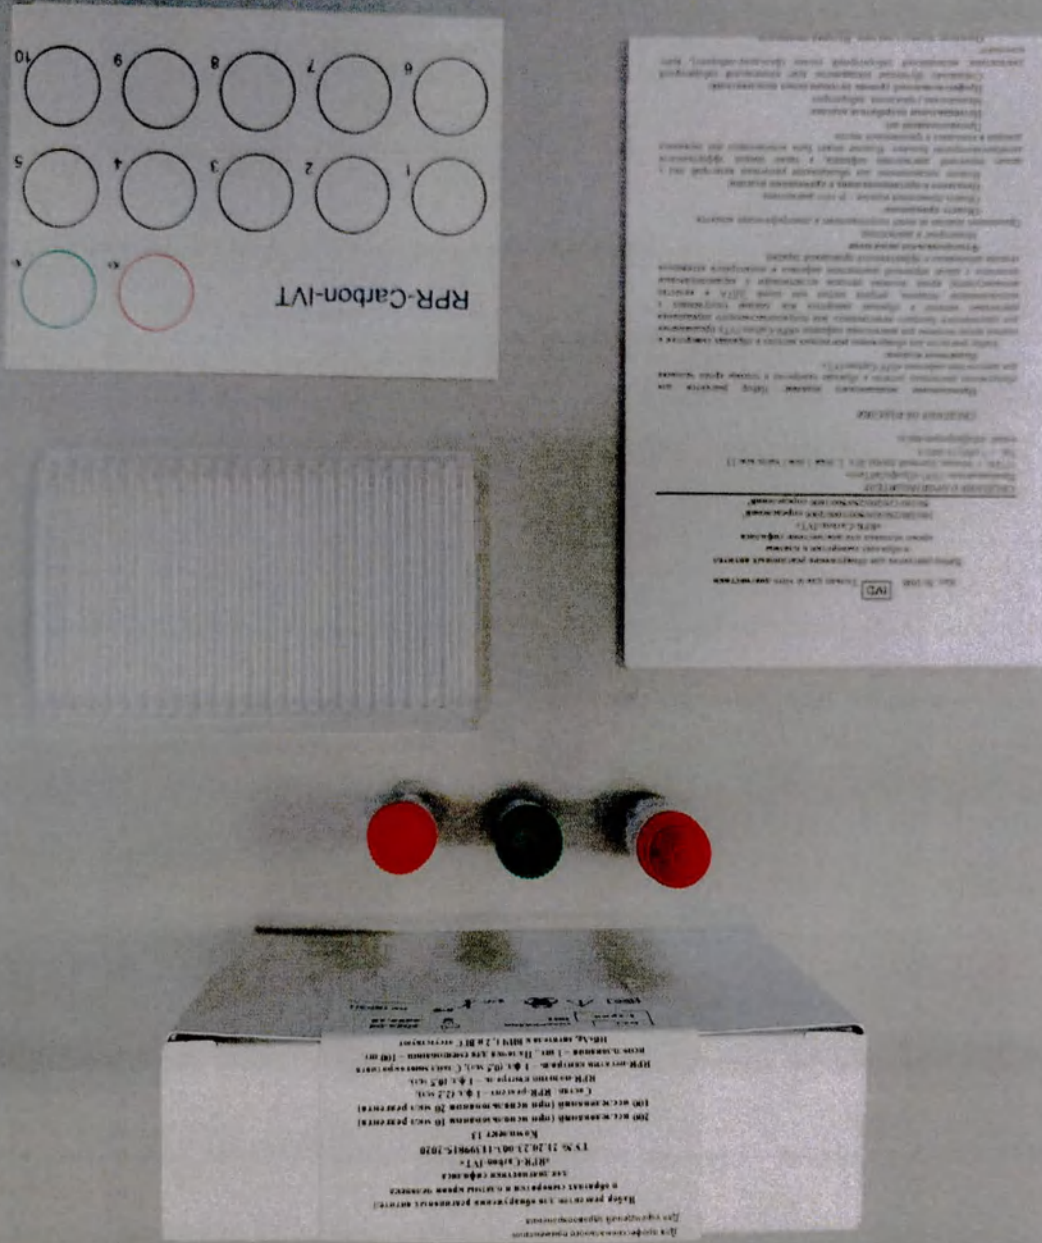

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ: 1000 и более копий
1117246, г. Москва, Нарынский проезд 20 д. 7, этаж 1, пом. 1 часть, комн. 13
Тел. + 7 (495) 14 9006-3
E-mail: info@svyazme.ru

Наименование предприятия: Наблюдательная компания "Самарская энергетическая компания"

Наибольшие трудности при обработке данных радиотехнических аппаратов с образцами металлов и сплавов возникают при измерении их температуры. В этом случае приходится применять специальные методы измерения температуры. ВРП, Спектр-УФ и другие методы измерения температуры в металлах и сплавах не позволяют измерять температуру в металлах и сплавах, находящихся в состоянии перегрева. ВРП, Спектр-УФ и другие методы измерения температуры в металлах и сплавах не позволяют измерять температуру в металлах и сплавах, находящихся в состоянии перегрева.



© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

[illegible]

Chlorine was not used in this study. The chlorinated compounds

RPR-Carbon-IVT

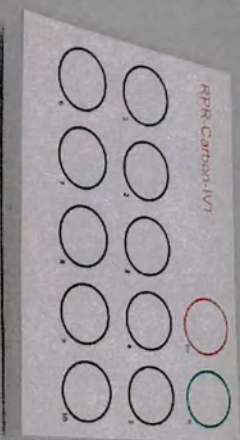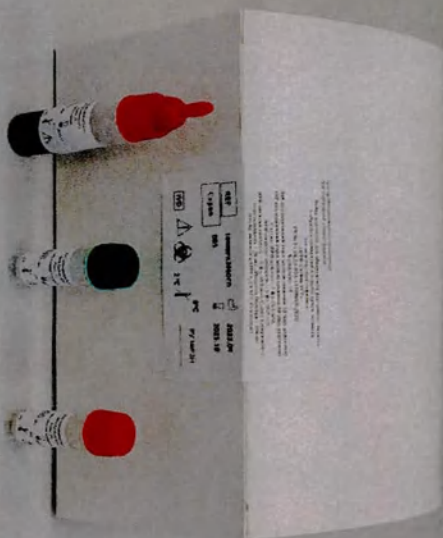

Внимание! Данный комплект предназначен для использования в качестве эталона при калибровке измерительных приборов, работающих в диапазоне 100-1200 нм. Для обеспечения точности измерений необходимо использовать данный комплект в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Комплект включает в себя:

- 3 флакона с растворами (красный, черный, синий)
- 12 круглых образцов для калибровки

Инструкция по эксплуатации:

- Проверить срок годности комплекта.
- Проверить целостность упаковки.
- Использовать комплект для калибровки измерительных приборов.
- Зафиксировать результаты калибровки.

Срок годности: 12 месяцев.


Производитель: ООО «ЦПММ».

Адрес: 125080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 2, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 125-12-12.

Электронная почта: info@cpmm.ru



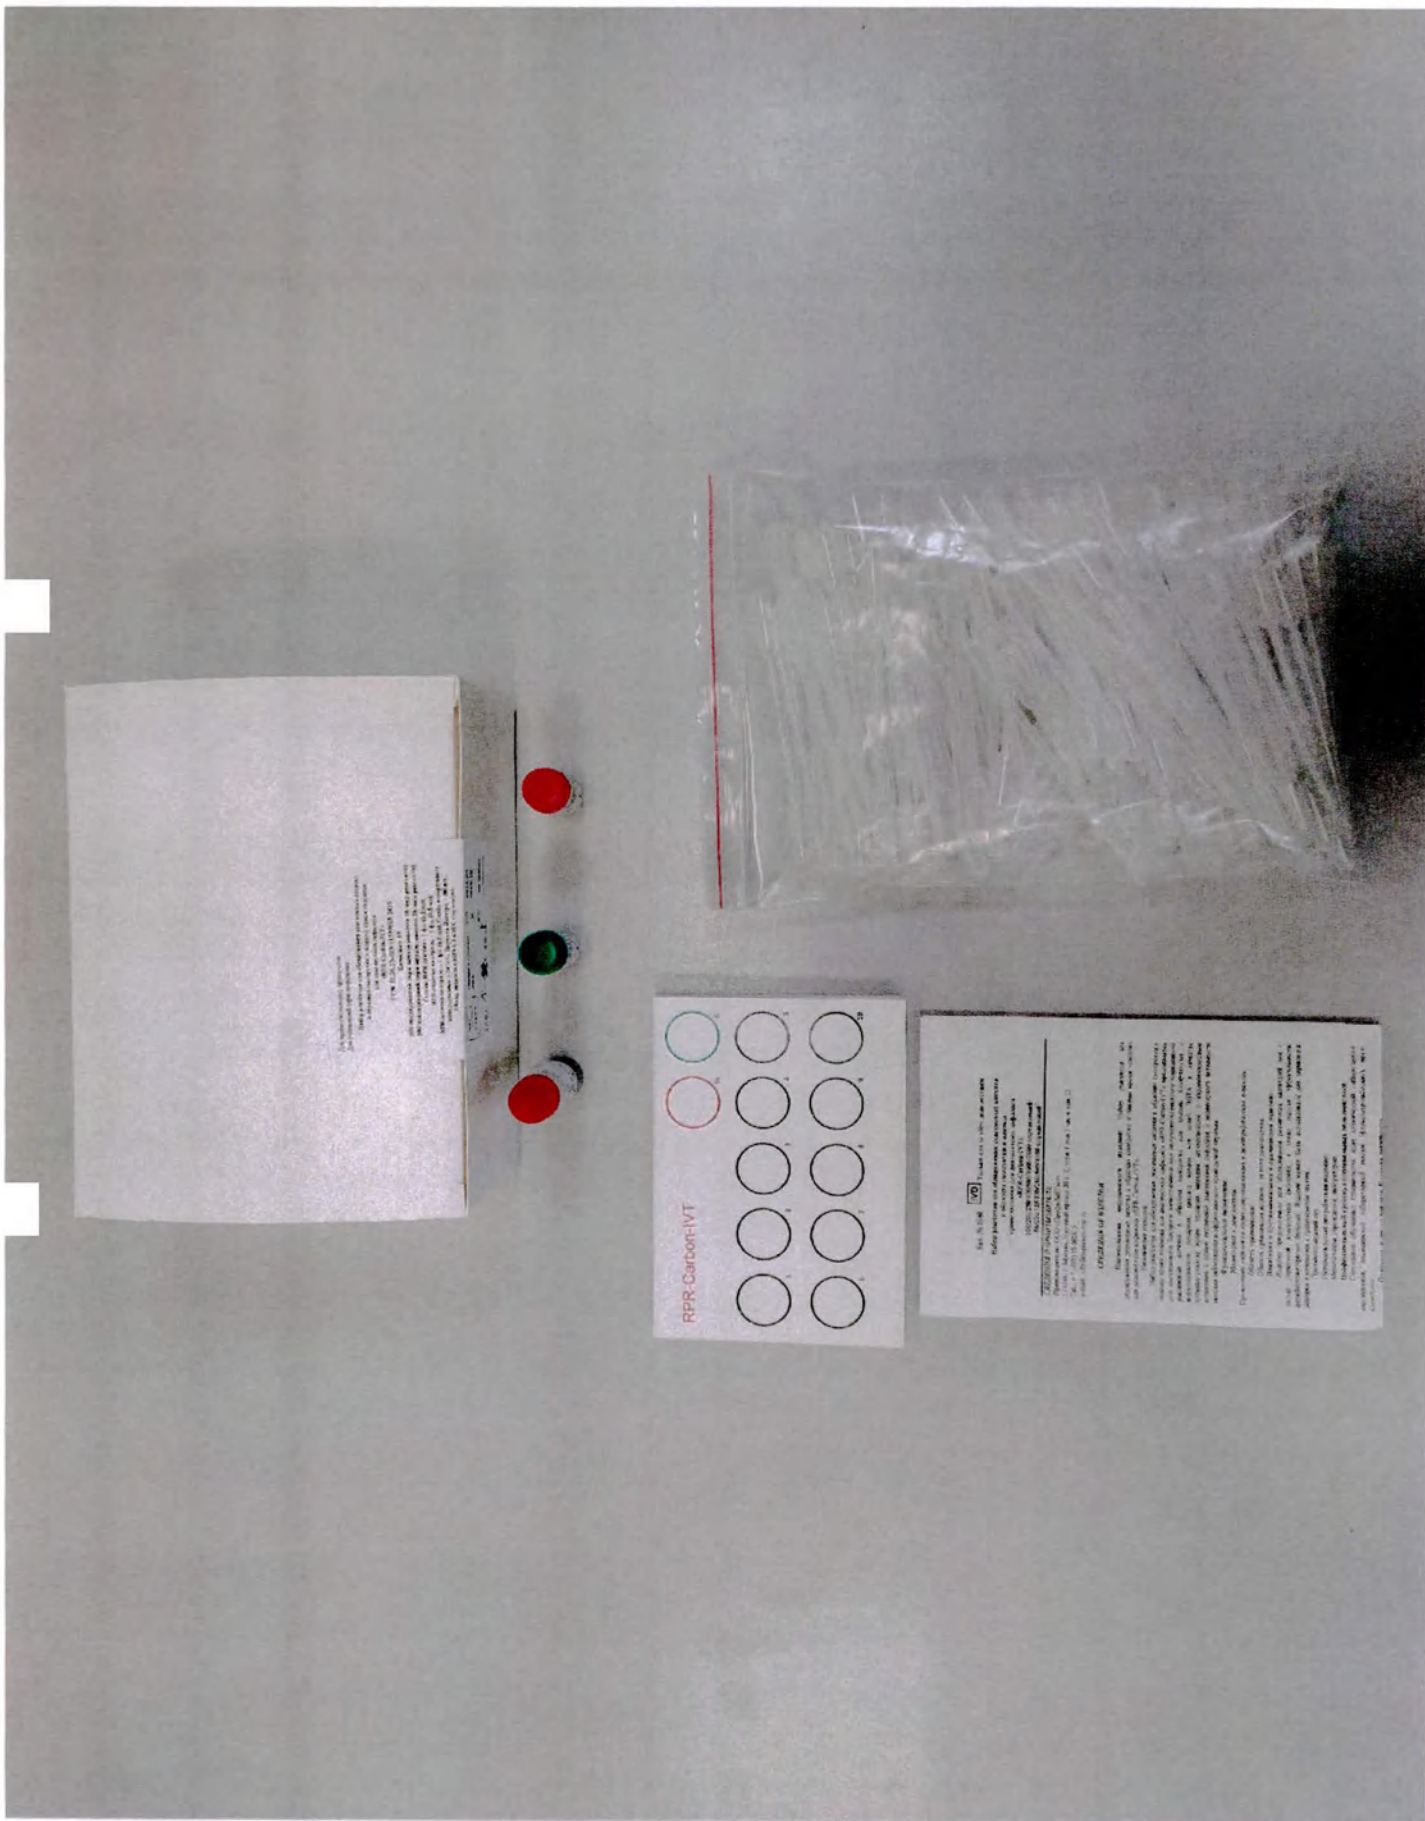

№ 10 (100) 17-й год. За 10 лет существования
изданию присвоен статус официального
справочника по истории культуры
и искусства в СССР.
№ 10 (100) 17-й год. За 10 лет существования
изданию присвоен статус официального
справочника по истории культуры
и искусства в СССР.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ИСКУССТВ»
125080, Москва, Греческий рынок, 20, к. 1, 1-й этаж, тел. 3-12-11
Фон. 3-12-11, 3-12-12, 3-12-13, 3-12-14, 3-12-15, 3-12-16, 3-12-17, 3-12-18, 3-12-19, 3-12-20, 3-12-21, 3-12-22, 3-12-23, 3-12-24, 3-12-25, 3-12-26, 3-12-27, 3-12-28, 3-12-29, 3-12-30, 3-12-31, 3-12-32, 3-12-33, 3-12-34, 3-12-35, 3-12-36, 3-12-37, 3-12-38, 3-12-39, 3-12-40, 3-12-41, 3-12-42, 3-12-43, 3-12-44, 3-12-45, 3-12-46, 3-12-47, 3-12-48, 3-12-49, 3-12-50, 3-12-51, 3-12-52, 3-12-53, 3-12-54, 3-12-55, 3-12-56, 3-12-57, 3-12-58, 3-12-59, 3-12-60, 3-12-61, 3-12-62, 3-12-63, 3-12-64, 3-12-65, 3-12-66, 3-12-67, 3-12-68, 3-12-69, 3-12-70, 3-12-71, 3-12-72, 3-12-73, 3-12-74, 3-12-75, 3-12-76, 3-12-77, 3-12-78, 3-12-79, 3-12-80, 3-12-81, 3-12-82, 3-12-83, 3-12-84, 3-12-85, 3-12-86, 3-12-87, 3-12-88, 3-12-89, 3-12-90, 3-12-91, 3-12-92, 3-12-93, 3-12-94, 3-12-95, 3-12-96, 3-12-97, 3-12-98, 3-12-99, 3-12-100, 3-12-101, 3-12-102, 3-12-103, 3-12-104, 3-12-105, 3-12-106, 3-12-107, 3-12-108, 3-12-109, 3-12-110, 3-12-111, 3-12-112, 3-12-113, 3-12-114, 3-12-115, 3-12-116, 3-12-117, 3-12-118, 3-12-119, 3-12-120, 3-12-121, 3-12-122, 3-12-123, 3-12-124, 3-12-125, 3-12-126, 3-12-127, 3-12-128, 3-12-129, 3-12-130, 3-12-131, 3-12-132, 3-12-133, 3-12-134, 3-12-135, 3-12-136, 3-12-137, 3-12-138, 3-12-139, 3-12-140, 3-12-141, 3-12-142, 3-12-143, 3-12-144, 3-12-145, 3-12-146, 3-12-147, 3-12-148, 3-12-149, 3-12-150, 3-12-151, 3-12-152, 3-12-153, 3-12-154, 3-12-155, 3-12-156, 3-12-157, 3-12-158, 3-12-159, 3-12-160, 3-12-161, 3-12-162, 3-12-163, 3-12-164, 3-12-165, 3-12-166, 3-12-167, 3-12-168, 3-12-169, 3-12-170, 3-12-171, 3-12-172, 3-12-173, 3-12-174, 3-12-175, 3-12-176, 3-12-177, 3-12-178, 3-12-179, 3-12-180, 3-12-181, 3-12-182, 3-12-183, 3-12-184, 3-12-185, 3-12-186, 3-12-187, 3-12-188, 3-12-189, 3-12-190, 3-12-191, 3-12-192, 3-12-193, 3-12-194, 3-12-195, 3-12-196, 3-12-197, 3-12-198, 3-12-199, 3-12-200, 3-12-201, 3-12-202, 3-12-203, 3-12-204, 3-12-205, 3-12-206, 3-12-207, 3-12-208, 3-12-209, 3-12-210, 3-12-211, 3-12-212, 3-12-213, 3-12-214, 3-12-215, 3-12-216, 3-12-217, 3-12-218, 3-12-219, 3-12-220, 3-12-221, 3-12-222, 3-12-223, 3-12-224, 3-12-225, 3-12-226, 3-12-227, 3-12-228, 3-12-229, 3-12-230, 3-12-231, 3-12-232, 3-12-233, 3-12-234, 3-12-235, 3-12-236, 3-12-237, 3-12-238, 3-12-239, 3-12-240, 3-12-241, 3-12-242, 3-12-243, 3-12-244, 3-12-245, 3-12-246, 3-12-247, 3-12-248, 3-12-249, 3-12-250, 3-12-251, 3-12-252, 3-12-253, 3-12-254, 3-12-255, 3-12-256, 3-12-257, 3-12-258, 3-12-259, 3-12-260, 3-12-261, 3-12-262, 3-12-263, 3-12-264, 3-12-265, 3-12-266, 3-12-267, 3-12-268, 3-12-269, 3-12-270, 3-12-271, 3-12-272, 3-12-273, 3-12-274, 3-12-275, 3-12-276, 3-12-277, 3-12-278, 3-12-279, 3-12-280, 3-12-281, 3-12-282, 3-12-283, 3-12-284, 3-12-285, 3-12-286, 3-12-287, 3-12-288, 3-12-289, 3-12-290, 3-12-291, 3-12-292, 3-12-293, 3-12-294, 3-12-295, 3-12-296, 3-12-297, 3-12-298, 3-12-299, 3-12-300, 3-12-301, 3-12-302, 3-12-303, 3-12-304, 3-12-305, 3-12-306, 3-12-307, 3-12-308, 3-12-309, 3-12-310, 3-12-311, 3-12-312, 3-12-313, 3-12-314, 3-12-315, 3-12-316, 3-12-317, 3-12-318, 3-12-319, 3-12-320, 3-12-321, 3-12-322, 3-12-323, 3-12-324, 3-12-325, 3-12-326, 3-12-327, 3-12-328, 3-12-329, 3-12-330, 3-12-331, 3-12-332, 3-12-333, 3-12-334, 3-12-335, 3-12-336, 3-12-337, 3-12-338, 3-12-339, 3-12-340, 3-12-341, 3-12-342, 3-12-343, 3-12-344, 3-12-345, 3-12-346, 3-12-347, 3-12-348, 3-12-349, 3-12-350, 3-12-351, 3-12-352, 3-12-353, 3-12-354, 3-12-355, 3-12-356, 3-12-357, 3-12-358, 3-12-359, 3-12-360, 3-12-361, 3-12-362, 3-12-363, 3-12-364, 3-12-365, 3-12-366, 3-12-367, 3-12-368, 3-12-369, 3-12-370, 3-12-371, 3-12-372, 3-12-373, 3-12-374, 3-12-375, 3-12-376, 3-12-377, 3-12-378, 3-12-379, 3-12-380, 3-12-381, 3-12-382, 3-12-383, 3-12-384, 3-12-385, 3-12-386, 3-12-387, 3-12-388, 3-12-389, 3-12-390, 3-12-391, 3-12-392, 3-12-393, 3-12-394, 3-12-395, 3-12-396, 3-12-397, 3-12-398, 3-12-399, 3-12-400, 3-12-401, 3-12-402, 3-12-403, 3-12-404, 3-12-405, 3-12-406, 3-12-407, 3-12-408, 3-12-409, 3-12-410, 3-12-411, 3-12-4

RPR-Carbon-IVT

RPR-Carbon-IVT

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75




76 77 78 79 80



81 82 83 84 85


86 87 88 89 90





91 92 93 94 95





96 97 98 99 100

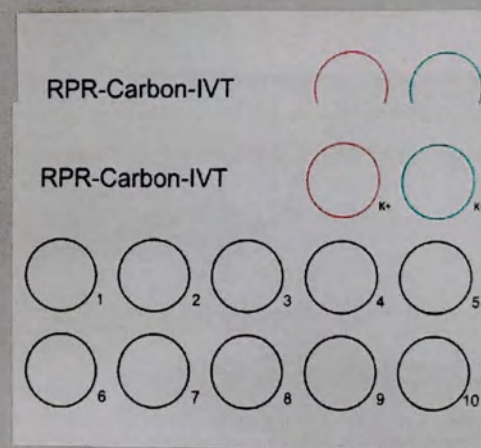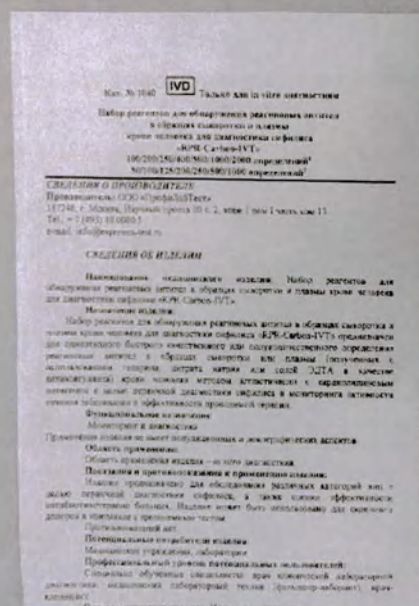
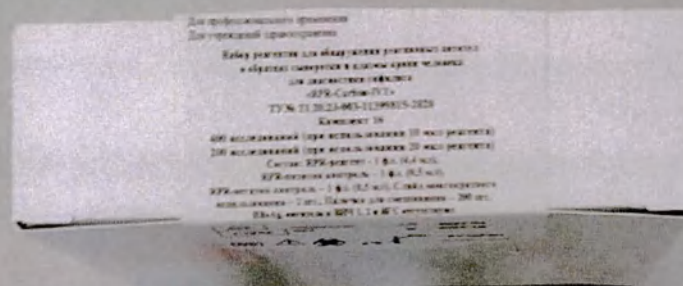




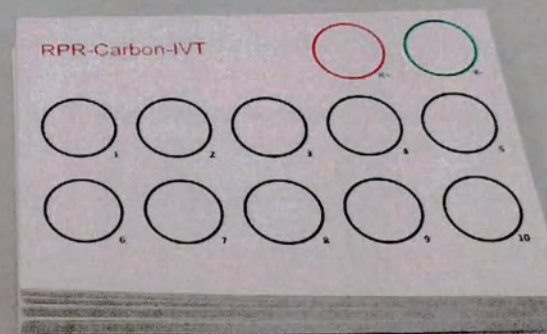
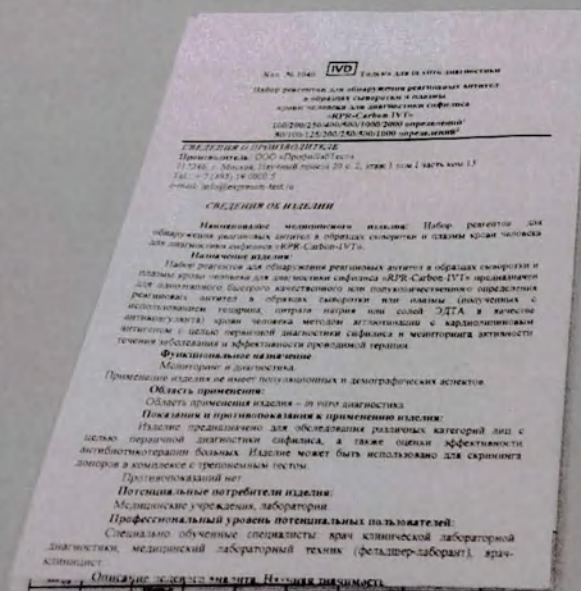


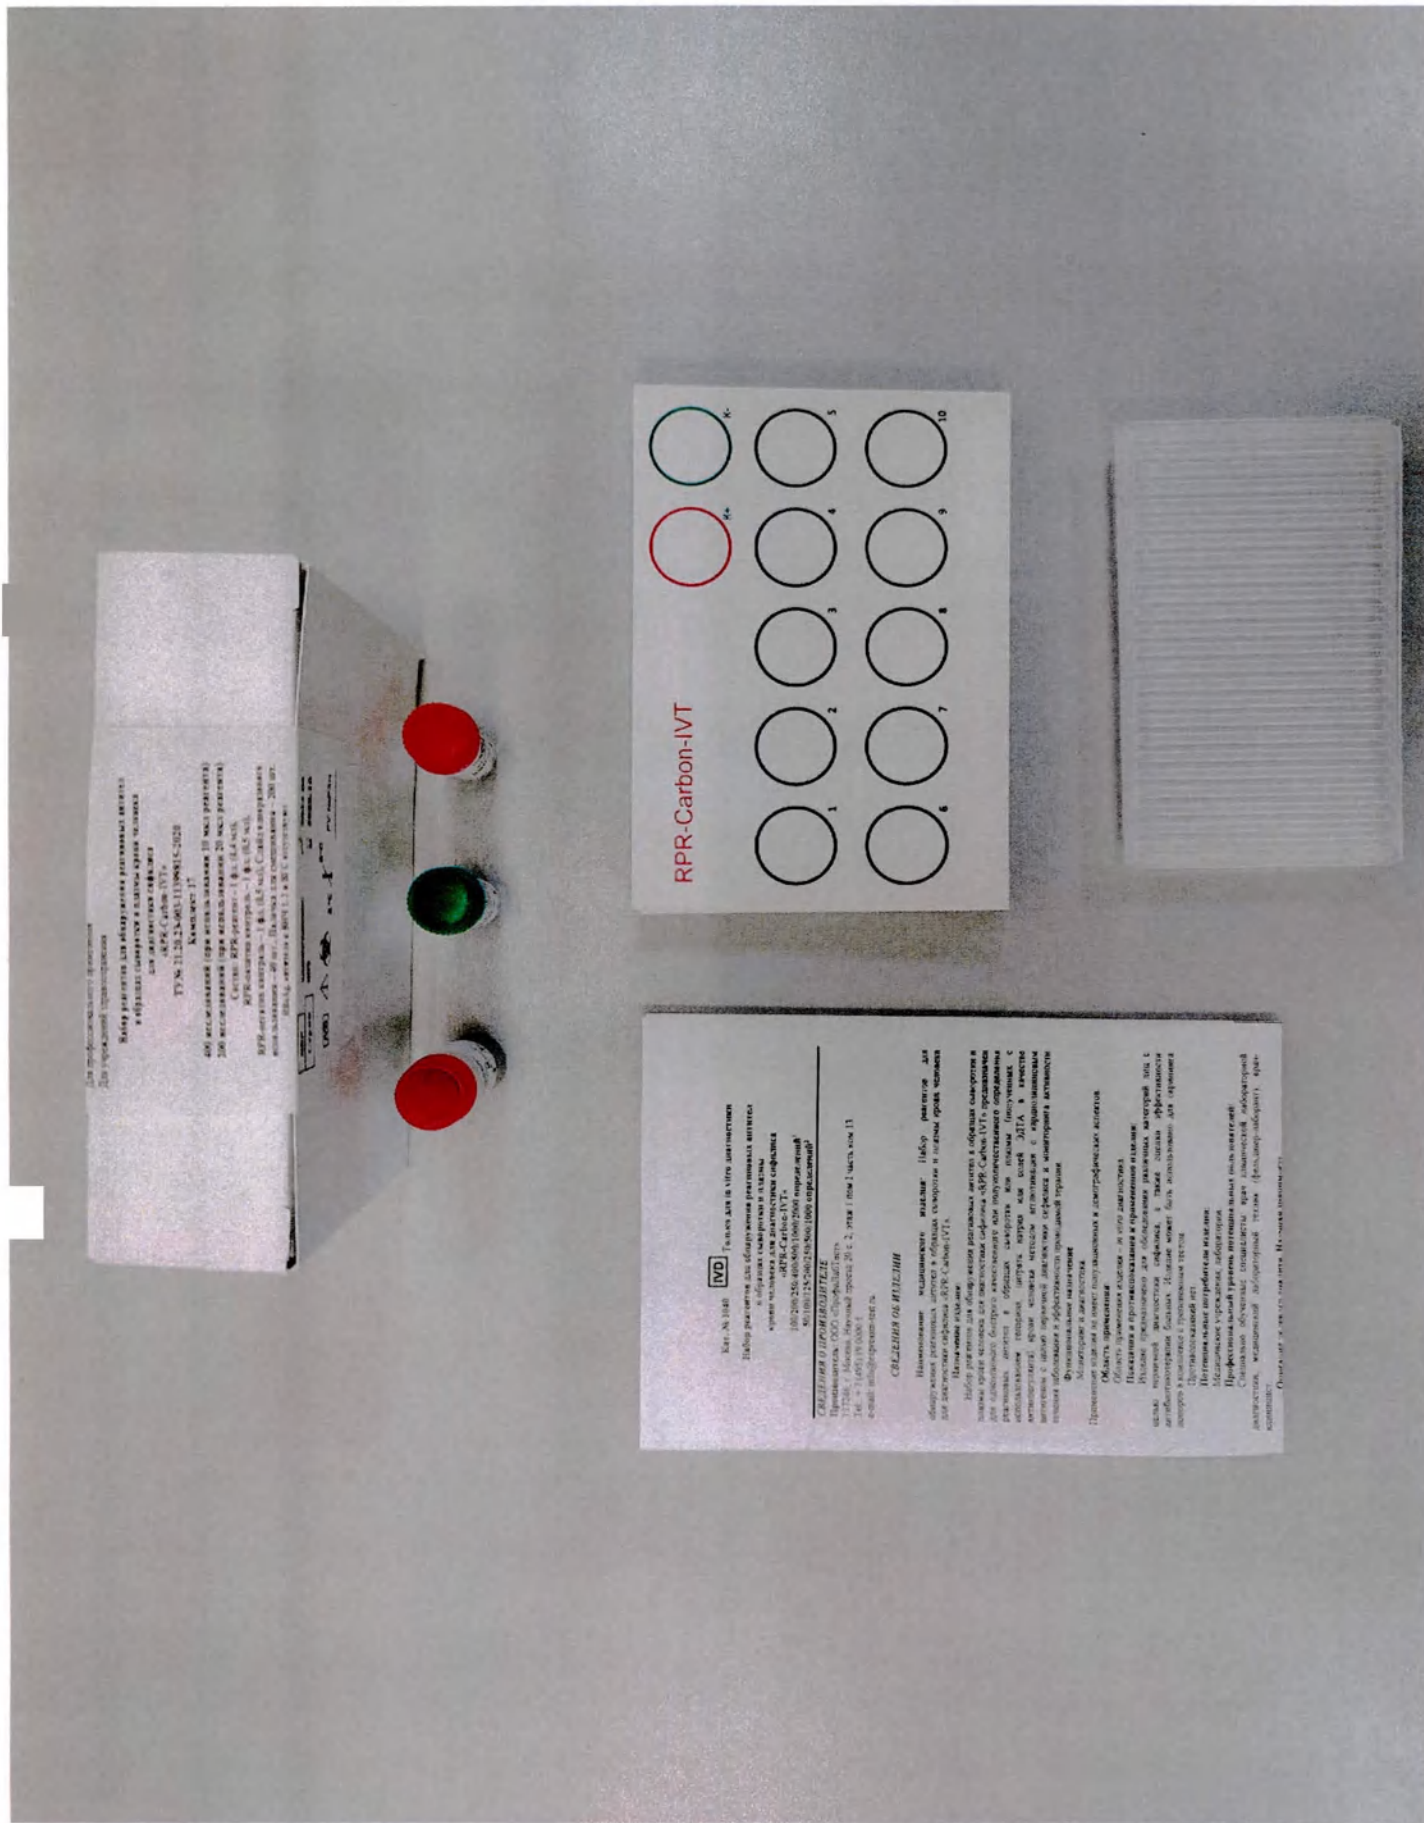

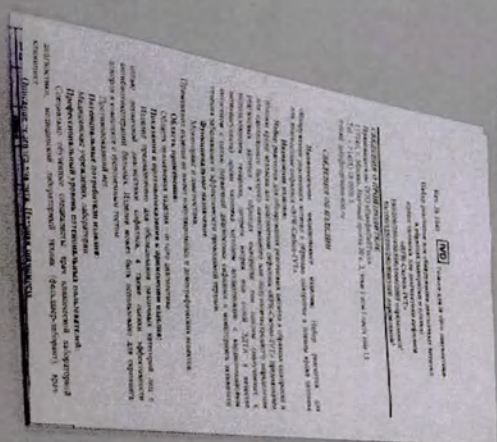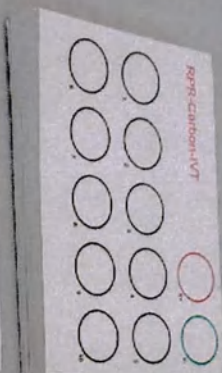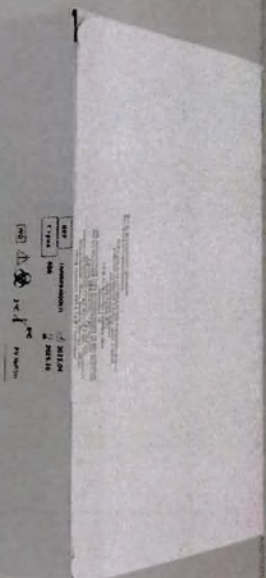

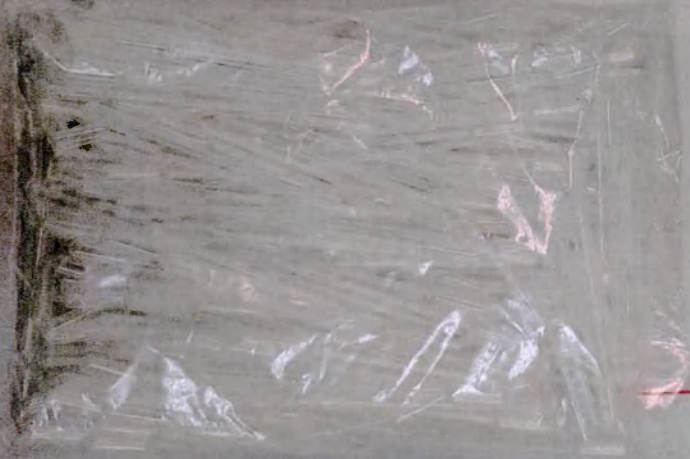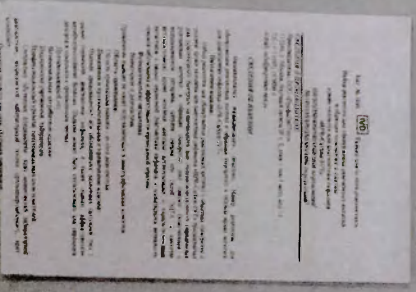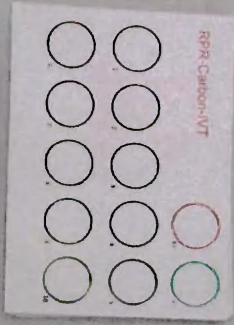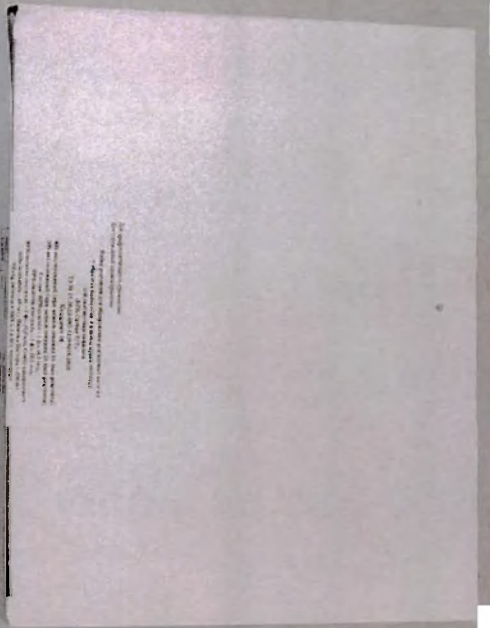


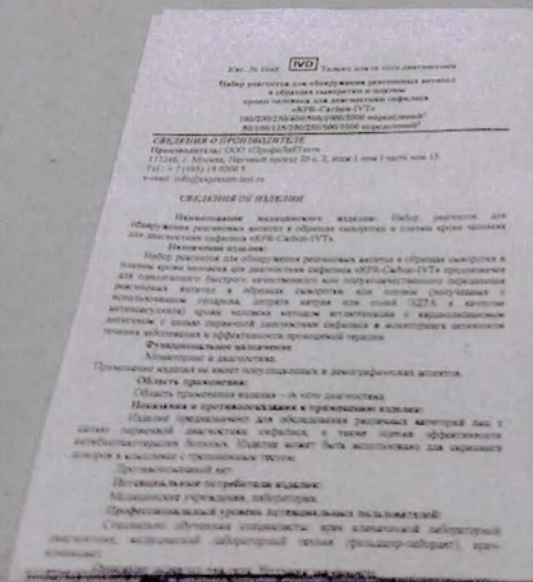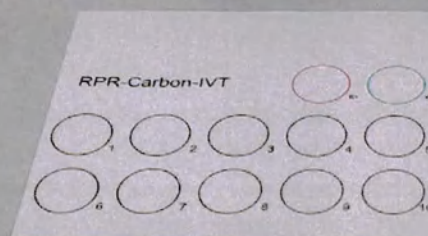

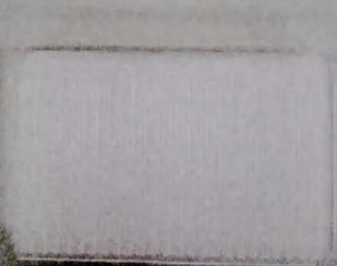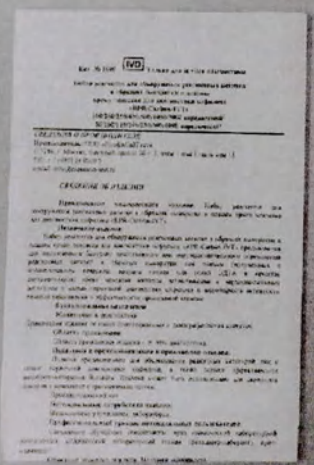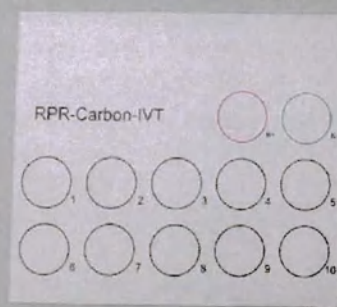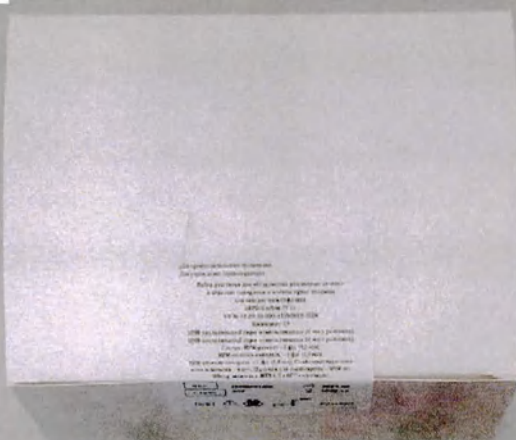






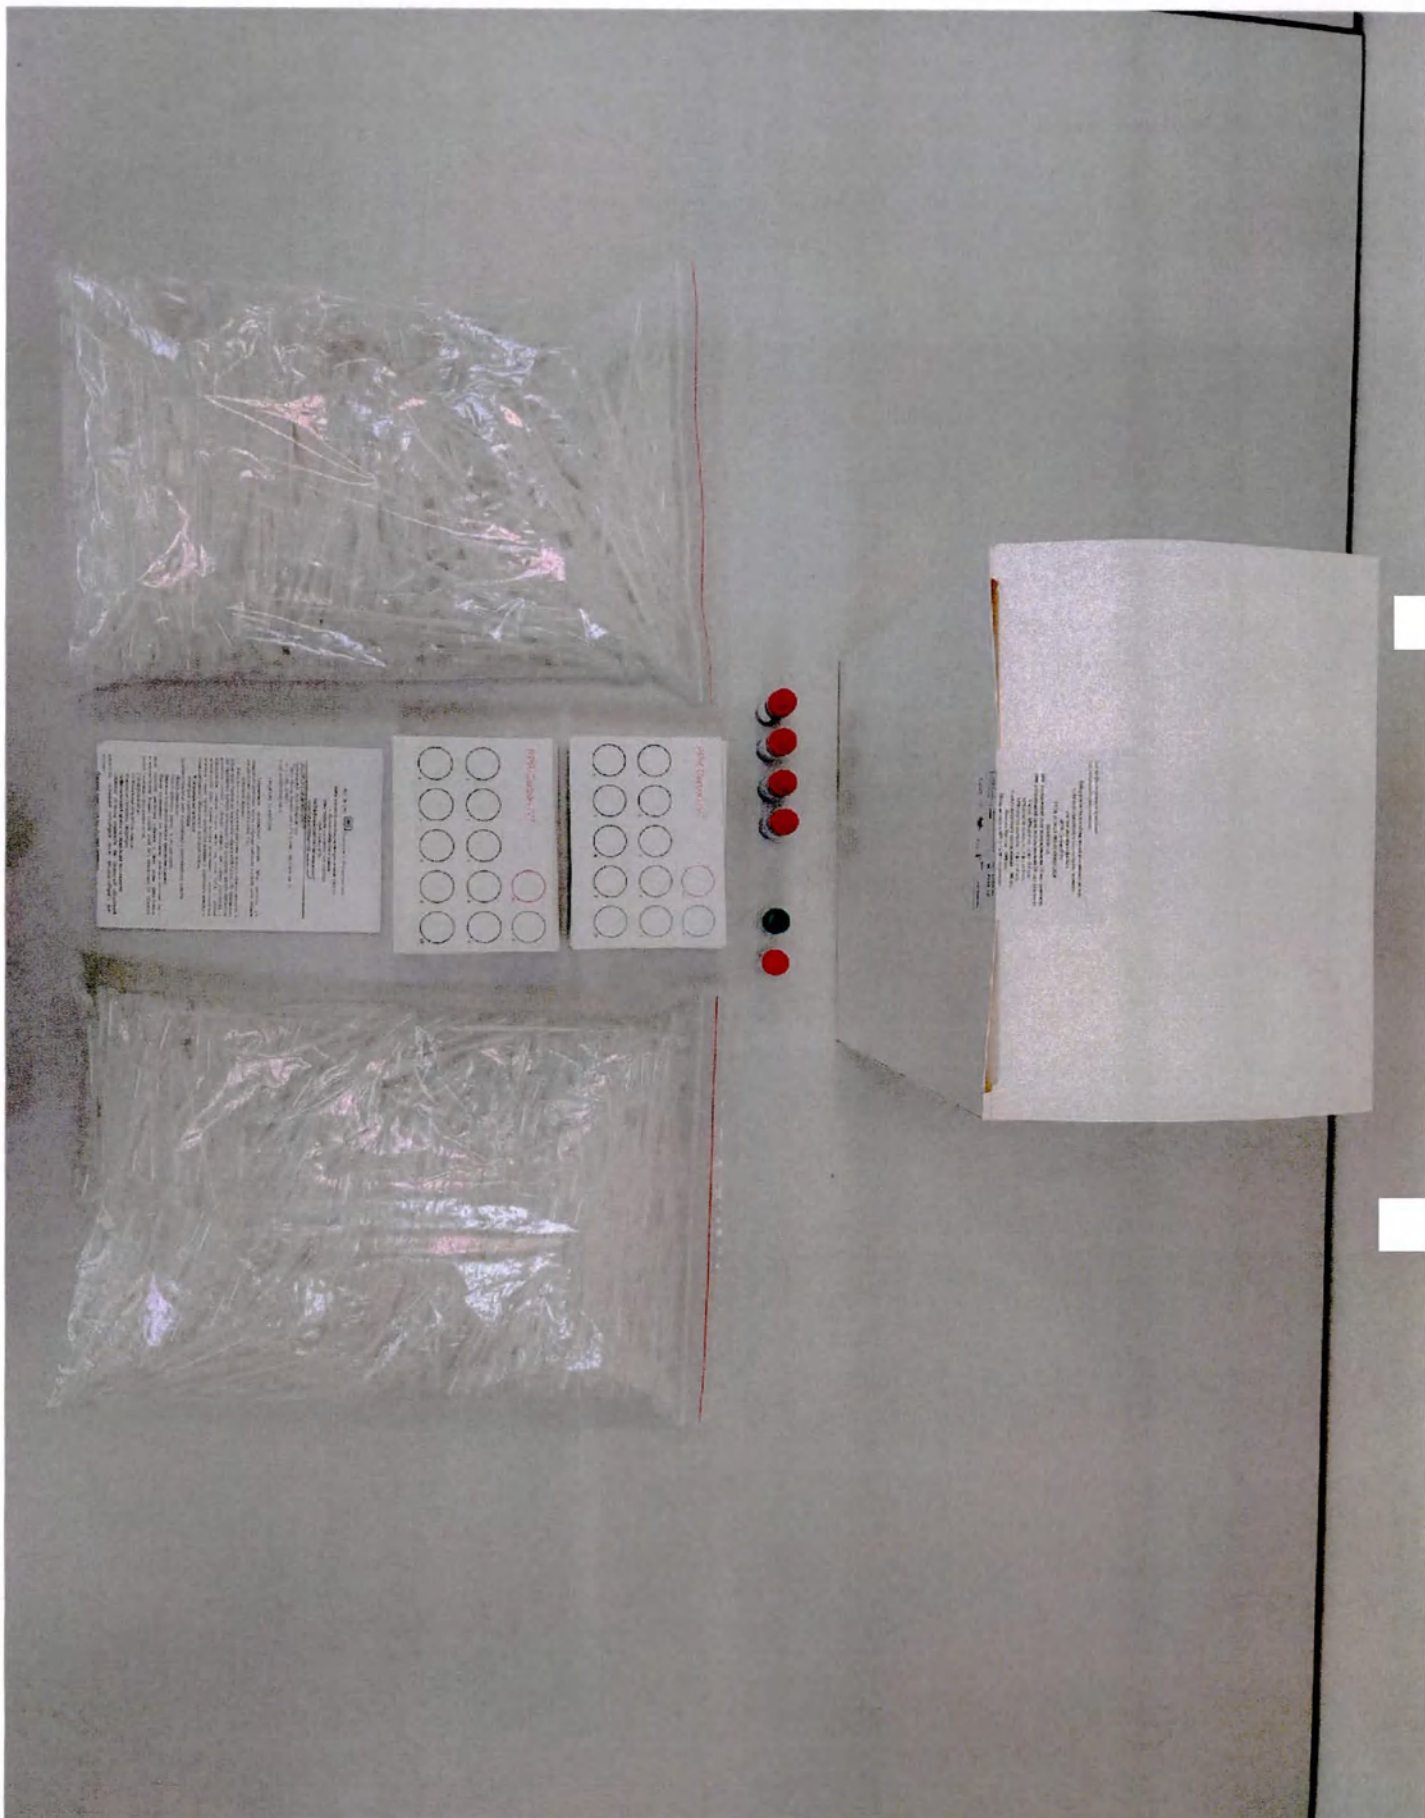

Фотографические изображения компонентов в Набор реагентов для обнаружения рибонуклеиновых антител в образцах сыворотки и плазмы крови человека для диагностики сифилиса «RPR-Carbon-IVT»





1. RPR-реагент

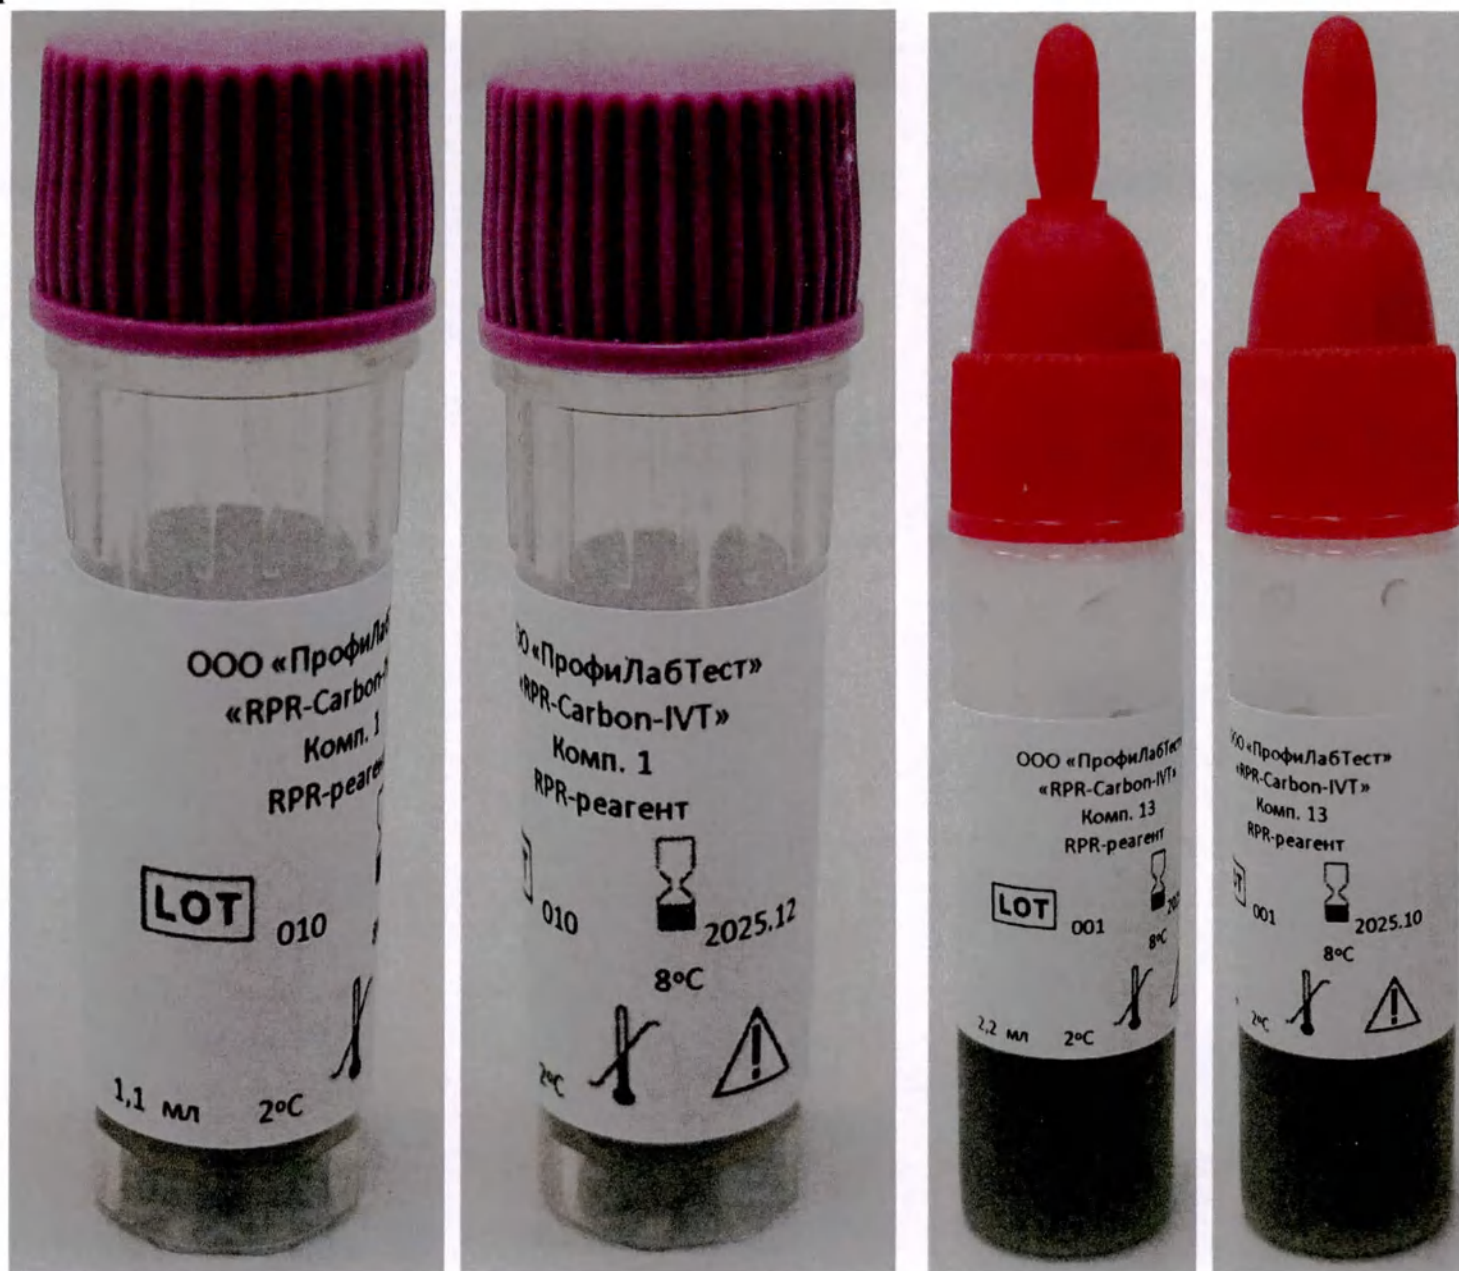







2. RPR-позитив контроль

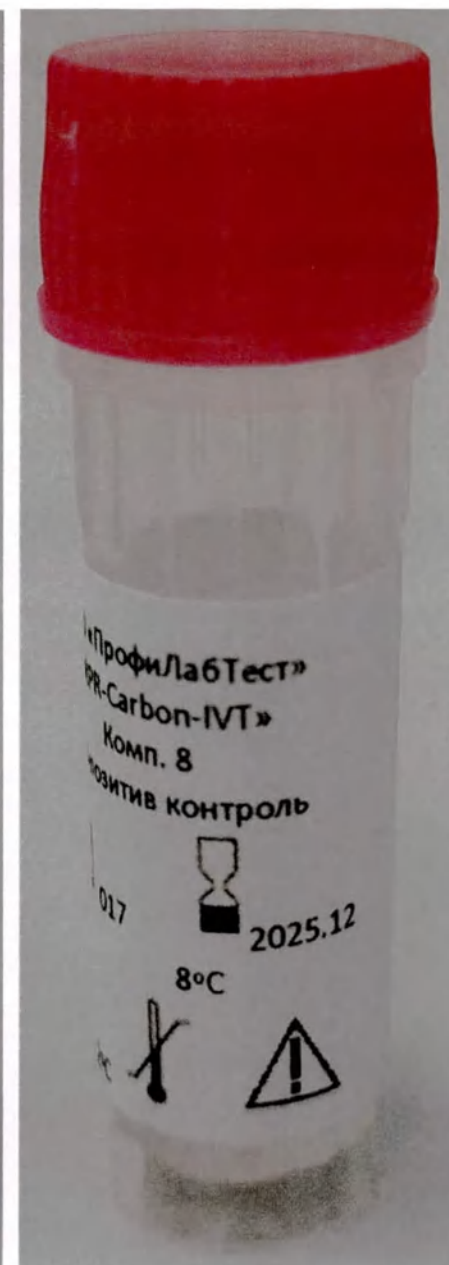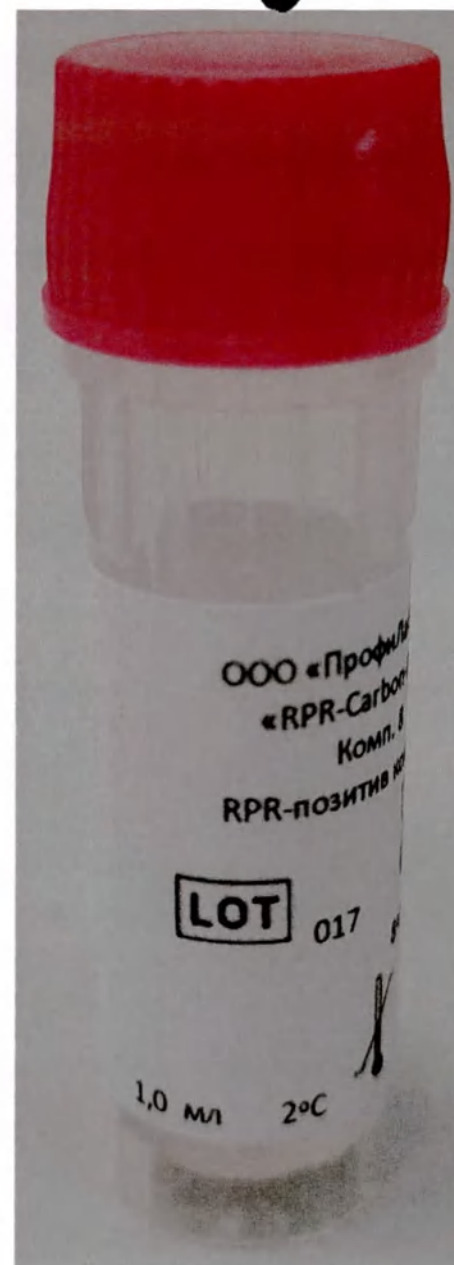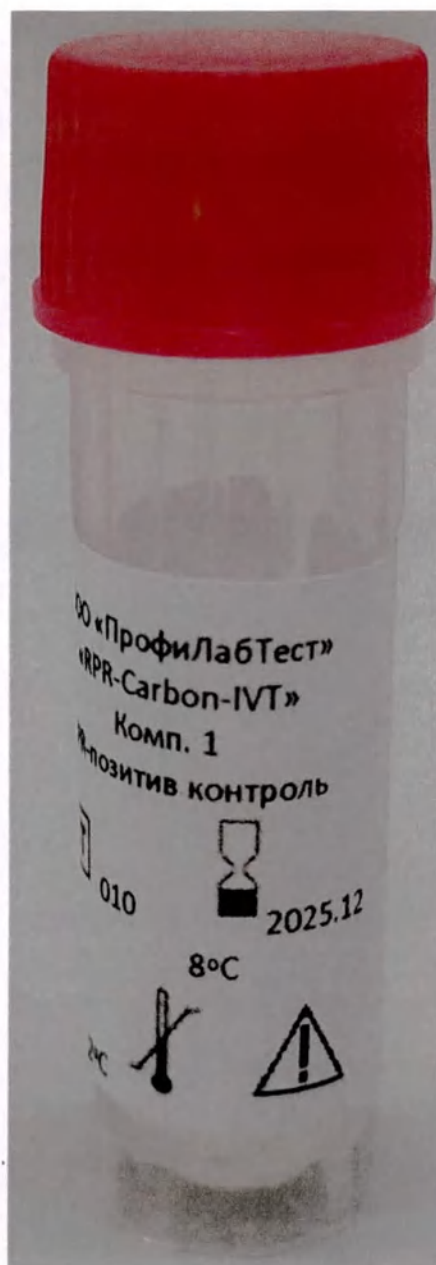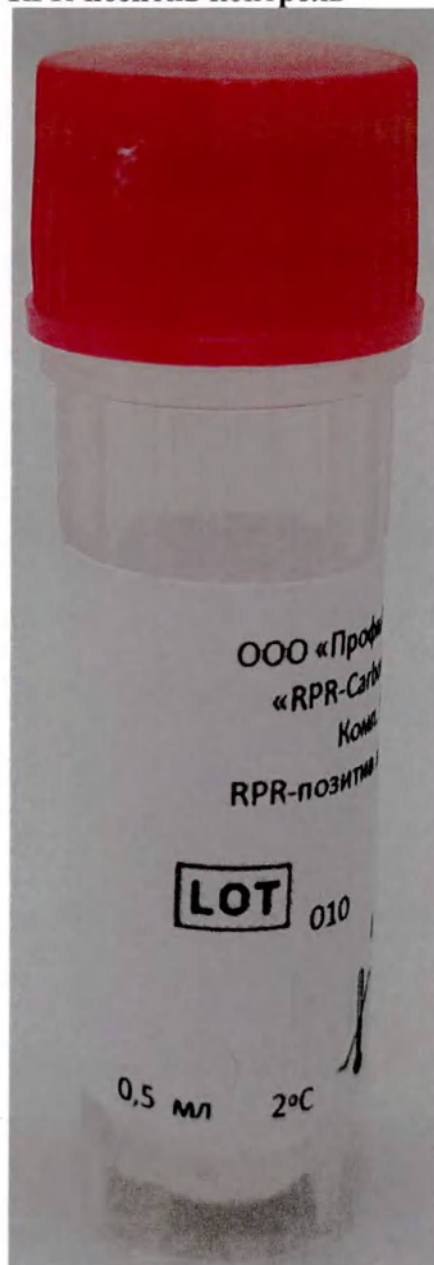


3. RPR-позитив контроль

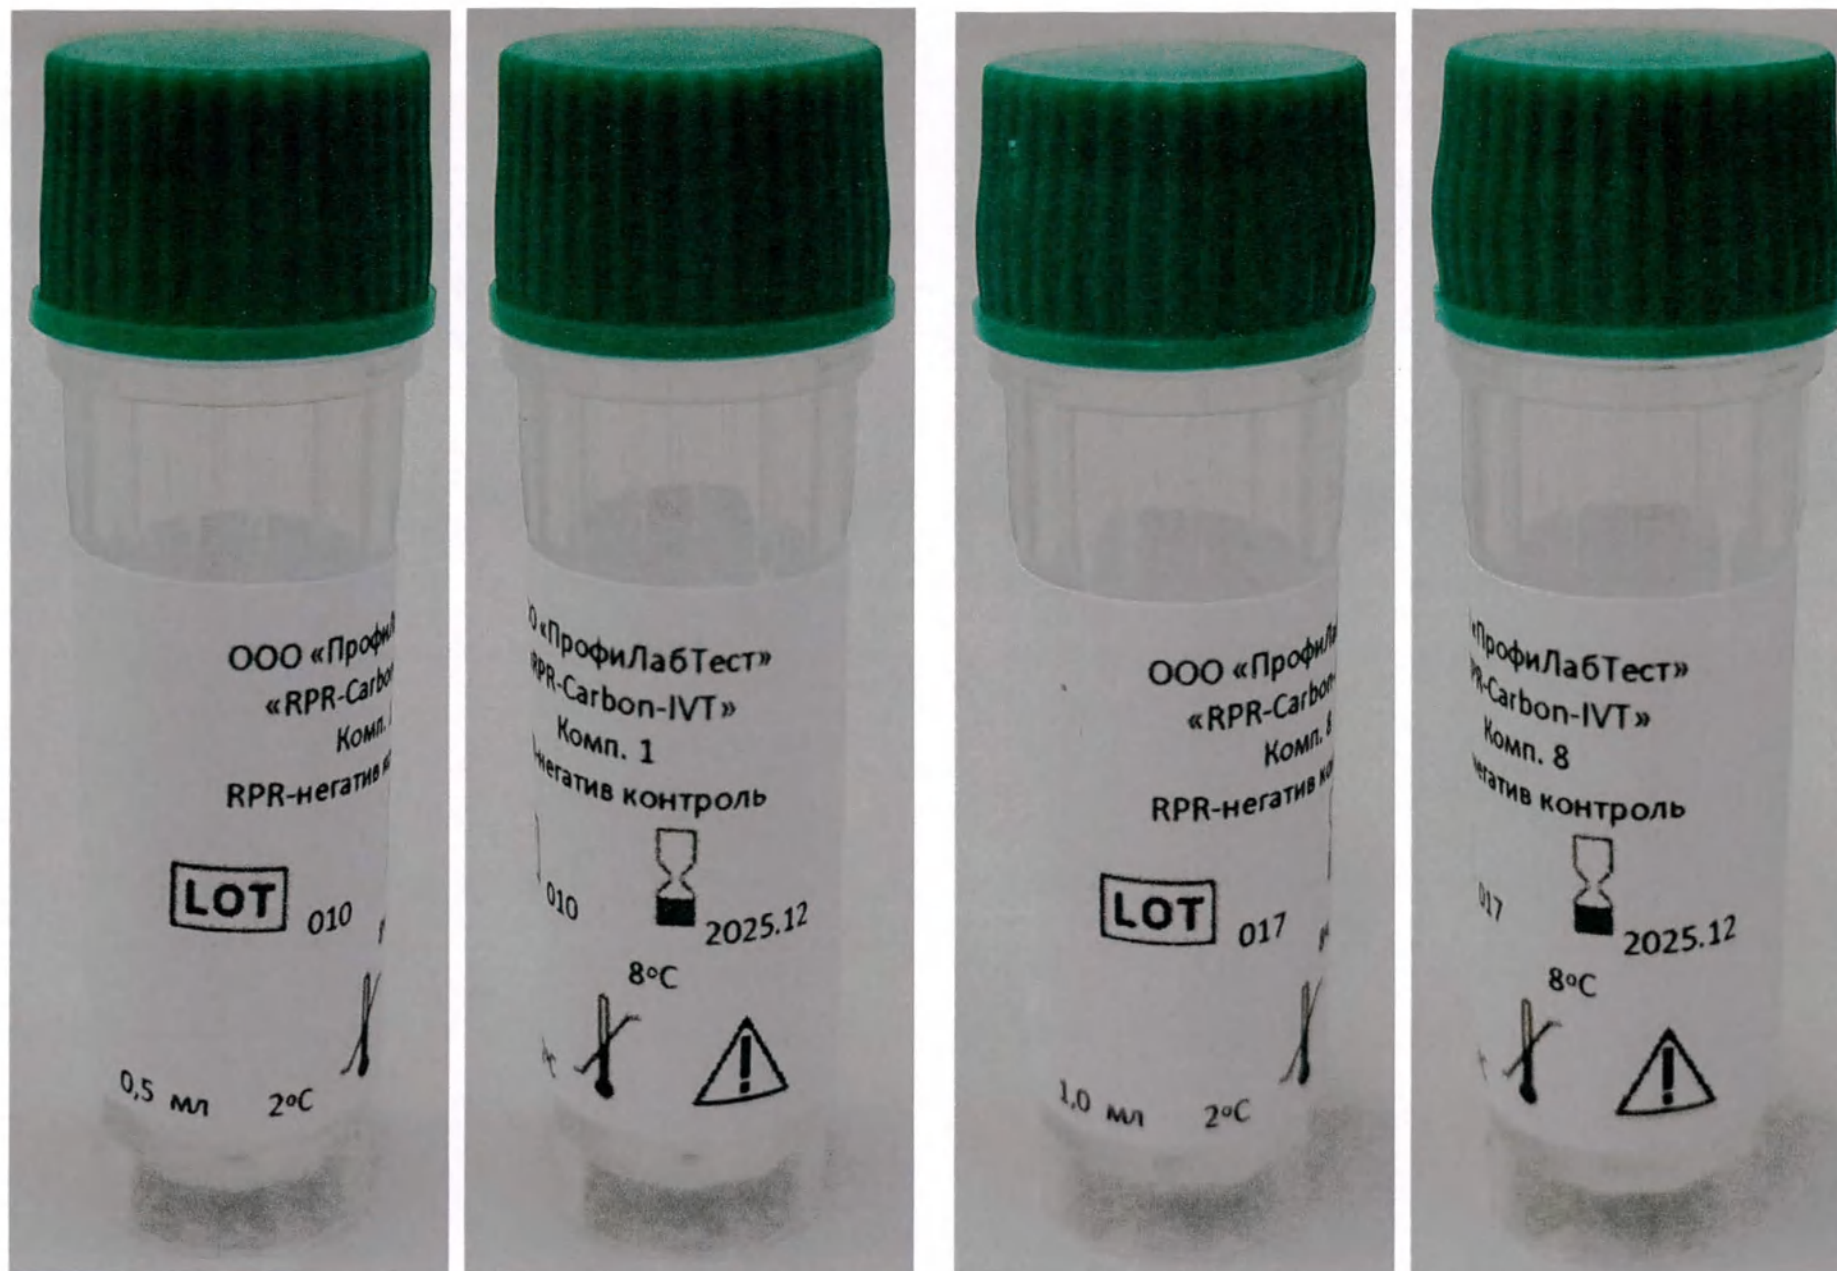


4. Упаковка

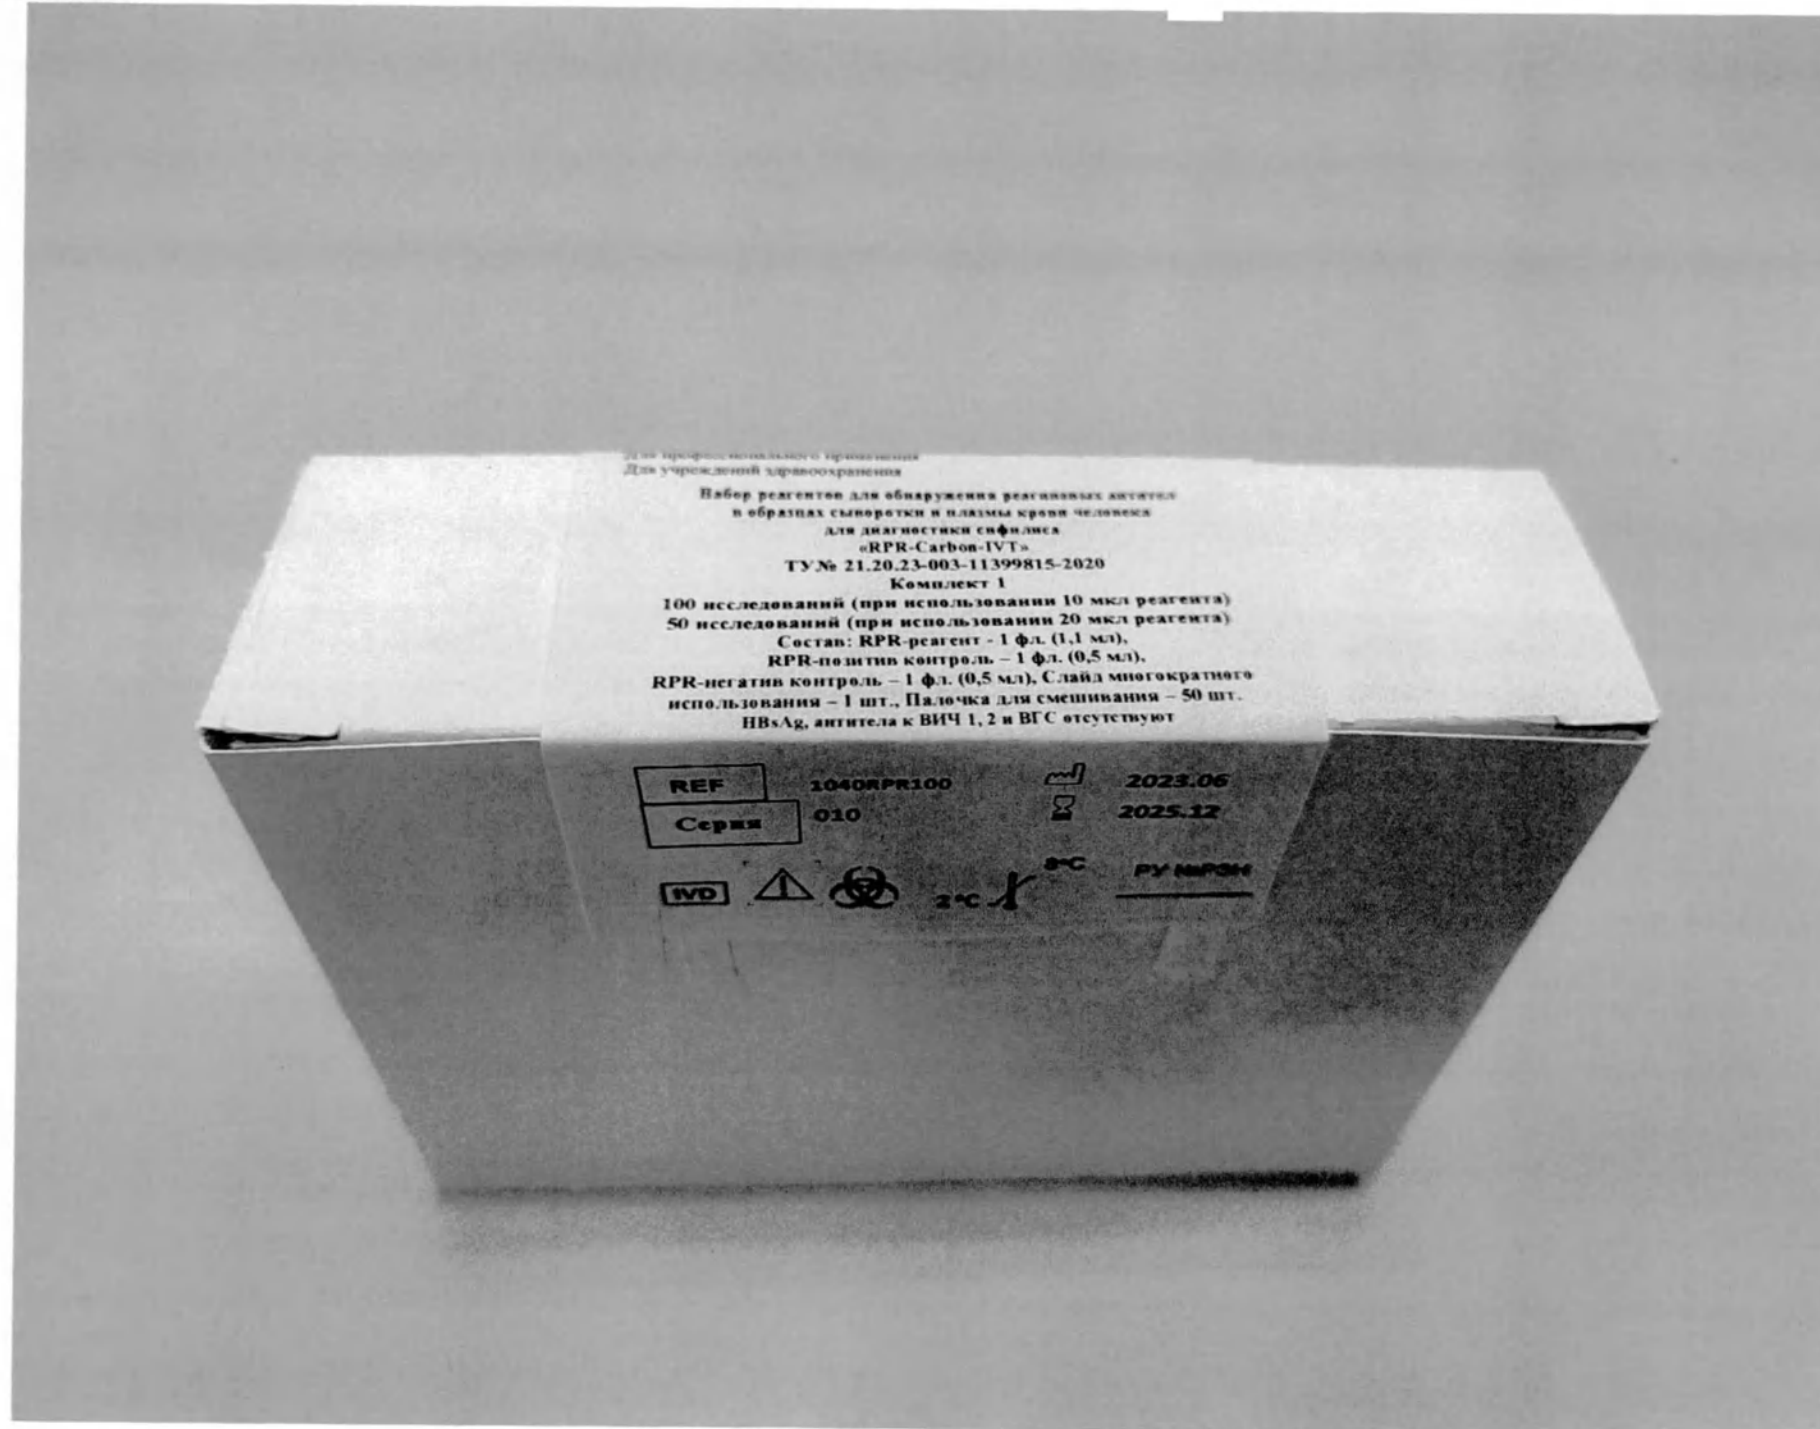


Комплект 1

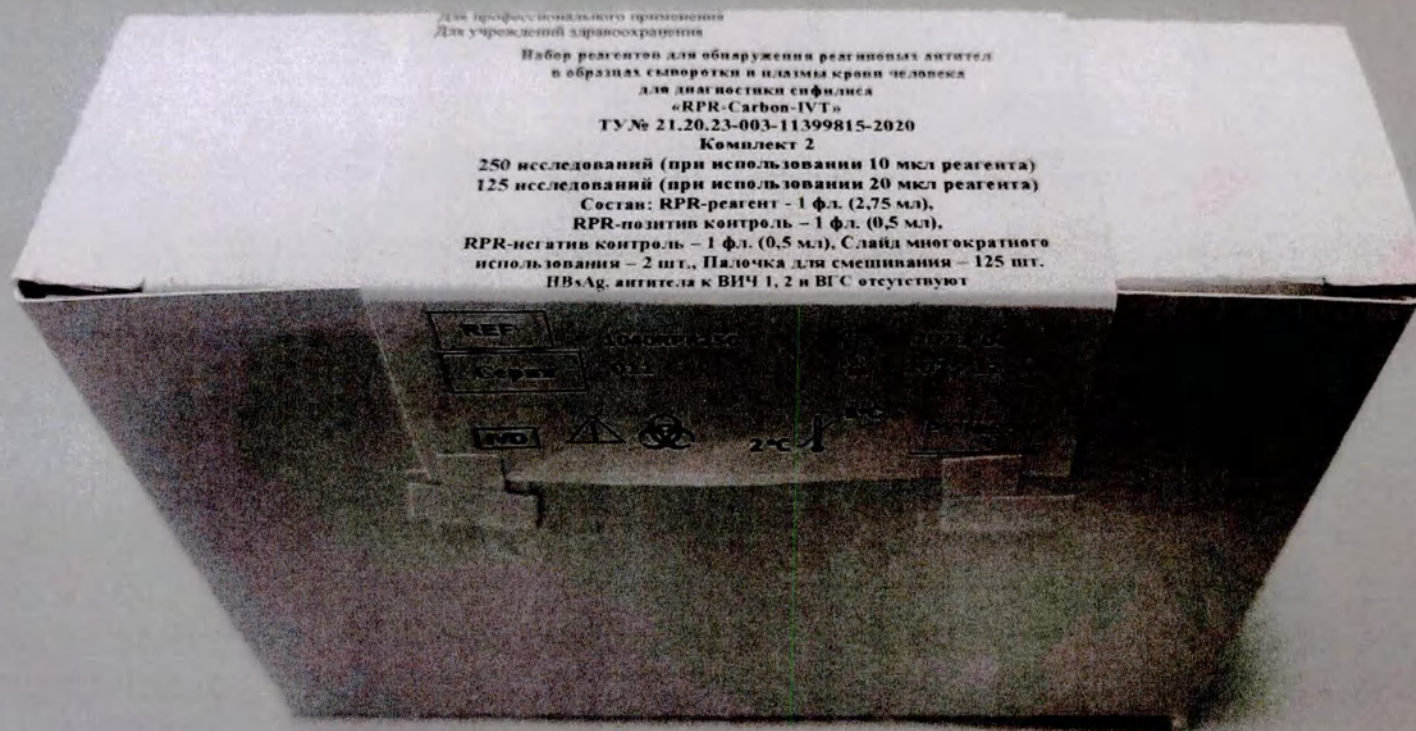


Комплект 2

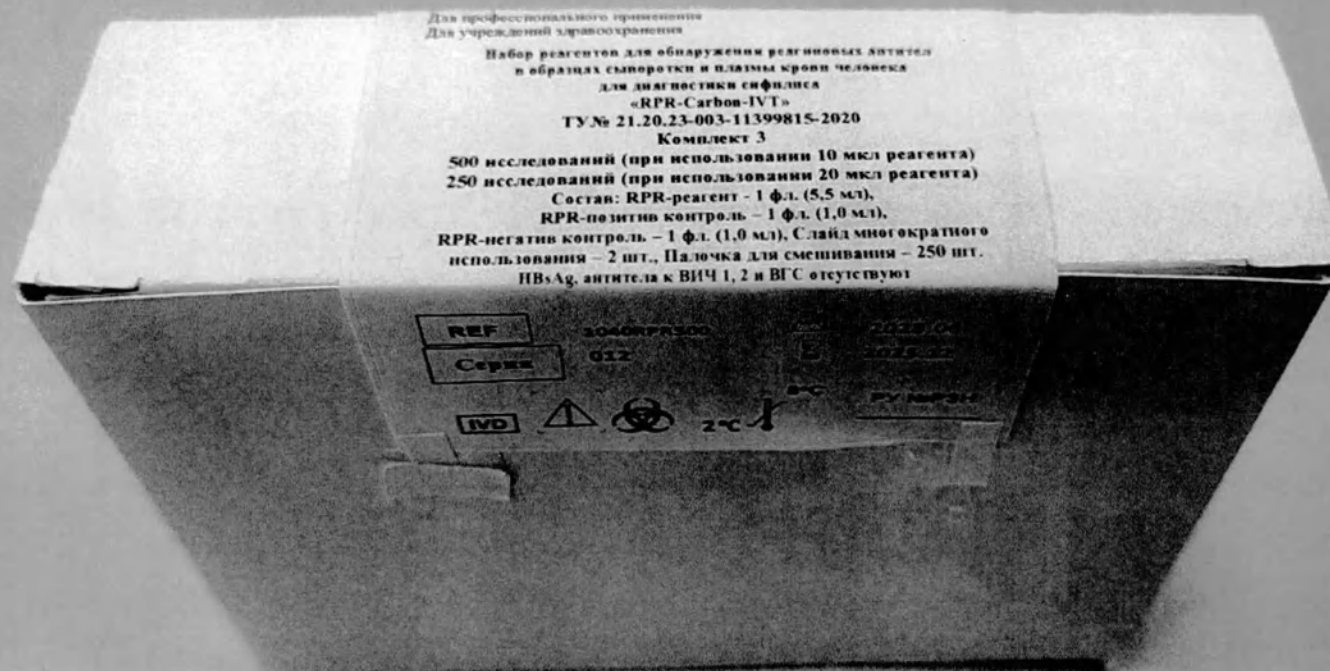


Комплект 3

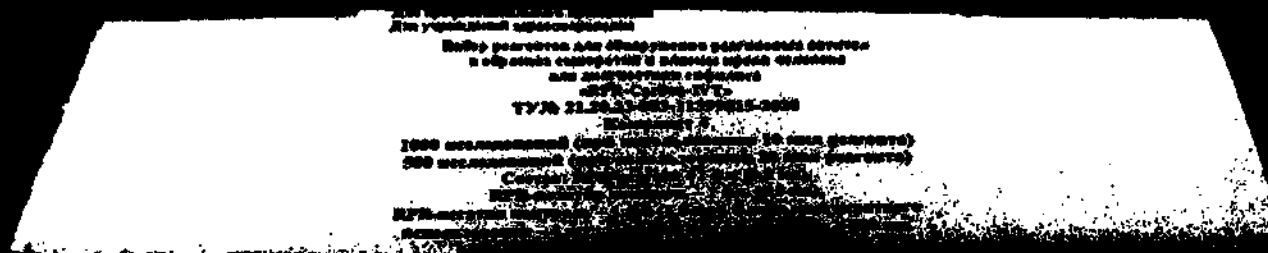


Комплект 4

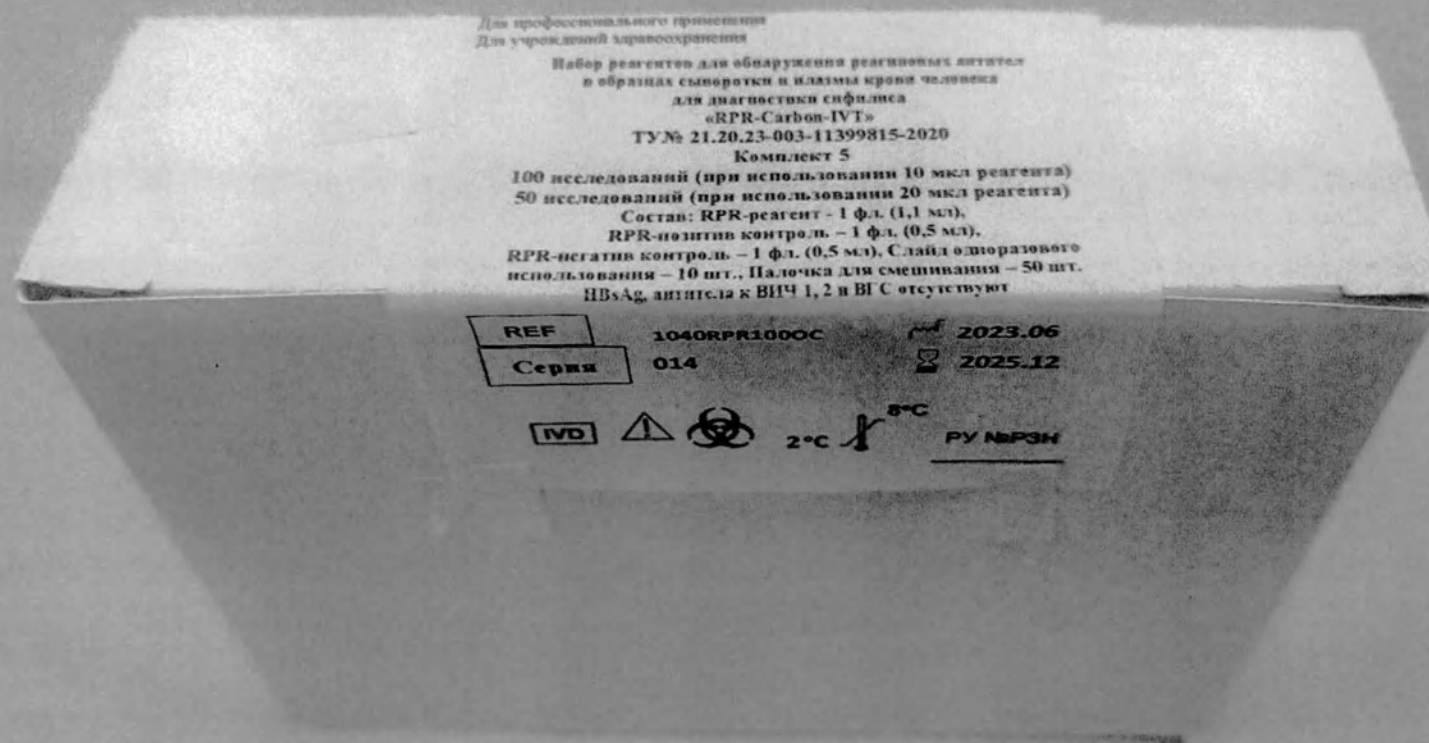


Комплект 5

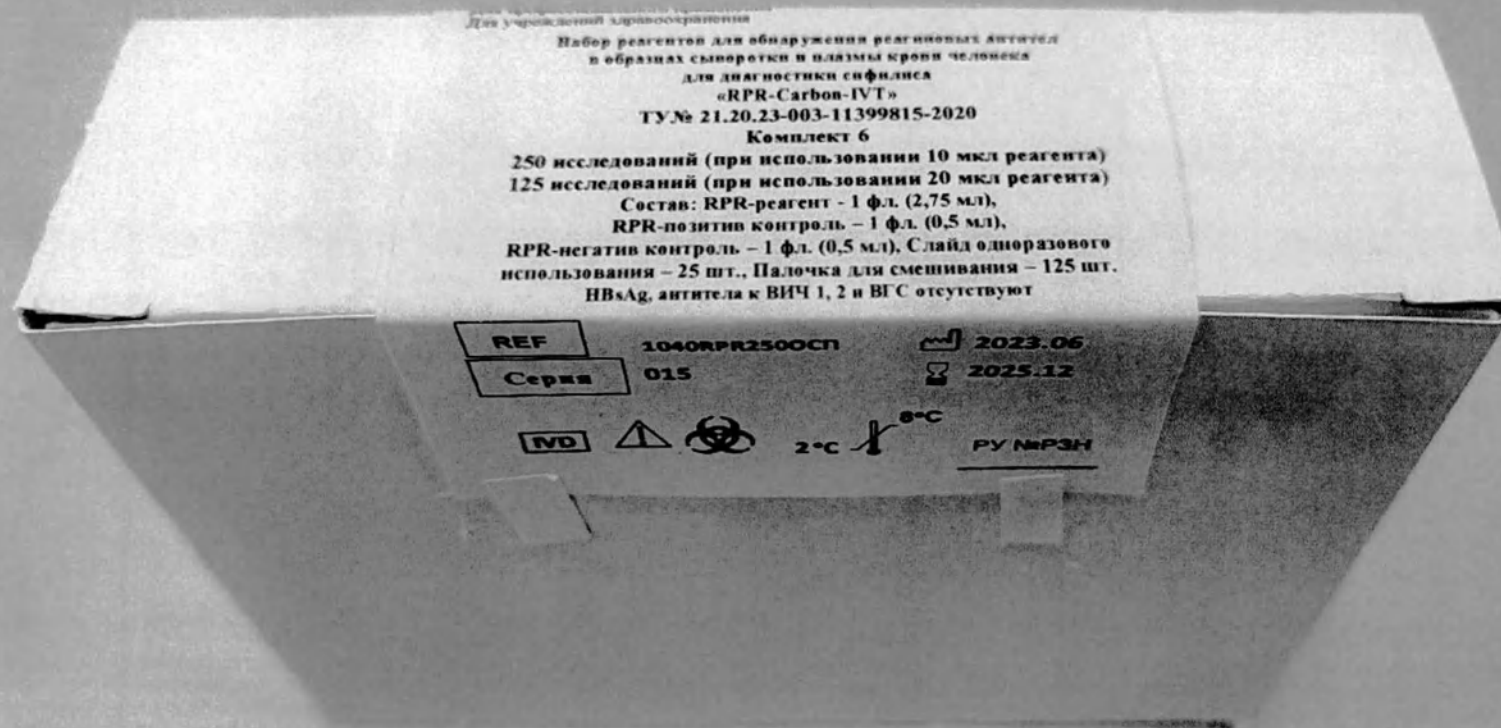

Комплект 6

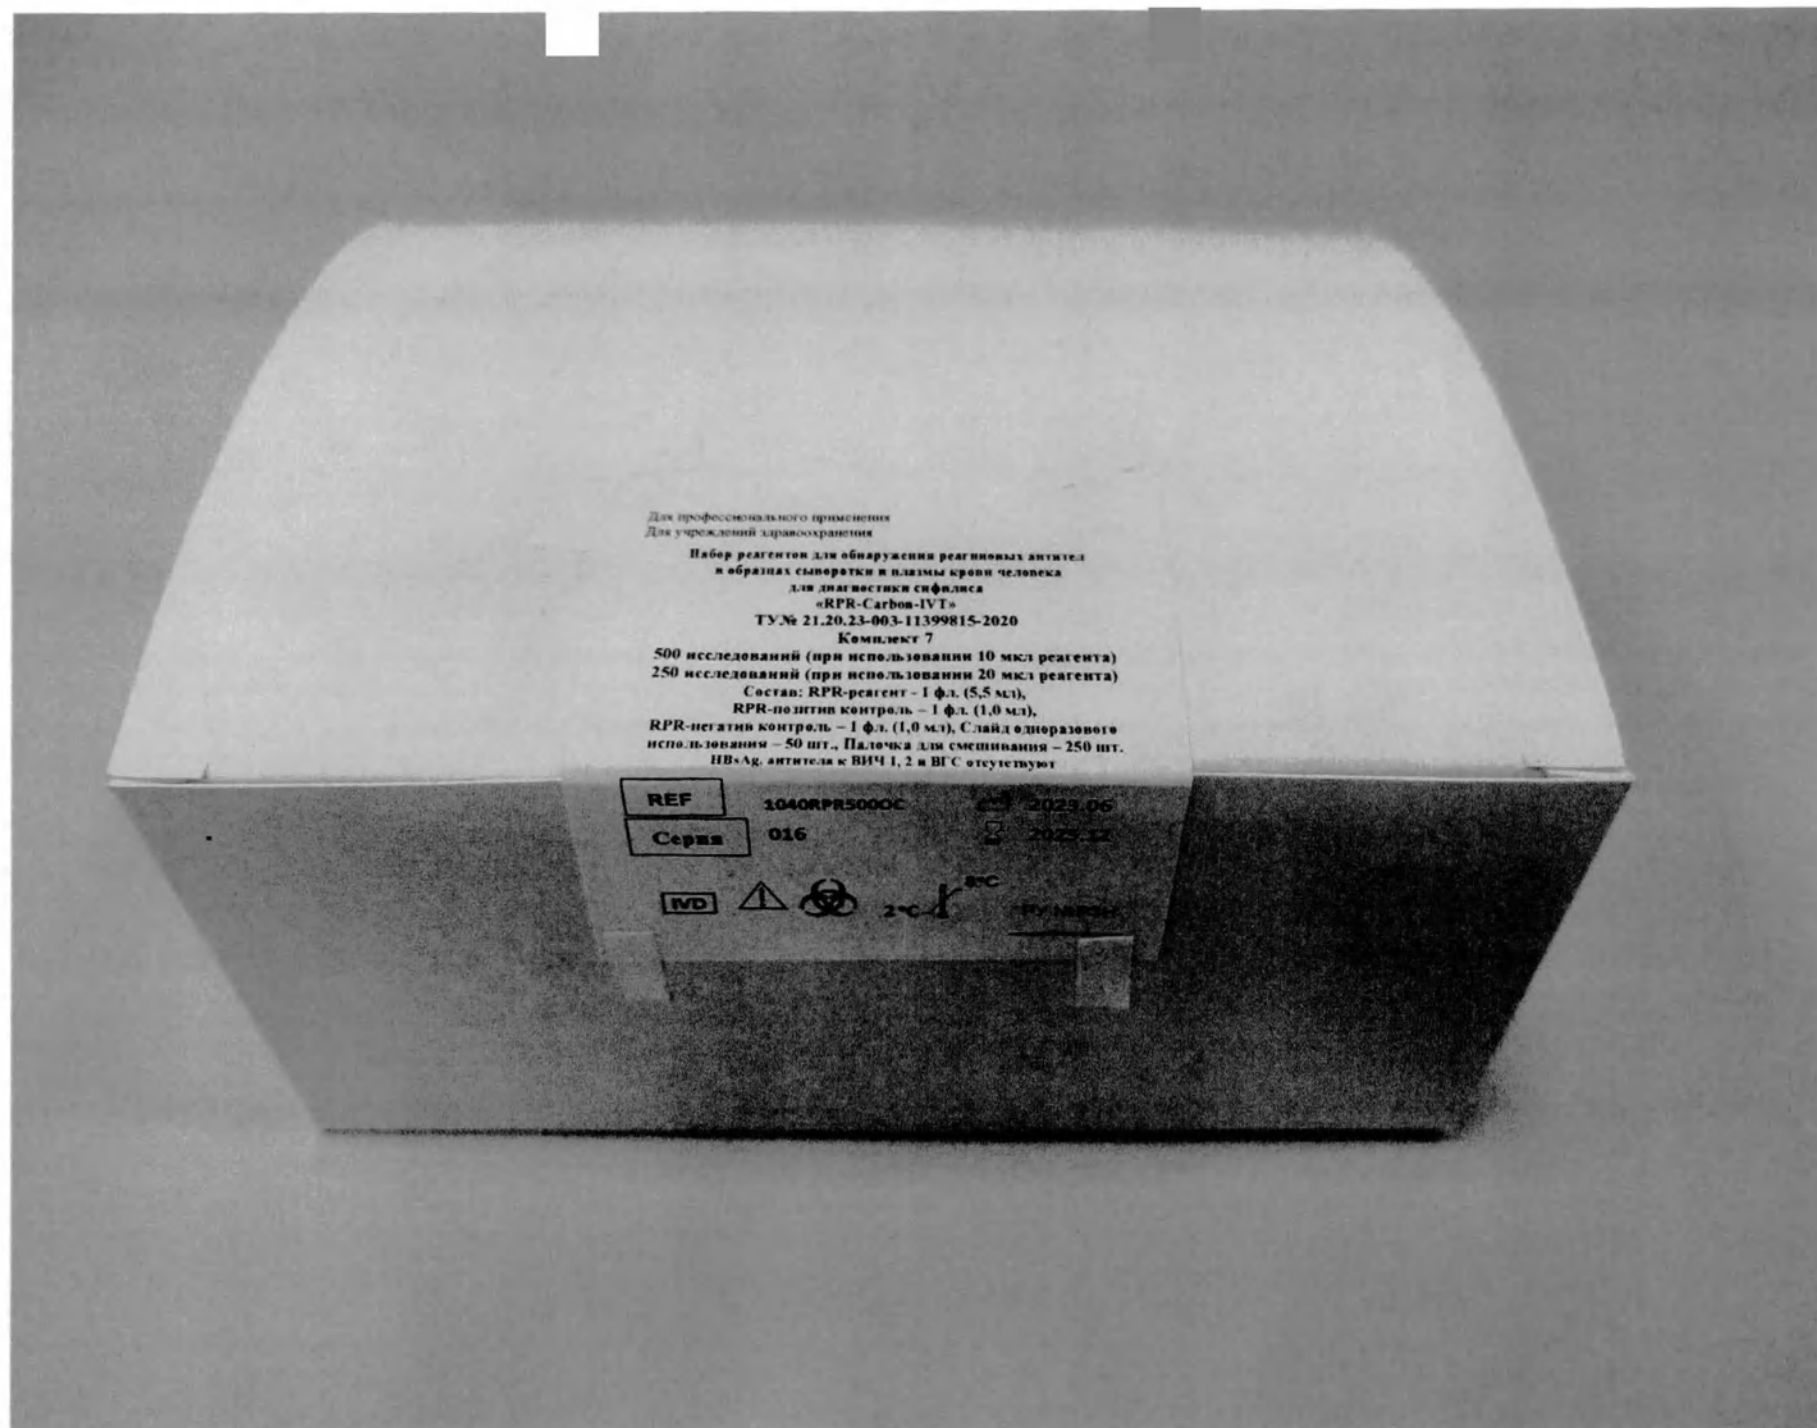

Комплект 7

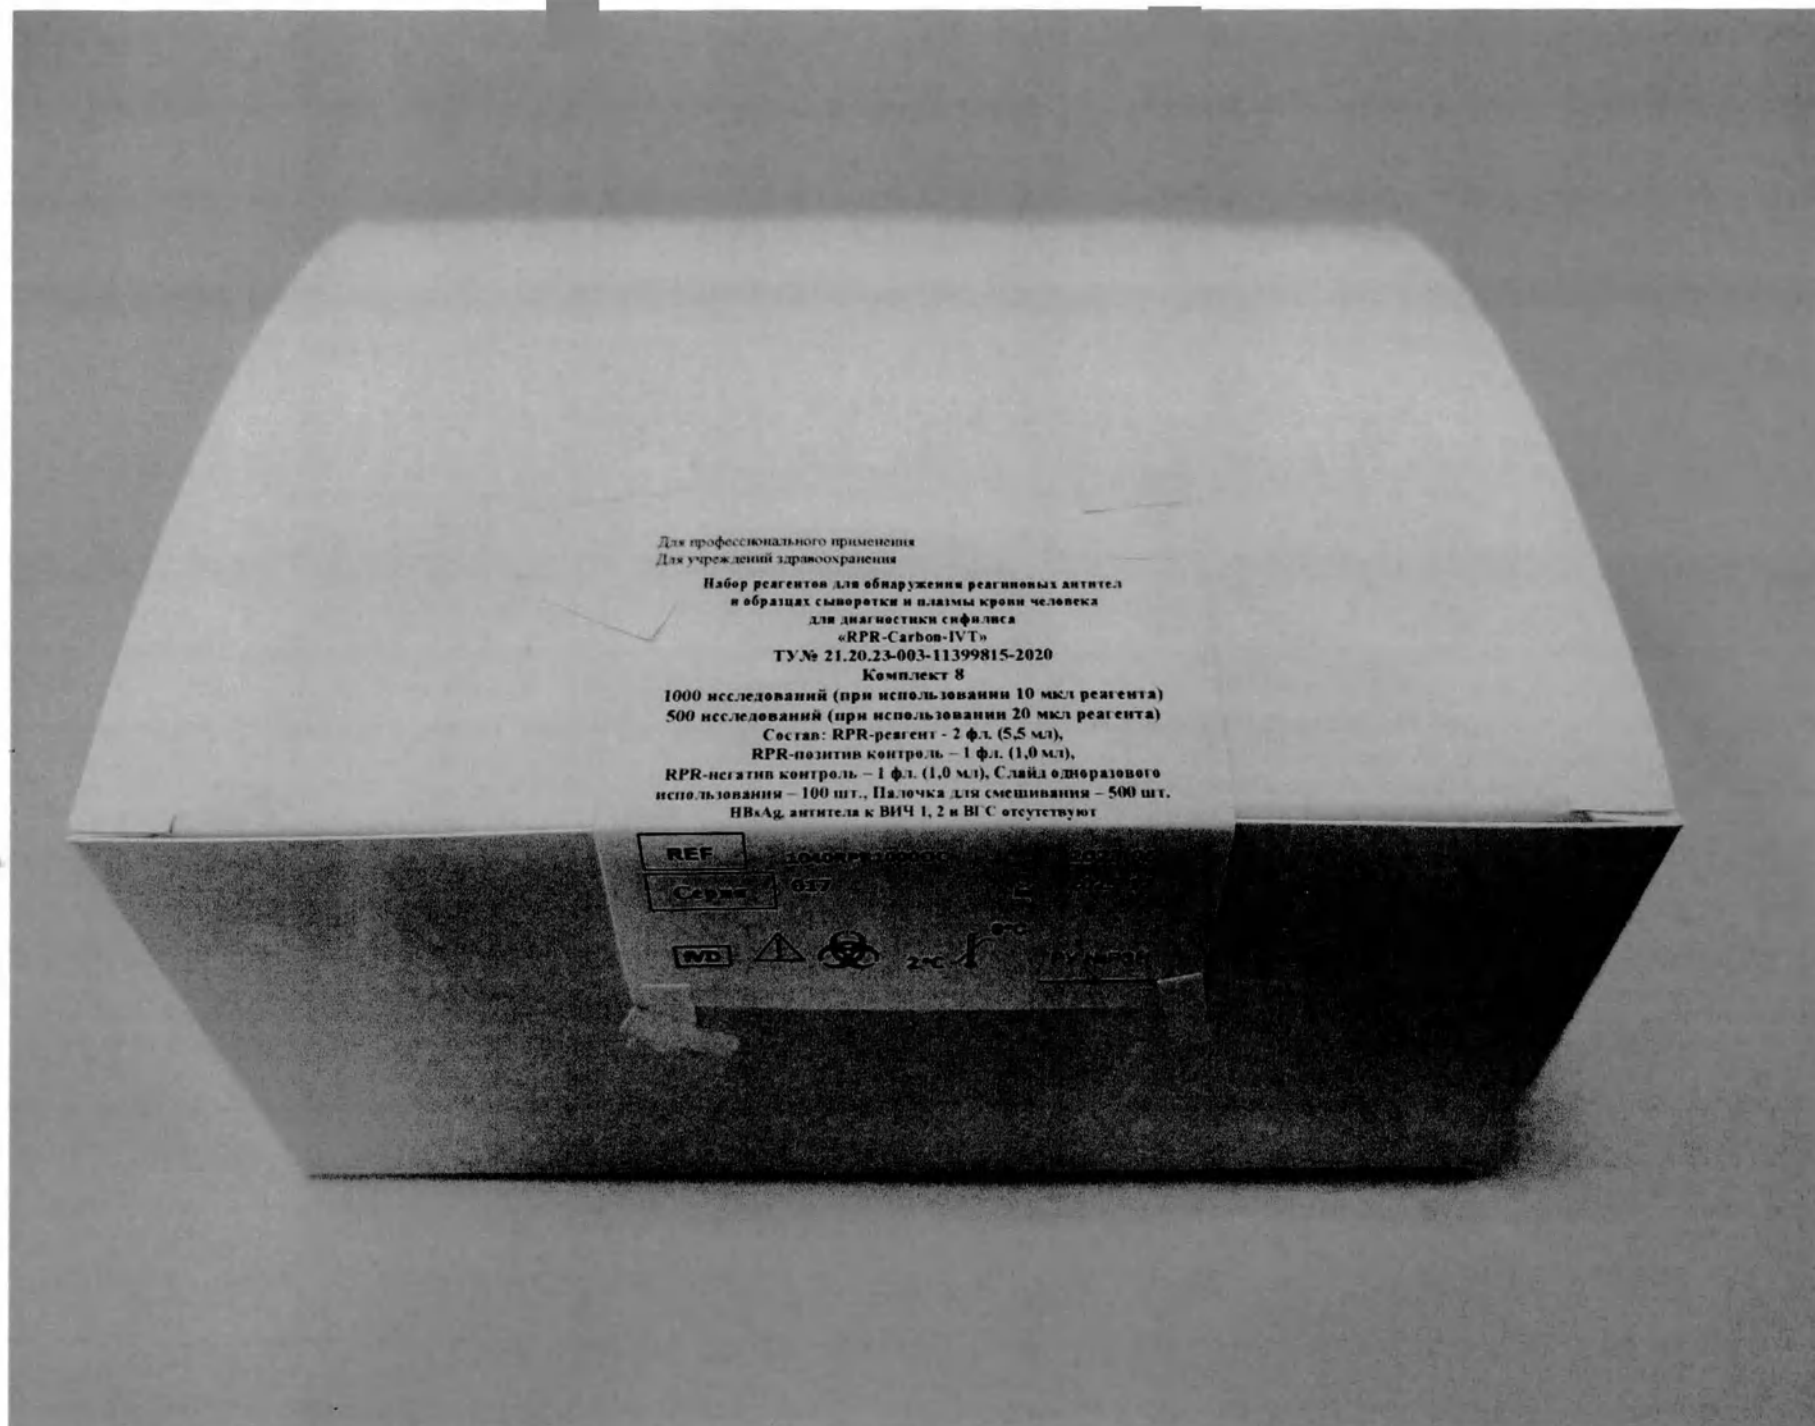

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для обнаружения реактивных антител
в образцах сыворотки и плазмы крови человека
для диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»

ТУ № 21.20.23-003-11399815-2020

Комплект 8

1000 исследований (при использовании 10 мкл реагента)

500 исследований (при использовании 20 мкл реагента)

Состав: RPR-реагент - 2 фл. (5,5 мл),

RPR-позитив контроль - 1 фл. (1,0 мл),


RPR-негатив контроль - 1 фл. (1,0 мл), Слайд одноразового

использования - 100 шт., Палочка для смешивания - 500 шт.


HBsAg, антитела к ВИЧ 1, 2 и В1 С отсутствуют



Комплект 8

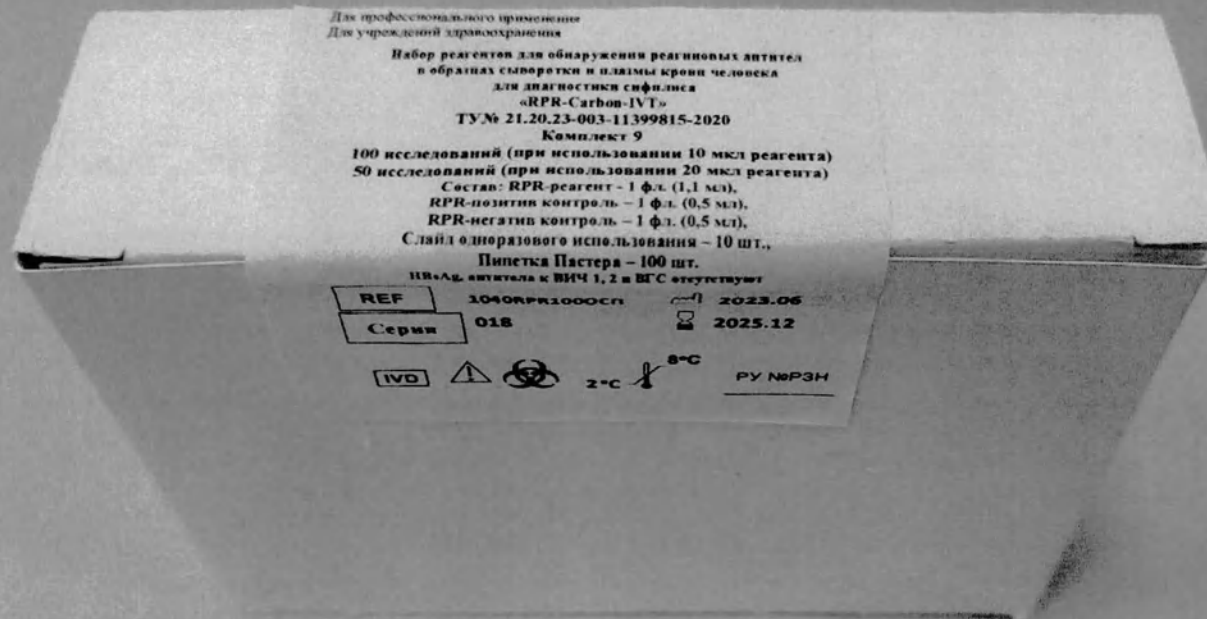


Комплект 9

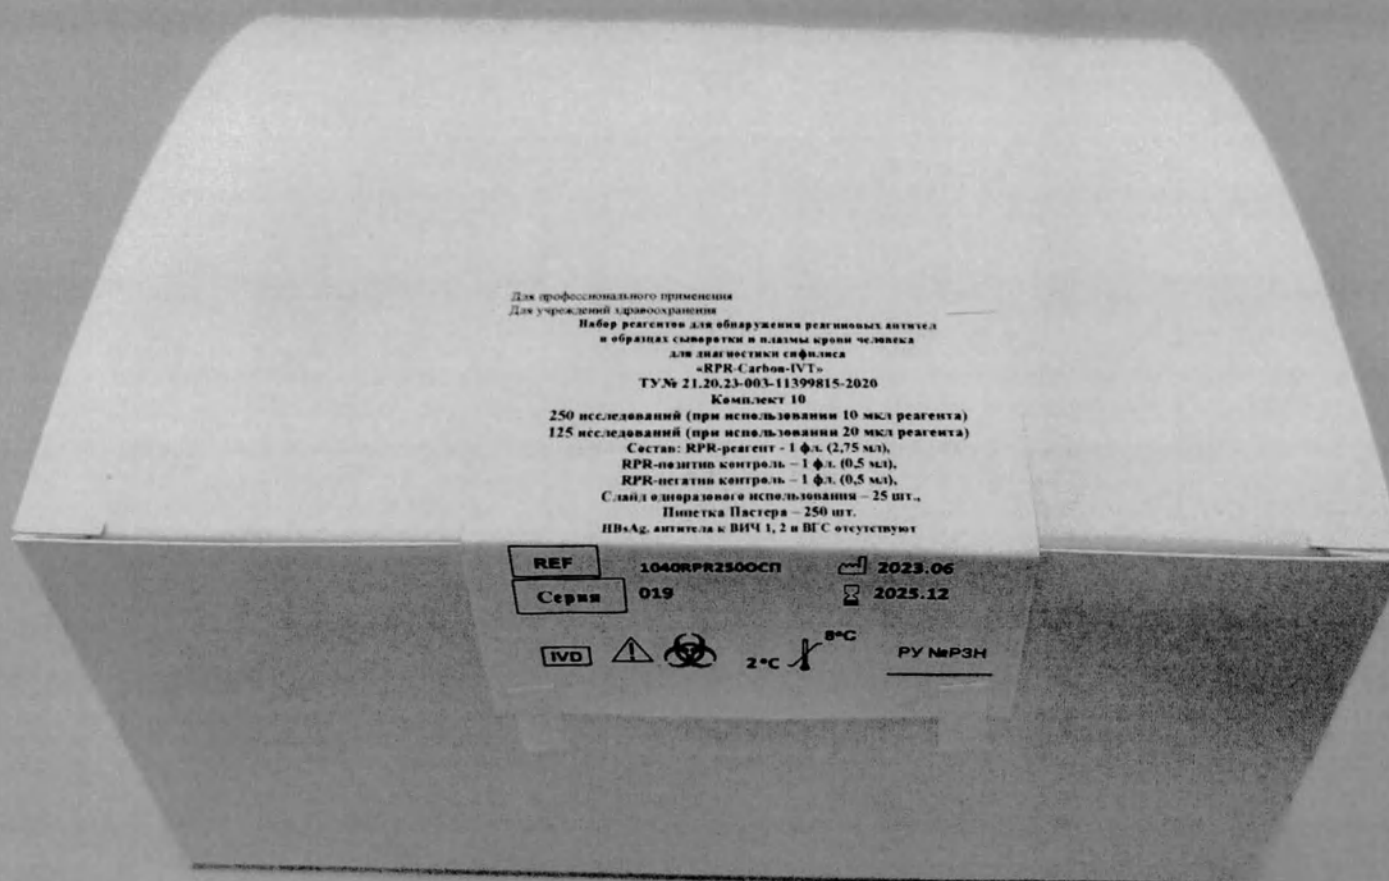

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов для обнаружения реактивных антител
в образцах сыворотки и плазмы крови человека
для диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»
ТУ № 21.20.23-003-11399815-2020
Комплект 10
250 исследований (при использовании 10 мкл реагента)
125 исследований (при использовании 20 мкл реагента)
Состав: RPR-реагент – 1 ф.л. (2,75 мл),
RPR-позитив контроль – 1 ф.л. (0,5 мл),
RPR-негатив контроль – 1 ф.л. (0,5 мл),
Слайды для разового использования – 25 шт.,
Пипетка Пастера – 250 шт.,
HBsAg, антитела к ВИЧ 1, 2 и ВГС отсутствуют

REF	1040RPR2500CP	2023.06
Серия	019	2025.12
IVD	⚠️ ⚠️ ⚠️	2°C 8°C
		РУ №РЗН


Комплект 10

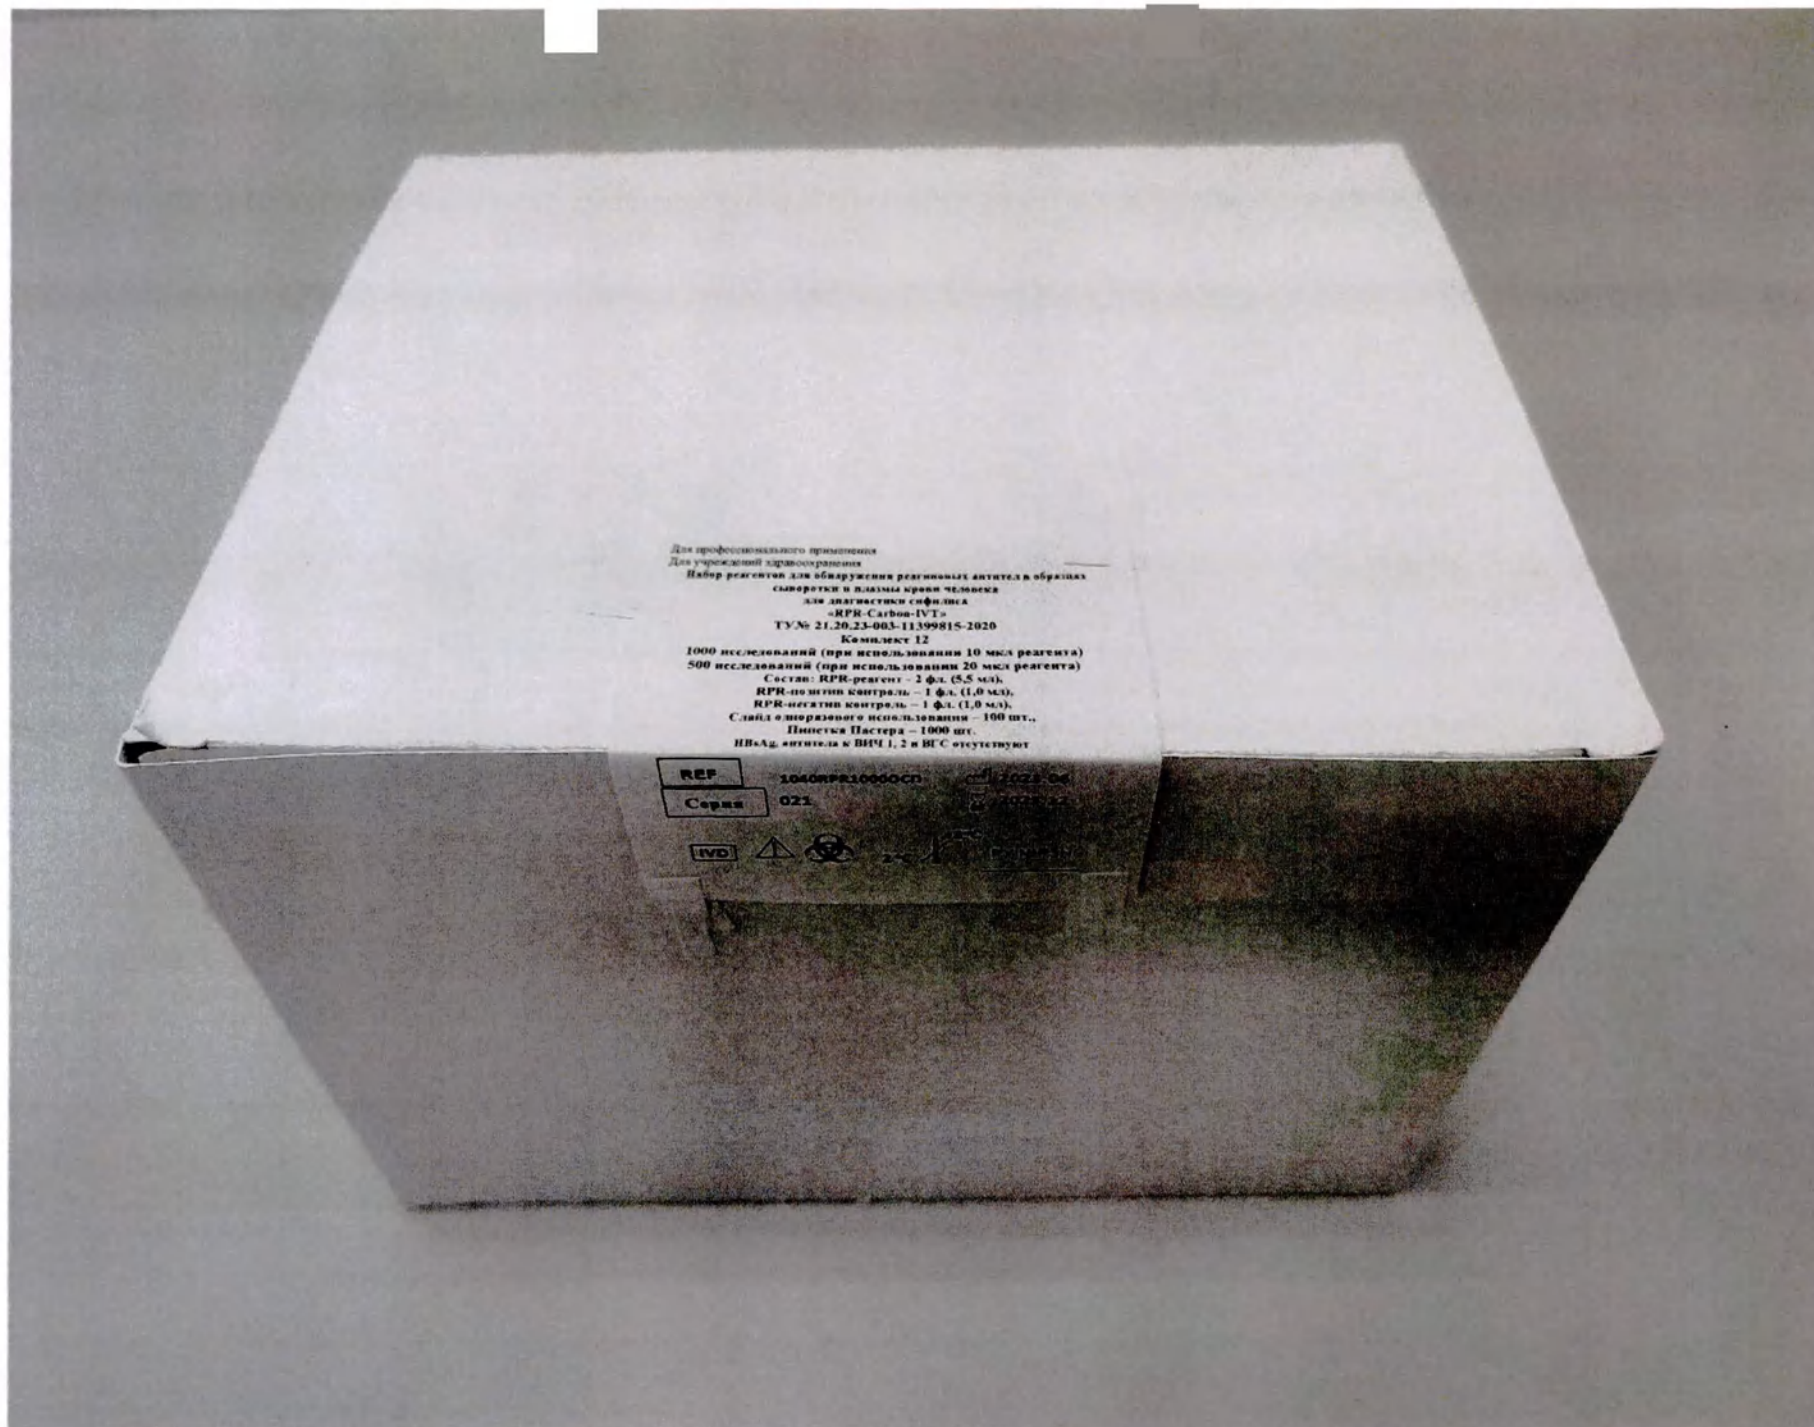


Для профессионального применения
 Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов для обнаружения реактивных антител в образцах сыворотки и плазмы крови человека для диагностики сифилиса «RPR-Carbo-IVT»
 ТУ № 21.20.23-003-11399815-2020
 Комплект 12
 1000 исследований (при использовании 10 мкл реагента)
 500 исследований (при использовании 20 мкл реагента)
 Состав: RPR-реагент – 2 фла. (5,5 мл),
 RPR-позитив контроль – 1 фла. (1,0 мл),
 RPR-негатив контроль – 1 фла. (1,0 мл),
 Слайды микроскопического использования – 100 шт.,
 Пипетка Пастера – 1000 шт.
 HBsAg, антитела к ВИЧ 1, 2 и ВС отсутствуют

REF 1040RPR100000CP
 Серия 021
 IVD CE RoHS

Комплект 12

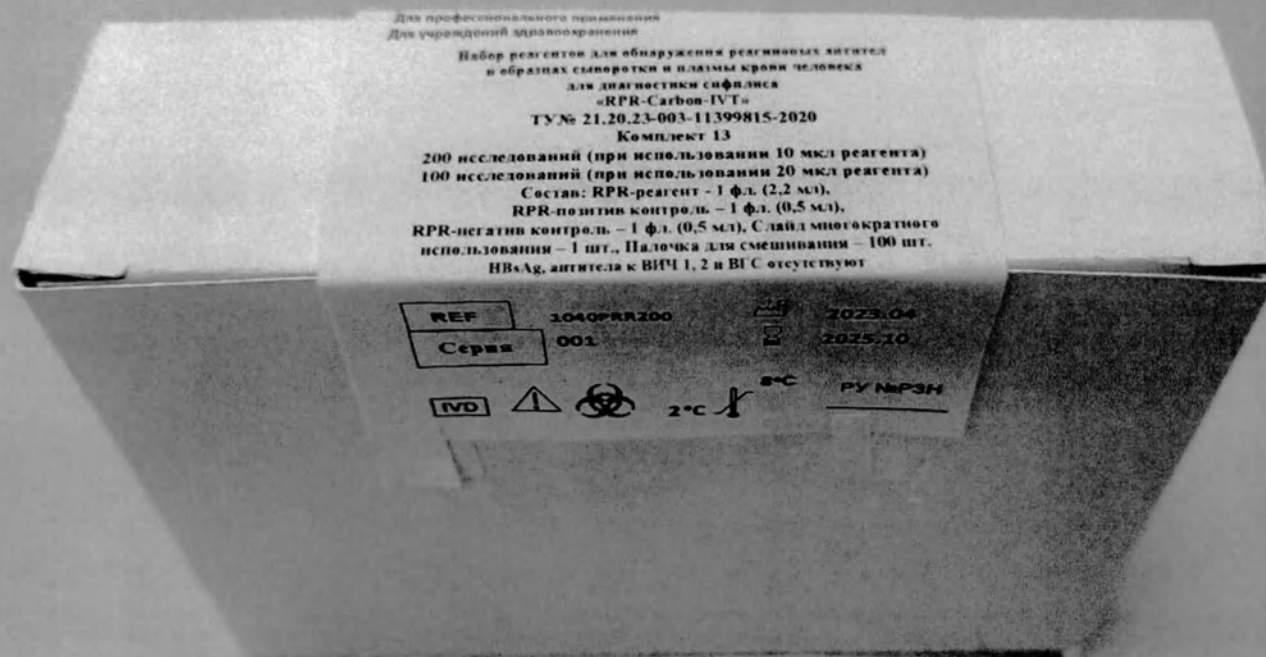

Комплект 13

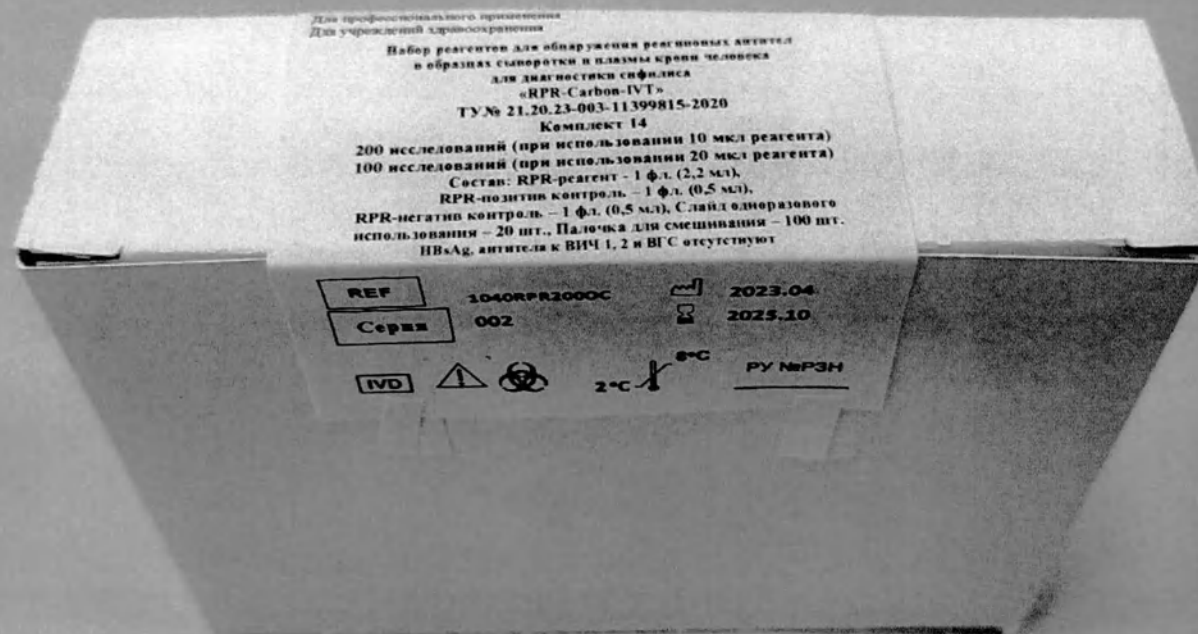

Комплект 14

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

**Набор реагентов для обнаружения реактивных антител
в образцах сыворотки и плазмы крови человека
для диагностики сифилиса**

«RPR-Carbon-IVT»
TY № 21.20.23-003-11399815-2020

Комплект 15

200 исследований (при использовании 10 мкл реагента)
100 исследований (при использовании 20 мкл реагента)

100 исследований (при использовании 20 мкл реагента)
Состав: РРР-реагент - 1 фл. (2,2 мл),

Состав: RPR-реагент - 1 фл. (2,2 мл),

Состав: RPR-реагент - 1 ф.л. (2,2 мл),
RPR-позитив контроль - 1 ф.л. (0,5 мл),
1 ф.л. (0,5 мл). Служит для

РРР-позитивный контроль – 1 ф.л. (0,5 мл), Слайд одноразового использования – 20 шт., Пипетка Пастера – 200 шт.
НВsAg, антитела к ВИЧ 1, 2 и ВГС отсутствуют

НВsAg, антитела к ВИЧ 1, 2 и ВГС отсутствуют

REF 1040 REF 1000 CTR 7023 04

CAPES 1000

NO

△


⊗

⊙


⊖

⊕


Комплект 15

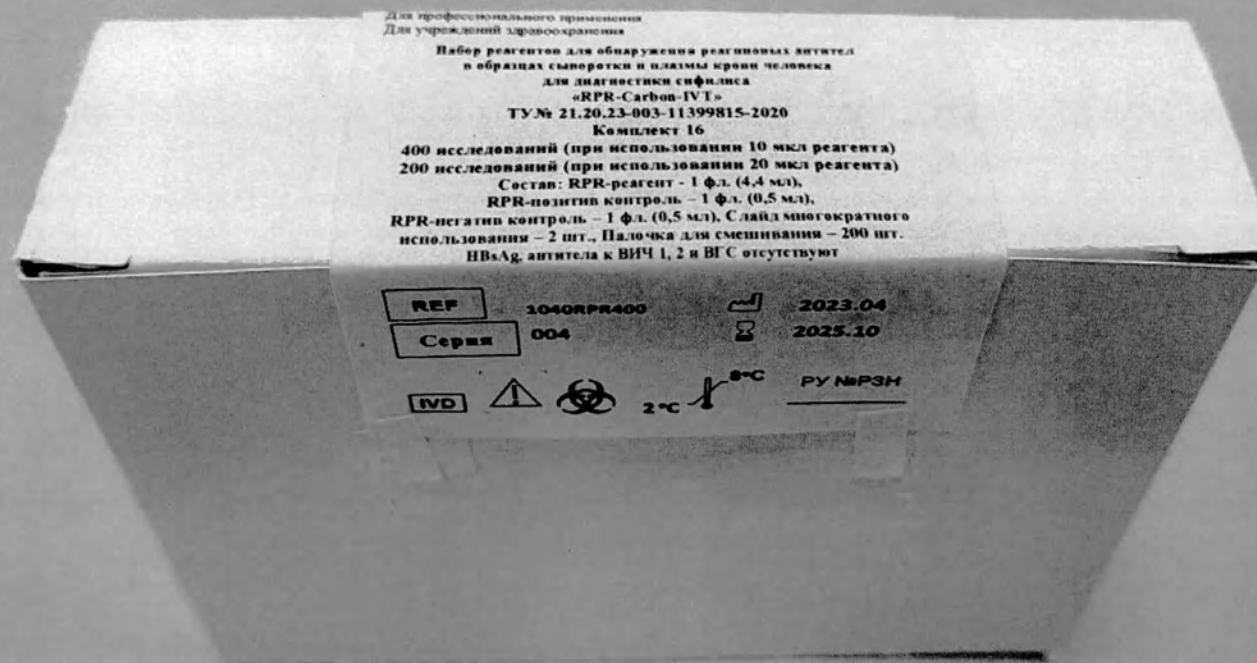


Комплект 16

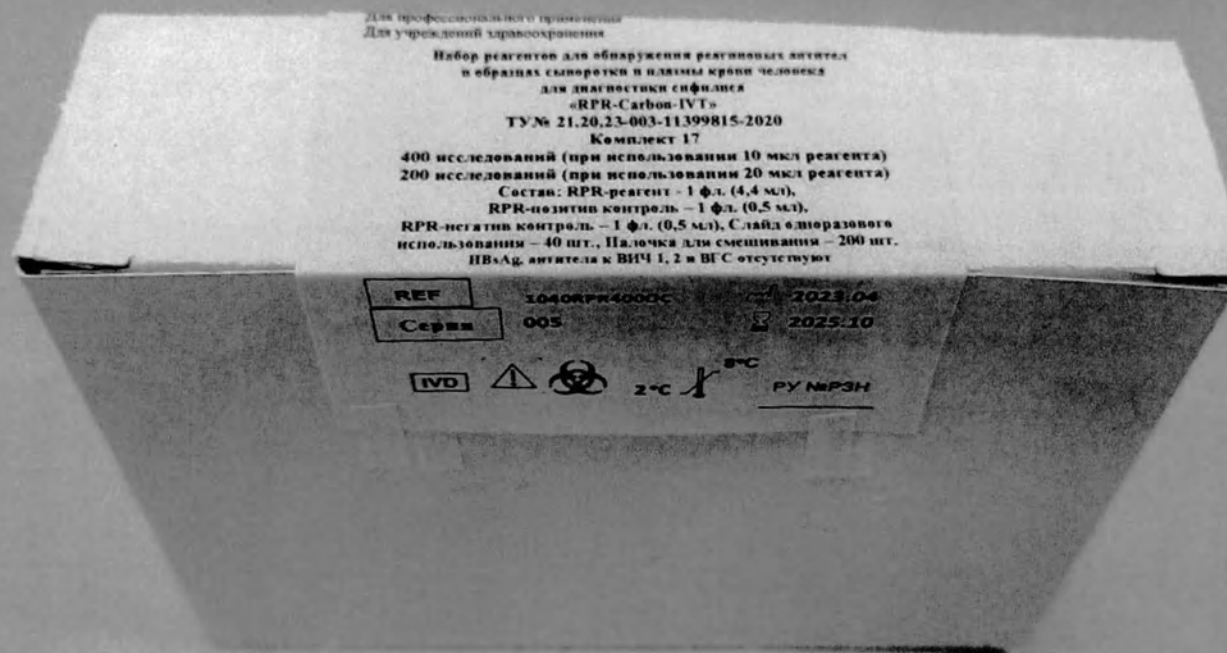


Комплект 17

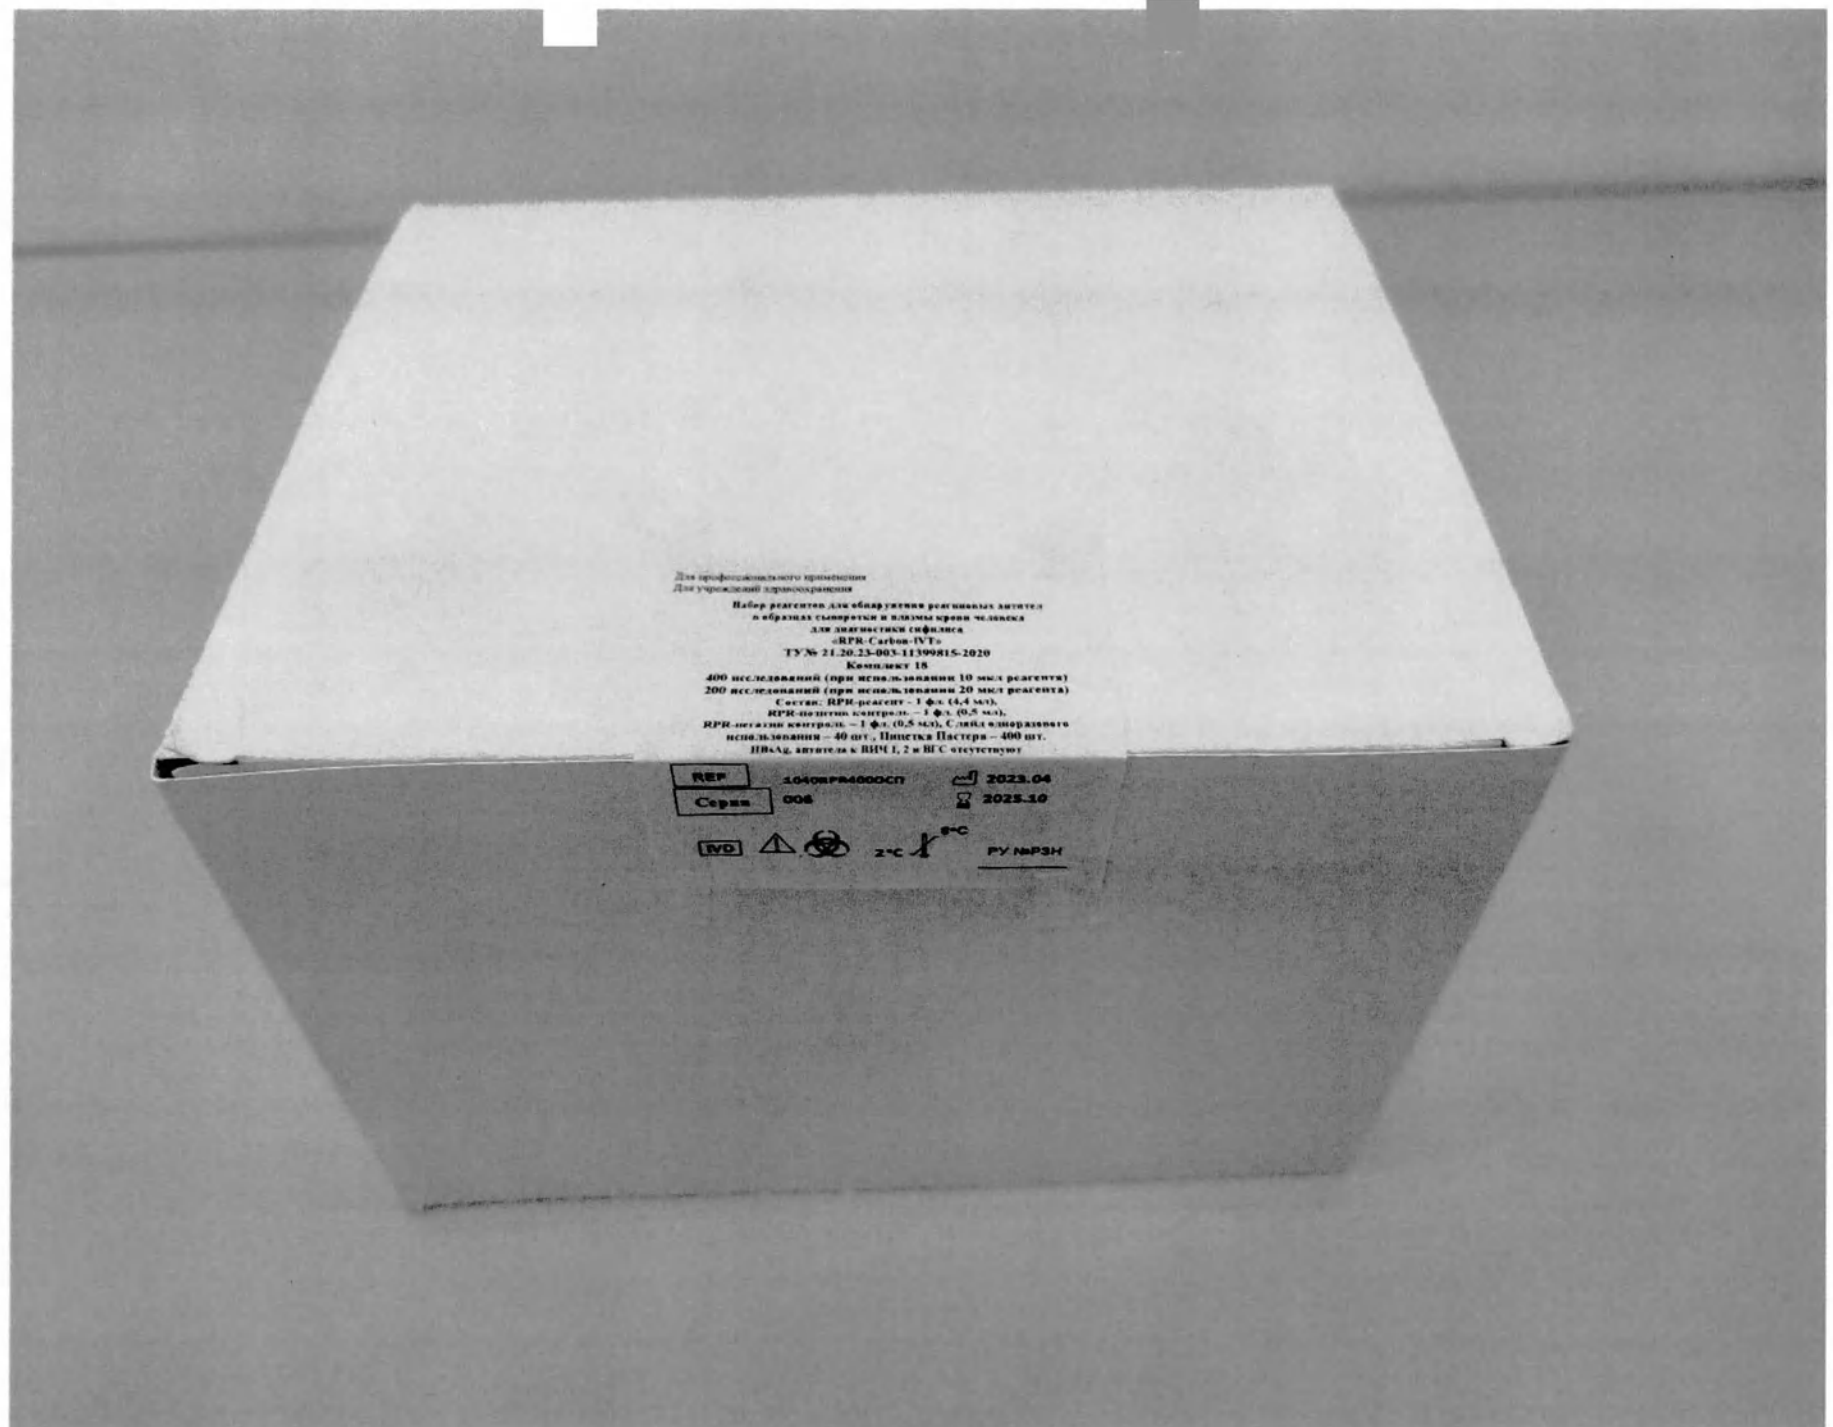

Комплект 18

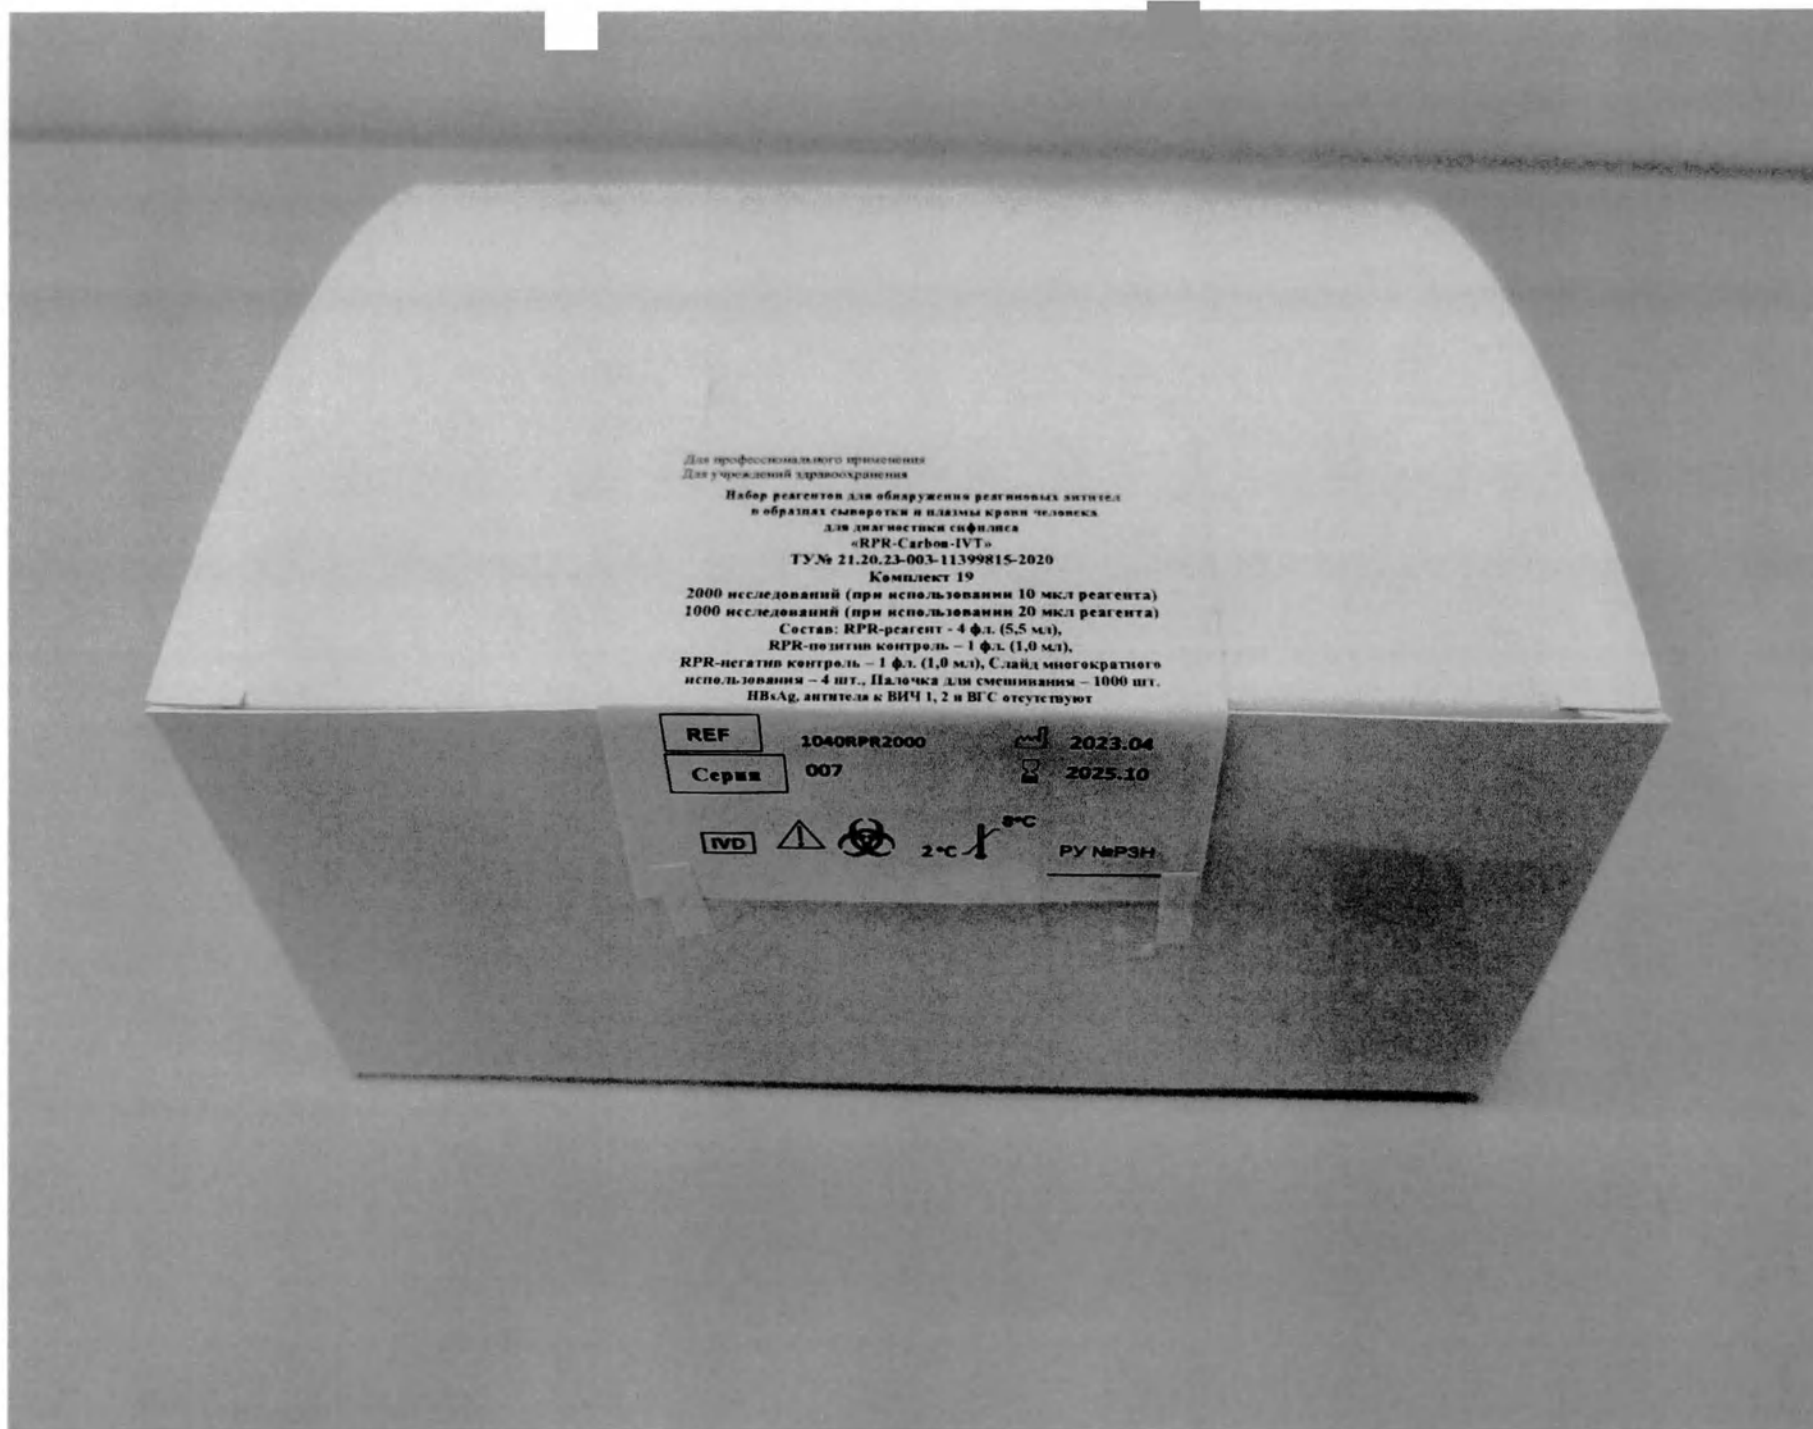

Комплект 19

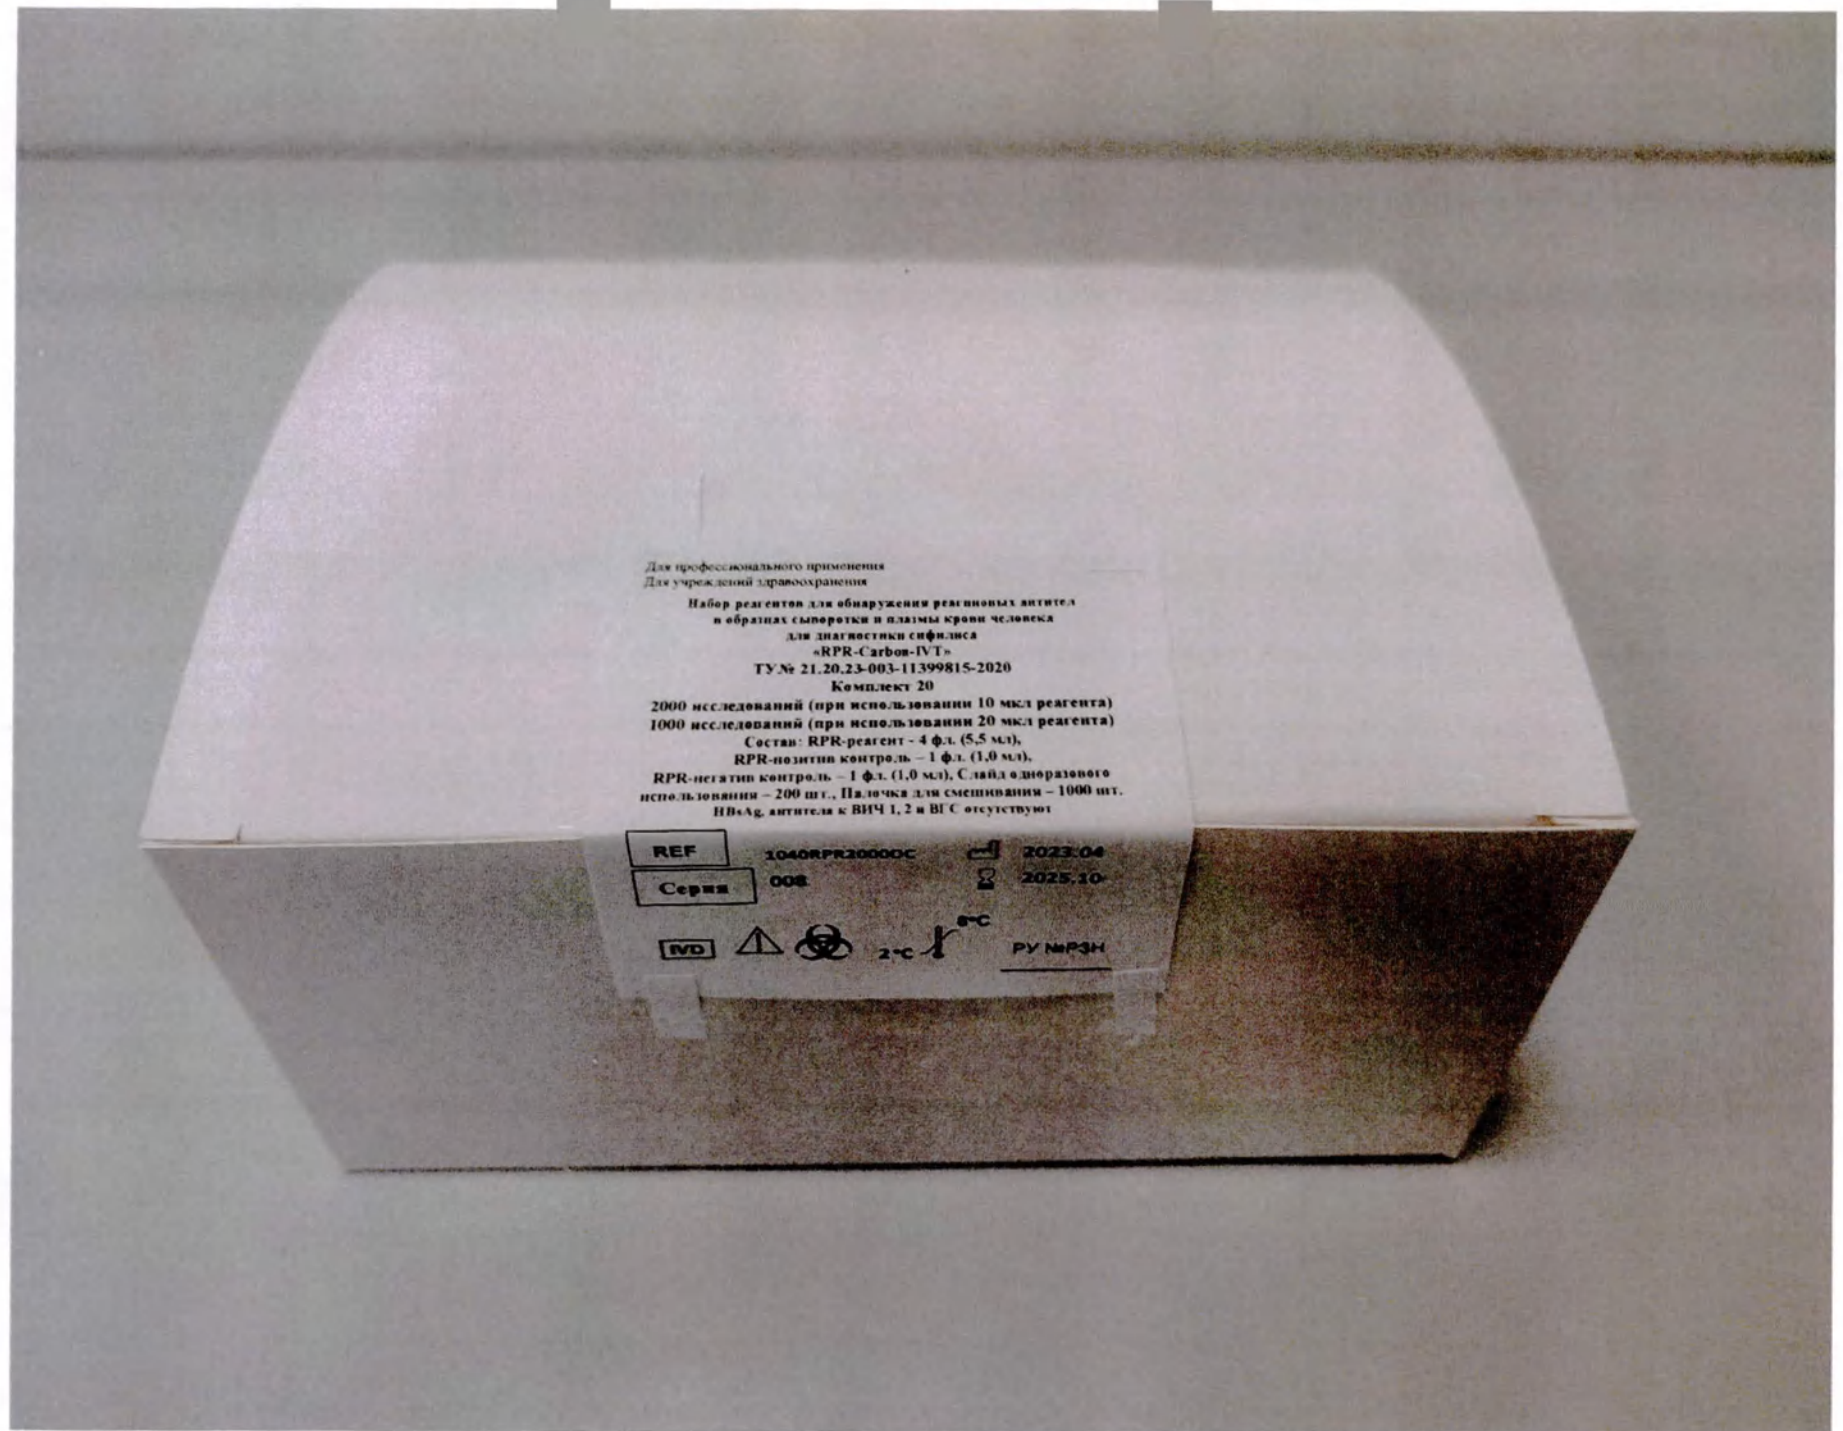

Комплект 20



ООО «ПрофиЛабТест»



117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13.



+7 495-19-0000-5



+7-985-57-2233-0



Info@expressm-test.ru




www.expressm-test.ru




 **ООО «ПрофиЛабТест»**
 117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13.

 +7 495-19-0000-5
 +7-985-57-2233-0

 info@expressm-test.ru
 www.expressm-test.ru



5. Макеты транспортной упаковки

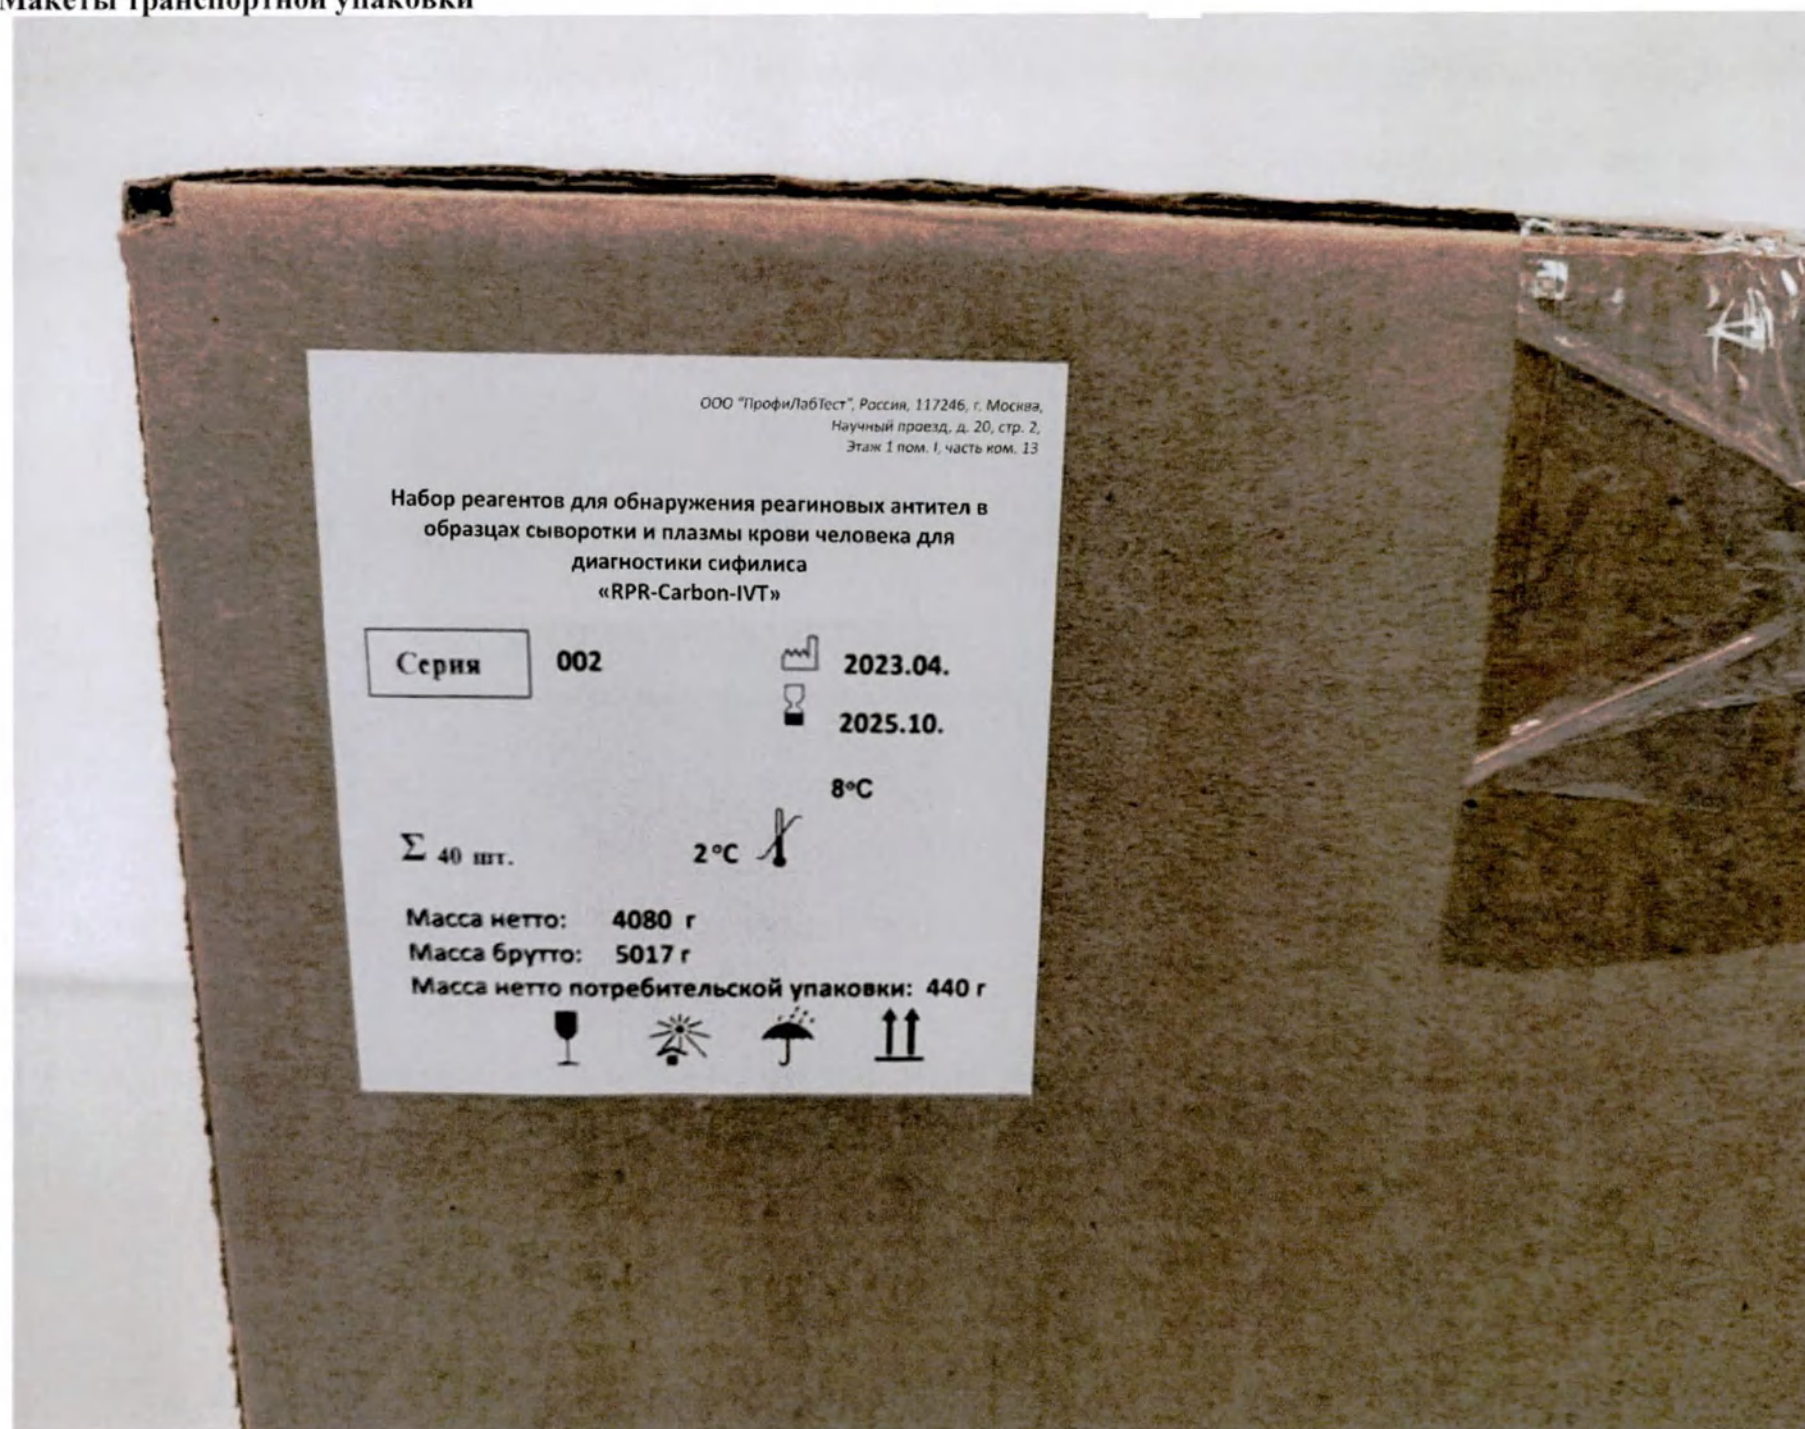



ООО "ПрофиЛабТест", Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 20, стр. 2,
Этаж 1 пом. I, часть ком. 13

Набор реагентов для обнаружения реактивных антител в
образцах сыворотки и плазмы крови человека для
диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»

Серия

002



2023.04.



2025.10.

8°C

Σ 2 шт.

2°C



Масса нетто: 204 г

Масса брутто: 576 г

Масса нетто потребительской упаковки: 22 г





ООО "ПрофиЛабТест", Россия, 117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 20, стр. 2,
Этаж 1 пом. 1, часть ком. 13

Набор реагентов для обнаружения реактивных антител в
образцах сыворотки и плазмы крови человека для
диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»

Серия

008



2023.04.



2025.10.

8°C

Σ 16 шт.

2°C



Масса нетто: 12640 г

Масса брутто: 15100 г

Масса нетто потребительской упаковки: 1360 г





скреплено печатью

77 ЛИСТ 26

Генеральный директор

ООО "ПрофиЛабТест"

Киреев А.И.



Юридический адрес:
117246, г. Москва, Пр-д Научный, д. 20 стр. 2,
этаж 1, пом I, часть ком 13
Почтовый адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
д. 28а
+7 (495) 190-00-05
info@expressm-test.ru
https://expressm-test.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛабТест»
ОГРН: 1157746600153 ИНН/КПП 7728277709/772801001

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПрофиЛабТест»

Киреев А.И.

« 06 » апреля 2023 г.

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для обнаружения реактивных антител в
образцах сыворотки и плазмы крови человека
для диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»
ТУ № 21.20.23-003-11399815-2020
Комплект _____
_____ исследований (при использовании 10 мкл реагента)
_____ исследований (при использовании 20 мкл реагента)

Состав: RPR-реагент - _____ фл. (_____ мл), RPR-позитив контроль - 1 фл.
(_____ мл).
RPR-негатив контроль - 1 фл. (_____ мл), Палочка для смешивания -
_____ шт., Слайд одноразового использования - _____ шт.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

REF 1040 _____ ГГГГ.ММ
Серия XXXX _____ ГГГГ.ММ
8°C
ПУ №РЗН
2°C

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для обнаружения реактивных антител в
образцах сыворотки и плазмы крови человека
для диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»
ТУ № 21.20.23-003-11399815-2020
Комплект _____
_____ исследований (при использовании 10 мкл реагента)
_____ исследований (при использовании 20 мкл реагента)

Состав: RPR-реагент - _____ фл. (_____ мл), RPR-позитив контроль - 1 фл.
(_____ мл).
RPR-негатив контроль - 1 фл. (_____ мл), Слайд одноразового
использования - _____ шт., Пипетка Пастера - _____ шт.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

REF 1040 _____ ГГГГ.ММ
Серия XXXX _____ ГГГГ.ММ
8°C
ПУ №РЗН
2°C

Для профессионального применения
Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов для обнаружения реактивных антител в
образцах сыворотки и плазмы крови человека
для диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»

ТУ № 21.20.23-003-11399815-2020

Комплект _____


_____ исследований (при использовании 10 мкл реагента)

_____ исследований (при использовании 20 мкл реагента)

Состав: RPR-реагент - _____ фл. (_____ мл), RPR-позитив контроль - 1 фл. (_____ мл),


RPR-негатив контроль - 1 фл. (_____ мл), Слайд многократного использования - _____ шт., Палочка для смешивания - _____ шт.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

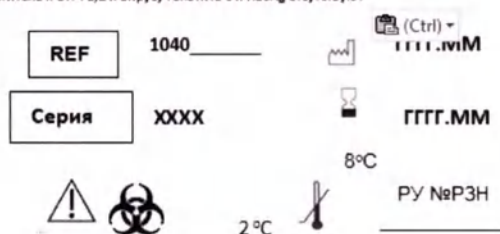


ООО «ПрофиЛабТест»
«RPR-Carbon-IVT»

RPR-негатив контроль




ООО «ПрофиЛабТест»
«RPR-Carbon-IVT»

RPR-позитив контроль

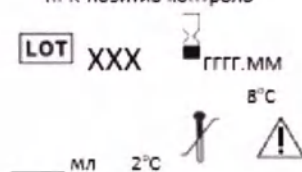

ООО «ПрофиЛабТест»
«RPR-Carbon-IVT»


RPR-реагент

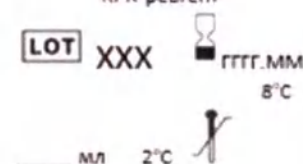

Макет транспортной упаковки

ООО «ПрофиЛабТест», Россия, 117246, Москва,
Научный проезд, д. 20, стр. 2,
Этаж 1 пом. I, часть ком. 13.


Набор реагентов для обнаружения реактивных антител в
образцах сыворотки и плазмы крови человека для
диагностики сифилиса
«RPR-Carbon-IVT»

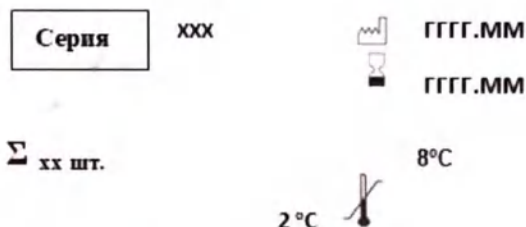

Масса нетто: XXXX г

Масса брутто: XXXX г

Масса потребительской упаковки: XXXX г



Наименование предприятия-изготовителя, контакты, знаки «только для in vitro диагностики» и «обратитесь к инструкции по применению» указаны на этикетке:



ООО «ПрофиЛабТест»



117246, г. Москва, Научный проезд,
д. 20 стр. 2, этаж 1 пом I часть ком 13.



+7 495-19-0000-5



+7-985-57-2233-0



info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



Начальник производства

Начальник отдела контроля качества



Н.Н. Зубкова


С.А. Зуева

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью

5 лист

Генеральный директор
ООО "ПрофиЛабТест"



 Киреев А.И.