



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**«Материал керамический для изготовления стоматологических реставраций методом
фрезерования IPS e.max ZirCAD»,
производства: Ivoclar Vivadent AG, Лихтенштейн**


1. Диск для фрезерования IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic, Ø 98.5 мм, толщина 14 мм, цвет A2

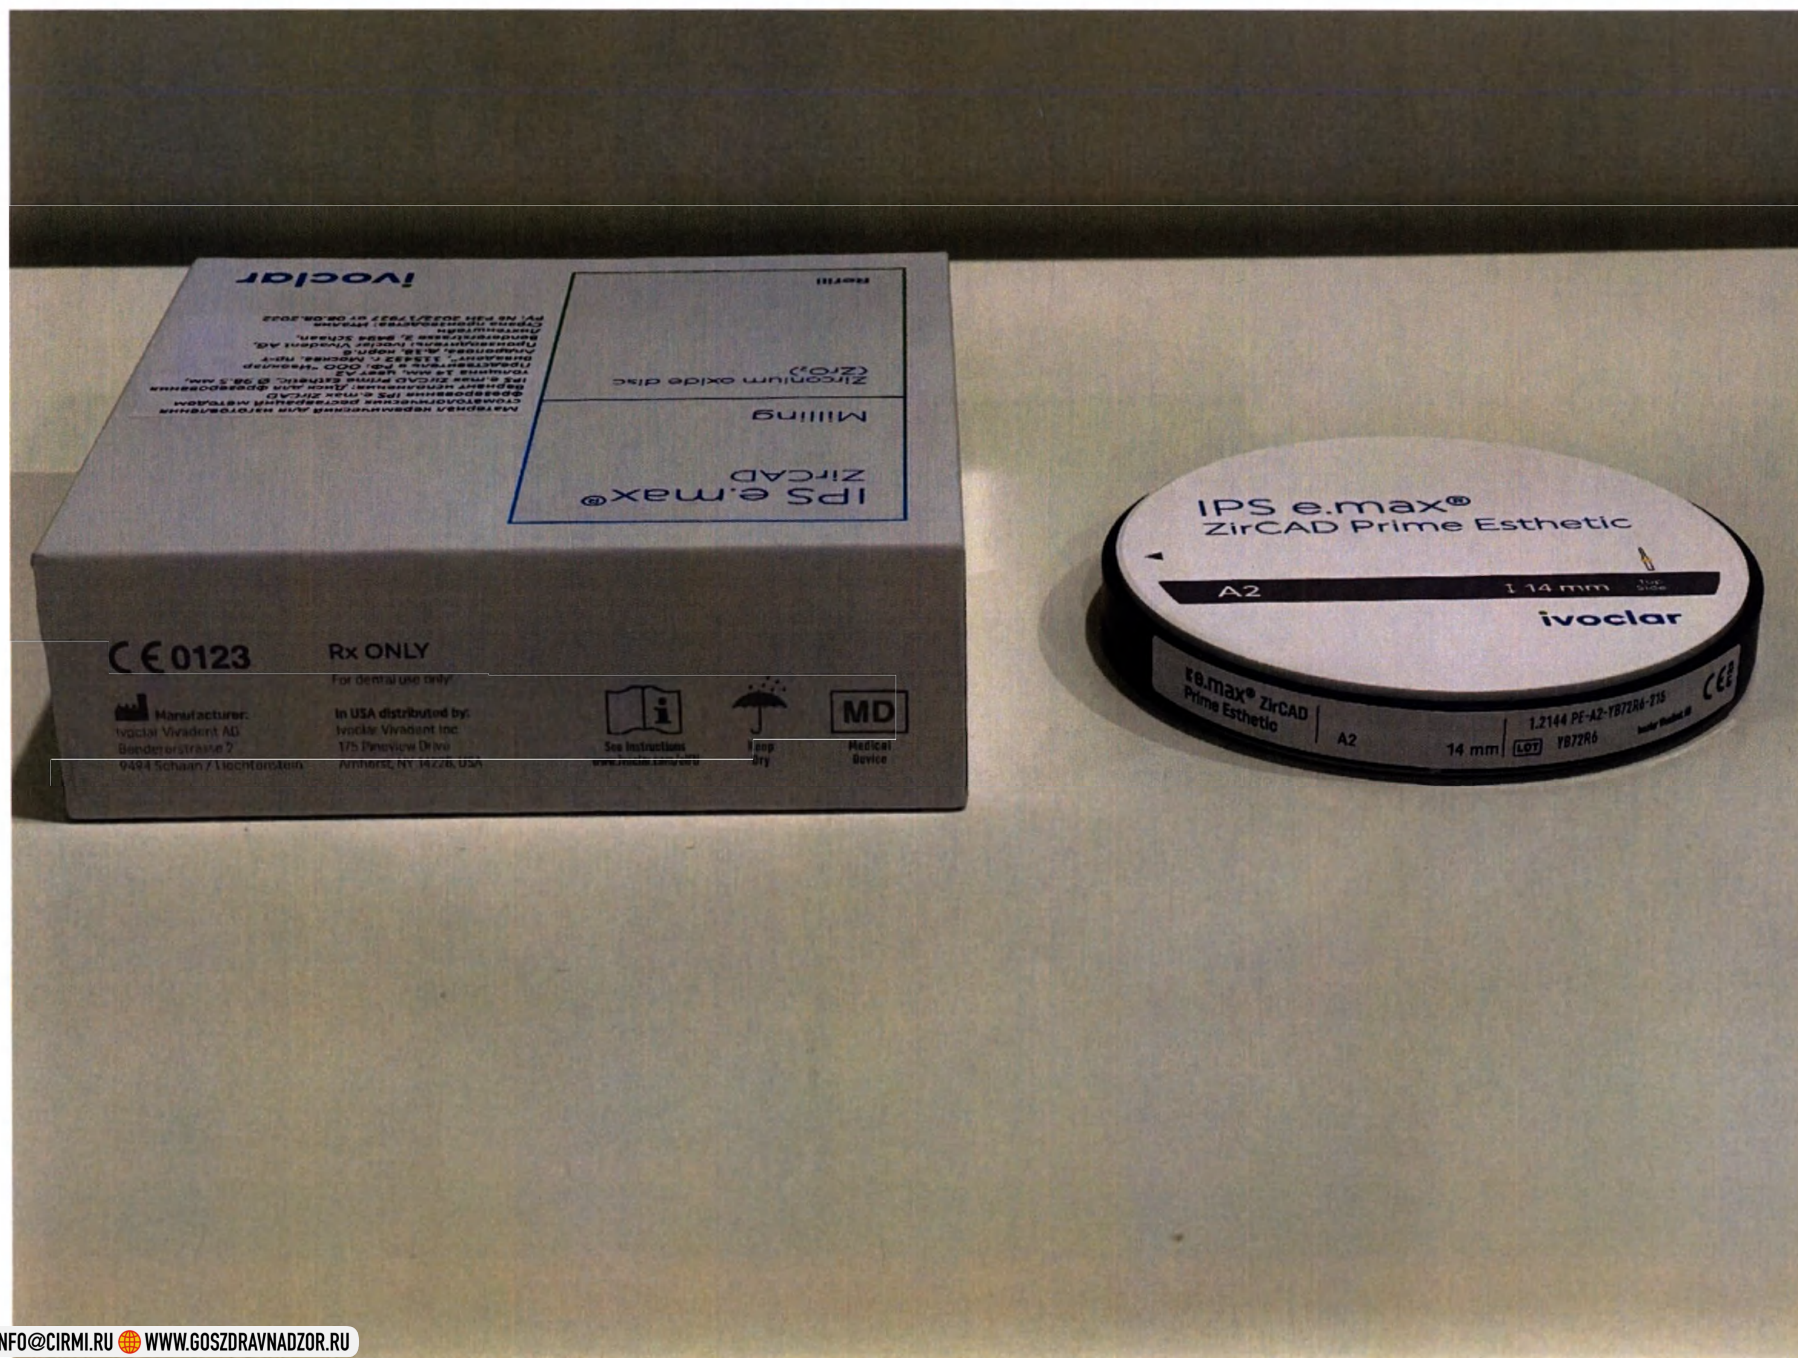


2. Диск для фрезерования IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic, Ø 98.5 мм, толщина 16 мм, цвет A3

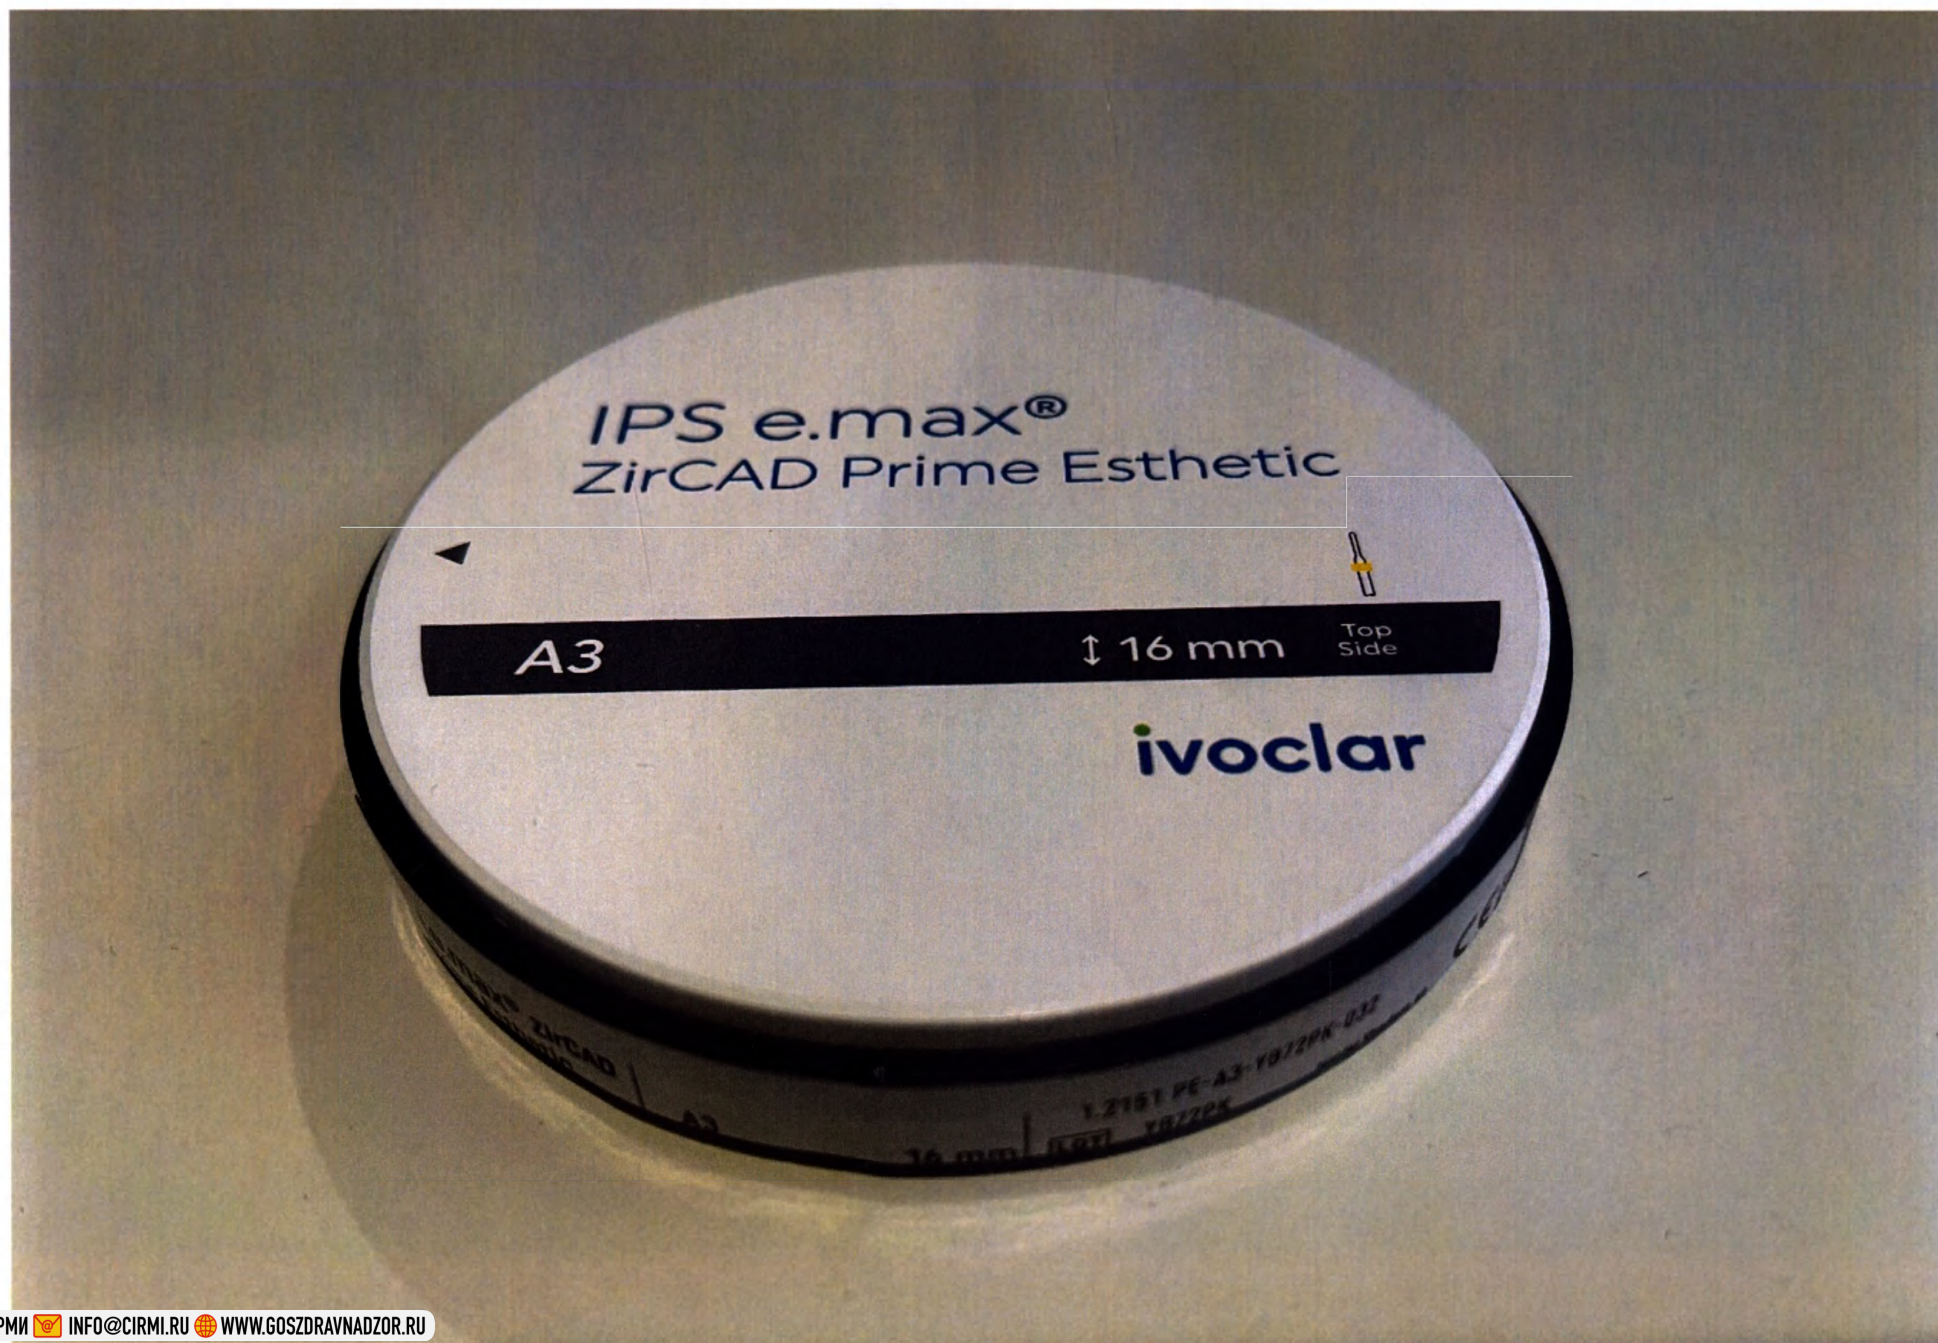

3. Диск для фрезерования IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic, Ø 98.5 мм, толщина 16 мм, цвет A3 (упаковка)

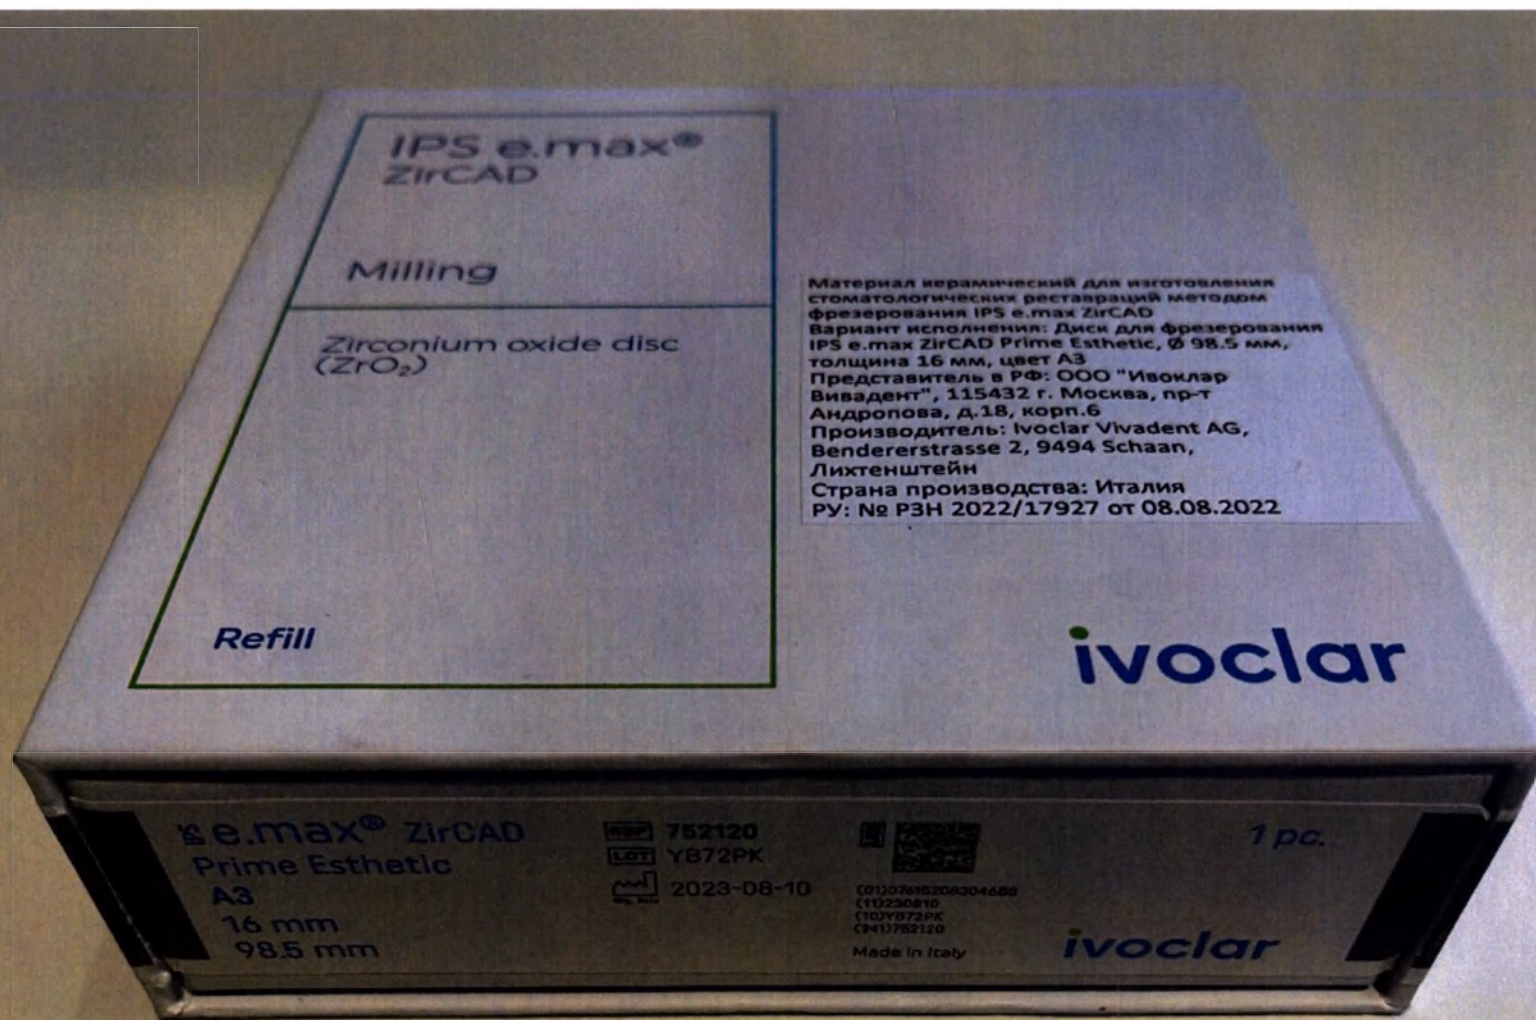

4. Диск для фрезерования IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic, Ø 98.5 мм, толщина 20 мм, цвет B1

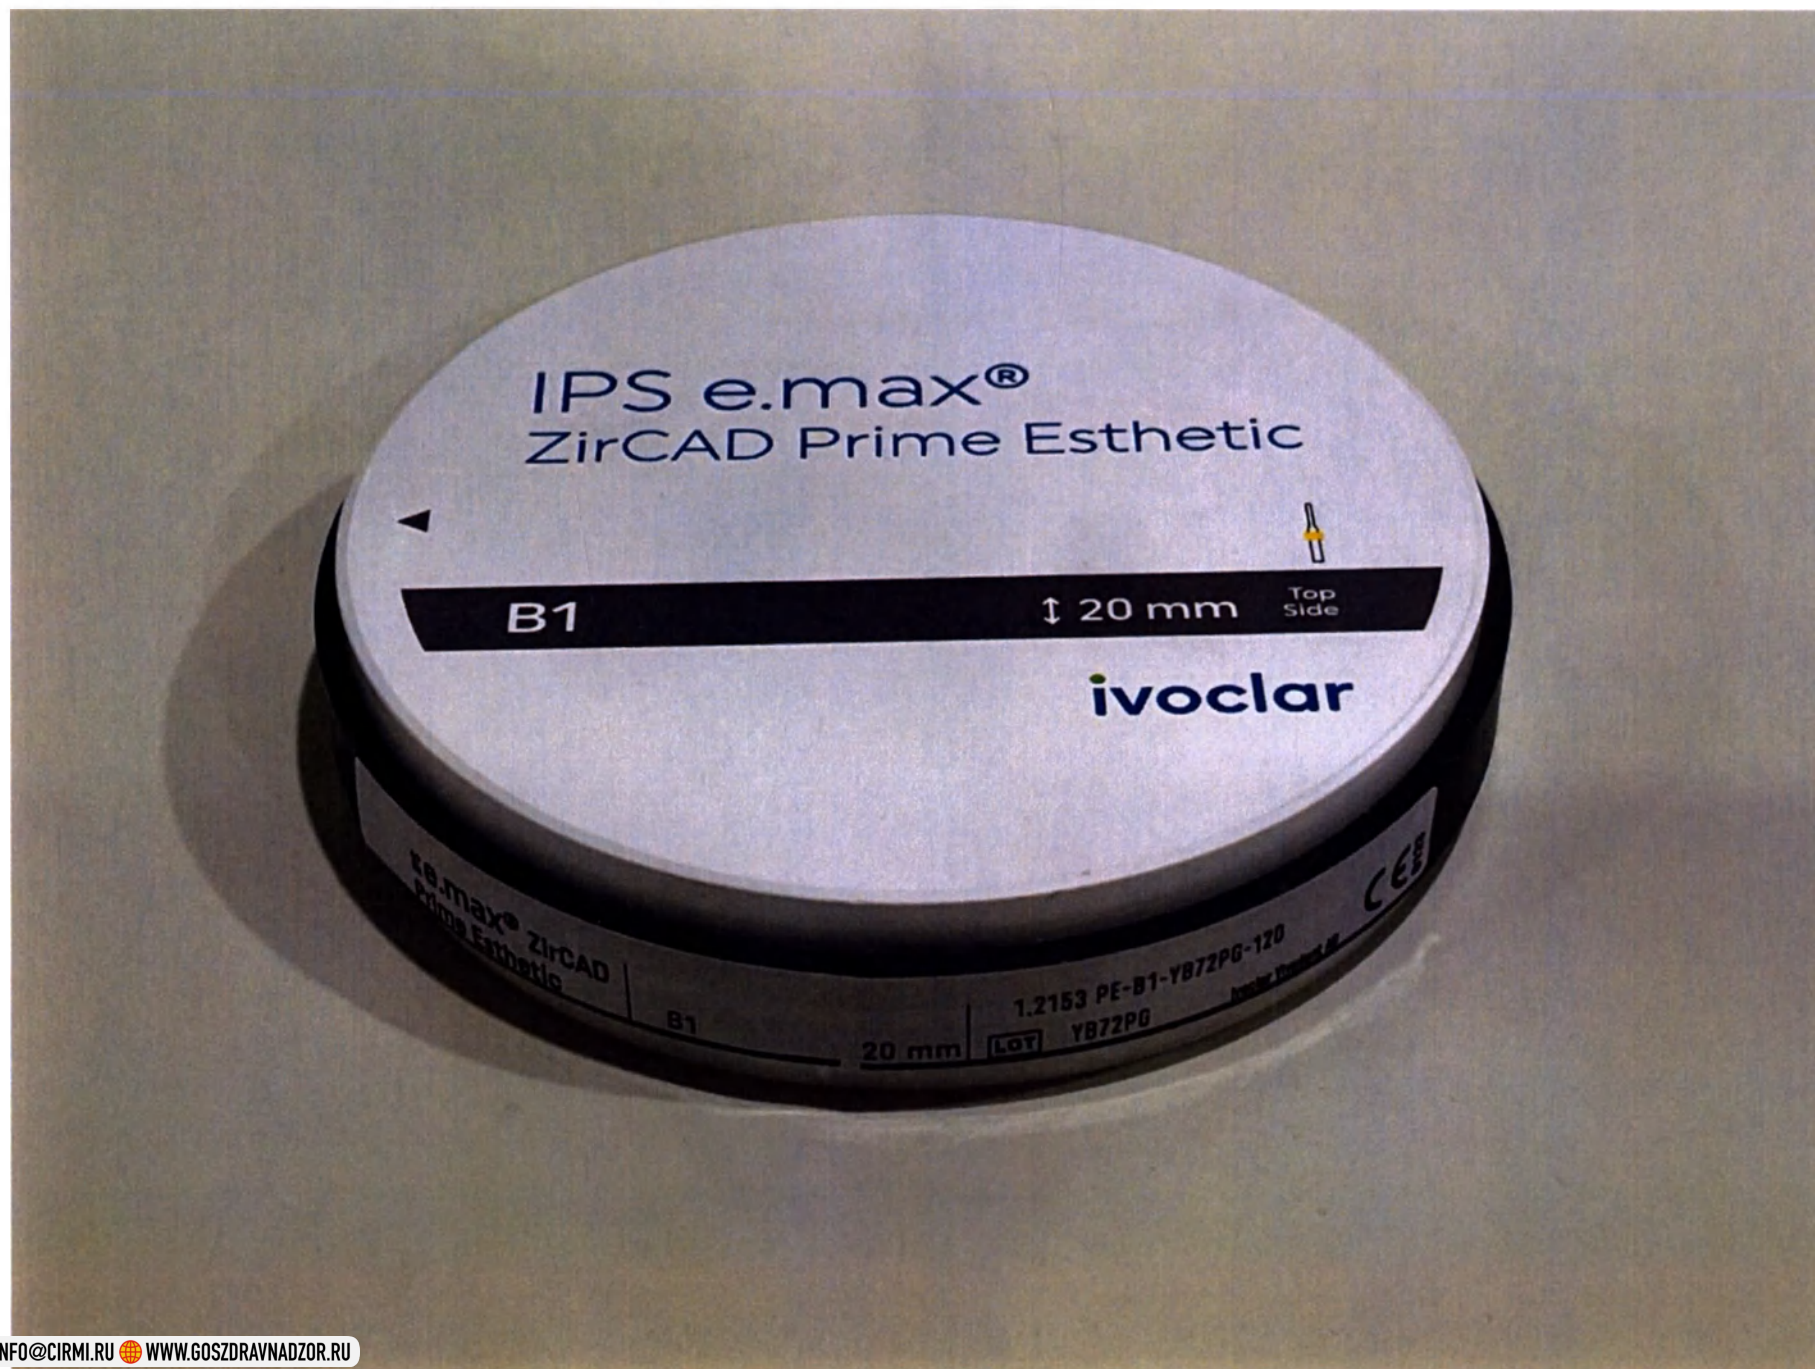

5. Диск для фрезерования IPS e.max ZirCAD LT, Ø 98.5 мм, толщина 25 мм, цвет C1



6. Диск для фрезерования IPS e.max ZirCAD LT, Ø 98.5 мм, толщина 25 мм, цвет C1



Пронумеровано, прошито, скреплено печатью 7 листов

ООО Ивоклар Вивадент

28/12/2023

Штефан Ульманн
Генеральный директор

