

**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия и принадлежностей
«Система скрининговая «QSight 225MD UHPLC Screening System» для проведения
исследований in vitro на клинических образцах методом масс-спектрометрической
идентификации аналитов с применением тандемной масс-спектрометрии и ультра
высокоэффективной жидкостной хроматографии»**

Официальный производитель:

«Валлак Ою» (Wallac Oy)
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland
(Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)
Тел: 358-(0)2-267 8111
Факс: 358-(0)2-267 8357

Наименование и адрес места производства:

«Валлак Ою» (Wallac Oy),
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland
(Мустионкату 6, FI-20750, Турку, Финляндия)

Уполномоченный представитель в ЕАЭС:

Акционерное общество «ПРИБОРЫ»
109028, г. Москва, Певческий переулок, дом 4, строение 1, помещение I, комната 10
Телефон/факс: 8 (495) 937-45-94/ 8 (495) 937-45-92
Адрес электронной почты: info@pribori.com

Утверждено:


Полное имя: Ефимов Леонид Николаевич
Должность: Генеральный директор
Компания: Акционерное общество «ПРИБОРЫ»
Подпись:
Дата:
Печать:



1. Масс-спектрометр QSight 225 MD (QSight 225 MD Mass spectrometer)



1. Масс-спектрометр QSight 225 MD (QSight 225 MD Mass spectrometer)

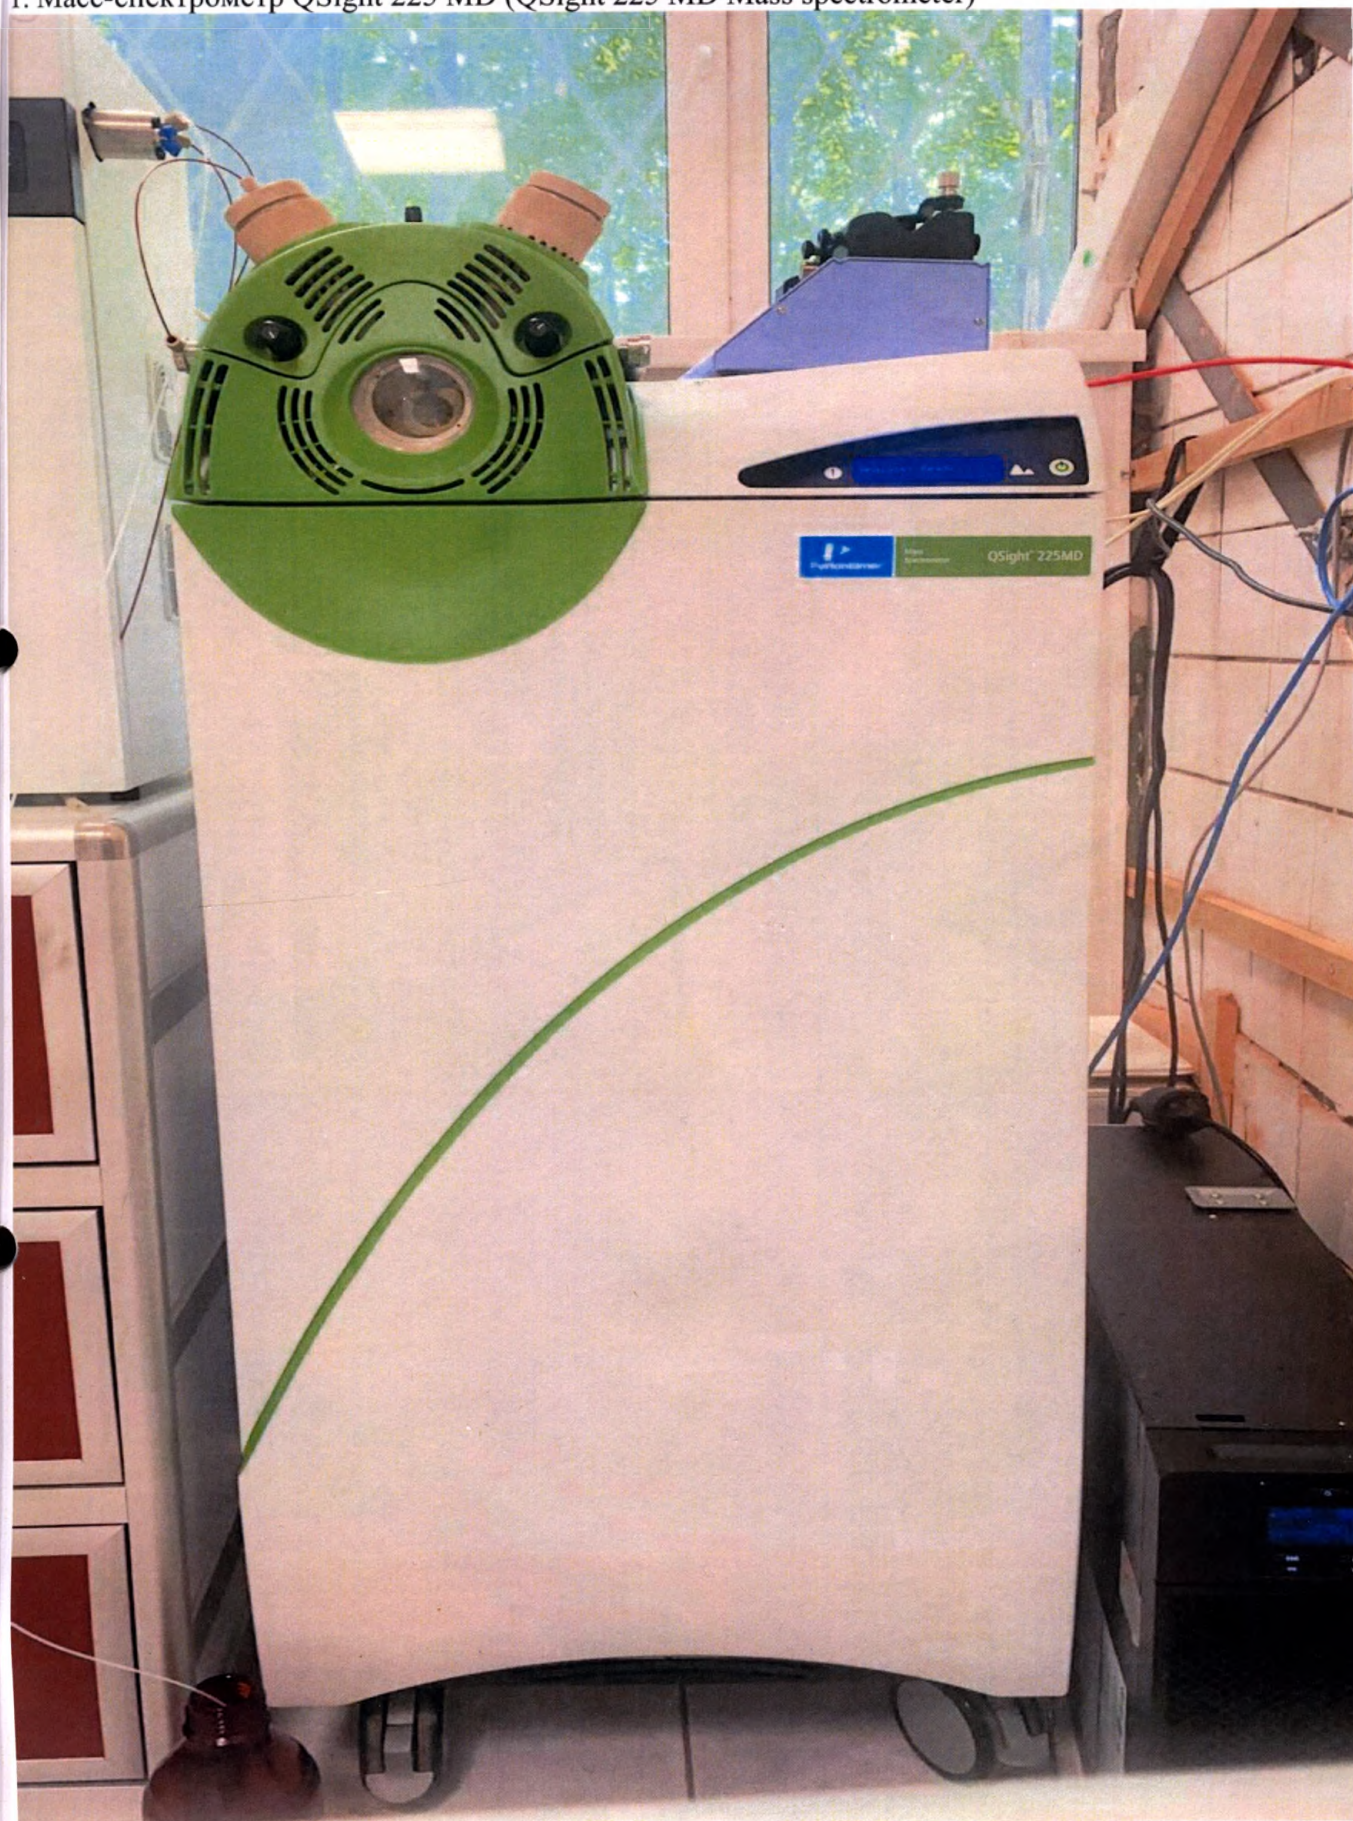

QSight 225 MD

2041-0030

Mass Spectrometer

SERIAL NO.

20410016

Manufacturer: Wallac Oy, Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finland



Warning

Equipment needs be de-energized for 60 seconds to allow safe discharging of capacitors.



190-240V 50/60Hz 12A

DO NOT OPEN
RETURN FOR SERVICE

NE PAS OUVRIR
RETOURNER POUR
RÉPARATION



WARNING

NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED
PERKINELMER PERSONNEL

ATTENTION

LES COMPOSANTS À L'INTÉRIEUR NE PEUVENT
PAS ÊTRE RÉPARÉS PAR LES UTILISATEURS
CONSULTER LE PERSONNEL QUALIFIÉ DE
PERKINELMER

AC Distribution Box

P/N: 04617

USER WARNING

INSTRUMENT TO BE
OPENED BY QUALIFIED
PERKINELMER
PERSONNEL ONLY

AVERTISSEMENT À L'UTILISATEUR

INSTRUMENT À OUVRIR
UNIQUEMENT PAR DU
PERSONNEL QUALIFIÉ
DE PERKINELMER


2. Автосемплер для УВЭЖХ QSight MD (QSight MD UHPLC Autosampler)



2. Автосемплер для УВЭЖХ QSight MD (QSight MD UHPLC Autosampler)




2. Автосемплер для УВЭЖХ QSight MD (QSight MD UHPLC Autosampler)

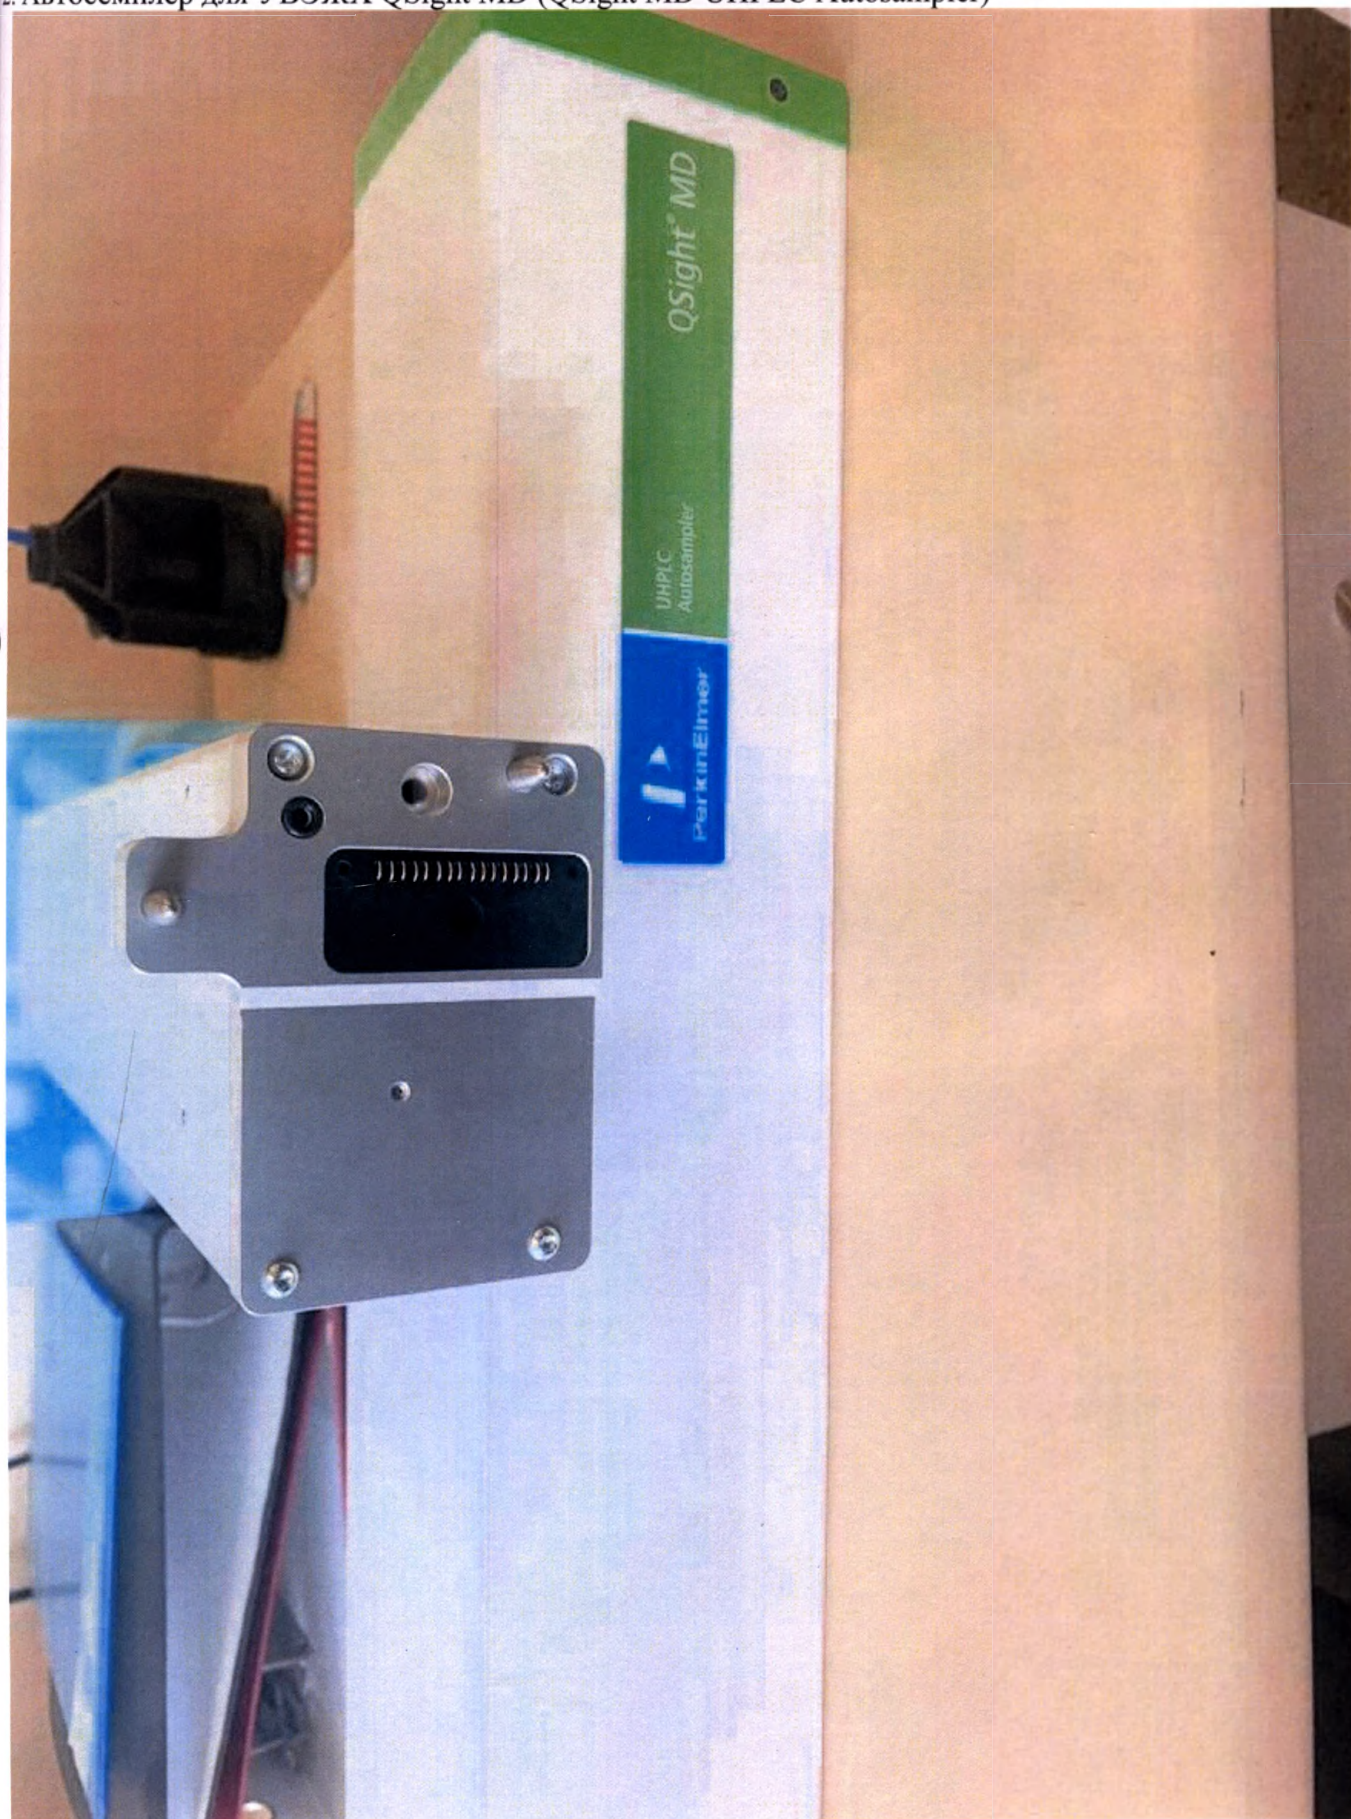

2. Автосемплер для УВЭЖХ QSight MD (QSight MD UHPLC Autosampler)



2. Автосемплер для УВЭЖХ QSight MD (QSight MD UHPLC Autosampler)

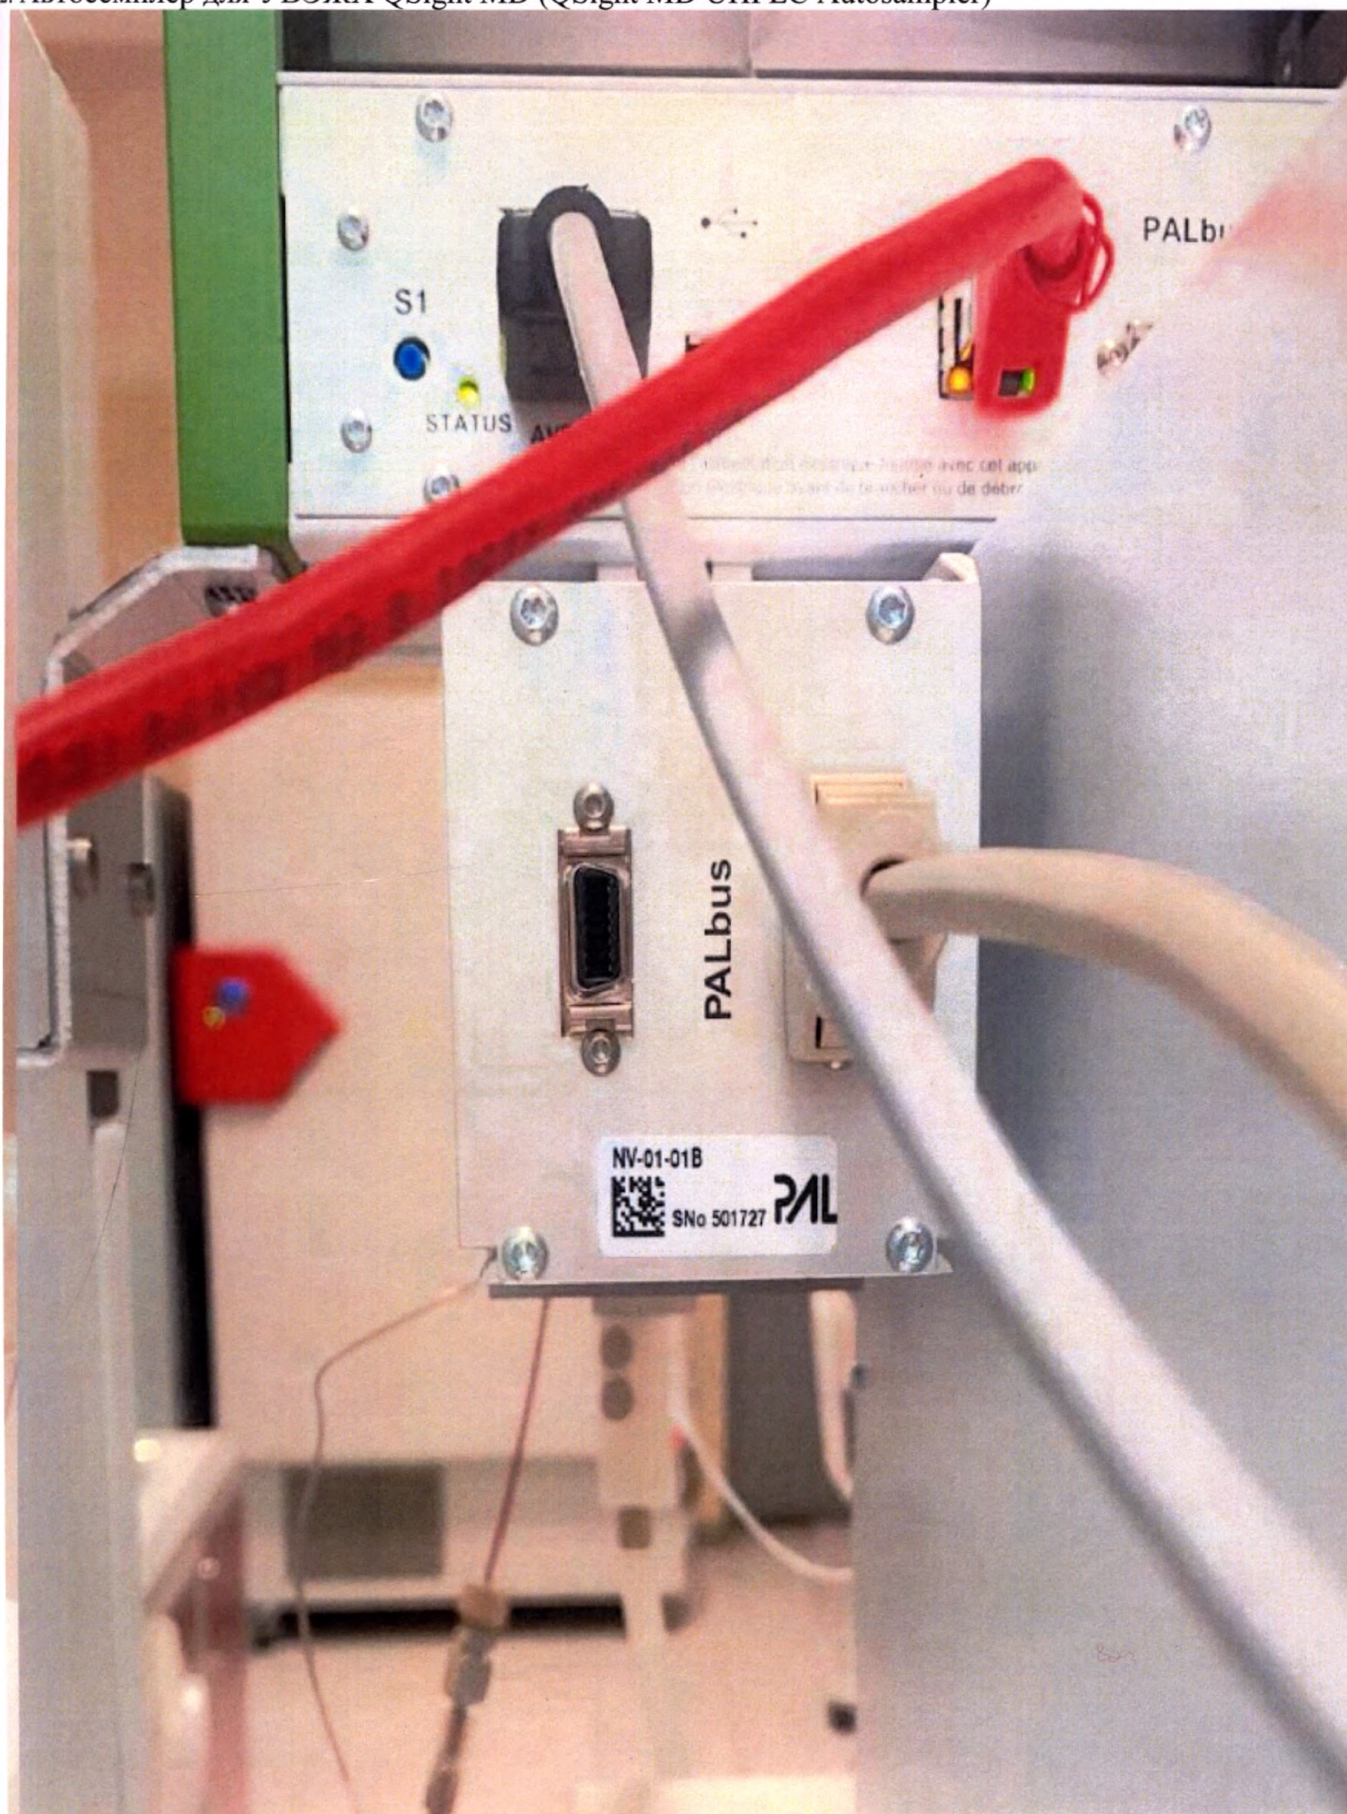

3. Насос для УВЭЖХ QSight 225 MD (QSight MD UHPLC Pump)



3. Настройка YB3XKX QSight 225 MD (QSight MD UHPLC Pump)



QSight MD UHPLC Pump



PerkinElmer

QSight 225 MD UHPLC Screening System

REF


11700161

SN

210072



100-240V~ 450VA 50/60HZ

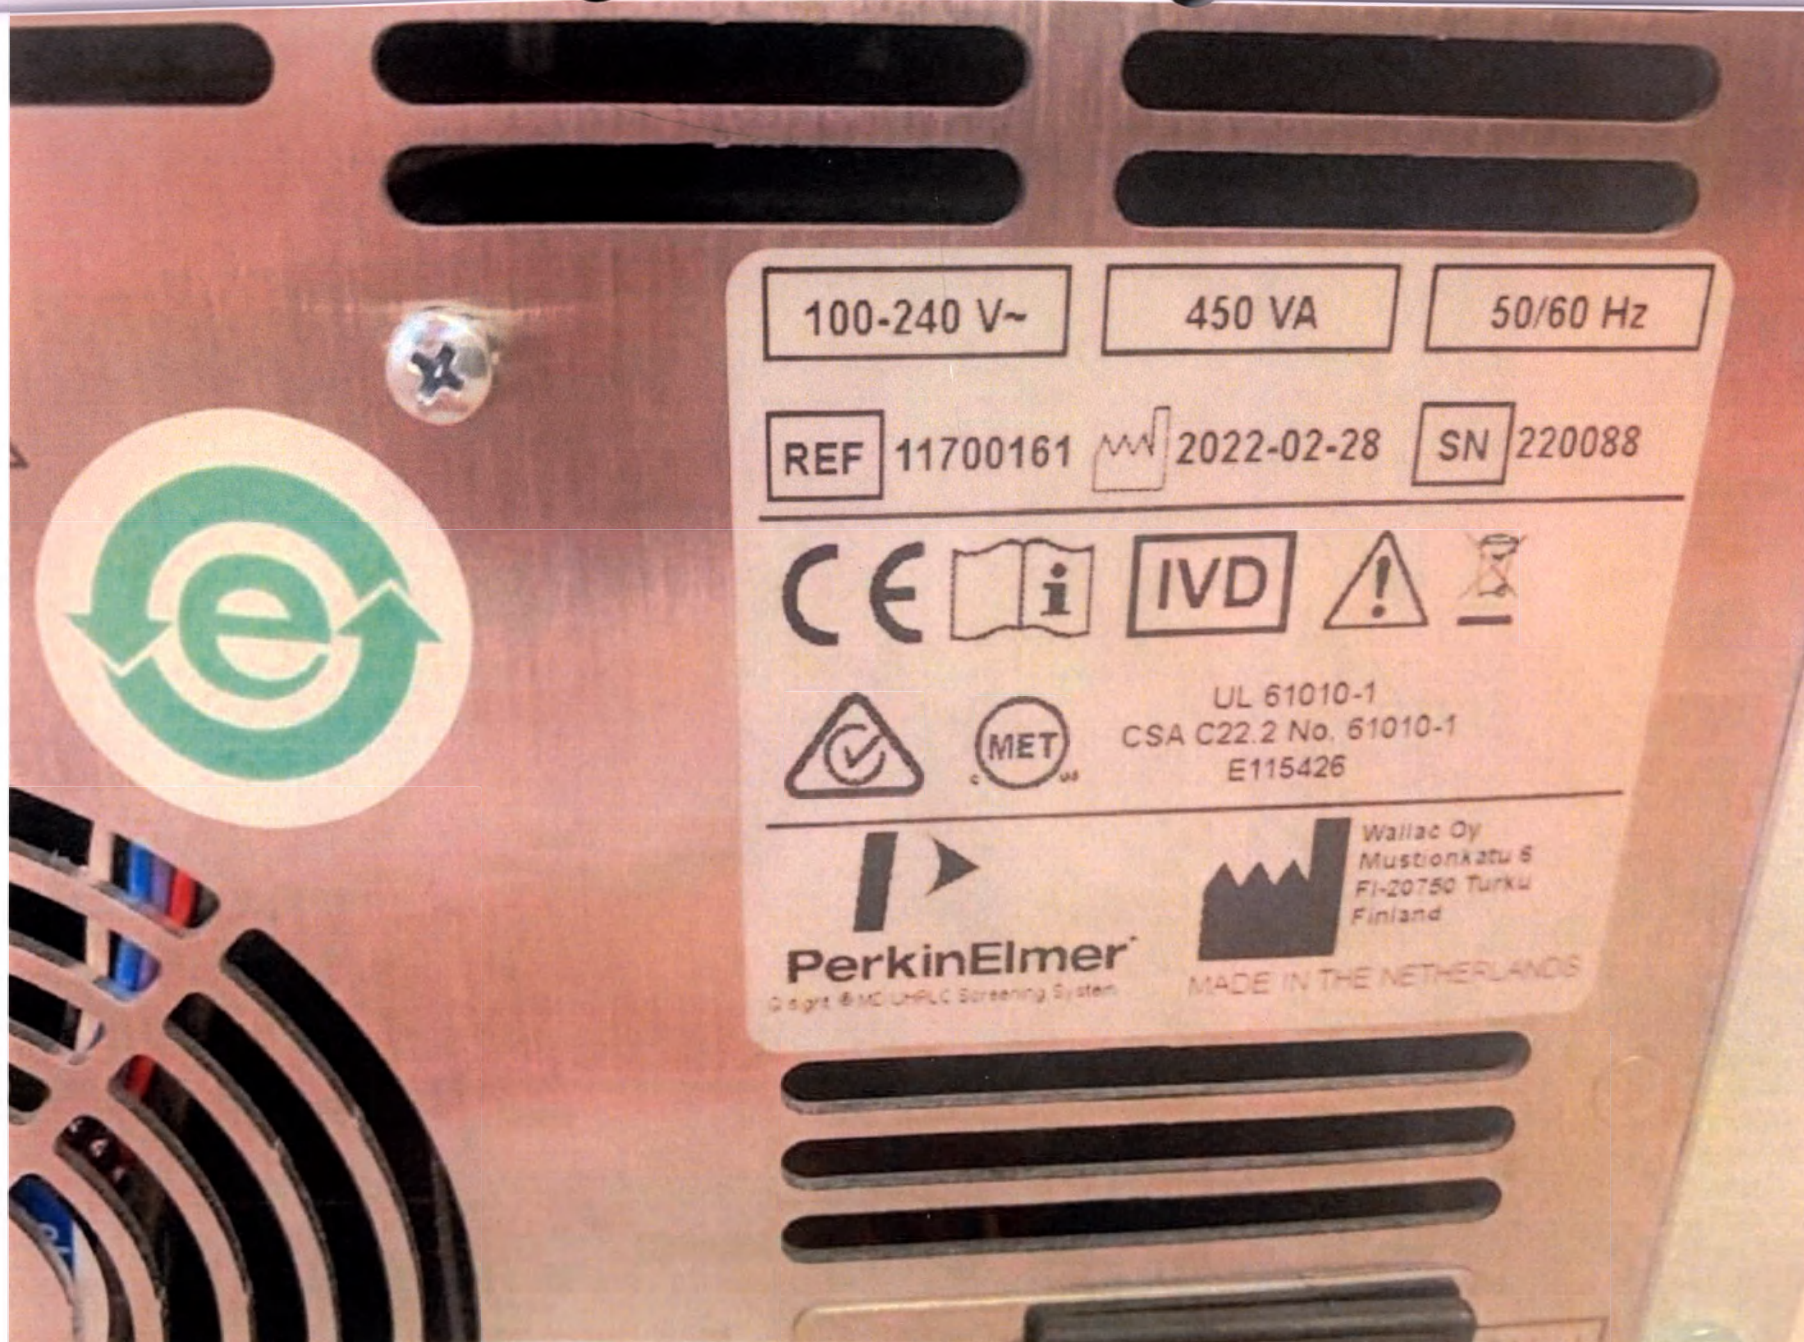

4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD)




4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD)




4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD)




4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD). Маркировка

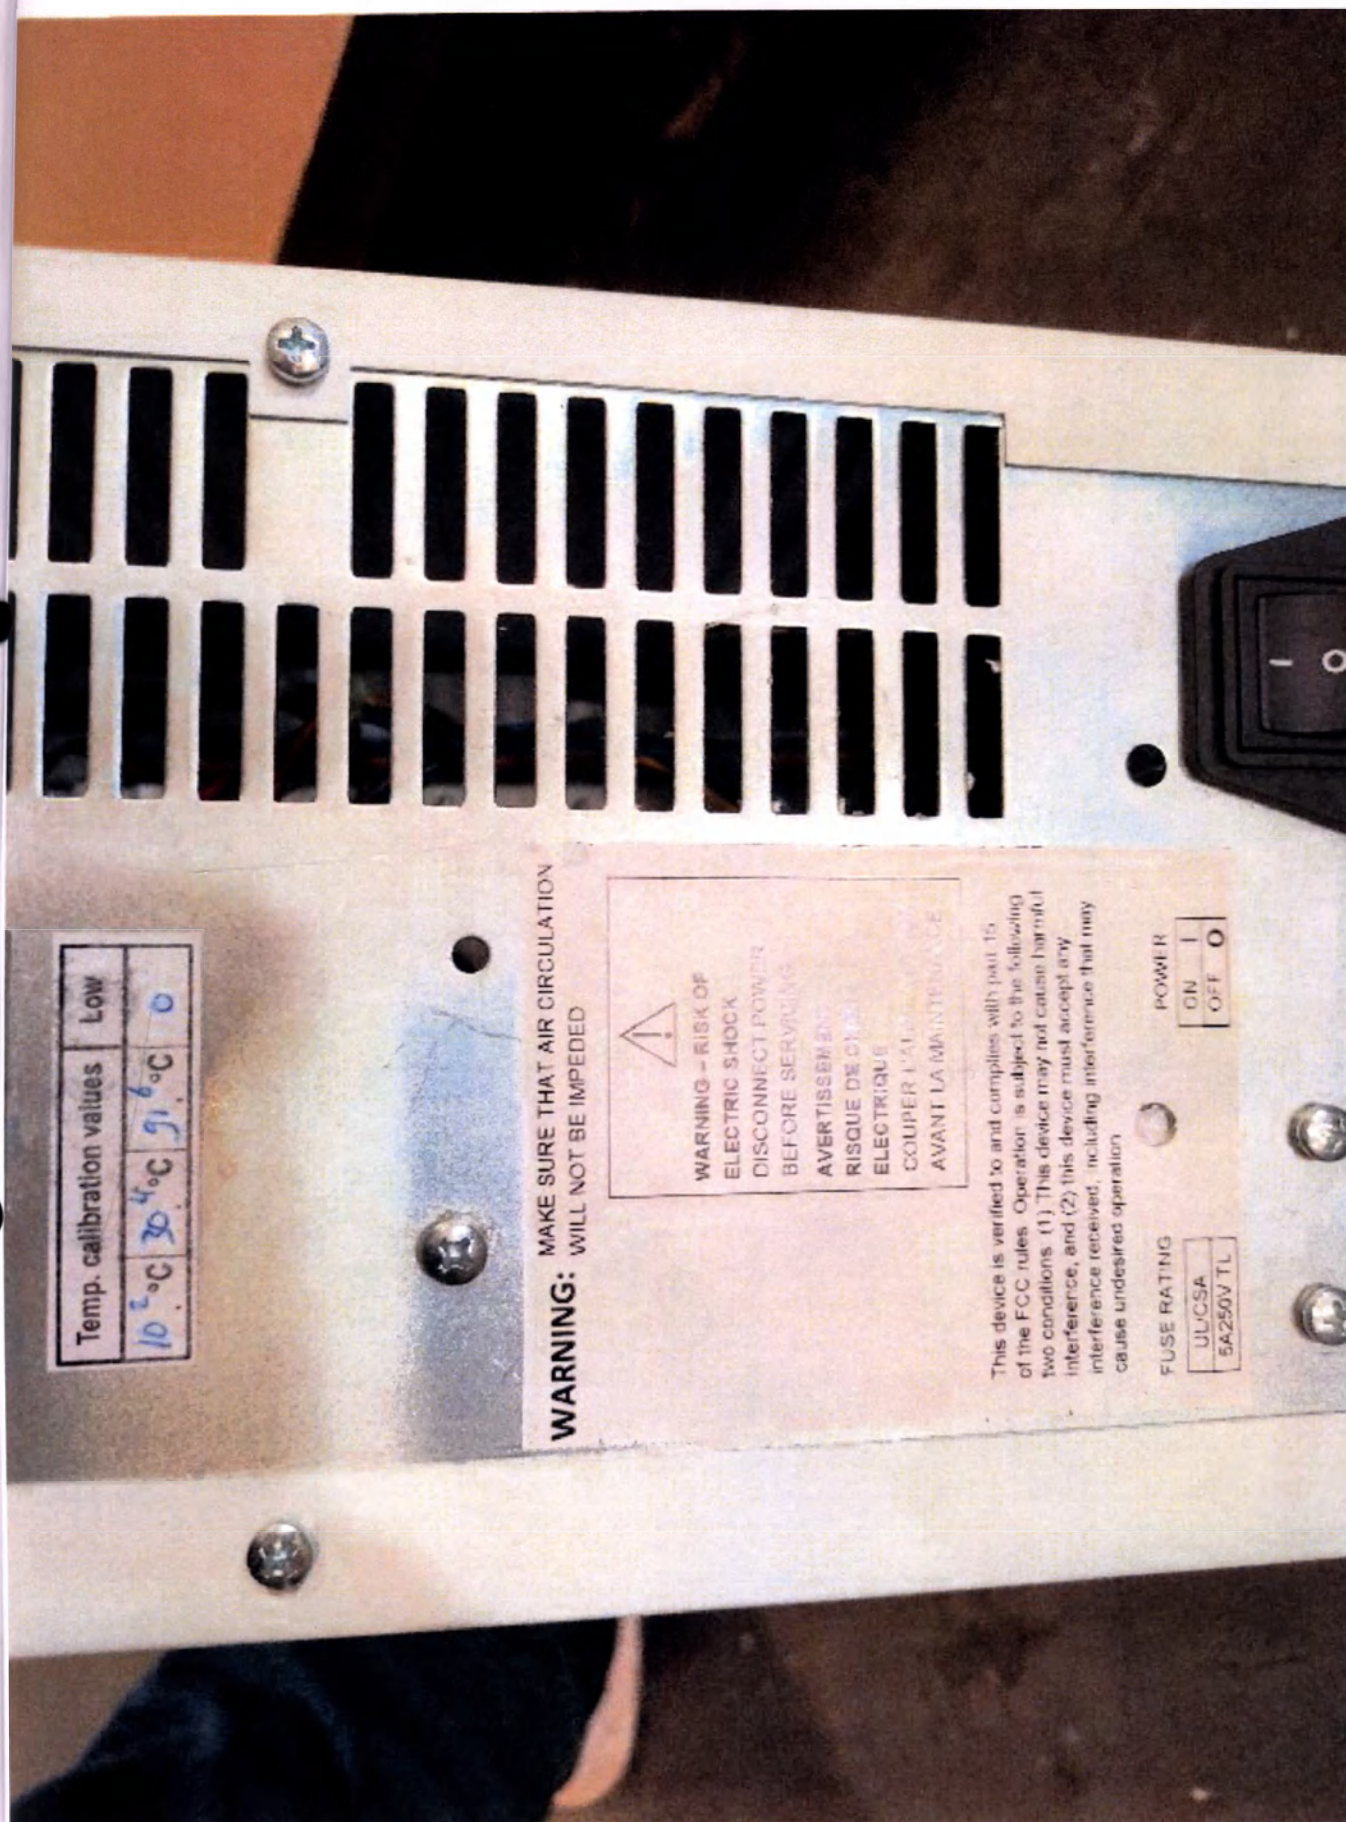

4. Колоночный термостат QSight MD (QSight Column Oven MD). Маркировка

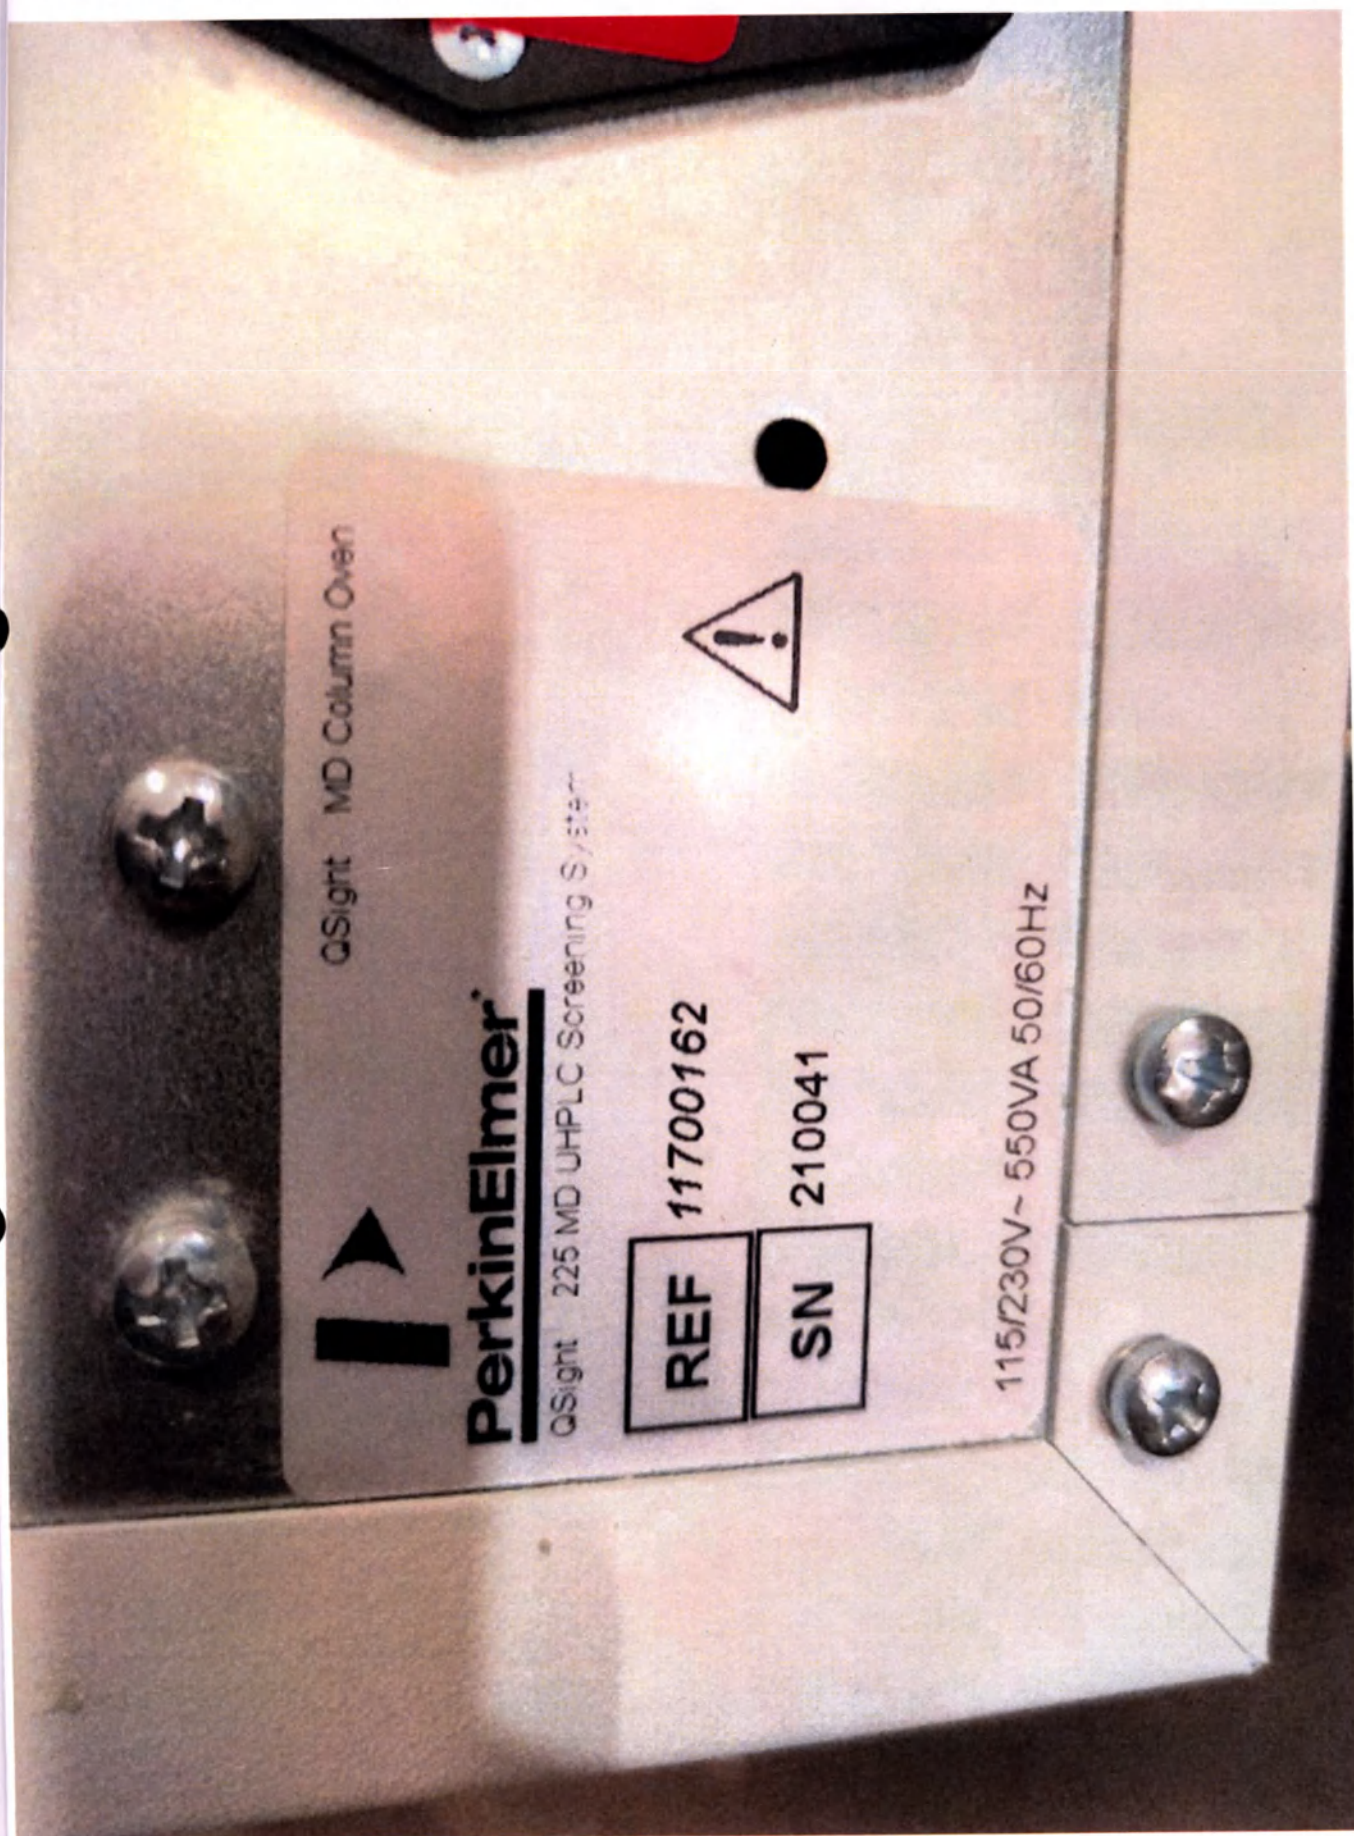

4. Колоночный термостат Qsight MD (Qsight Column Oven MD). Маркировка

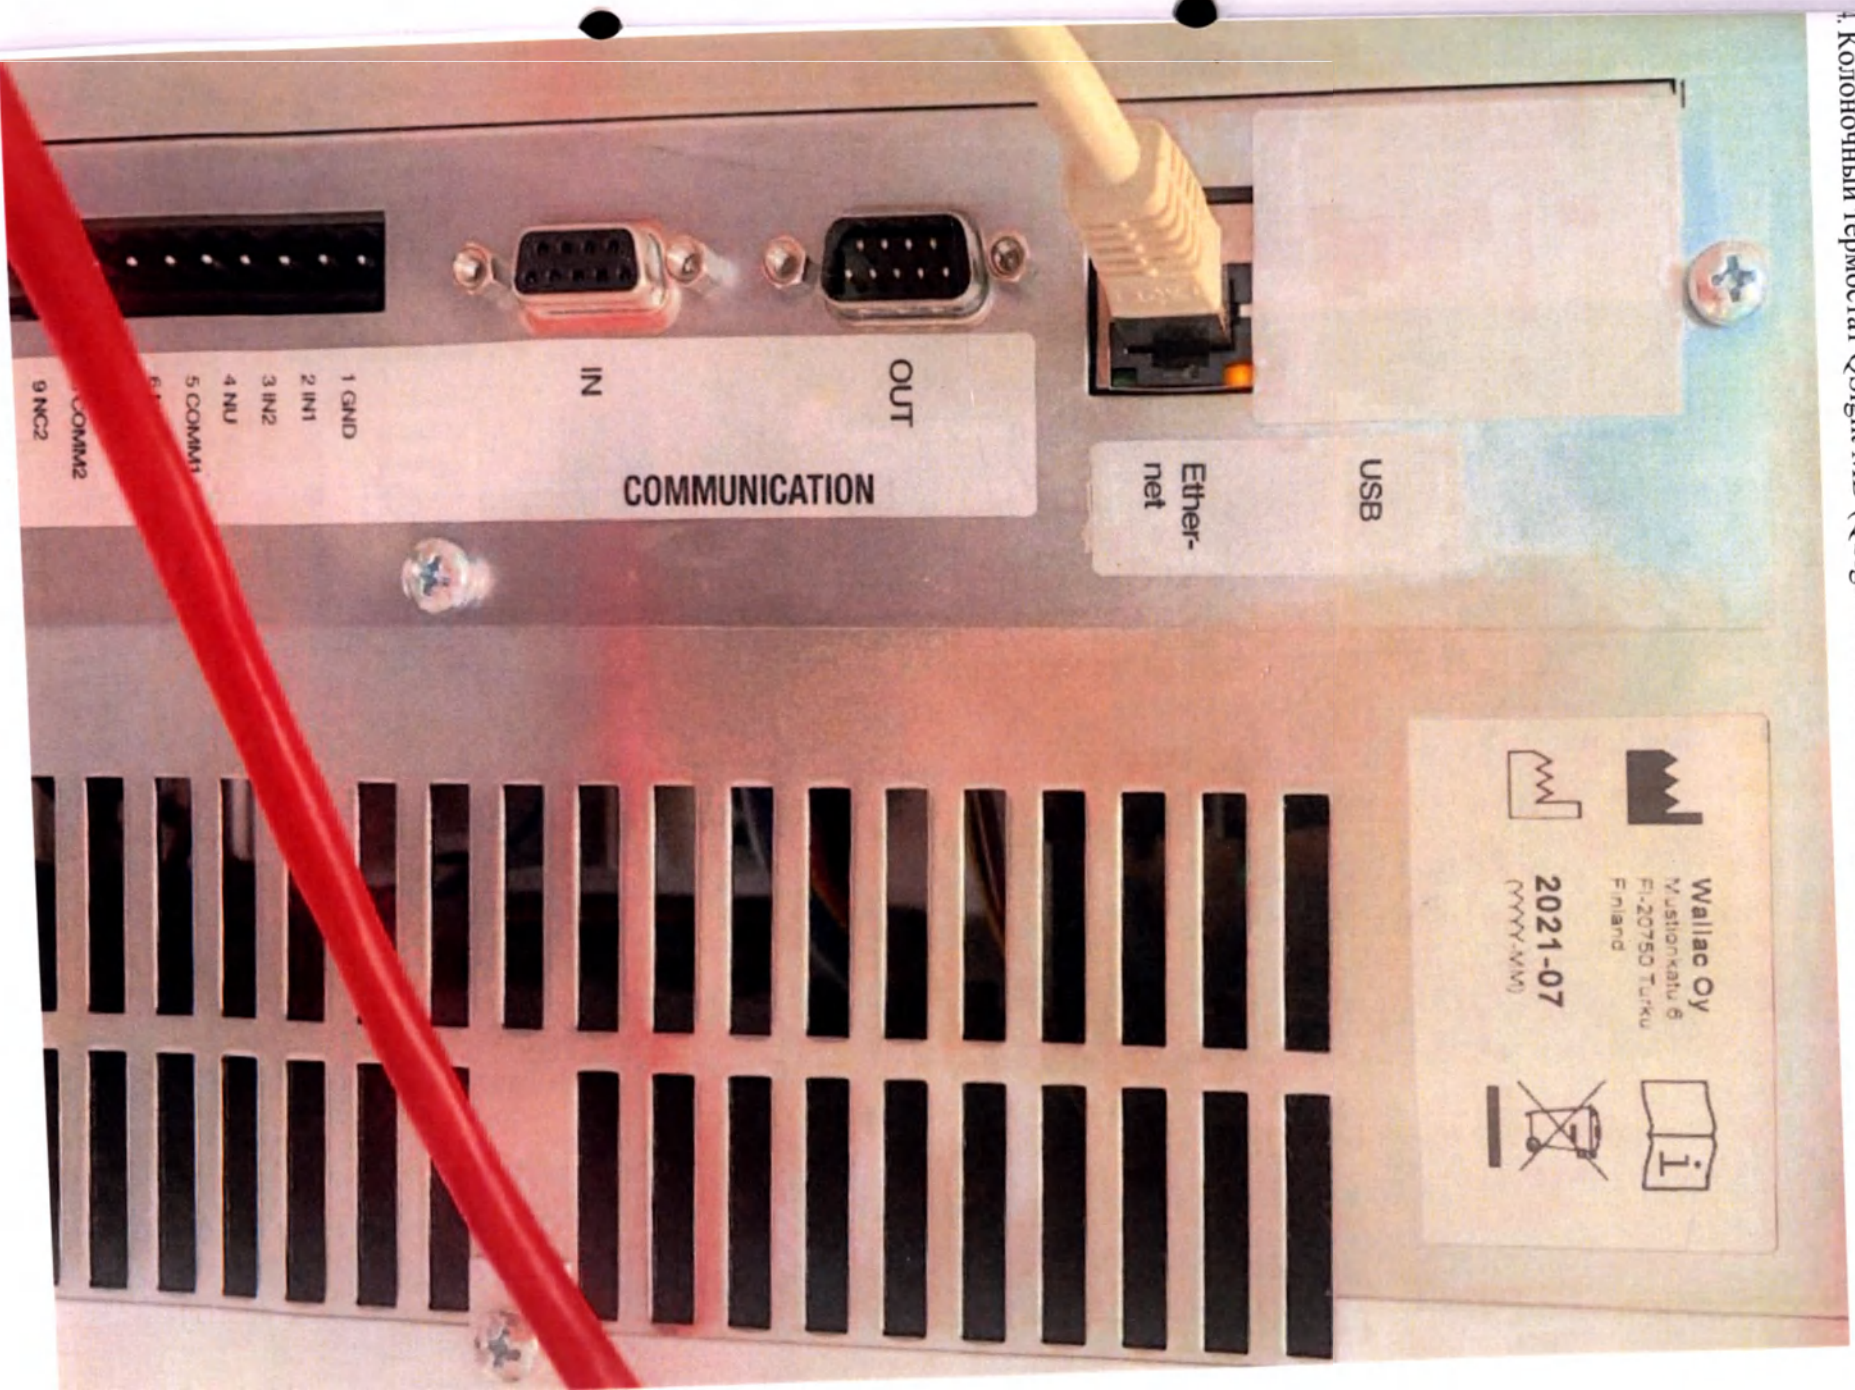

The screenshot displays the SIMPLICITY 3Q MD software interface. The top navigation bar includes the SIMPLICITY 3Q MD logo and a user profile icon labeled 'ADVANCED USER' with a 'LOG OUT' button. The main workspace is divided into three vertical panels:

- Batch List Creator (Blue Panel):** Features a white icon of a document with a list. The text reads: "Batch List Creator" and "Generate or import your sample list."
- Batch Acquisition Queue (Green Panel):** Features a white icon of a sample tray with an upward arrow. The text reads: "Batch Acquisition Queue" and "Run samples and manage batch run order."
- Quant (Teal Panel):** Features a white icon of a chromatogram. The text reads: "Quant".

At the bottom, a status bar shows the system state as "Ready". A table of system components and their statuses is visible:

Module	Status
MS	Ready
AS	Ready
Pump	Ready
Queue	Ready

The right sidebar contains a "Batch List" section with a "Batch List" button and a "Batch List" dropdown menu. Below this is a "Sample" section with a "Sample" button and a "Sample" dropdown menu. The bottom right corner shows a "Page" indicator with "Page 1" and a "Page" button.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью на 21 листах.

Подпись

Ф.И.О.

