

LEGION

ООО «ЛЕГИОН»

198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская,

д. 69, лит. А, пом. 157-н, оф. 651.1В

тел. (812) 327 3129, факс (812) 327 2604, www.legion.ru

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия:

Монитор медицинский жидкокристаллический в вариантах исполнения

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор


ООО «ЛЕГИОН»




Мошкин И.С.

1. Монитор медицинский жидкокристаллический MD17G




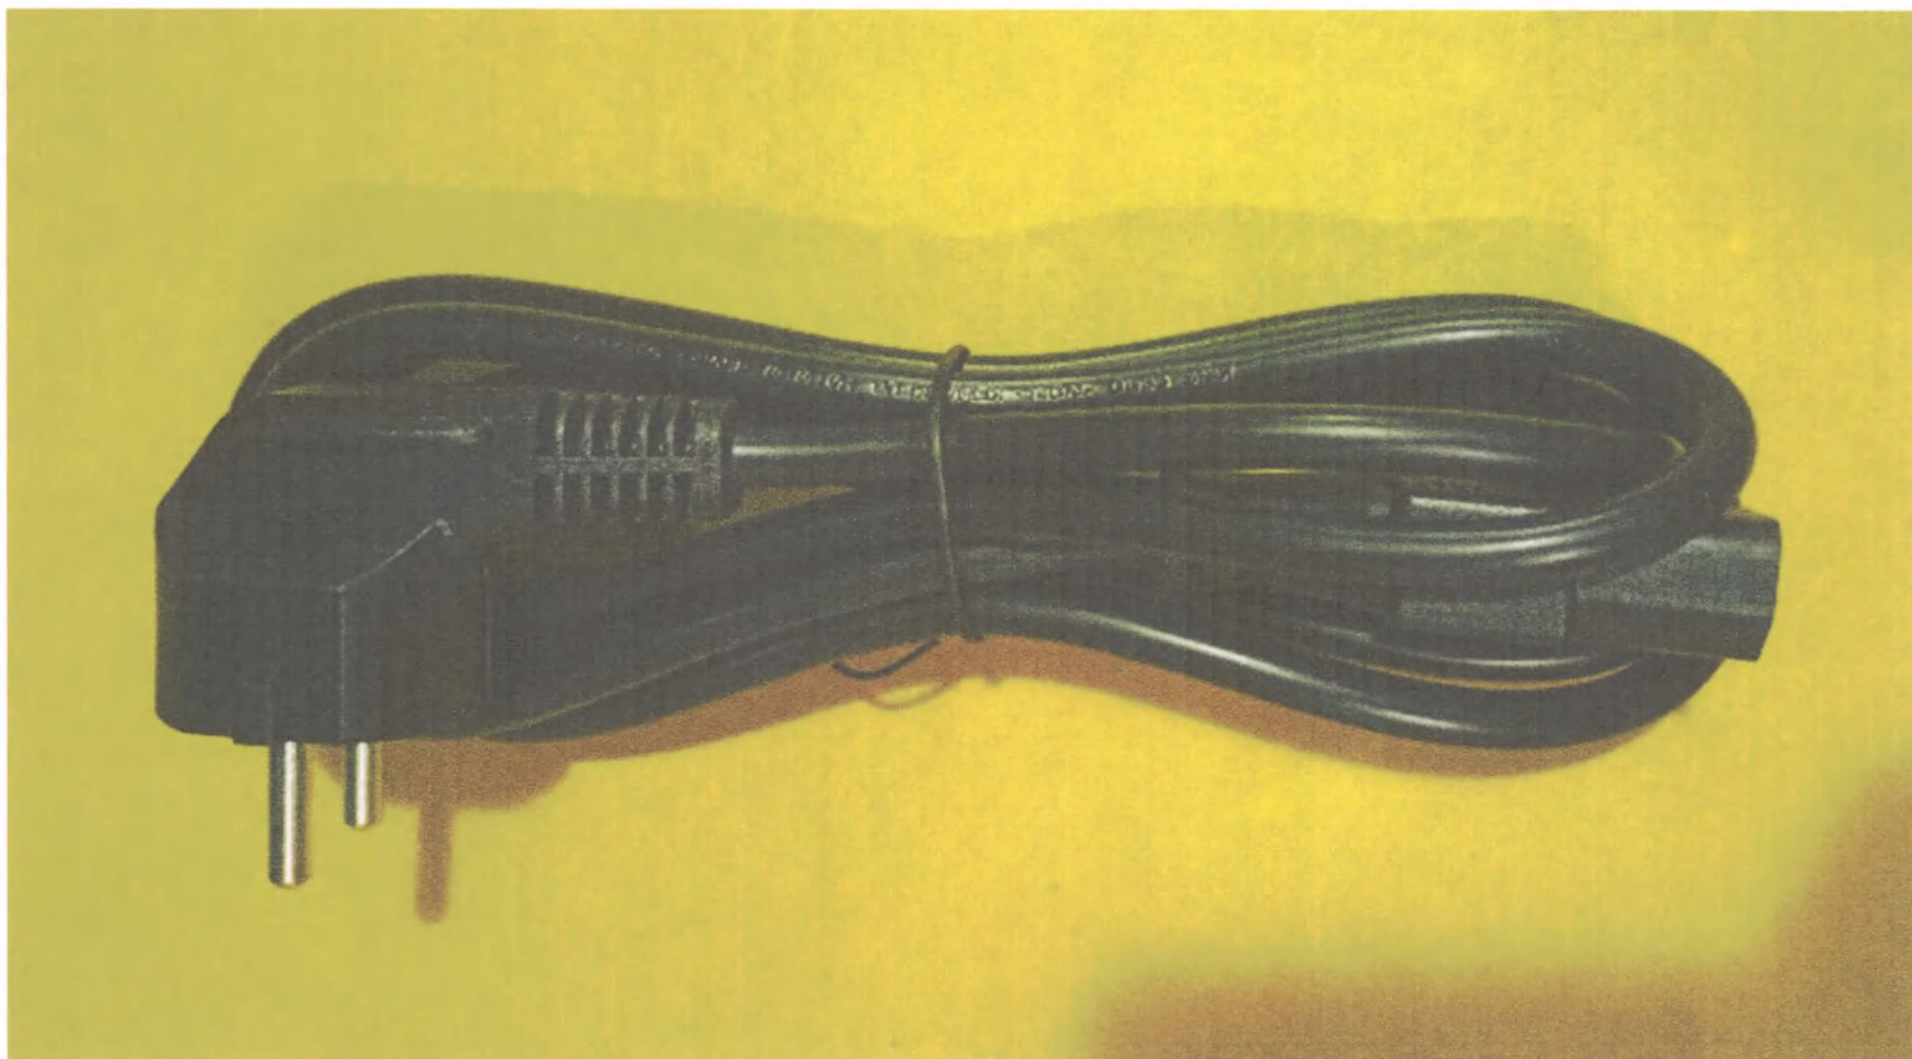


Шнур питания

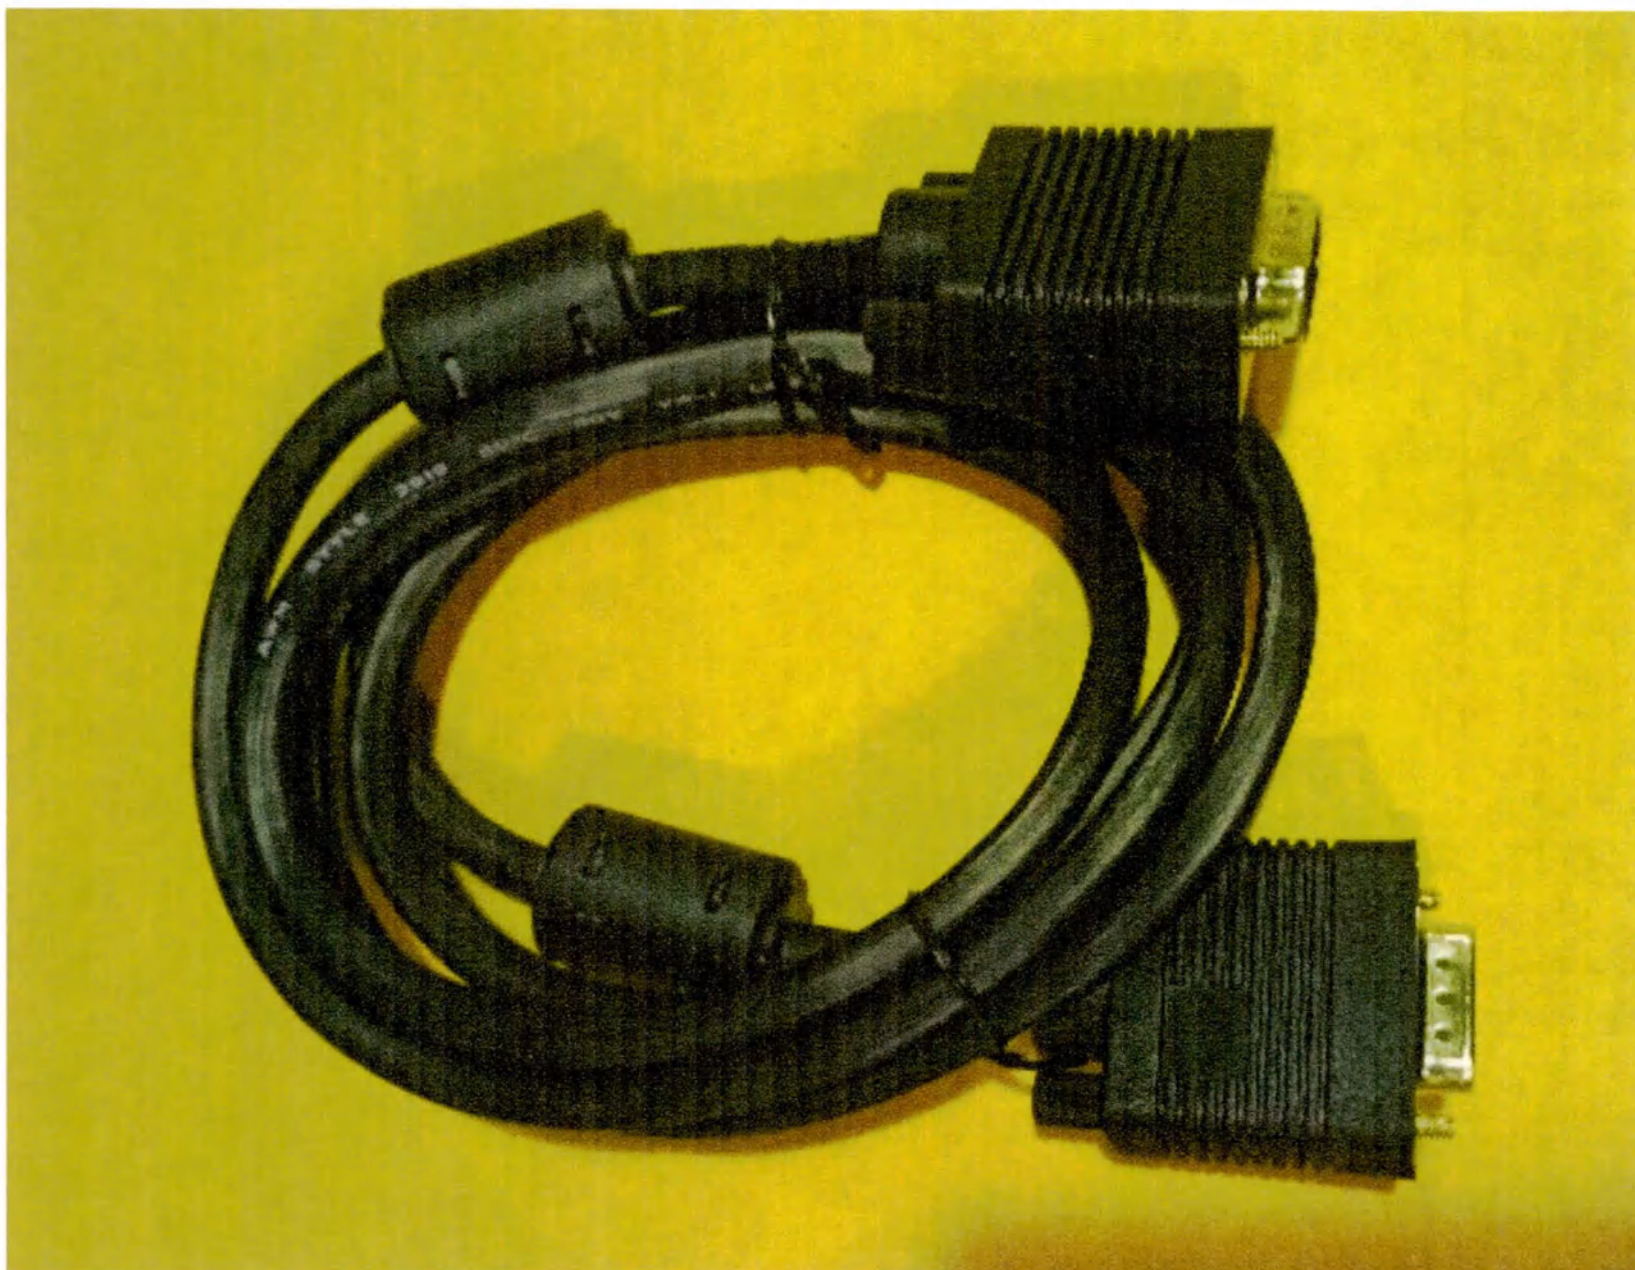

Цифровой сигнальный кабель VGA

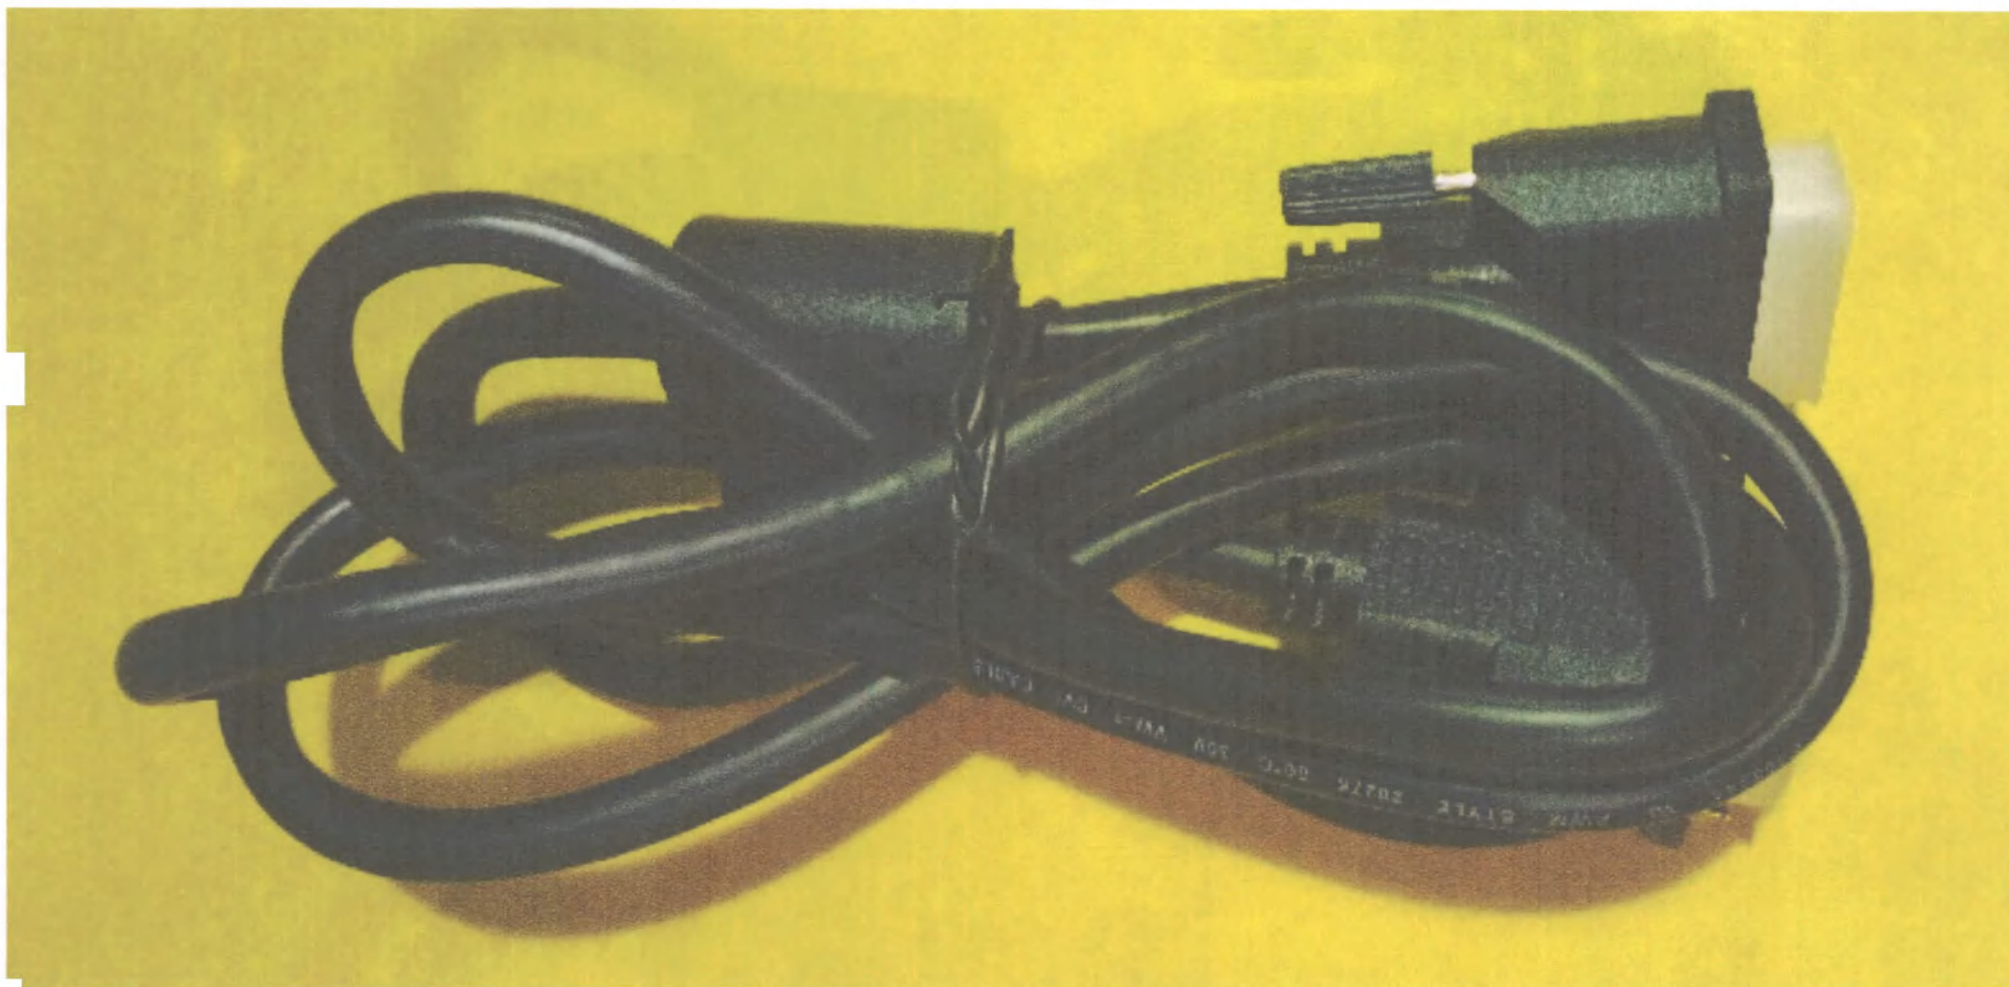

Цифровой сигнальный кабель DVI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСПЛЕЕВ С БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD17G

JLD-RD-GGS-223
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Просим внимательно
ознакомиться с данной
инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить
для последующего
использования.


II. Монитор медицинский жидкокристаллический MD22CA




Монитор



Цифровой сигнальный кабель VGA

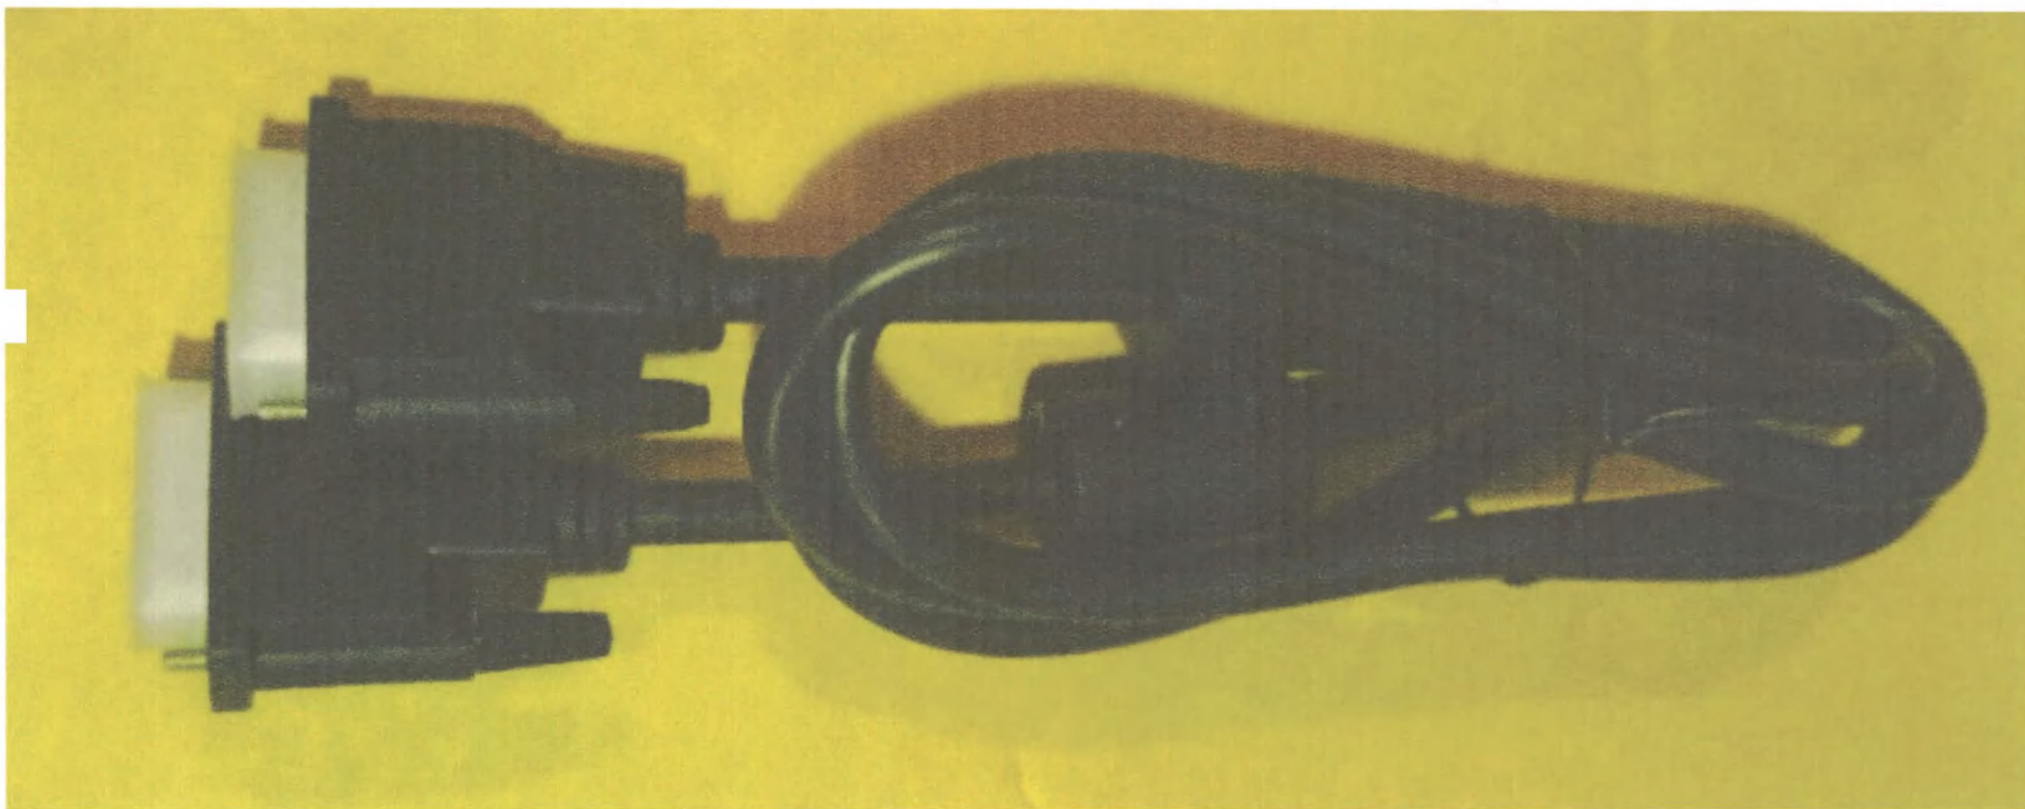

Цифровой сигнальный кабель DVI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ
С БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD22CA


Просим внимательно
ознакомиться с данной
инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить
для последующего
использования.

JLD-RD-GGS-271
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

III. Монитор медицинский жидкокристаллический MD26C




Монитор

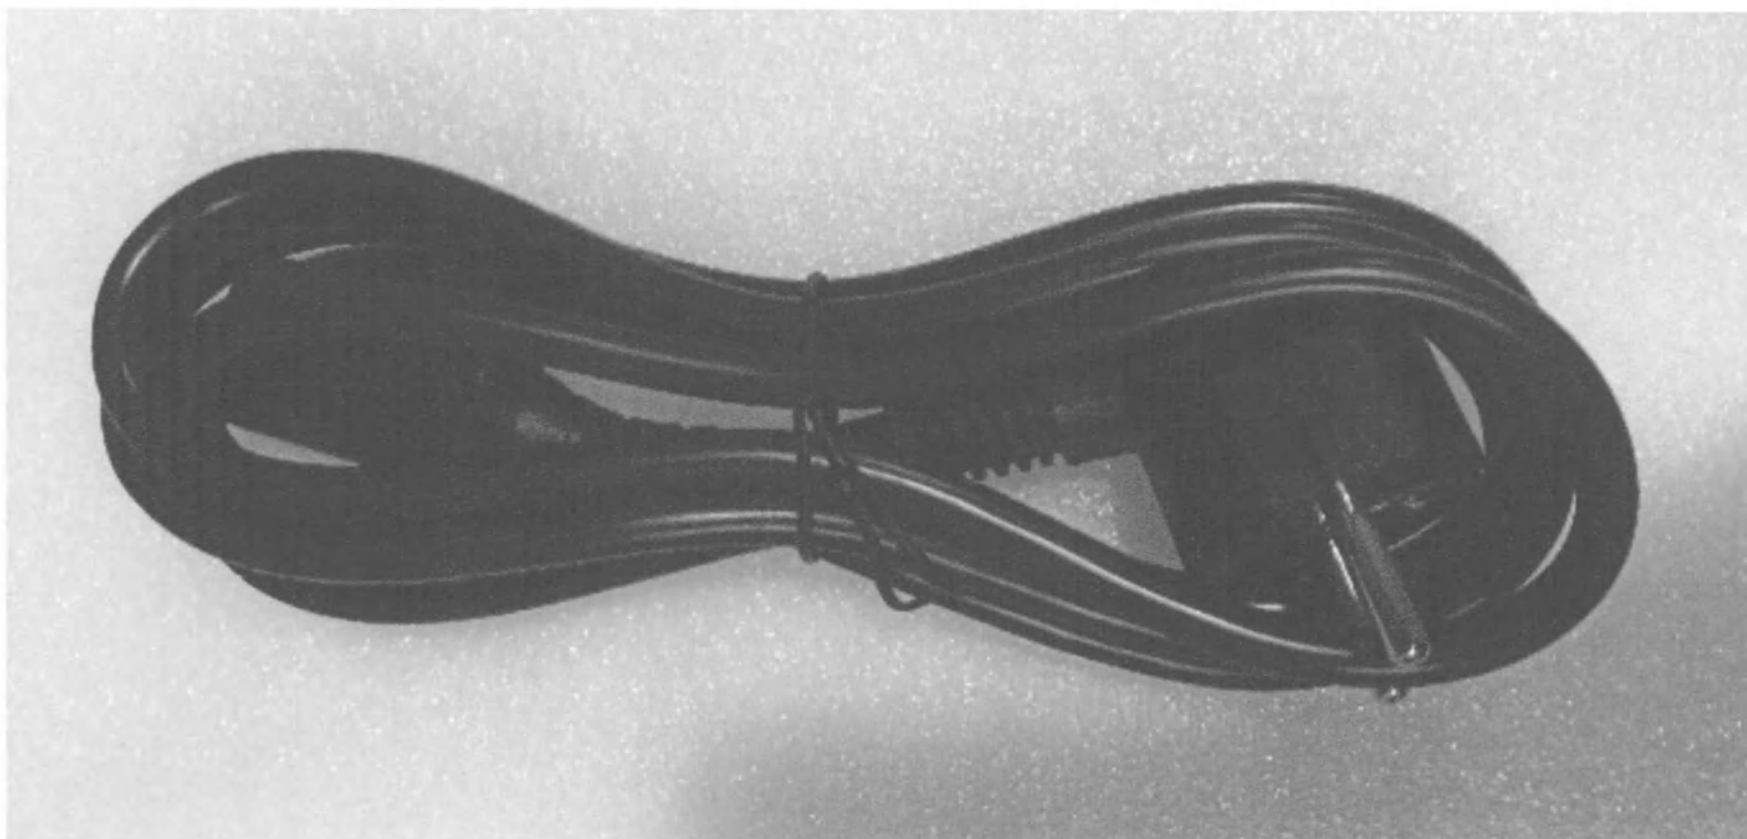


Шнур питания



Цифровой сигнальный кабель VGA

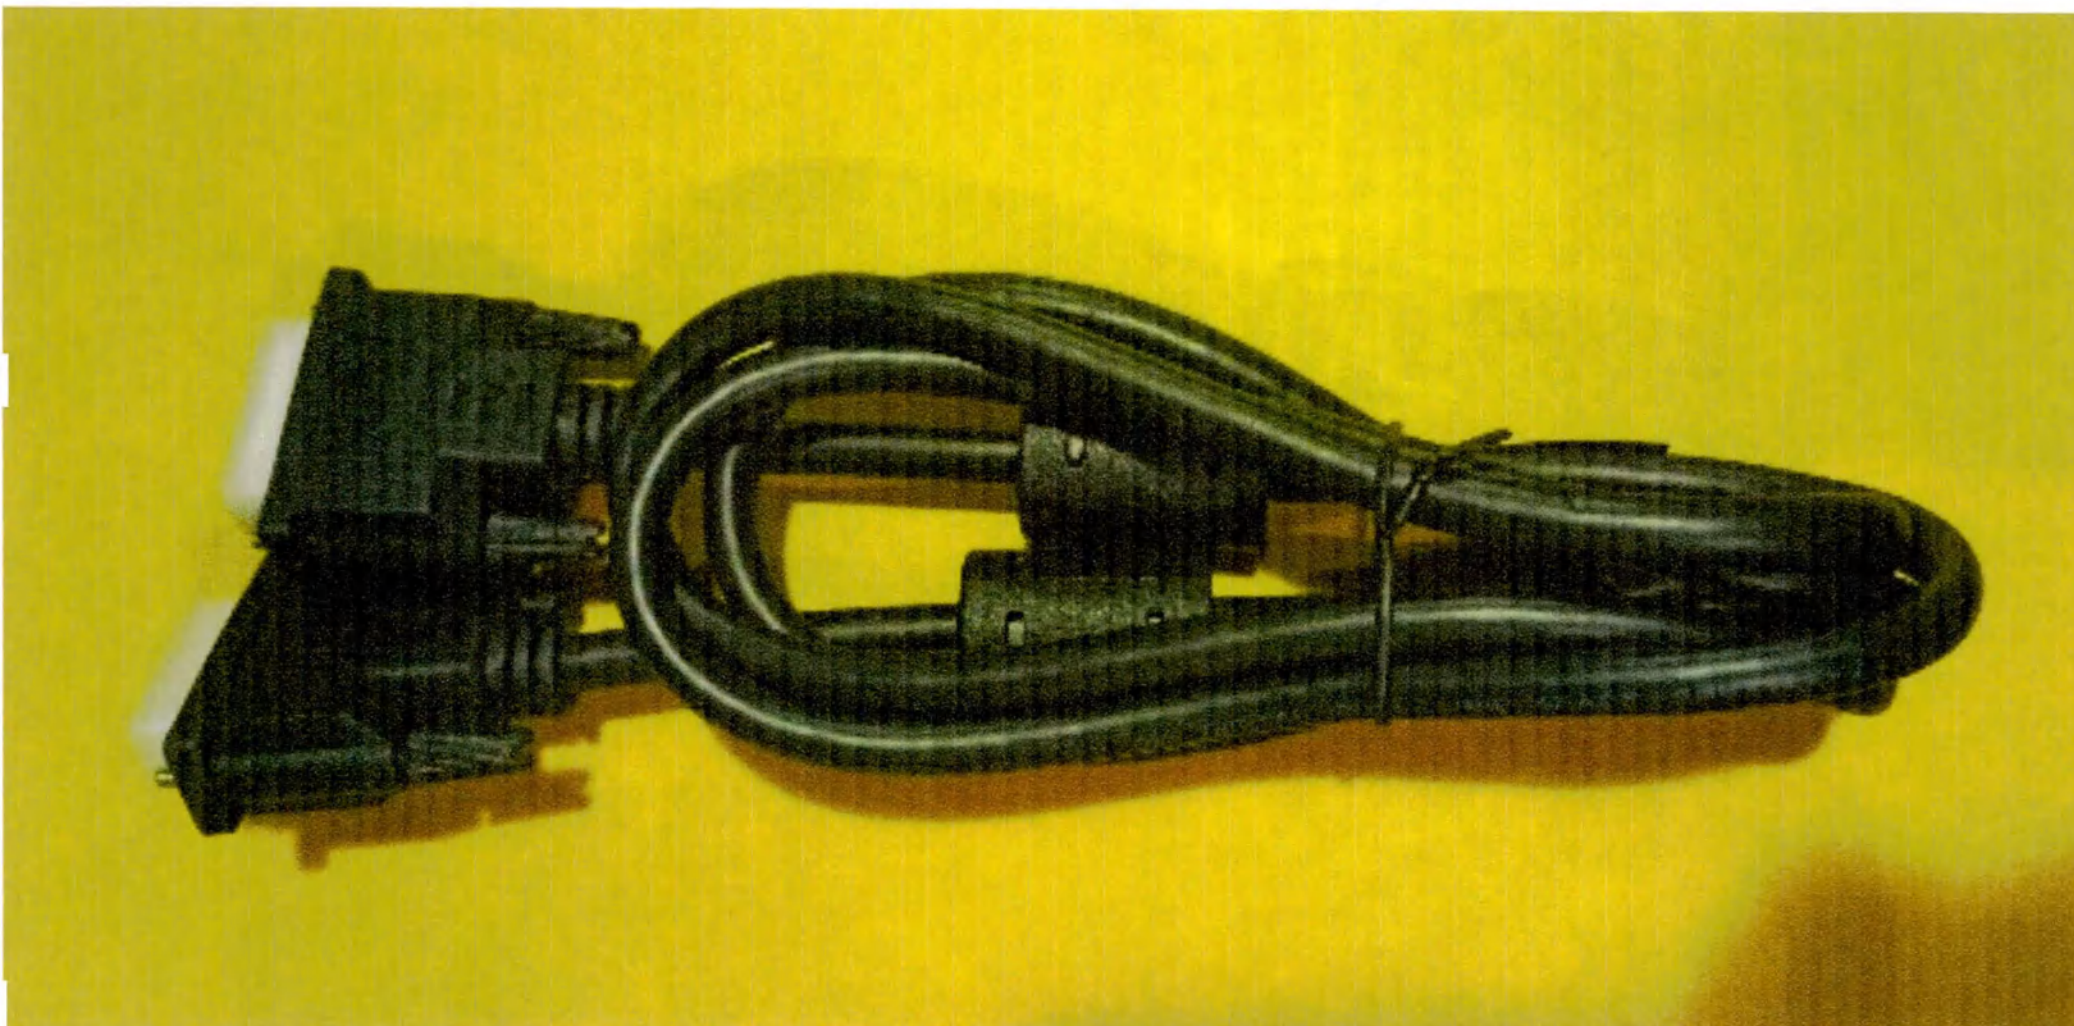

Цифровой сигнальный кабель DVI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ С
БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD26C


JLD-RD-GGS-181
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Просим внимательно
ознакомиться с данной
инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить
для последующего
использования.

IV. Монитор медицинский жидкокристаллический MD26GA




Монитор

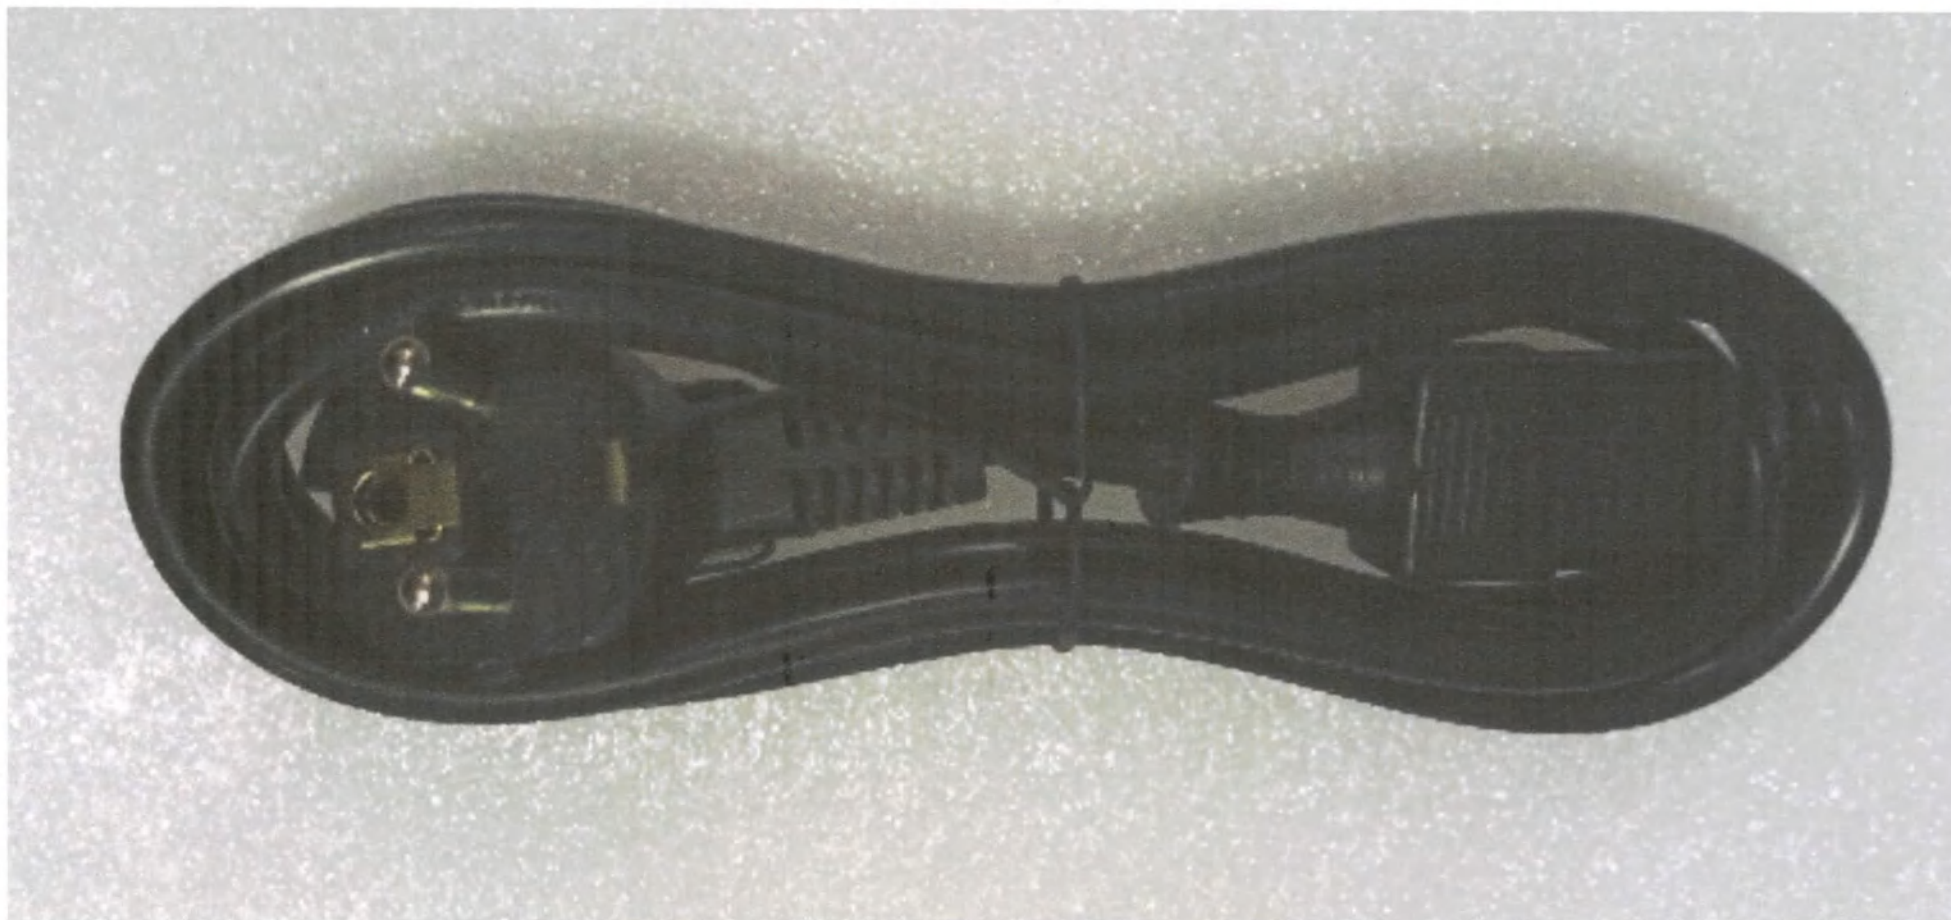


Шнур питания




Адаптер переменного тока

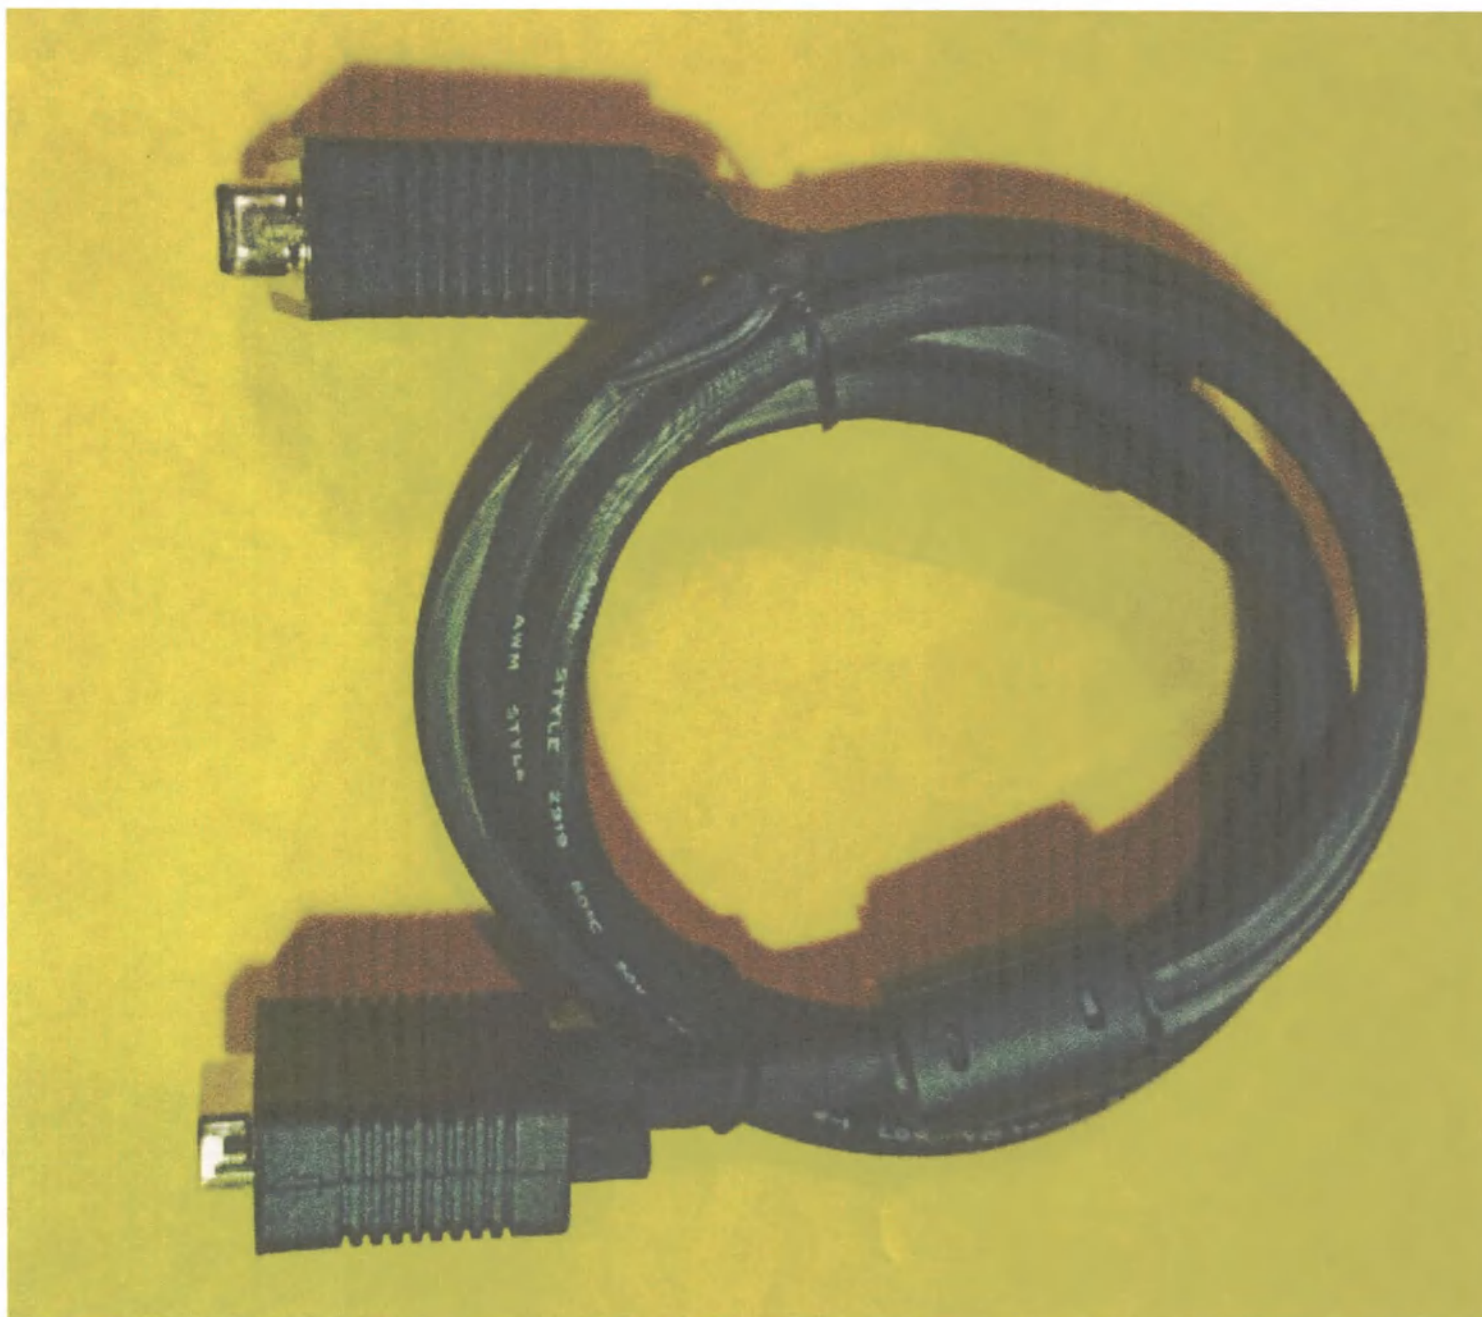

Цифровой сигнальный кабель VGA

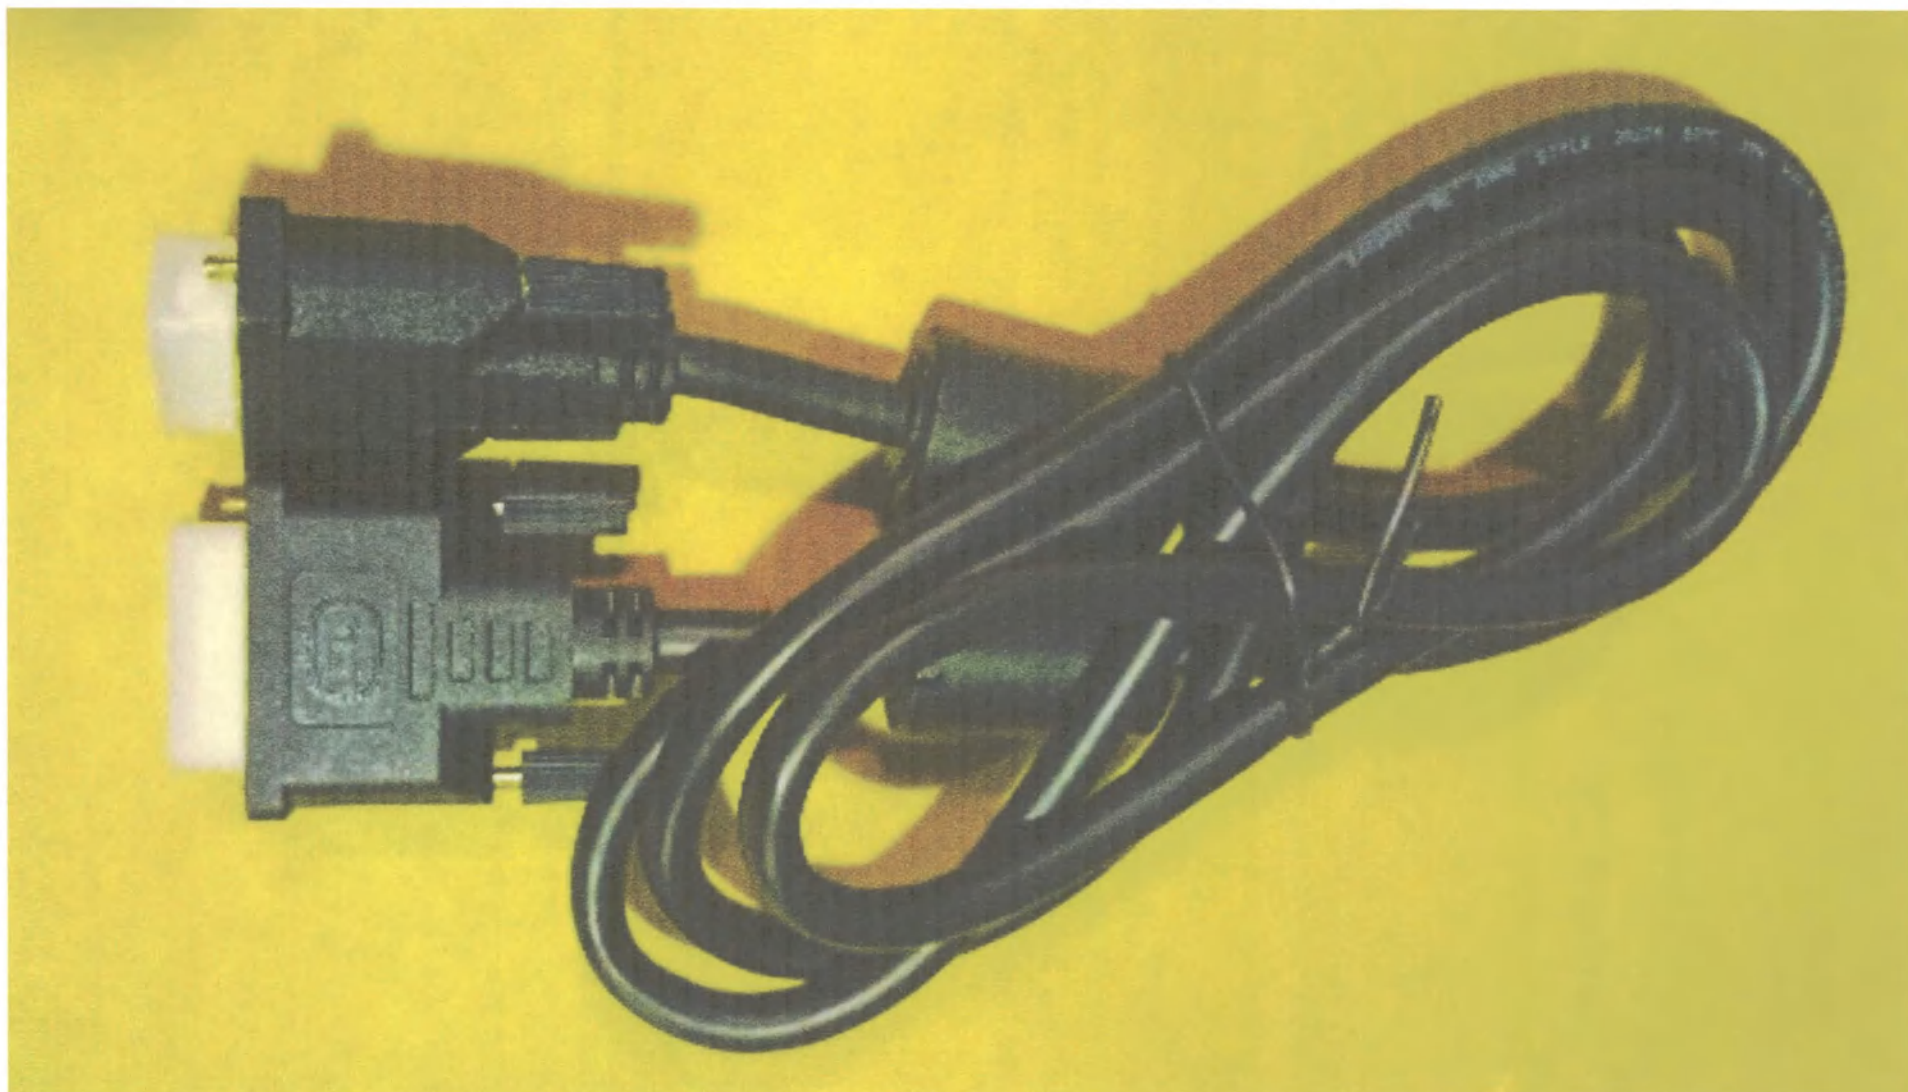

Цифровой сигнальный кабель DVI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСПЛЕЕВ С БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD26GA


JLD-RD-GGS-240
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Просим внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить для последующего использования.

V. Монитор медицинский жидкокристаллический MD32C




Монитор

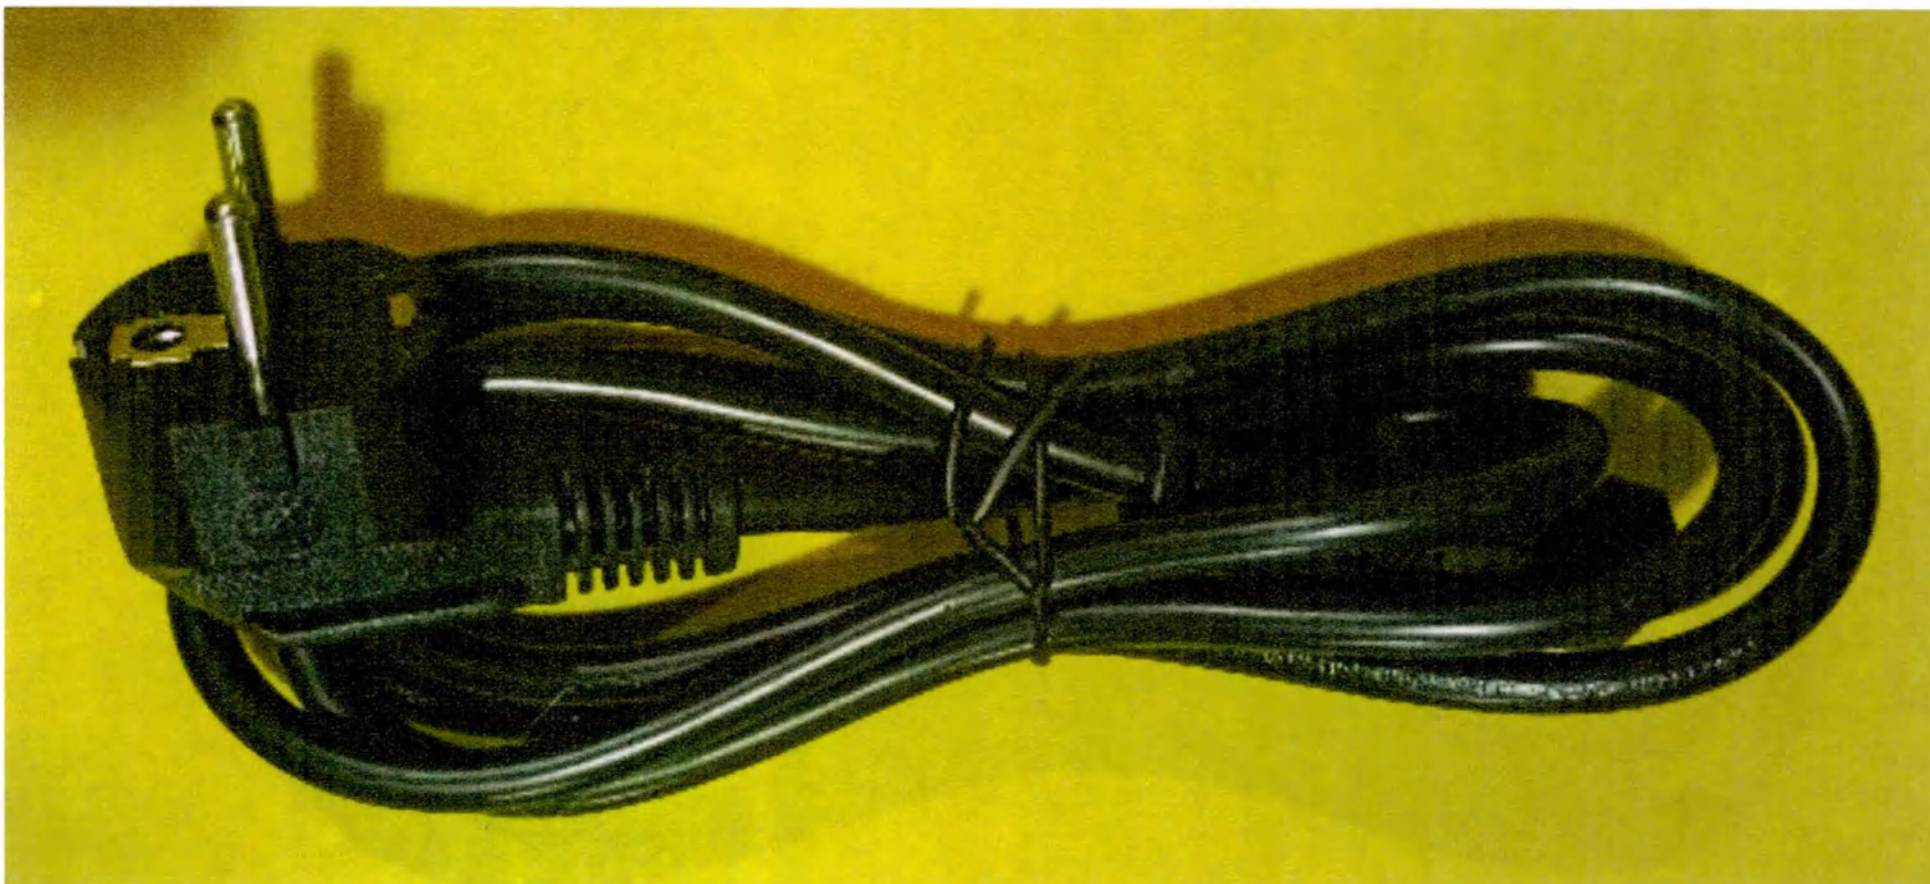


Шнур питания



Цифровой сигнальный кабель VGA

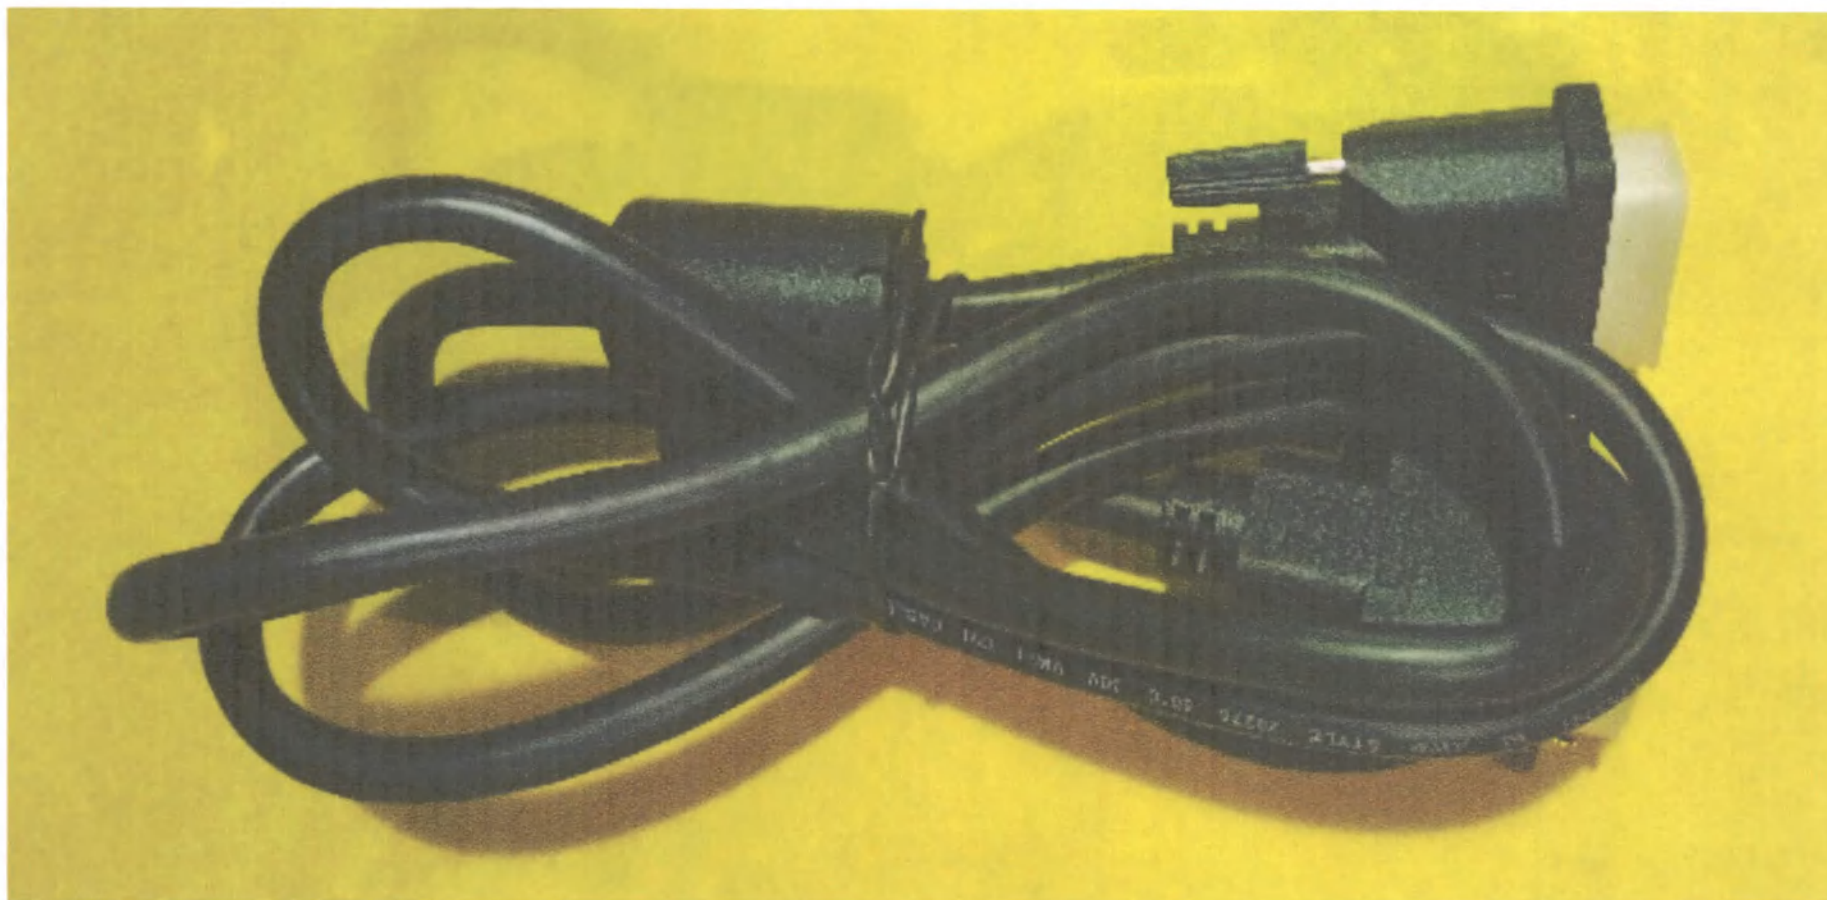

Цифровой сигнальный кабель DVI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСПЛЕЕВ С БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD32C

JLD-RD-GGS-252
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ


Просим внимательно
ознакомиться с данной
инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить
для последующего
использования.

VI.

Монитор медицинский жидкокристаллический MD45C




Монитор

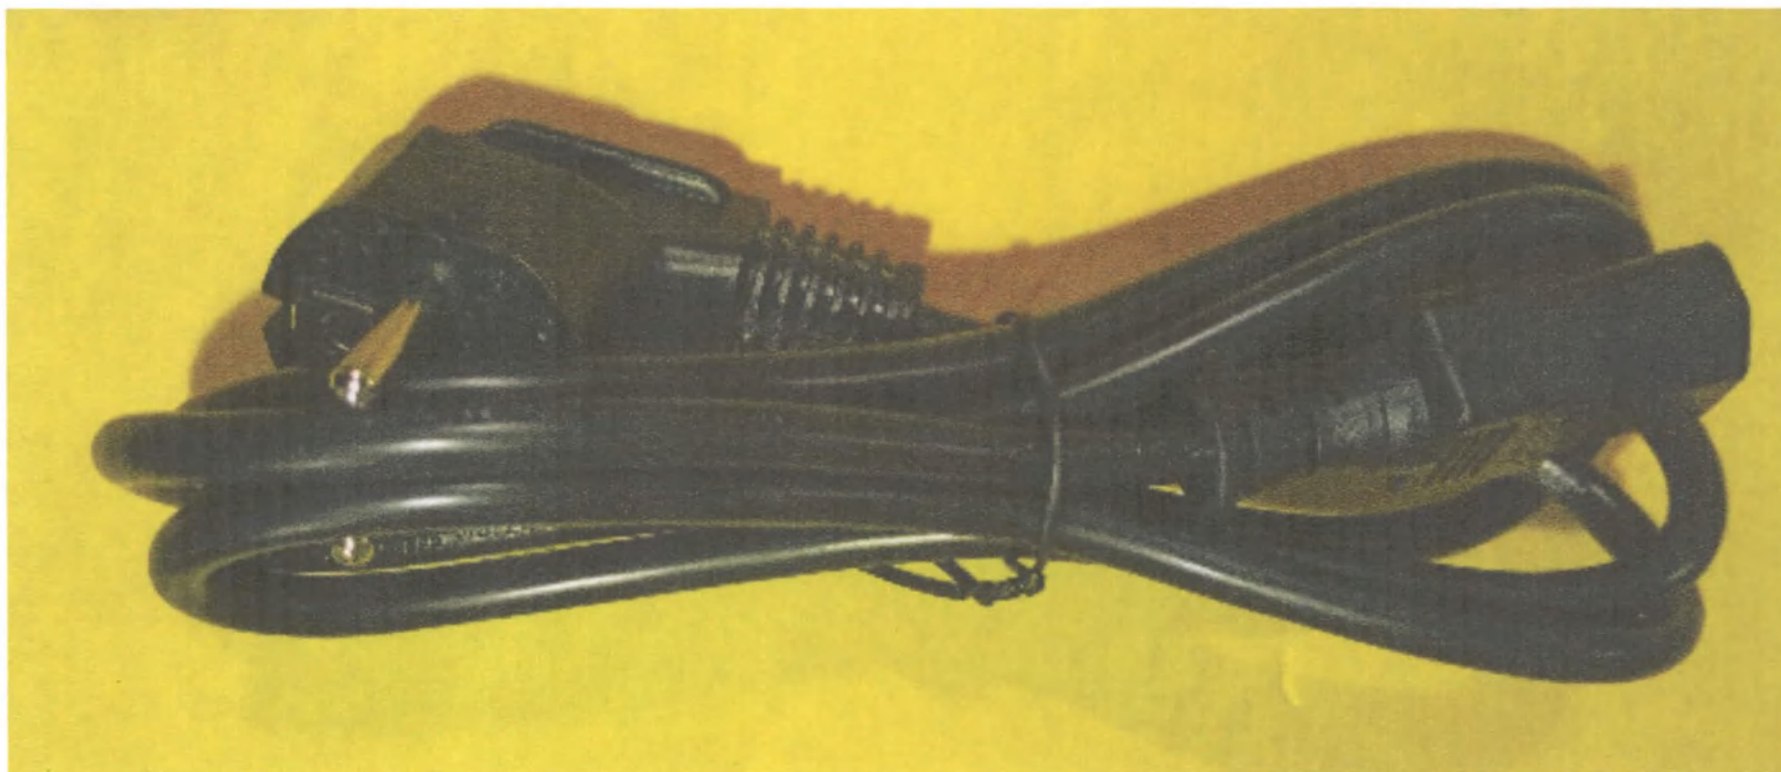


Шнур питания




Адаптер переменного тока

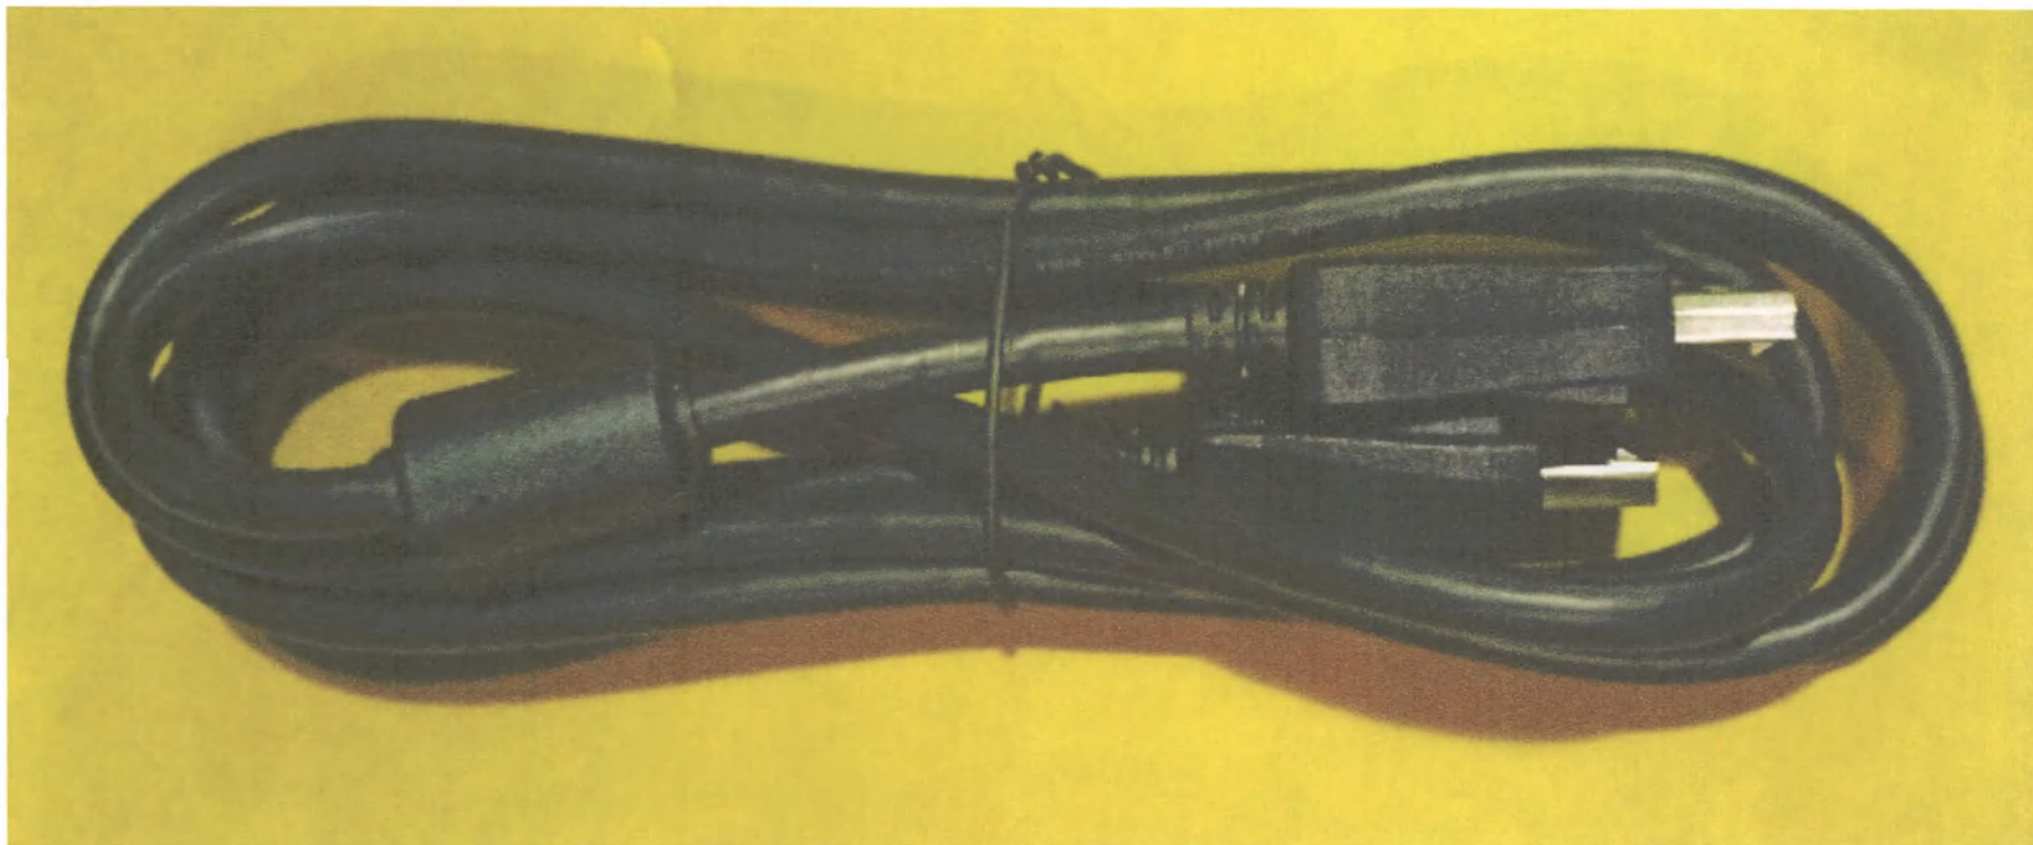

Цифровой сигнальный кабель DP

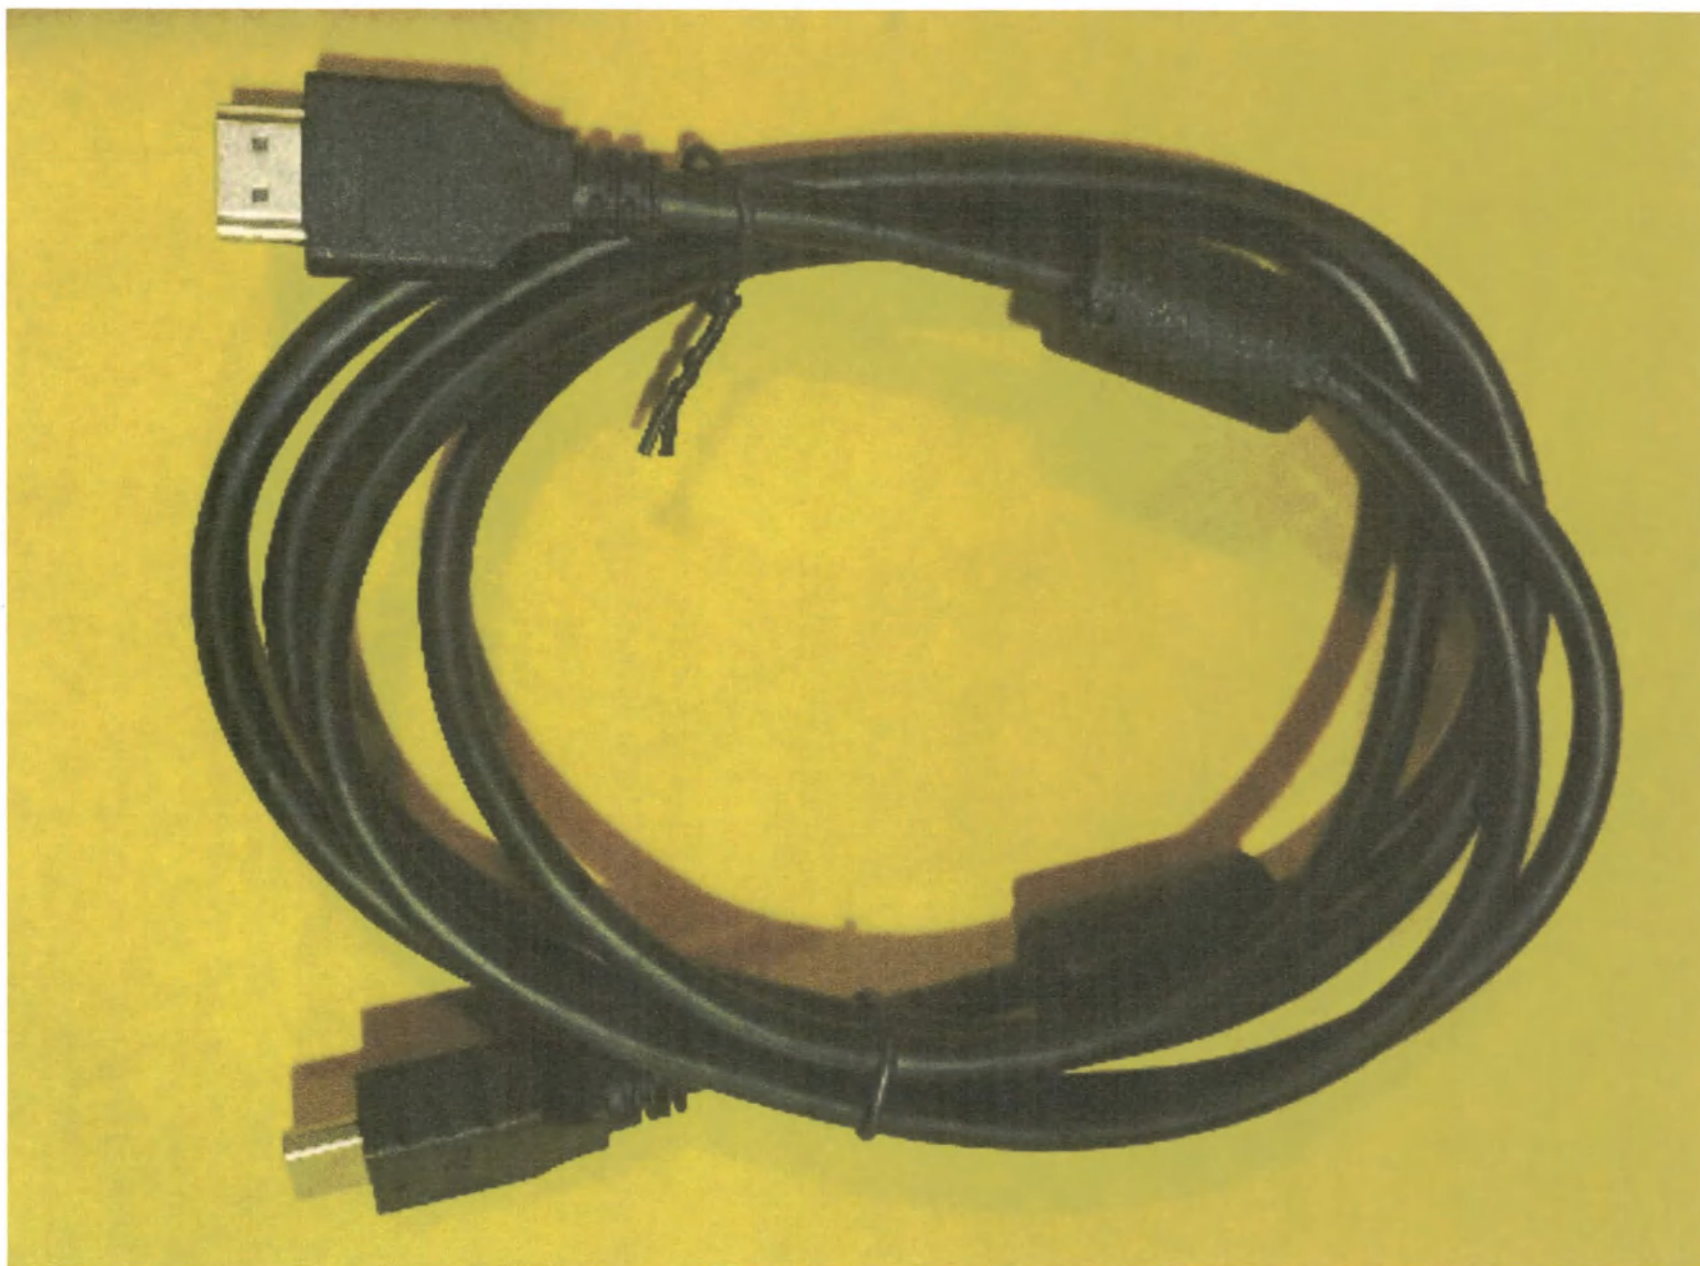

Цифровой сигнальный кабель HDMI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСПЛЕЕВ С БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD45C


JLD-RD-GGS-291
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Просим внимательно
ознакомиться с данной
инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить
для последующего
использования.

VII. Монитор медицинский жидкокристаллический MD52G



Монитор

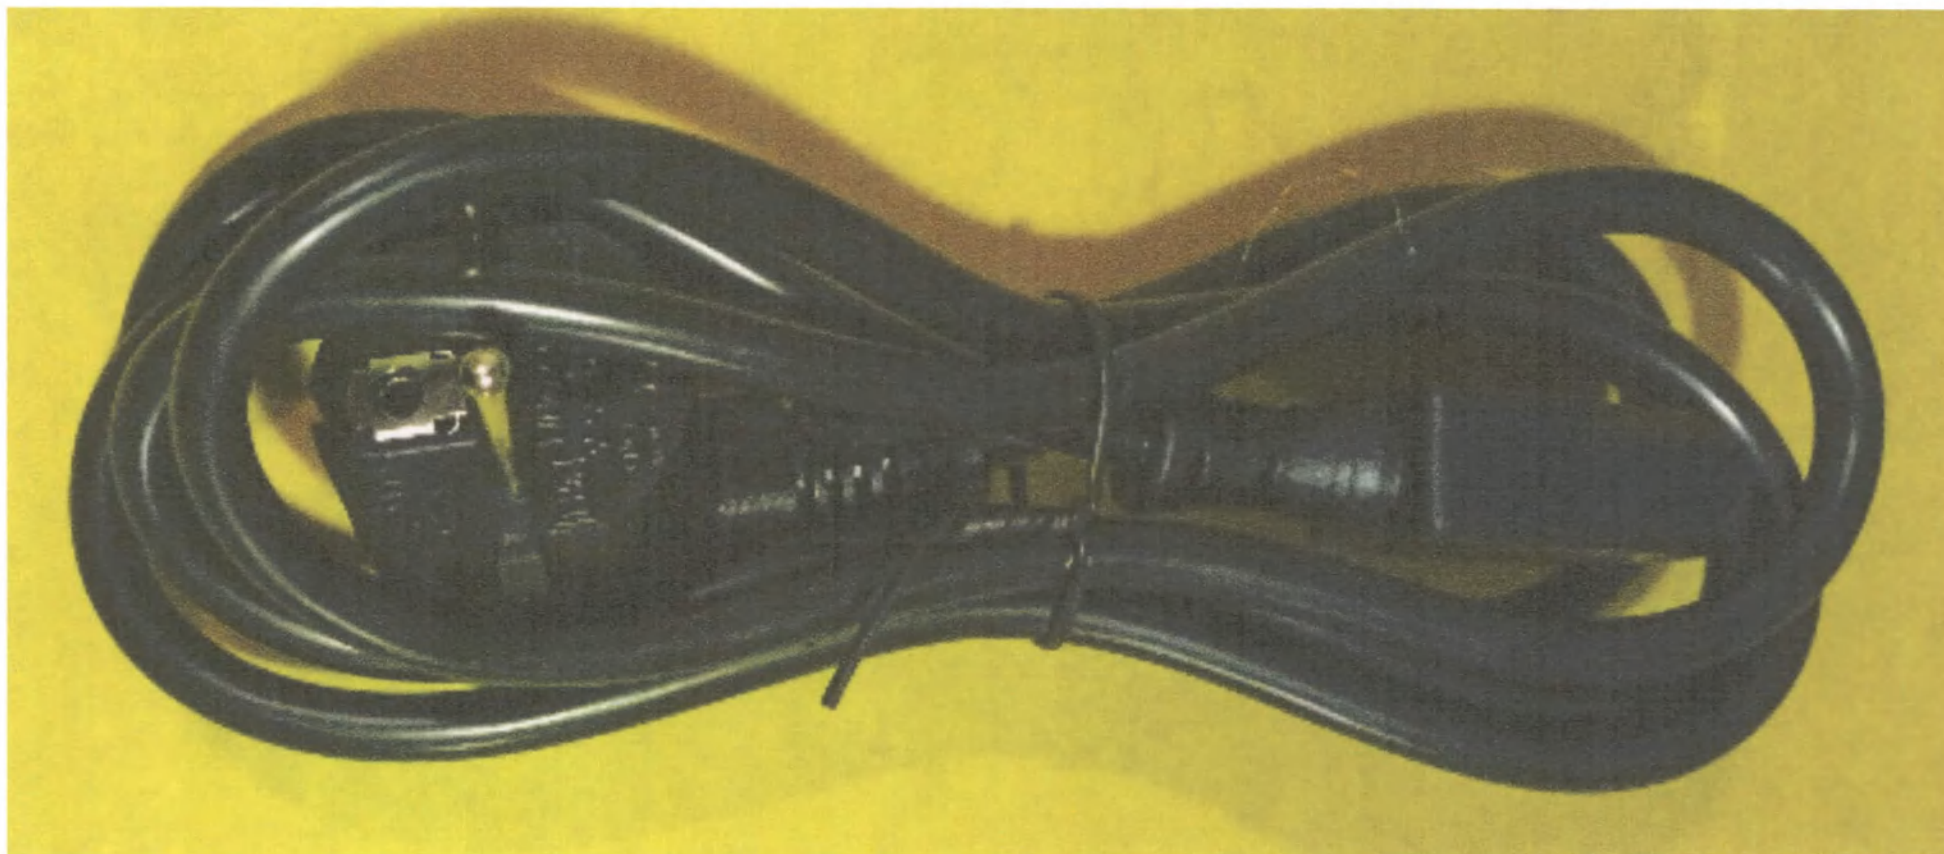


Шнур питания




Адаптер переменного тока



Цифровой сигнальный кабель VGA

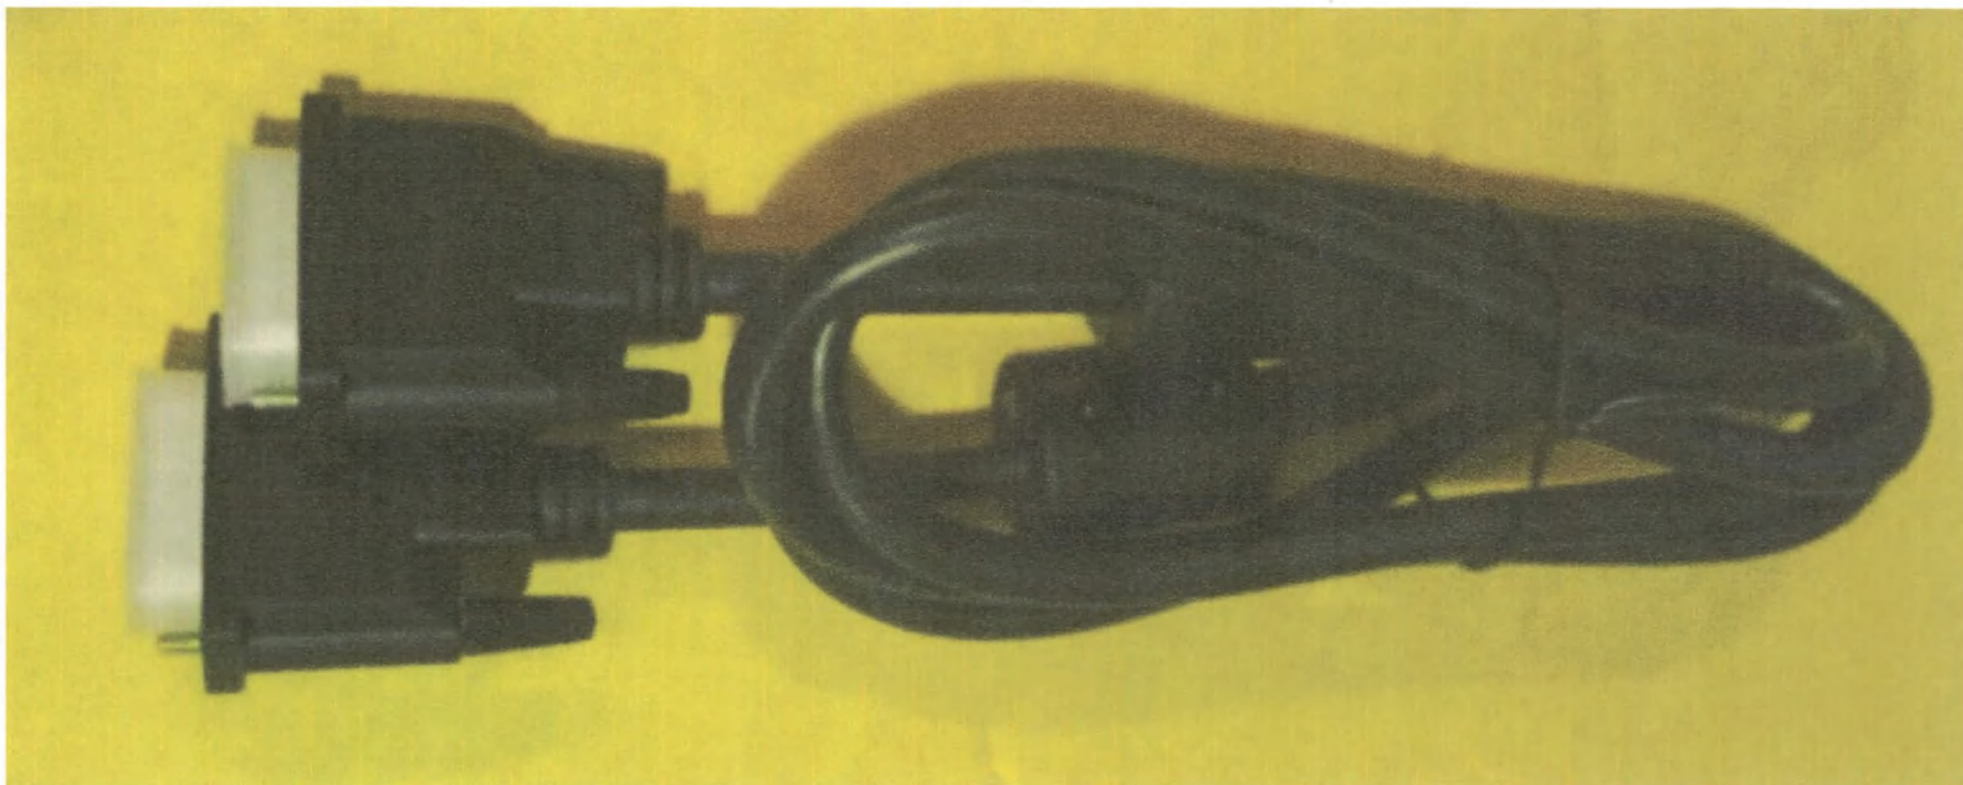

Цифровой сигнальный кабель DVI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСПЛЕЕВ С БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD52G


JLD-RD-GGS-202
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Просим внимательно
ознакомиться с данной
инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить
для последующего
использования.


УП. Монитор медицинский жидкокристаллический MD85CA




Монитор

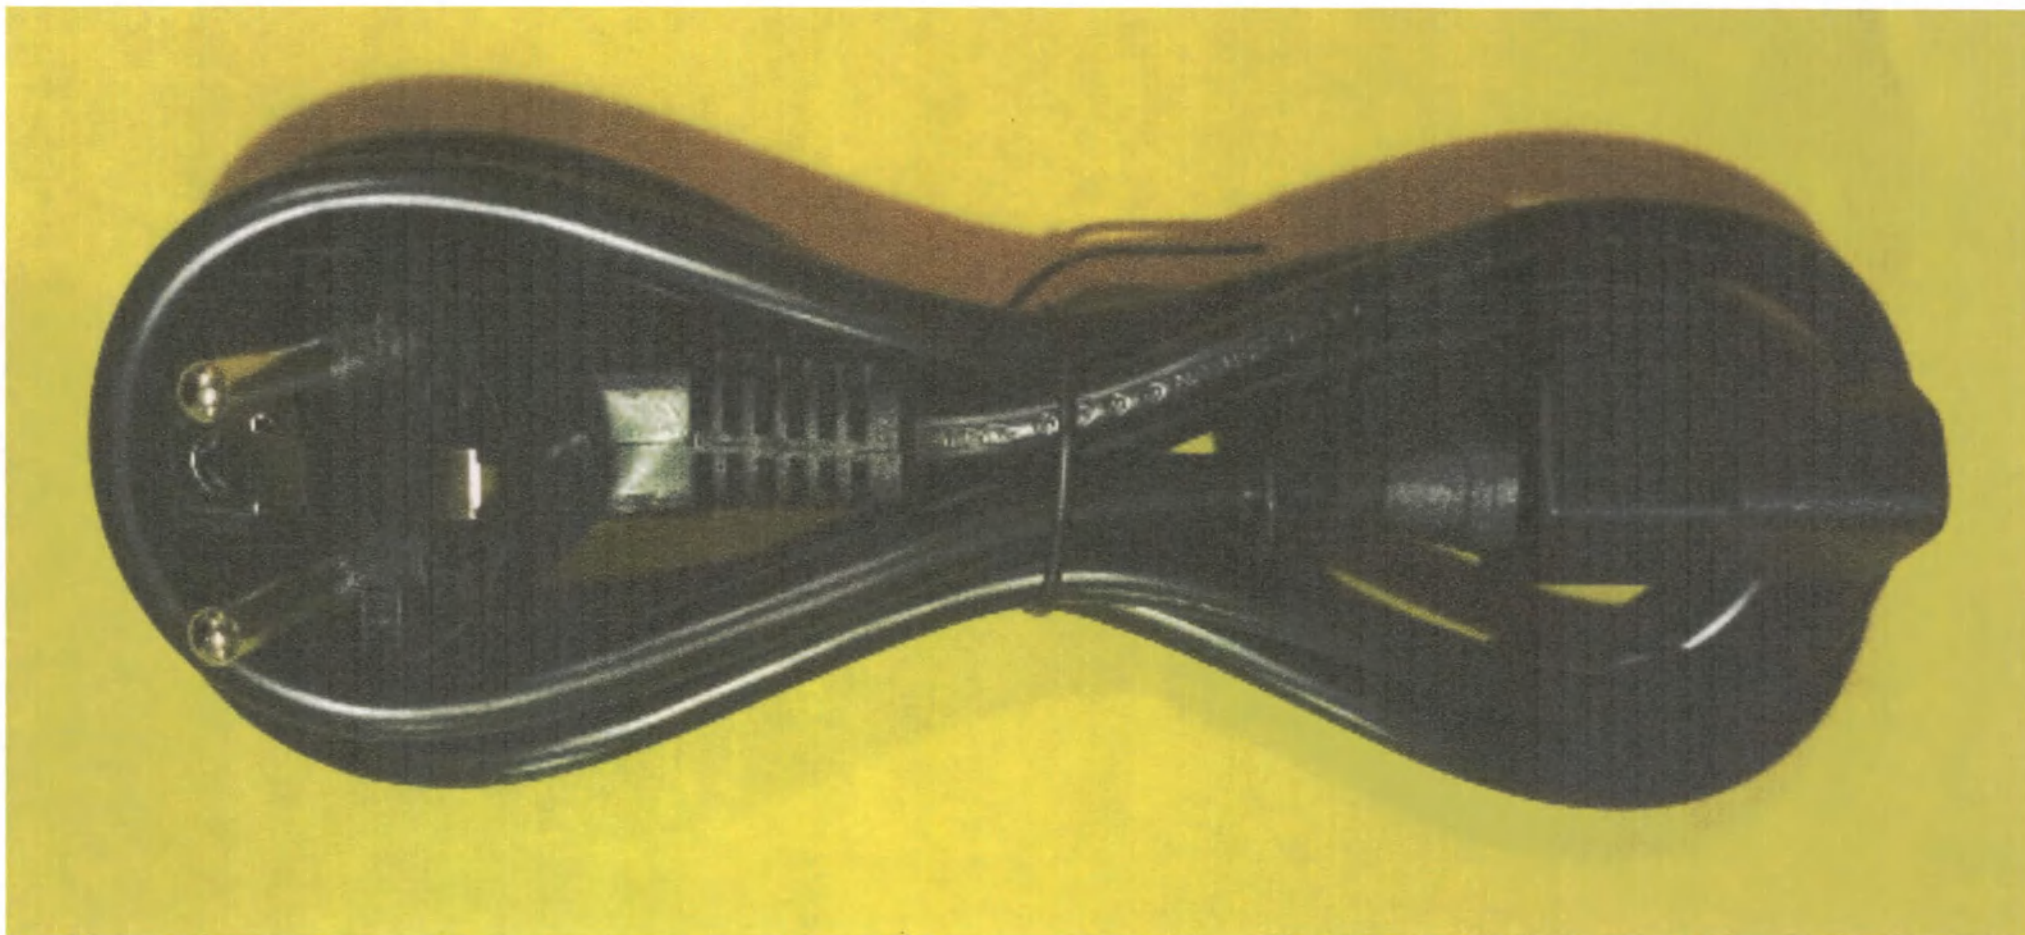

Шнур питания

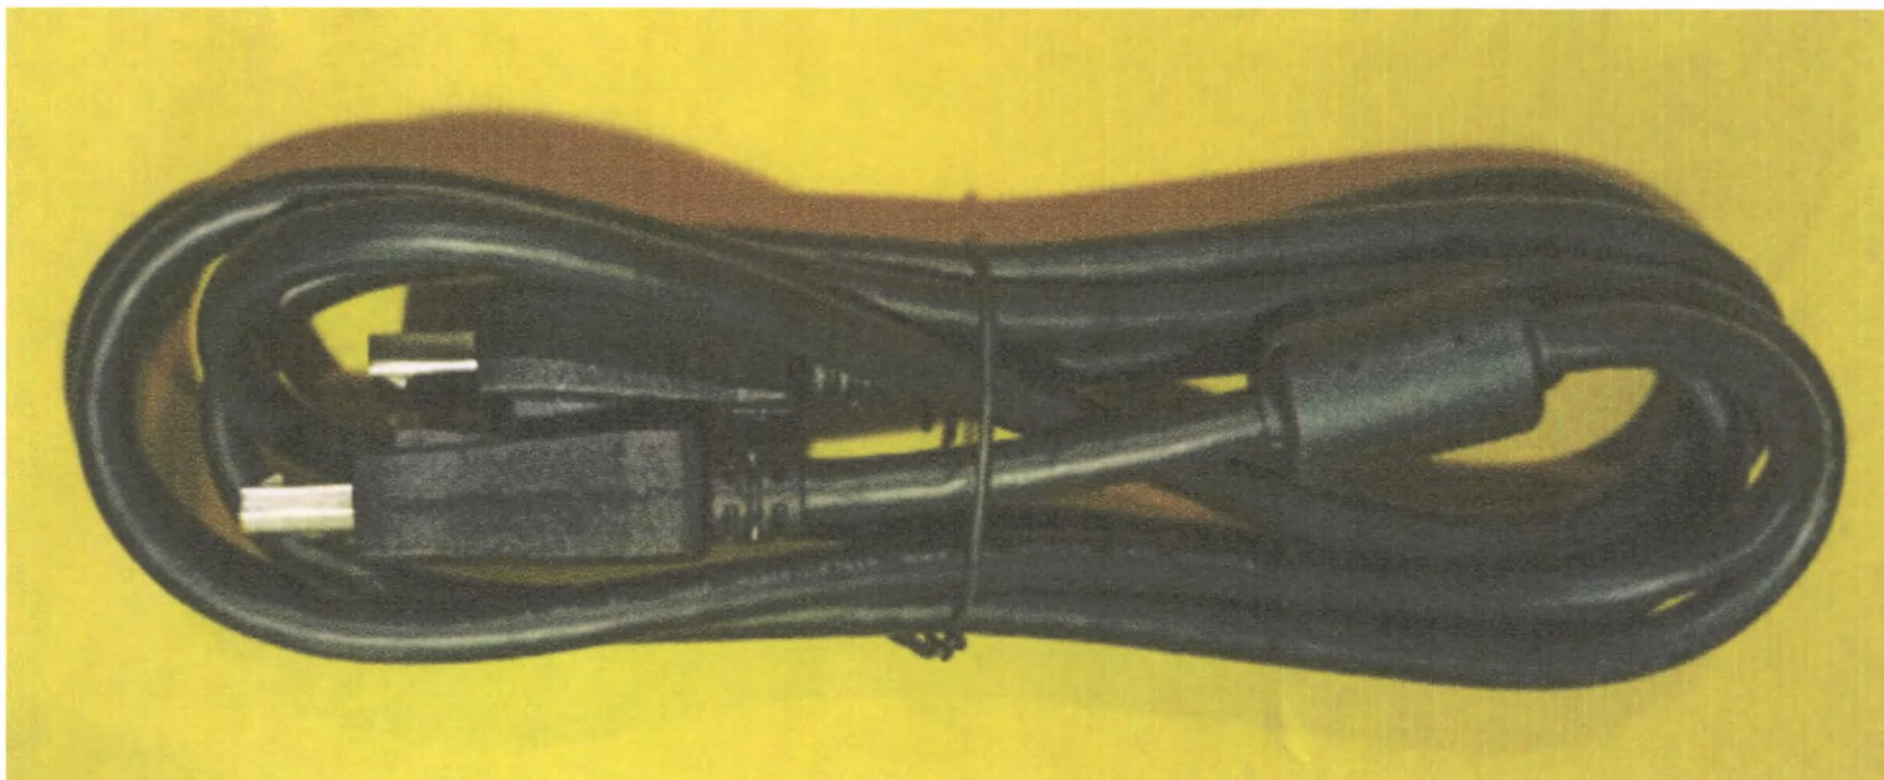

Цифровой сигнальный кабель DP

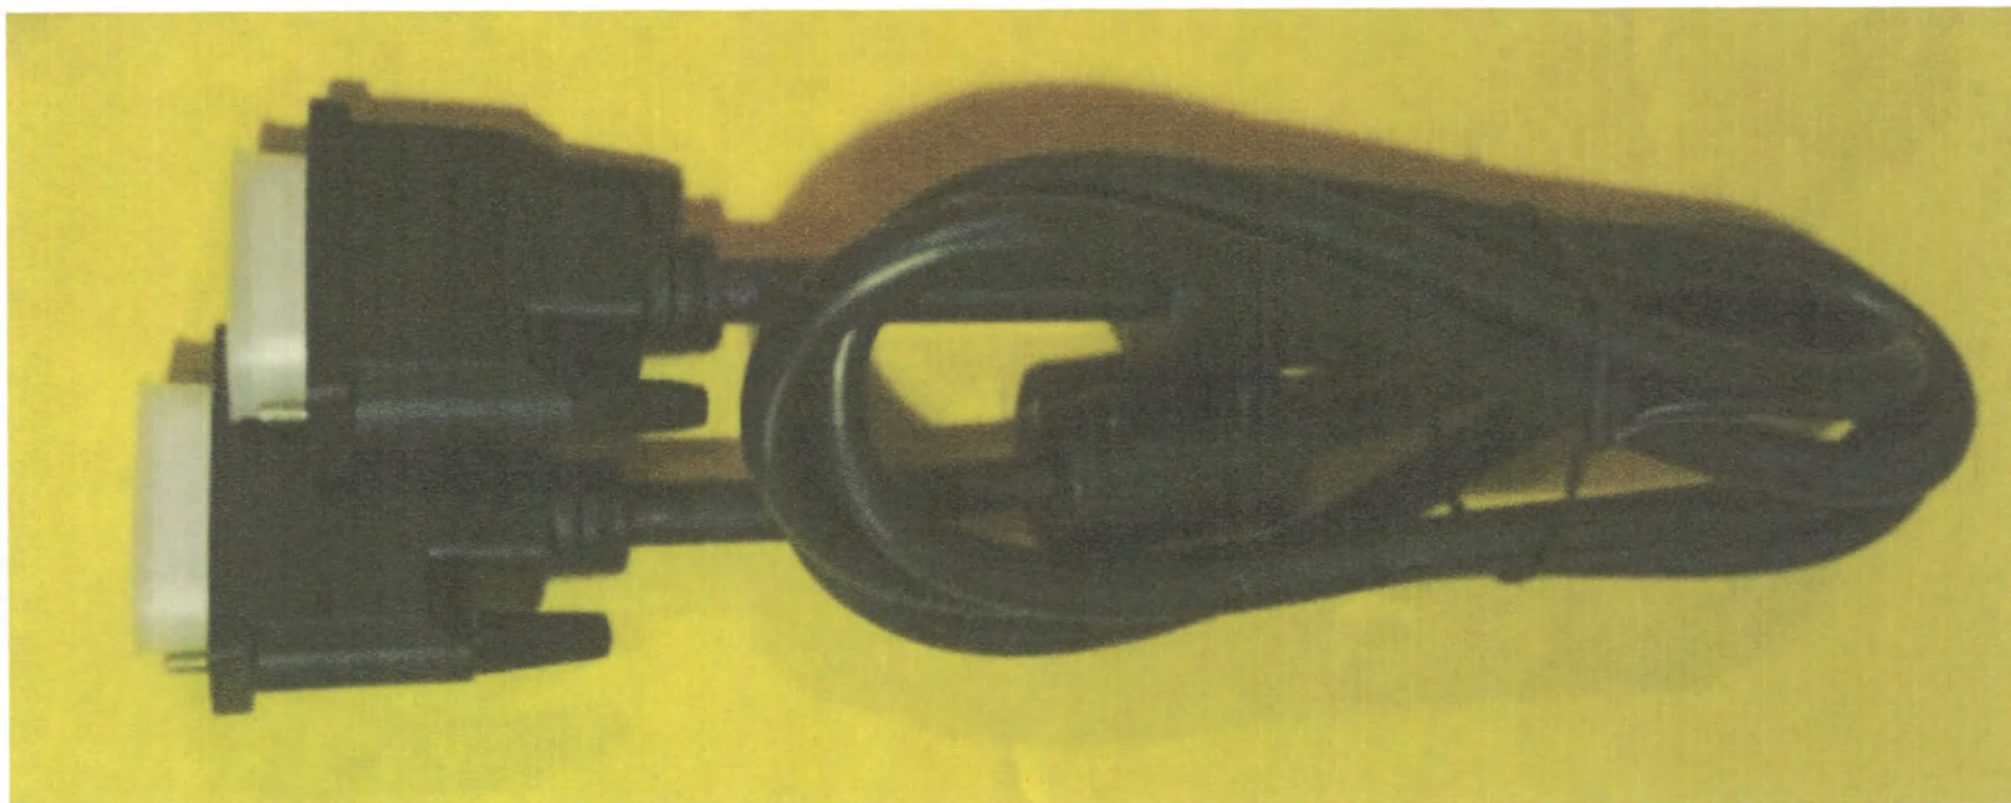

Цифровой сигнальный кабель DVI



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСПЛЕЕВ С БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD85CA


JLD-RD-GGS-278
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Просим внимательно
ознакомиться с данной
инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить
для последующего
использования.


IX. Монитор медицинский жидкокристаллический MD120C




Монитор

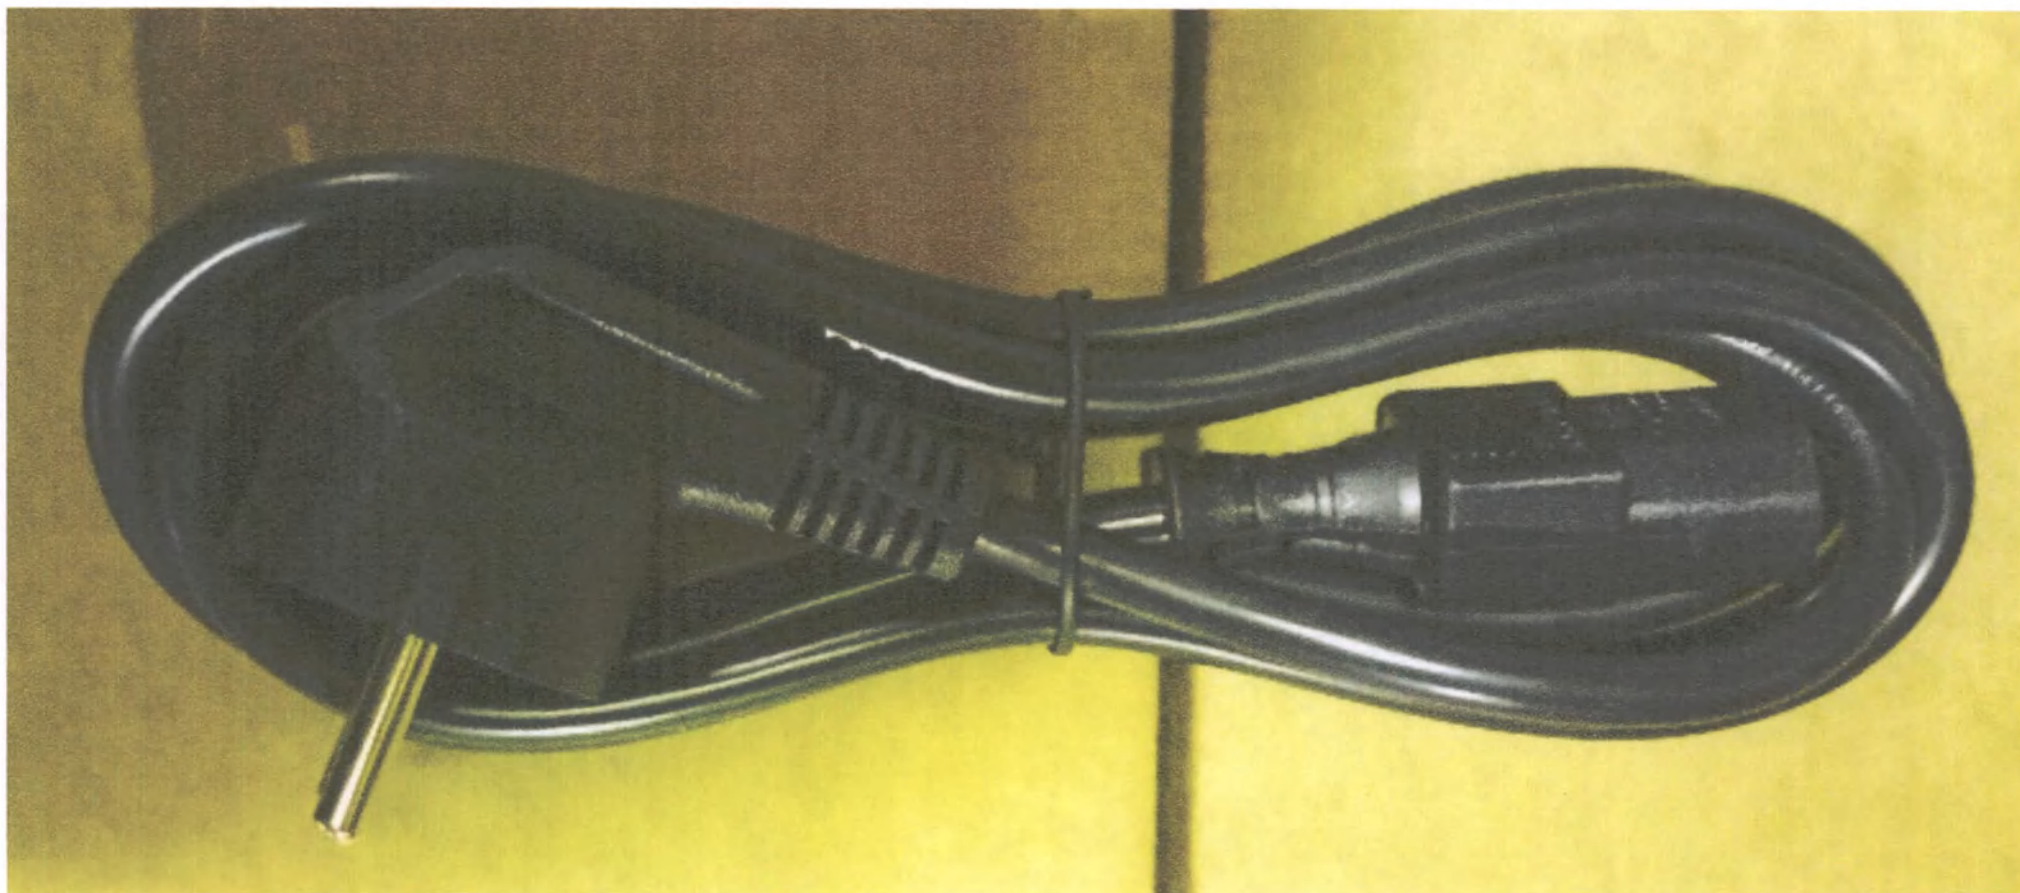

Шнур питания

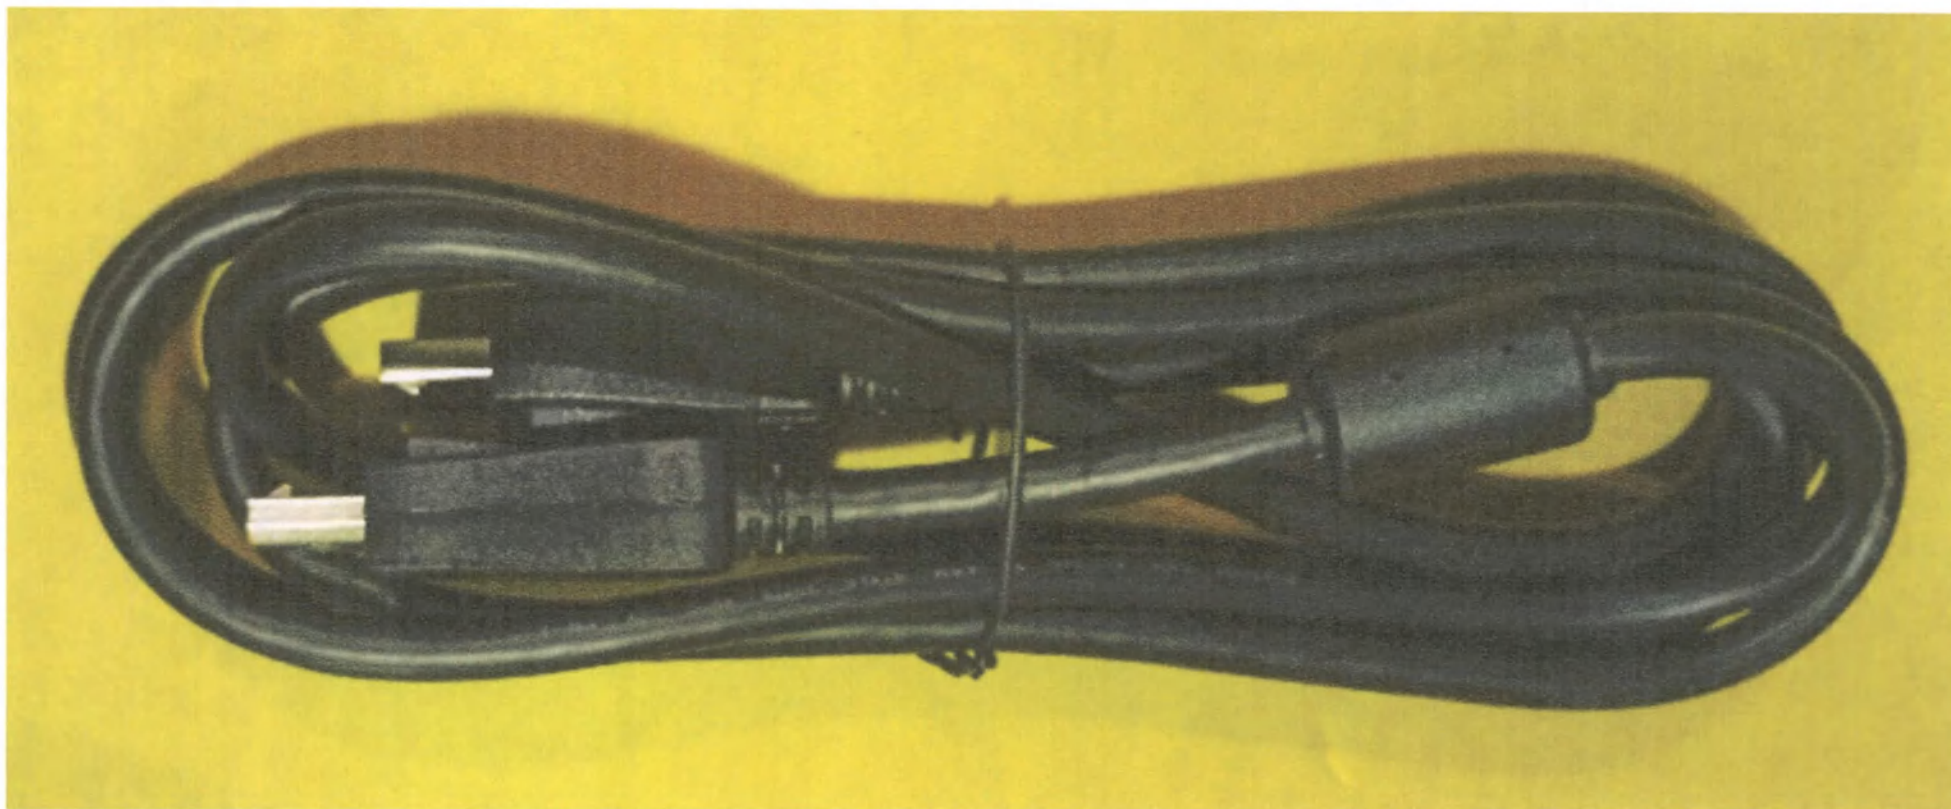

Цифровой сигнальный кабель DP



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ
С БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

МОНИТОР МЕДИЦИНСКИЙ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

Модель: MD120C

JLD-RD-GGS-288
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Просим внимательно
ознакомиться с данной
инструкцией перед
эксплуатацией и сохранить
для последующего
использования.

Паспорт качества ОТК



Гарантийный талон



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

装箱清单

1/1

开箱检验:

每件设备应如下物品, 请打开包装箱检查, 核对装箱单物品是否

与齐全, 若有损坏或短缺物品, 请及时与经销商联系, 谢谢合作!

Each device should arrive with following as below, please open your box and check

whether it is complete, if there is any damage or shortage, please contact the distributor

in time. Thanks for your cooperation.

序号/NO.	物品名称/Material Name	数量 QTY	是否包含 Contain Y/N
1	液晶显示器/LCD Monitor	1	✓
2	电源适配器/Power Adapter	1	✓
3	电源线/Power Cable	1	✓
4	医疗显示/Medical Display Card	1	✓
5	VGA信号线/VGA Cable	1	✓
6	DVI信号线/DVI Cable	1	✓
7	DVI信号线/DVI Cable	1	✓
8	BNC信号线/BNC Cable	1	✓
9	S-VIDEO信号线/S-VIDEO Cable	1	✓
10	RS232信号线/RS232 Cable	1	✓
11	USB信号线/USB Cable	1	✓
12	音频线/Audio Cable	1	✓
13	信号卡/Signal Card	1	✓
14	说明书/User Manual	1	✓
15	测试报告/Test Report	1	✓
16	其它/Others		

Макеты маркировки медицинского изделия

Идентификационная табличка монитора MD17G

 **Reshin**

Model No.: MD17G

Name: LCD Monitor

Input : 100-240V~50/60Hz 0.5A



SERIAL NUMBER:



MD17G**19W20373634

EAC



CAUTION: High voltage in the monitor,
only qualified can open it!

Manufacturer: Shenzhen JLD Display Expert Co., Ltd
Address: B1001, Mogen Industrial Park, Building 1, No.10,
Shilongzai Road, Xinshi Community, Dalang Street,
Longhua District, Shenzhen City

Made in China

Изображение маркировки адаптера переменного тока, артикул GSM120A24-JLD



Упаковка медицинского изделия

Боковая часть:



Фронтальная часть:



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 59 листов.
Генеральный директор
ООО «ЛЕГИОН»
Мошкин И.С.

