


УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

 Сюн Вэй

«15» августа 2024г.


Фотографические изображения медицинского изделия

**Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями: варианты исполнения
WATO EX-65, WATO EX-65 Pro**

**производства Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.) («Шэньчжэнь
Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай.**

1. Блок основной WATO EX-65 – 1 шт.




1.1 Блок основной WATO EX-65 Pro – 1 шт.



1. Кабель питания - не более 5 шт



2. Руководство оператора WATO EX-65 – 1 шт

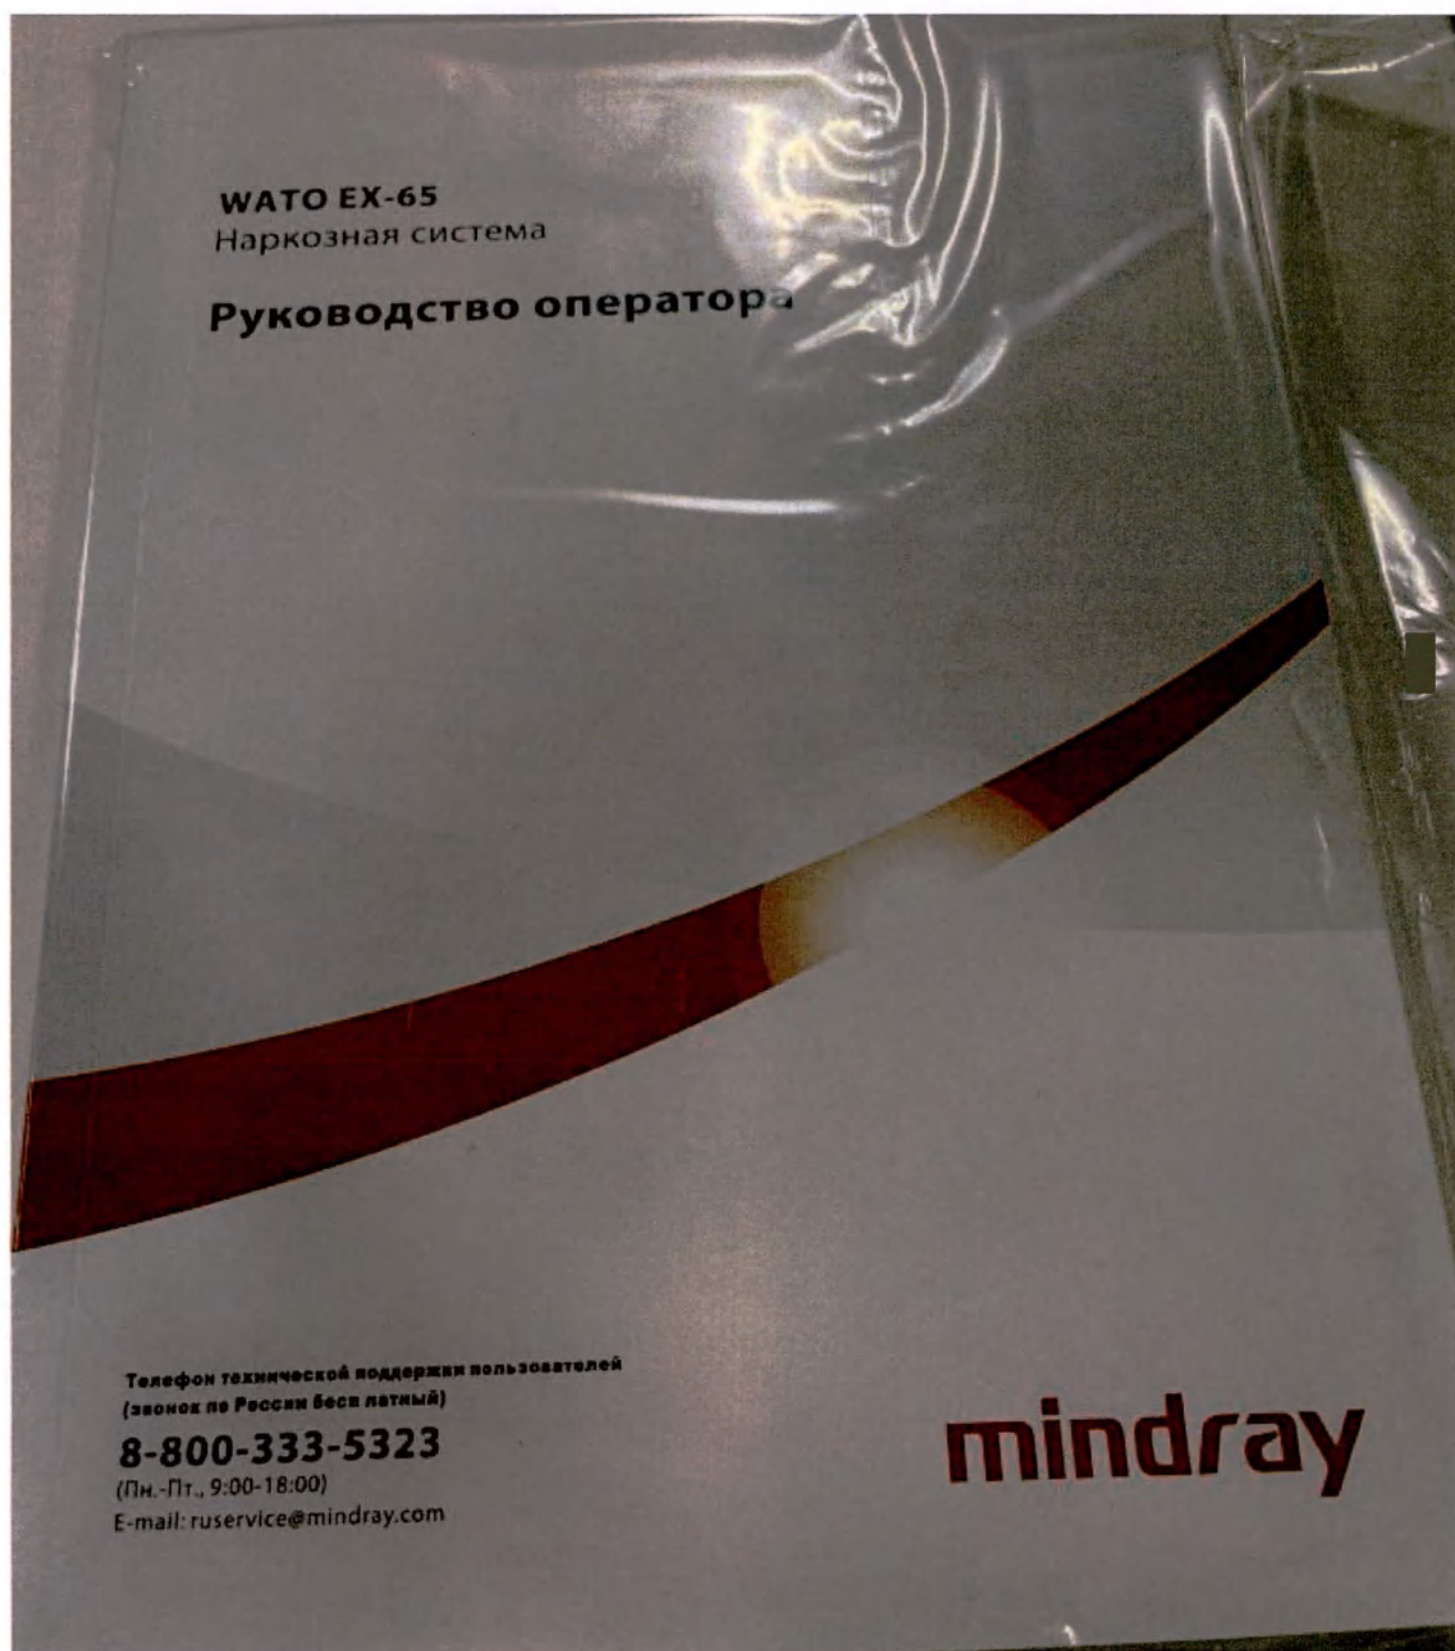

WATO EX-65
Наркозная система

Руководство оператора

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)

8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)

E-mail: ruservice@mindray.com

mindray

WATO EX-65 Pro
Наркозная система

Руководство оператора

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)

8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)

E-mail: ruservice@mindray.com

mindray

WATO EX-55 Pro/65 Pro

НАРКОЗНЫЙ АППАРАТ

План предоперационной проверки

Эти рекомендации можно изменять в соответствии с клиническими процедурами, принятыми в медицинском учреждении.

Данная проверка должна выполняться перед проведением анестезии. Подобные изменения на местах должны быть соответствующим образом проконтролированы ответственными лицами. Описание специальных процедур и мер предосторожности следует смотреть в руководстве оператора. Для получения пошаговых инструкций необходимо обратиться к соответствующей главе руководства оператора.

Ежедневно перед проведением анестезии должны быть выполнены следующие действия


- При подключении наркозного аппарата к электросети переменного тока приведите сетевой выключатель в положение ВКЛ и убедитесь, что устройство работает от сети. Следуя появляющимся на экране подсказкам, полностью выполните самопроверку системы.
- Убедитесь, что при сбое подачи O_2 подается сигнал тревоги и появляется соответствующее сообщение (сообщение также должно появляться при нормальной работе системы подачи), что при низкой концентрации O_2 , высоком и низком давлении в воздуховоде, а также при низком значении минутного объема и при апноэ подаются соответствующие сигналы тревоги.
- Убедитесь, что показания датчика O_2 составляют приблизительно 21 % при комнатной температуре и более 95 % при воздействии чистого O_2 (100 %).
- Убедитесь, что испарители установлены должным образом и достаточно наполнены, а отверстия для заправки тщательно закрыты. Убедитесь, что одновременно включен только один испаритель.
- Проверка обратного давления испарителя. При наличии левого испарителя включите его и проведите проверку обратного давления испарителя. Выключите испаритель. Проведите аналогичную процедуру с правым испарителем, если он установлен.
- Убедитесь, что поплавок СУГА движется свободно. Настройте отрицательное давление таким образом, чтобы поплавок находился между минимальной и максимальной отметками.
- Удалите всю жидкость из влагоотделителя дыхательной системы.

Перед проведением анестезии каждому новому пациенту должны быть выполнены следующие действия

- Осмотрите наркозный аппарат на предмет повреждений и нарушений безопасности. Убедитесь, что в наличии имеется все необходимое оборудование и материал, т. е. медикаменты, поглотитель CO_2 (не отработанный), дыхательные контуры и гаечный ключ для баллонов.

(ОКОНЧАНИЕ)


4. Магистраль высокого давления для кислорода — не более 5 шт.

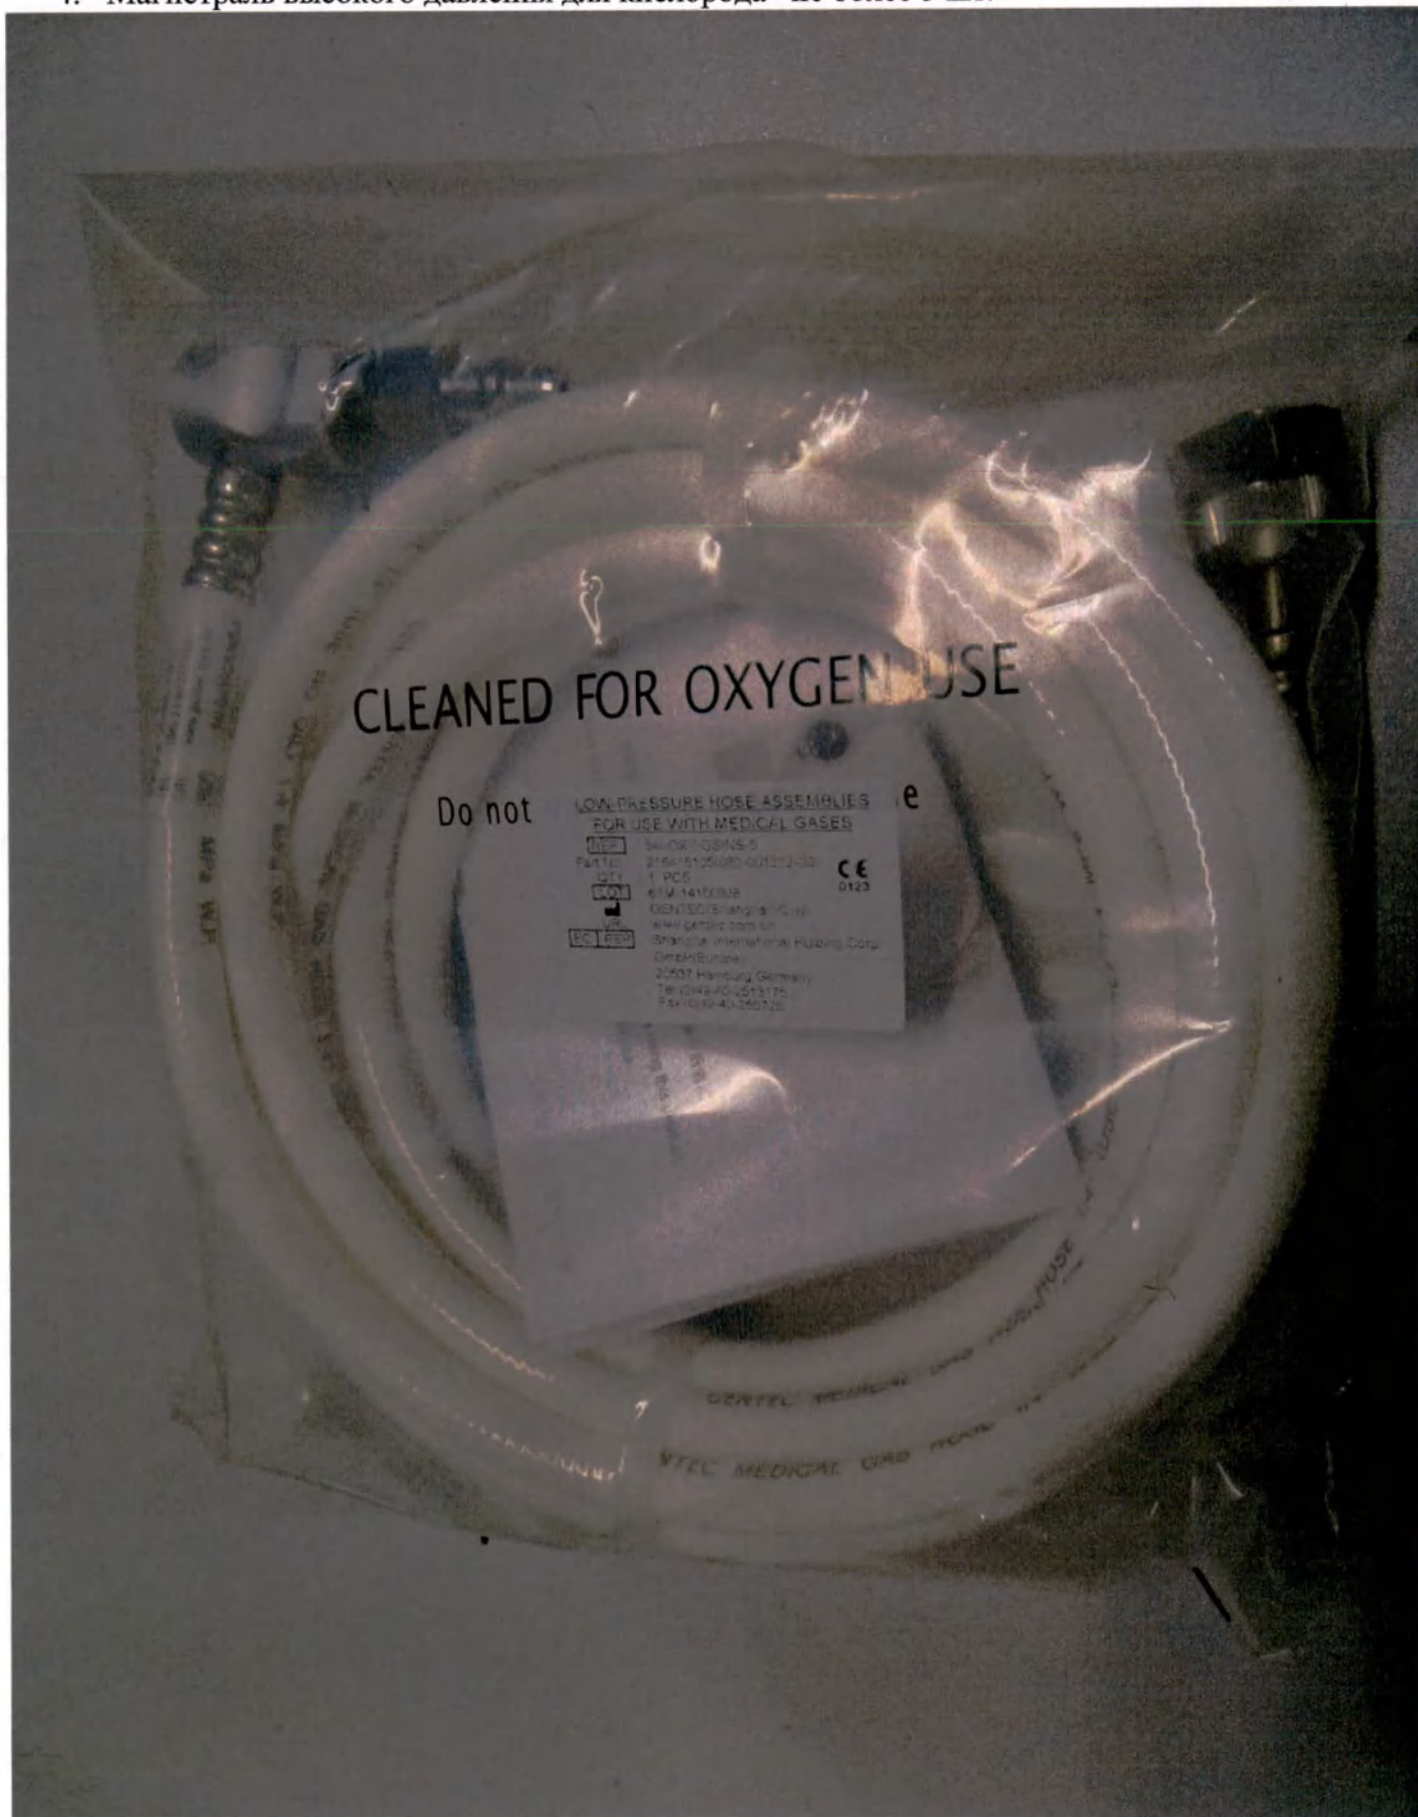

5. Батарея аккумуляторная литий-ионная – не более 3 шт.



6. Встроенный воздушный компрессор – 1 шт. (при необходимости).

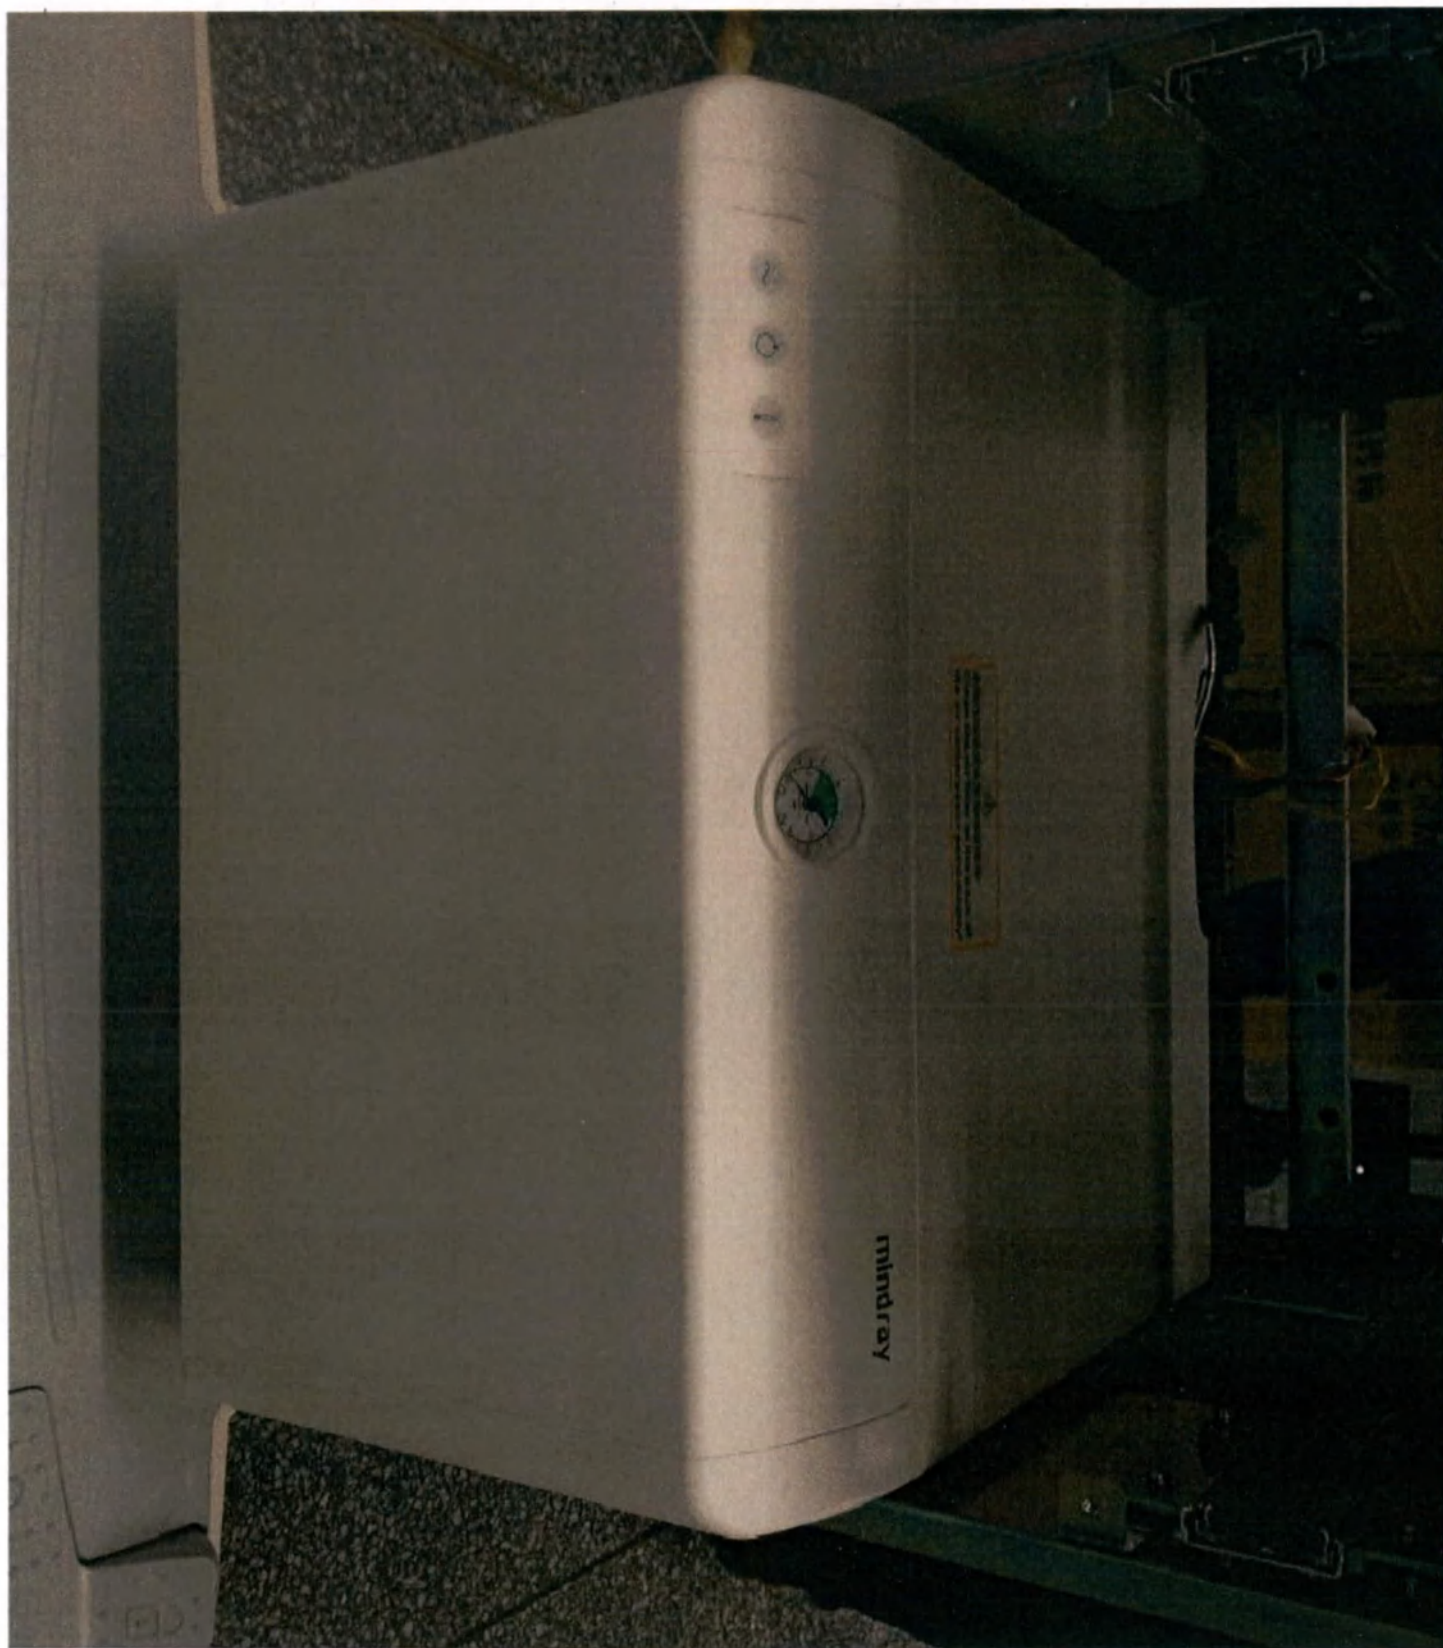

7. Дыхательный контур с ёмкостью для насыпного абсорбента без функции BYPASS – 1 шт.
(при необходимости).



8. Дыхательный контур с ёмкостью для насыпного абсорбента с функцией BYPASS – 1 шт. (при необходимости).



9. Дыхательный контур с ёмкостью для предупакованного абсорбента – 1 шт. (при необходимости).



10. Модуль капнометрии в основном потоке – не более 2 шт. (при необходимости).




11. Набор принадлежностей для капнометрии в основном потоке – не более 30 шт. (при необходимости), в составе:

- Адаптер, для подключения в дыхательный контур, взрослые/дети – 1 шт.
- Адаптер, для подключения в дыхательный контур, неонатальный – 1 шт.
- Клипса-держатель кабеля – 5 шт.
- Датчик CO₂ CAPNOSTAT – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.



12. Модуль капнометрии в боковом потоке – не более 2 шт. (при необходимости).

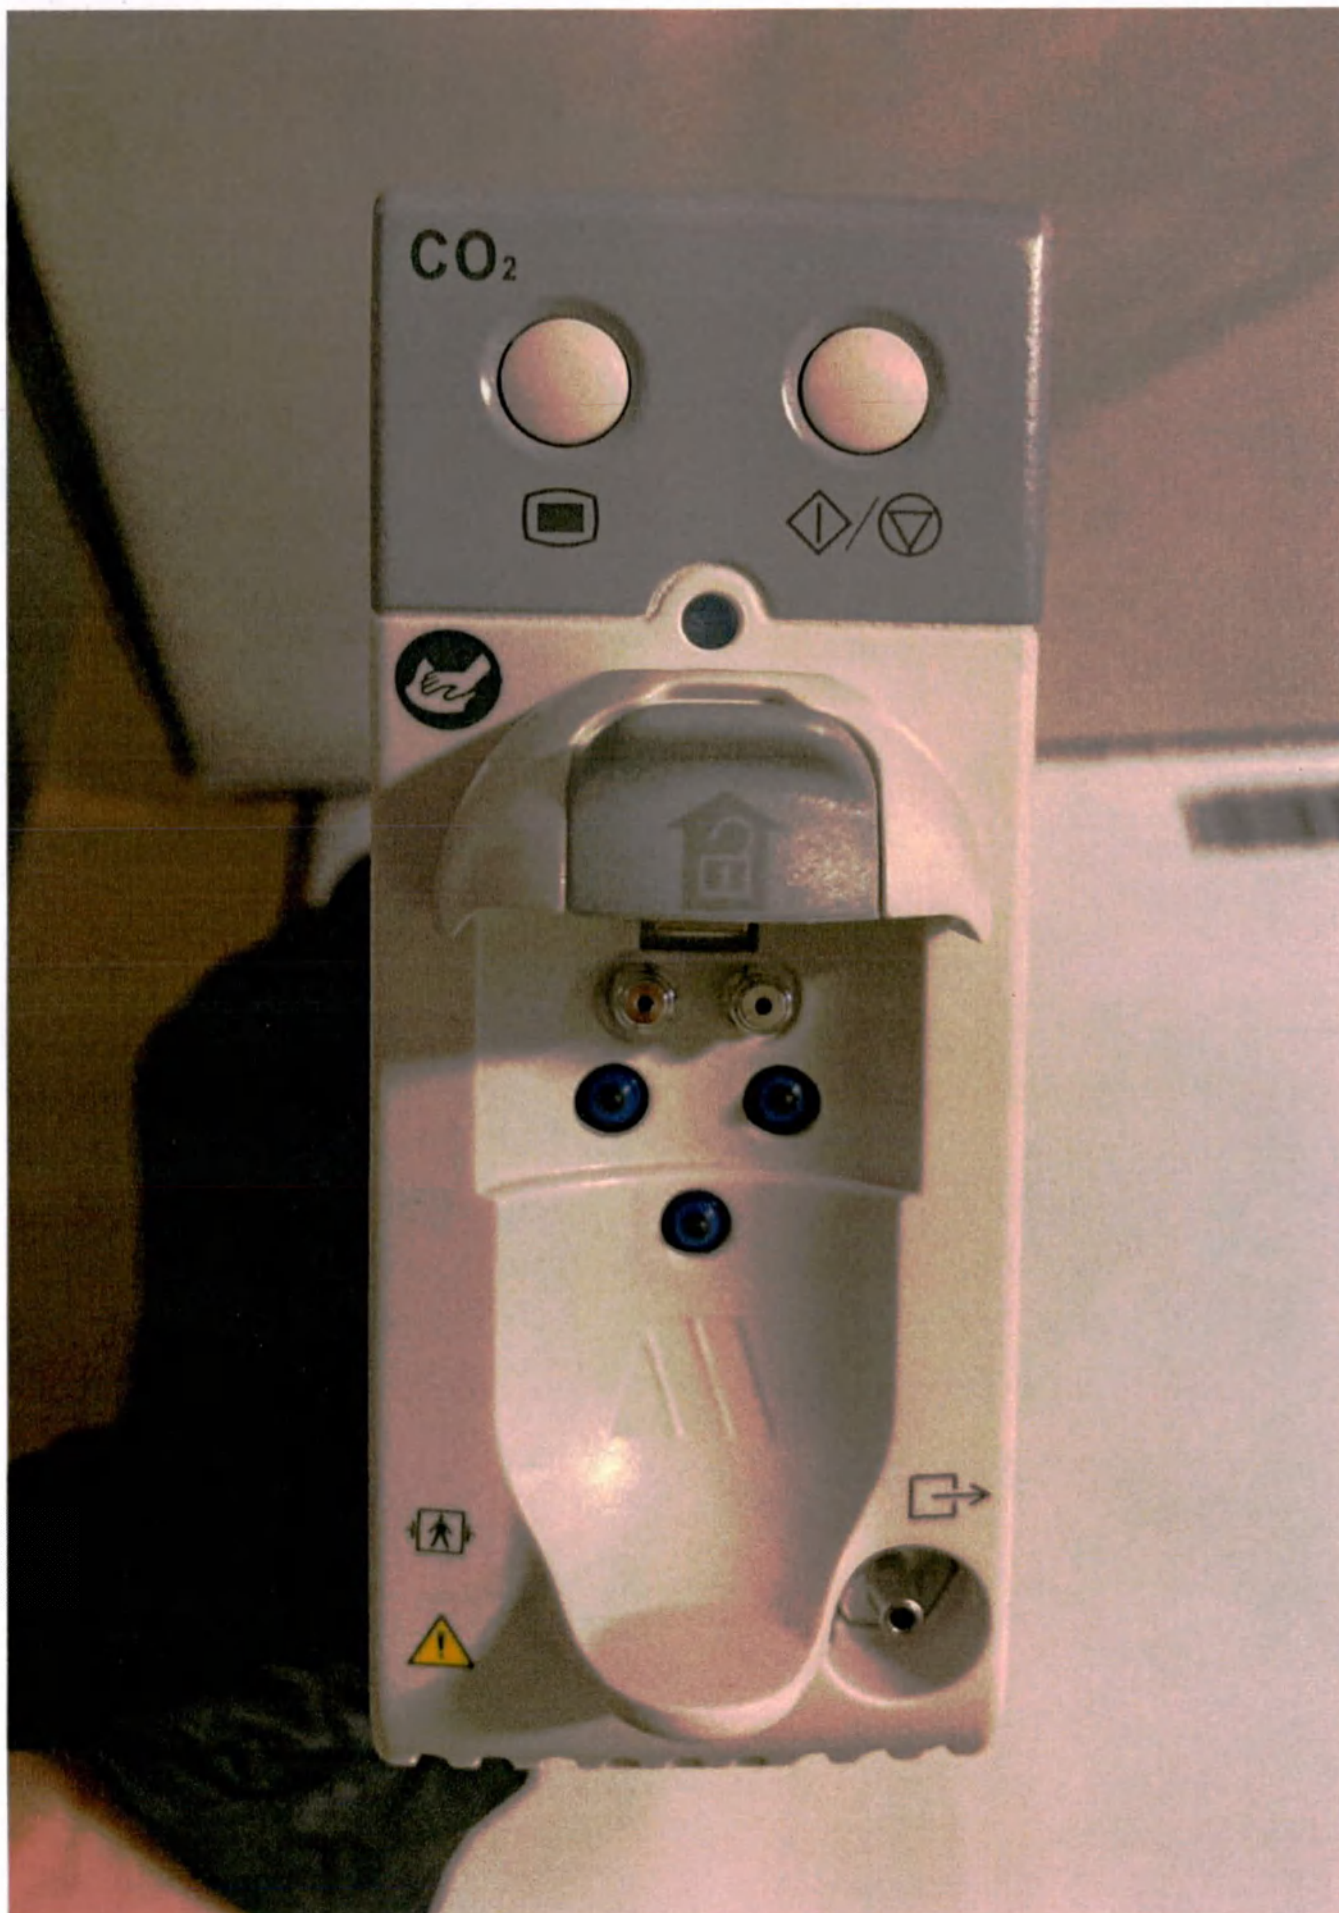

13. Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке, для взрослых/детей - не более 30 шт. (при необходимости), в составе:

- Линия забора пробы газа – 2 шт.
- Адаптер для подключения в дыхательный контур – 2 шт.
- Влагосборник – 2 шт.
- Соединительная трубка с быстросъемным адаптером – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.




14. Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке, неонатальный - не более 30 шт.

(при необходимости), в составе:


- Линия забора пробы газа – 2 шт.
- Адаптер для подключения в дыхательный контур – 2 шт.
- Влагосборник – 2 шт.
- Соединительная трубка с быстросъемным адаптером – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.



15. Модуль газоанализа с парамагнитным датчиком кислорода – не более 2 шт. (при необходимости).

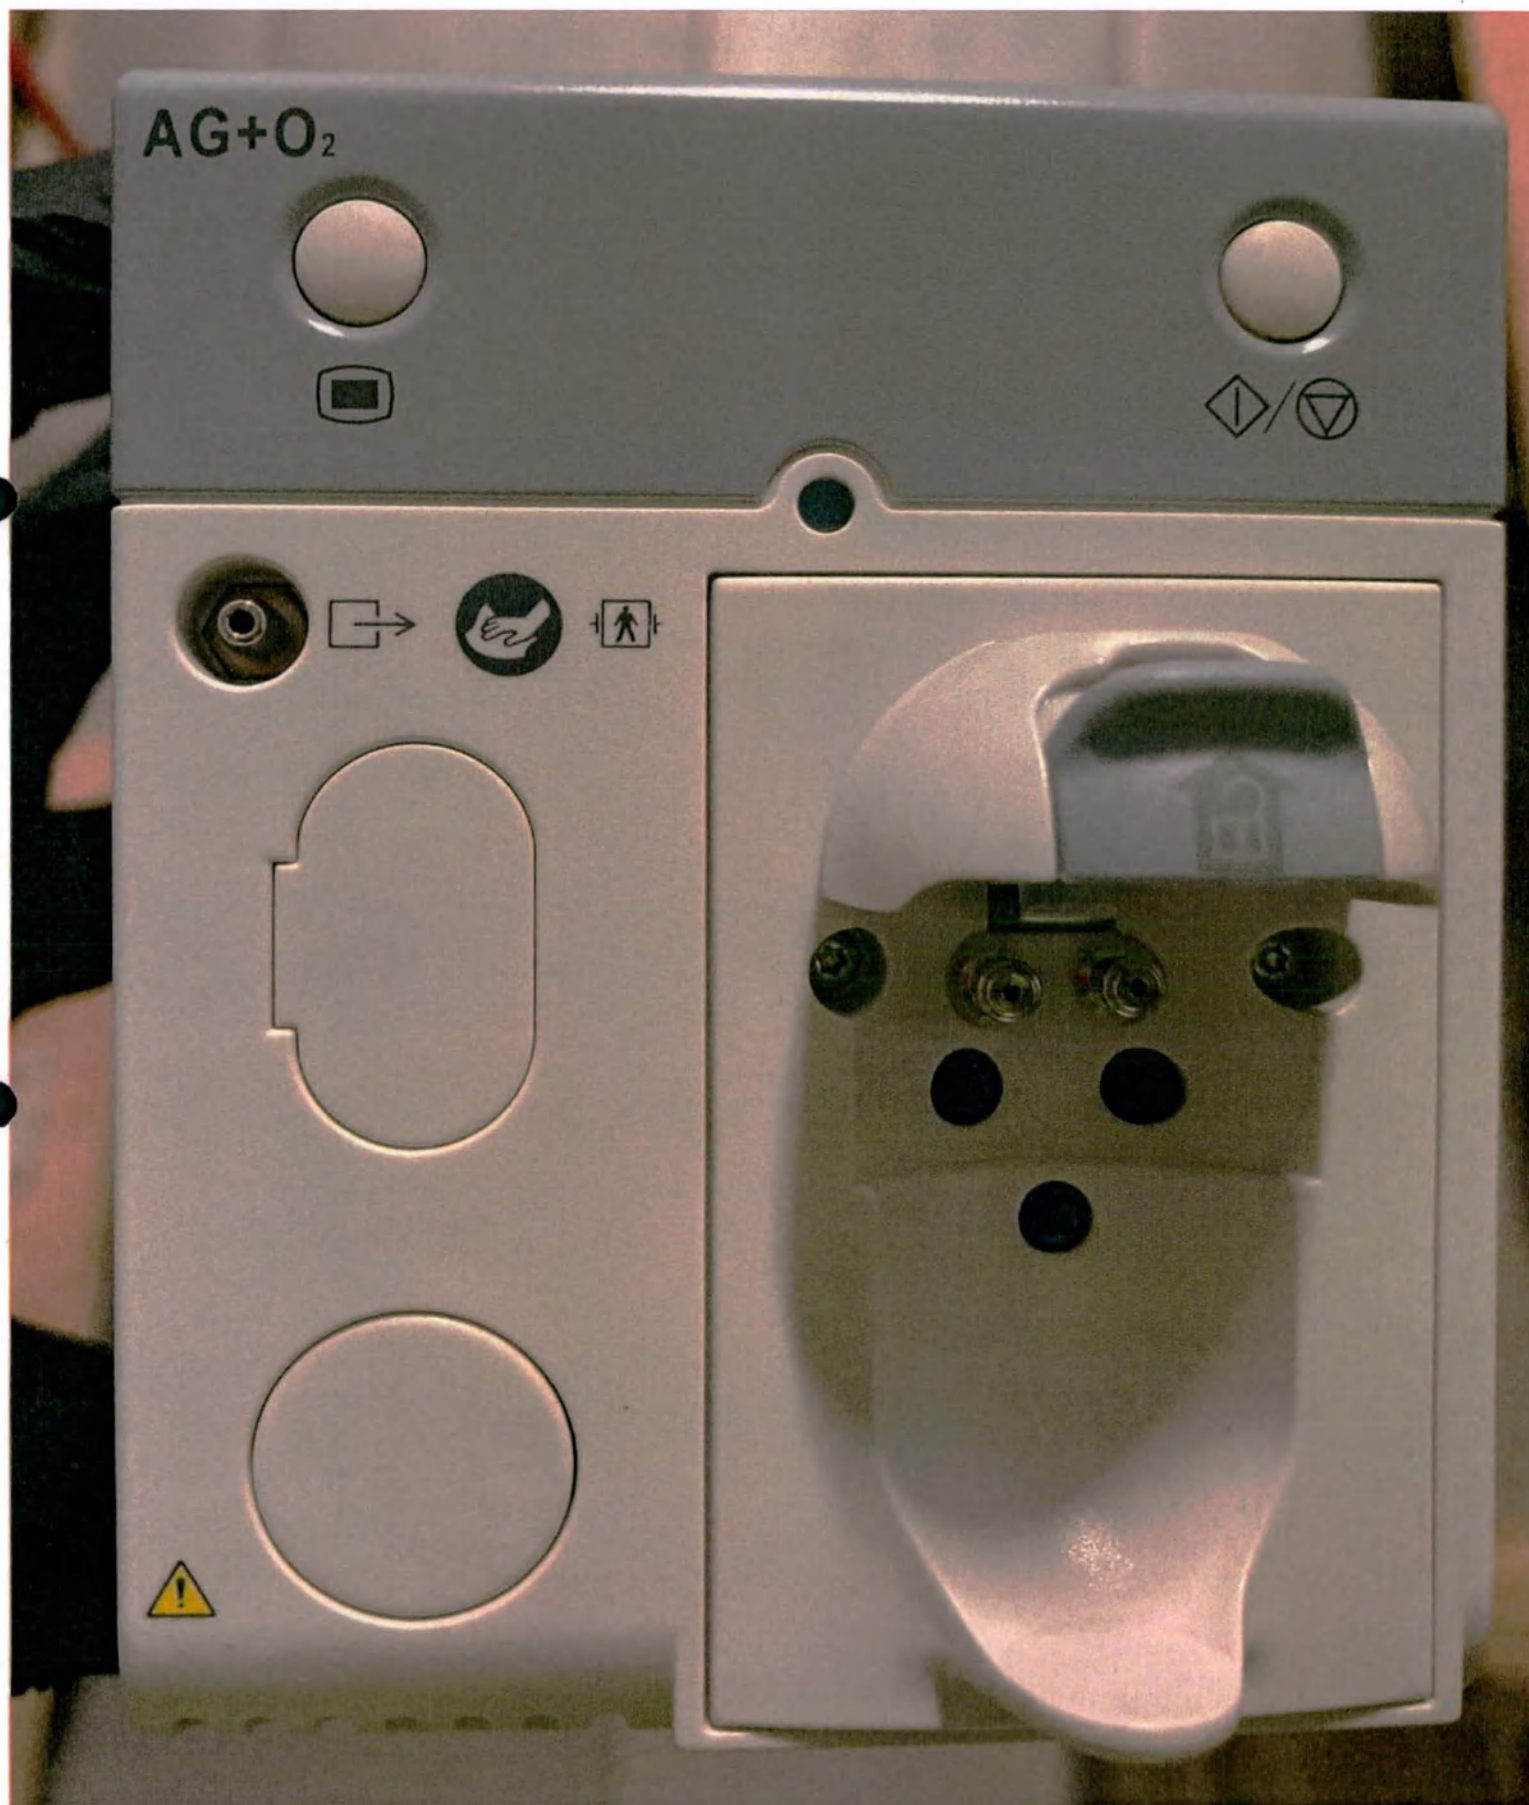


16. Модуль газоанализа без парамагнитного датчика кислорода – не более 2 шт. (при необходимости).

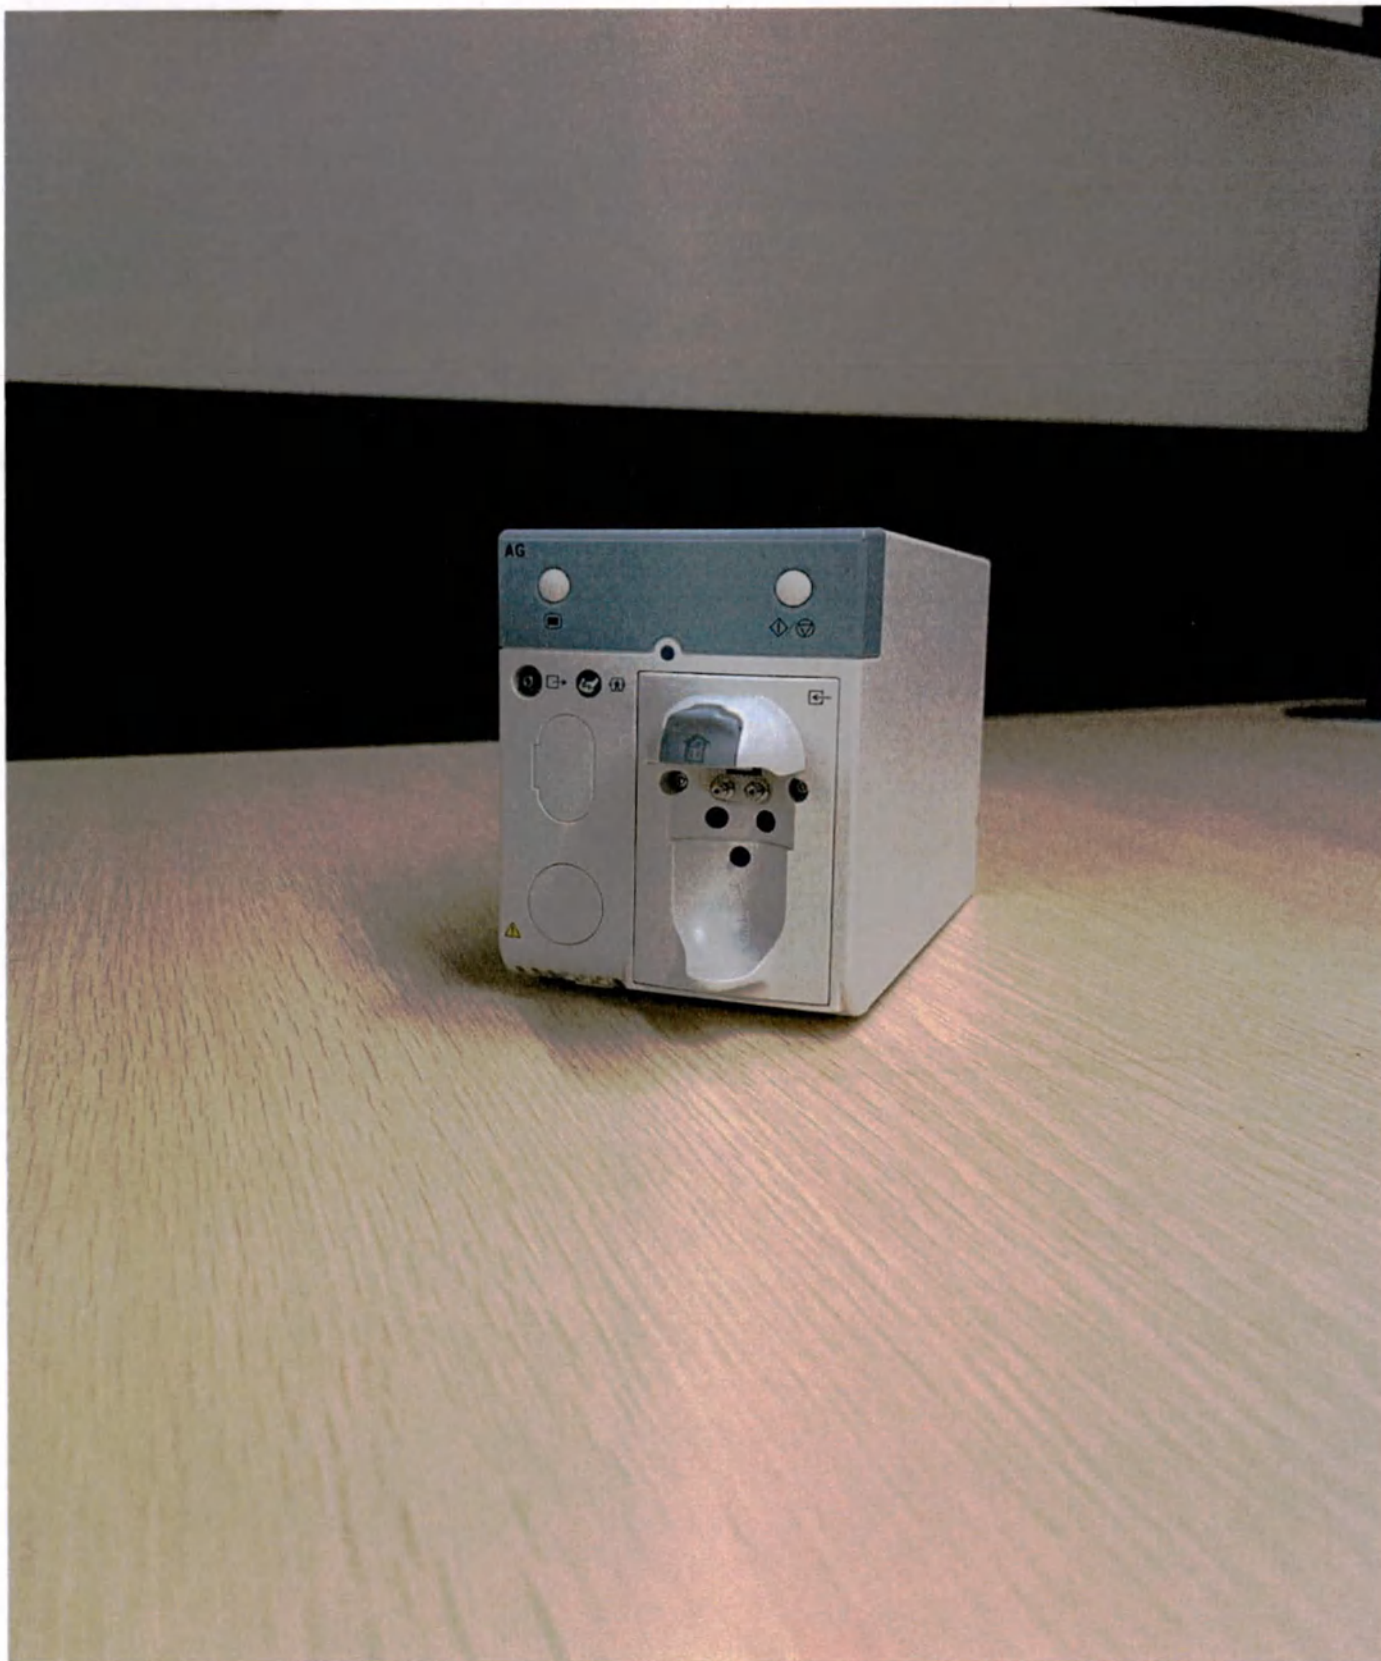

17. Модуль газоанализа с парамагнитным датчиком кислорода и с BIS – не более 2 шт. (при необходимости).



18. Модуль газоанализа без парамагнитного датчика кислорода и с BIS – не более 2 шт. (при необходимости).

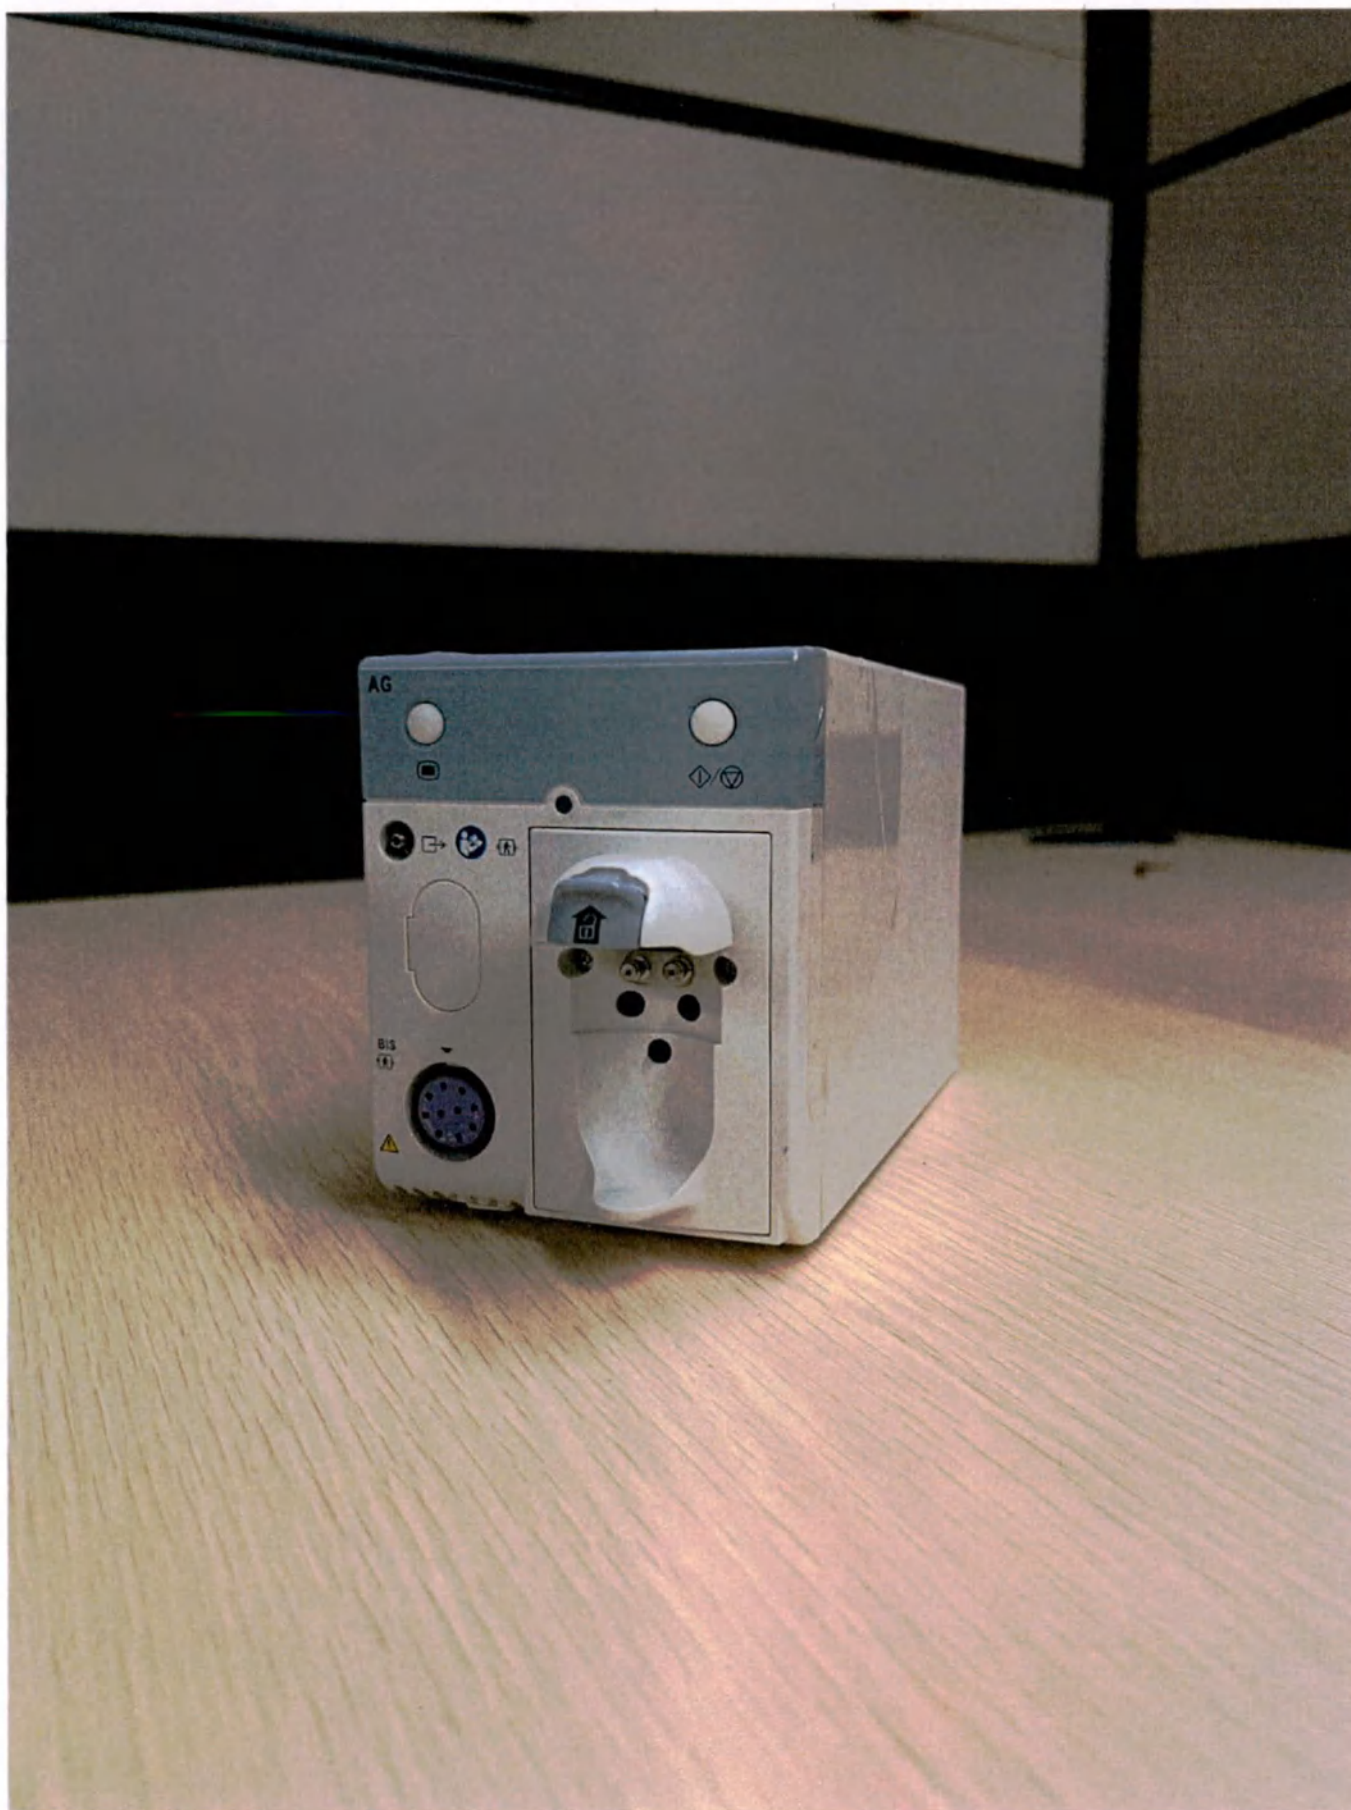

19. Набор расходных материалов для модуля газоанализа – не более 50 шт. (при необходимости), в составе:

- Адаптер прямой, взрослый/детский - 2 шт.;
- Адаптер неонатальный - 2 шт.;
- Влагосборник взрослый/детский - 2 шт.;
- Влагосборник неонатальный - 2 шт.;
- Линия забора пробы газа взрослая/детская - 2 шт.;
- Линия забора пробы газа неонатальная - 2 шт.;
- Соединительная трубка с быстросъемным адаптером - 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.



20. Модуль определения глубины анестезии (BIS) – не более 2 шт. (при необходимости).




21. Цифровой преобразователь сигнала с кабелем для соединения с модулем определения глубины анестезии и измерительным кабелем - не более 5 шт. (при необходимости).



22. Цифровой билатеральный преобразователь сигнала с кабелем для соединения с модулем определения глубины анестезии и измерительным кабелем - не более 5 шт. (при необходимости).




23. Сенсоры одноразовые для взрослых, не более 300 шт. (при необходимости) РУ № ФСЗ 2011/11013, производства «Covidien Llc», США.

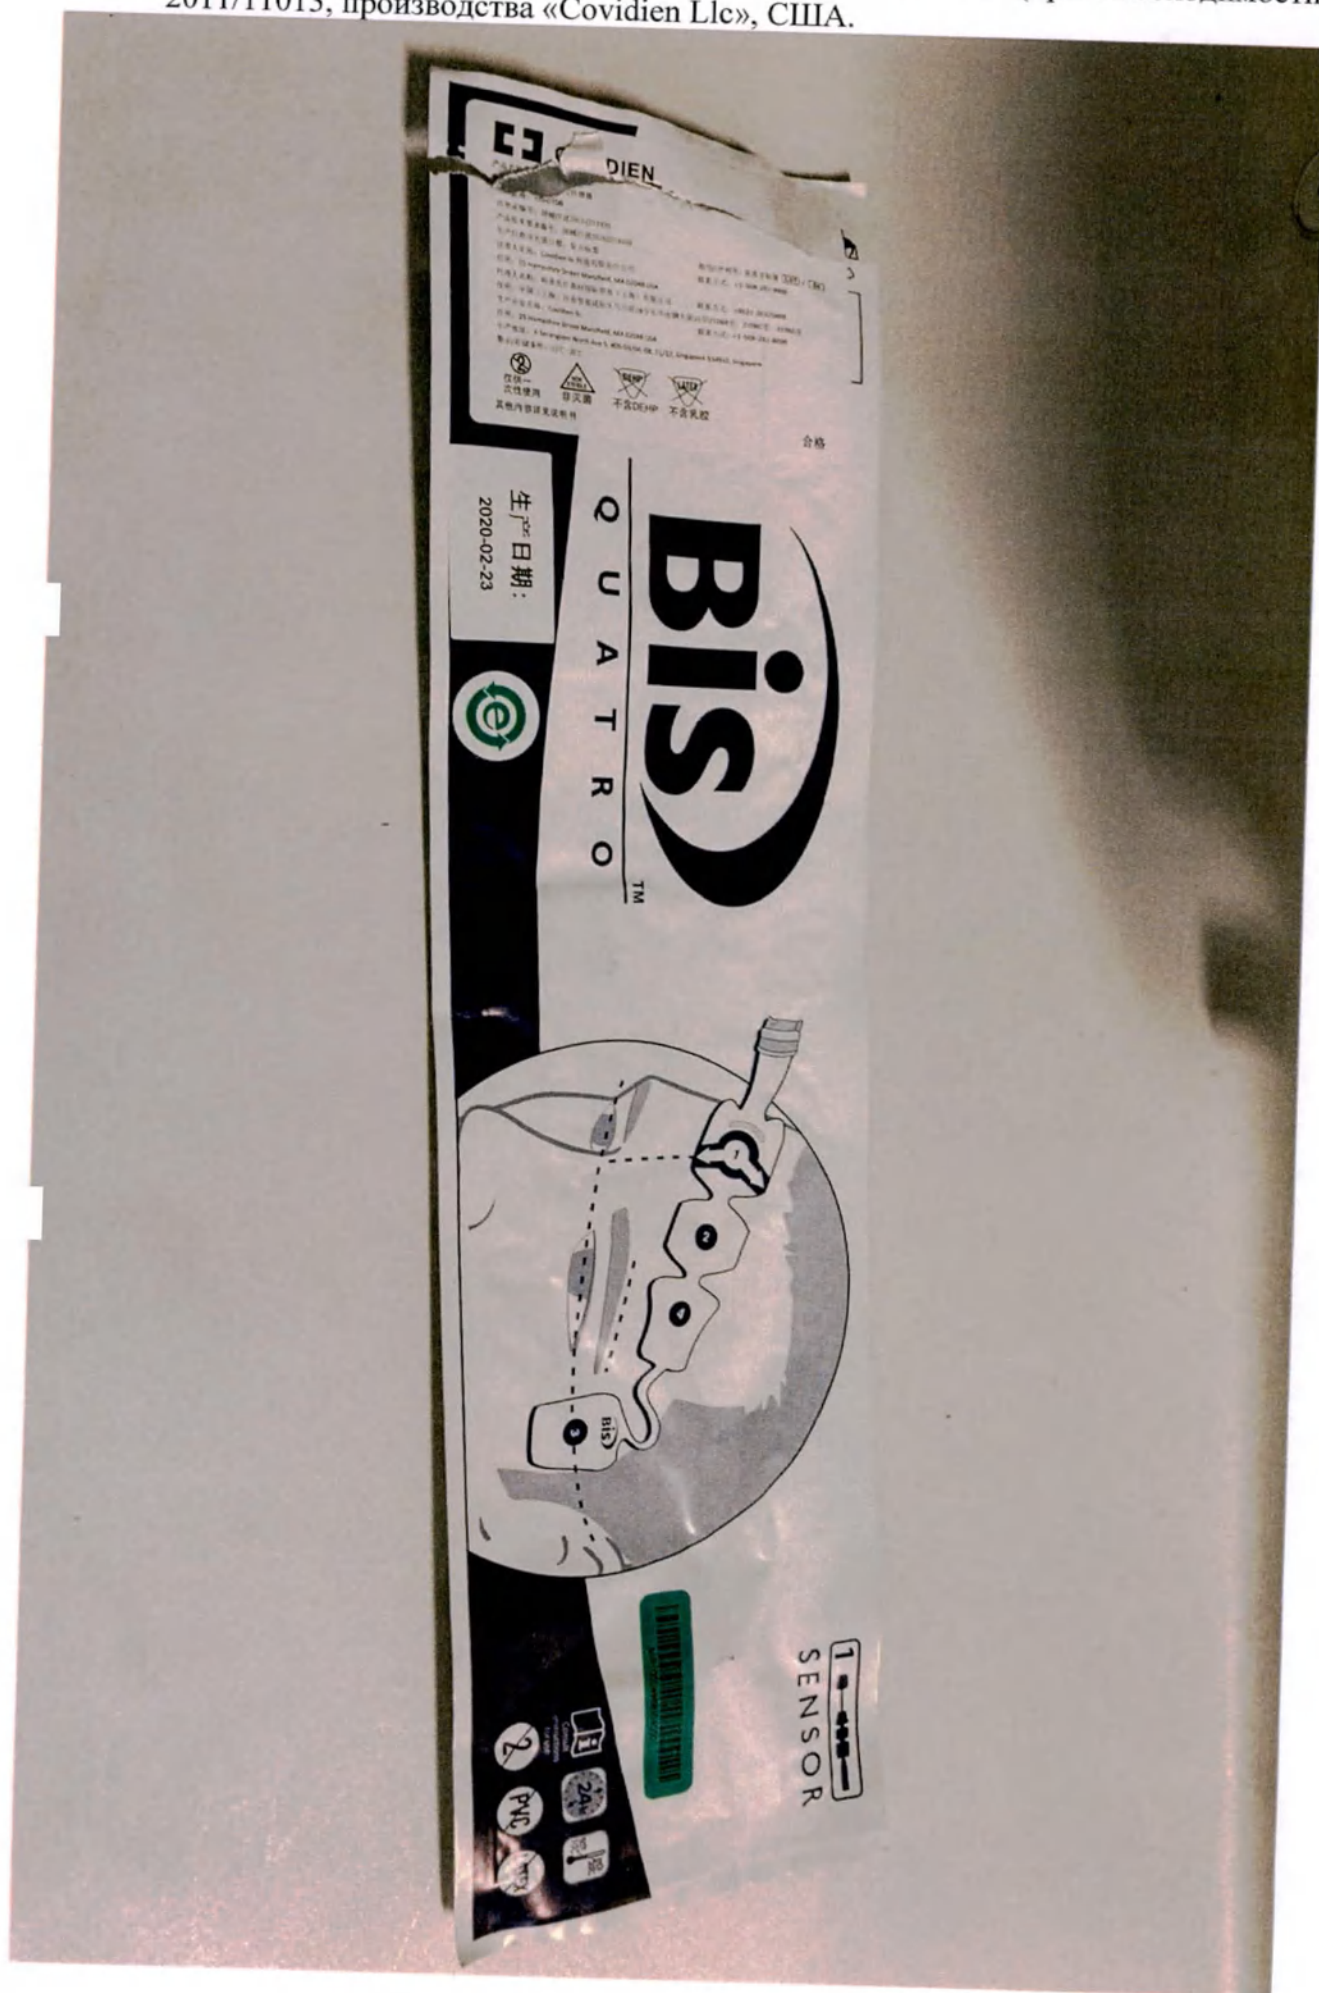

24. Сенсоры одноразовые для детей, не более 300 шт. (при необходимости) РУ № ФСЗ 2011/11013, производства «Covidien Llc», США.



25. Сенсоры одноразовые билатеральные для взрослых, не более 300 шт. (при необходимости) РУ № ФСЗ 2011/11013, производства «Covidien Llc», США.

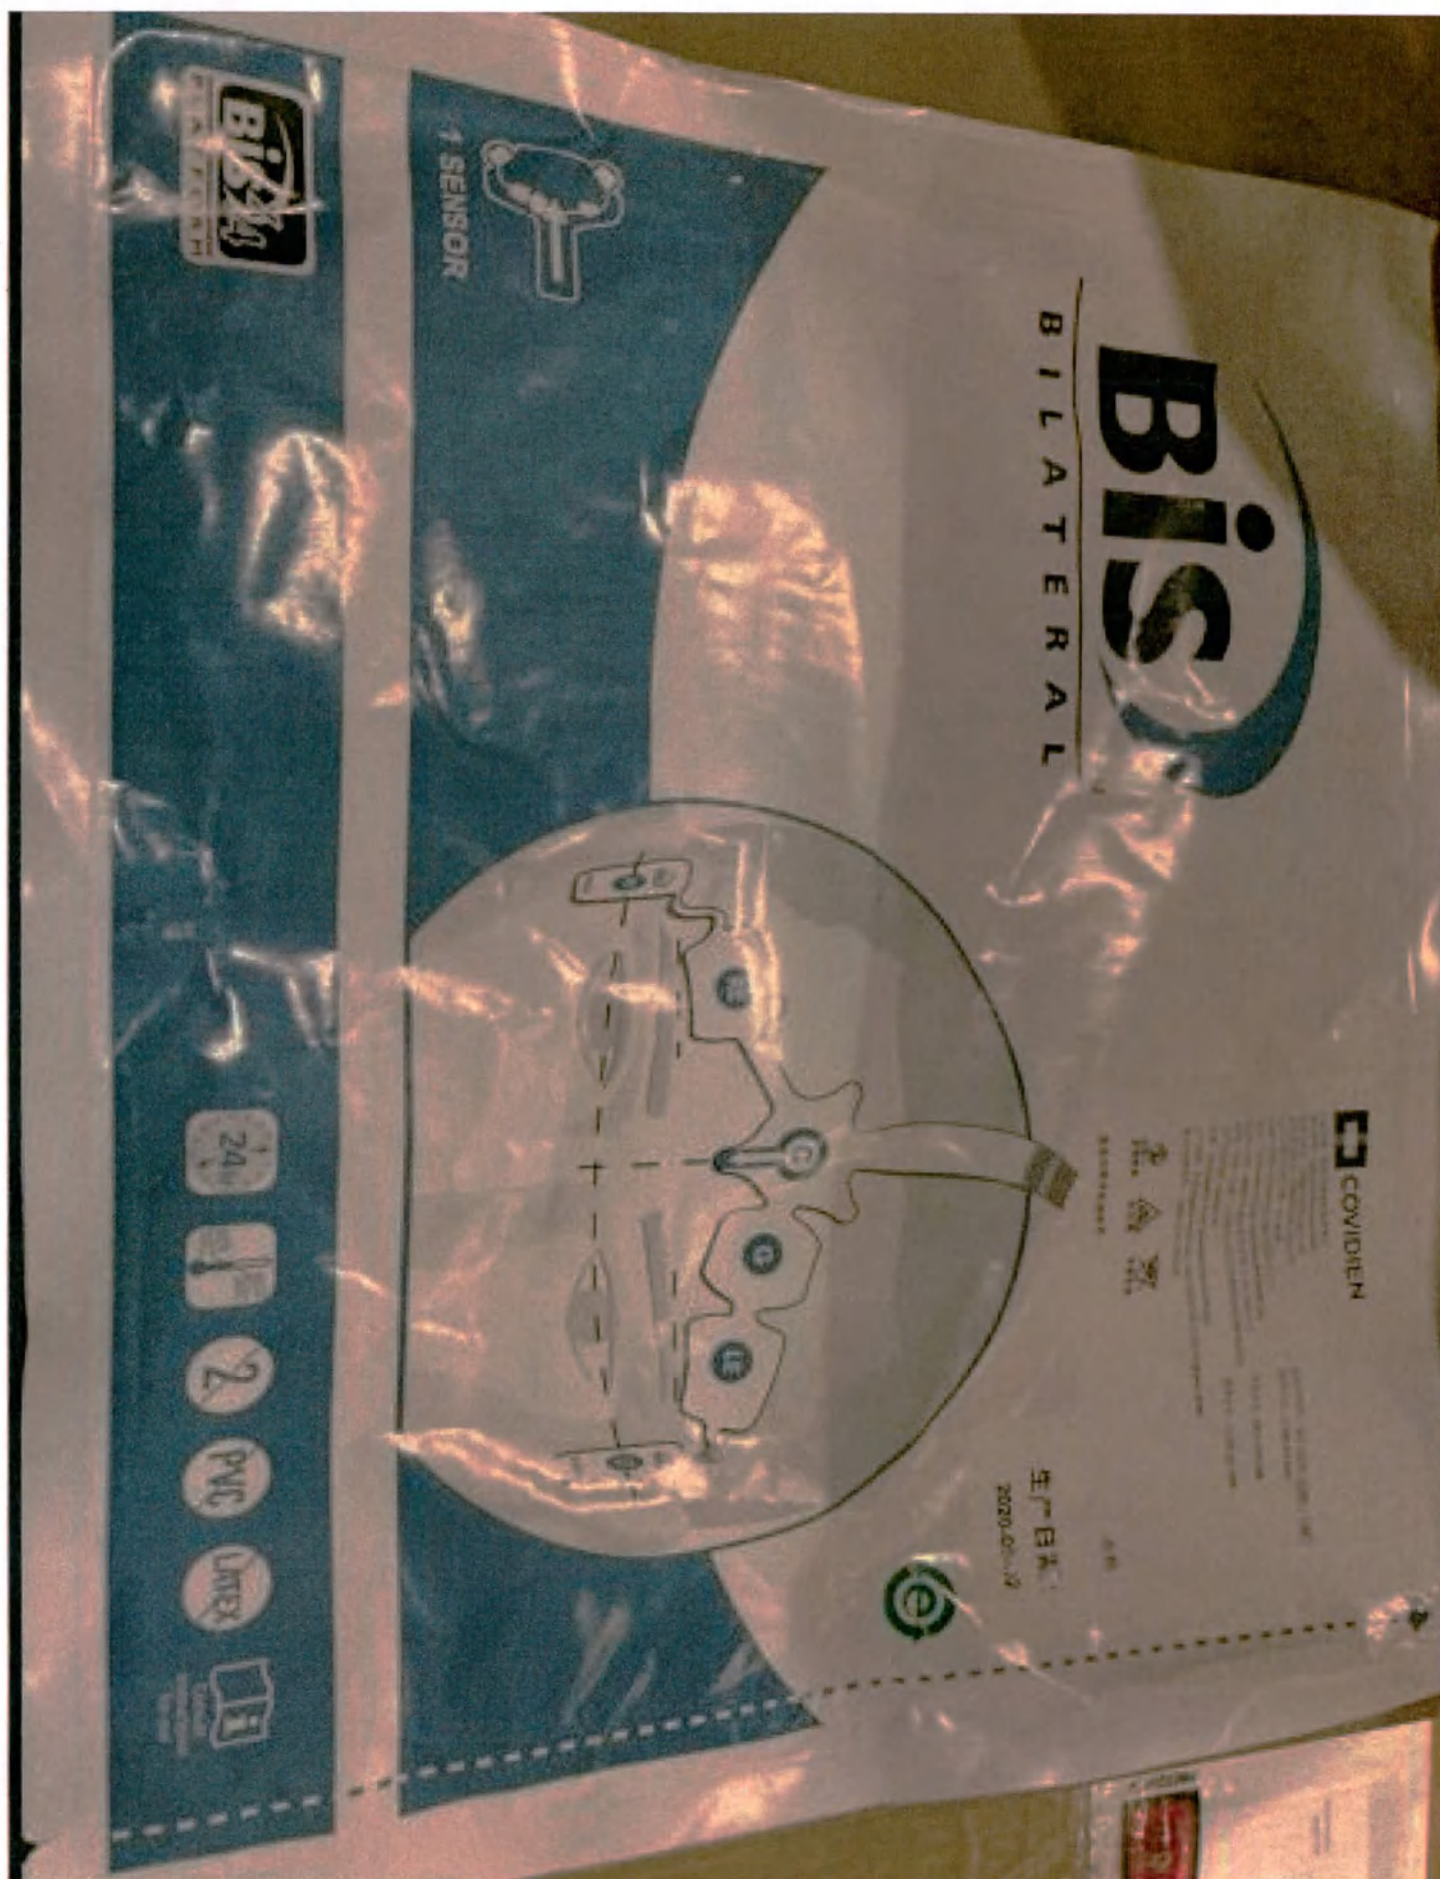

26. Модуль измерения нервно-мышечной передачи (НМП) – не более 2 шт. (при необходимости).



27. Электрод ЭКГ, взрослый, 100 шт./уп. – не более 20 уп. (при необходимости).



28. Электрод ЭКГ, взрослый, 5 шт./уп. – не более 20 уп. (при необходимости).



29. Кабель НМП – не более 10 шт. (при необходимости).



30. Датчик НМП с кабелем – не более 10 шт. (при необходимости).



31. Кабель НМП стимуляционный – не более 10 шт. (при необходимости).



32. Фиксатор для датчика НМП, одноразовый, 20 шт. в упаковке – не более 30 упаковок (при необходимости).




33. Система активного выведения анестезиологических газов (СВАГ) низкопоточная – не более 5 шт. (при необходимости), в составе:


33.1. Блок активной низкопоточной системы выведения анестезиологических газов – не более 5 шт.



33.2. Шланг активной низкопоточной системы вывода анестезиологических газов - не более 5 шт.

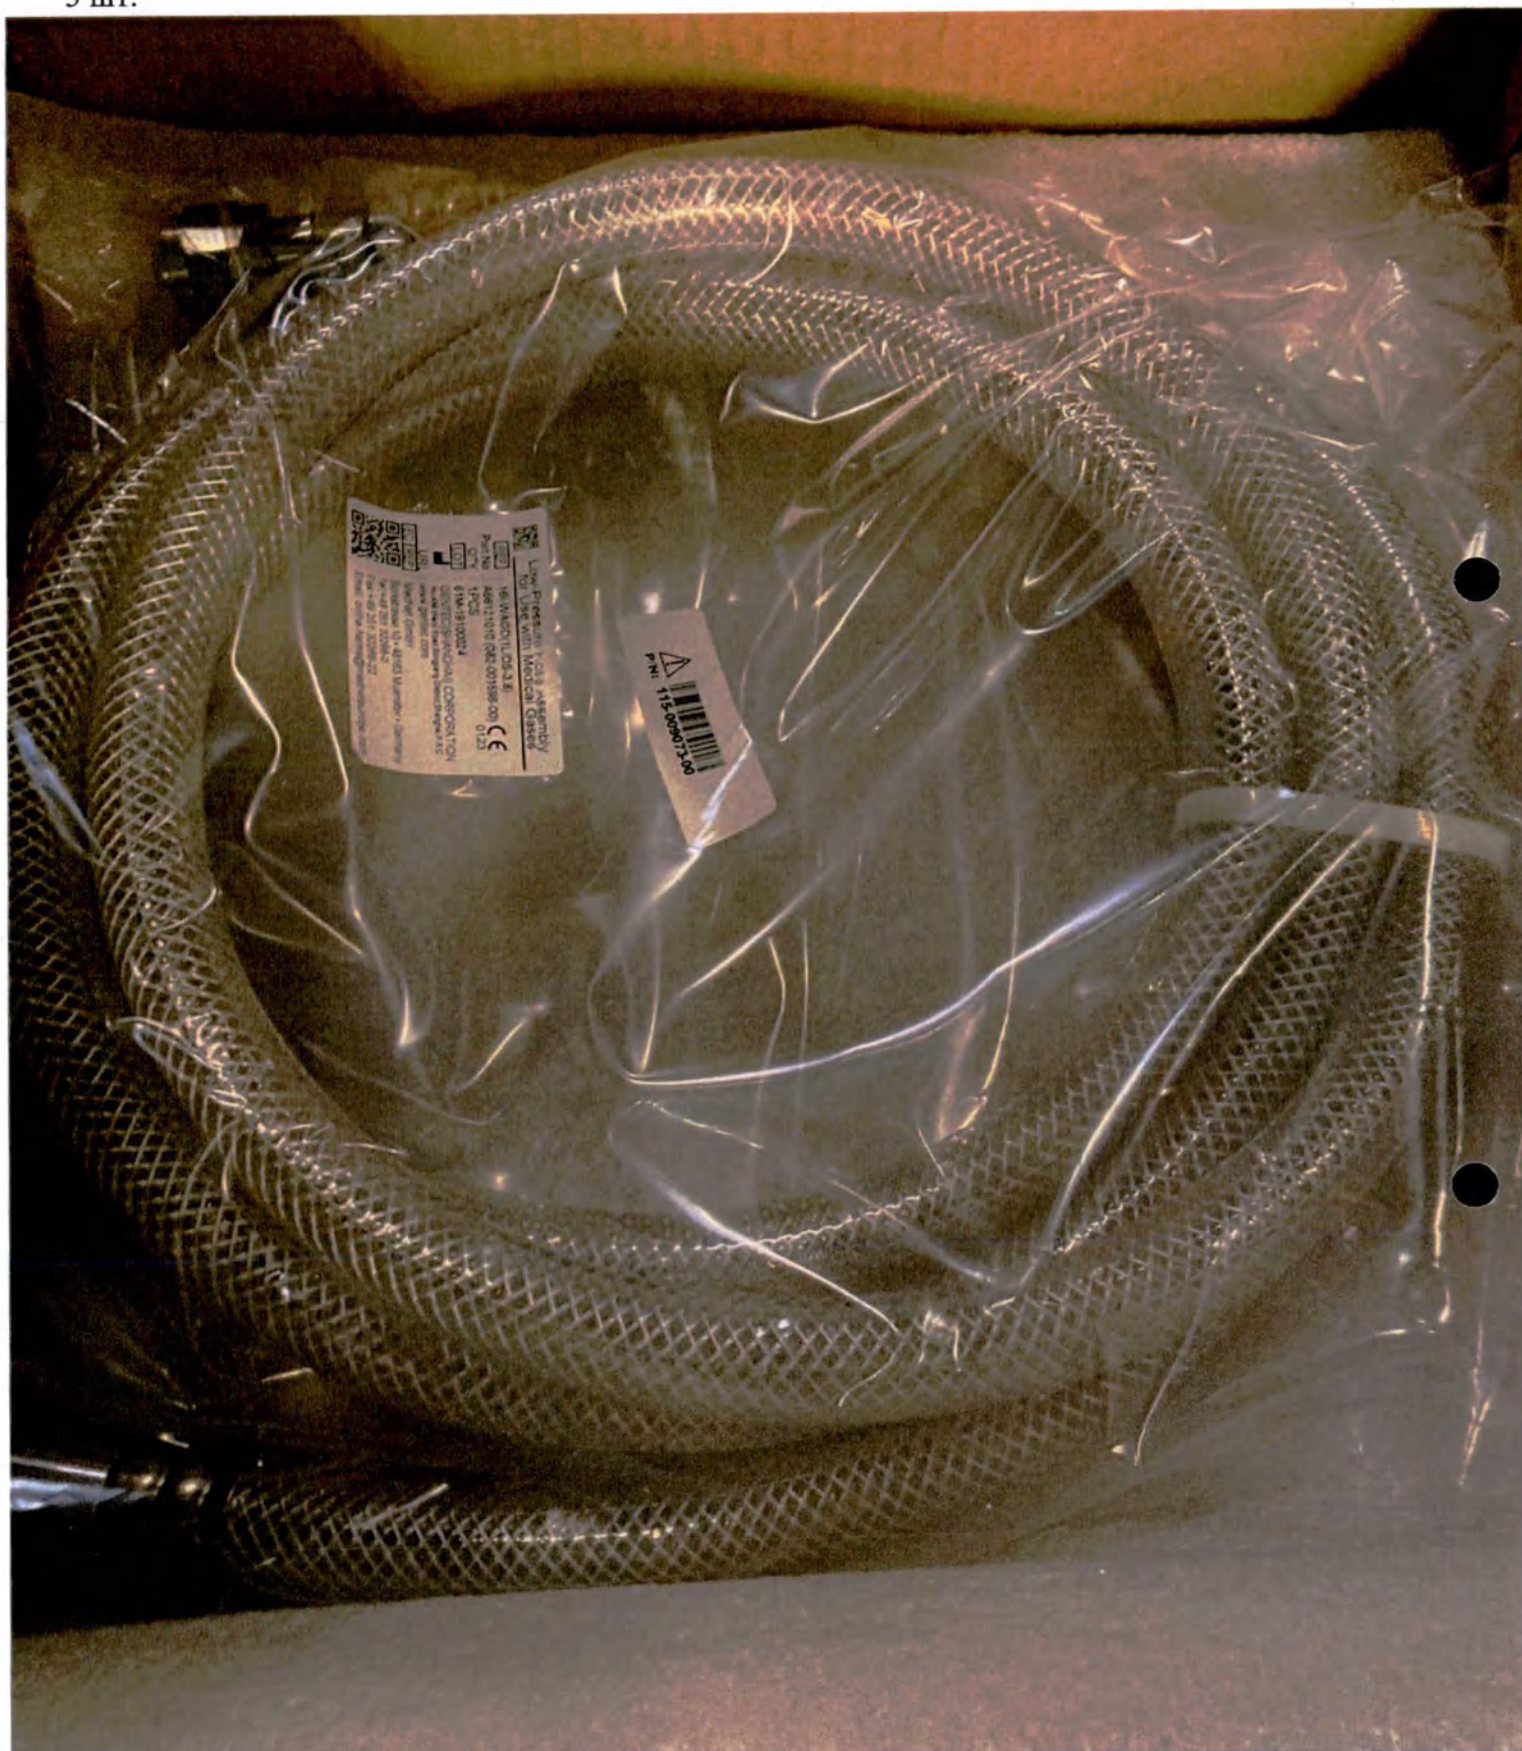

33.3. Трубка газопередающая активной выведения анестезиологических газов – не более 5 шт.

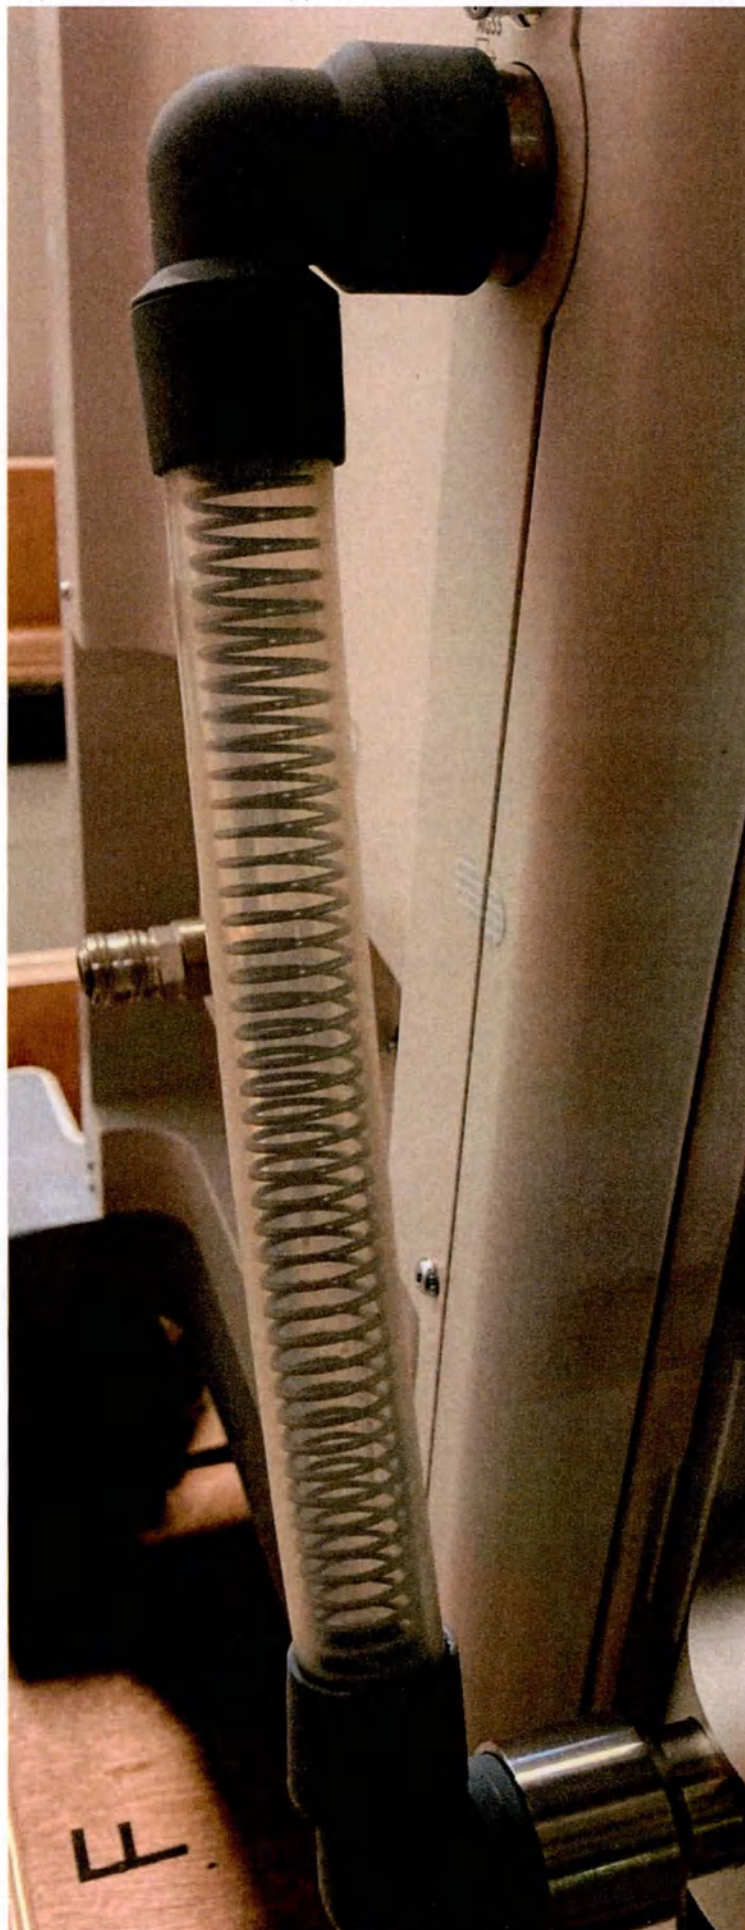


33.4. Трехходовой коннектор системы вывода анестезиологических газов – не более 5 шт.
(при необходимости).



34. Система активного выведения анестезиологических газов (СВАГ) высокопоточная – не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- 34.1. Блок активной высокопоточной системы выведения анестезиологических газов основной – не более 5 шт.



34.2. Трубка газопередающая высокопоточной системы вывода анестезиологических газов — не более 5 шт.

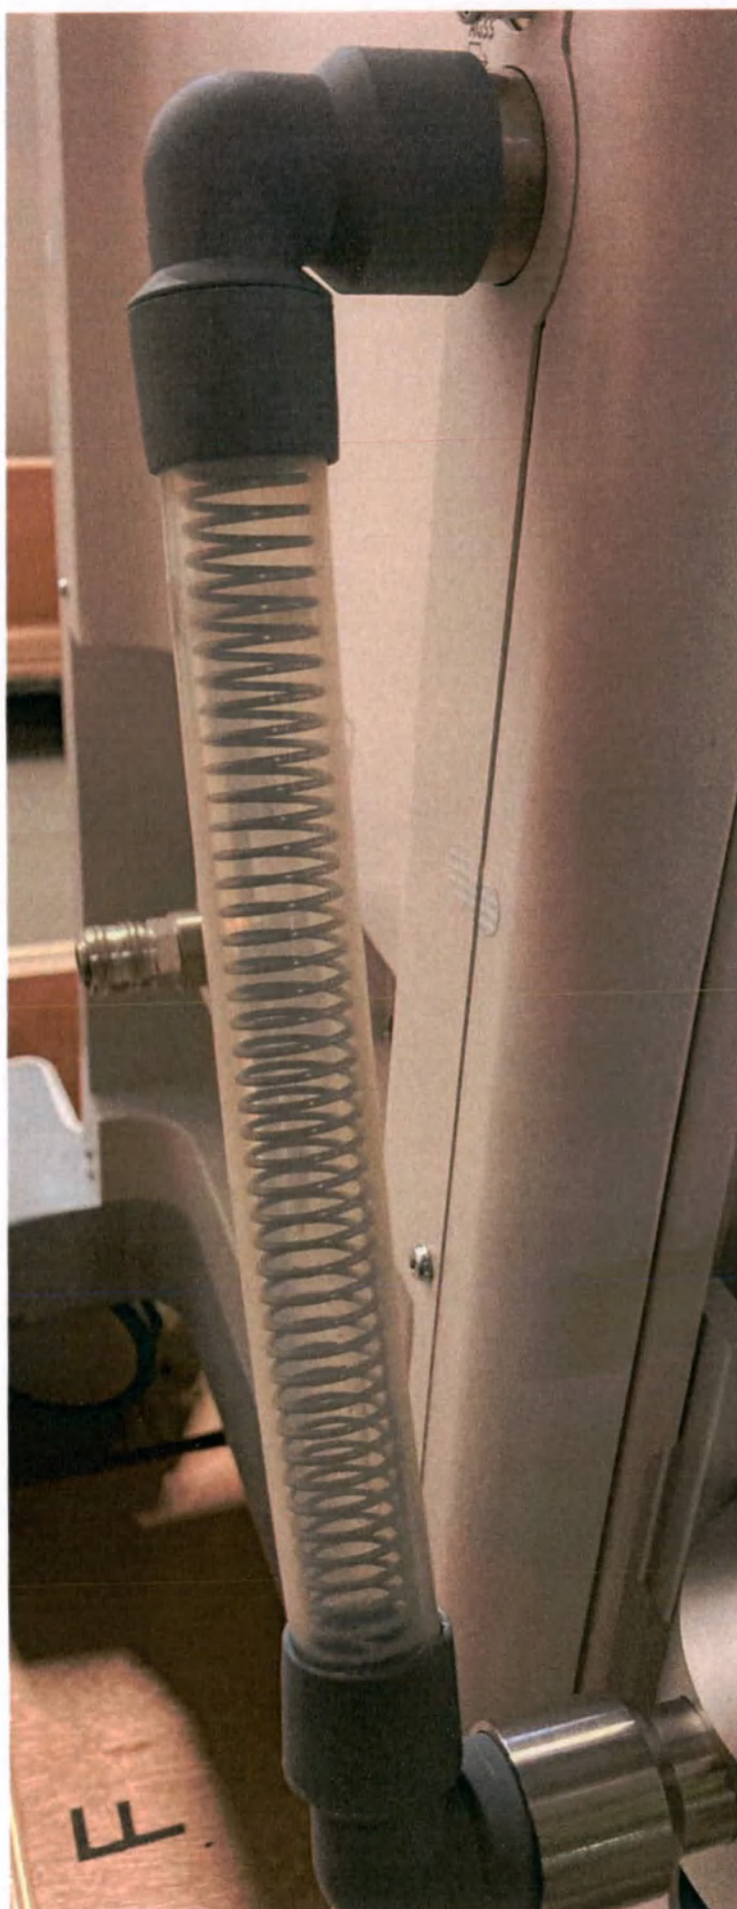

34.3. Шланг активной высокопоточной системы выведения анестезиологических газов — не более 5 шт.



34.4. Трехходовой коннектор системы вывода анестезиологических газов – не более 5 шт.
(при необходимости).



35. Система пассивного вывода анестезиологических газов (СВАГ) – не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

35.1. шланг пассивной системы вывода анестезиологических газов – 1 шт.;



35.2. адаптер – 1 шт.



36. Набор коннекторов для системы выведения анестезиологических газов - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:


- Насадка – 1 шт.;
- Муфта для насадки – 1 шт.;
- Шайба уплотнительная – 1 шт.;
- Хомут для трубки – 1 шт.



37. Магистраль высокого давления для вакуума –не более 5 шт. (при необходимости).



38. Колба системы аспирации с защитой от переполнения – не более 5 шт. (при необходимости).

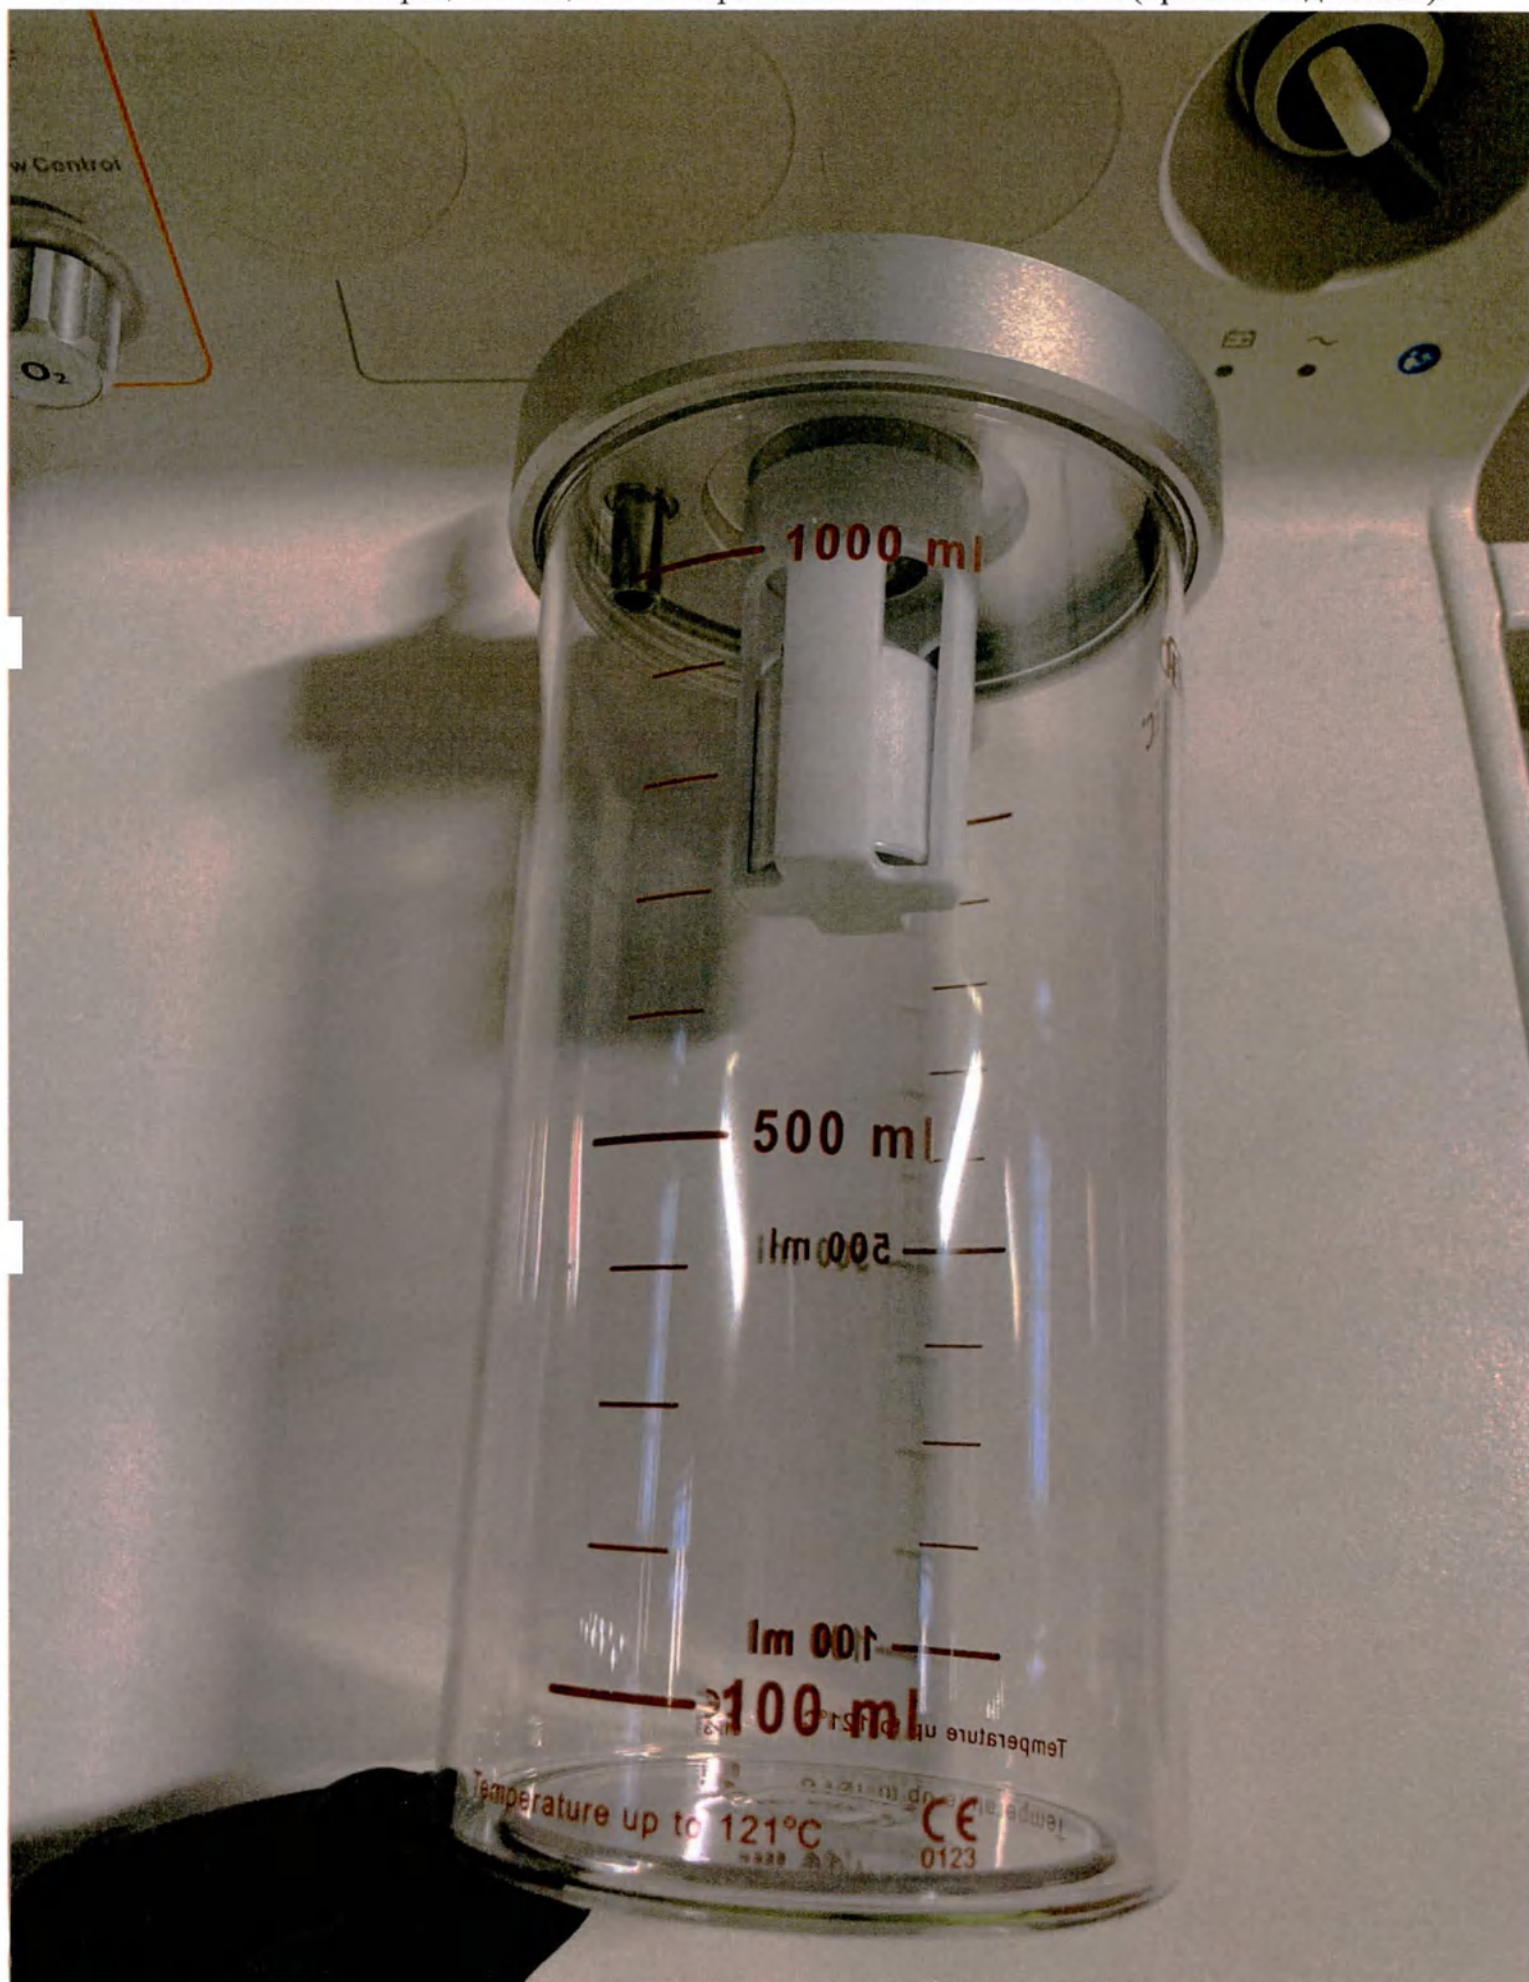


39. Колба системы аспирации – не более 5 шт. (при необходимости).




40. Набор для системы аспирации – не более 20 шт. (при необходимости), в составе:


40.1. Трубка для системы аспирации – не более 3 шт.,

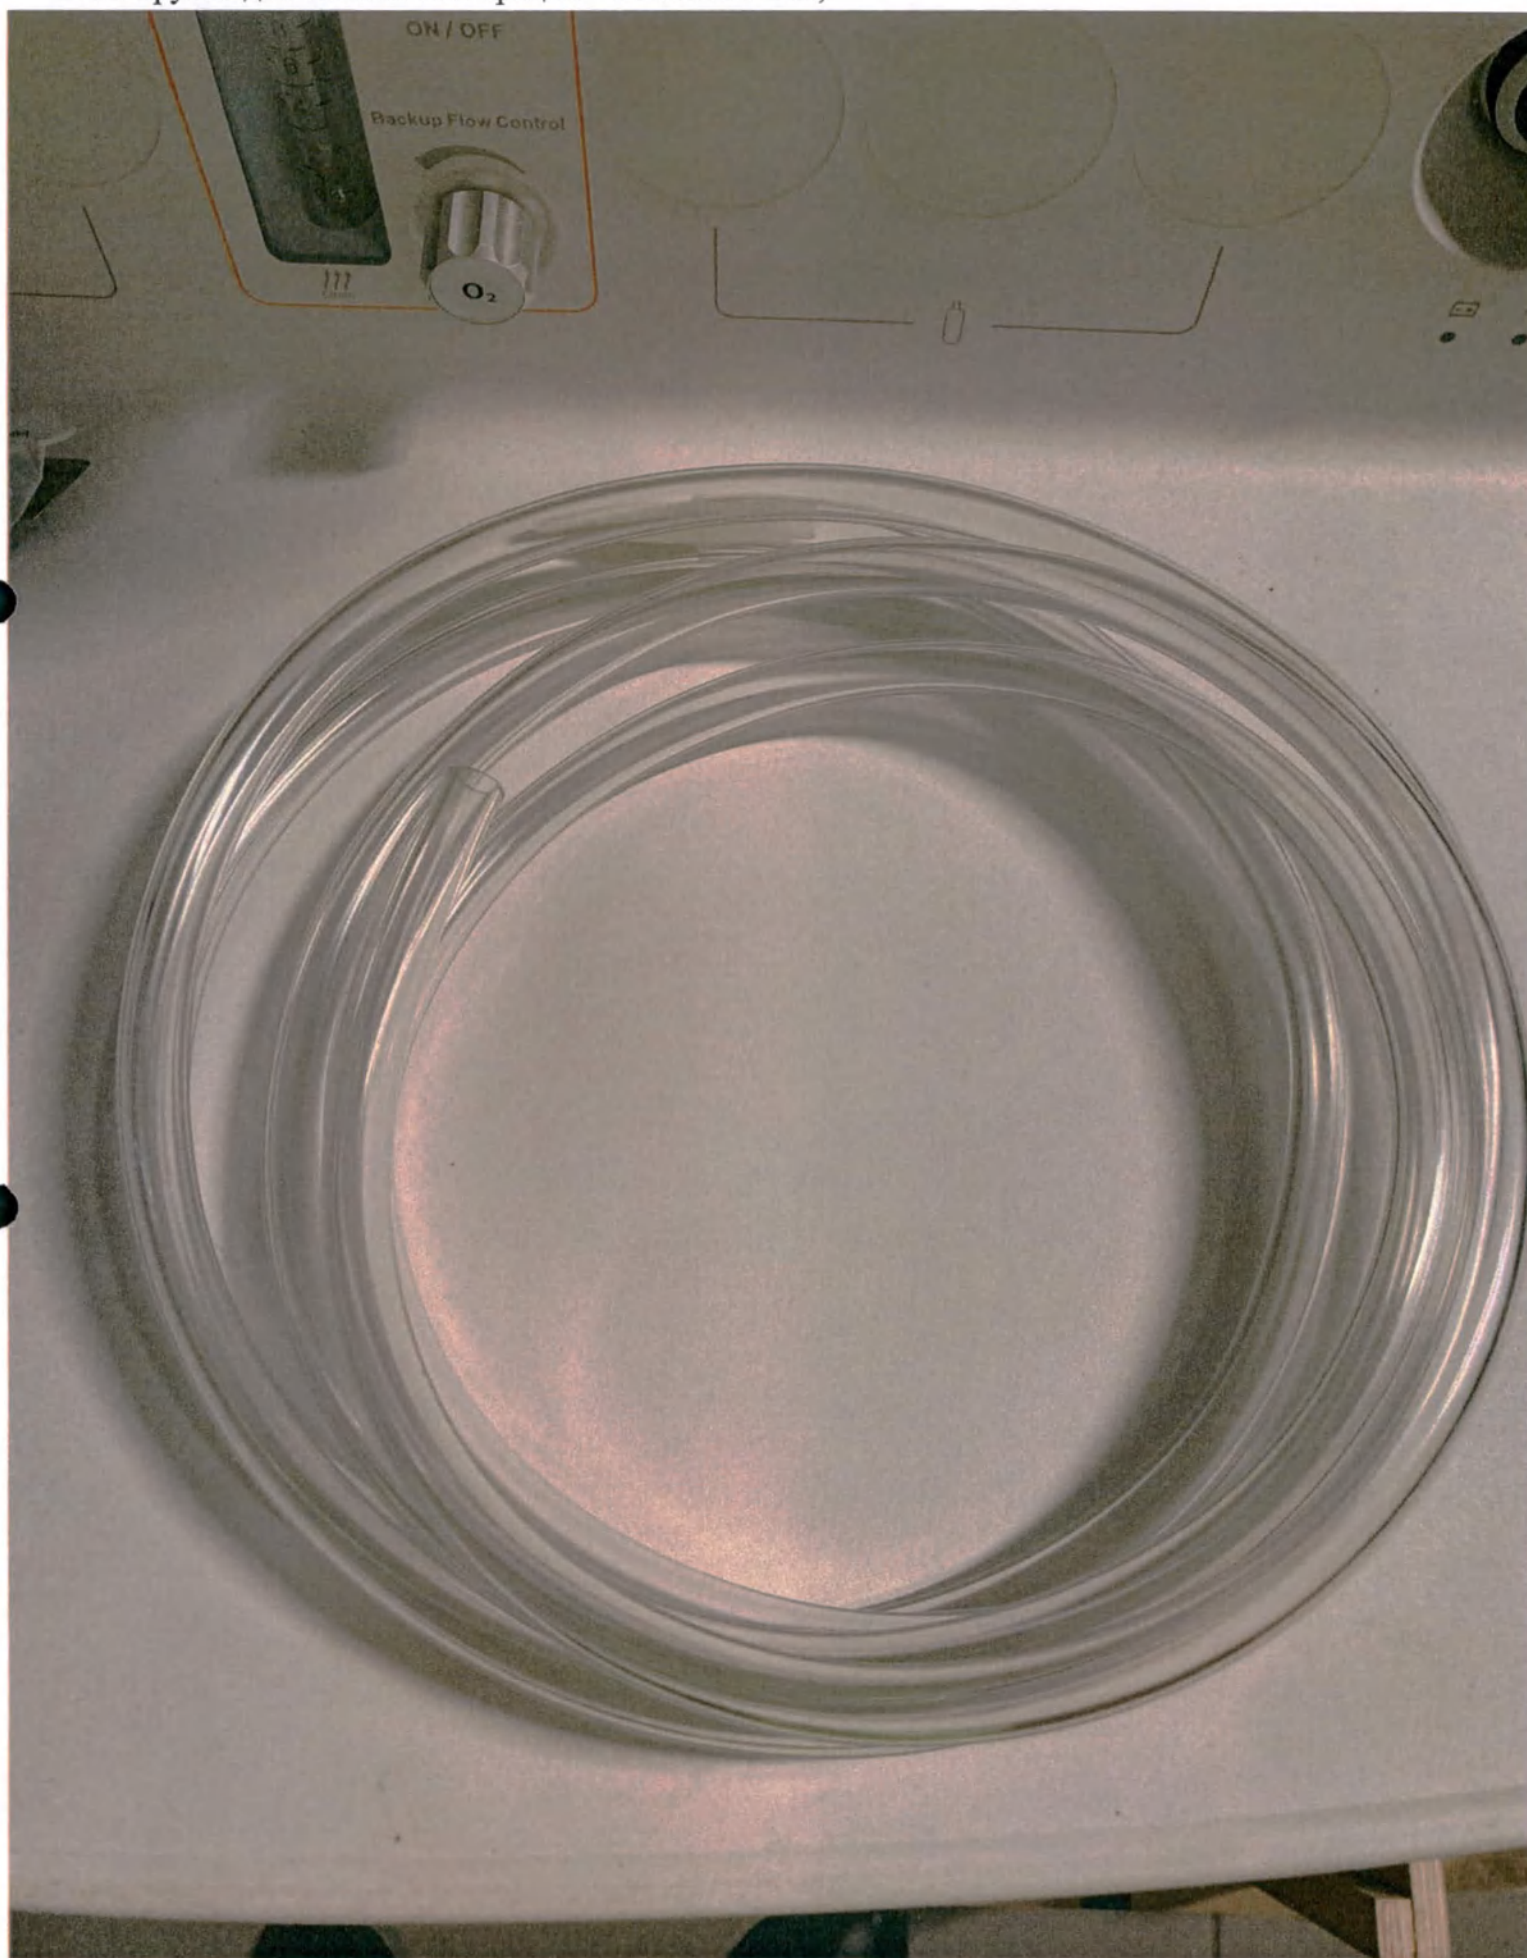

40.2. Фильтр для системы аспирации – 1 шт.

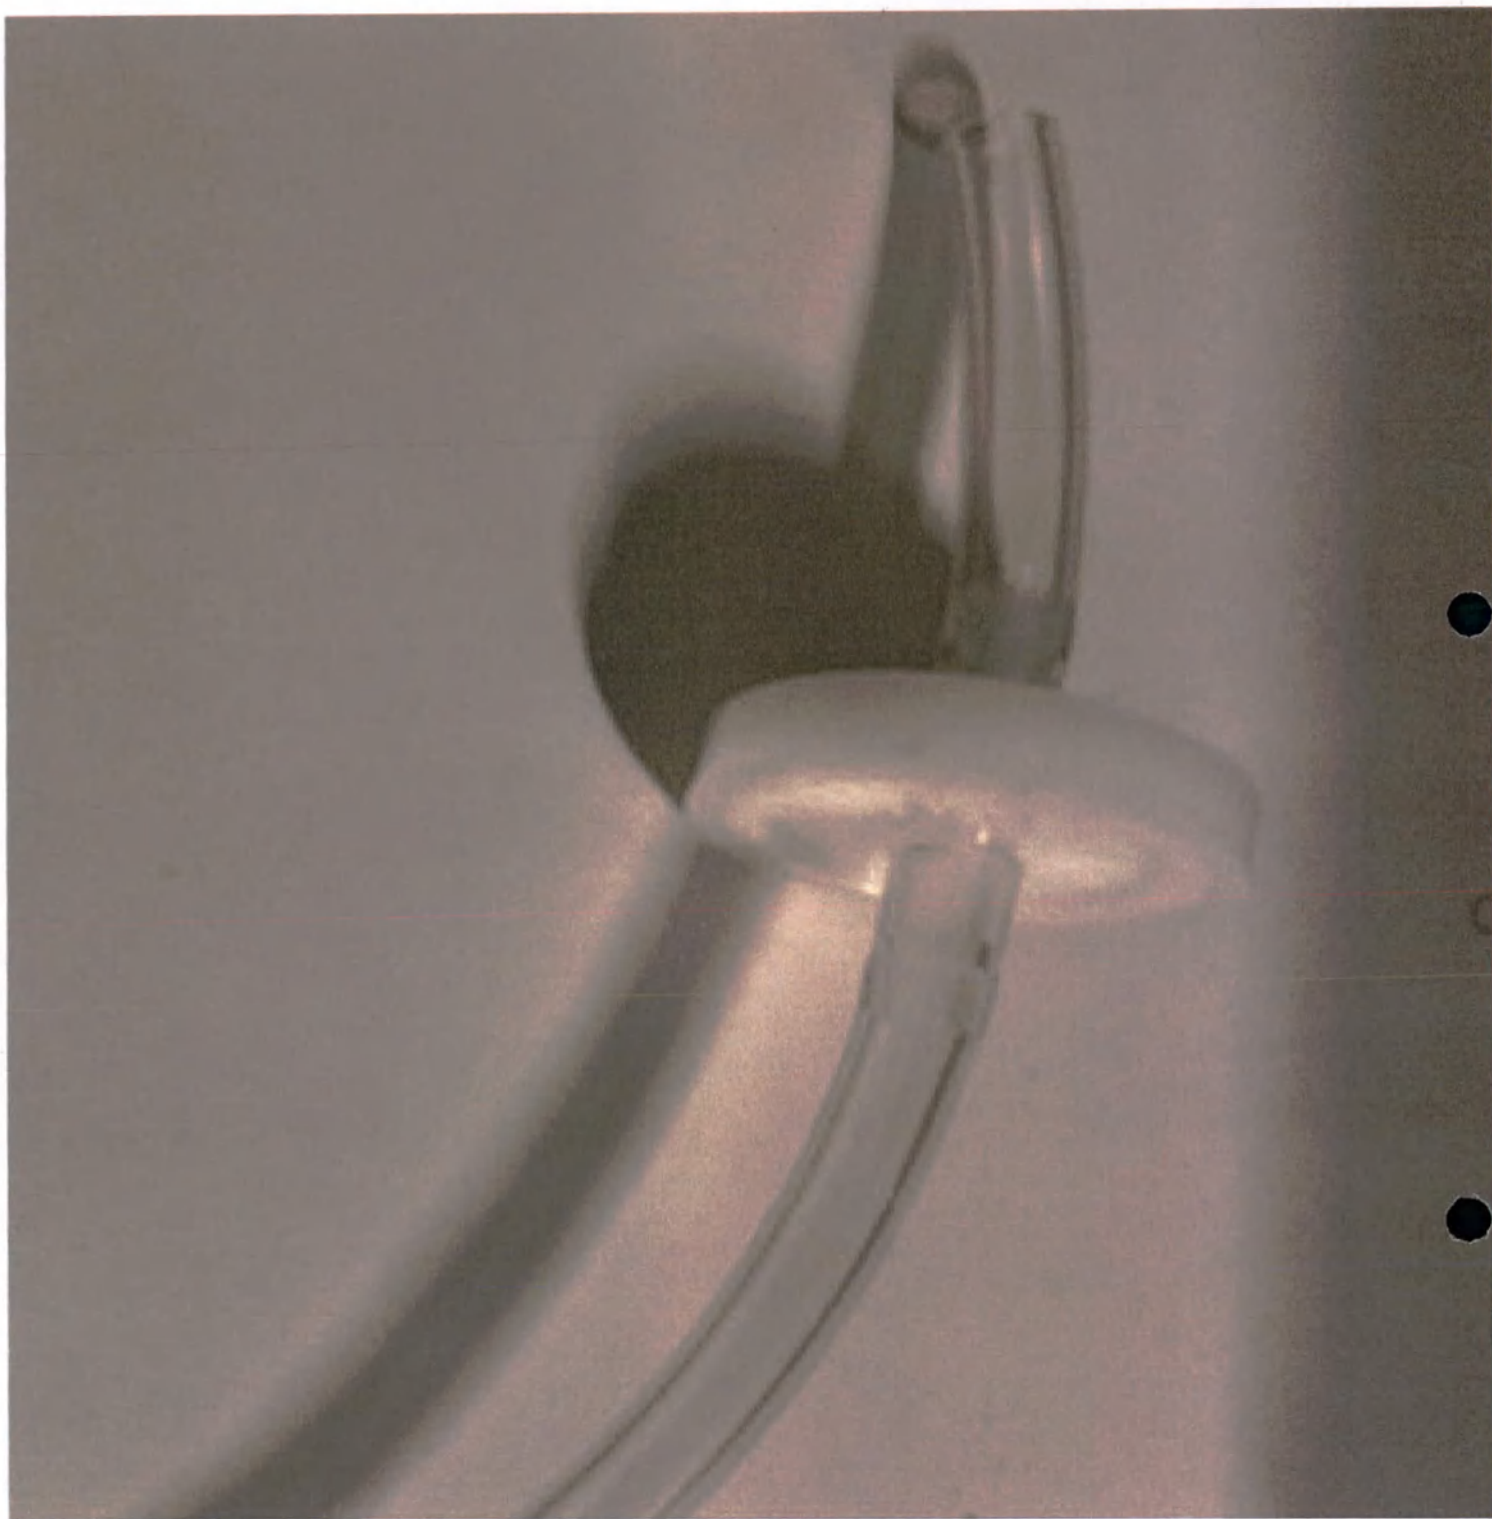


41. Держатель для увлажнителя - не более 2 шт. (при необходимости).

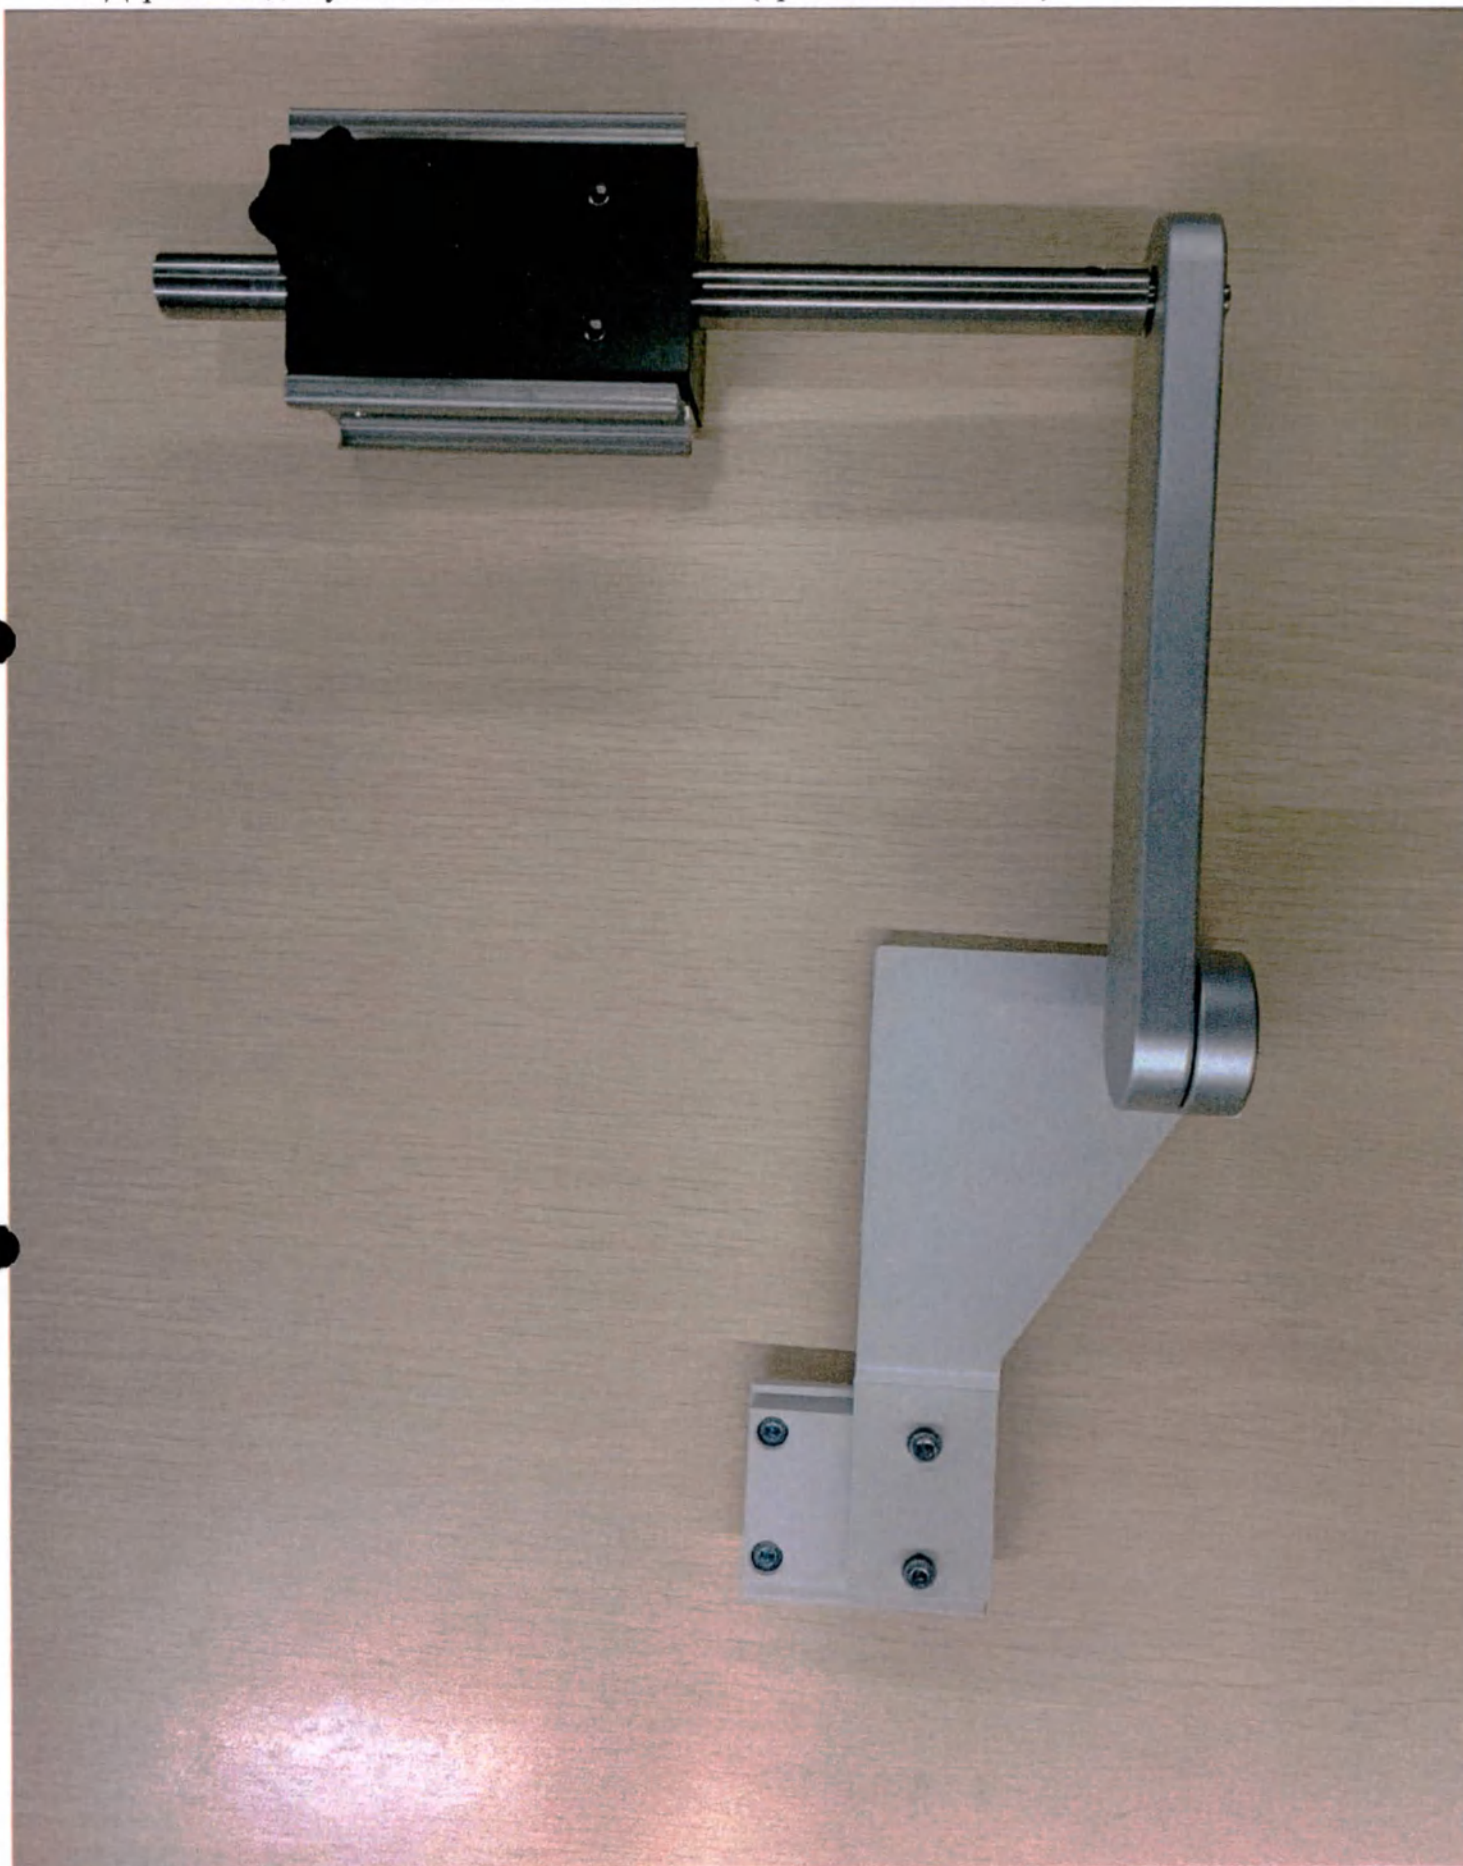

42. Магистраль высокого давления для воздуха –не более 5 шт. (при необходимости).



43. Магистраль высокого давления для закиси азота –не более 5 шт. (при необходимости).

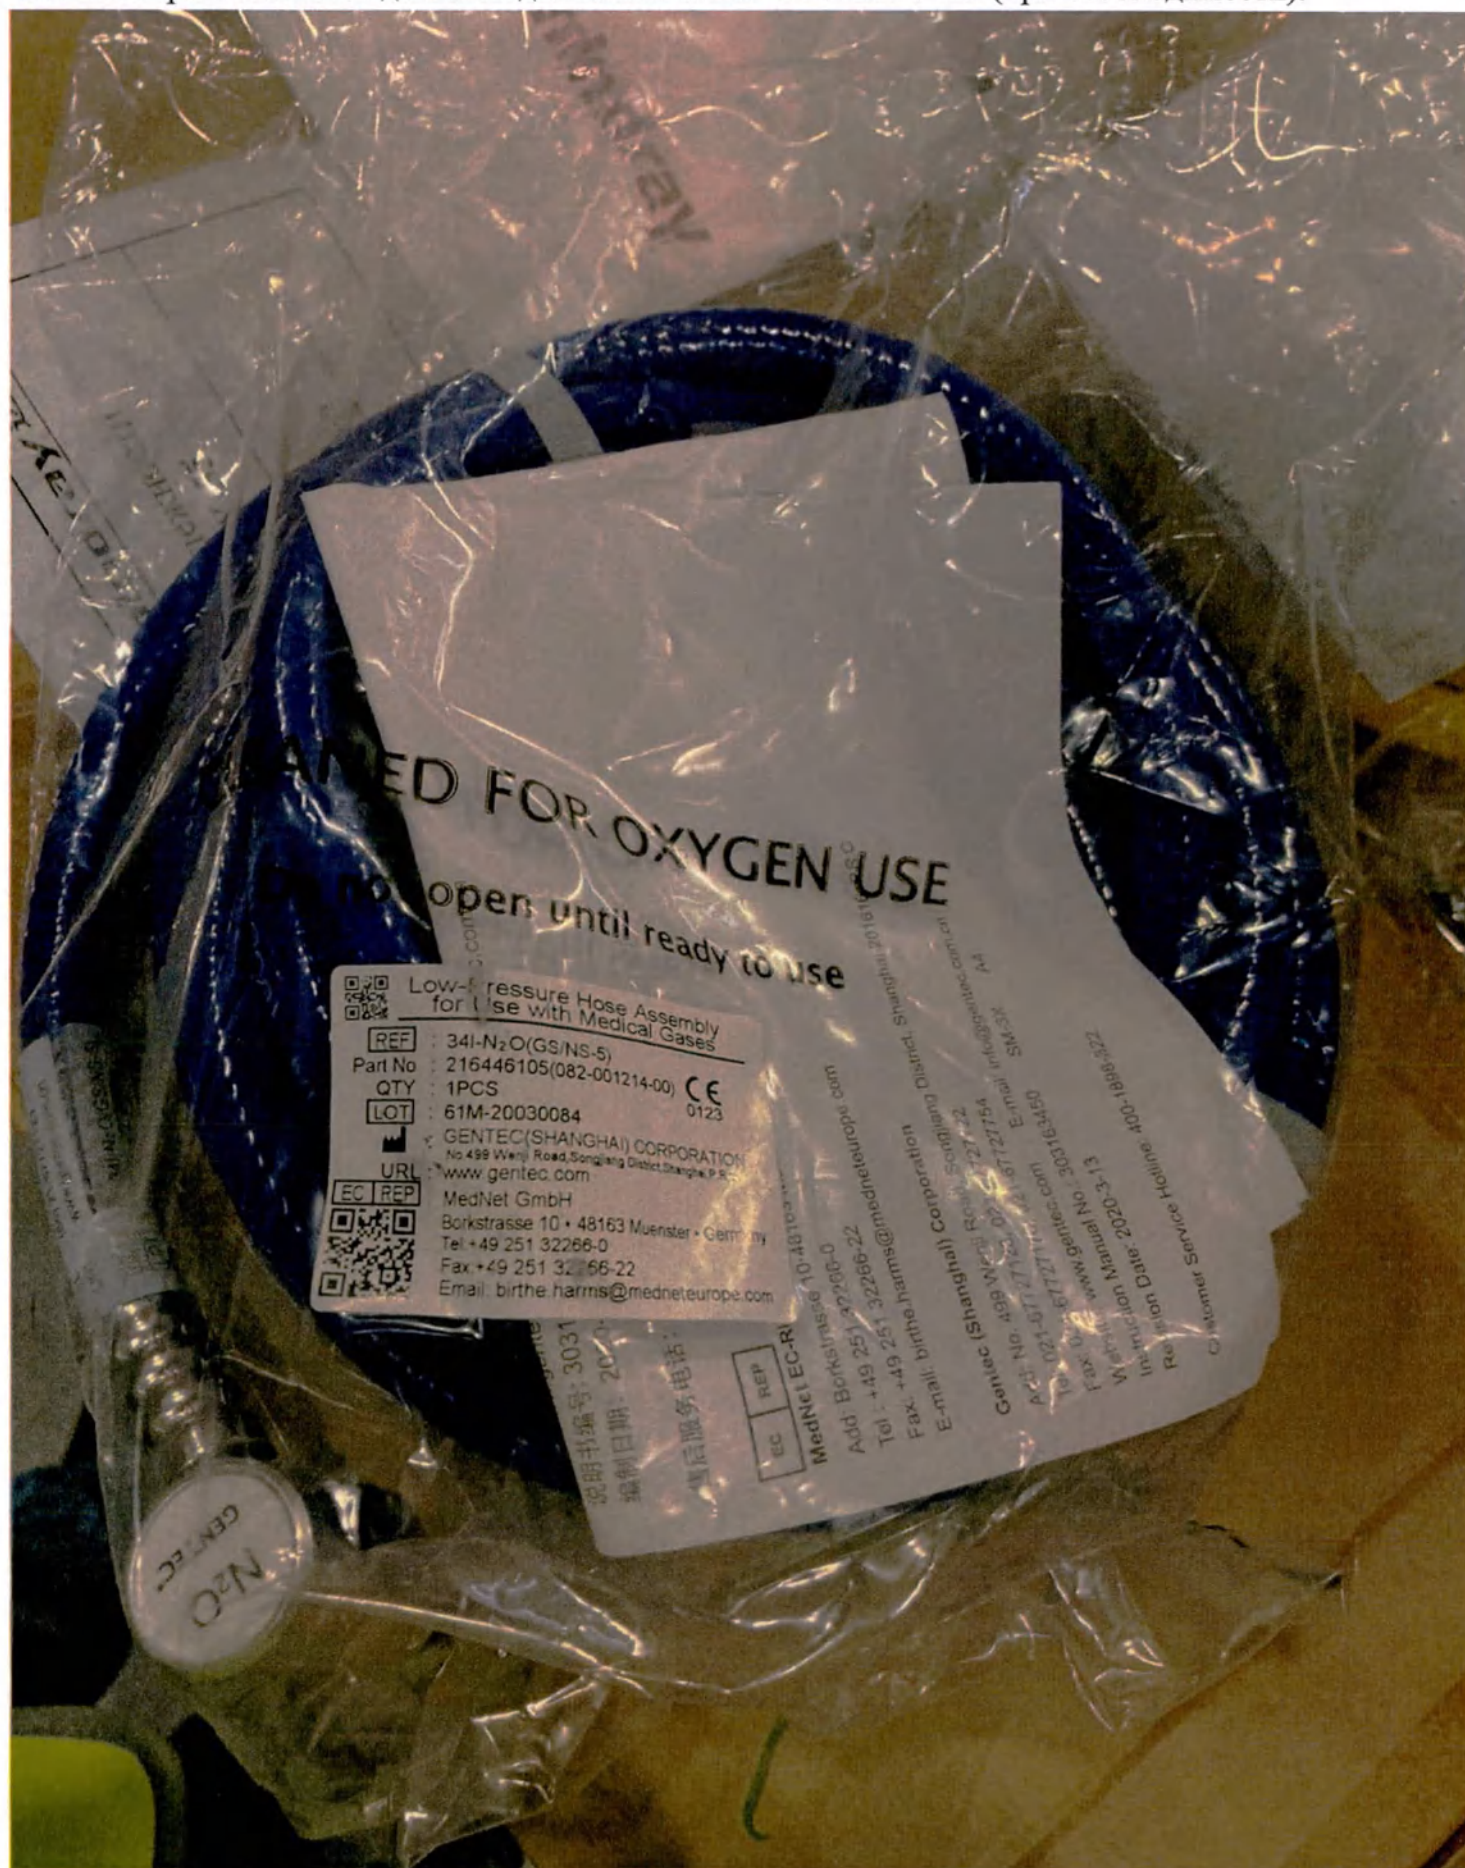

44. Испаритель изофлурана Pour Fill, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

- Испаритель изофлурана Pour Fill, модель V60 – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.



45. Испаритель изофлурана Key Filler, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

- Испаритель изофлурана Key Filler, модель V60 – 1 шт.;
- Адаптер Keyed Filler для изофлурана– 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.



46. Испаритель севофлурана Pour Fill, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

- Испаритель севофлурана Pour Fill, модель V60 – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.



47. Испаритель севофлурана Key Filler, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

- Испаритель севофлурана Key Filler, модель V60 – 1 шт;
- Адаптер Keyed Filler для севофлурана – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.



48. Испаритель севофлурана Quik Fil, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

- Испаритель севофлурана Quik Fil, модель V60 – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.



49. 1Испаритель галотана Pour Fill, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

- Испаритель галотана Pour Fill, модель V60 – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.



49.2 Испаритель галотана Powr Fill, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

- Испаритель галотана Powr Fill, модель V60 – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.



50. 1Испаритель галотана Key Filler, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:
- Испаритель галотана Key Filler, модель V60 – 1 шт.;
 - Адаптер Keyed Filler для галотана– 1 шт.;
 - Руководство пользователя – 1 шт.



50. 2Испаритель галотана Key Filler, модель V60 – не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

- Испаритель галотана Key Filler, модель V60 – 1 шт.;
- Адаптер Keyed Filler для галотана– 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.




51. Испаритель десфлурана V80, РУ №РЗН 2022/19126 – не более 2 шт. (при необходимости).




52. Испаритель десфлурана D-Vapor – не более 2 шт. (при необходимости).




53. Адаптер Keyed Filler для заполнения испарителя, галоган – не более 20 шт. (при необходимости).

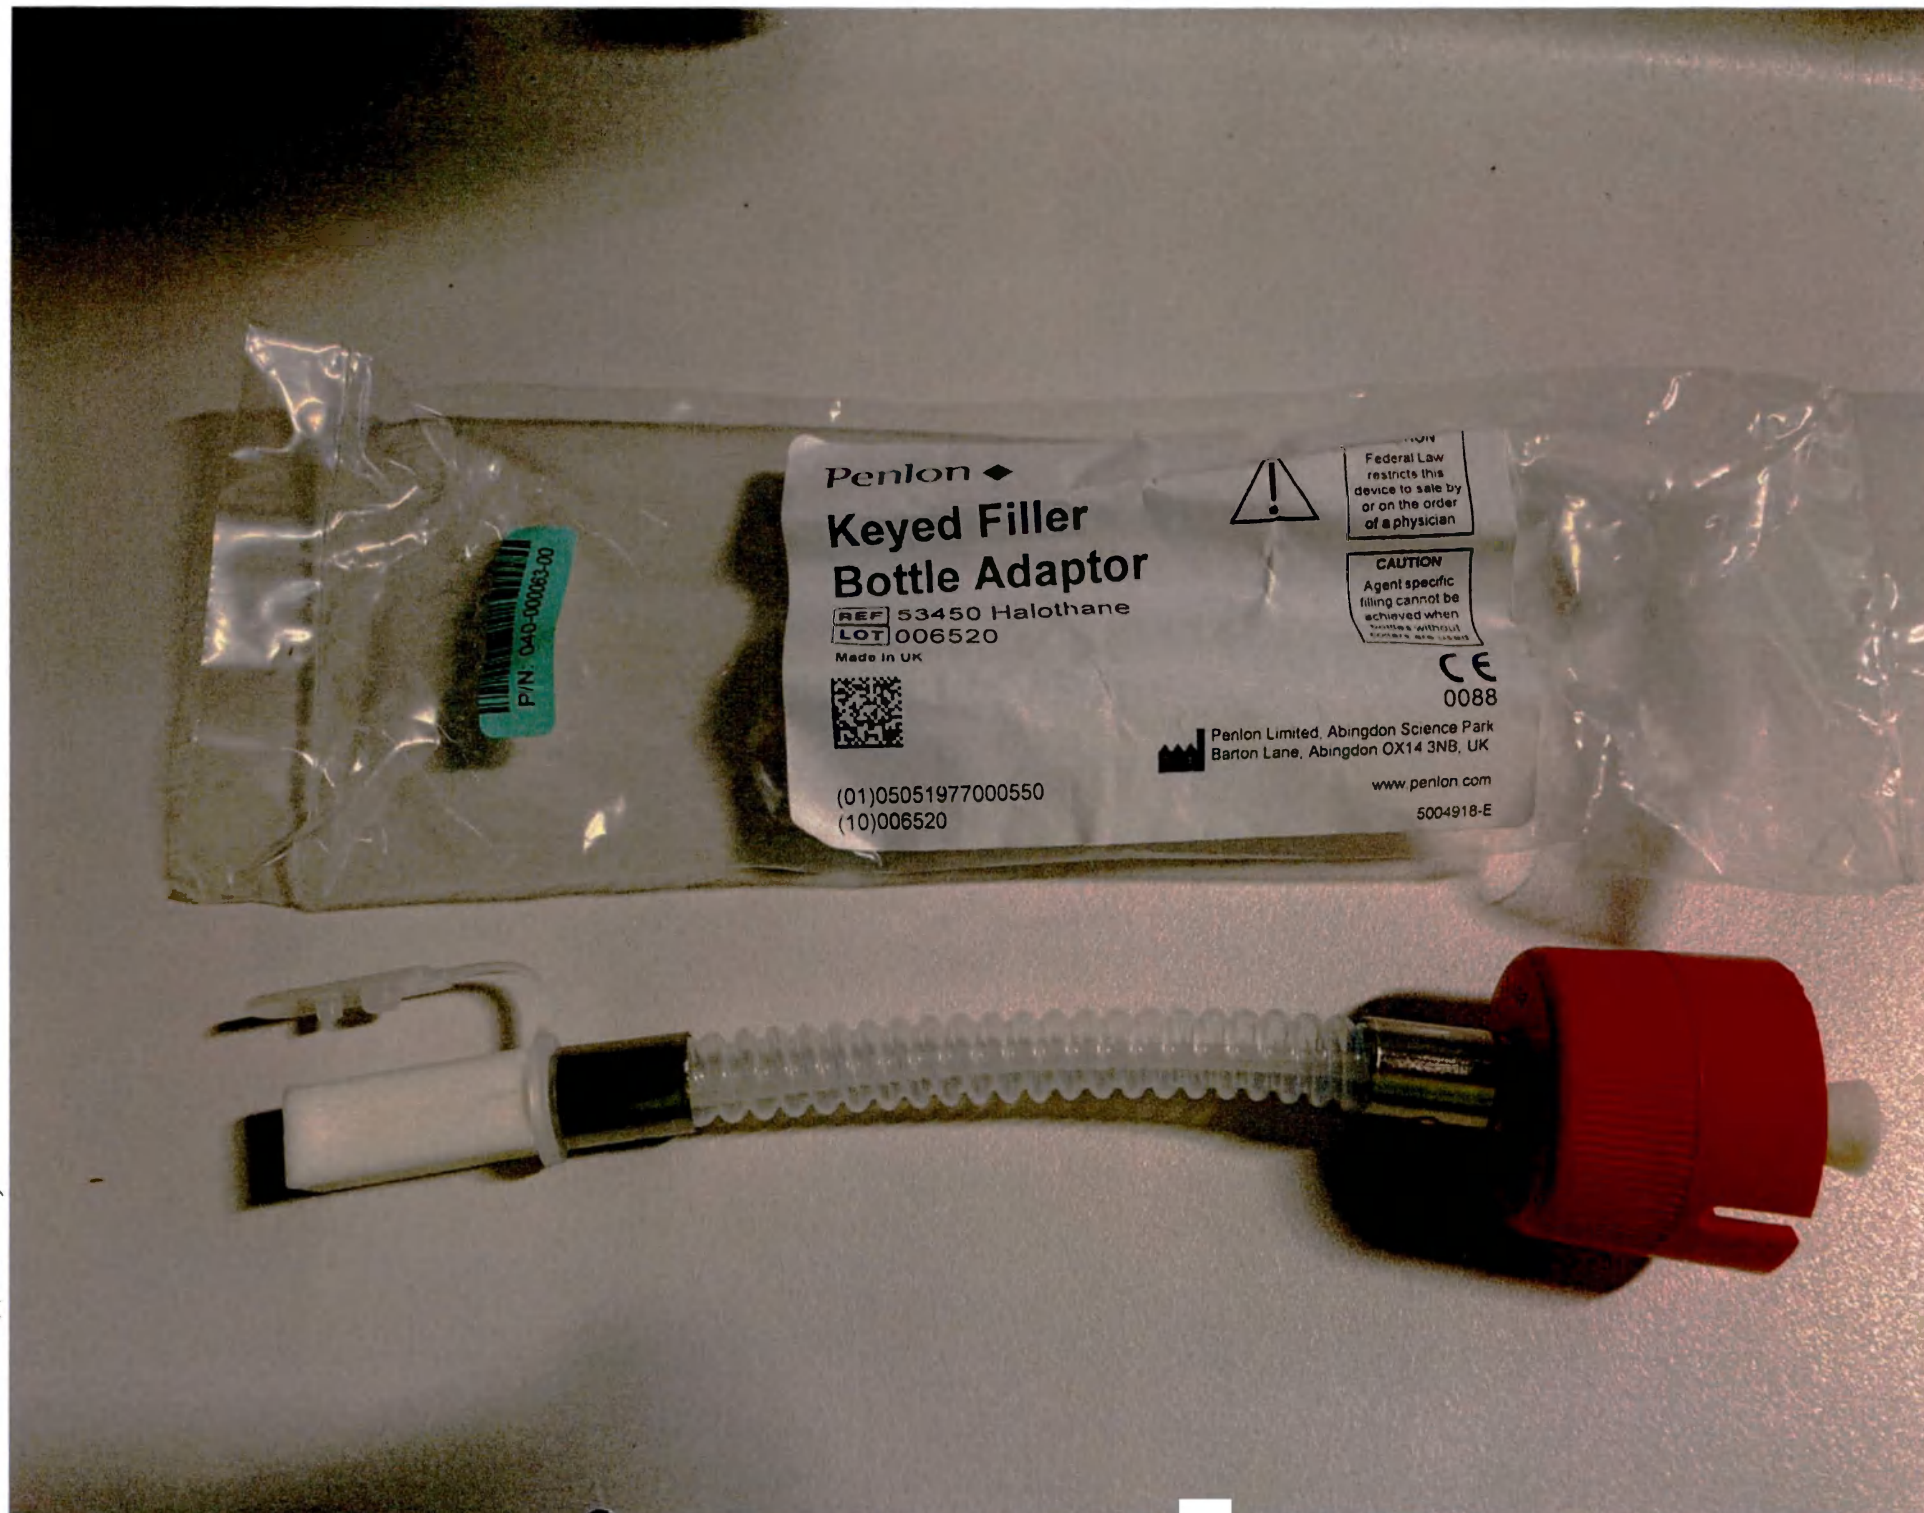

54. Адаптер Keyed Filler для заполнения испарителя, изофлуран – не более 20 шт. (при необходимости).

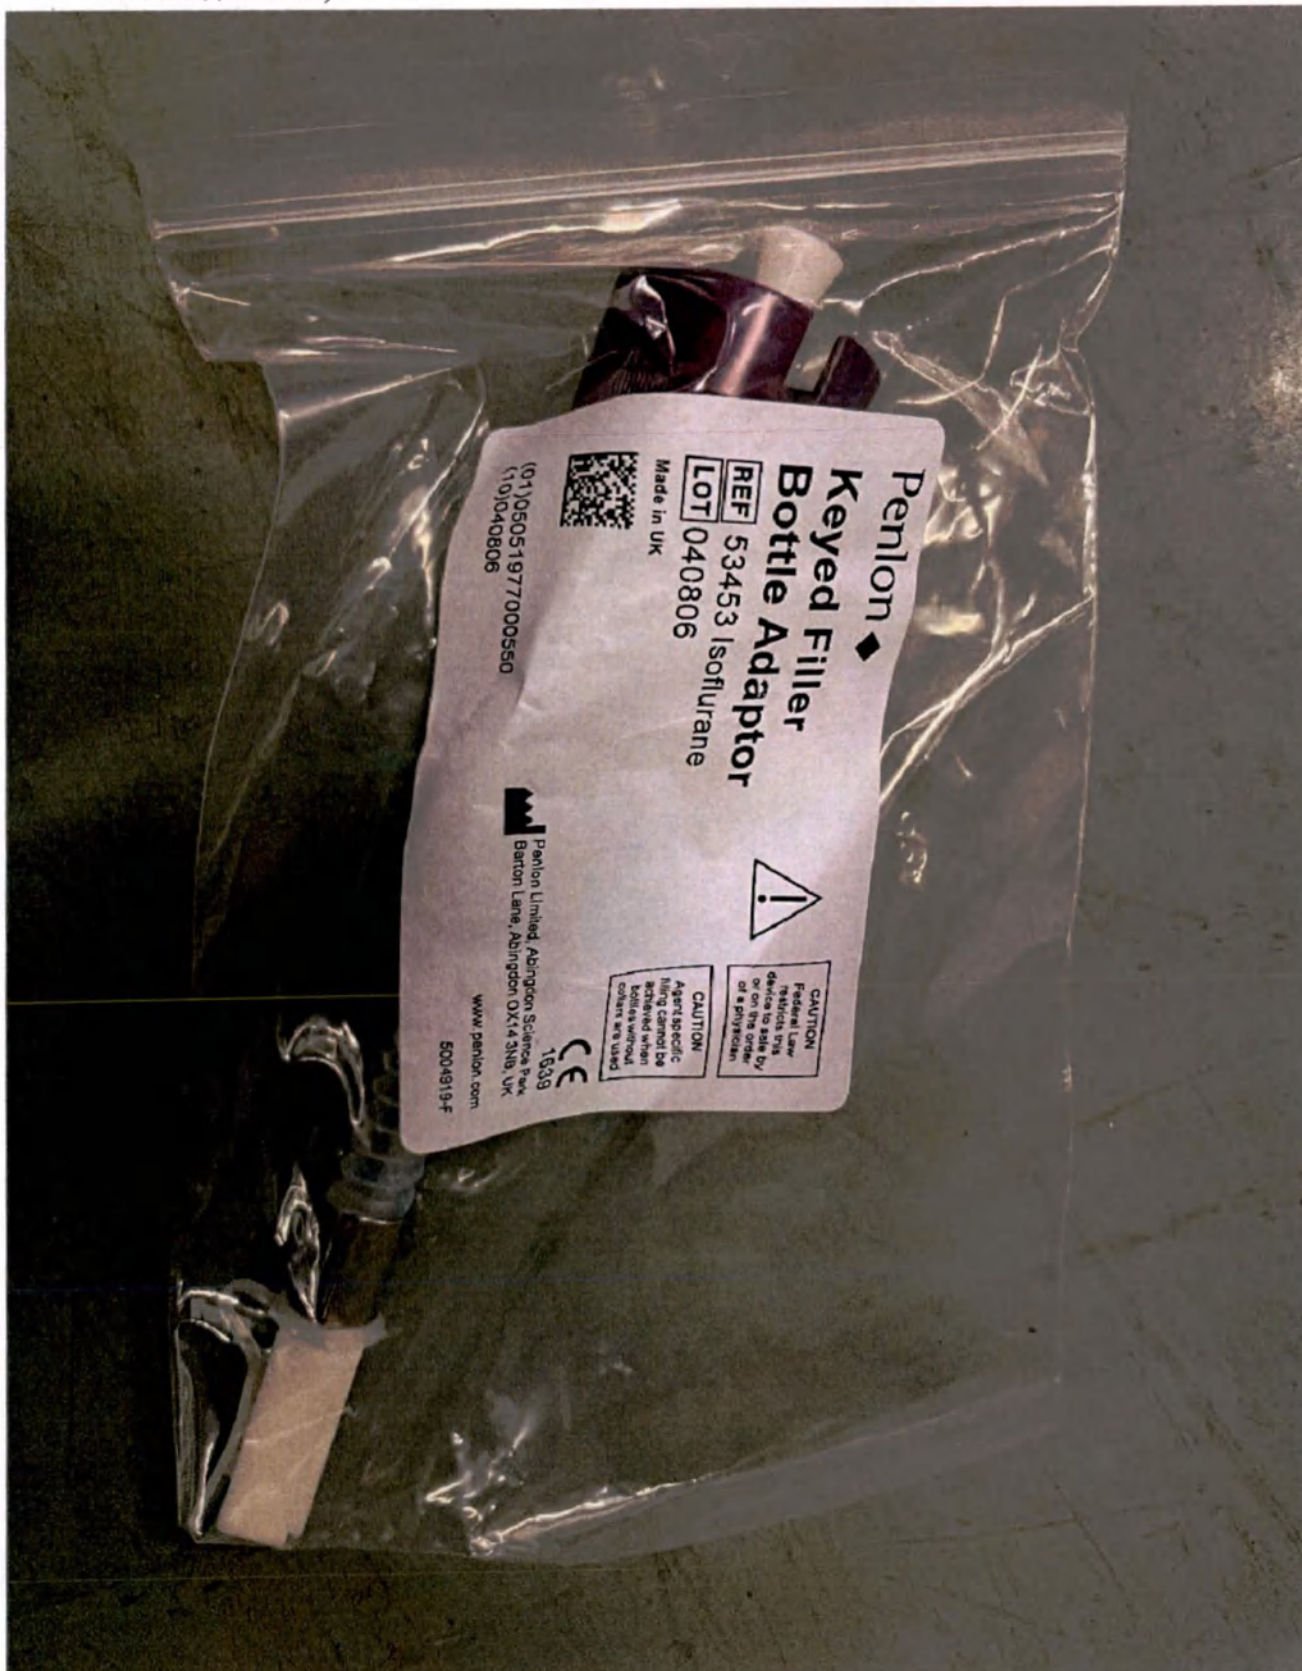

55. Адаптер Keyed Filler для заполнения испарителя, севофлуран – не более 20 шт. (при необходимости).

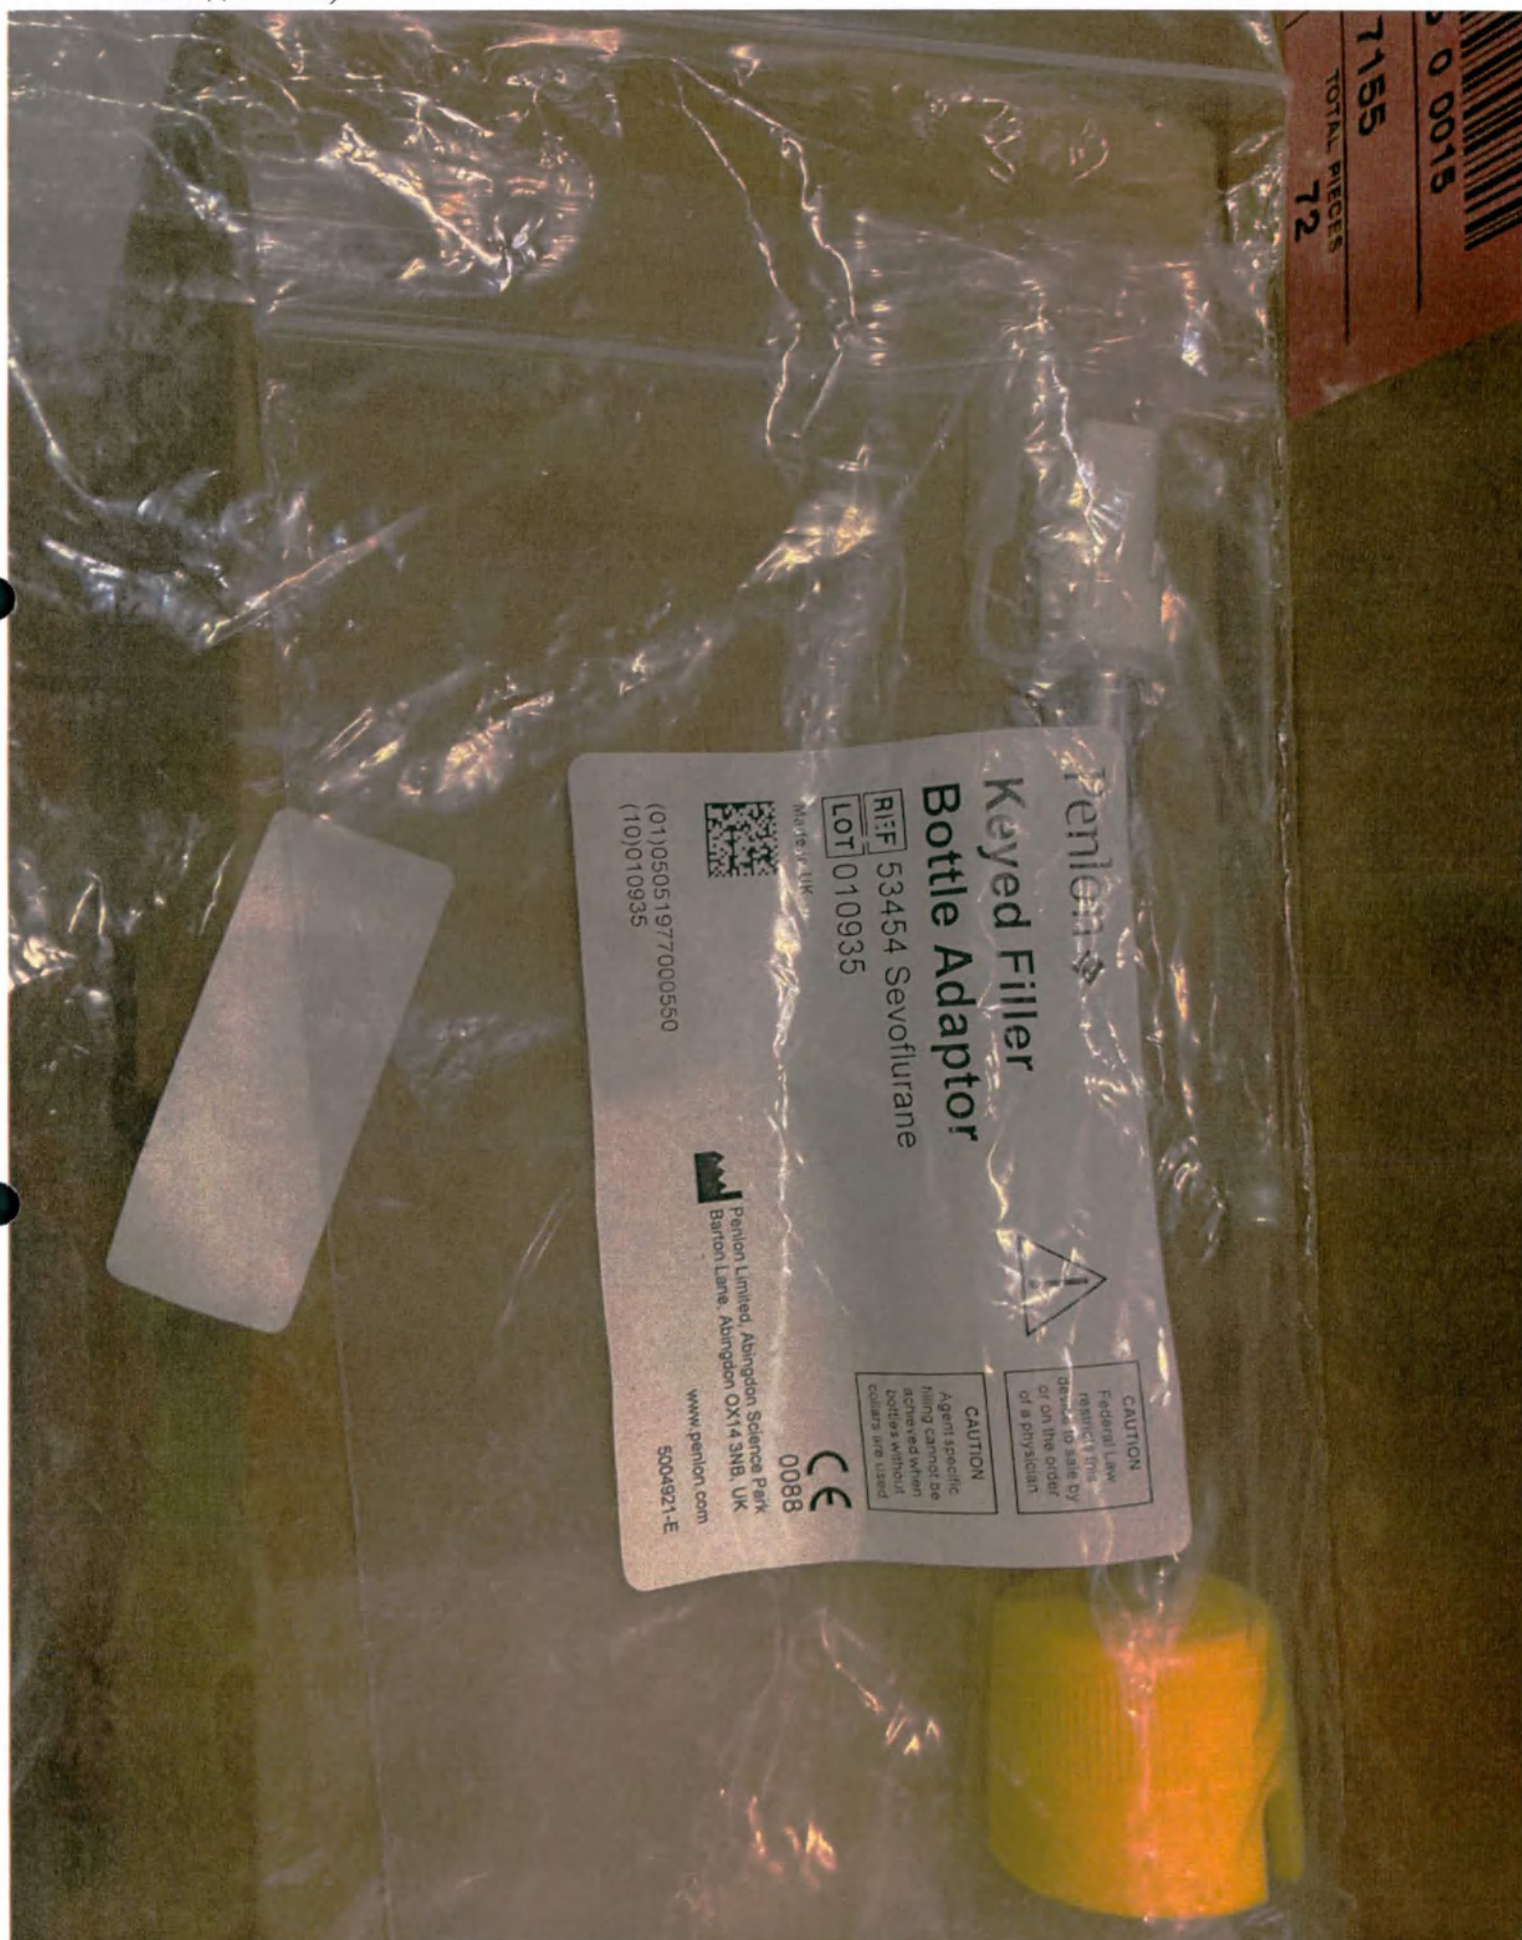


56. Адаптер Quik Fil для заполнения испарителя, севофлуран – не более 20 шт. (при необходимости).



57. Адаптер Quik Fil для слива севофлурана – не более 20 шт. (при необходимости).




58. Трубка дыхательная силиконовая для взрослых, гладкоствольная 0.45 м – не более 30 шт. (при необходимости).

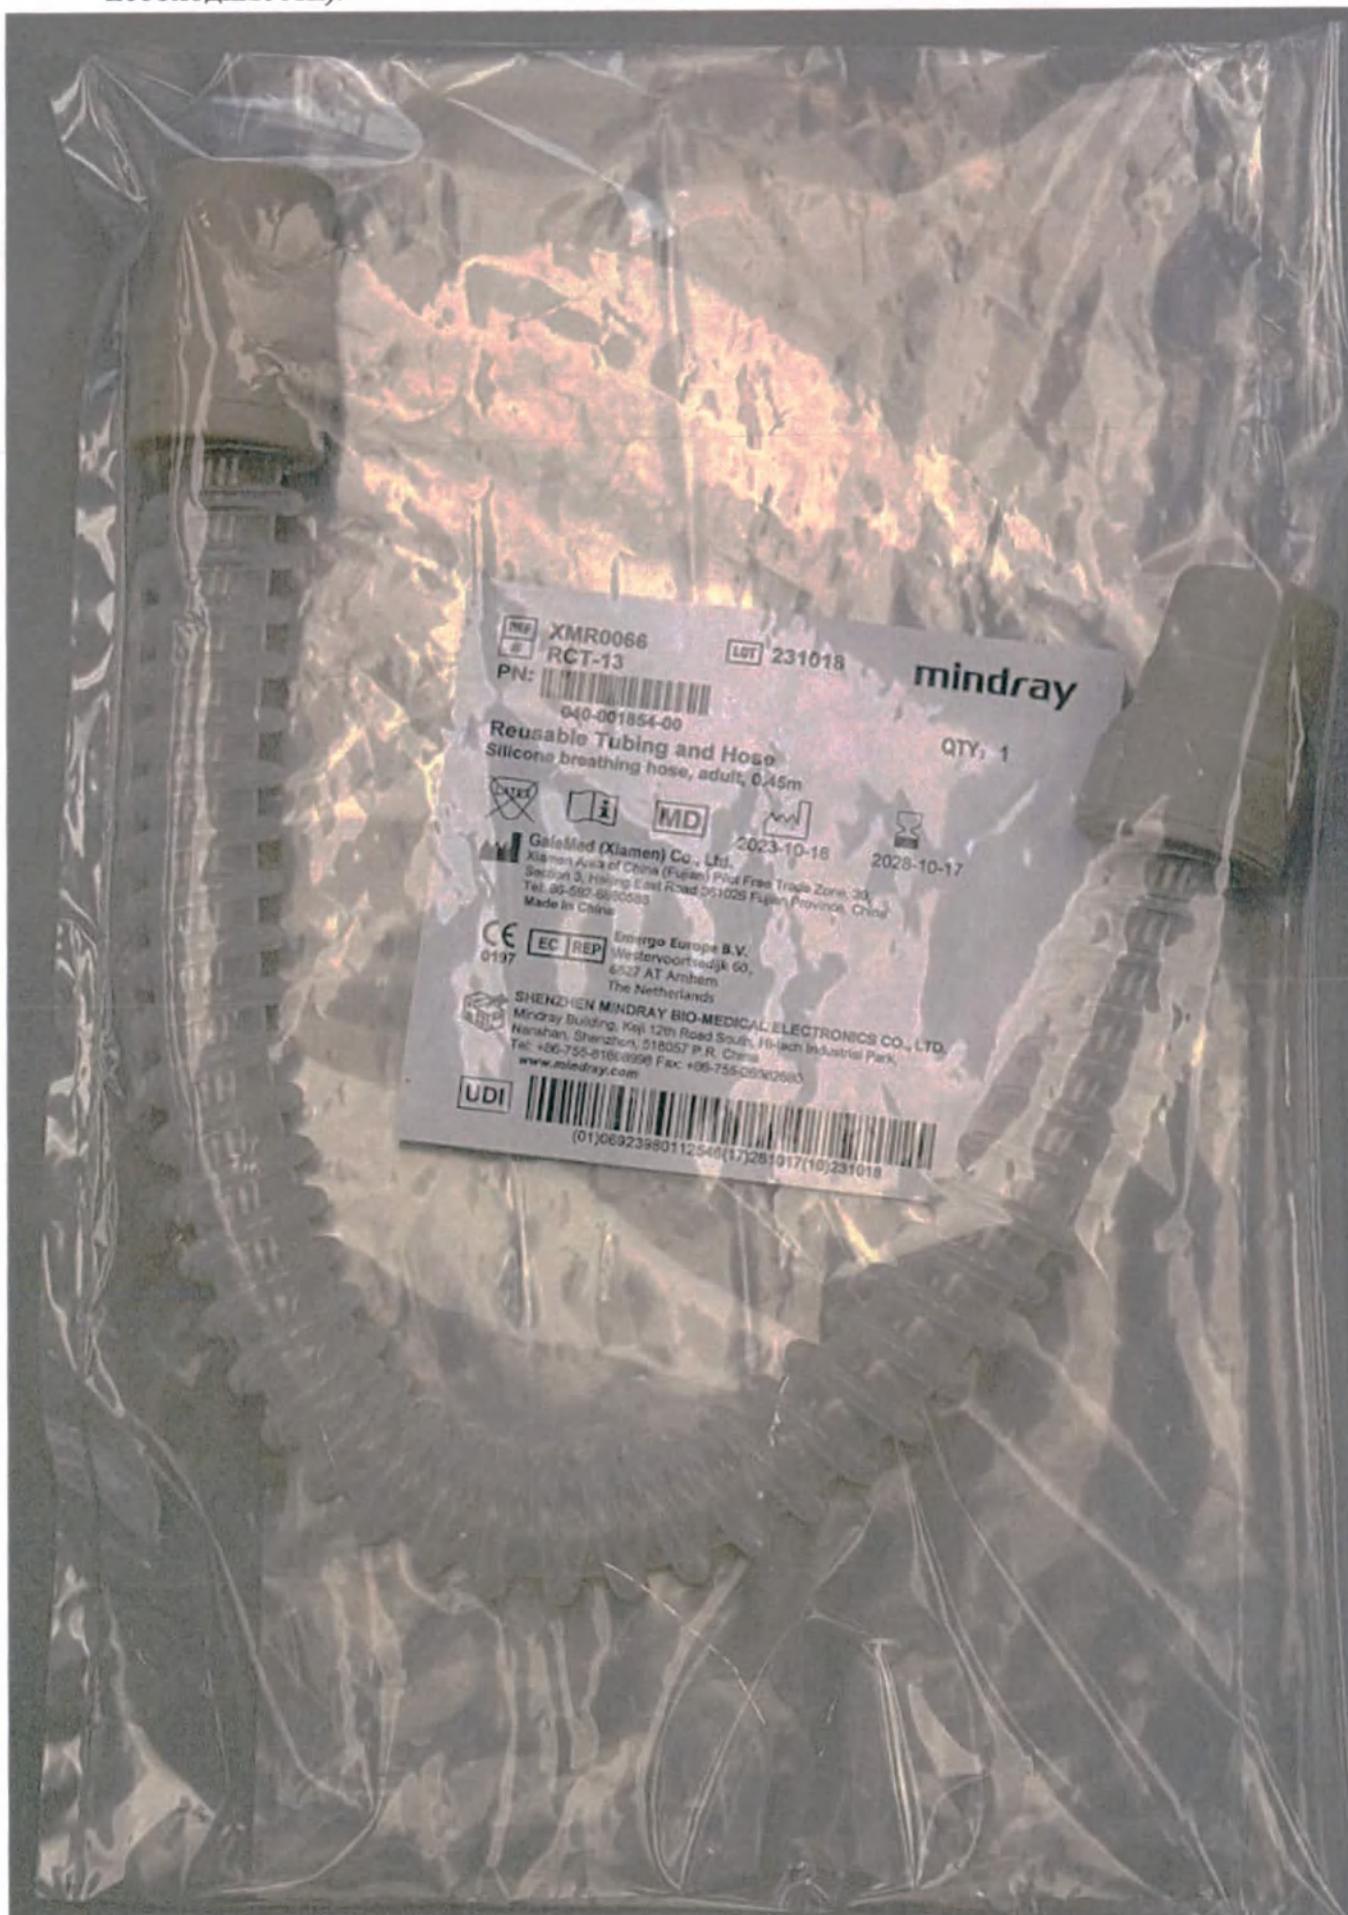

59. Маска дыхательная силиконовая – не более 30 шт. (при необходимости).

59.1. размер 0

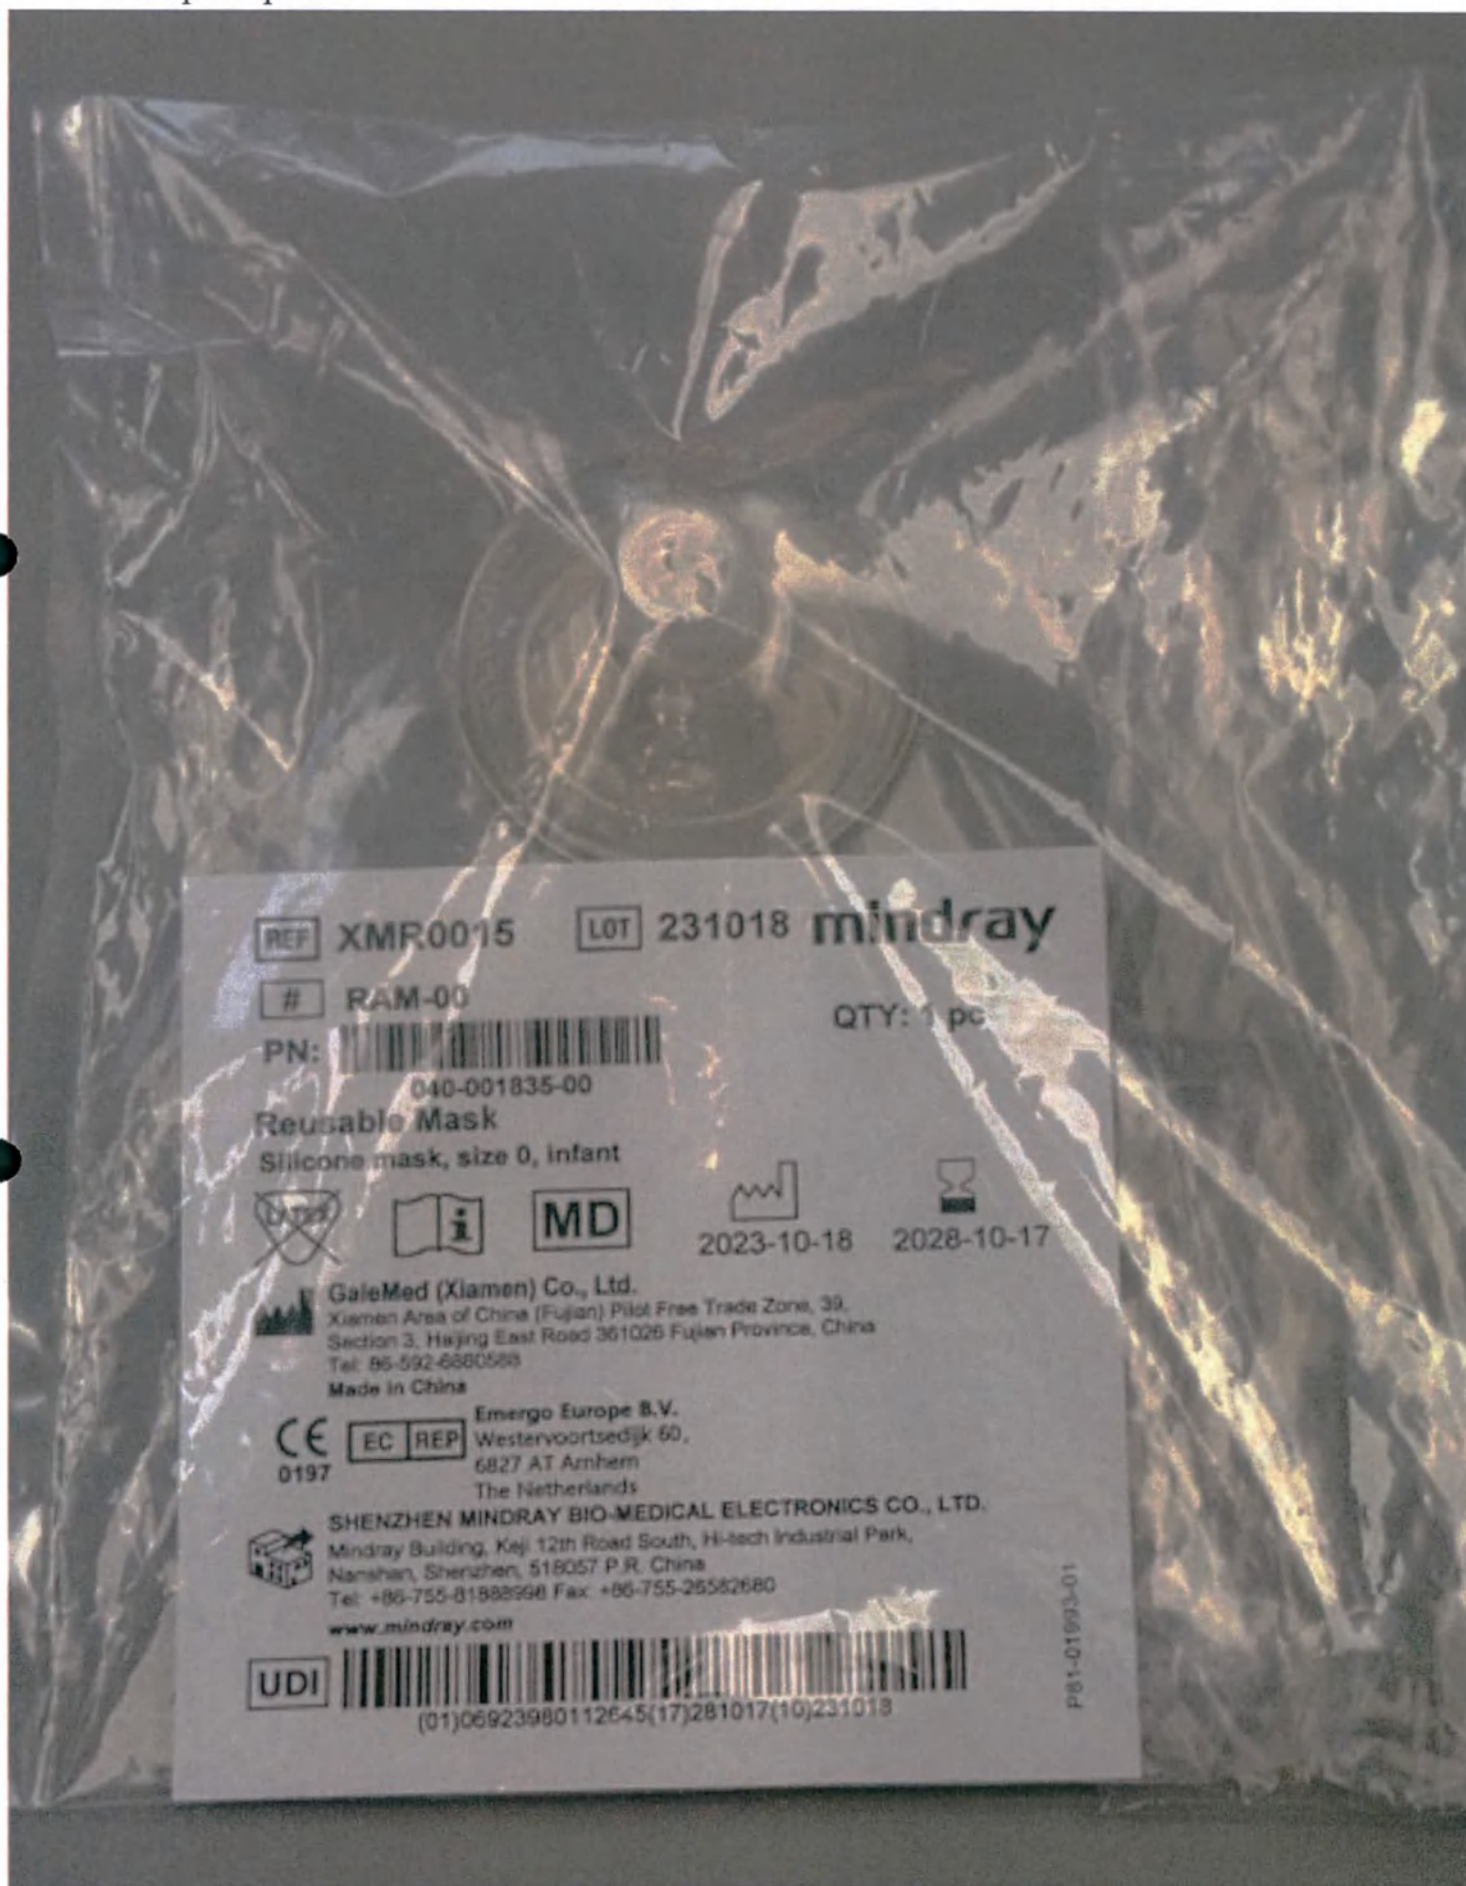

REF XMR0016

LOT 231018

mindray

RAM-01

PN:



QTY: 1 pc

040-001836-00

Reusable Mask

Silicone mask, size 1, infant large




2023-10-18 2028-10-17



GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588

Made in China



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

www.mindray.com



(01)06923980112652(17)281017(10)231018

P81-02282-01


REF XMR0017

LOT 231018

mindray

RAM-02

PN:



QTY: 1 pc

040-001837-00

Reusable Mask

Silicone mask, size 2, child



2023-10-18




2028-10-17



GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588
Made in China



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

www.mindray.com



(01)06923980112669(17)281017(10)231018

P81-02283-01

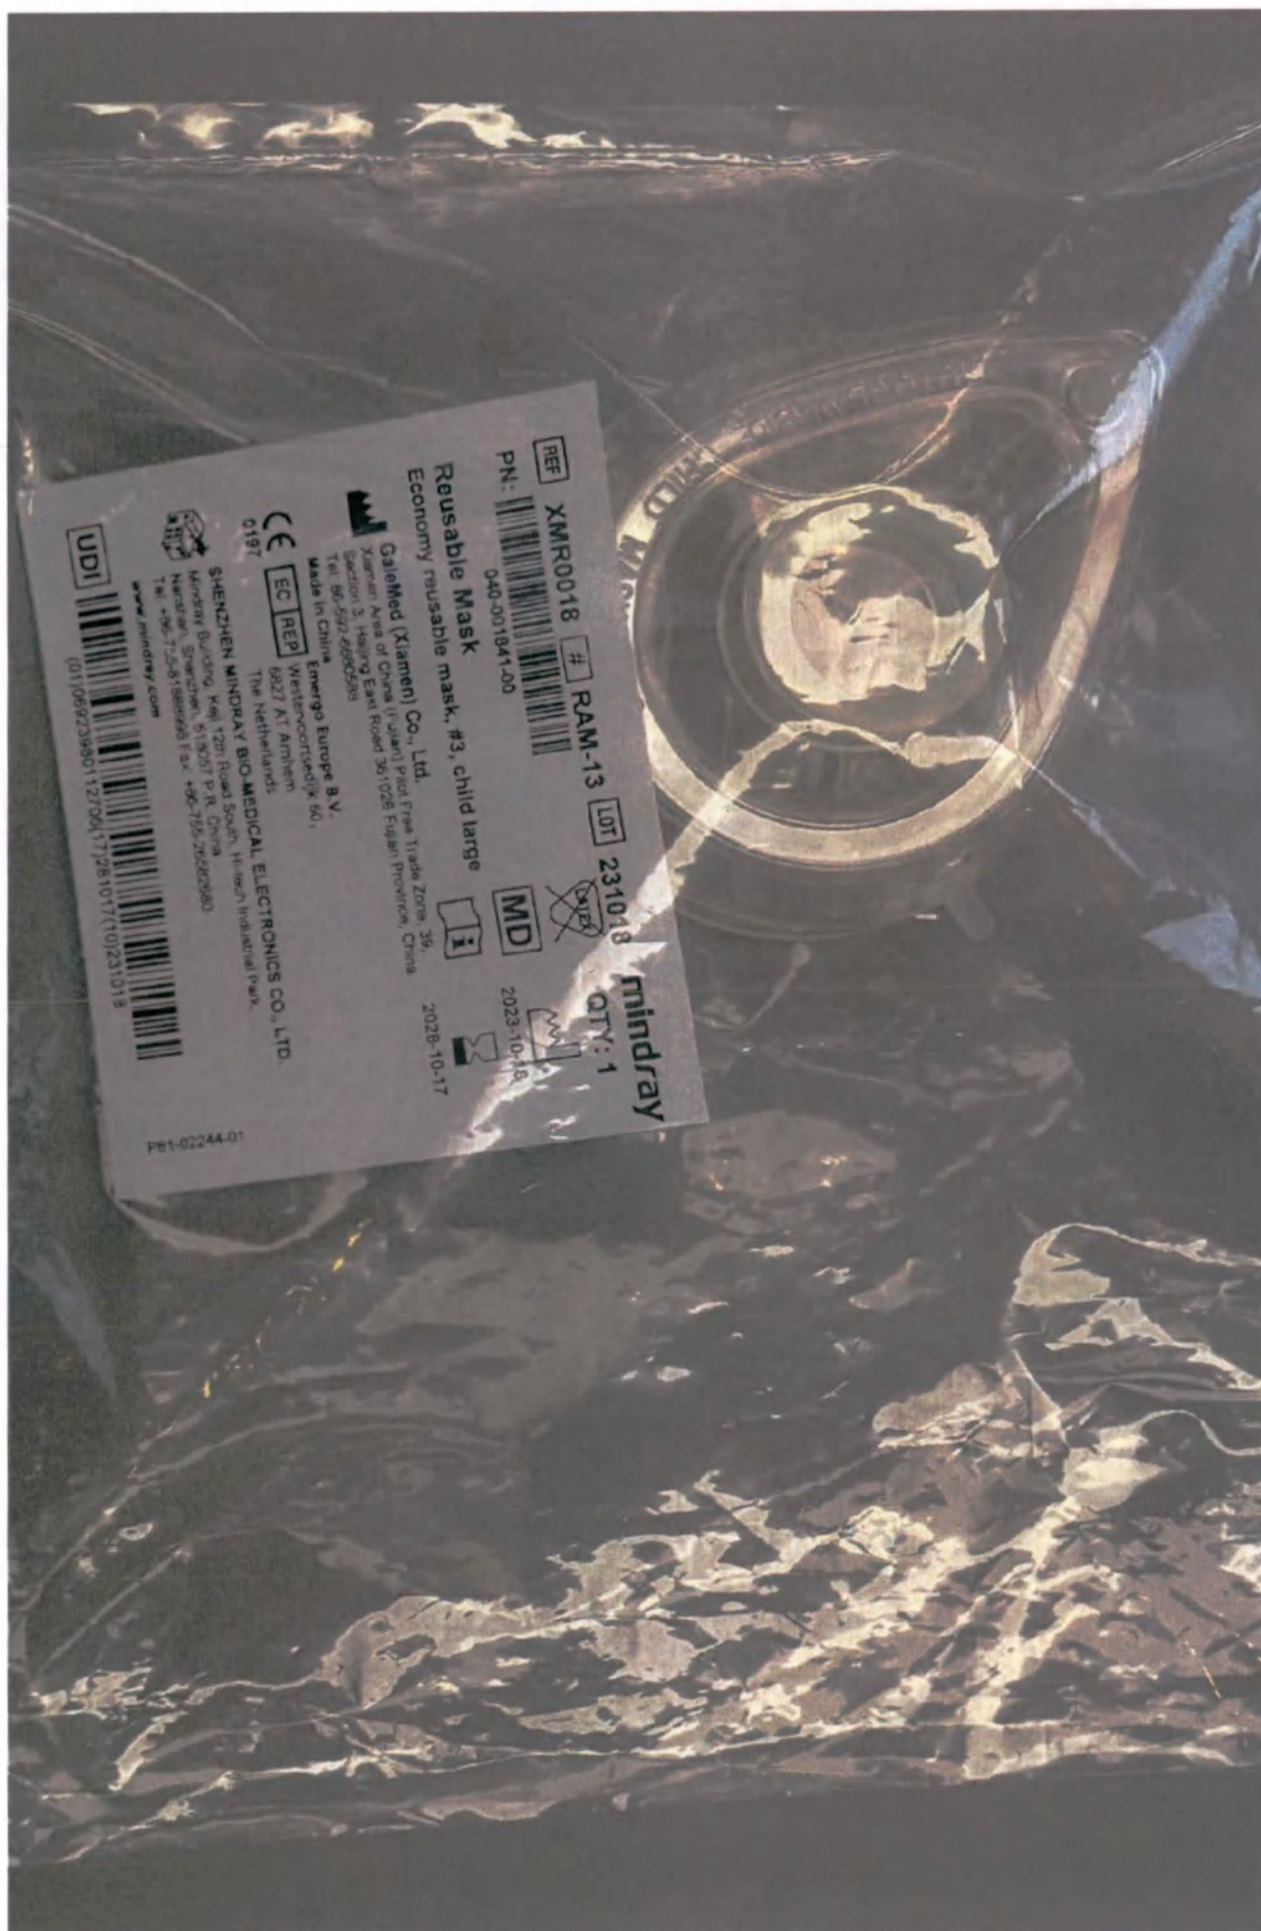

REF XMR0104 # RAM-14 LOT 231018 mindray


PN: 
040-001842-00

Reusable Mask

Economy reusable mask, #4, adult



QTY: 1



2023-10-18




2028-10-17



GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 33,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588

Made in China




Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680
www.mindray.com



(01)06923980112690(17)281017(10)231018

P81-02926-01

REF XMR0020 # RAM-15 LOT 231018 mindray


PN: 
040-001843-00

Reusable Mask
Economy reusable mask, #5, adult large

 GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.
Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 30,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-5580588
Made in China

CE 0197 EC REP Emergo Europe B.V.
Westervoortseijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Kefu 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81680968 Fax: +86-755-26582690
www.mindray.com

UDI 
0713054234801 1271301722810 171102231018

 QTY: 1
 2023-10-18
 2028-10-17

60. Маска дыхательная с воздушной подушкой, одноразовая – не более 30 шт. (при необходимости).

60.1. размер 0



REF XMR0021

LOT 231018

mindray

DM-01

PN: 
040-001818-00

QTY: 1

Disposable Mask

Aircushion mask, size 1, infant large

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripubertal males, male fetus and male infant of pregnant women, lactating women; exchange transfusion and total parental nutrition in neonates; multiple procedures in sick neonates; and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.



2023-10-18 2026-10-17

**GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.**

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588

Made in China

**Emergo Europe B.V.**

Westervoortsedijk 60,

6827 AT Arnhem

The Netherlands

**SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

www.mindray.com



(01)06923980112553(17)261017(10)231018

P81-0025-01

REF XMR0023

LOT 231018

mindray

DM-02

PN:



040-001819-00

QTY: 1

Disposable Mask

Aircushion mask, size 2, Child

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripuberal males, male fetus and male infant of pregnant women, lactating women; exchange transfusion and total parental nutrition in neonates; multiple procedures in sick neonates; and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.



2023-10-18 2026-10-17

**GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.**

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588
Made in China



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

**SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81880900 Fax: +86-755-26582680
www.mindray.com



(01)06923980112560(17)261017(10)231018

REF XMR0024

LOT 231018

mindray

DM-03

PN:



QTY: 1

040-001820-00

Disposable Mask

Aircushion mask, size 3, child large

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripuberal males, male fetus and male infant of pregnant women, lactating women; exchange transfusion and total parental nutrition in neonates; multiple procedures in sick neonates; and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.



2023-10-18 2026-10-17

**GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.**

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588

Made in China



0197




Emergo Europe B.V.
Westervoortseijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

**SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Tel: +86-755-81830668 Fax: +86-755-26582680

www.mindray.com



(01)06923980112577(17)281017(10)231018

REF XMR0102

LOT 231018

mindray

DM-04

QTY:1

PN:



040-001821-00

Disposable Mask

Aircushion mask, size 4, adult

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripuberal males, male fetus and male infant of pregnant women, lactating women; exchange transfusion and total parental nutrition in neonates; multiple procedures in sick neonates; and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.




2023-10-18 2026-10-17



GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588

Made in China




Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

www.mindray.com



(01)08923980112607(17)261017(10)231018

PS: 02054-01

REF XMR0026

LOT 231018

mindray

DM-05

PN:



QTY:1

040-001822-00

Disposable Mask

Aircushion mask, Size 5, Adult Large

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripuberal males, male fetus and male infant of pregnant women; lactating women; exchange transfusion and total parental nutrition in neonates; multiple procedures in sick neonates; and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.



2023-10-18 2026-10-17

**GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.**

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 351026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588
Made in China




EC REP


Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

**SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.**

Mindray Building, Kee 12th Road South, Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81690000 Fax: +86-755-81690001
www.mindray.com



61. Мешок дыхательный безлатексный, одноразовый – не более 30 шт. (при необходимости).
61.1. размер 0,5л

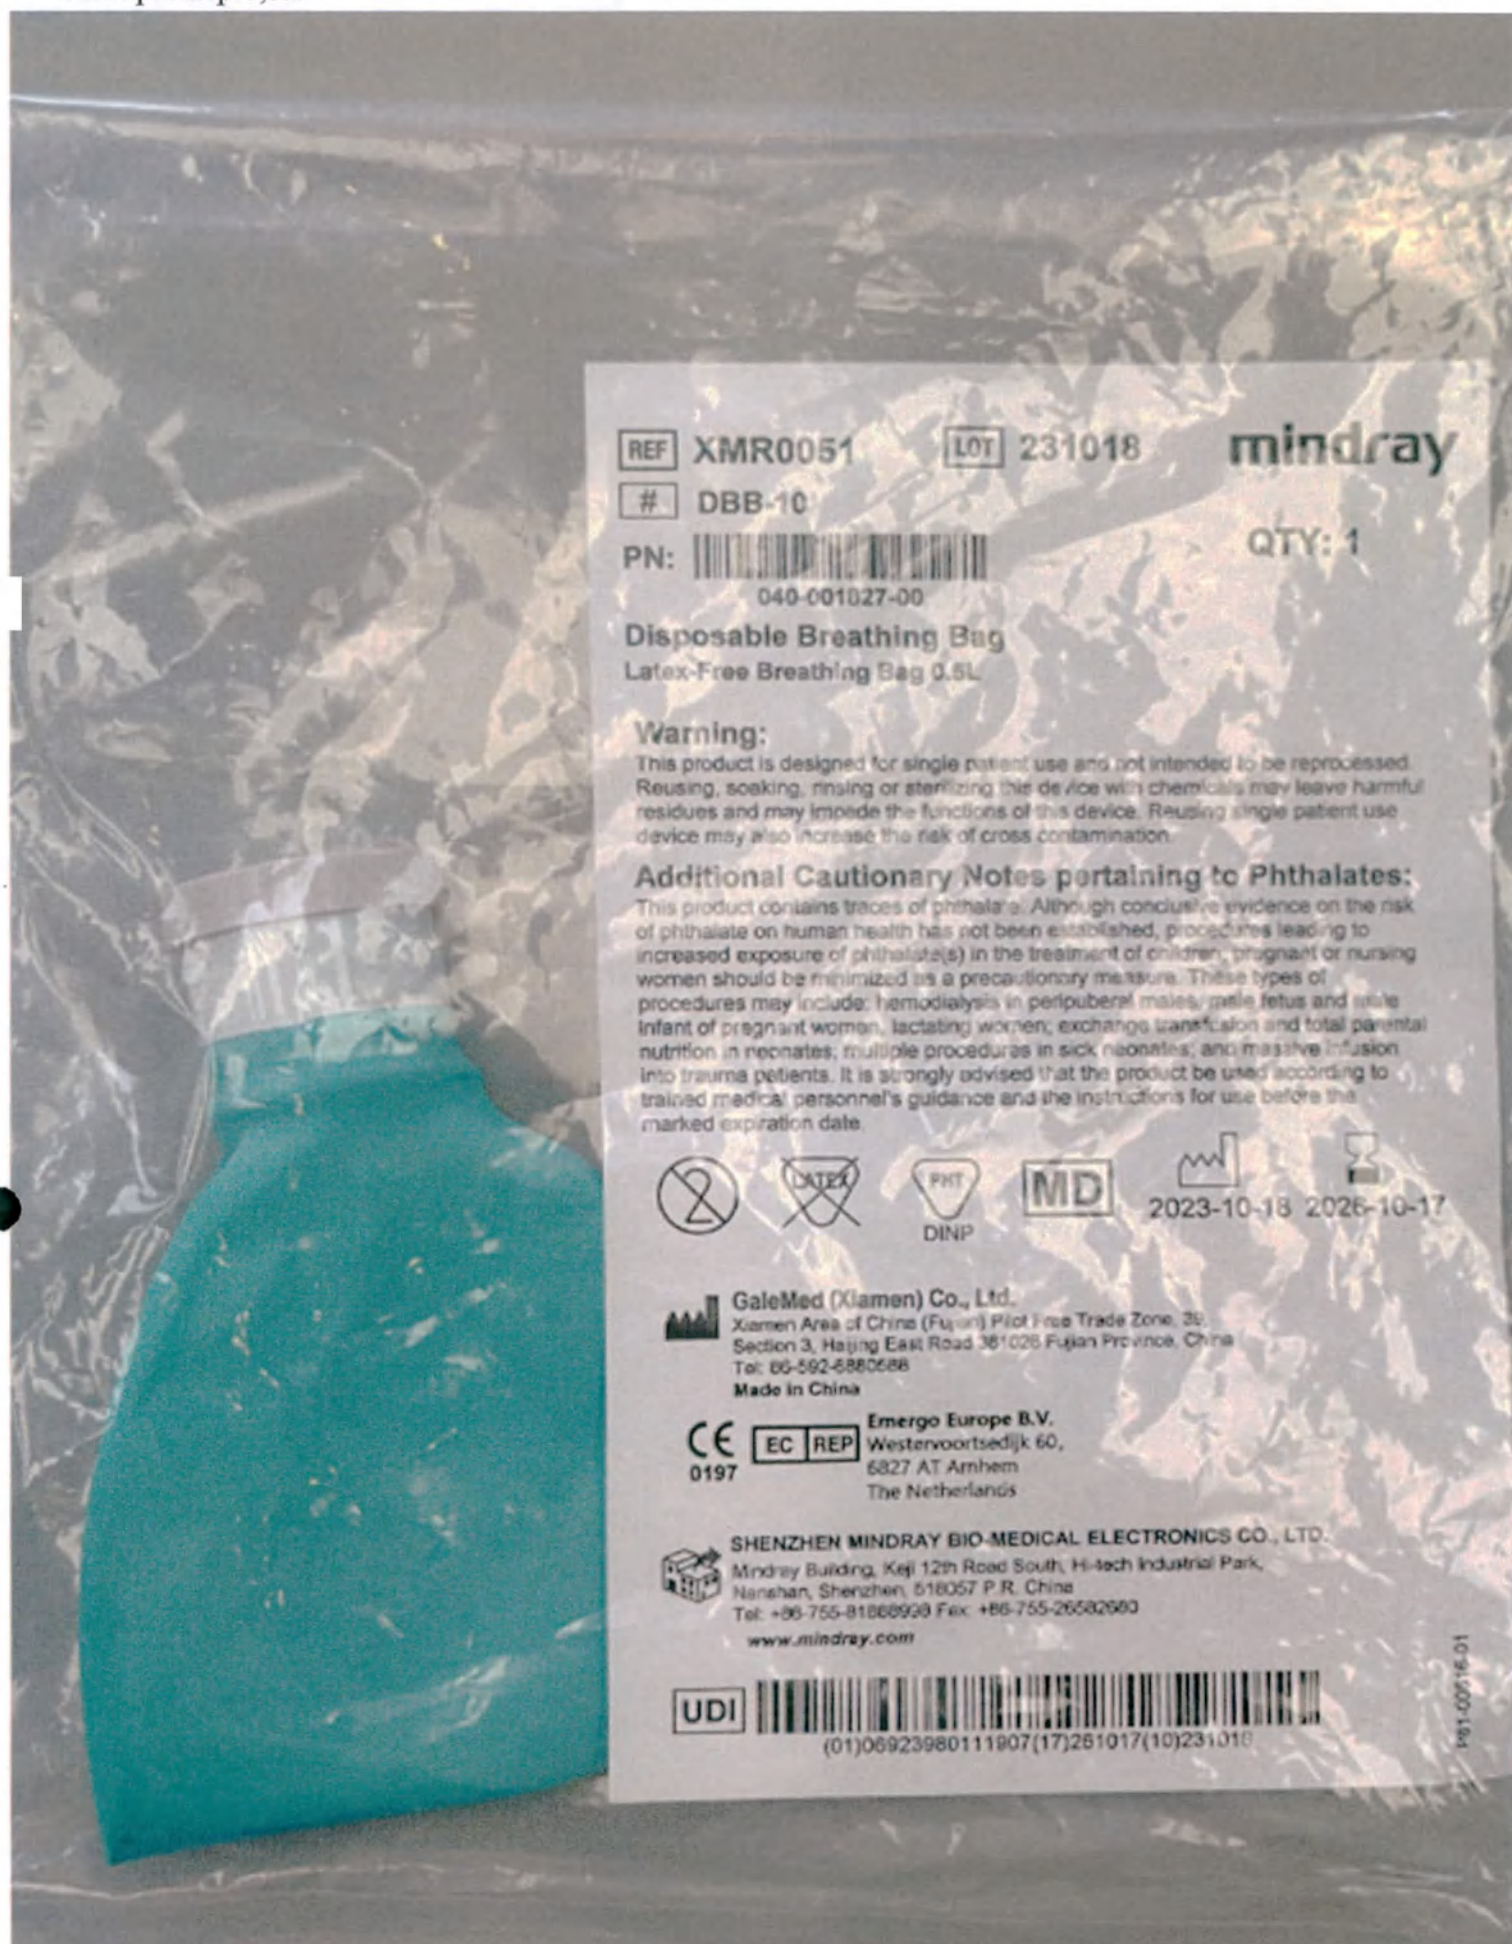

REF XMR0051

LOT 231018

mindray

DBB-10

PN: 

QTY: 1

040-001027-00


Disposable Breathing Bag
Latex-Free Breathing Bag 0.5L

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripubertal males, male fetus and male infant of pregnant women, lactating women; exchange transfusion and total parental nutrition in neonates; multiple procedures in sick neonates; and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.



2023-10-18 2026-10-17




GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 25,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China

Tel: 86-592-6880688

Made in China



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Tel: +86-755-81889929 Fax: +86-755-26582660

www.mindray.com



(01)06923980111907(17)261017(10)231018

1931-00516-01

REF XMR0052

LOT 231018

mindray

DBB-11

QTY: 1

PN: 
040-001828-00

Disposable Breathing Bag

Latex-Free Breathing Bag 1L

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripuberal males, male fetus and male infant of pregnant women, lactating women; exchange transfusion and total parental nutrition in neonates; multiple procedures in sick neonates; and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.




2023-10-18 2026-10-17



GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6890588
Made in China




Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Kaji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

www.mindray.com



(01)06923980112614(17)261017(10)231018

P81-00618-01

REF XMR0053

LOT 231018

mindray

DEB-12

PN: 
040-001829-00

QTY: 1

Disposable Breathing Bag
Latex-Free Breathing Bag 2L

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripuberal males, male fetus and male infant of pregnant women, lactating women, exchange transfusion and total parental nutrition in neonates, multiple procedures in sick neonates, and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.




2023-10-18 2026-10-17



GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588
Made in China



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26182080
www.mindray.com



(01)06923980112621(17)261017(10)231018

P81-00827-G1

REF XMR0081

LOT 231018

mindray

DBB-13

PN: 
040-001830-00

QTY: 1

Disposable Breathing Bag
Latex-Free Breathing Bag 3L

Warning:

This product is designed for single patient use and not intended to be reprocessed. Reusing, soaking, rinsing or sterilizing this device with chemicals may leave harmful residues and may impede the functions of this device. Reusing single patient use device may also increase the risk of cross contamination.

Additional Cautionary Notes pertaining to Phthalates:

This product contains traces of phthalate. Although conclusive evidence on the risk of phthalate on human health has not been established, procedures leading to increased exposure of phthalate(s) in the treatment of children, pregnant or nursing women should be minimized as a precautionary measure. These types of procedures may include: hemodialysis in peripubertal males, male fetus and male infant of pregnant women, lactating women; exchange transfusion and total parental nutrition in neonates; multiple procedures in sick neonates; and massive infusion into trauma patients. It is strongly advised that the product be used according to trained medical personnel's guidance and the instructions for use before the marked expiration date.




2023-10-18 2026-10-17



GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588

Made in China



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680

www.mindray.com

UDI




(01)08923980112638(17)261017(10)231018

P81-02578-01

62. Мешок дыхательный, силиконовый - не более 30 шт. (при необходимости).

62.1. размер 0,5л

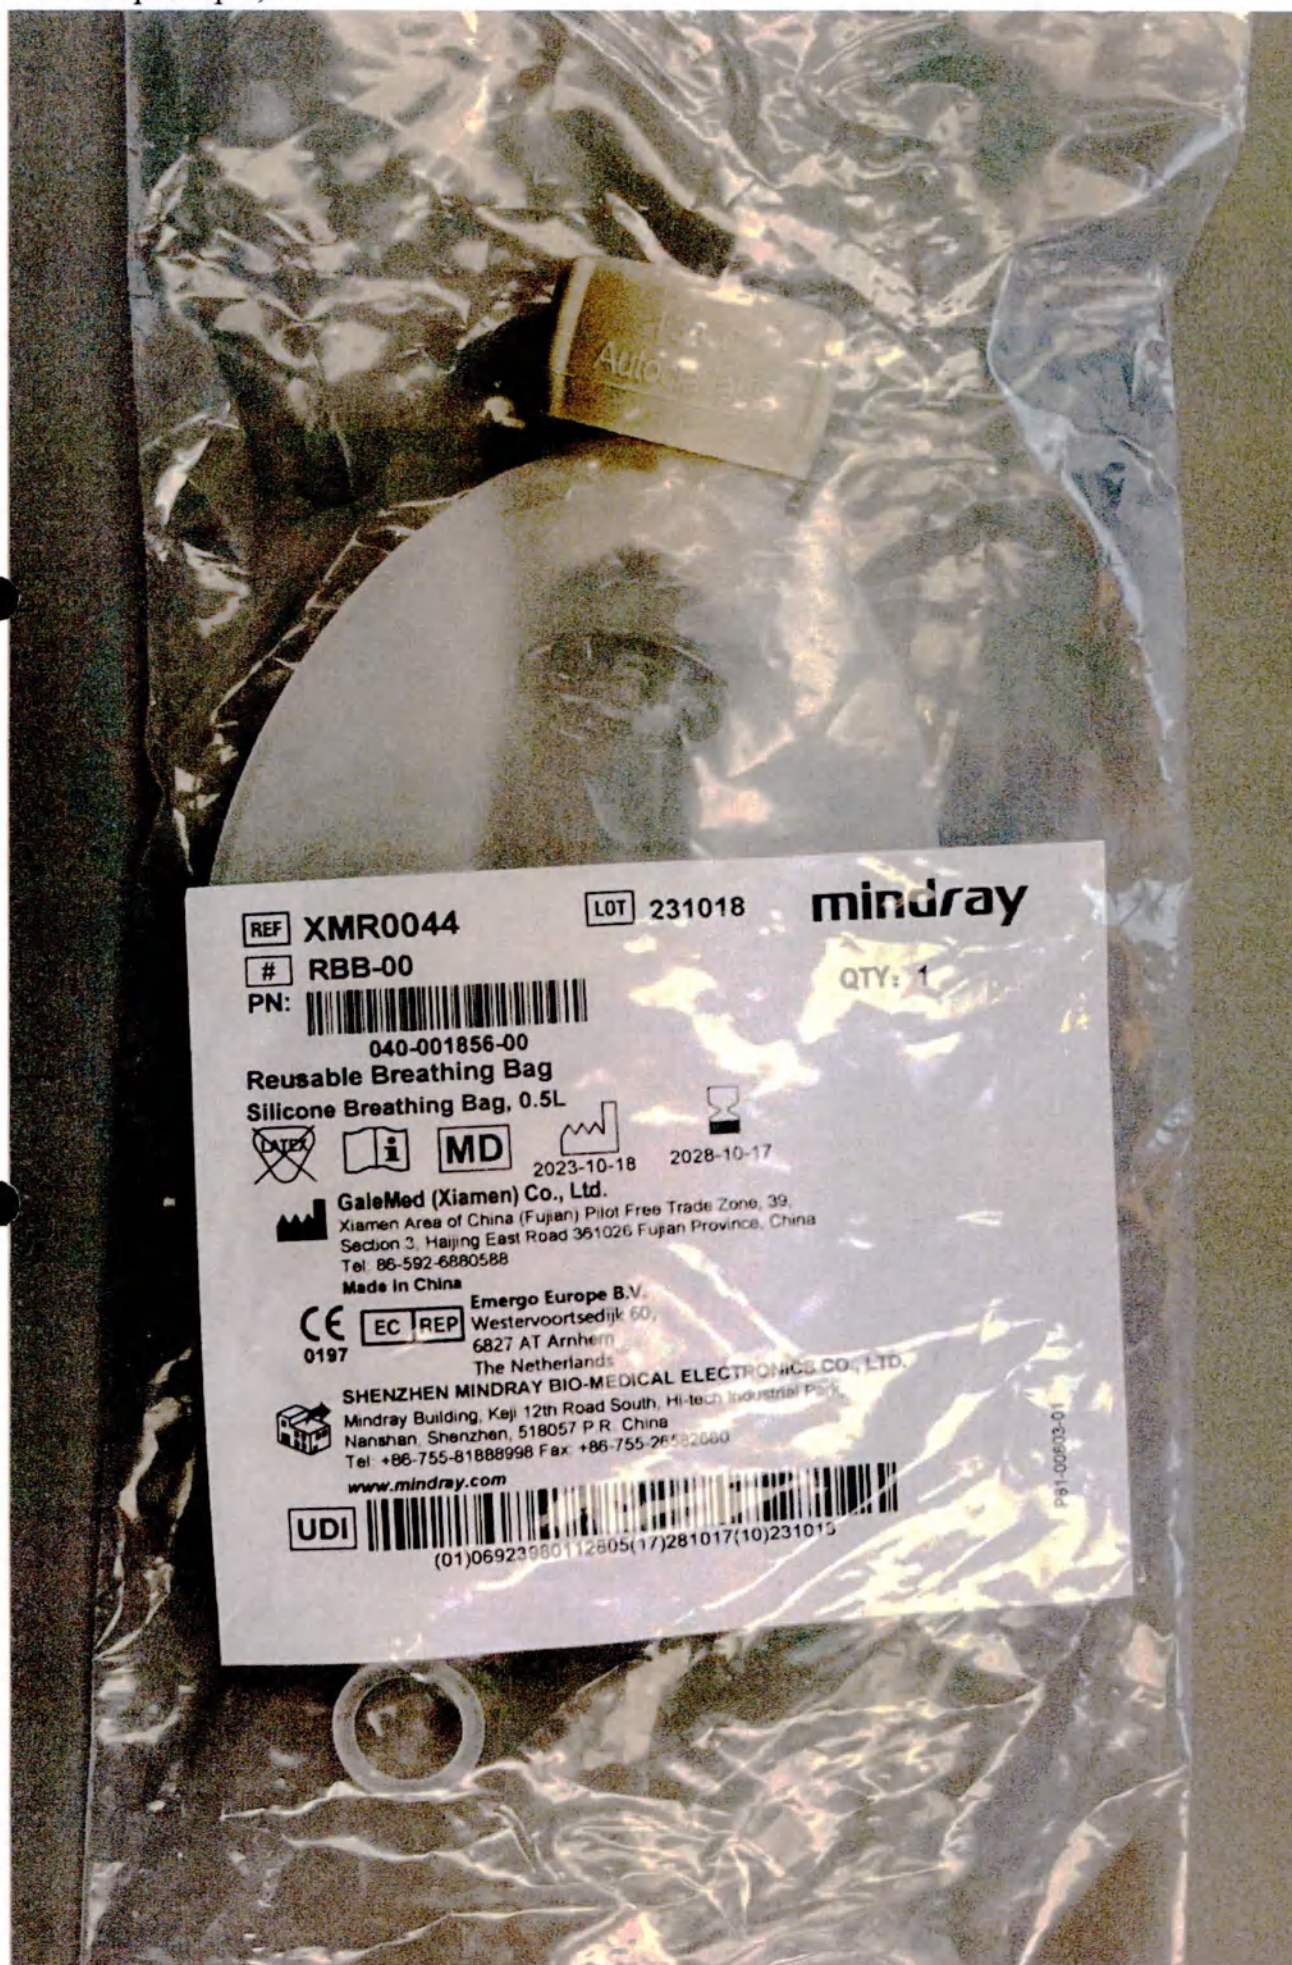

REF XMR0044

LOT 231018

mindray

RBB-00

QTY: 1


PN:



040-001856-00

Reusable Breathing Bag

Silicone Breathing Bag, 0.5L



2023-10-18


2028-10-17



GaleMed (Xiamen) Co., Ltd.

Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone, 39,
Section 3, Haijing East Road 361026 Fujian Province, China
Tel: 86-592-6880588

Made in China



Emergo Europe B.V.
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582660


www.mindray.com




(01)06923980112805(17)281017(10)231015

P81-006/03-01

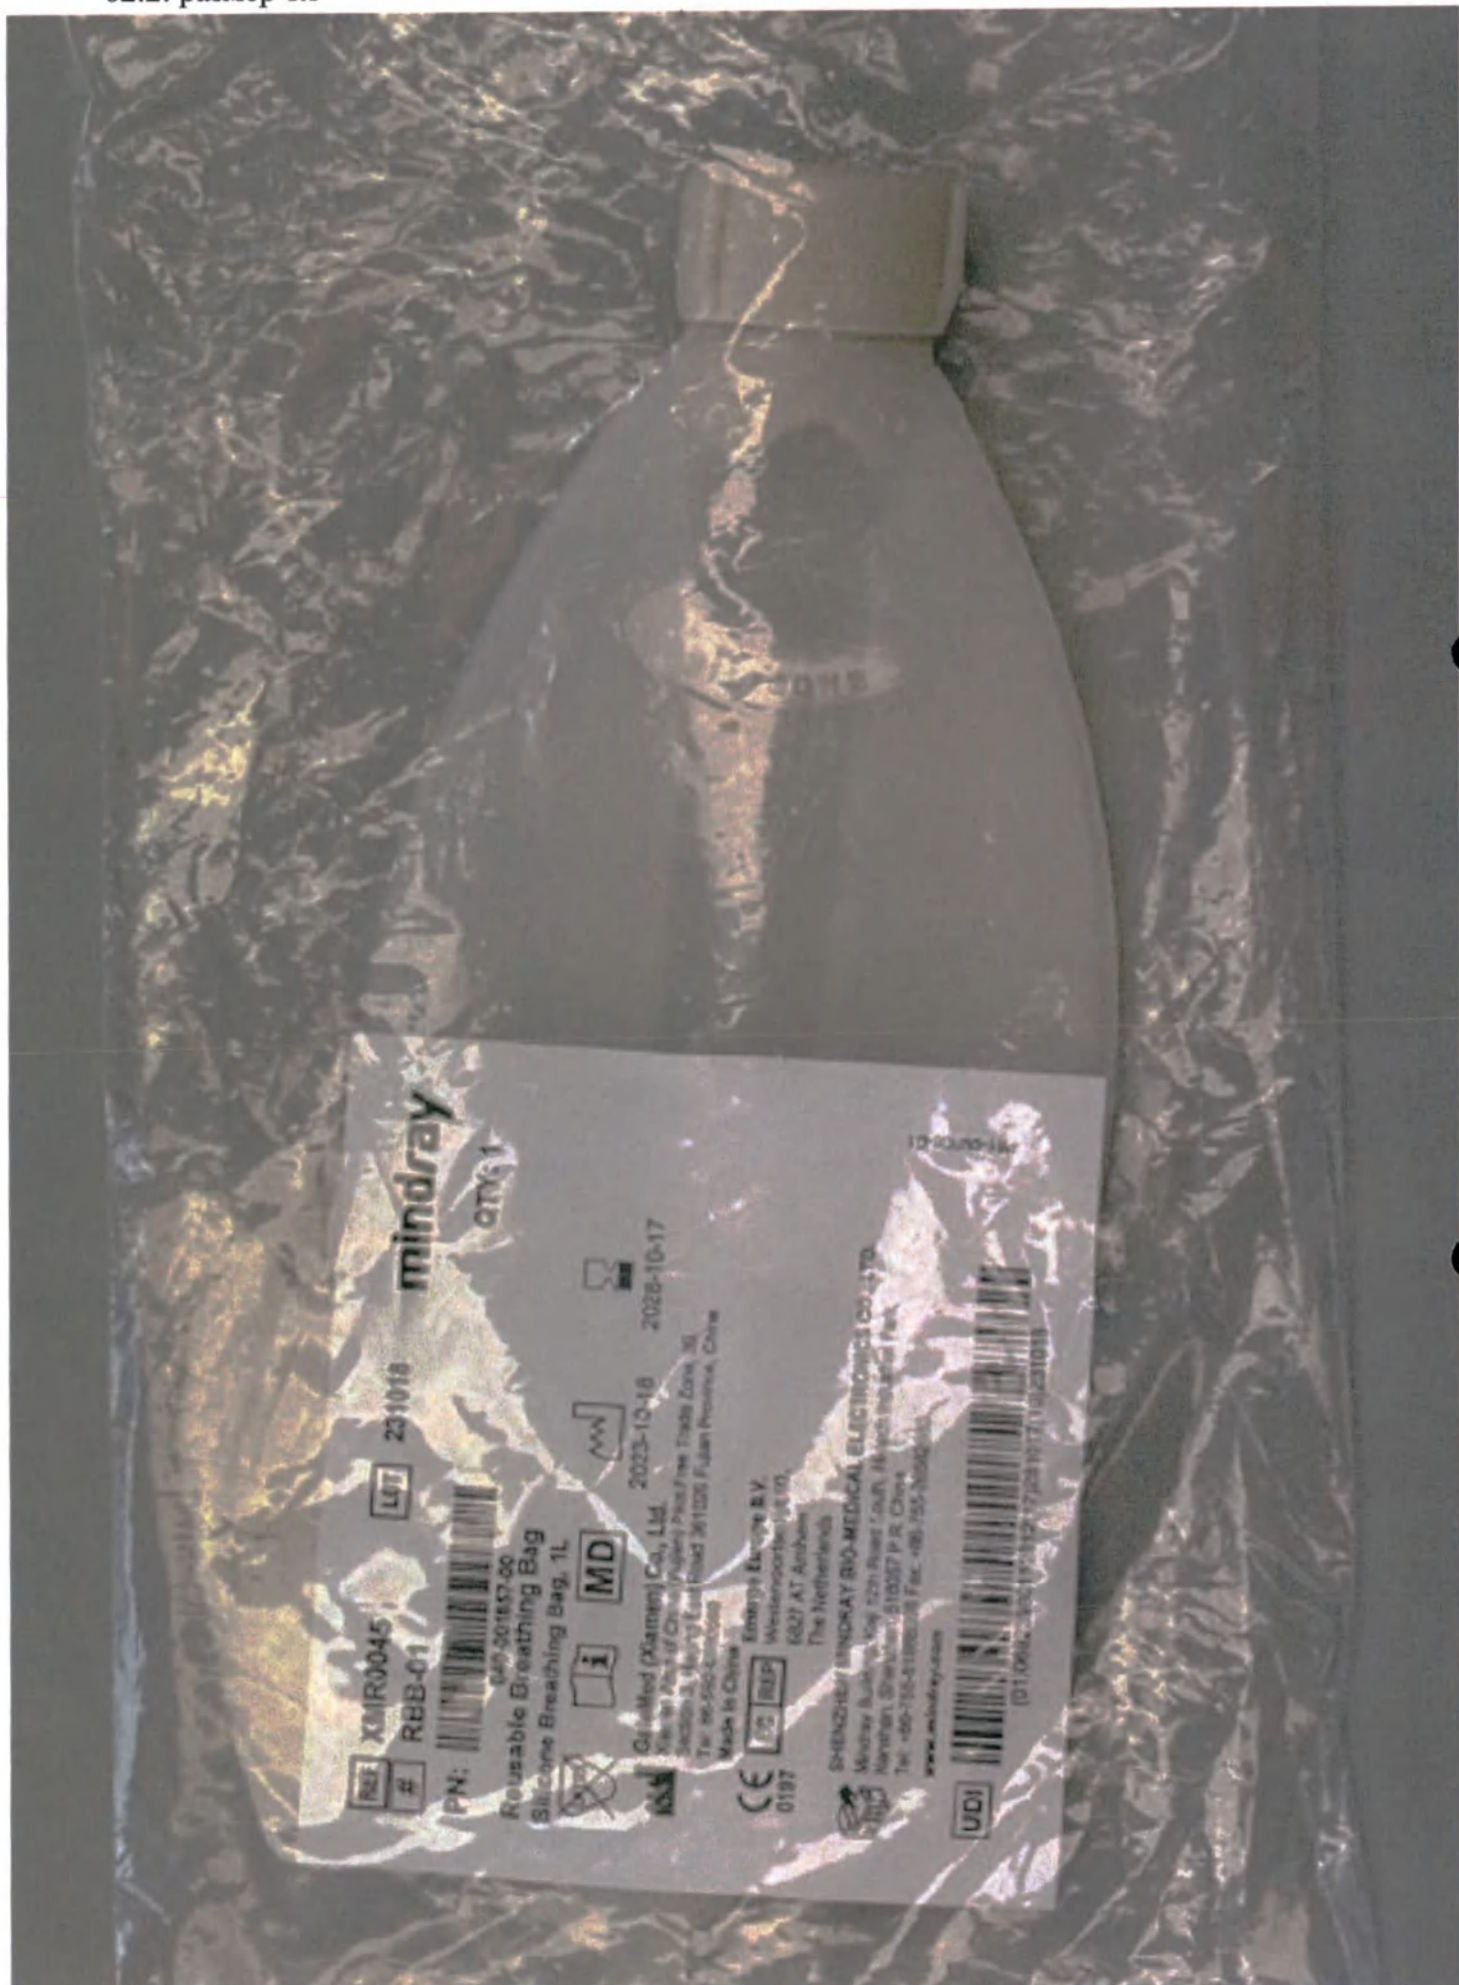

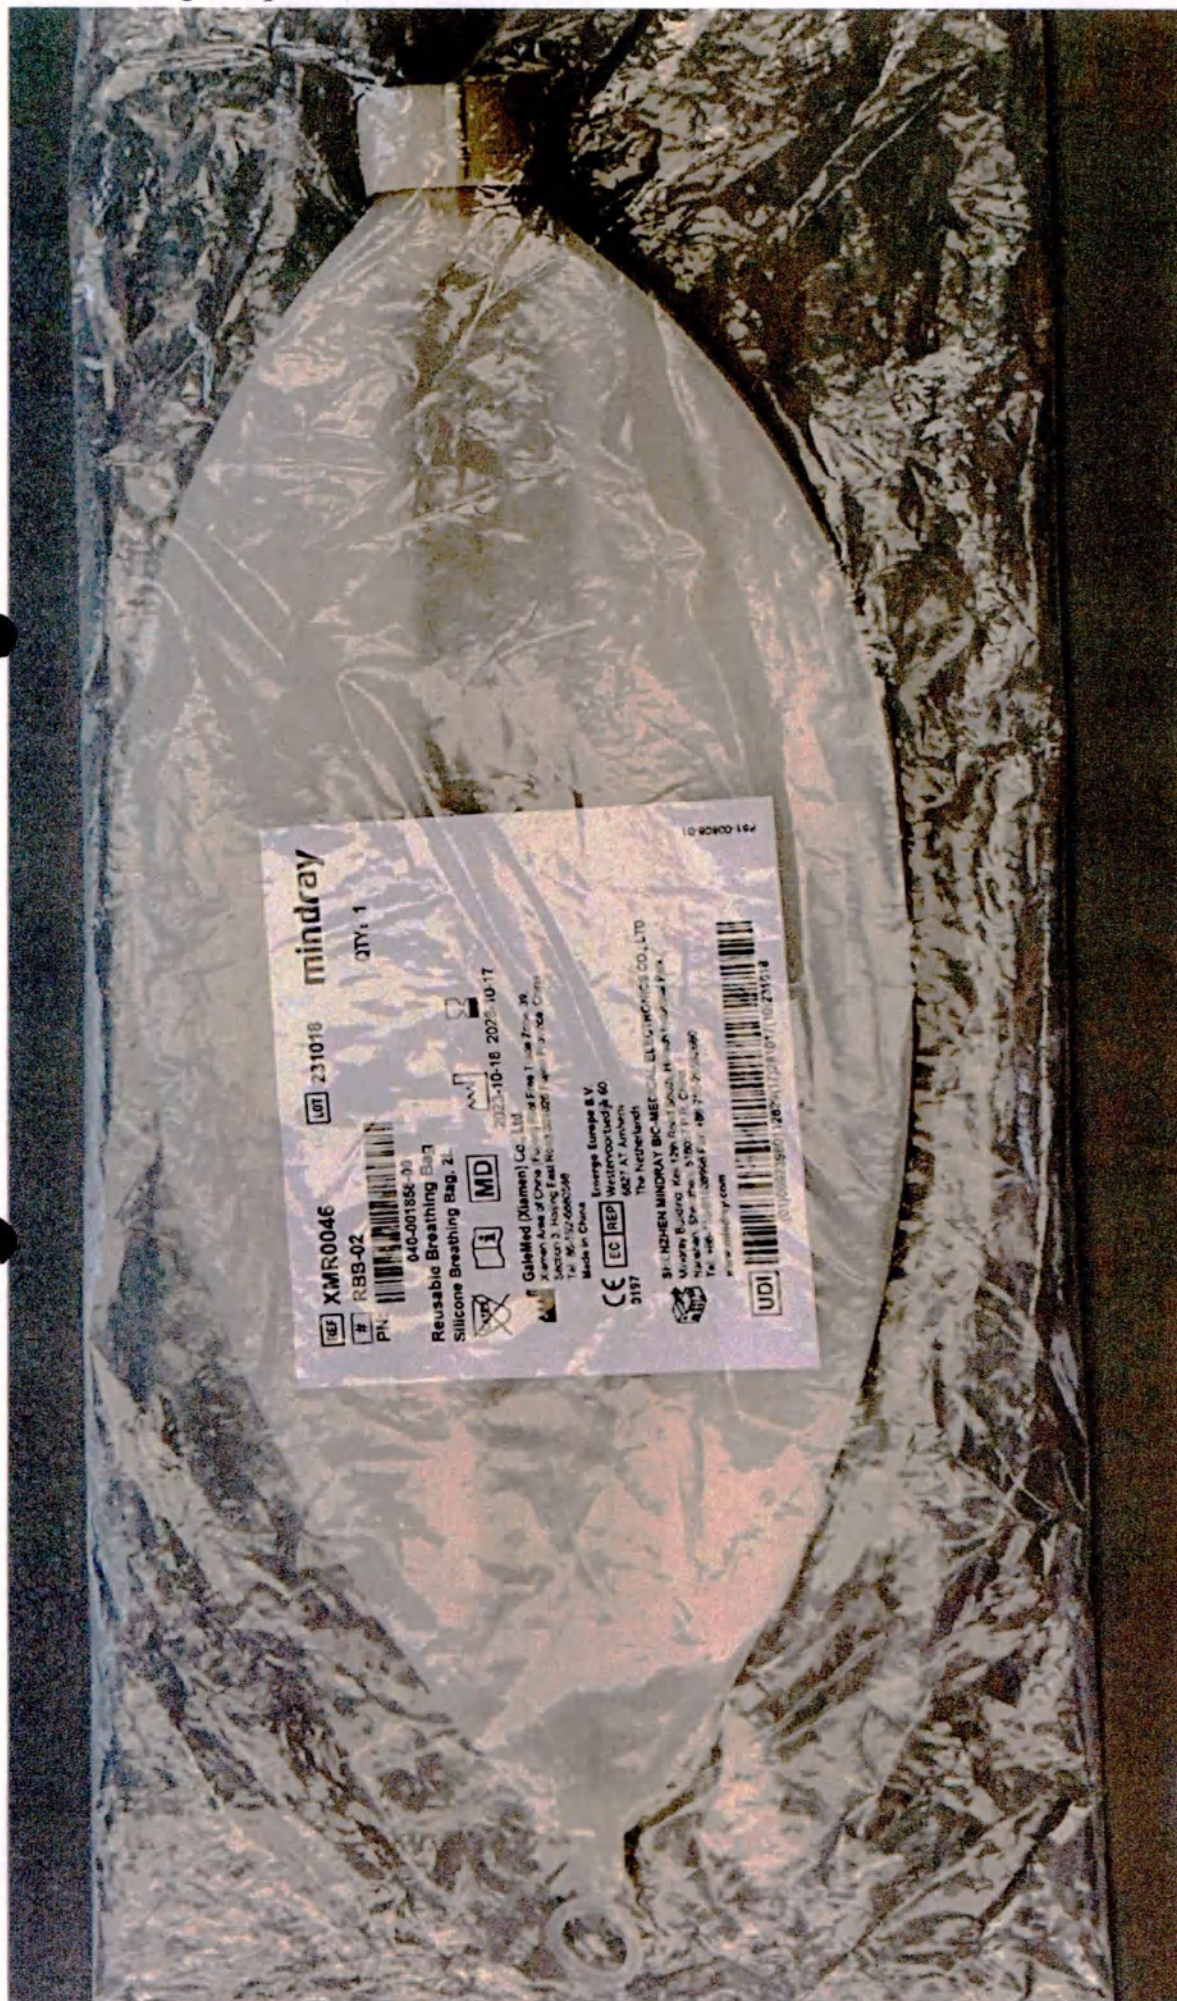


62.4. размер 3л

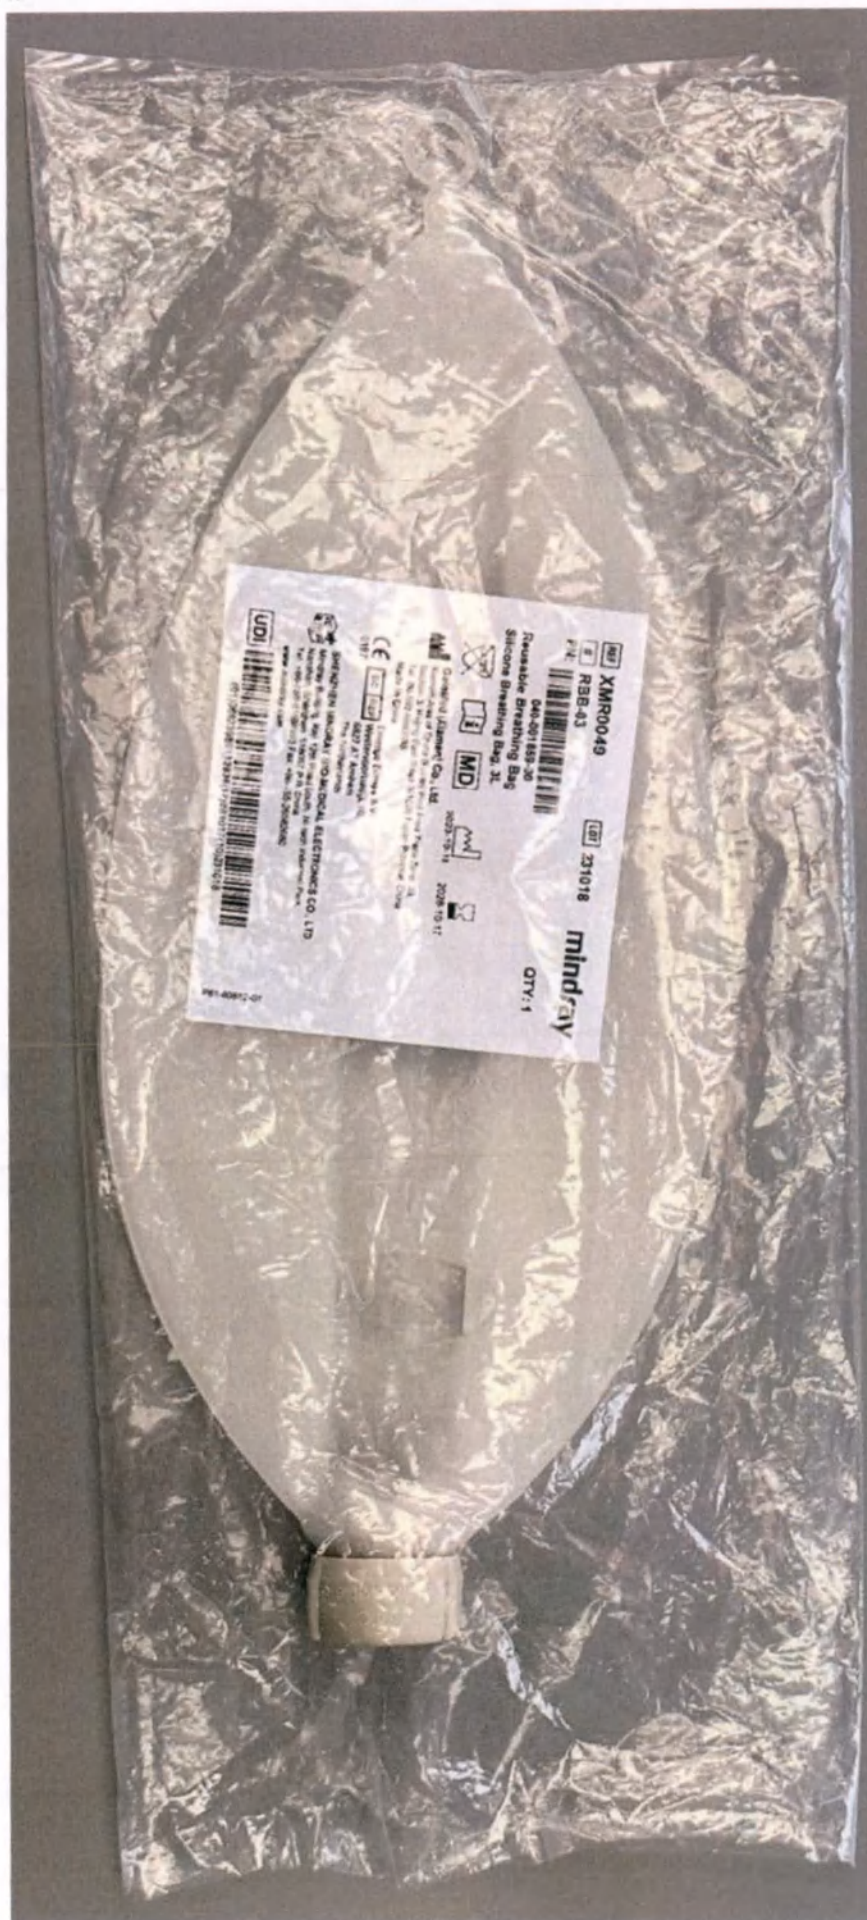

63. Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для взрослых, гладкоствольный - не более 50 шт. (при необходимости), в составе:

- Трубка дыхательная силиконовая гладкоствольная, 1,5 м - 2 шт.;
- Мешок дыхательный, силиконовый 3 л - 1 шт.;
- Маска дыхательная силиконовая, размер 5 - 1 шт.;
- Коннектор Y-образный - 1 шт.;
- Коннектор L-образный - 1 шт.

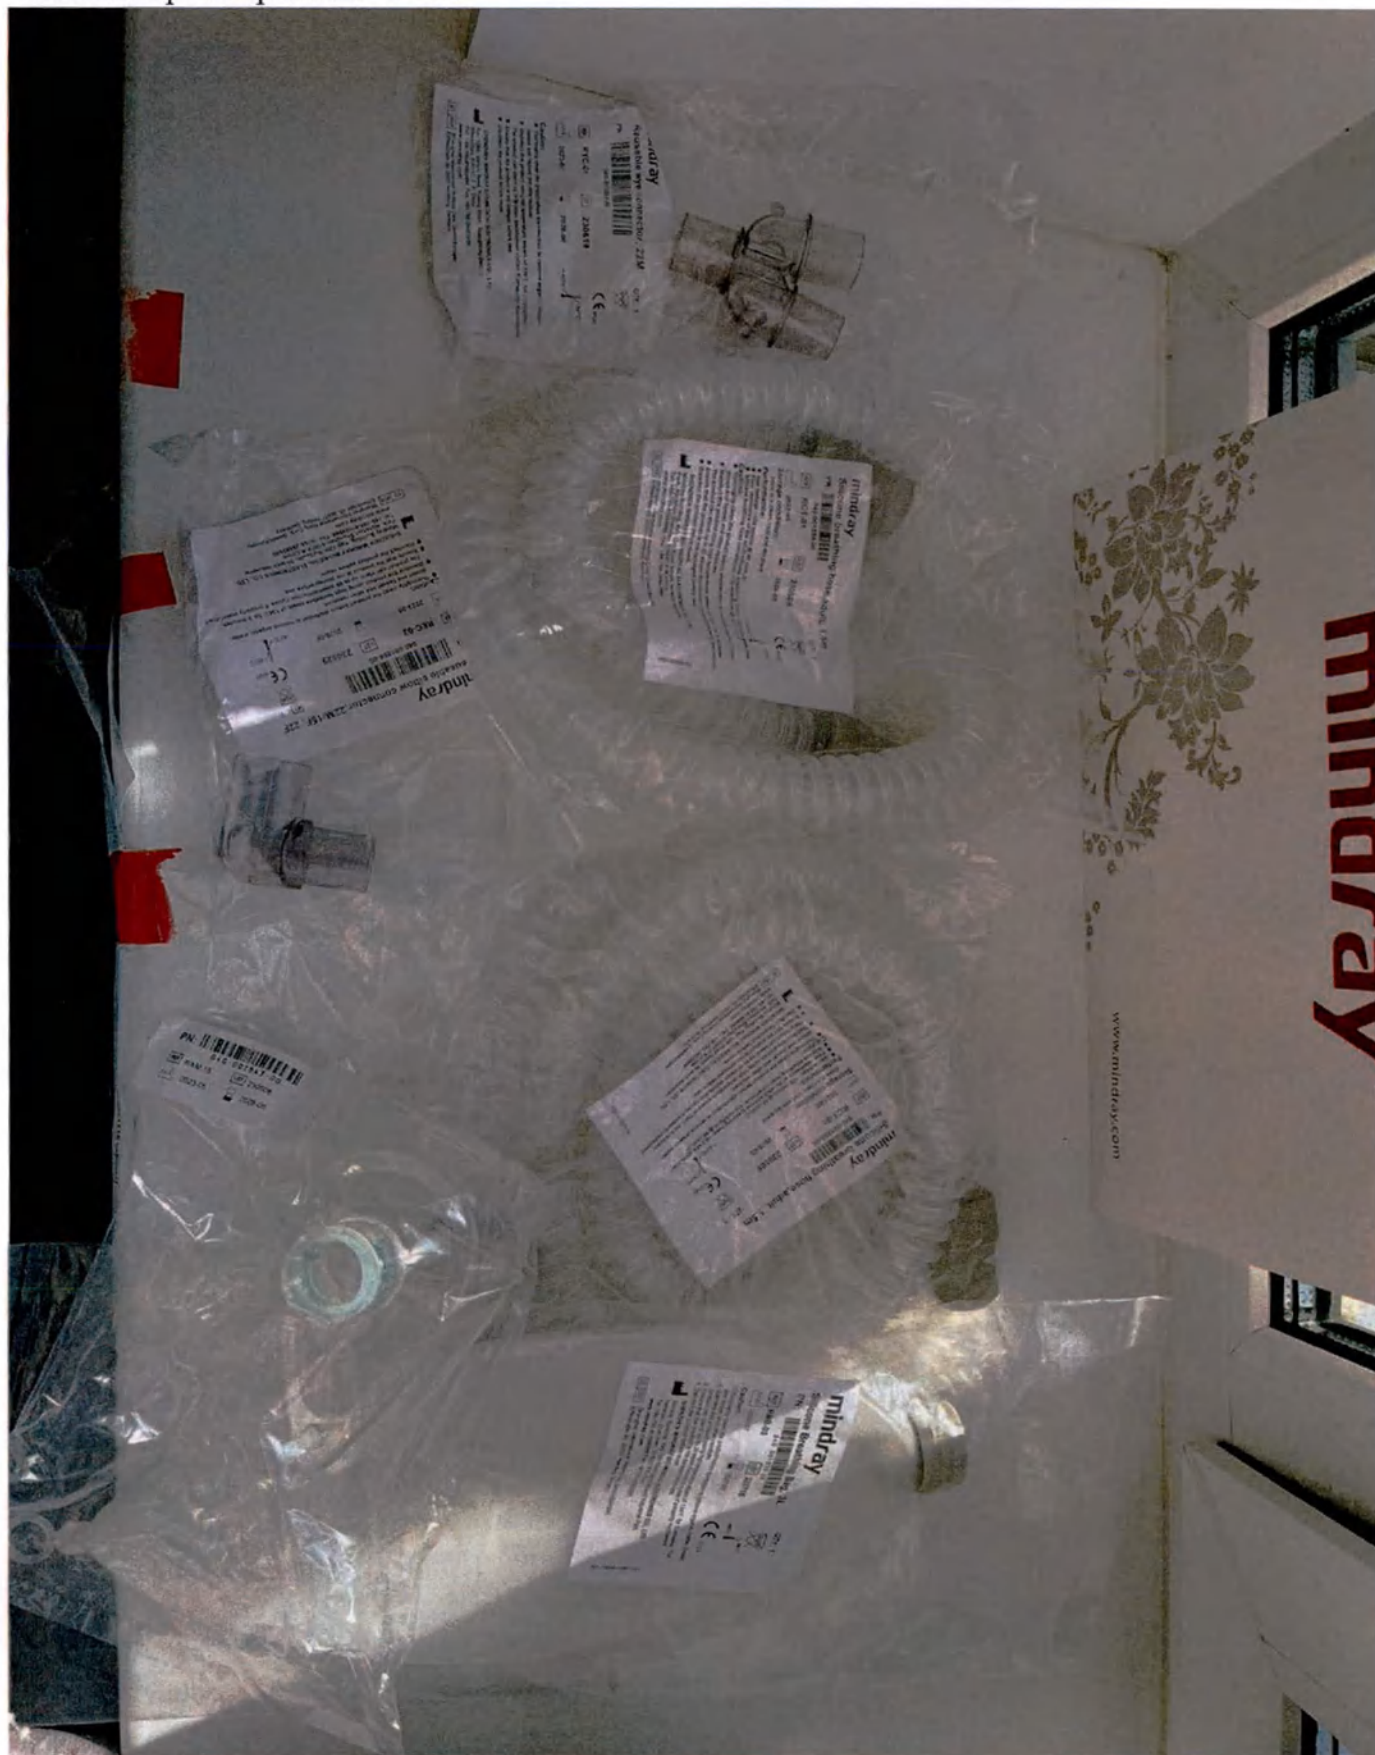


64. Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для детей, гладкоствольный - не более 50 шт. (при необходимости), в составе:

- 64.1. трубка дыхательная силиконовая гладкоствольная для детей/грудных детей, 1.5 м - 2 шт.;
- 64.2. мешок дыхательный, силиконовый 1 л - 1 шт.;
- 64.3. маска дыхательная силиконовая, размер 2 - 1 шт.;
- 64.4. коннектор Y-образный - 1 шт.;
- 64.5. коннектор L-образный - 1 шт.




65. Контур дыхательный, одноразовый для взрослых - не более 50 шт. (при необходимости), в наборе:

- Контур дыхательный, взрослый, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.;
- Коннектор L-образный - 1 шт.;
- Коннектор прямой - 1 шт.;
- Фильтр бактериальный - 1 шт.;
- Трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
- Мешок дыхательный, безлатексный, 3 л - 1 шт.

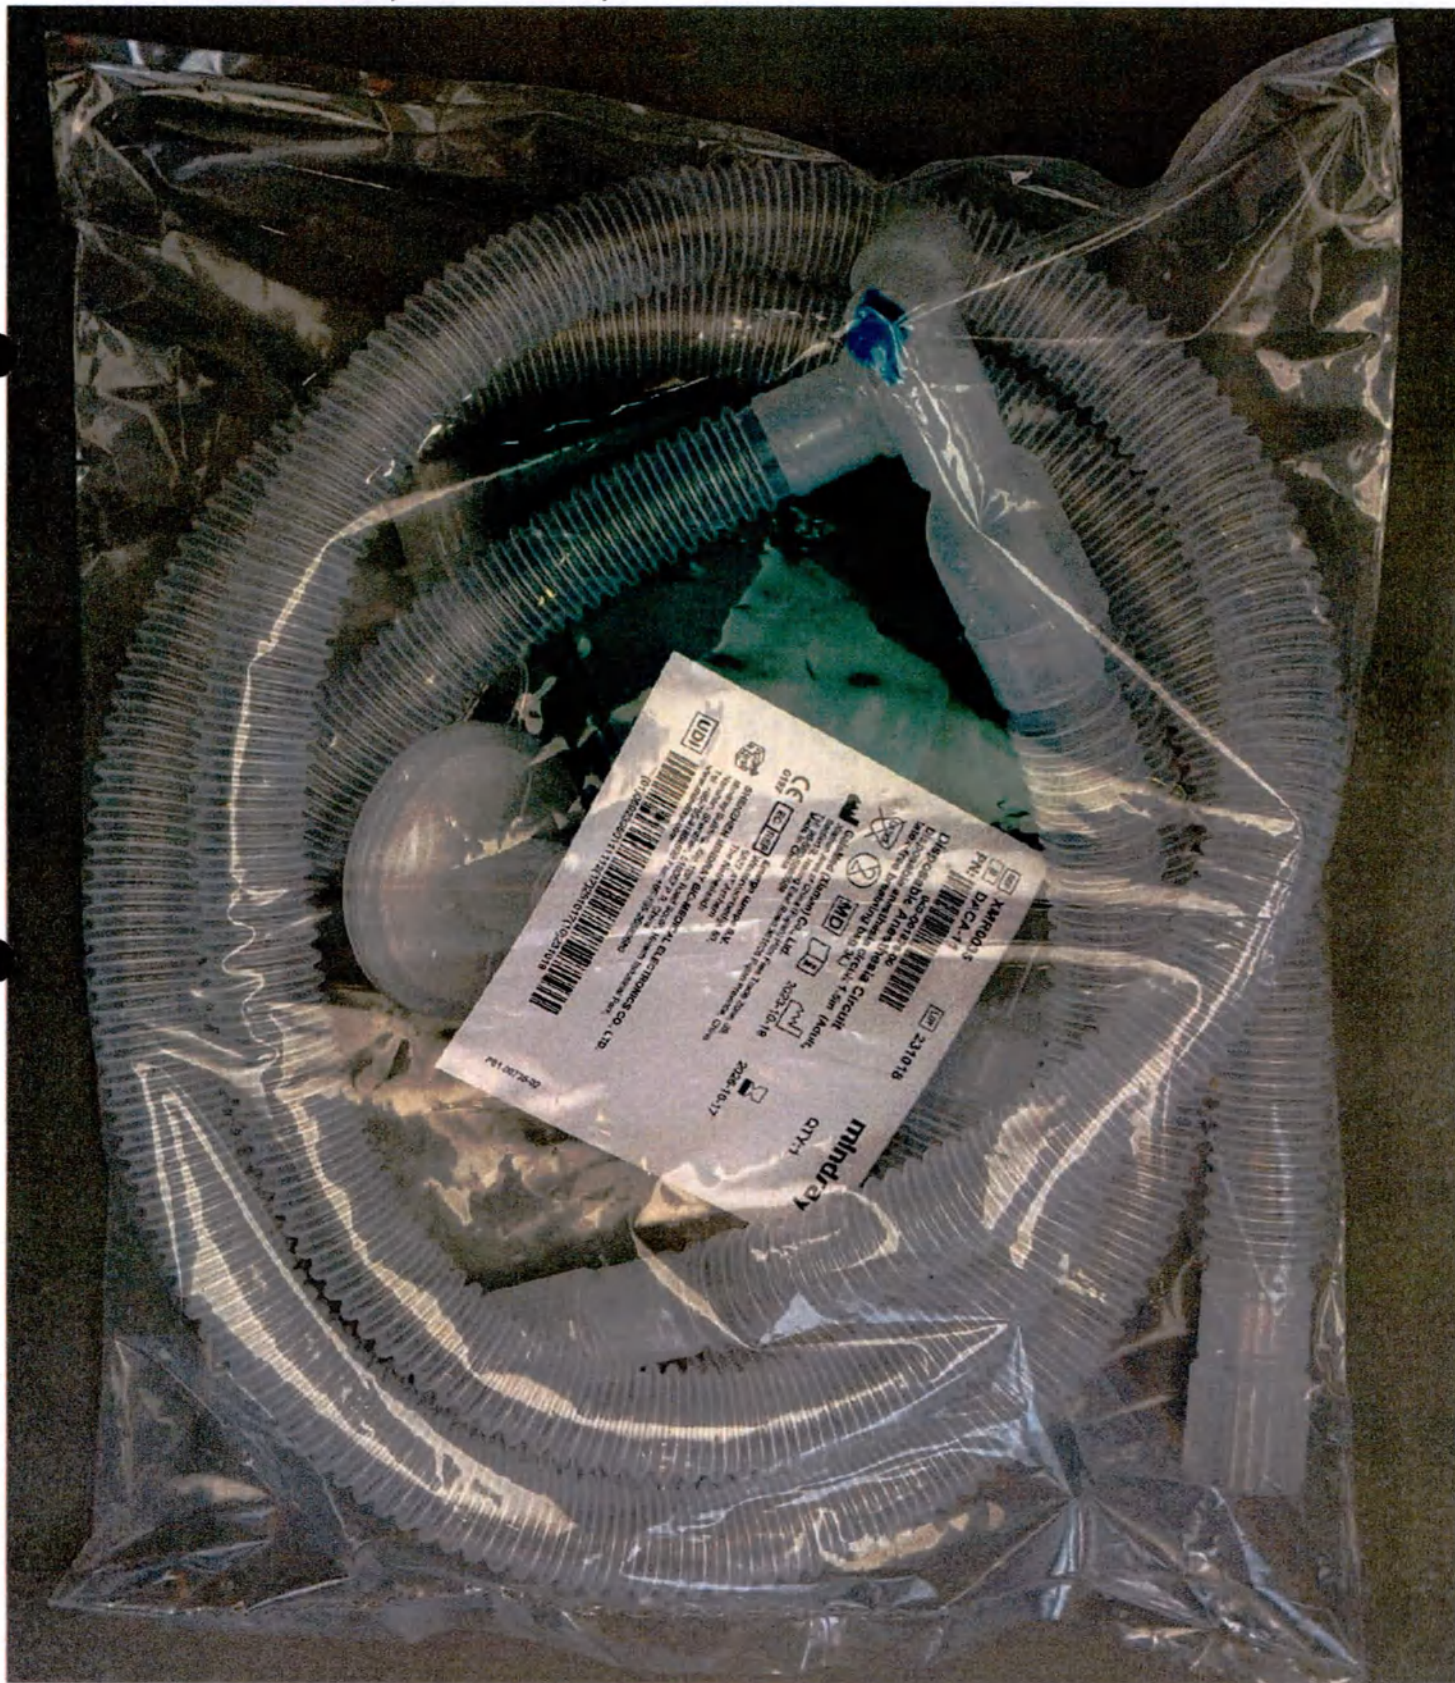

66. Контур дыхательный, одноразовый для детей - не более 50 шт. (при необходимости), в наборе:

- Контур дыхательный, детский, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.;
- Коннектор L-образный - 1 шт.;
- Коннектор прямой - 1 шт.;
- Фильтр бактериальный - 1 шт.;
- Трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
- Мешок дыхательный, безлатексный, 1 л - 1 шт.

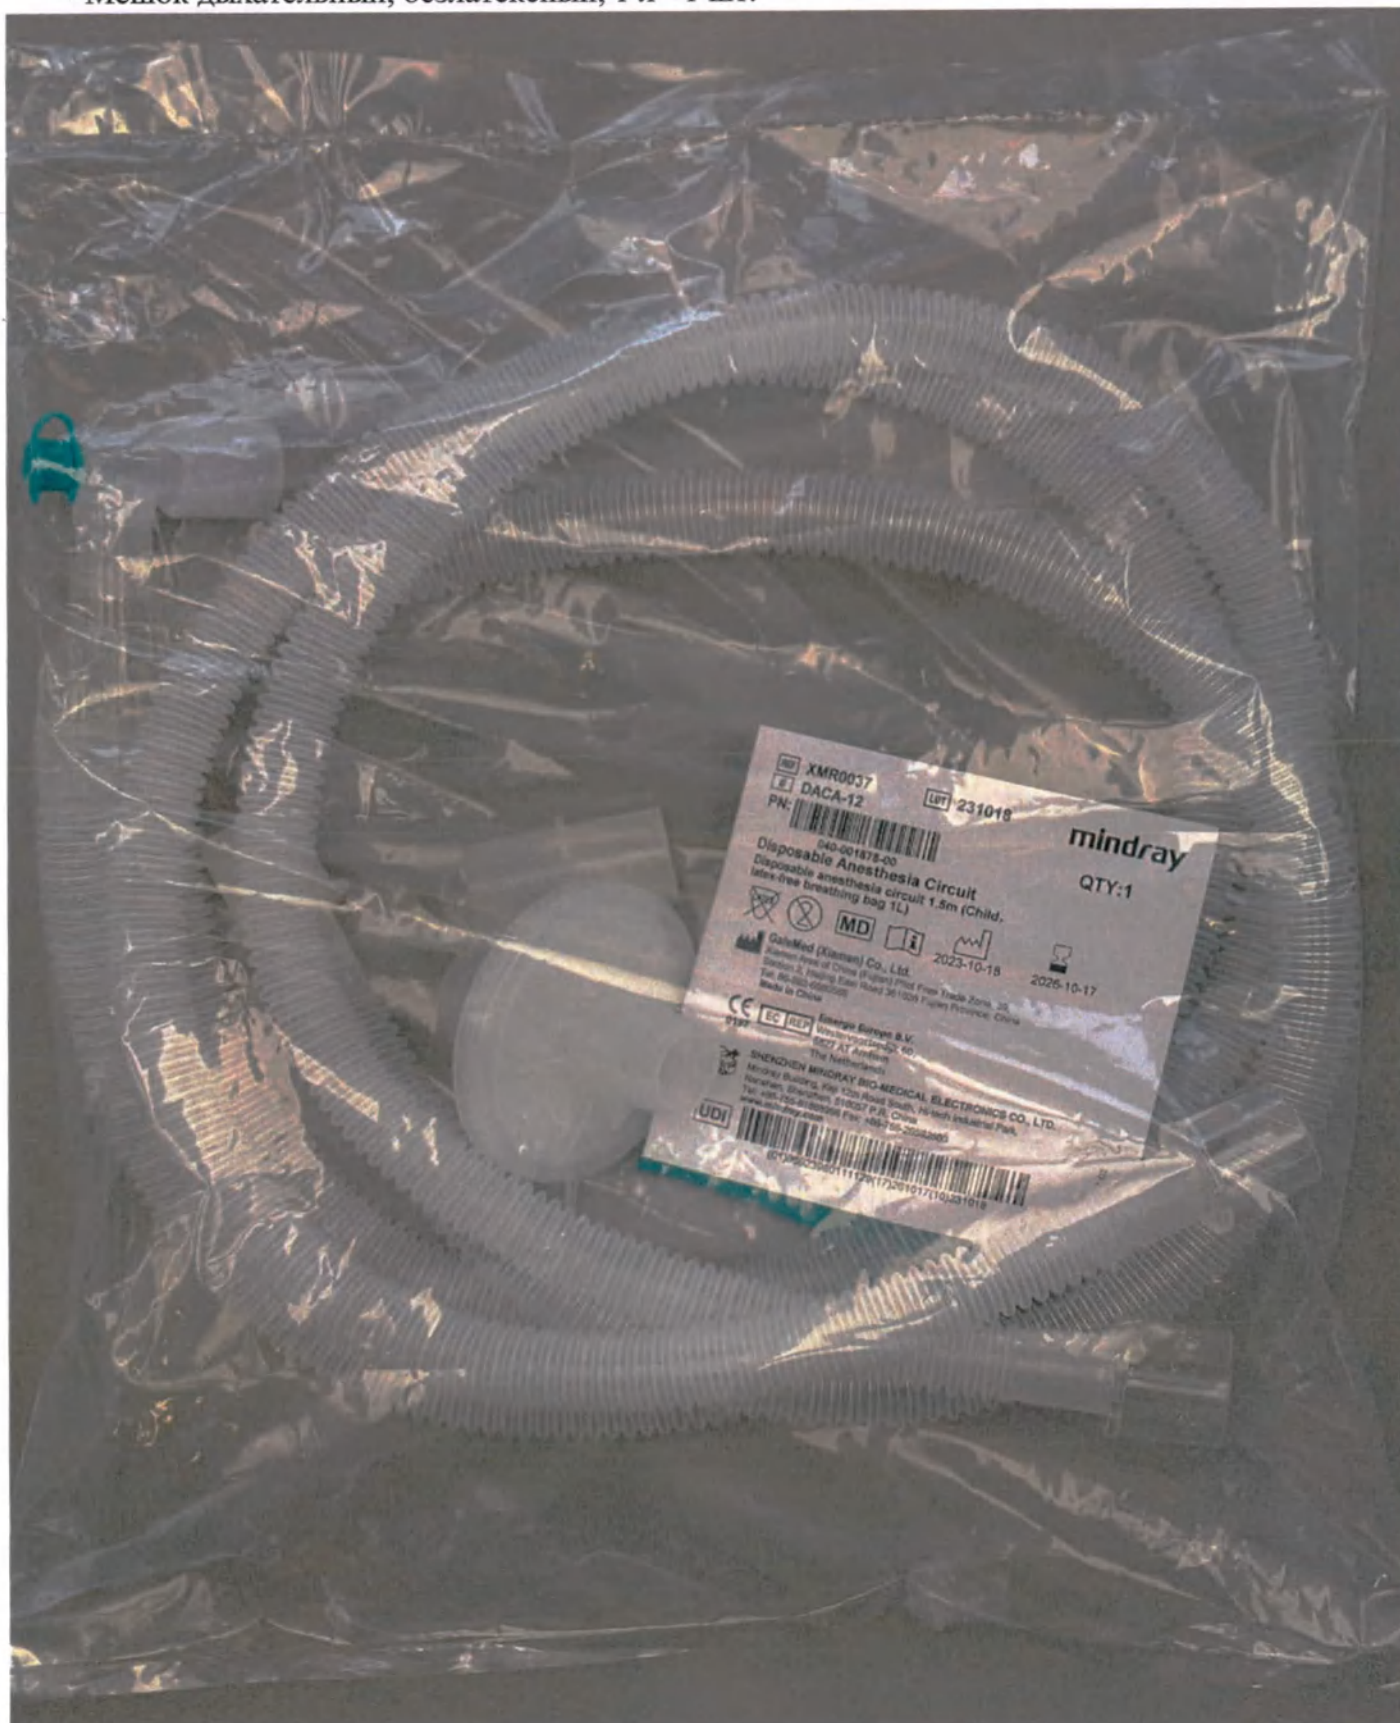


67. Комплект дыхательных принадлежностей одноразовый для взрослых - не более 50 шт. (при необходимости), в составе:

67.1. Контур дыхательный, одноразовый для взрослых - 1 шт., в наборе:

- контур дыхательный, взрослый, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.;
- коннектор прямой - 1 шт.;
- фильтр бактериальный - 1 шт.;
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
- мешок дыхательный, безлатексный, 3 л - 1 шт.

67.2. Маска дыхательная с воздушной подушкой, одноразовая, размер 5 - 1 шт.

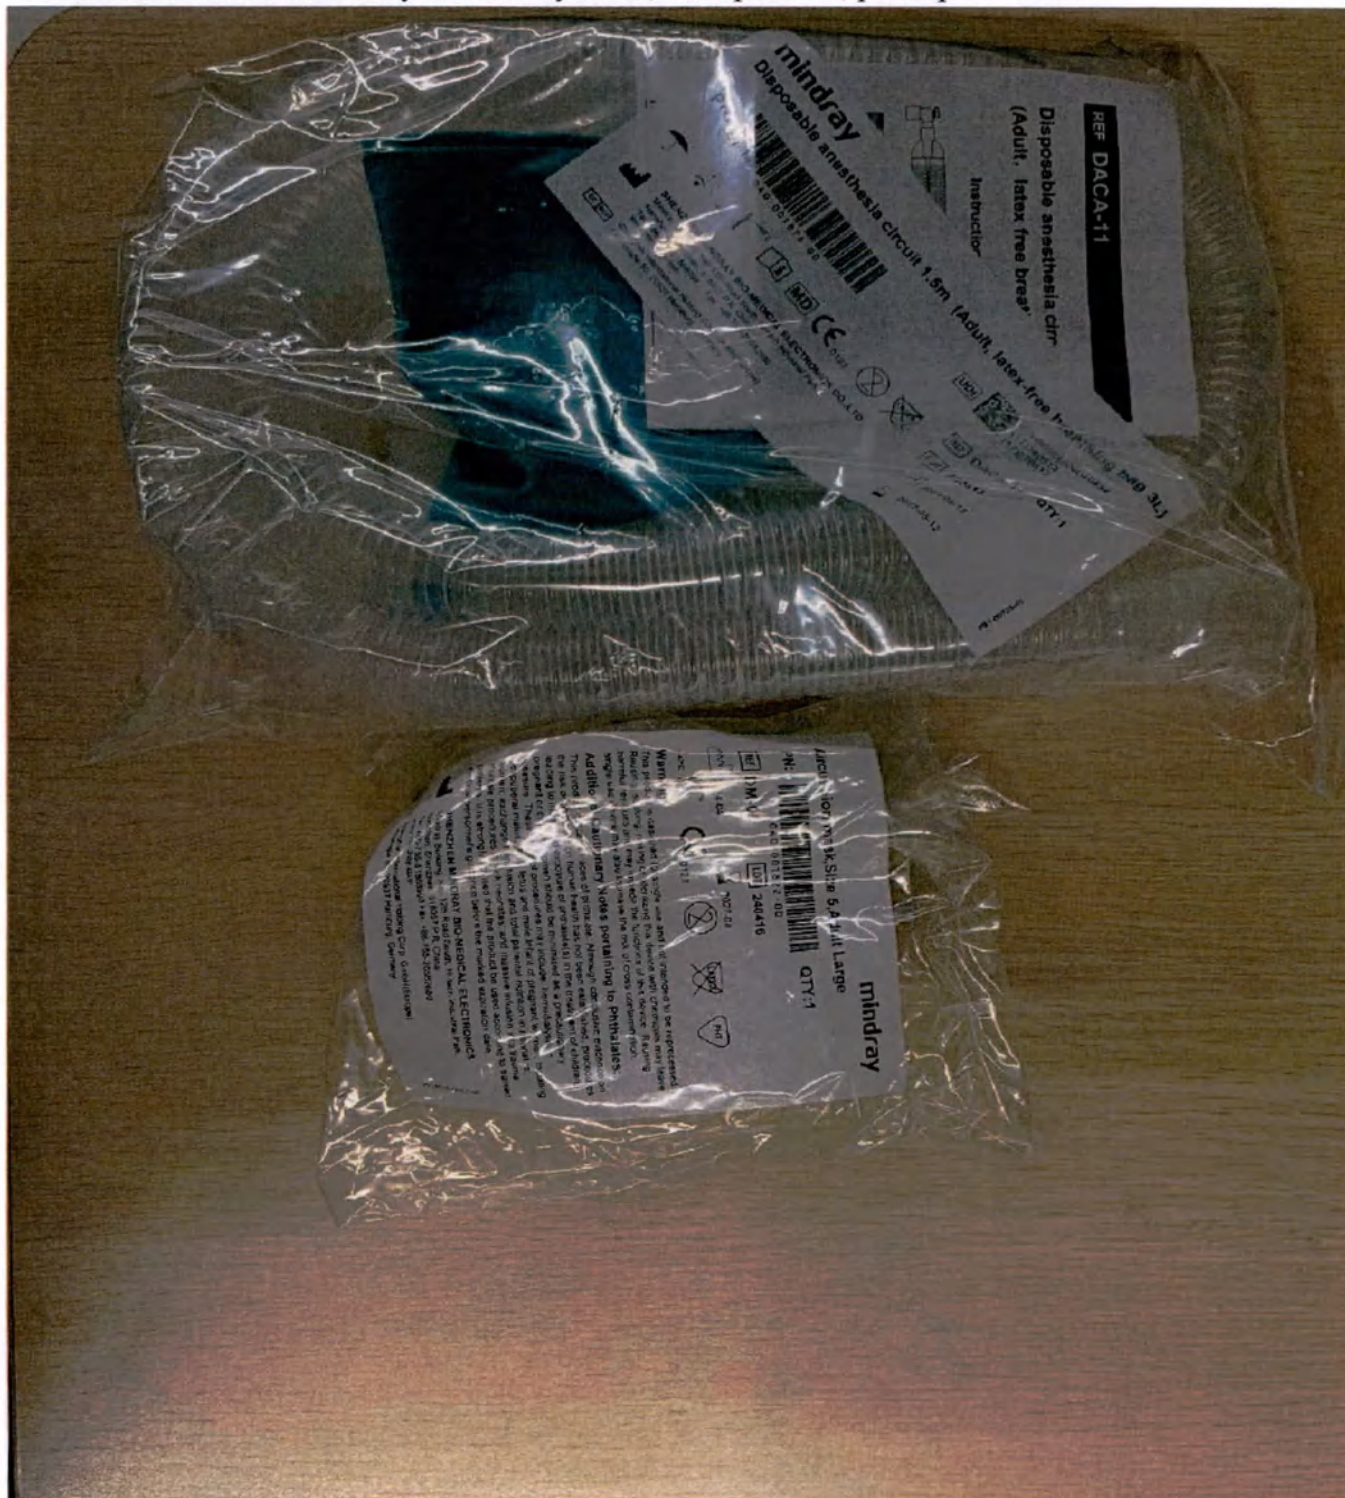

68. Комплект дыхательных принадлежностей одноразовый для детей - не более 50 шт. (при необходимости), в составе:

68.1. Контур дыхательный, одноразовый для детей - 1 шт., в наборе:

- контур дыхательный, детский, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.;
- коннектор прямой - 1 шт.;
- фильтр бактериальный - 1 шт.;
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
- мешок дыхательный, безлатексный, одноразовый, 1 л - 1 шт.

68.2. Маска дыхательная с воздушной подушкой, одноразовая, размер 2 - 1 шт.



69. Фильтр бактериальный, одноразовый – не более 100 шт. (при необходимости).

70. Трубка для высокопоточной оксигенотерапии, одноразовая – не более 100 шт. (при необходимости).




71. Комплект одноразовых трубок с обогревом для высокопоточной оксигенотерапии - не более 30 шт. (при необходимости), в составе:

- Трубка 1 метр - 1 шт.;
- Трубка 1.5 метра - 1 шт.



72. Канюля назальная взрослая Optiflow™+ малая (размер S) OPT942, производства «Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ № РЗН 2022/17712 – не более 50 шт. (при необходимости).

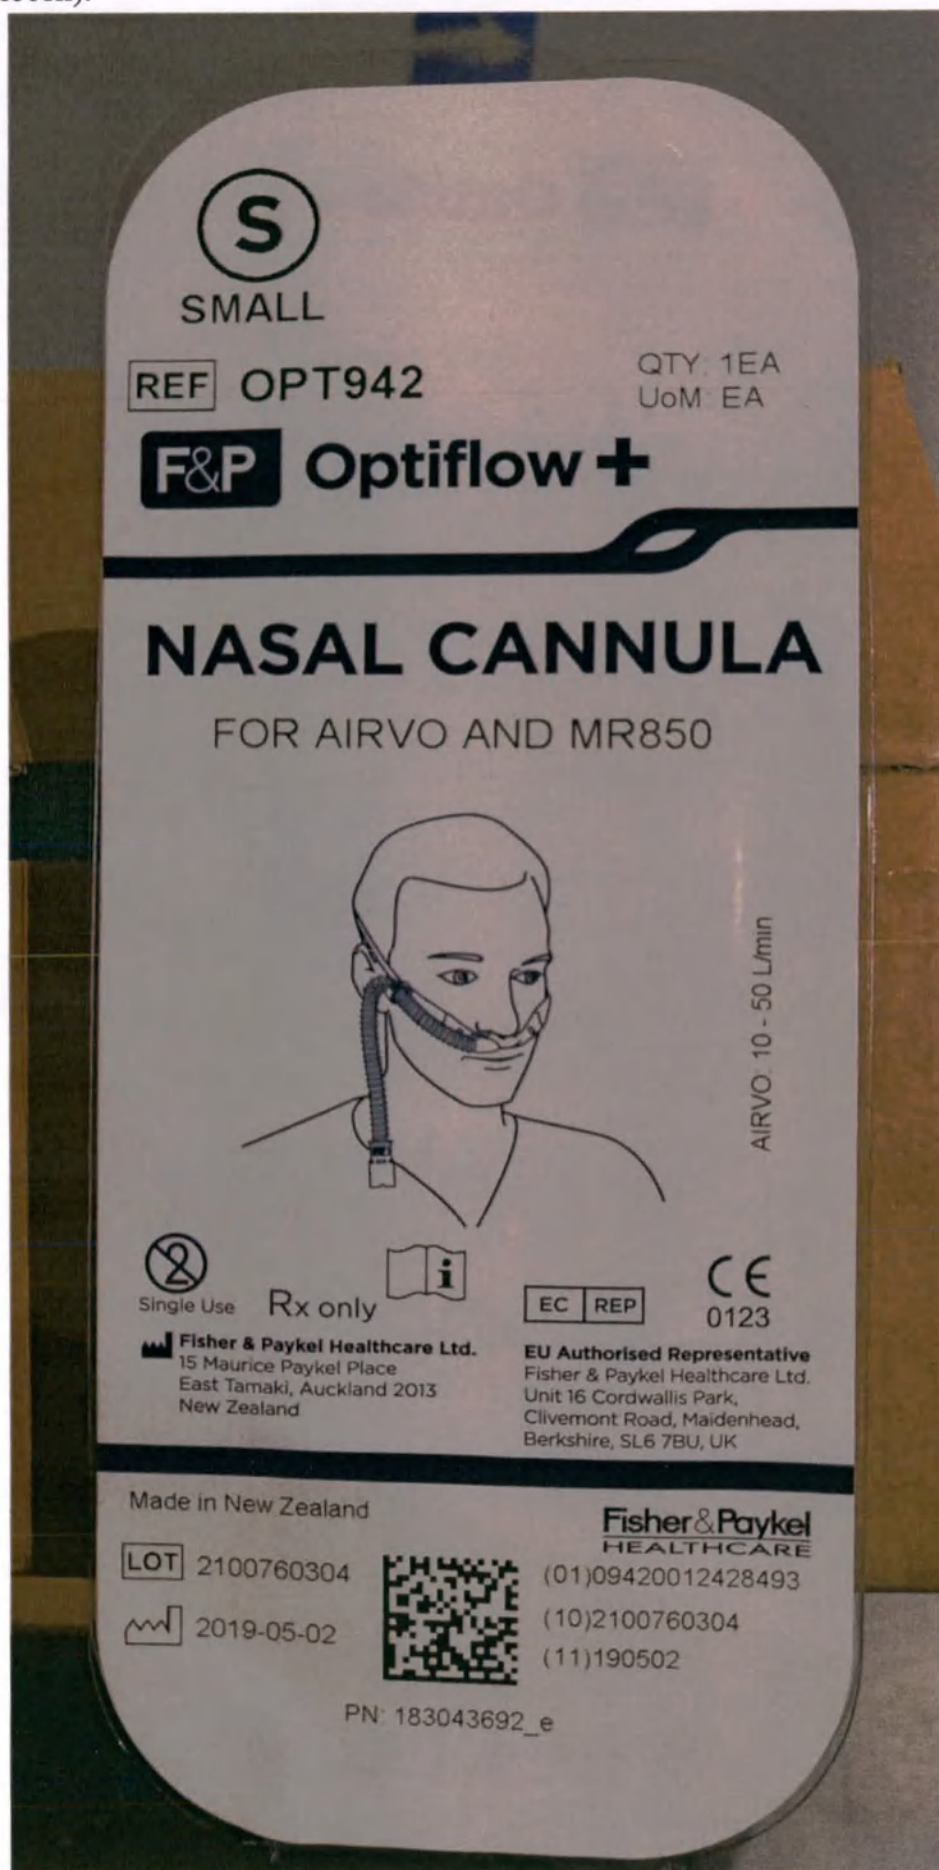


73. Канюля назальная взрослая Optiflow™+ средняя (размер M) OPT944, производства «Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ № РЗН 2022/17712 – не более 50 шт. (при необходимости).



74. Канюля назальная взрослая Optiflow™+ большая (размер L) OPT946, производства «Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ № РЗН 2022/17712 – не более 50 шт. (при необходимости).



75. Увлажнитель дыхательных смесей MR810 с принадлежностями, производства Fisher & Paykel Healthcare Ltd., Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 – не более 2 шт. (при необходимости)

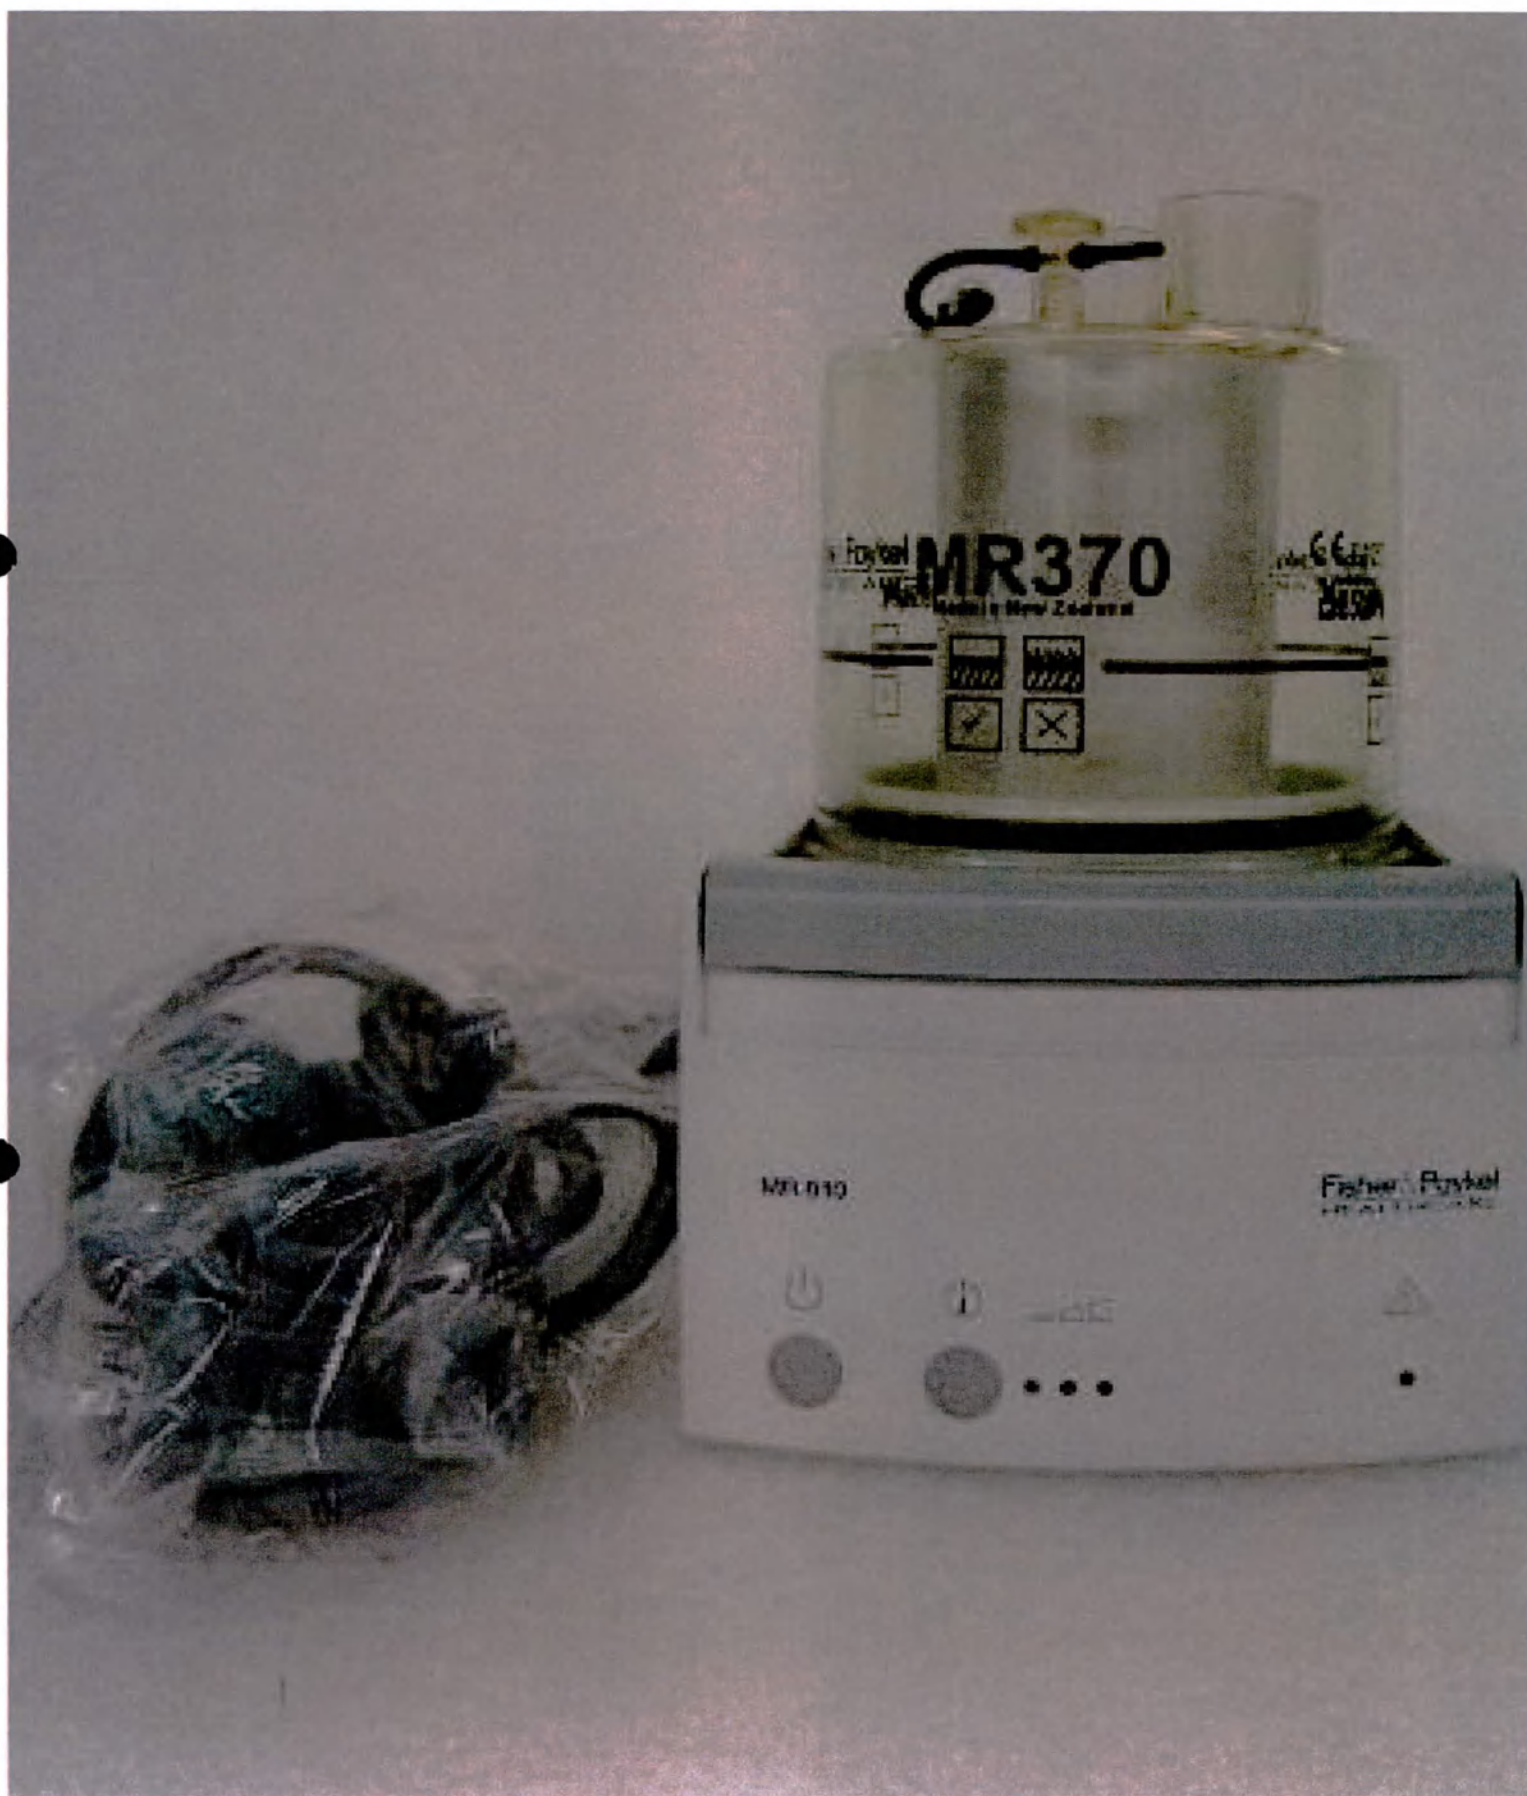


76. Камера увлажнителя MR370, производства Fisher & Paykel Healthcare Ltd., Новая Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 – не более 2 шт. (при необходимости)



77. Увлажнитель ЛКЕ SH330 - не более 2 шт. (при необходимости), в составе:


77.1. Основной блок увлажнителя ЛКЕ SH330 – 1 шт., в составе:

- Основной блок ЛКЕ SH330 – 1 шт.
- Адаптер угловой - 1 шт.
- Адаптер прямой – 1 шт.
- Внешний термометр – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

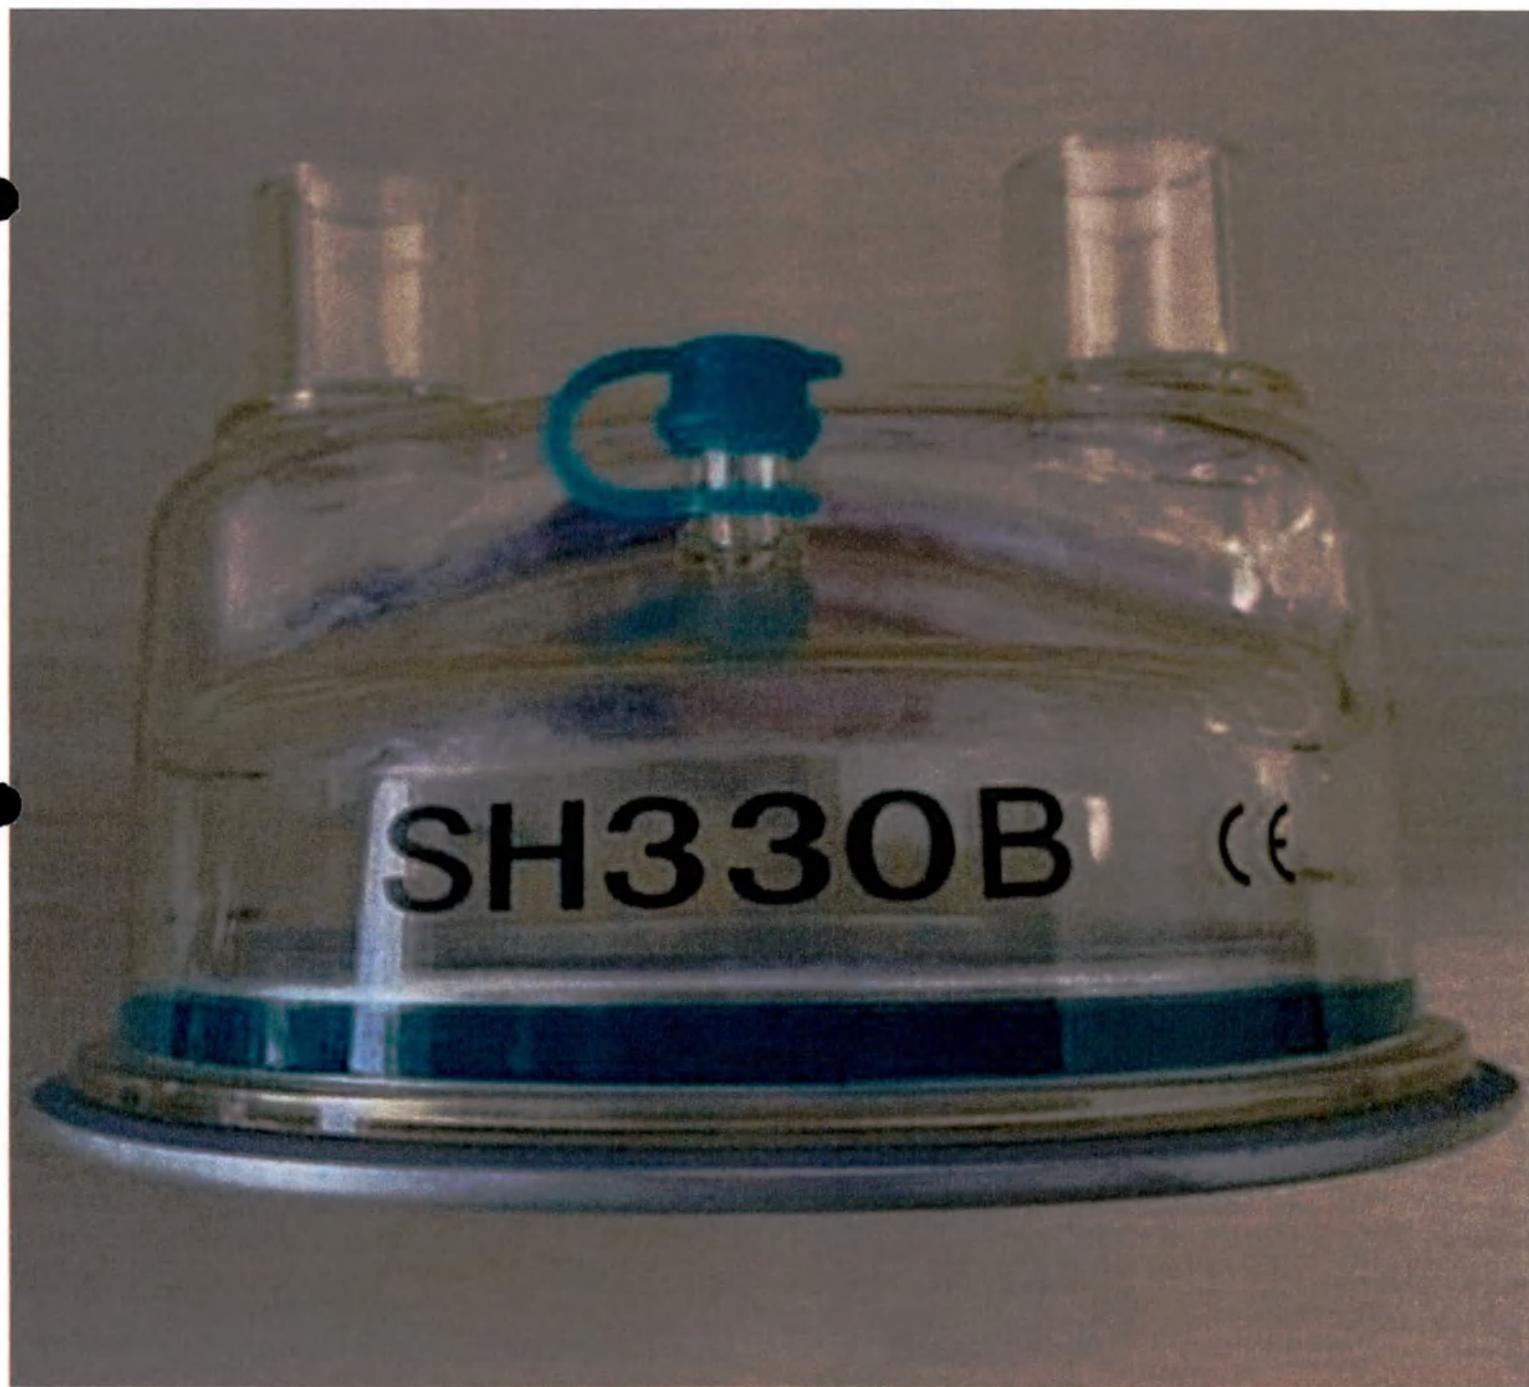

77.2. Камера увлажняющая – 1 шт. (при необходимости), в составе:

- Основной блок увлажняющей камеры – 1 шт.
- Заглушка – 2 шт.

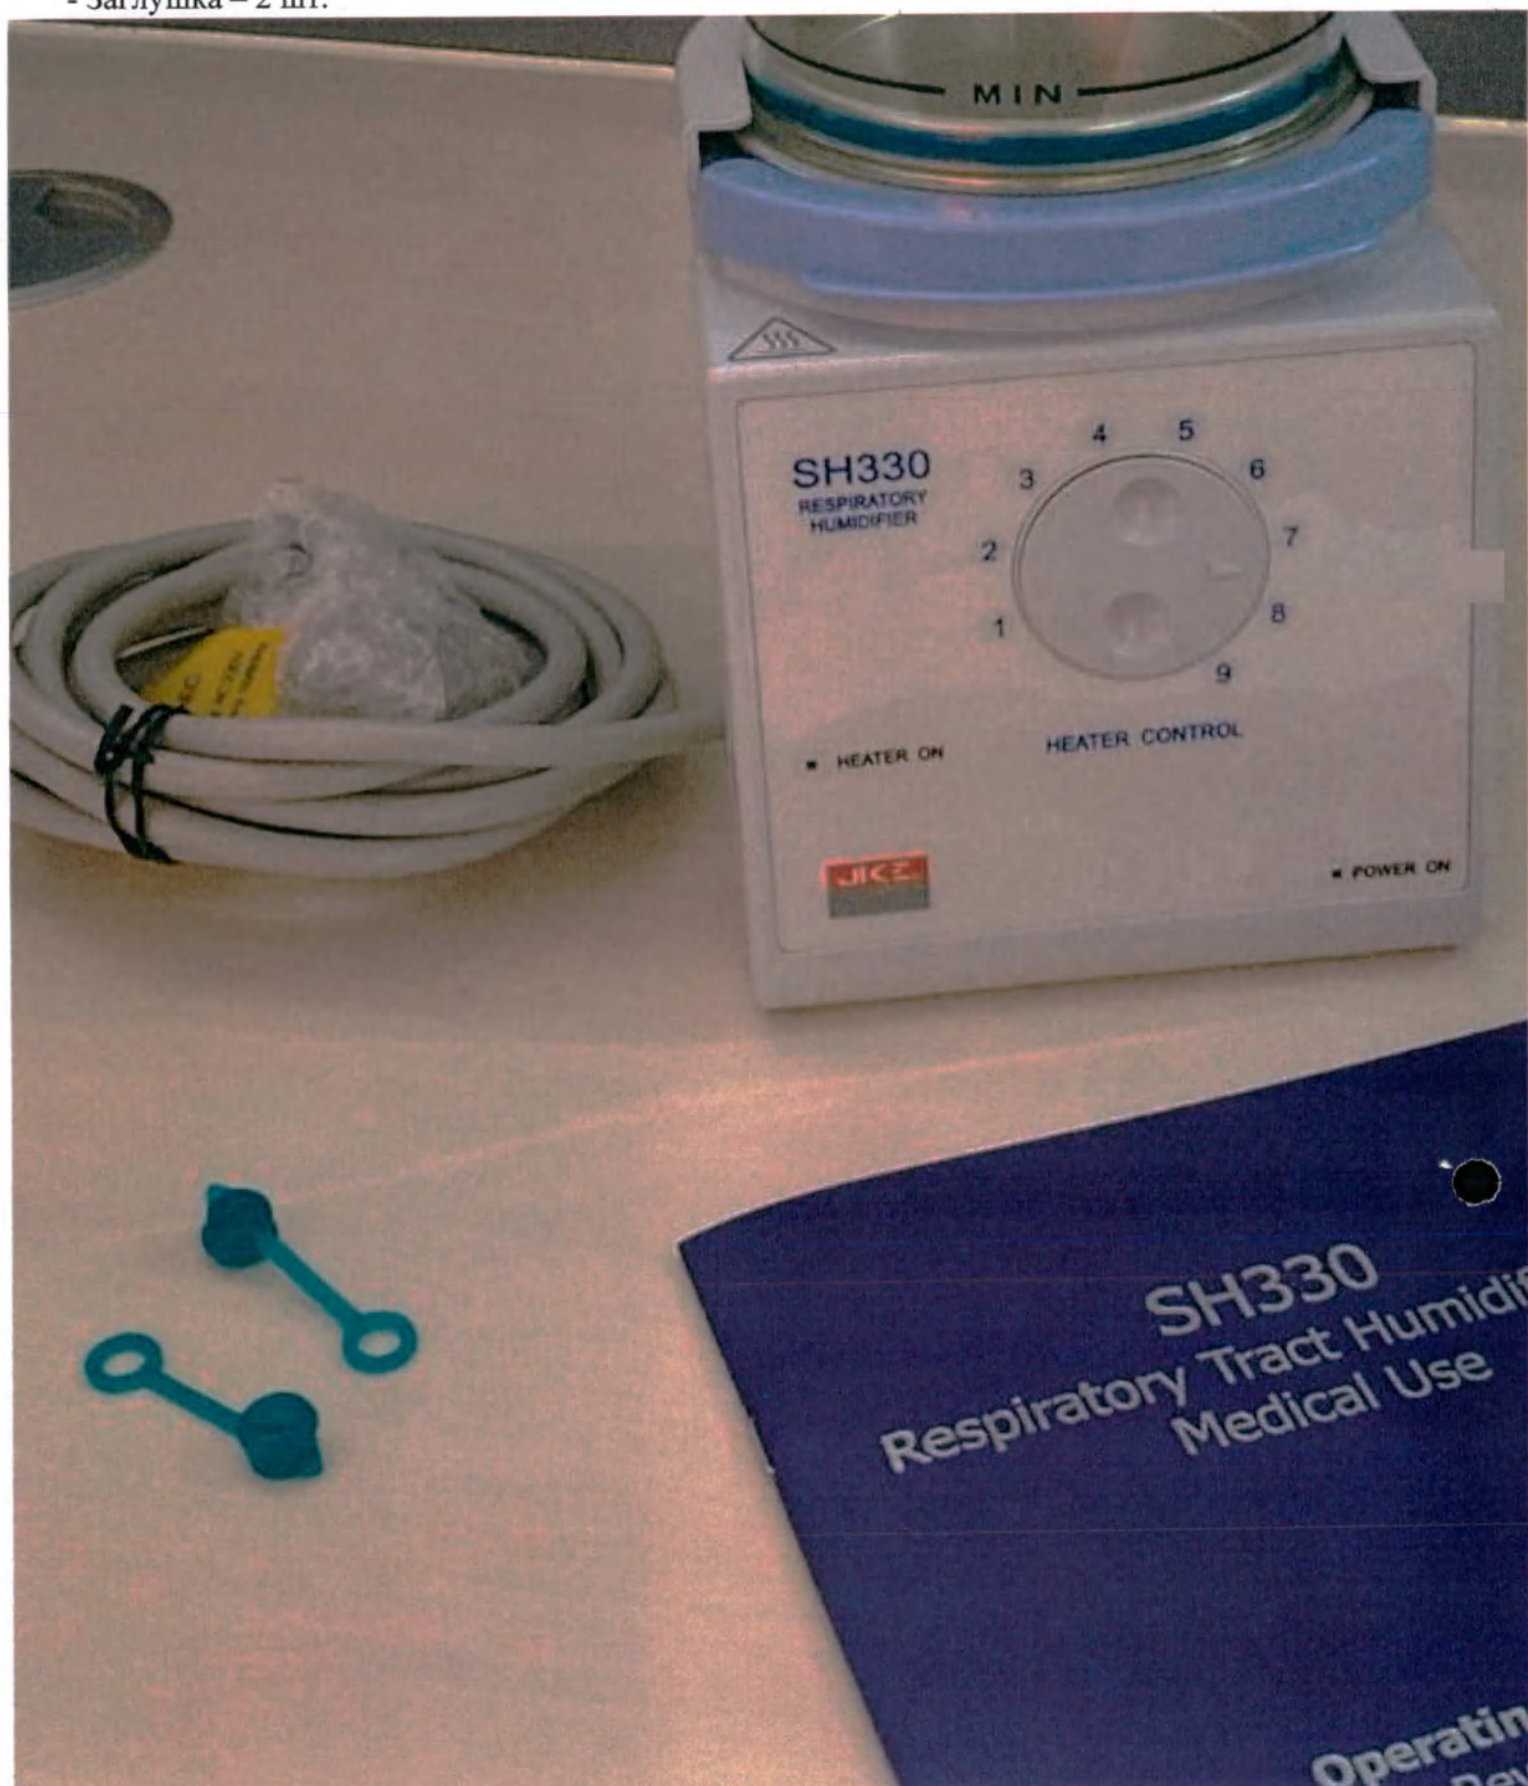

78. Датчик потока инспираторный – не более 20 шт. (при необходимости).



79. Датчик потока экспираторный, автоклавируемый – не более 20 шт. (при необходимости).



80. Набор датчиков потока - не более 20 шт. (при необходимости), в составе:

- Датчик потока экспираторный - 1 шт.
- Датчик потока инспираторный - 1 шт.



81. Датчик потока инспираторный, автоклавируемый – не более 20 шт. (при необходимости).




82. Датчик потока экспираторный, автоклавируемый – не более 20 шт. (при необходимости).



83. Набор датчиков потока автоклавируемых - не более 20 шт. (при необходимости), в составе:

- Датчик потока экспираторный - 1 шт.;
- Датчик потока инспираторный - 1 шт.

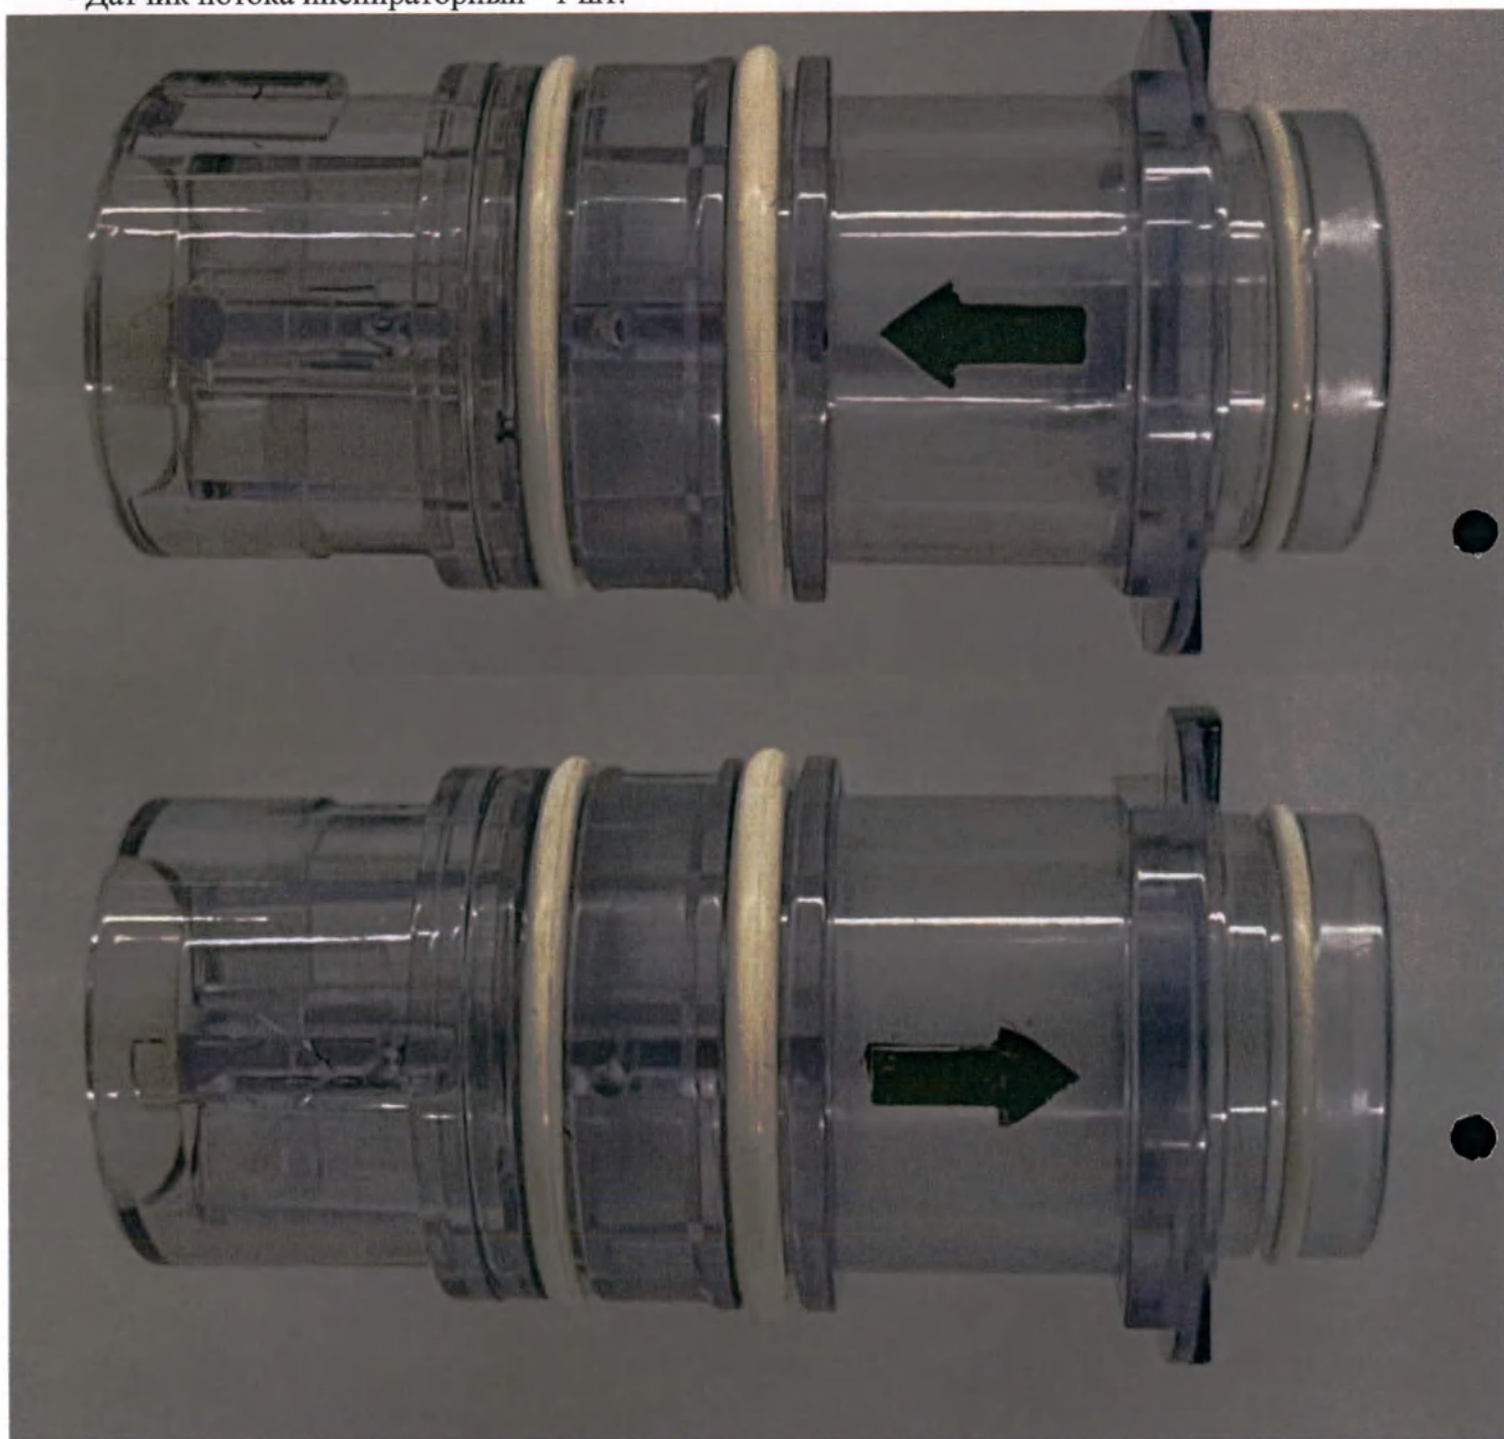

84. Кабель датчика кислорода – не более 10 шт. (при необходимости).



85. Датчик кислорода МОХ-2 – не более 10 шт. (при необходимости).




86. Корпус для датчика кислорода с кабелем – не более 10 шт. (при необходимости).




Принадлежности.


1. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат мониторов серий PM7000, PM8000 с фиксированной высотой – не более 2 шт.

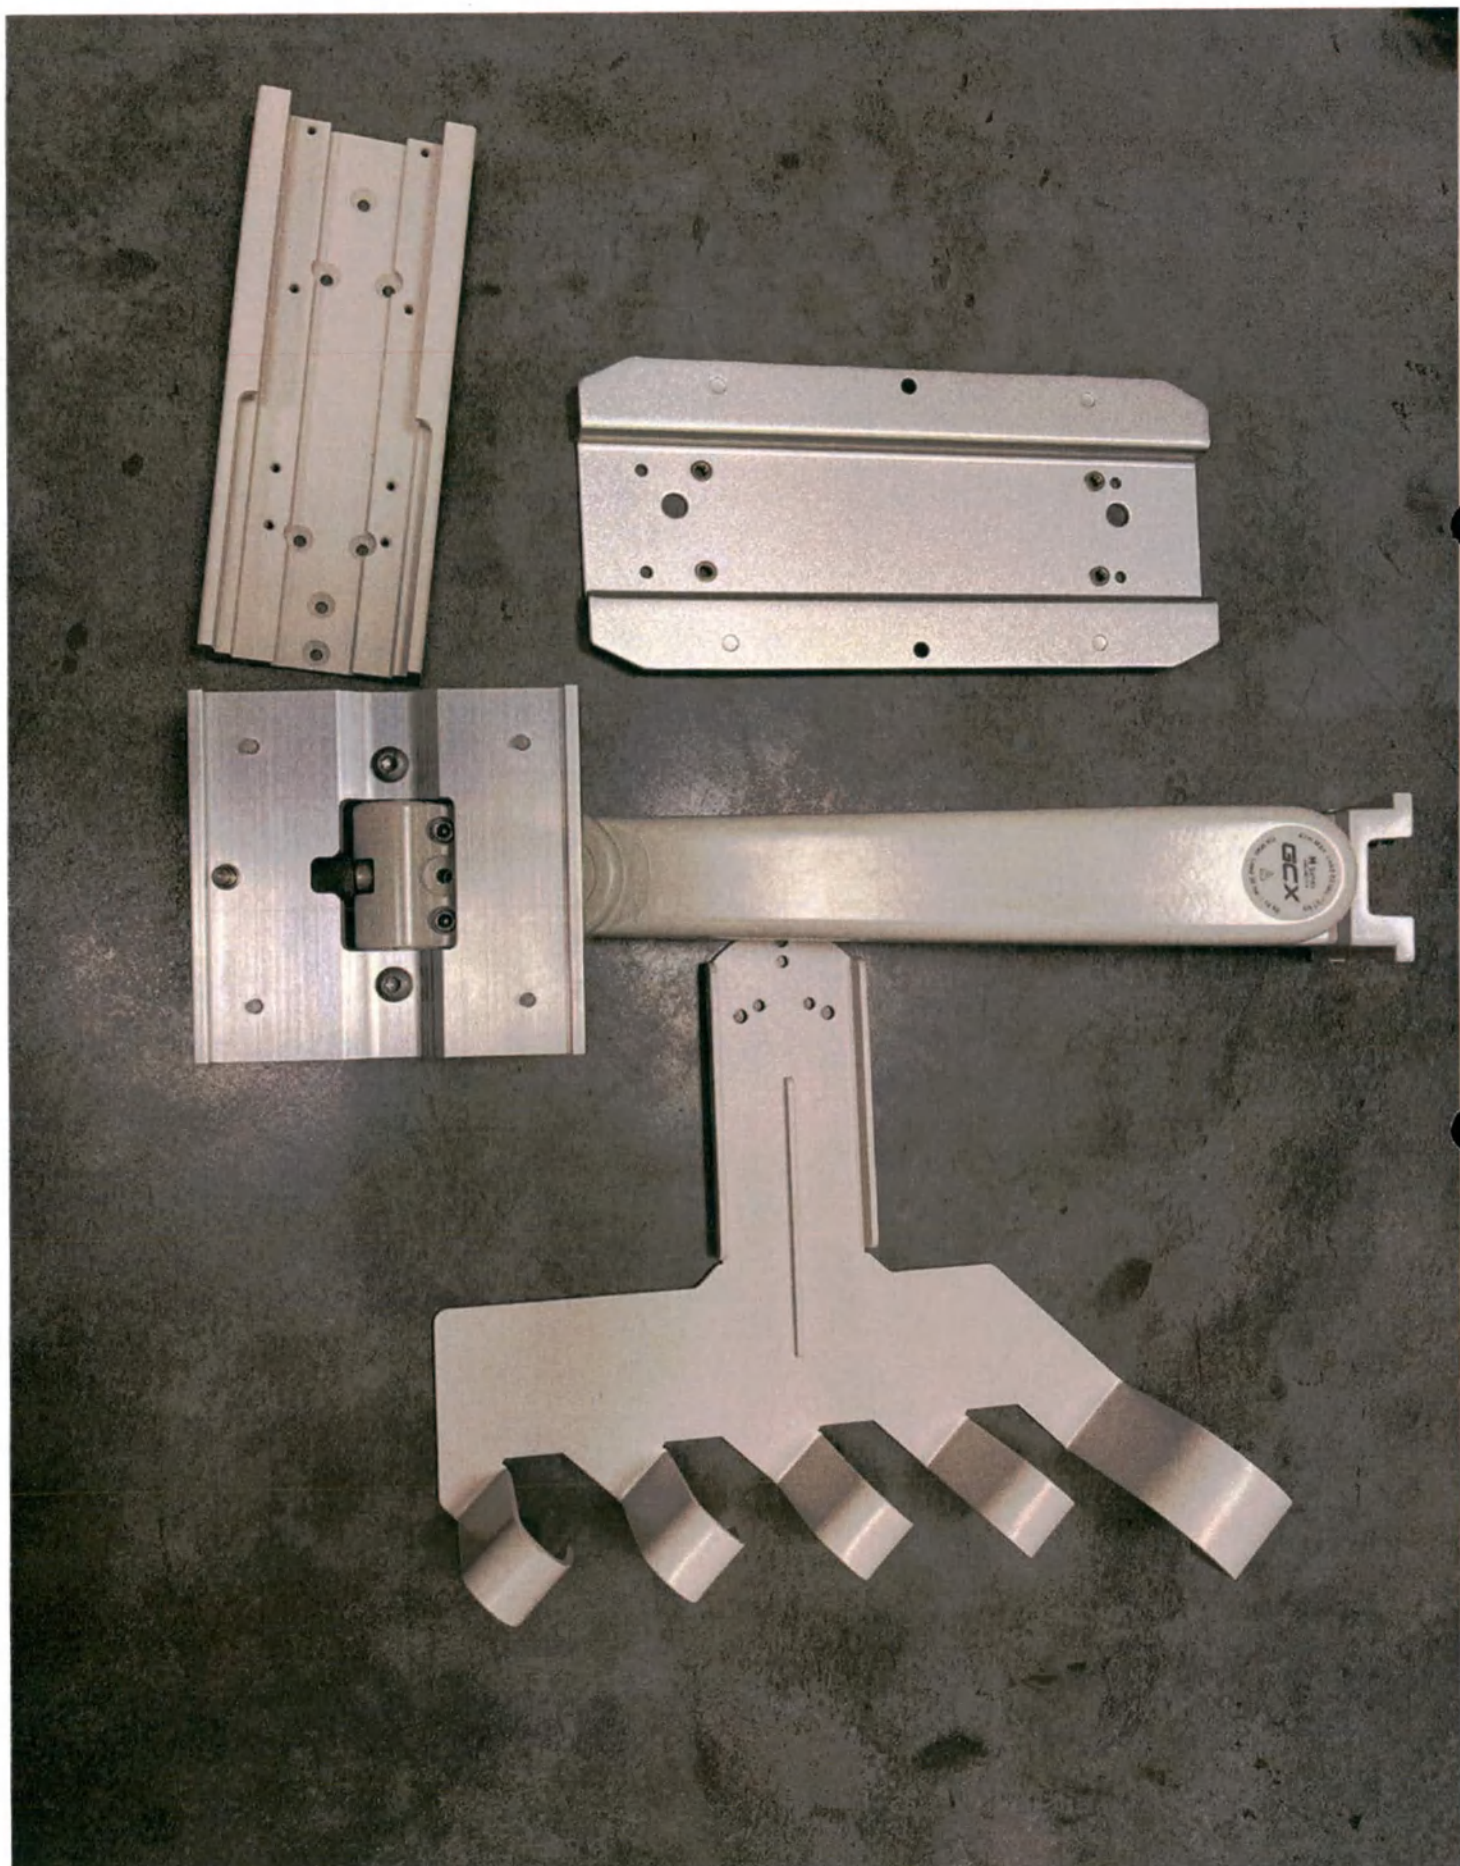


2. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview T5, PM 9000 с фиксированной высотой – не более 2 шт.

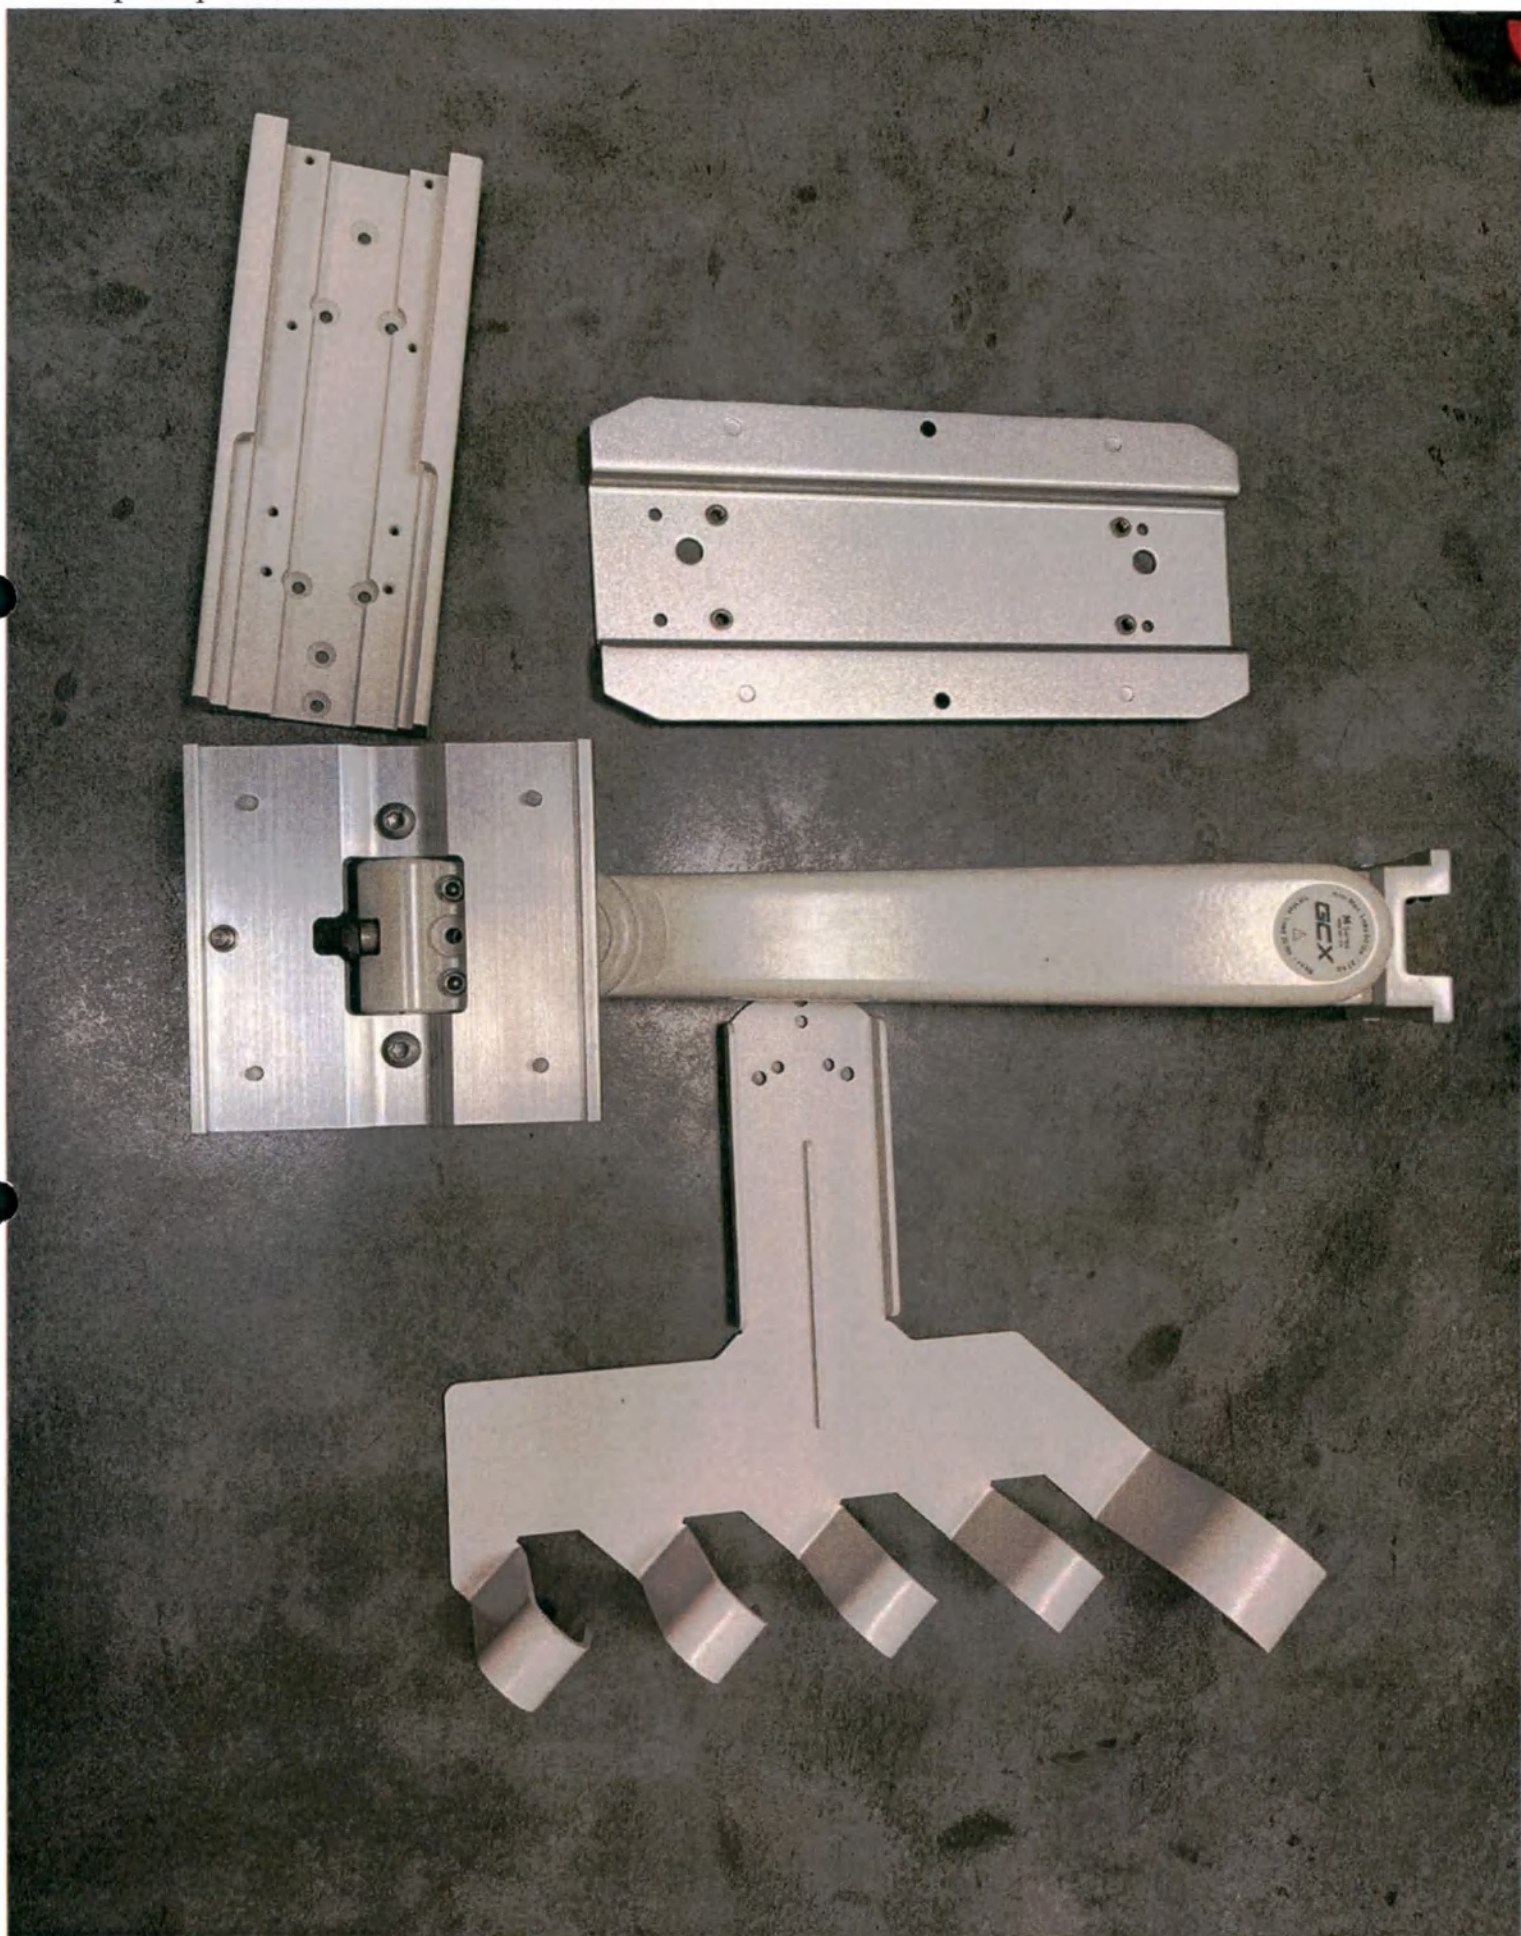


3. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview T5 с фиксированной высотой и разъемом для модулей – не более 2 шт.

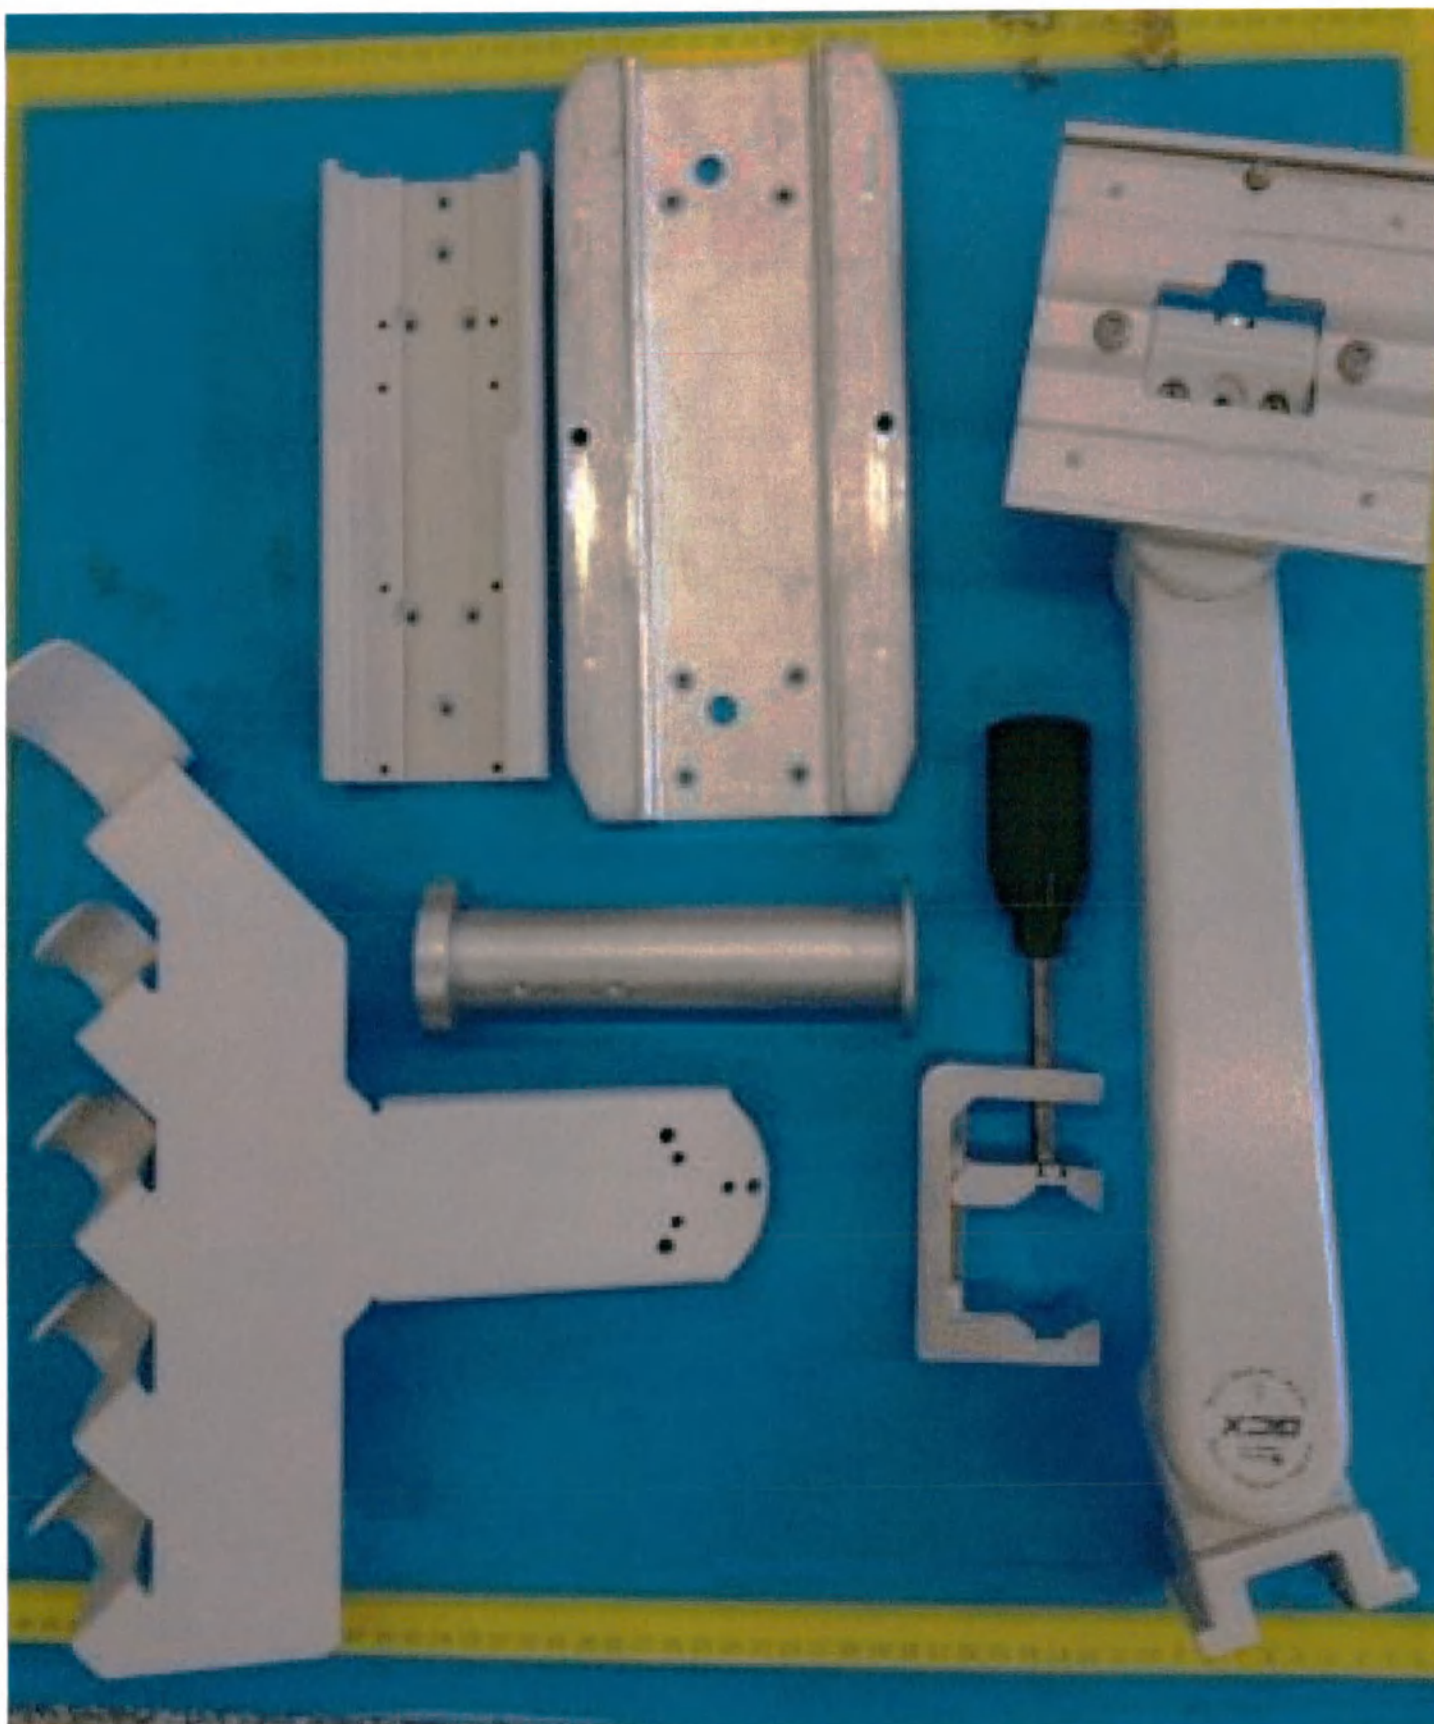

4. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview T8 с фиксированной высотой – не более 2 шт.

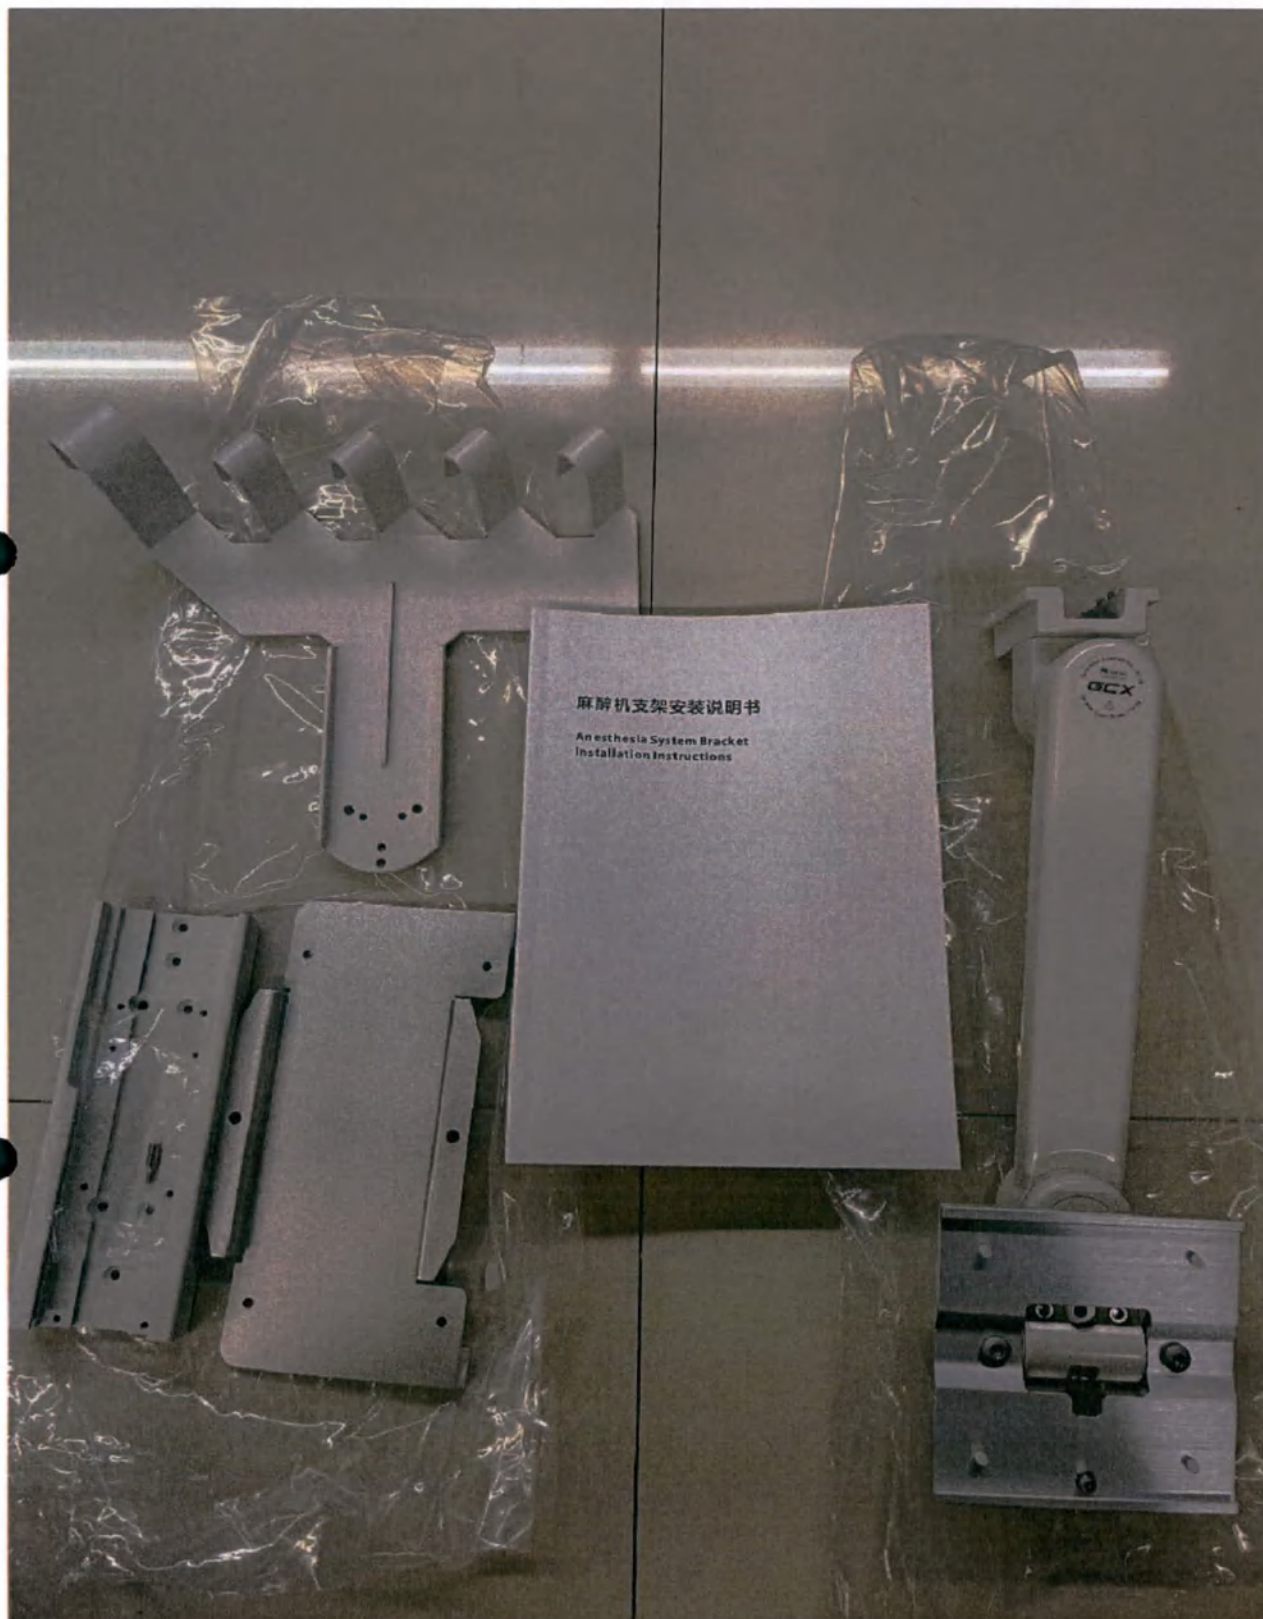


5. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview T8 с фиксированной высотой и разъемом для модулей – не более 2 шт.

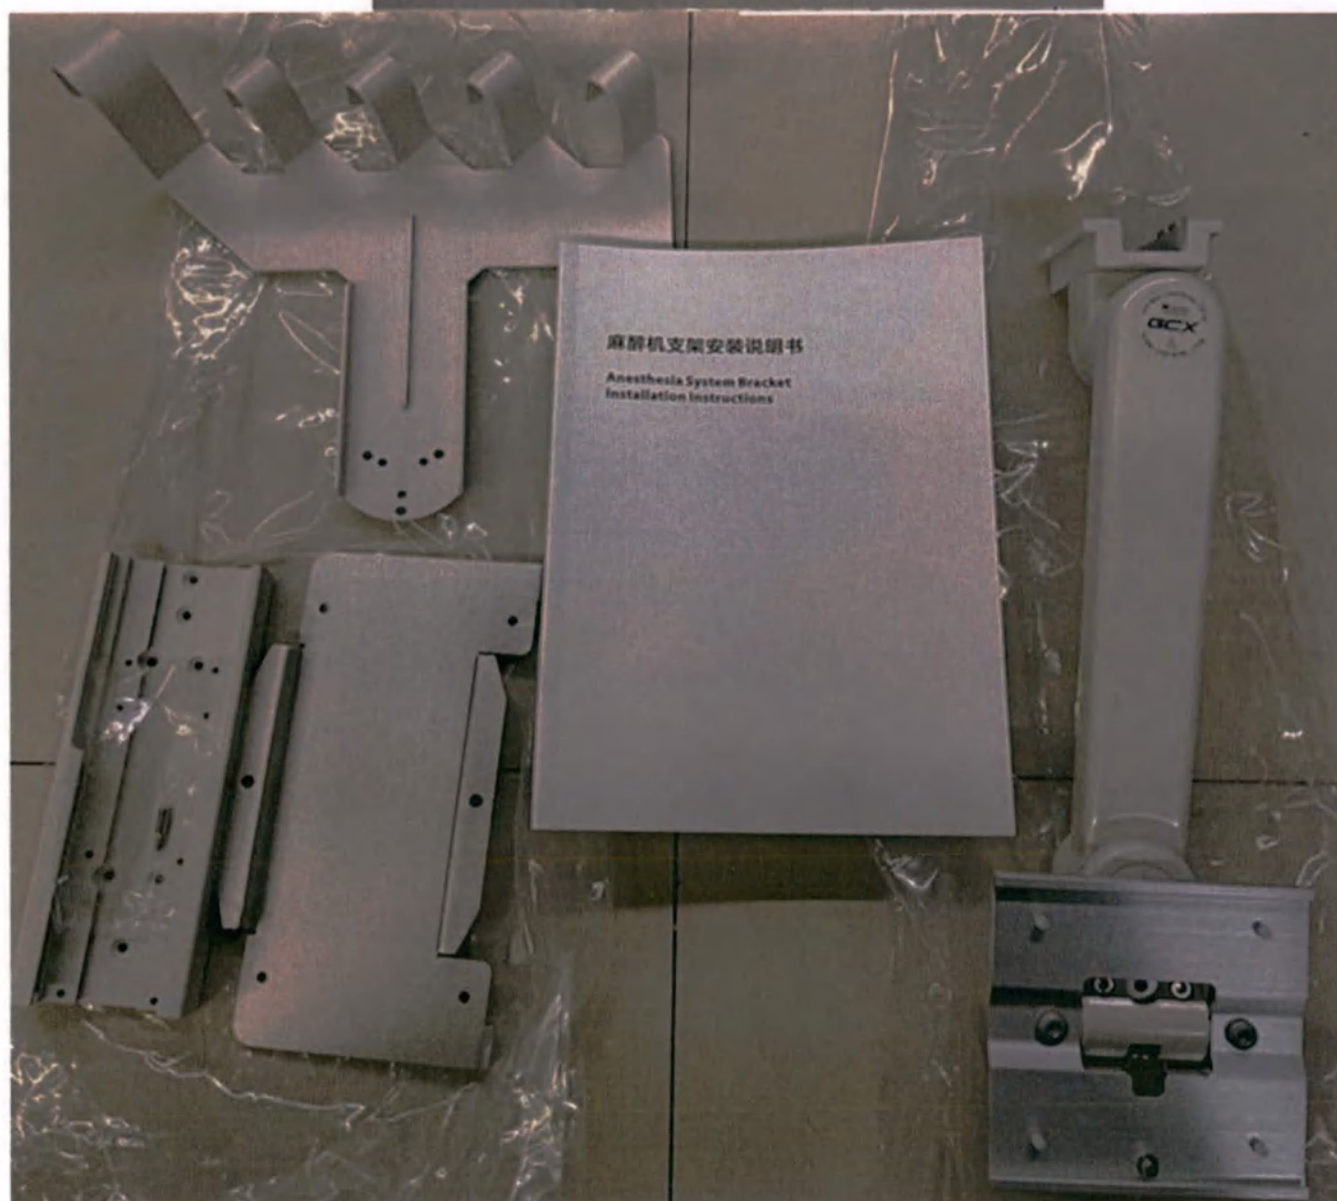


6. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат мониторов iMEC, iPM с фиксированной высотой— не более 2 шт.




7. Полка для установки монитора Т8 - не более 2 шт.

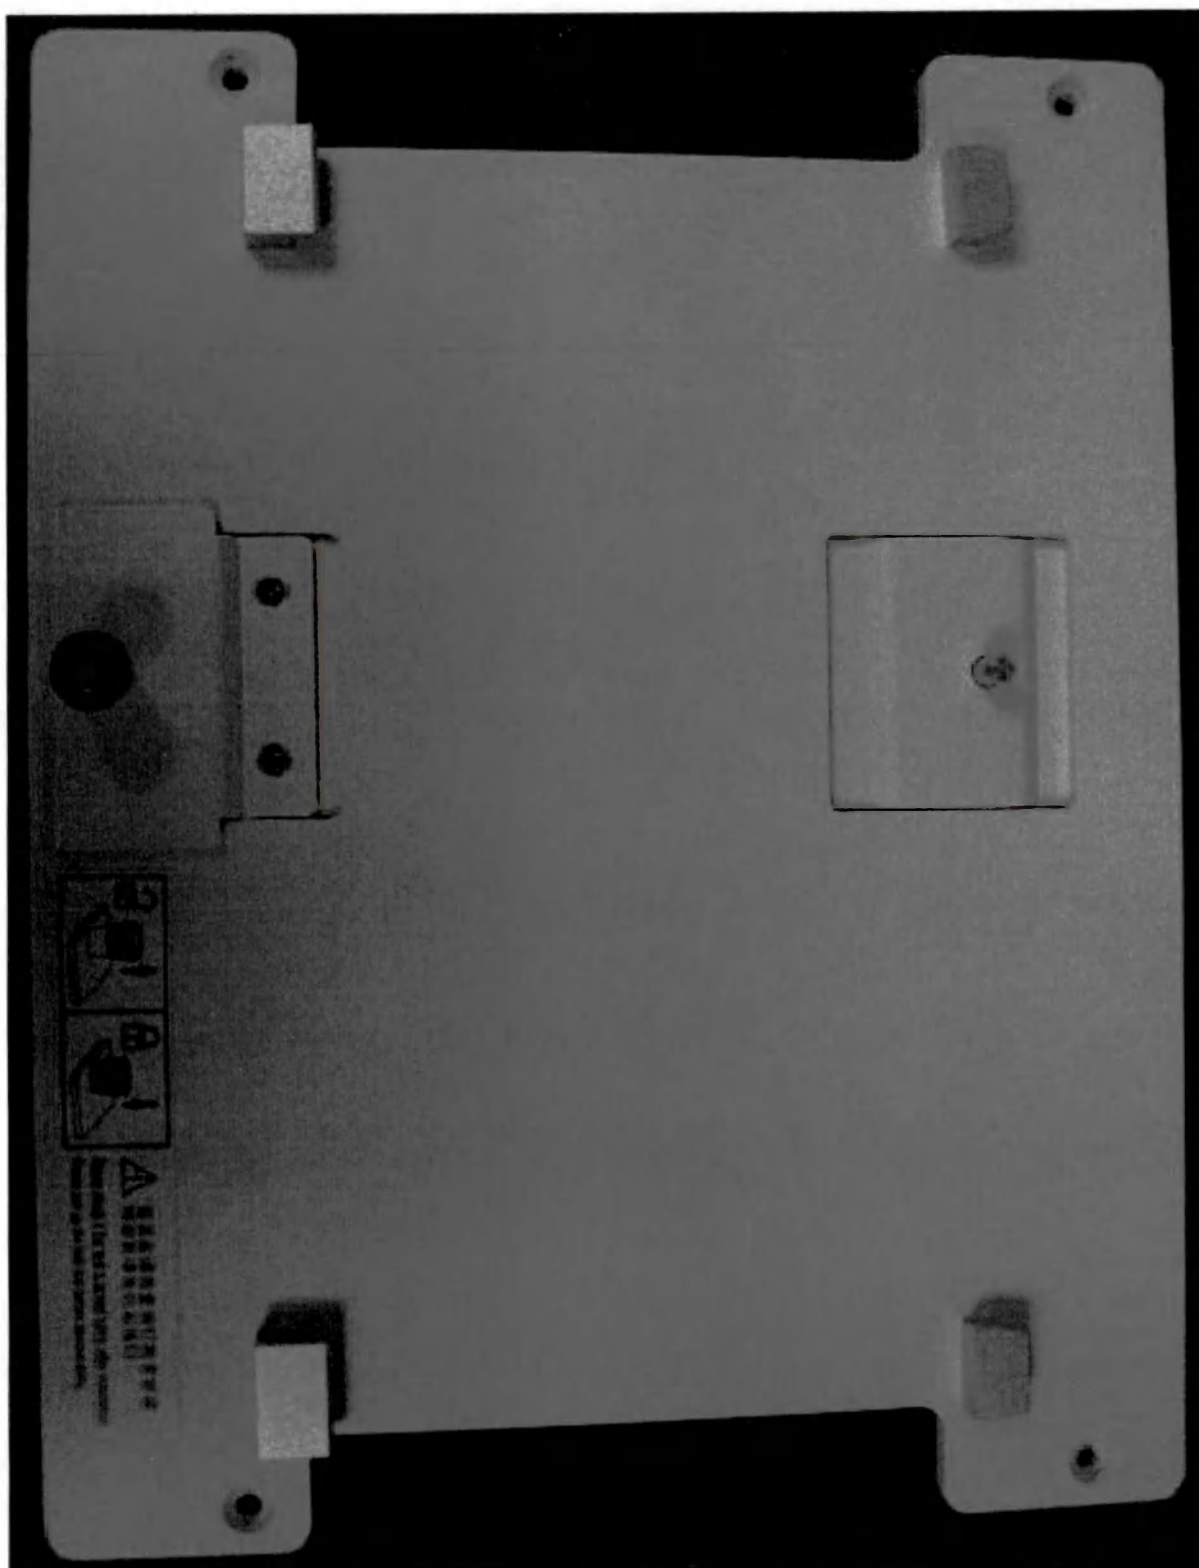


8. Полка для установки монитора Т5 - не более 2 шт.

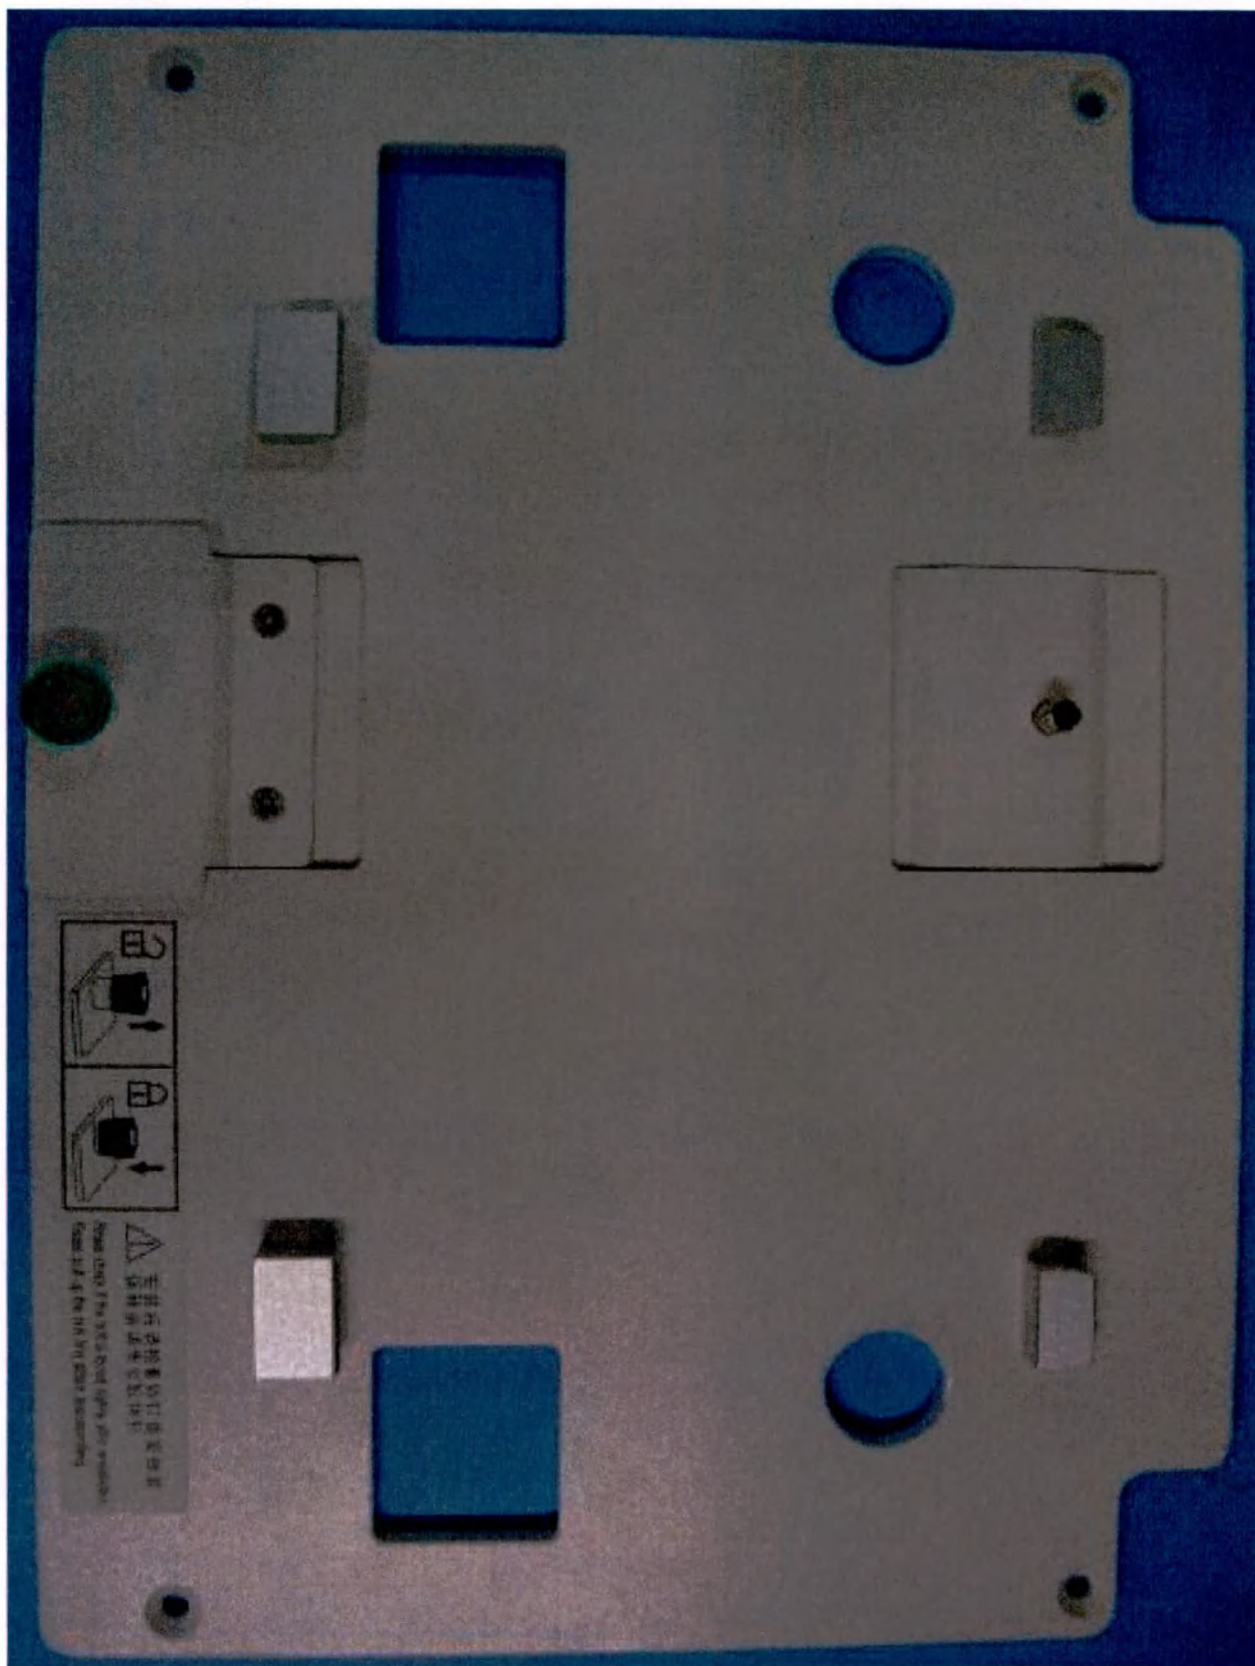

9. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора
N12/M12/N15/M15/N17/M17/ePM15 с фиксированной высотой– не более 2 шт.

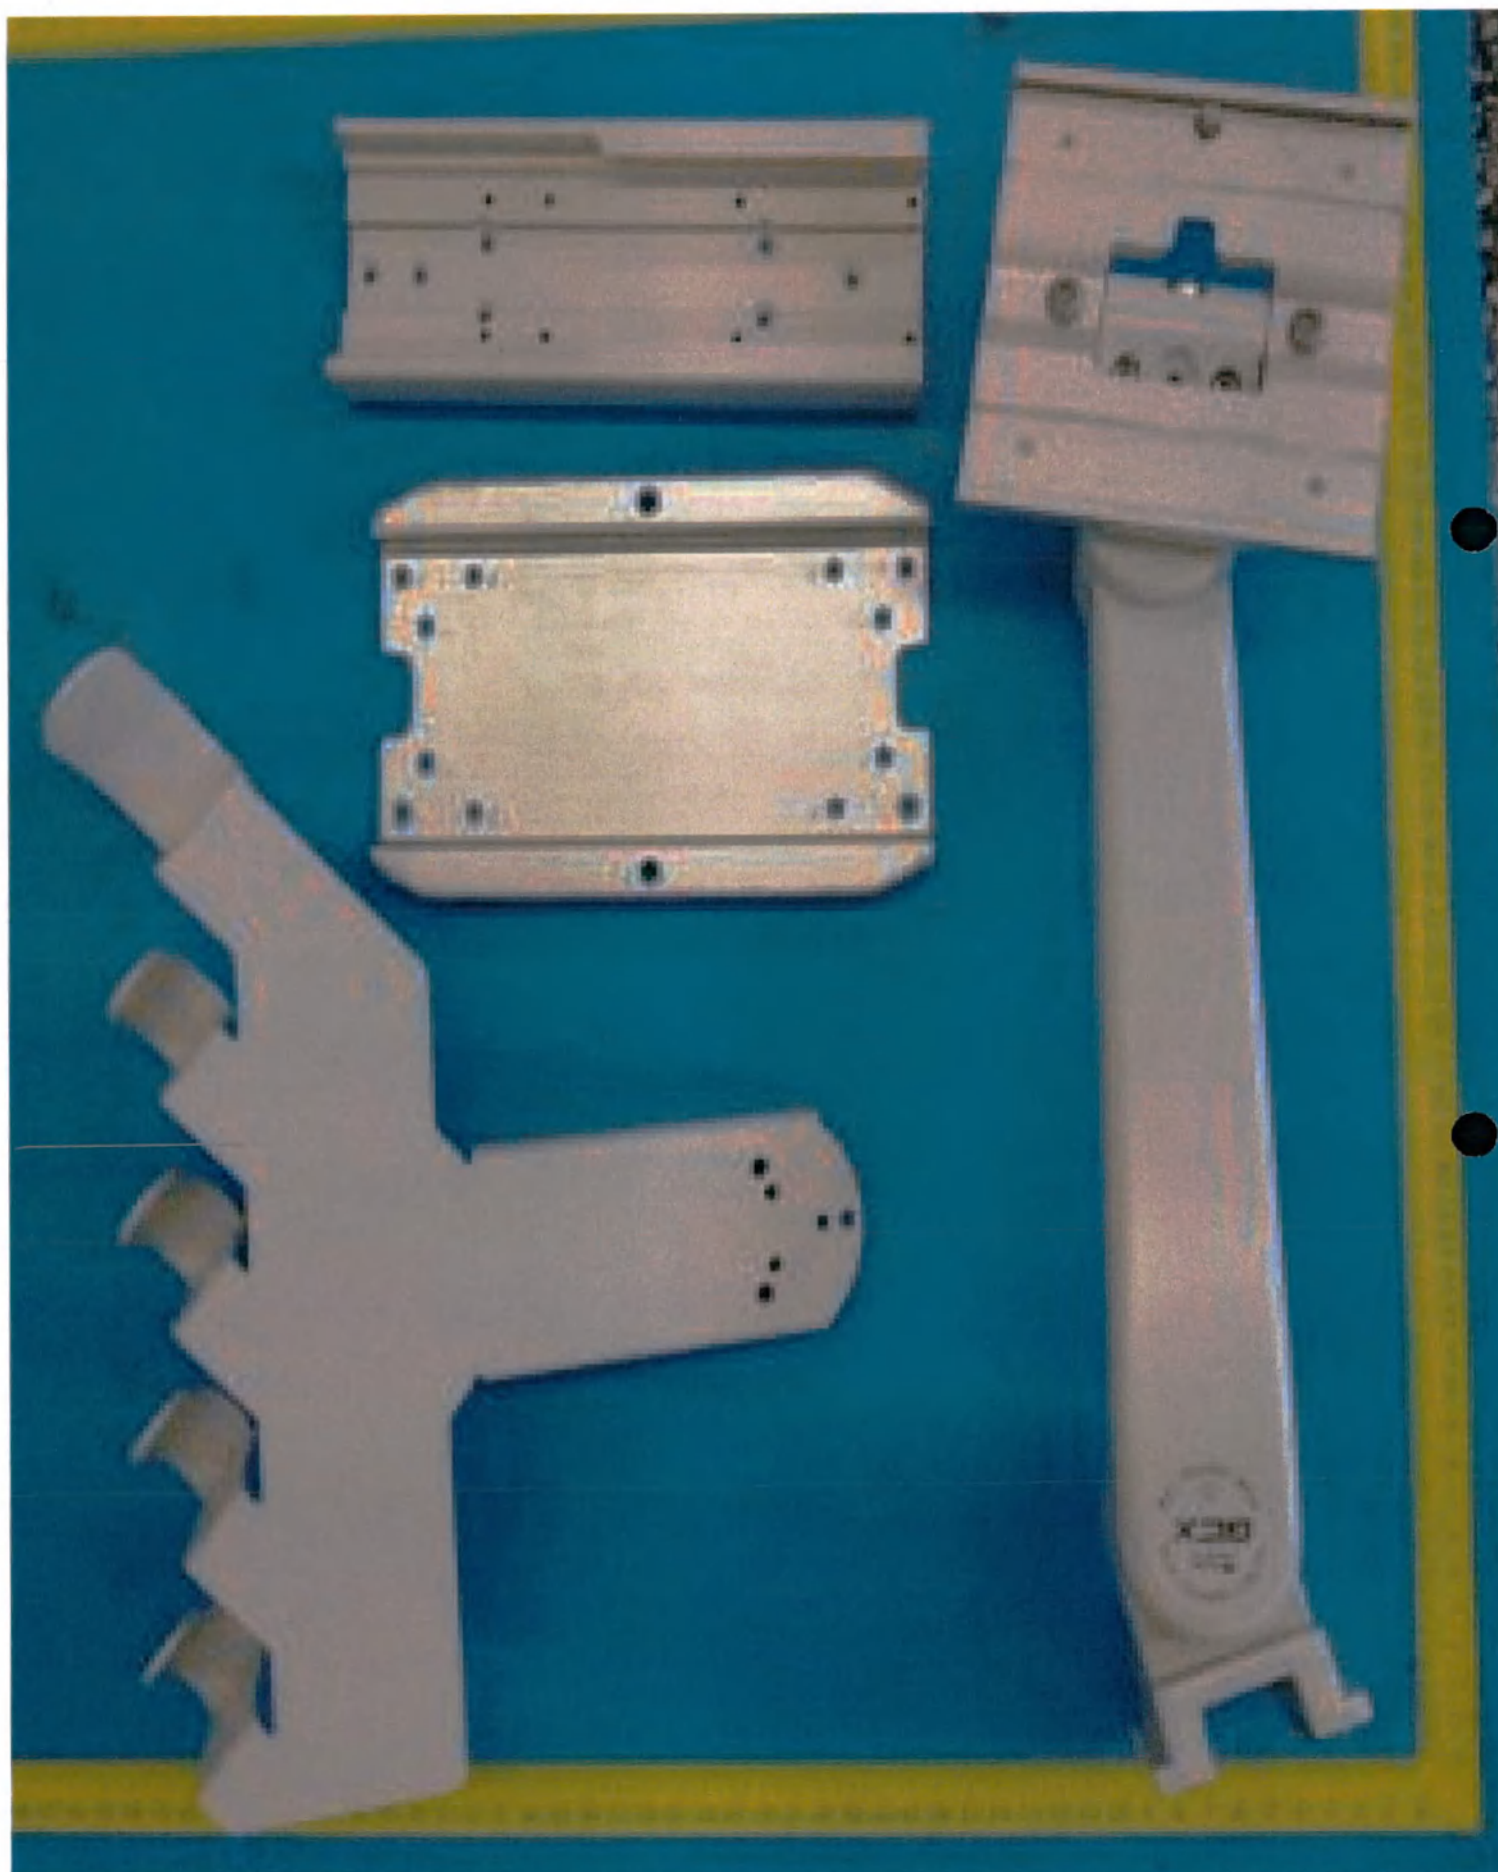


10. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора
N12/M12/N15/M15/N17/M17/ePM15 с регулируемой высотой– не более 2 шт.

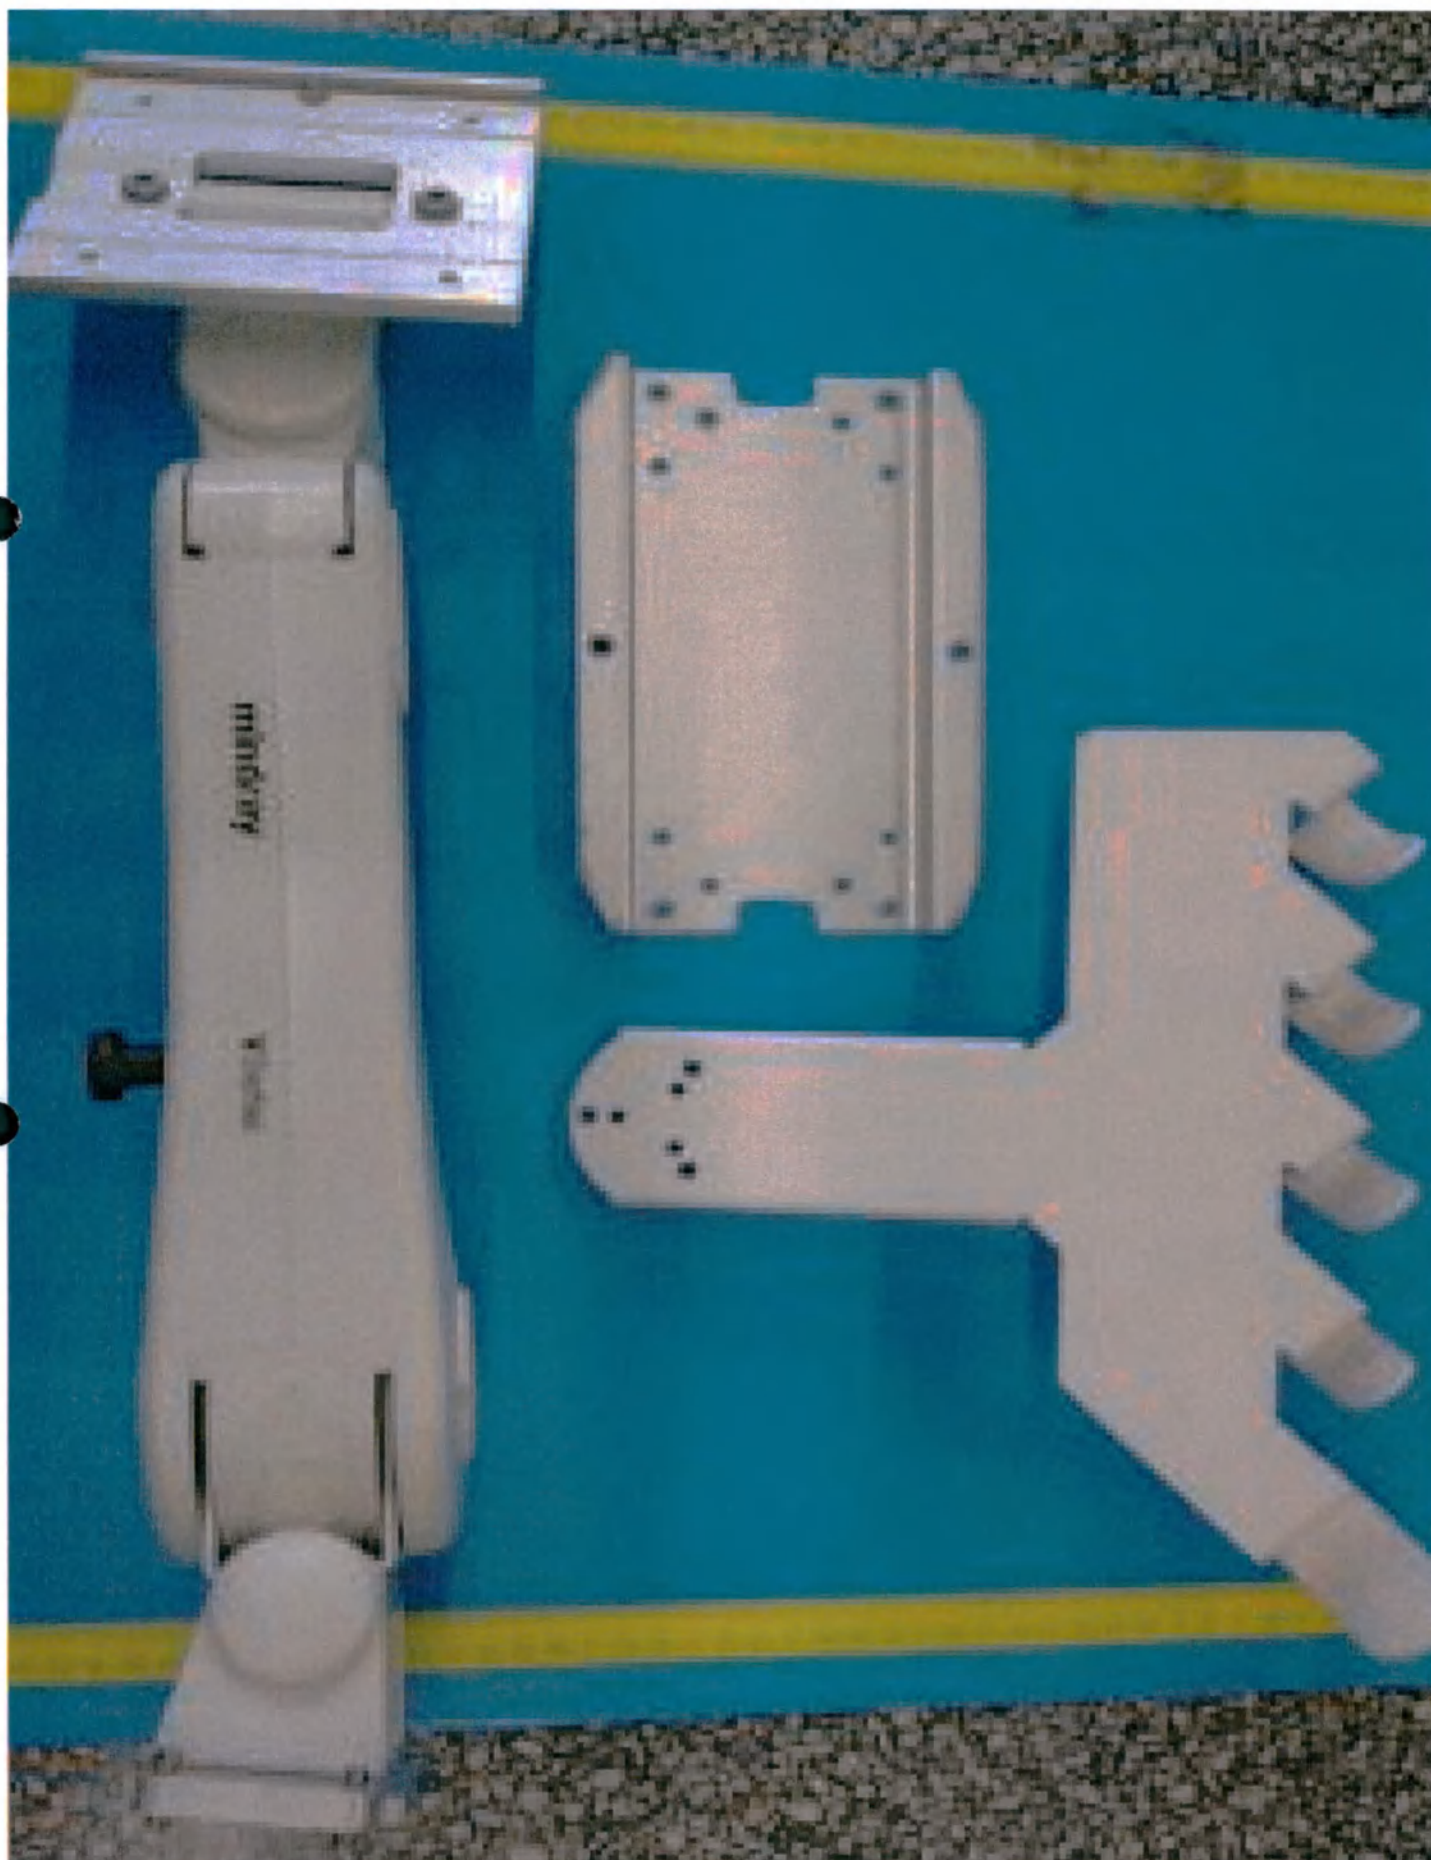


11. Крепление для установки на наркозный аппарат монитора ePM10/ePM12/uMEC с регулируемой высотой– не более 2 шт.




12. Крепление для установки на наркозный аппарат монитора ePM10/ePM12/uMEC с фиксированной высотой– не более 2 шт.

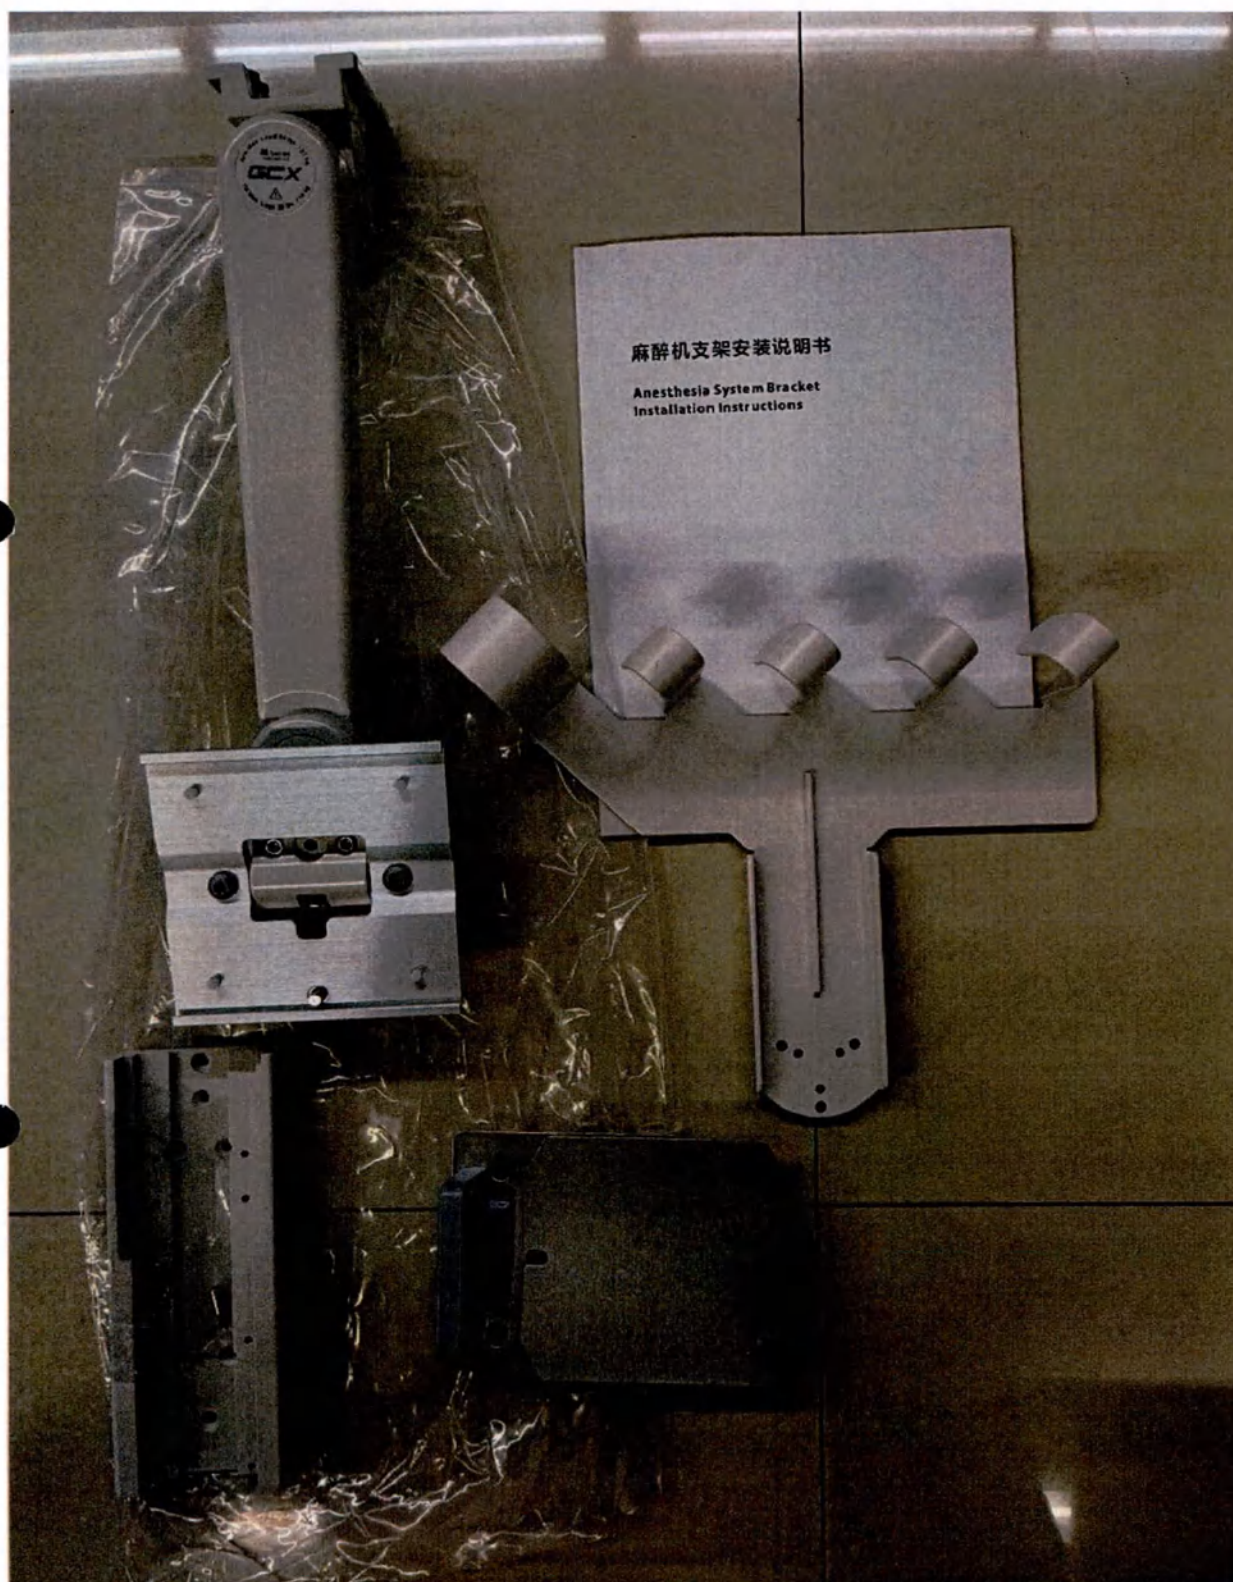

13. Полка для установки монитора N15/N17, M15/17, ePM15 - не более 2 шт.

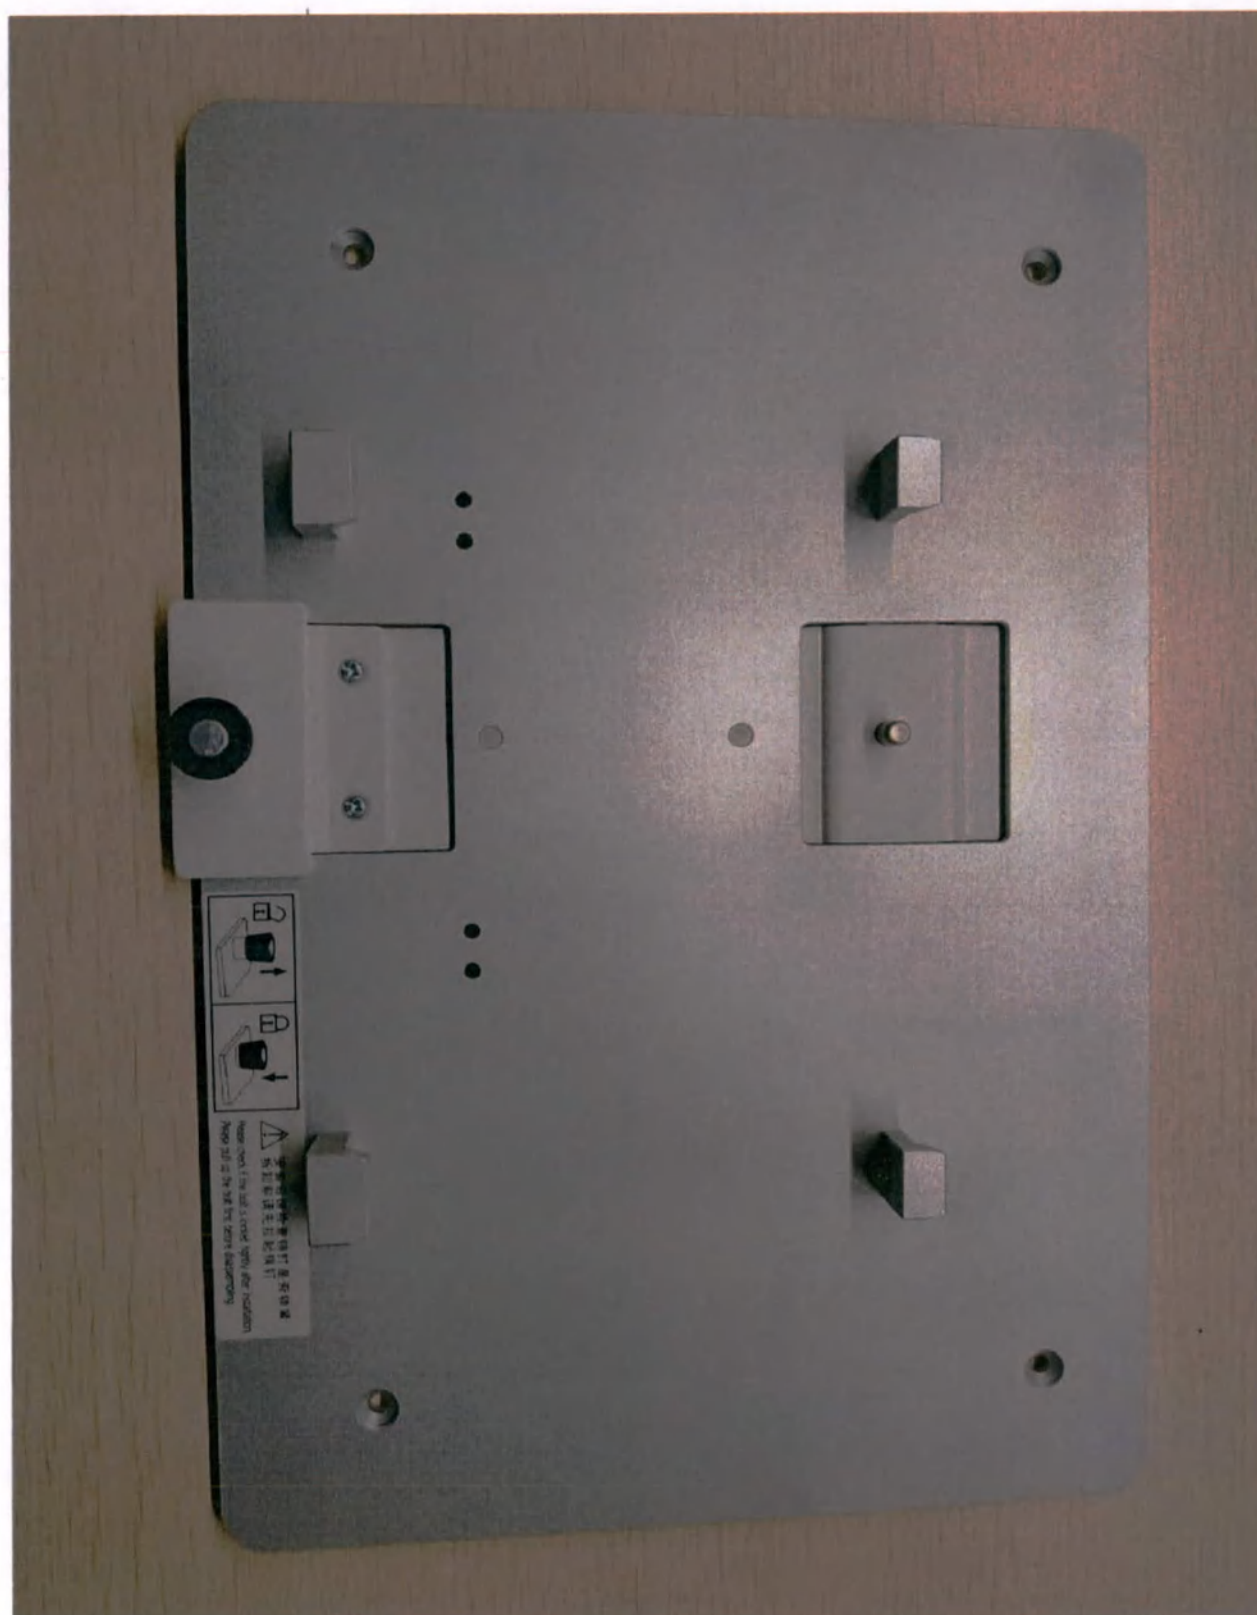


14. Полка для установки монитора N12, M12, ePM12, ePM10 - не более 2 шт.

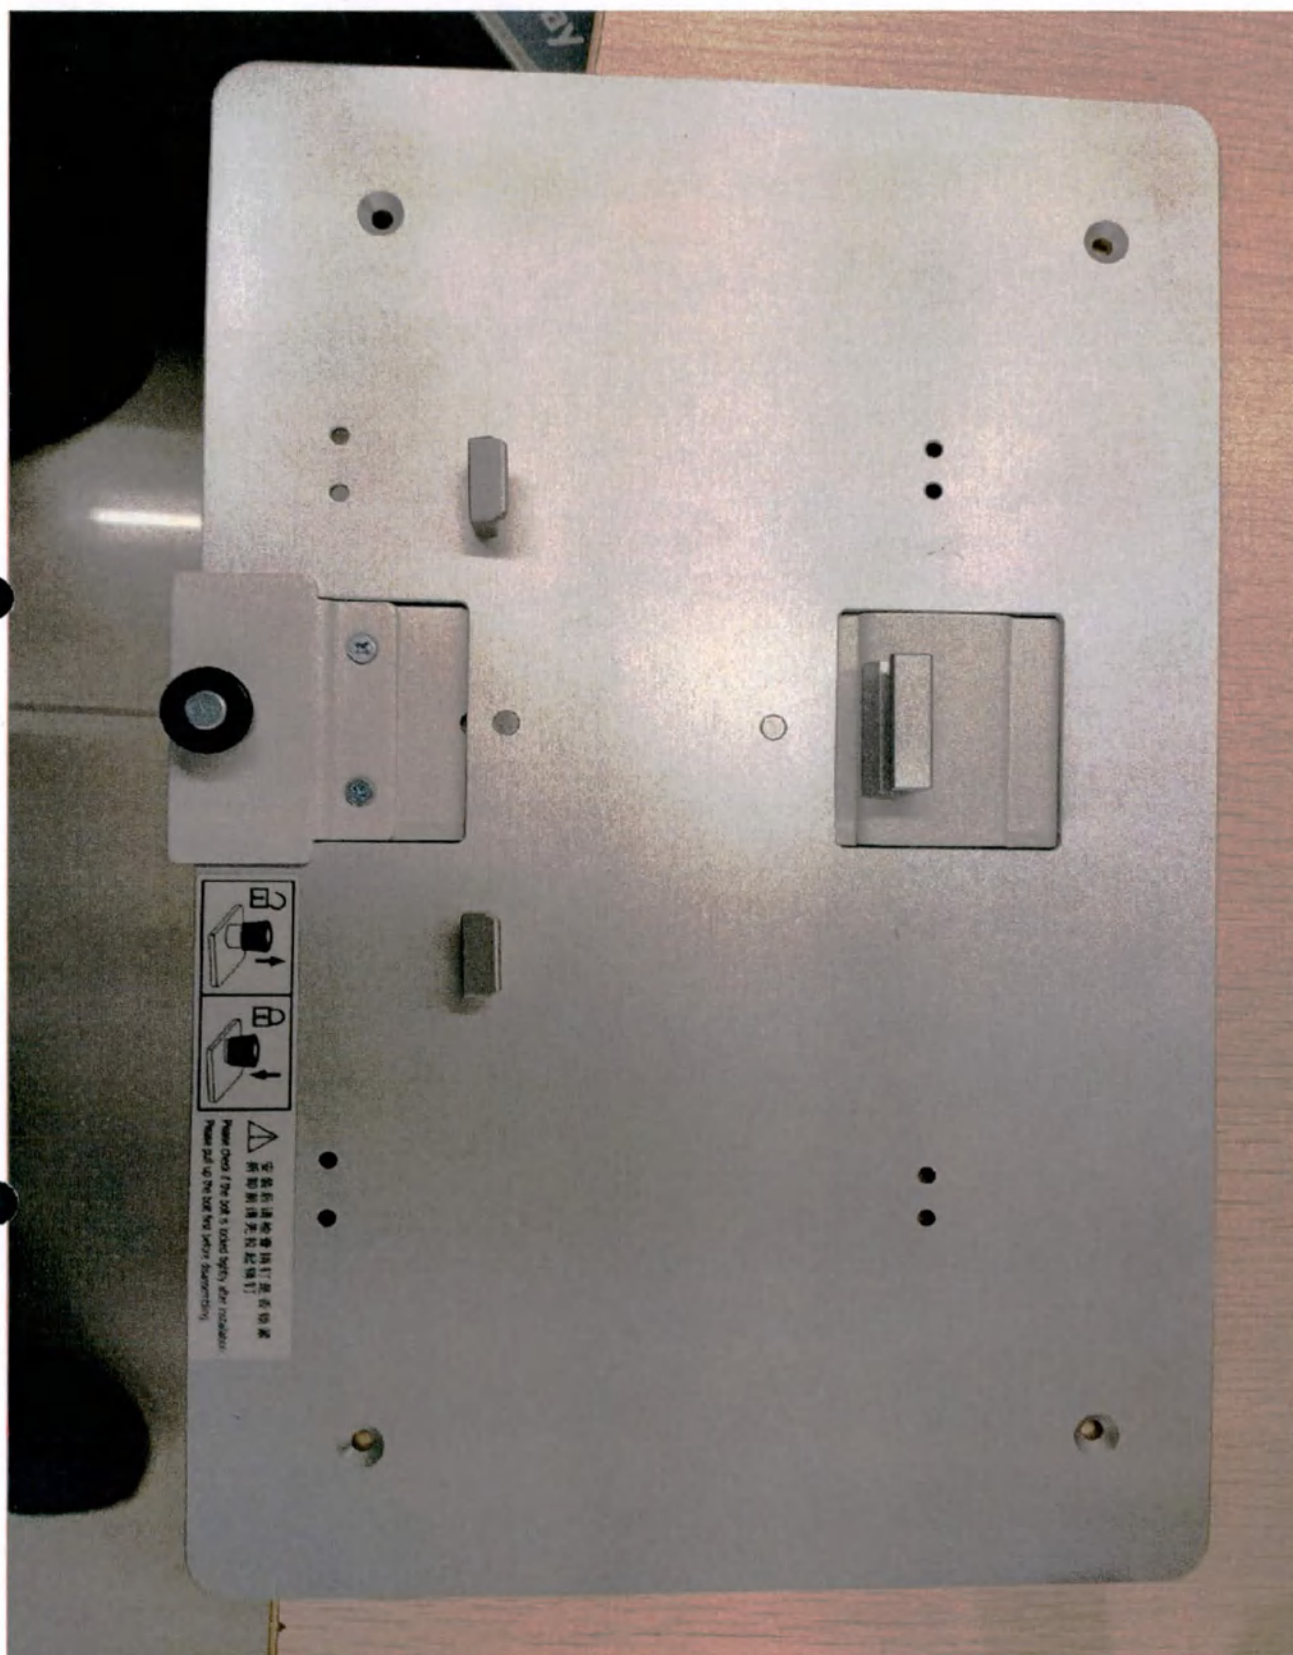


15. Консоль для мешка ручной вентиляции, гибкая - не более 2 шт.




16. Держатель проводов – не более 2 шт.

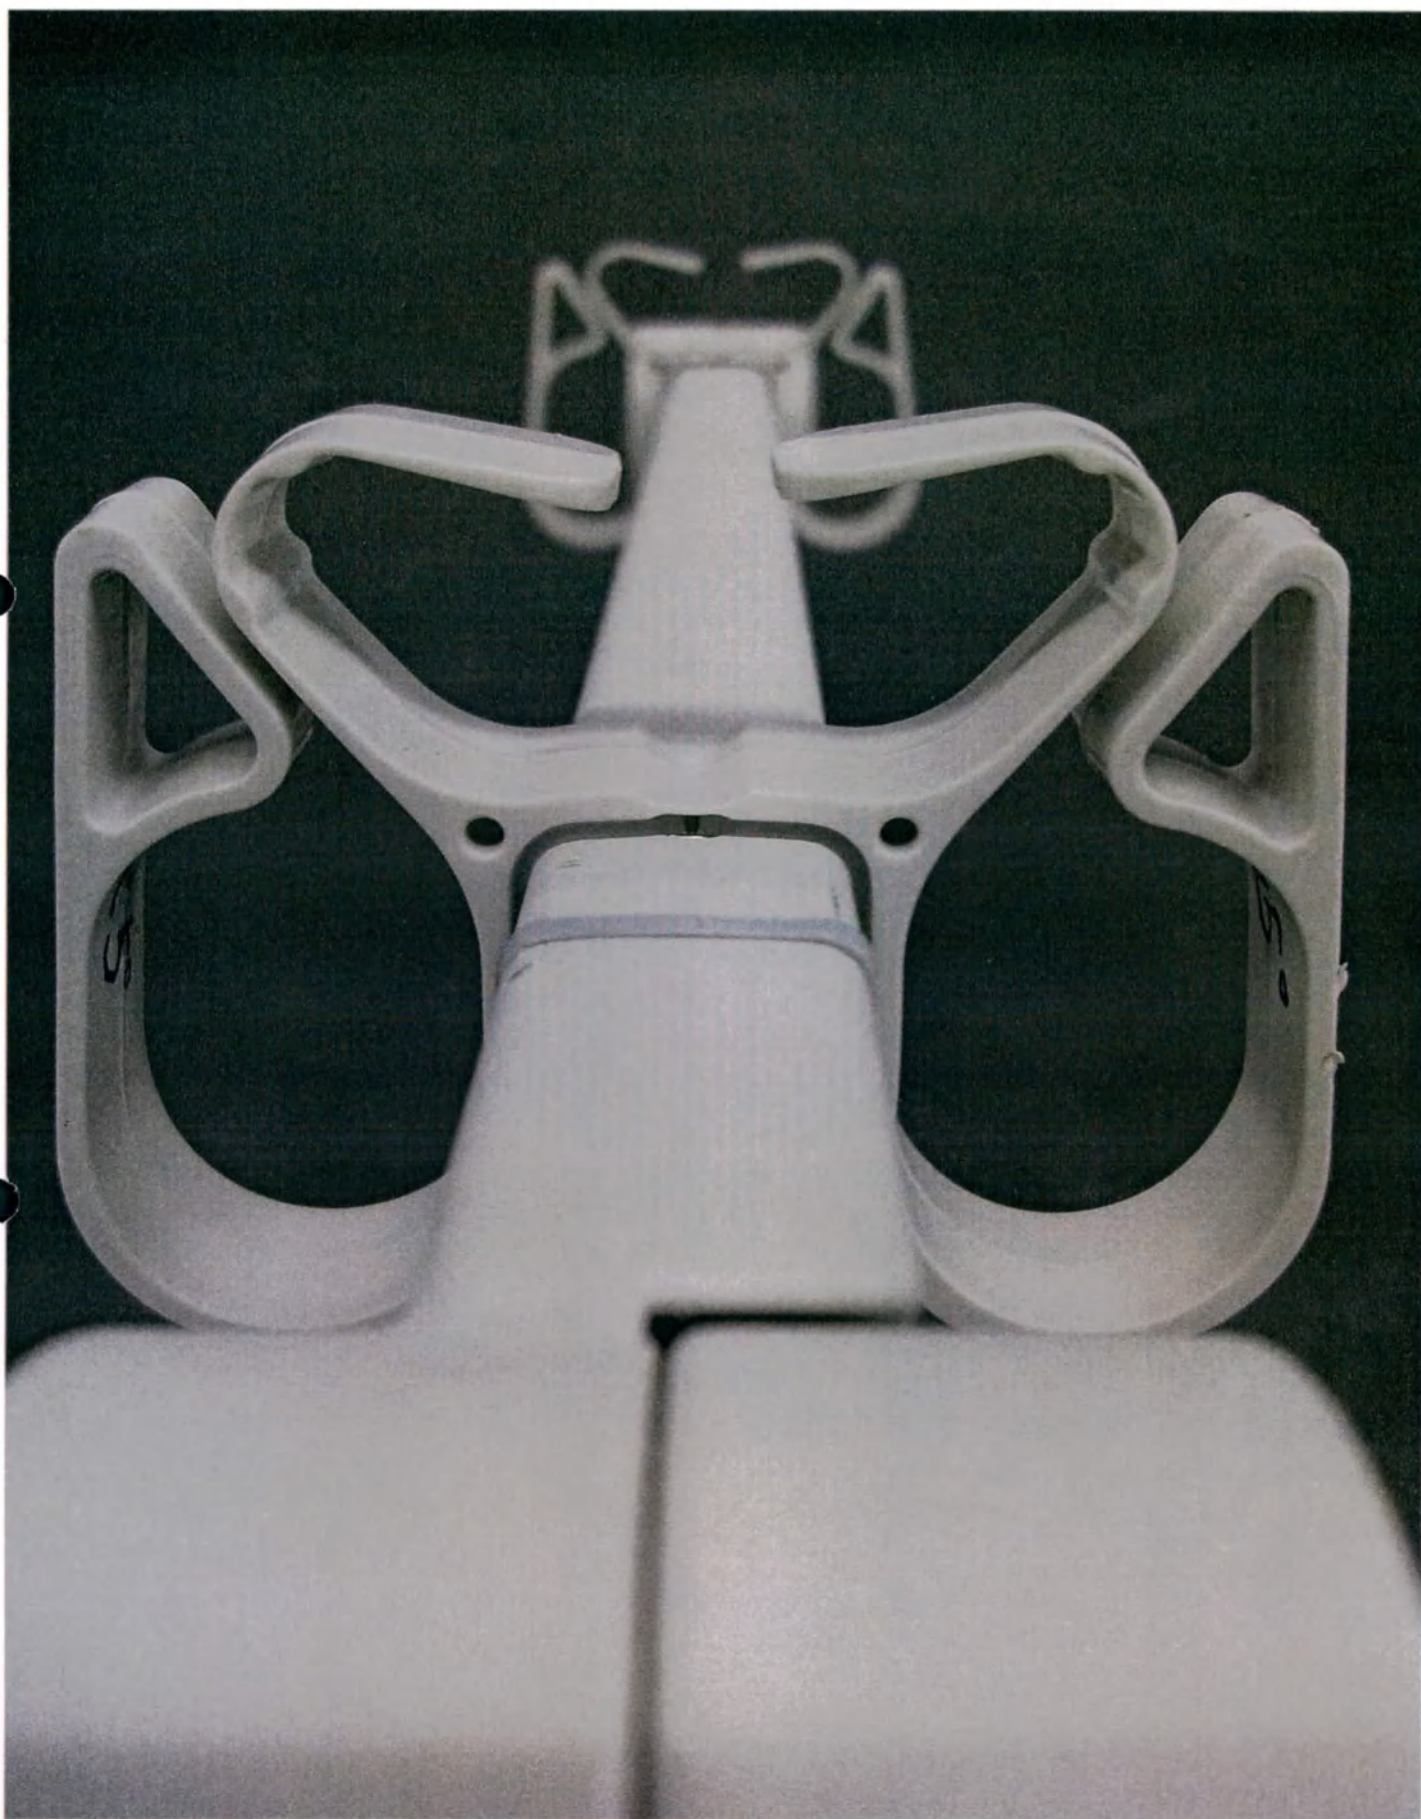

17. Крепление для коаксиальных дыхательных шлангов – не более 2 шт.

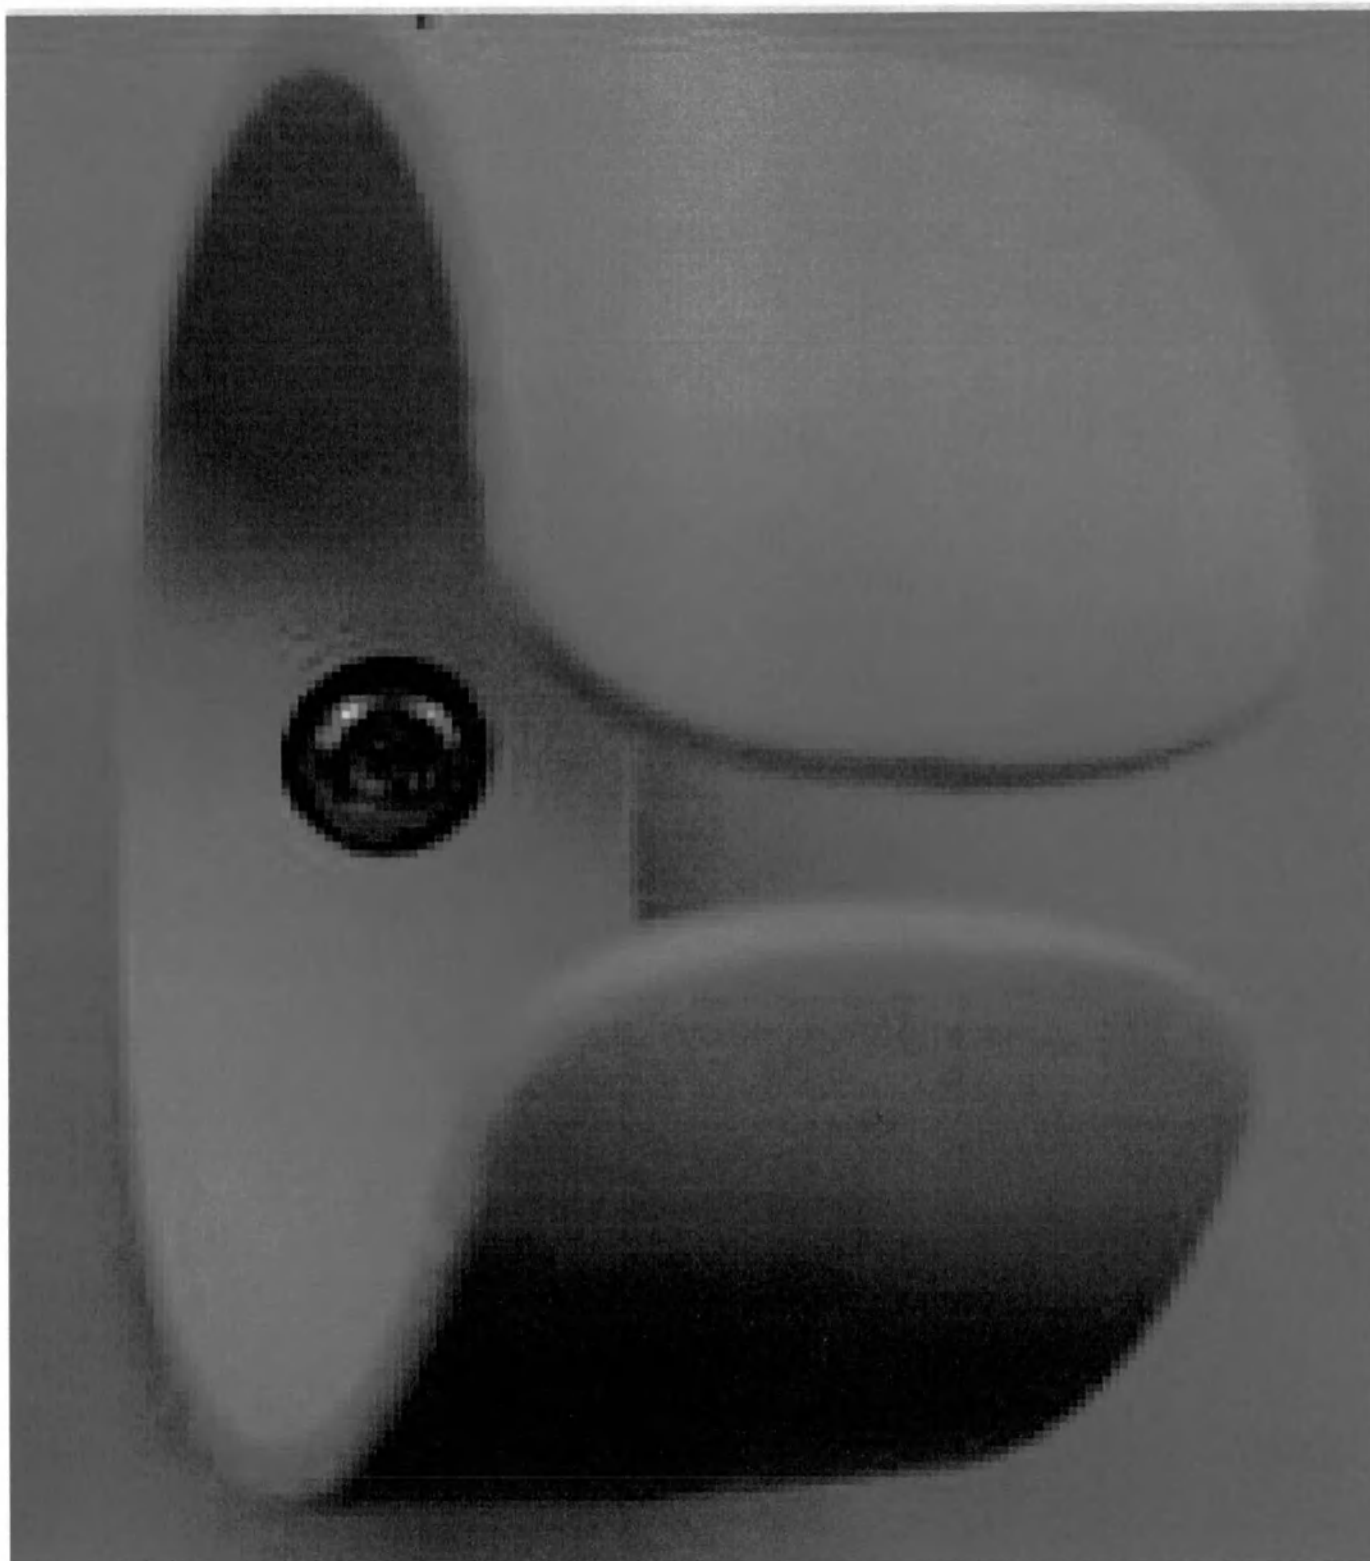


18. Крюк для аксессуаров – не более 2 шт.

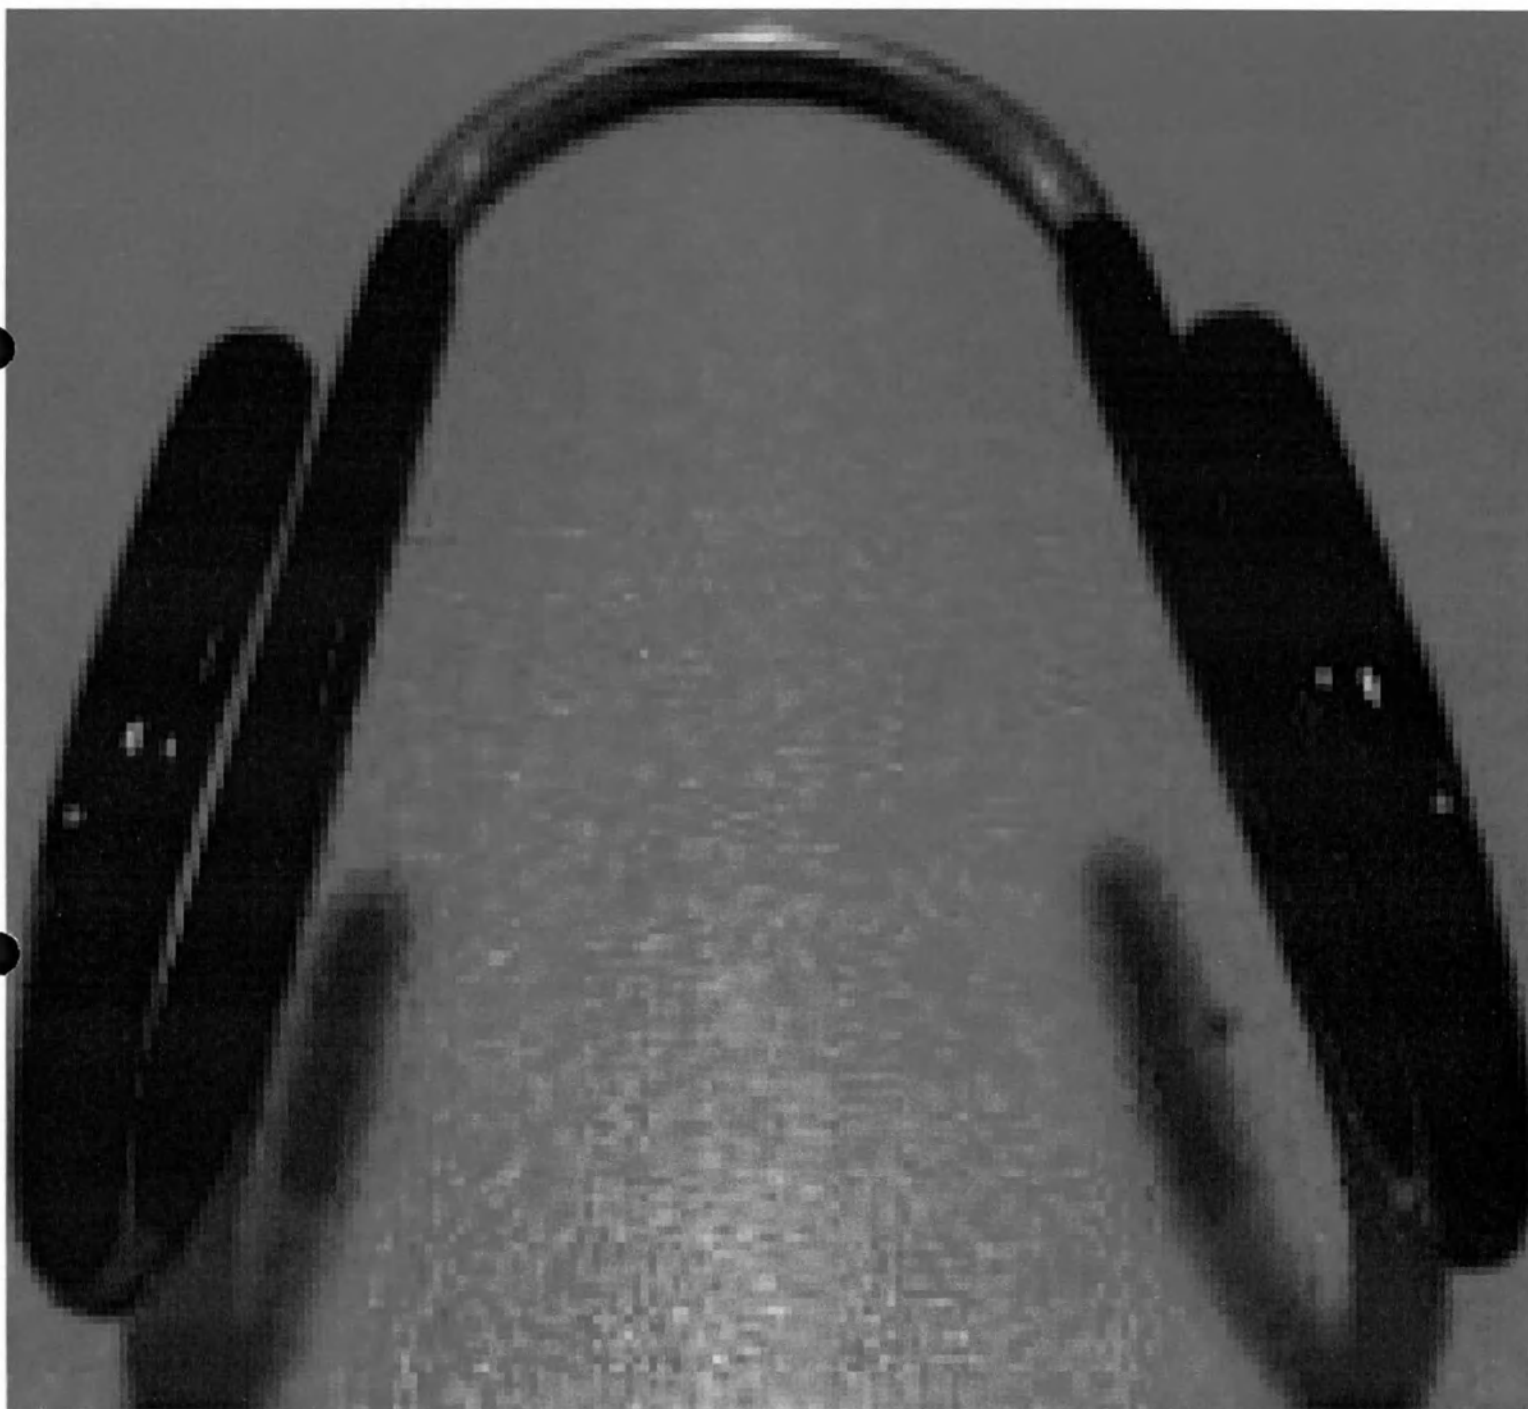

19. Кронштейн для фиксации дыхательного контура и проводов – не более 2 шт.




20. Консоль для проводов – не более 2 шт.

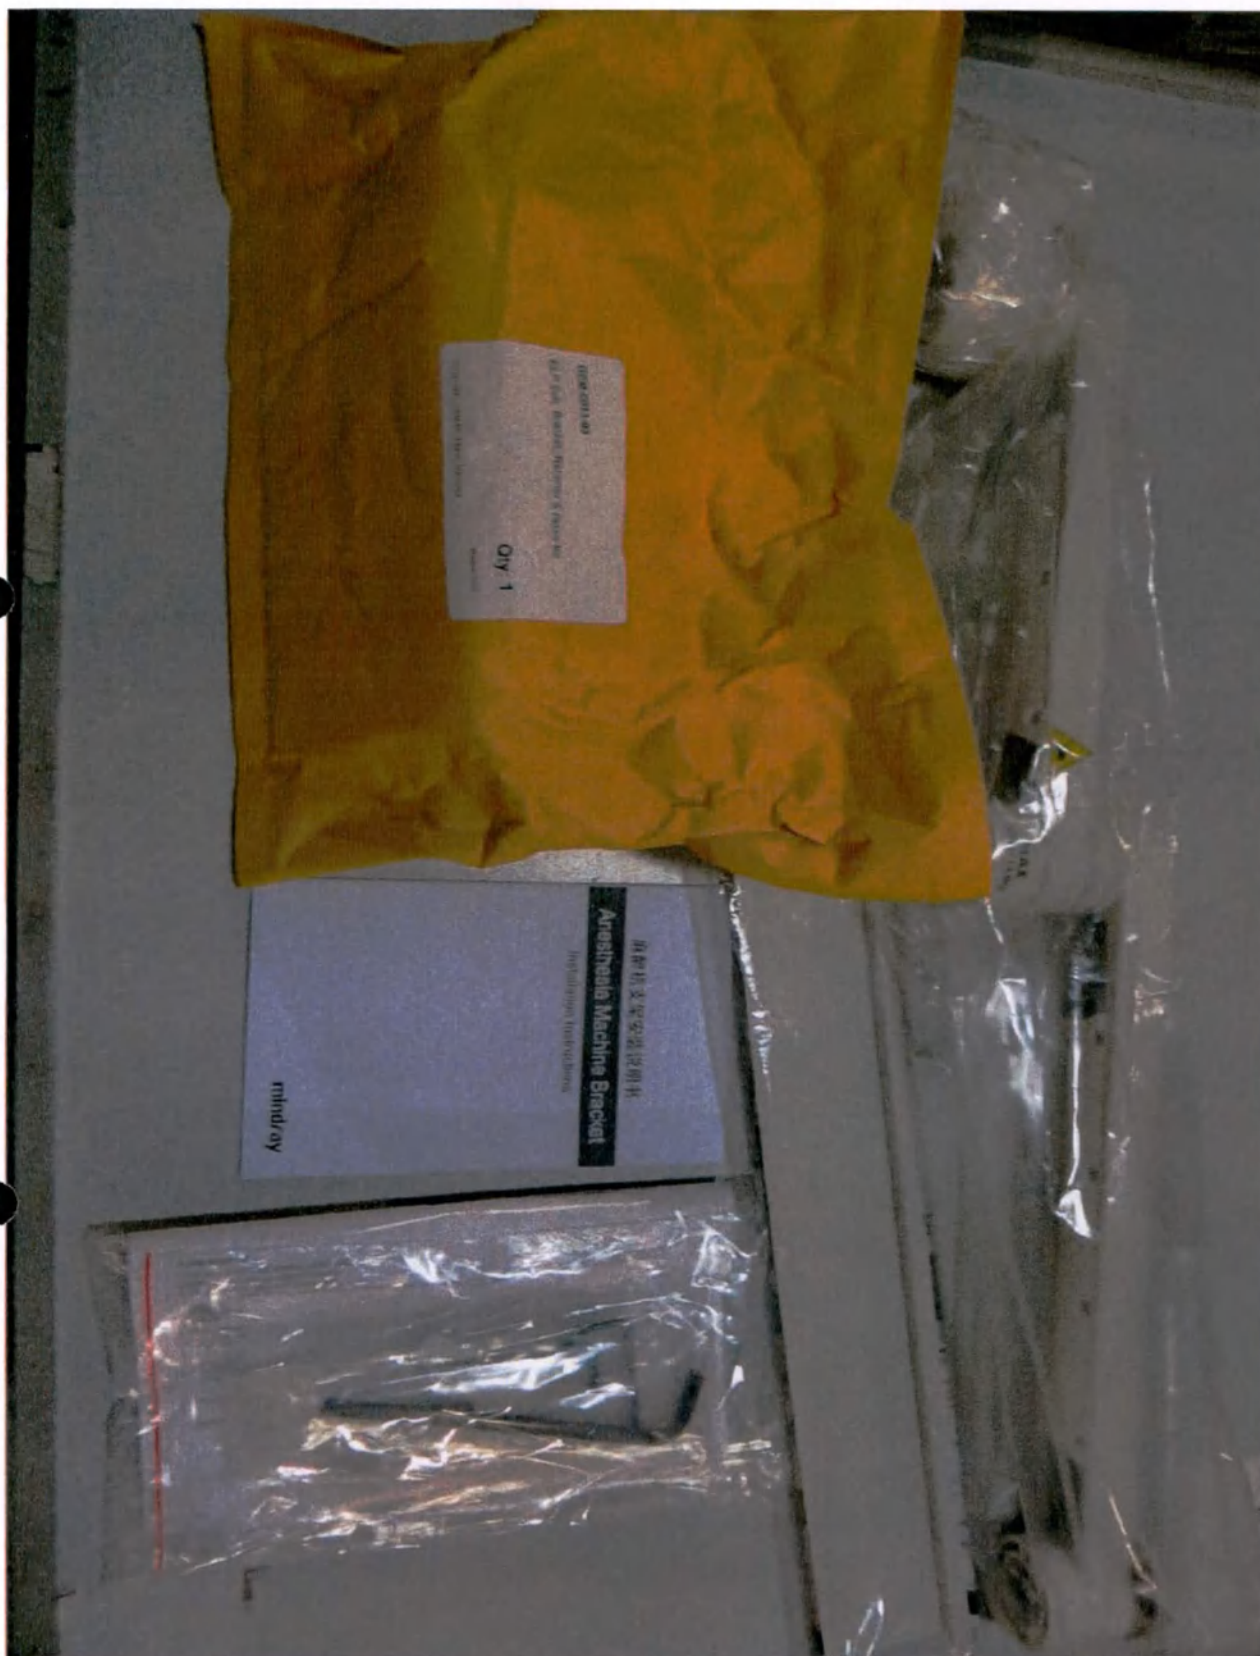


21. Кронштейн артикуляционный с пластиной –не более 2 шт.



22. Кронштейн с корзиной для крепления ультразвукового аппарата ТЕ7- не более 2 шт.

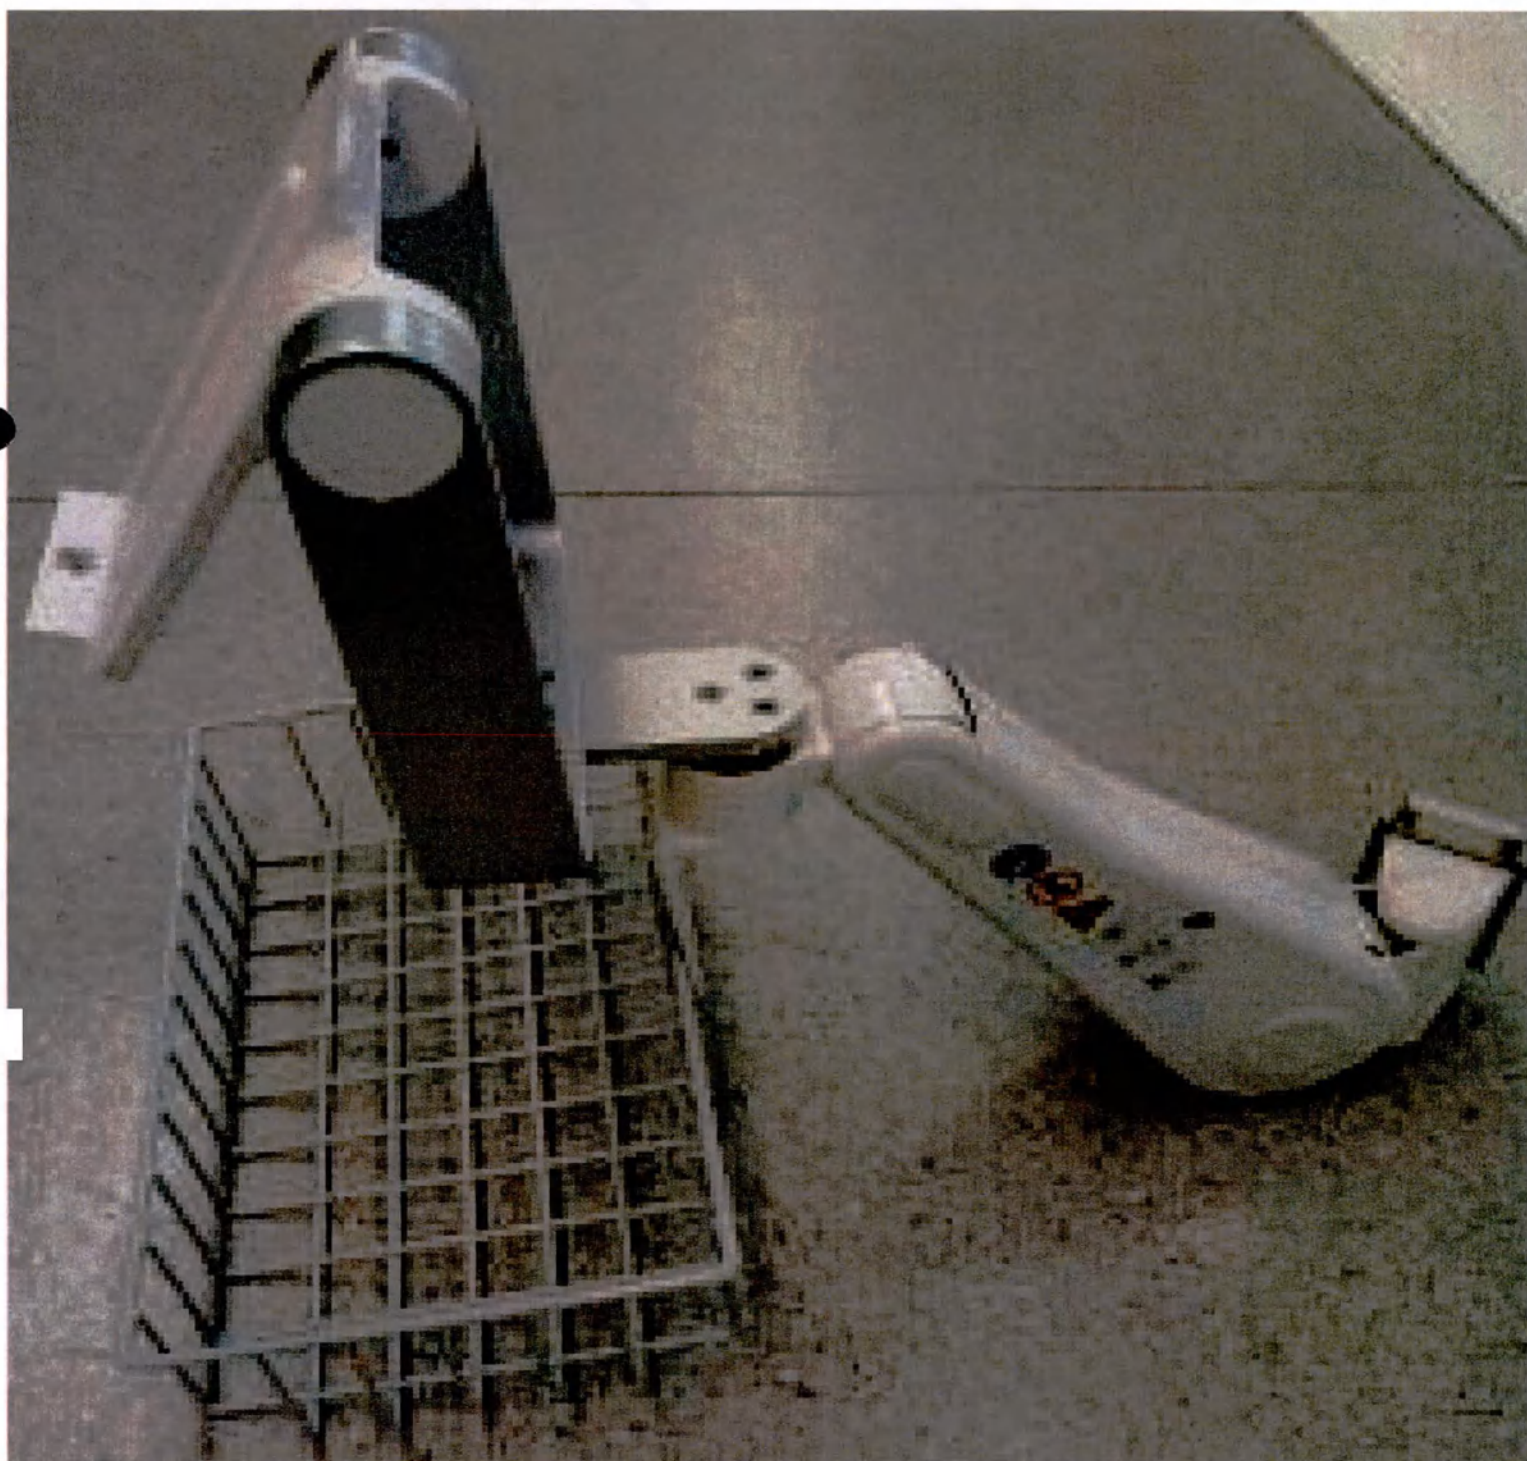


23. Кронштейн для крепления инфузионной помпы- не более 2 шт.

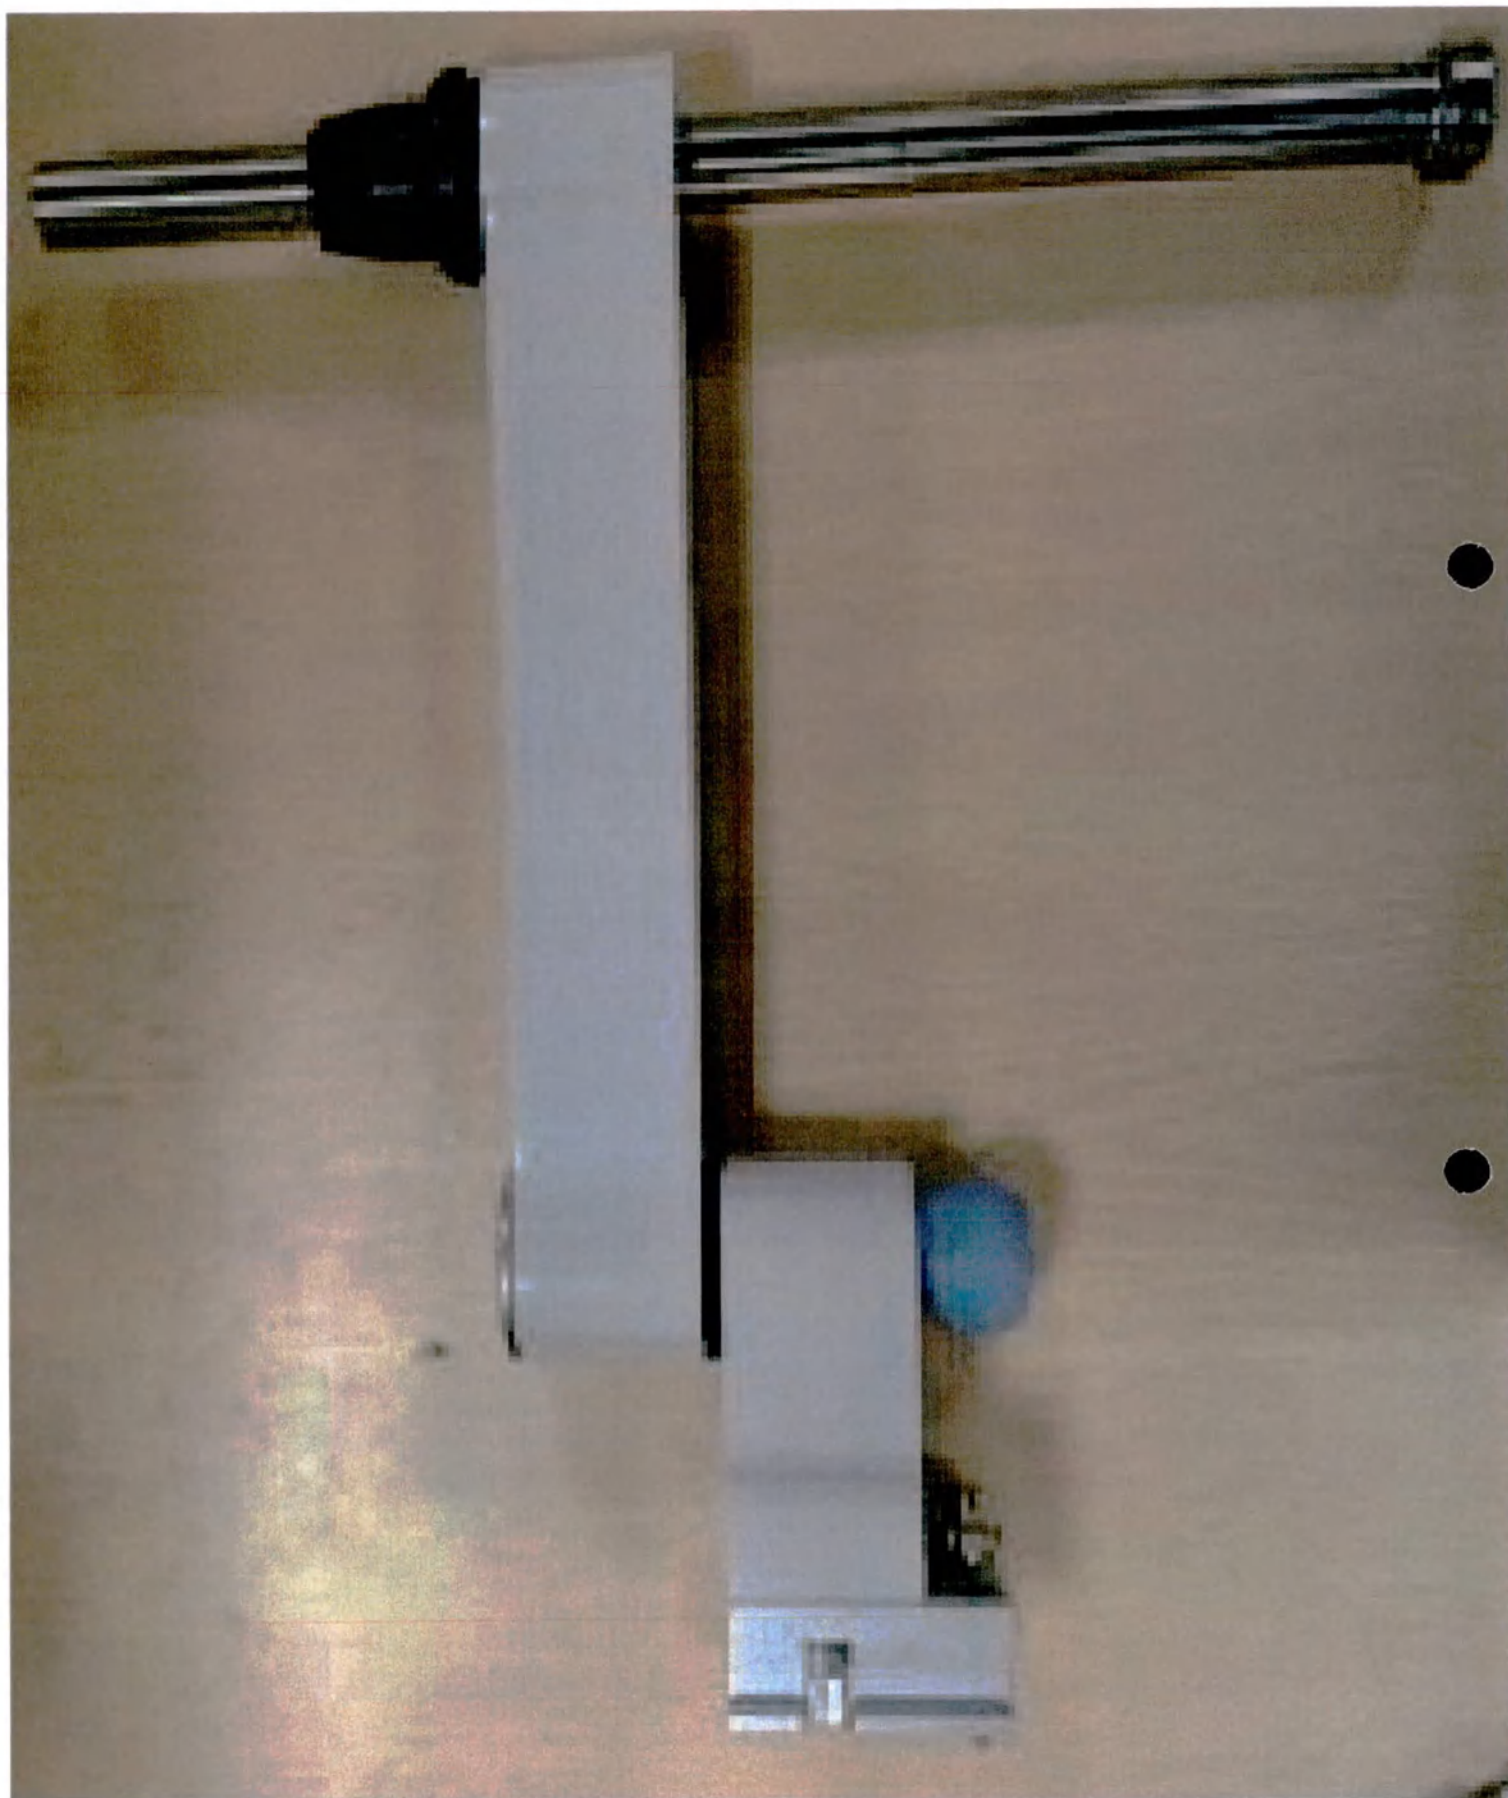


24. Сильфон – не более 5 шт.



25. Прокладка для ёмкости для насыпного абсорбента, 20 шт. в упаковке – не более 20 упаковок.

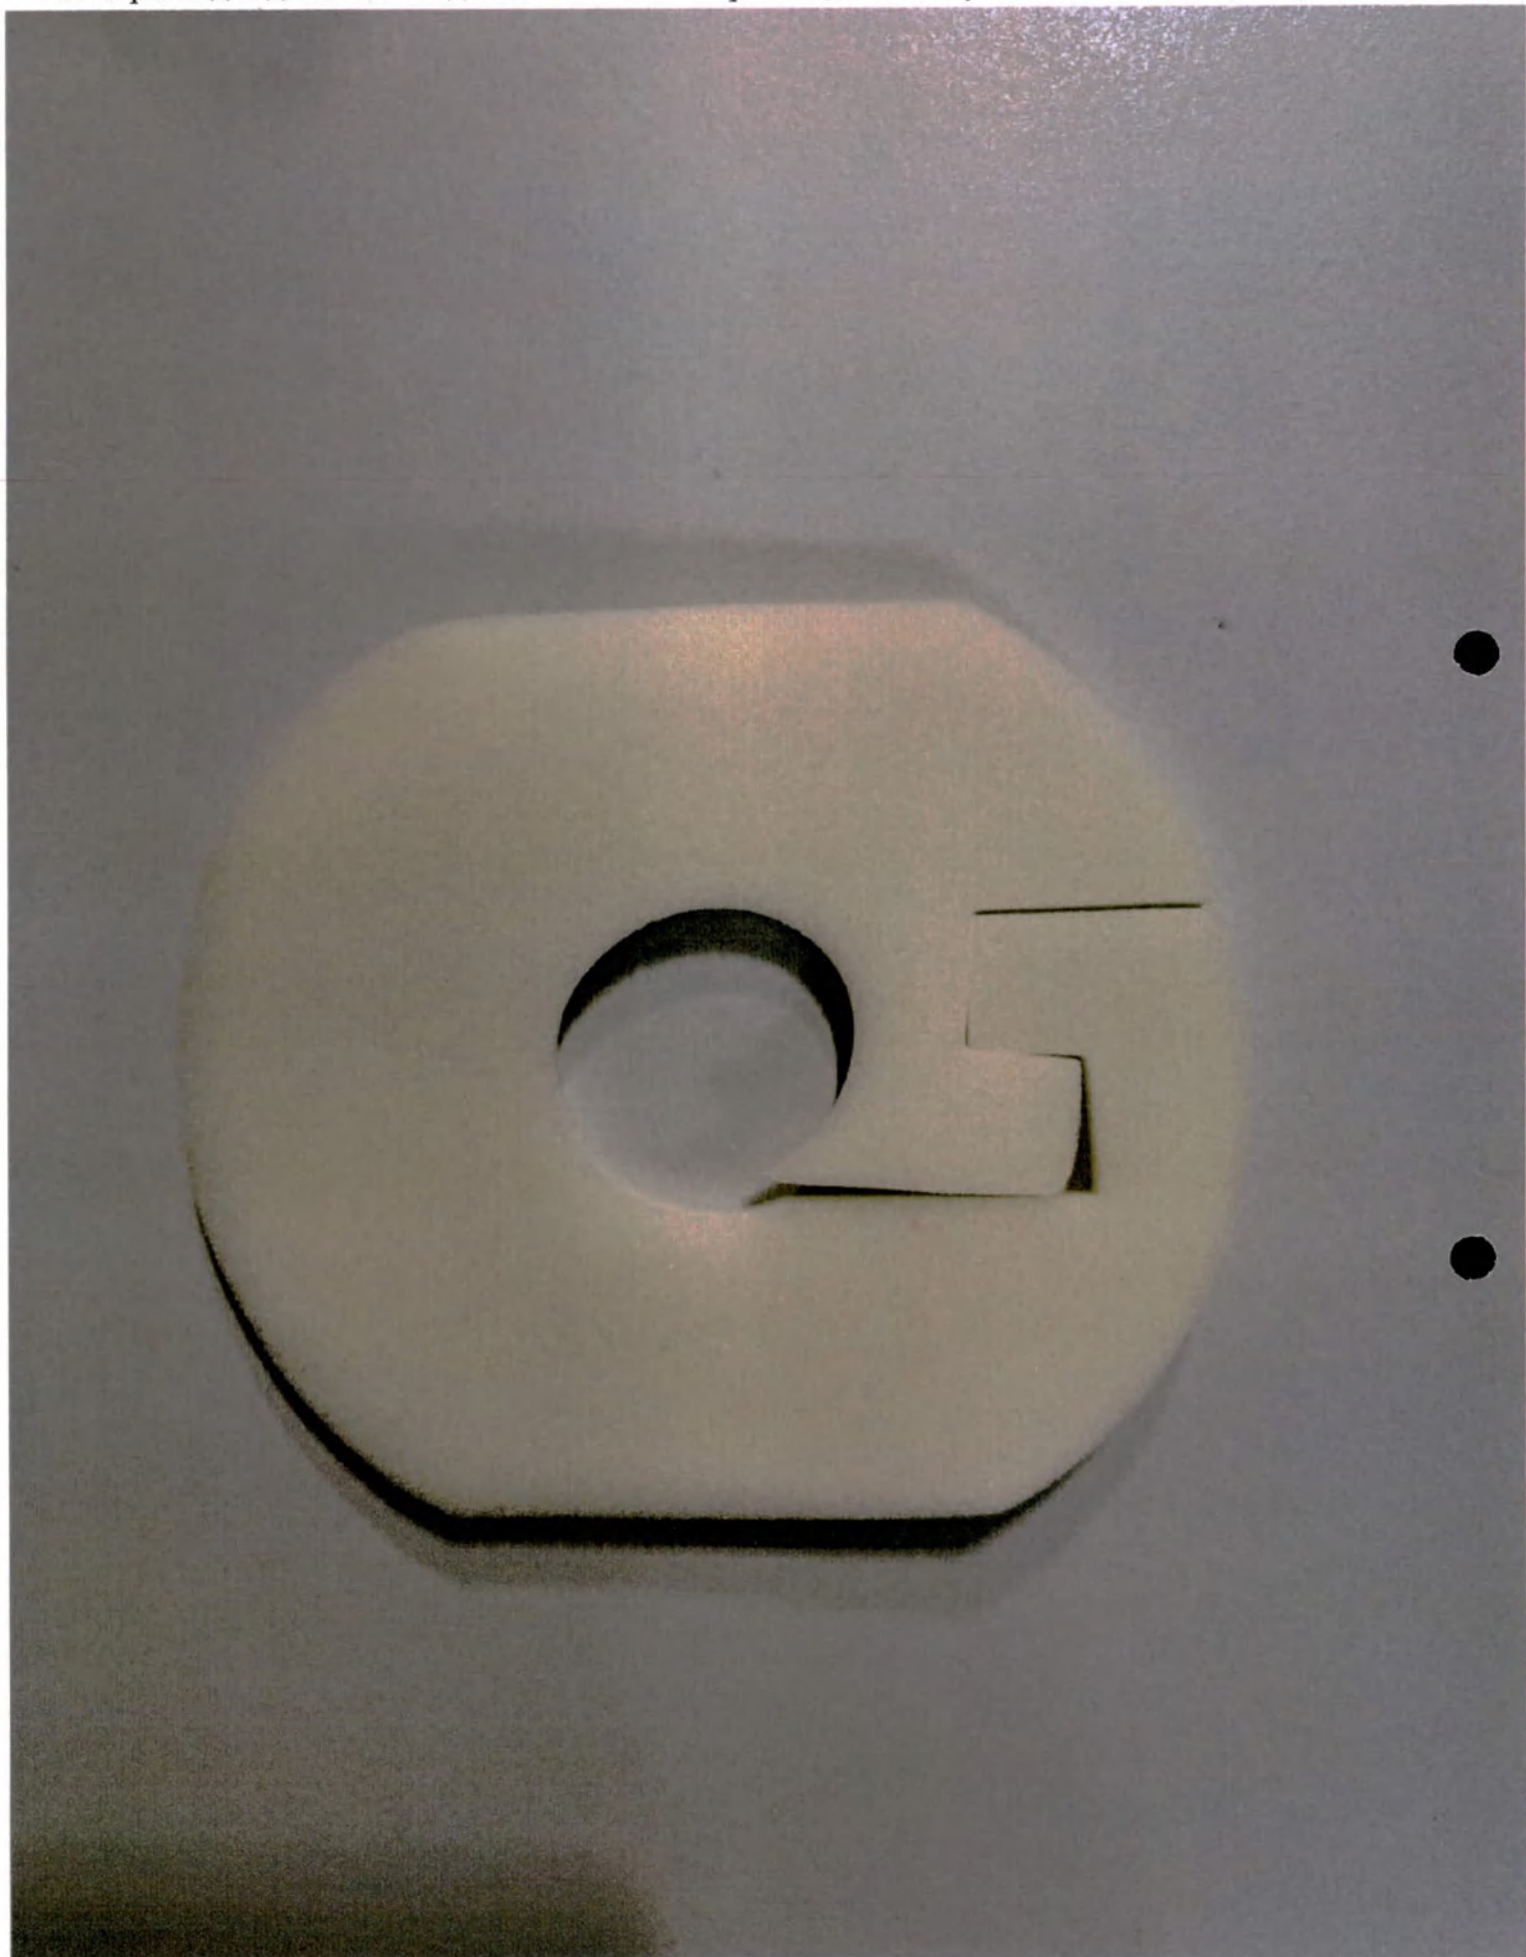


26. Уплотнитель для газовых баллонов – не более 5 шт.

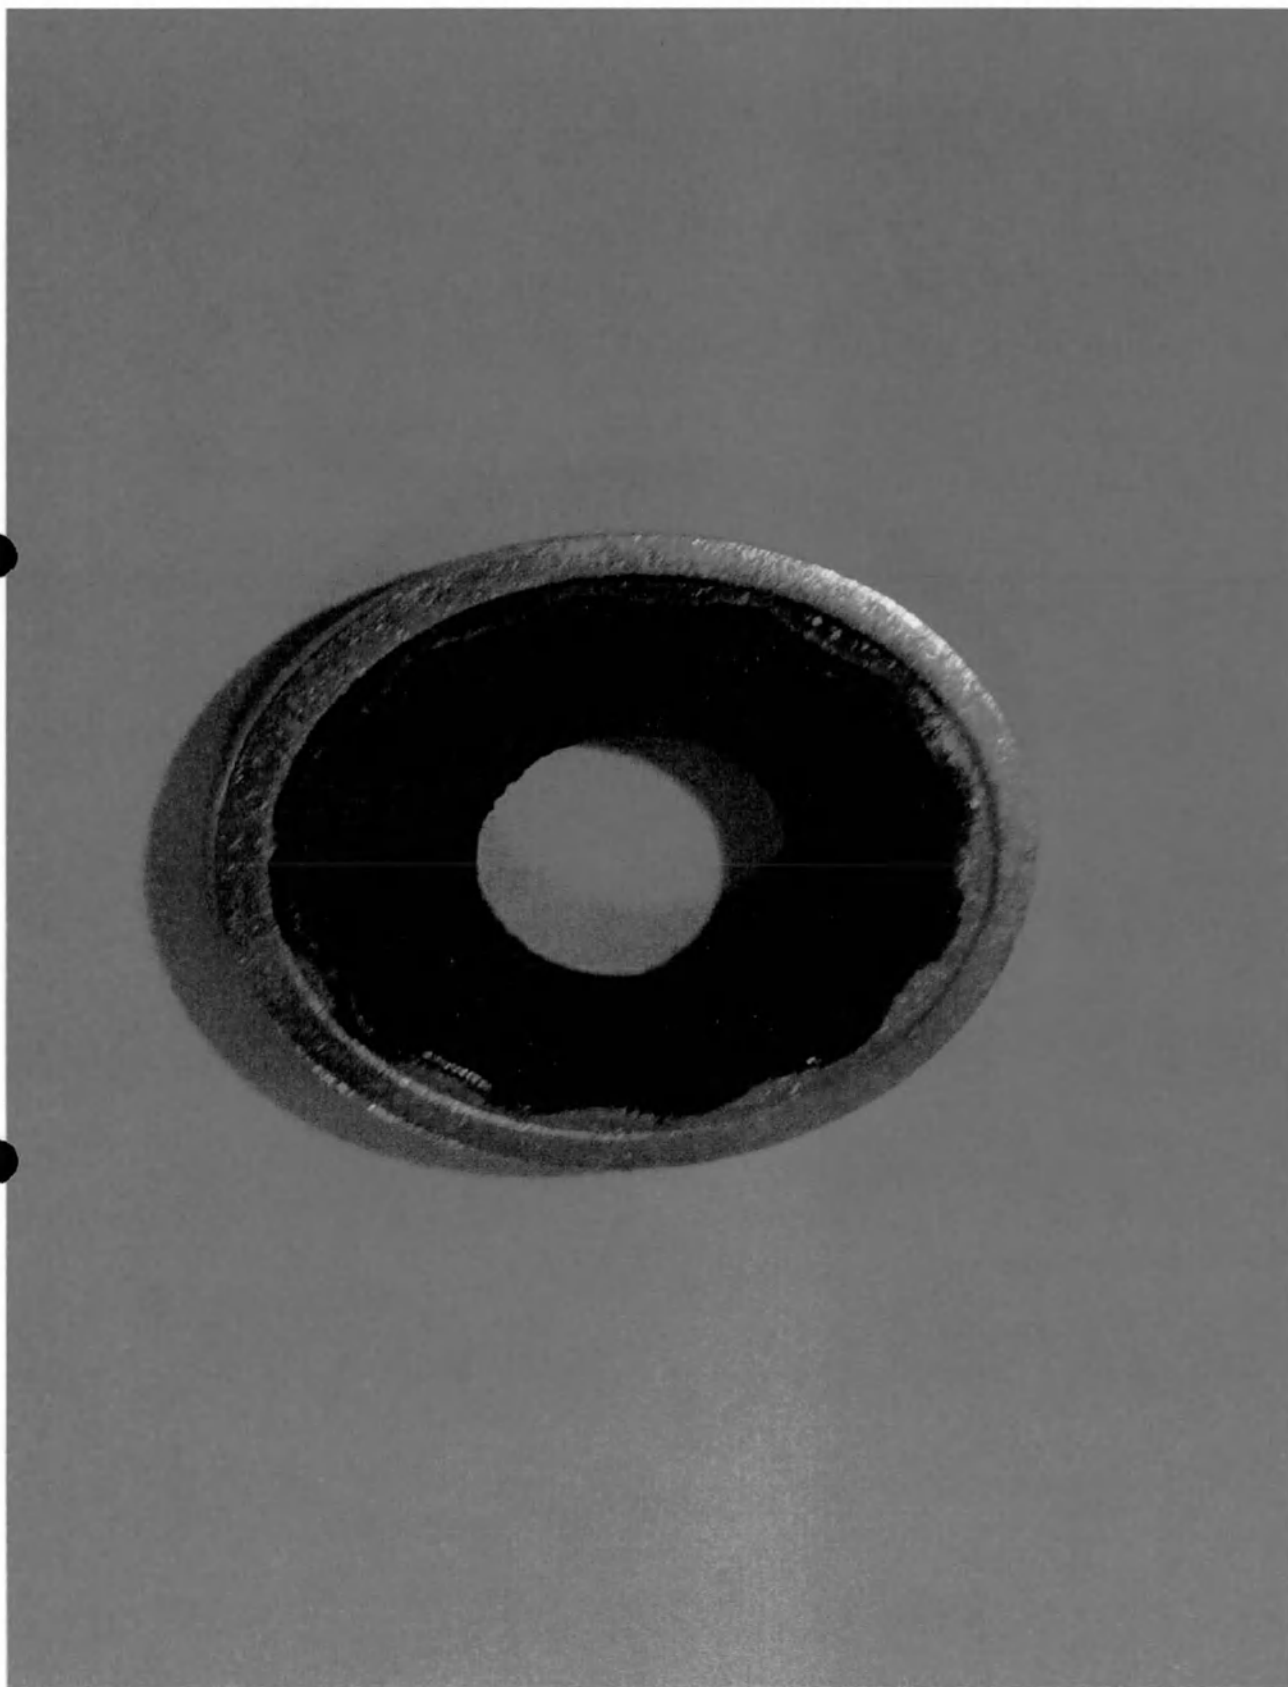


27. Ключ для газовых баллонов – не более 5 шт.



28. Опорный элемент для испарителя – не более 3 шт.

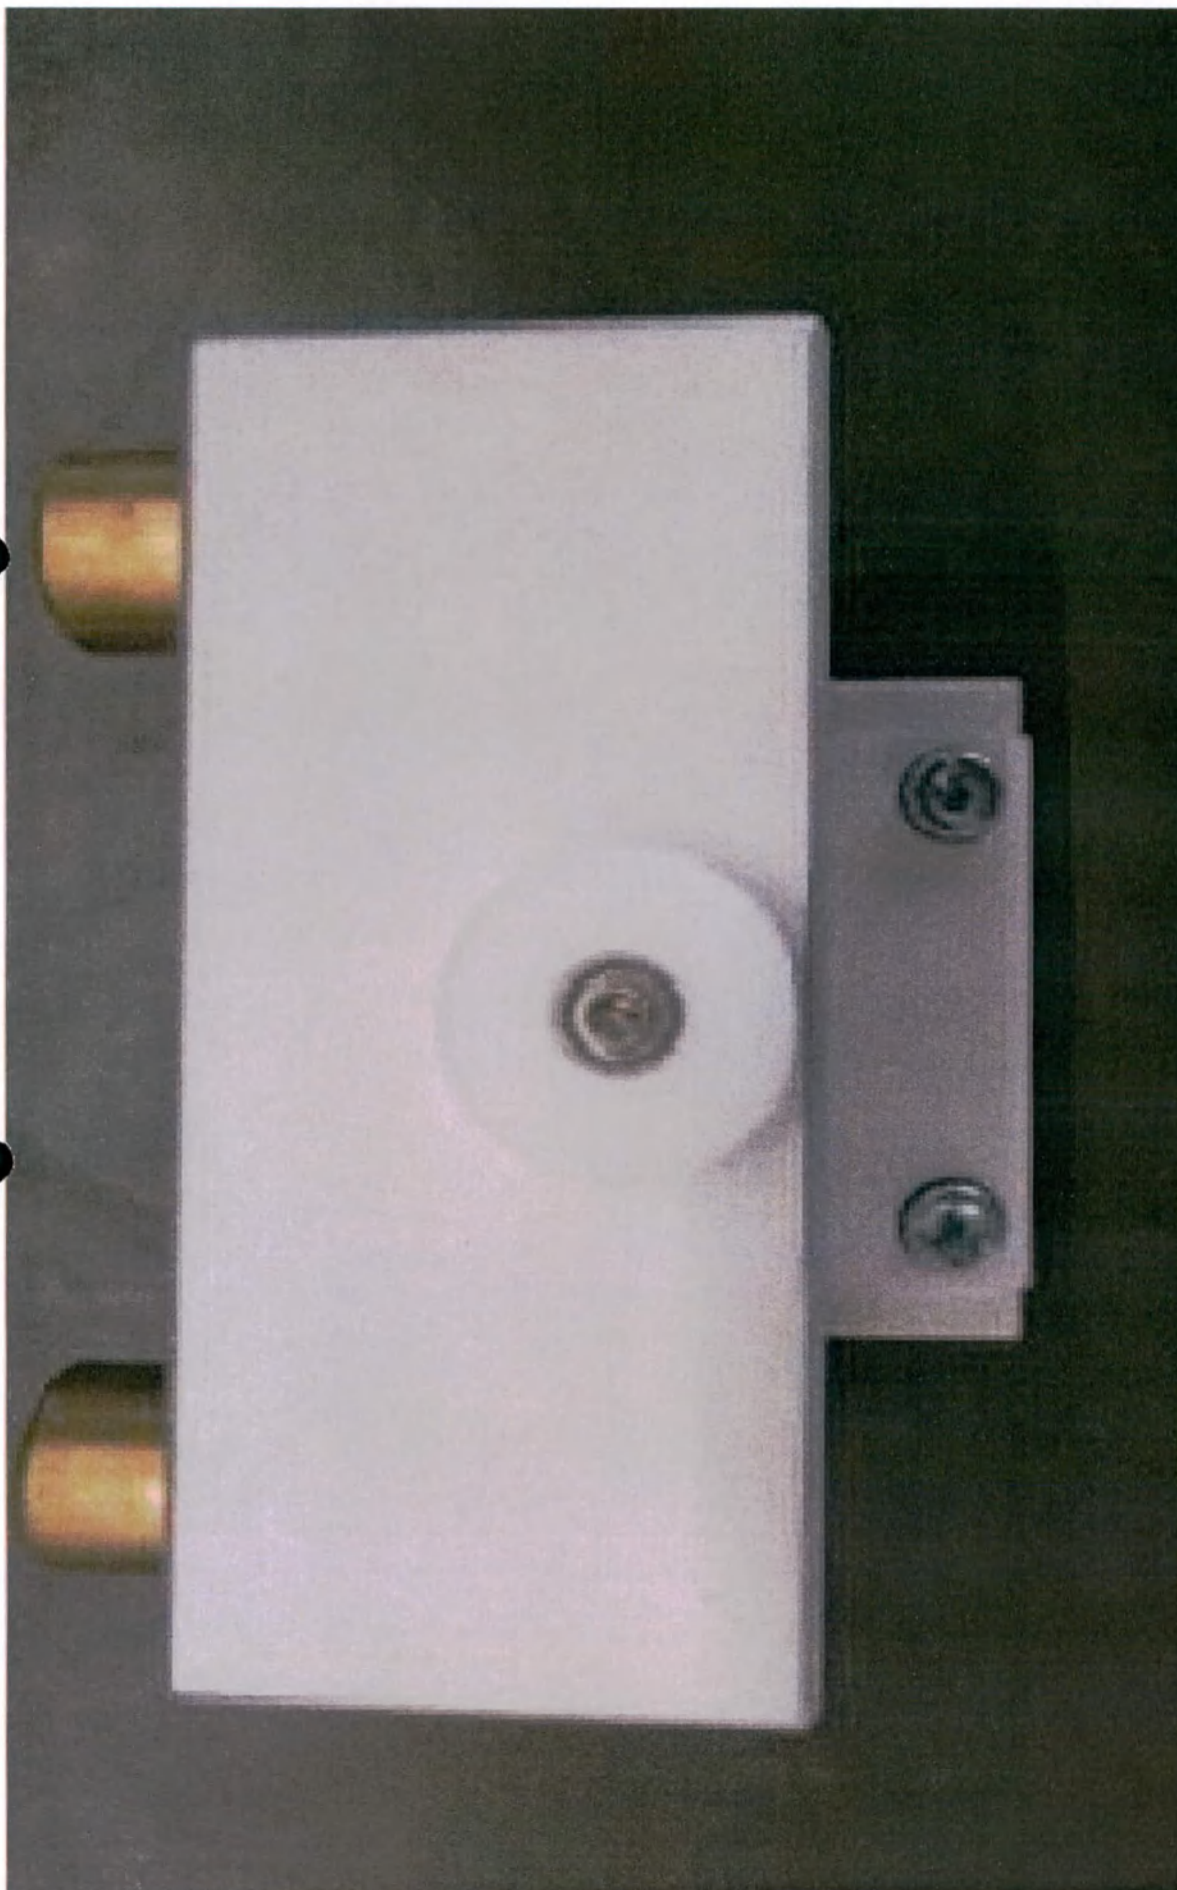

29. Опорный элемент для увлажнителя – не более 2 шт.

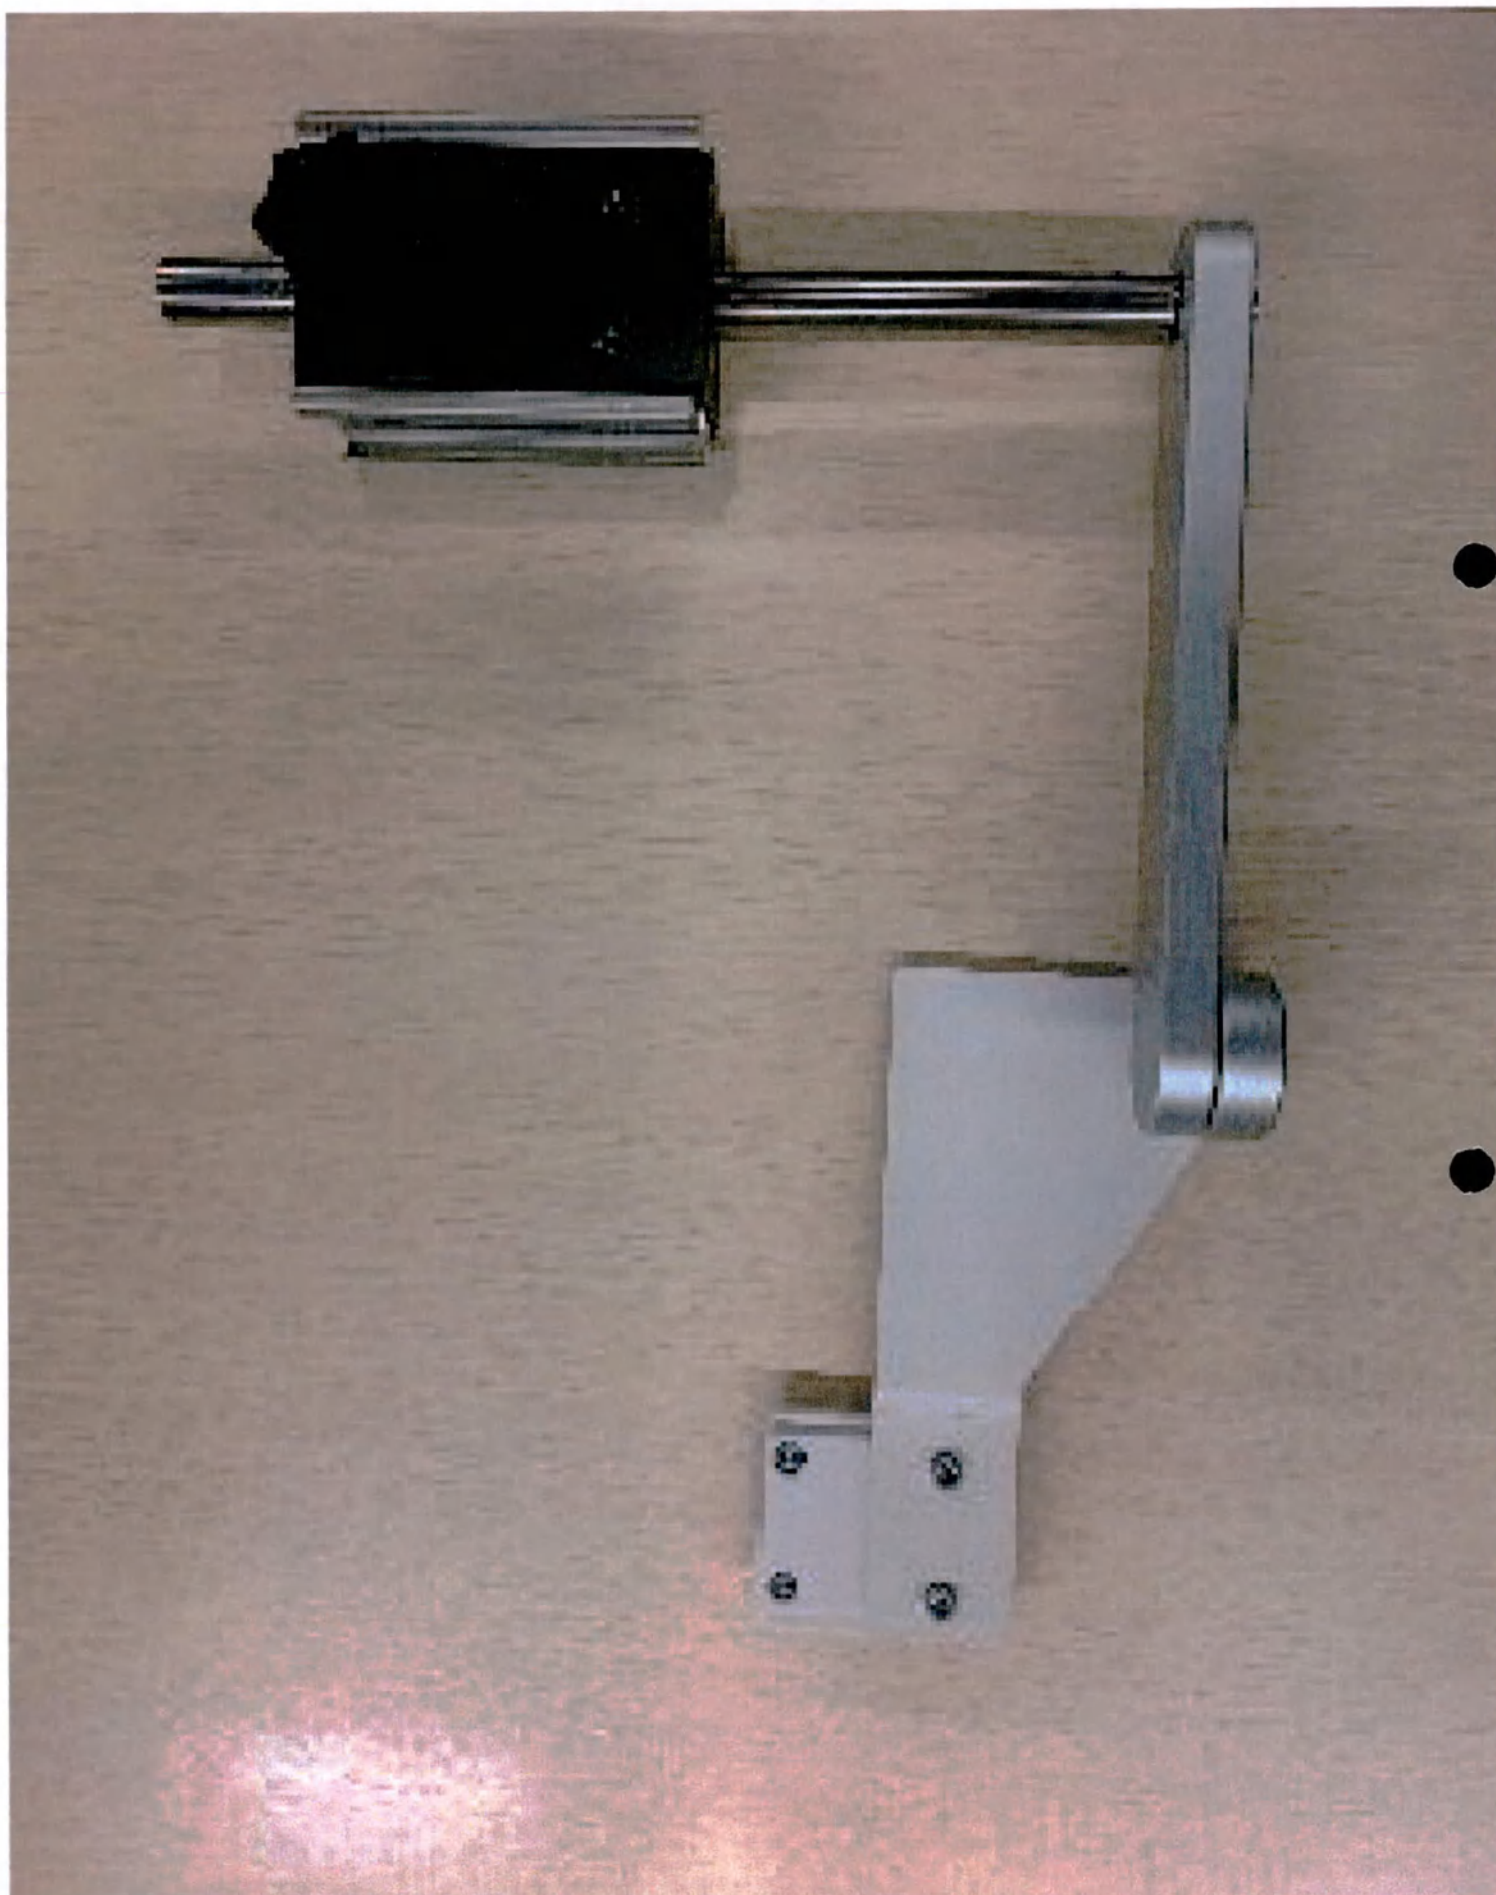


30. Ёмкость для насыпного абсорбента для дыхательного контура с функцией BYPASS – не более 5 шт



31. Ёмкость для предупакованного абсорбента – не более 5 шт.



32. Соединительная трубка с быстросъемным адаптером – не более 20 шт.

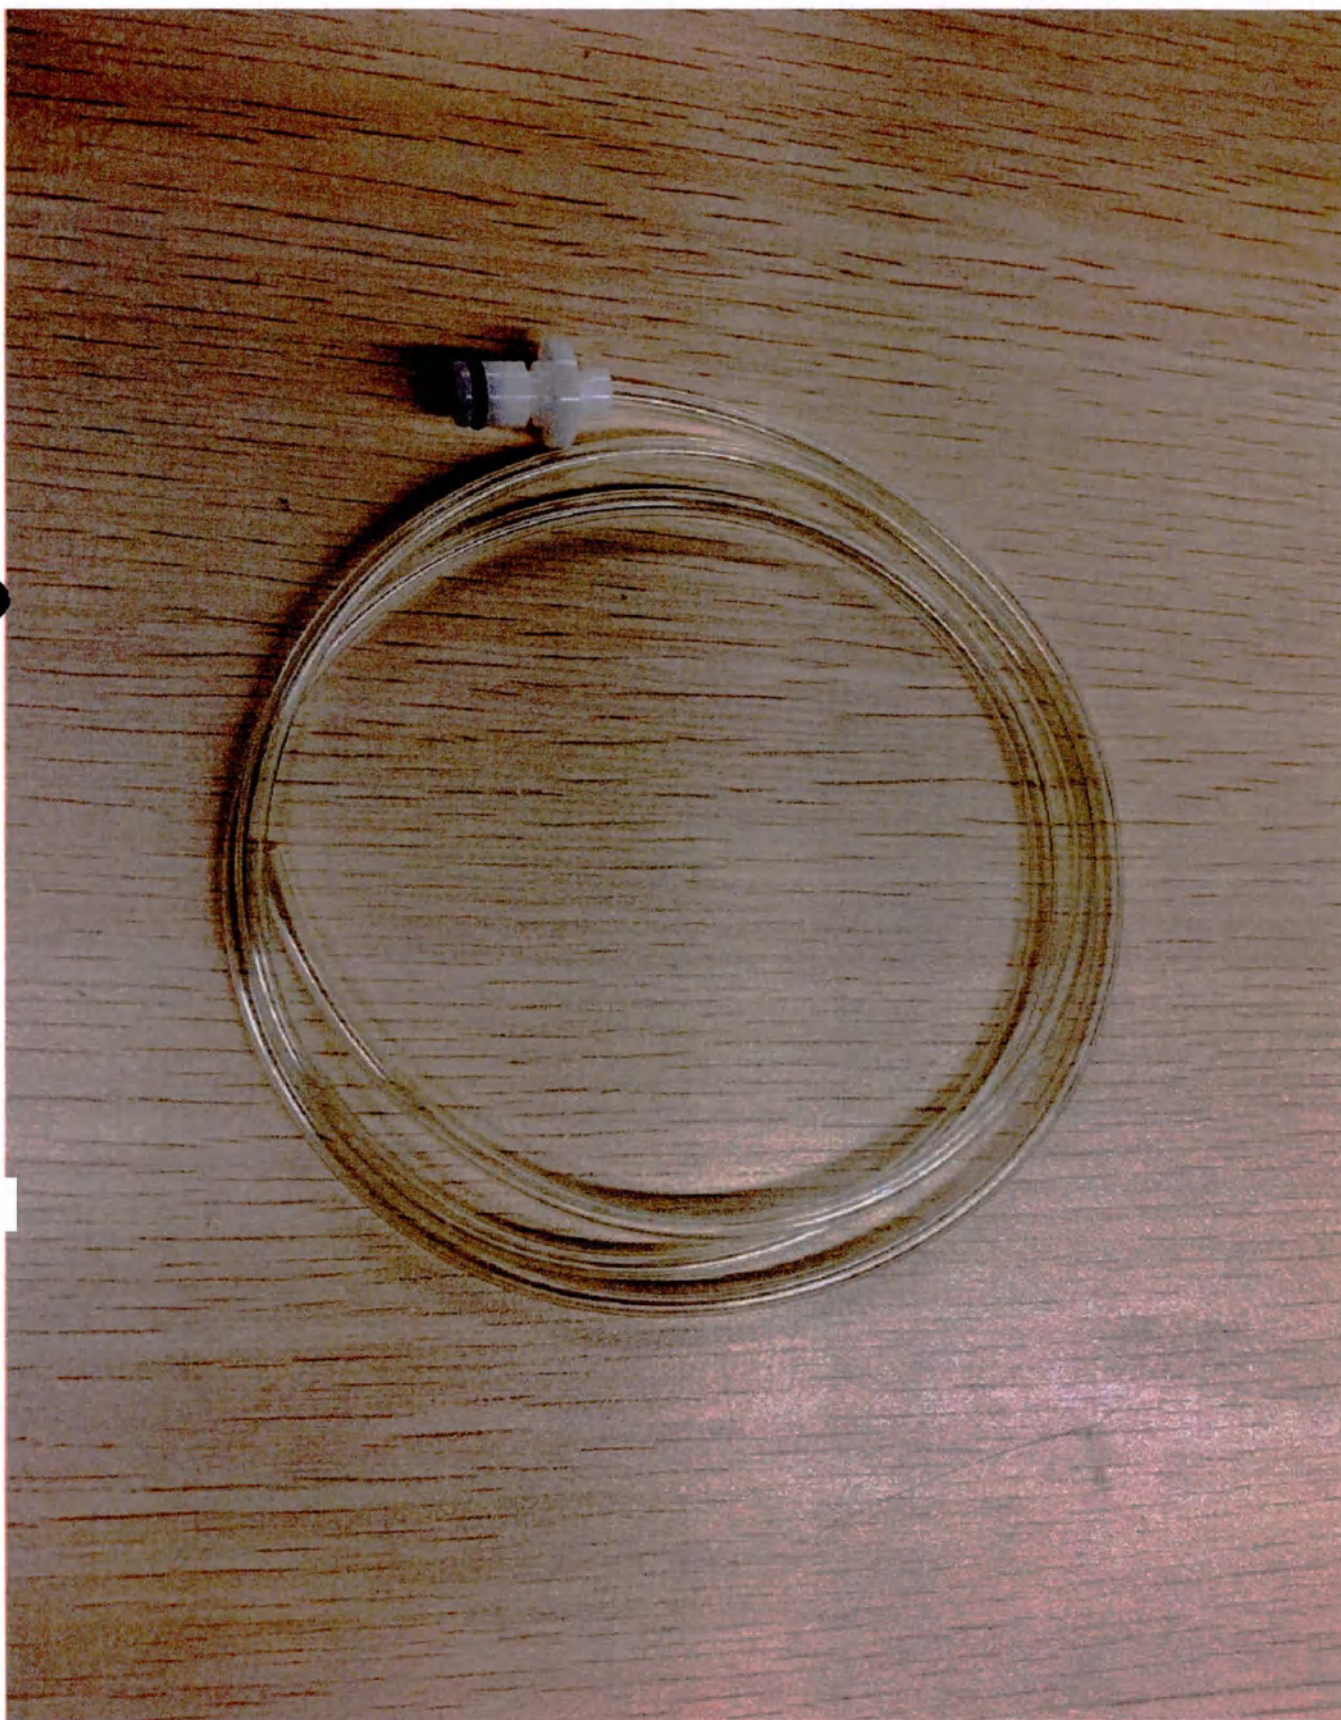

33. Хомут – не более 10 шт.



Упаковка медицинского изделия «Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями: варианты исполнения WATO EX-65, WATO EX-65 Pro»



Фотографическое изображение маркировки основного блока медицинского изделия:

«Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями: варианты исполнения WATO EX-65»



Фотографическое изображение маркировки основного блока медицинского изделия:

«Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями: варианты исполнения WATO EX-65 Pro»



Фотографическое изображение маркировки упаковки медицинского изделия «Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями: варианты исполнения WATO EX-65».

Anesthesia Machine

Model: WATO EX-65 Qty.: 1

Size: 1002mm×880mm×1556mm

N.W.: 140 kg G.W.:

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680
CE 0123
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP
-20°C 60°C 10% 95% 50.0kPa 106.0kPa
XXXXXXXX

mindray

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
W#:
XXXXXXXXXX
P/N:
XXXXXXXXXX
SN
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

047-015139-00(S-0)

Фотографическое изображение маркировки упаковки медицинского изделия «Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями: варианты исполнения WATO EX-65 Pro».

Anesthesia Machine

Model: WATO EX-65 Pro Qty.: 1

Size: 1002mm×880mm×1556mm

N.W.: 140 kg G.W.:

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China
Tel: +86-755-81888998 Fax: +86-755-26582680
CE 0123
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP
-20°C 60°C 10% 95% 50.0kPa 106.0kPa
XXXXXXXX

mindray

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
W#:
XXXXXXXXXX
P/N:
XXXXXXXXXX
SN
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

047-015139-00(S-0)

Макет стикера с русскоязычной маркировкой медицинского изделия: «Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями: варианты исполнения WATO EX-65»

Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями, вариант исполнения WATO EX-65

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Серийный номер и дата производства указаны на оригинальной маркировке изделия

Производитель: «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»

(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)

Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057
Shenzhen, People's Republic of China, Китай

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес:
129110, Россия, г. Москва, в/д.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт,
д.16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39

info.ru@mindray.com

Макет стикера с русскоязычной маркировкой медицинского изделия: «Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями: варианты исполнения WATO EX-65 Pro»

Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями, вариант исполнения WATO EX-65 Pro

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Серийный номер и дата производства указаны на оригинальной маркировке изделия

Производитель: «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»

(Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.)

Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057
Shenzhen, People's Republic of China, Китай

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес:
129110, Россия, г. Москва, в/д.г. муниципальный округ Мещанский, Олимпийский пр-кт,
д.16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39

info.ru@mindray.com

Пролито, прокумеровано 78 лет

