

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система мониторинга физиологических показателей с
принадлежностями Carescape One**


производства


GE Medical Systems Information Technologies, Inc. / «ДжиИ Медикал Системз Информейшн
Технолоджиз, Инк.», США

1. Монитор Carescape One






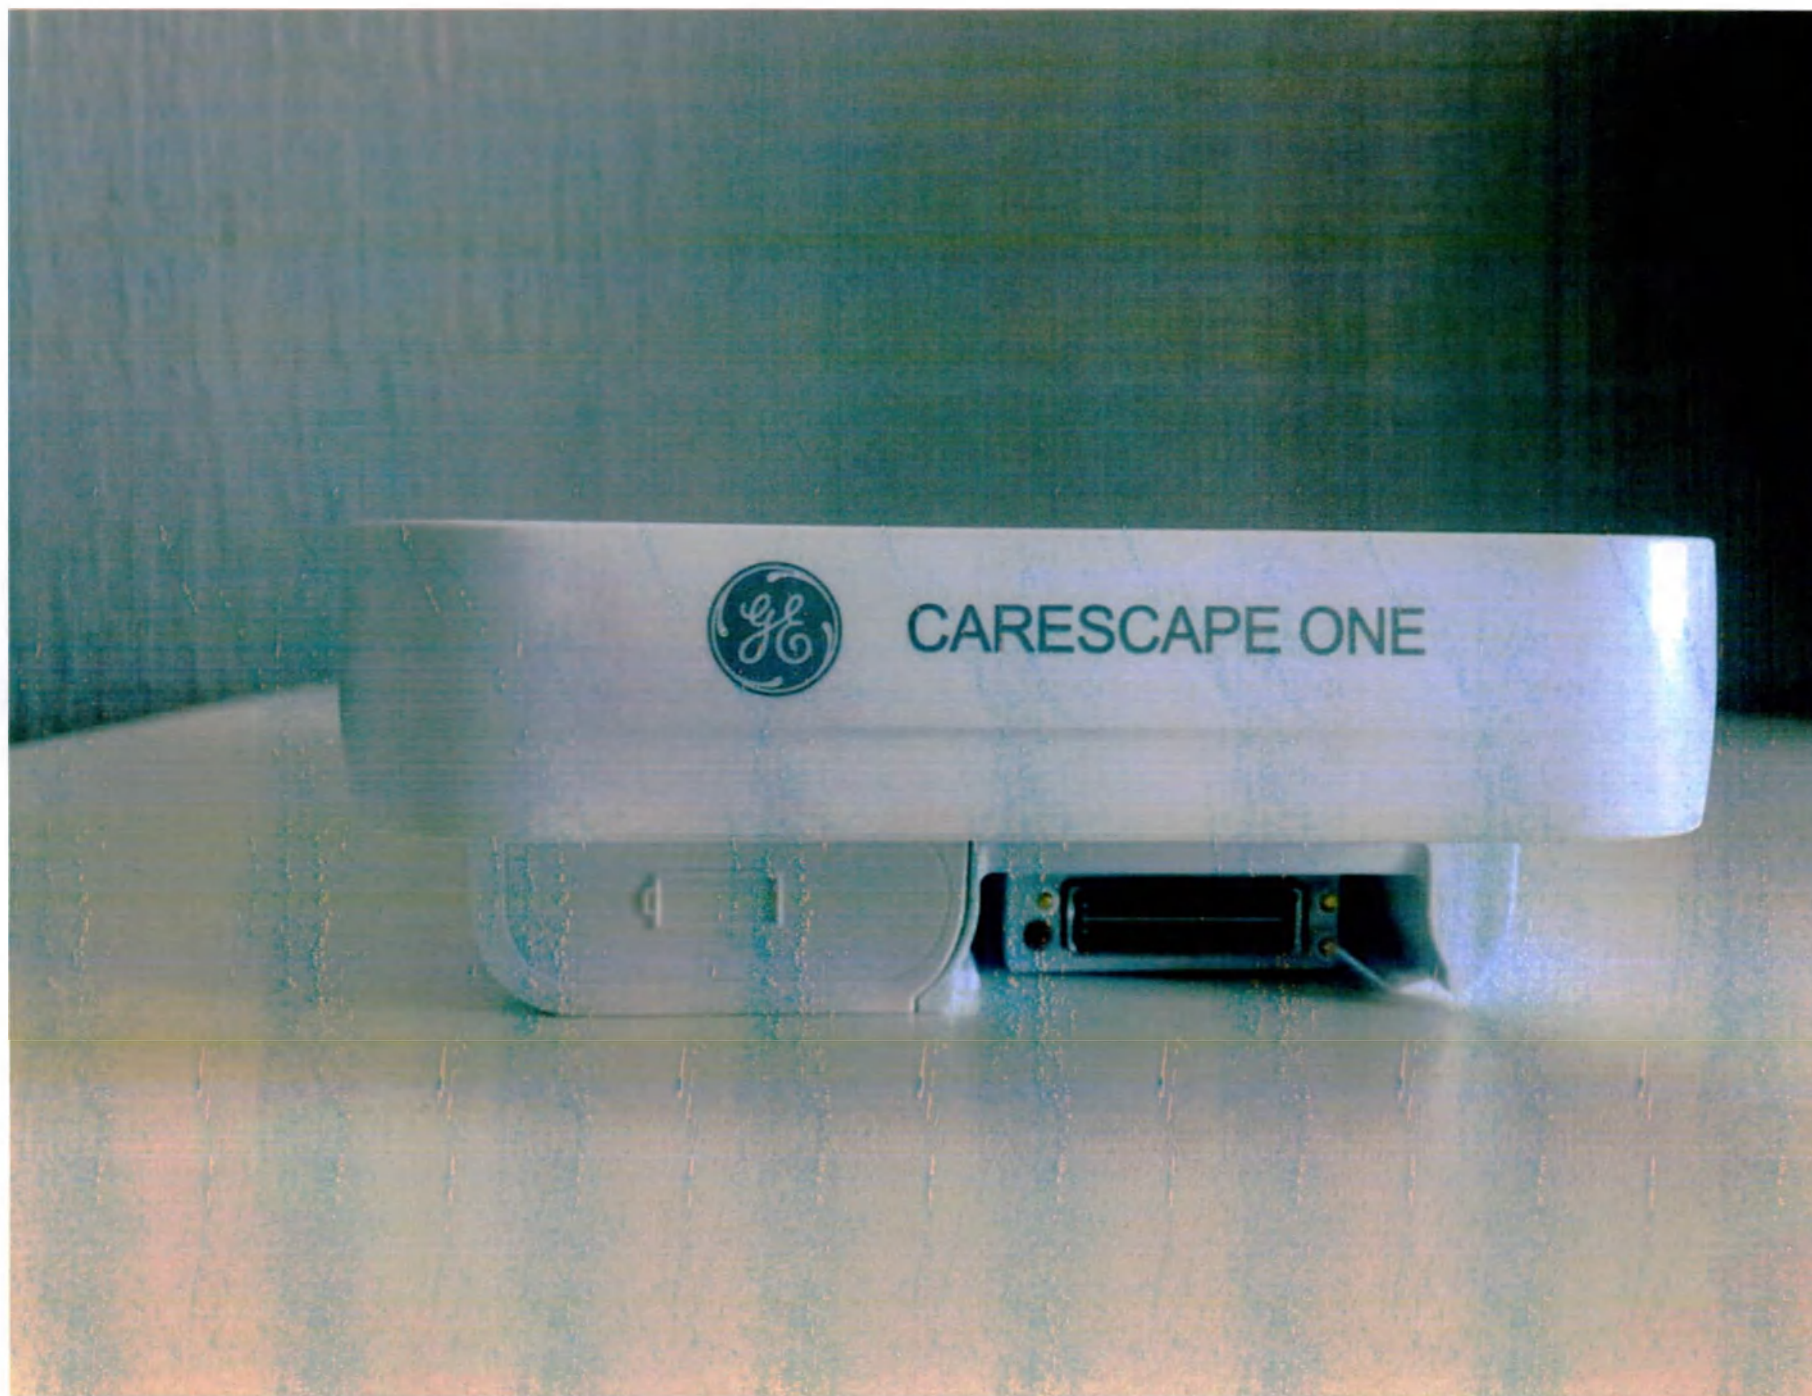

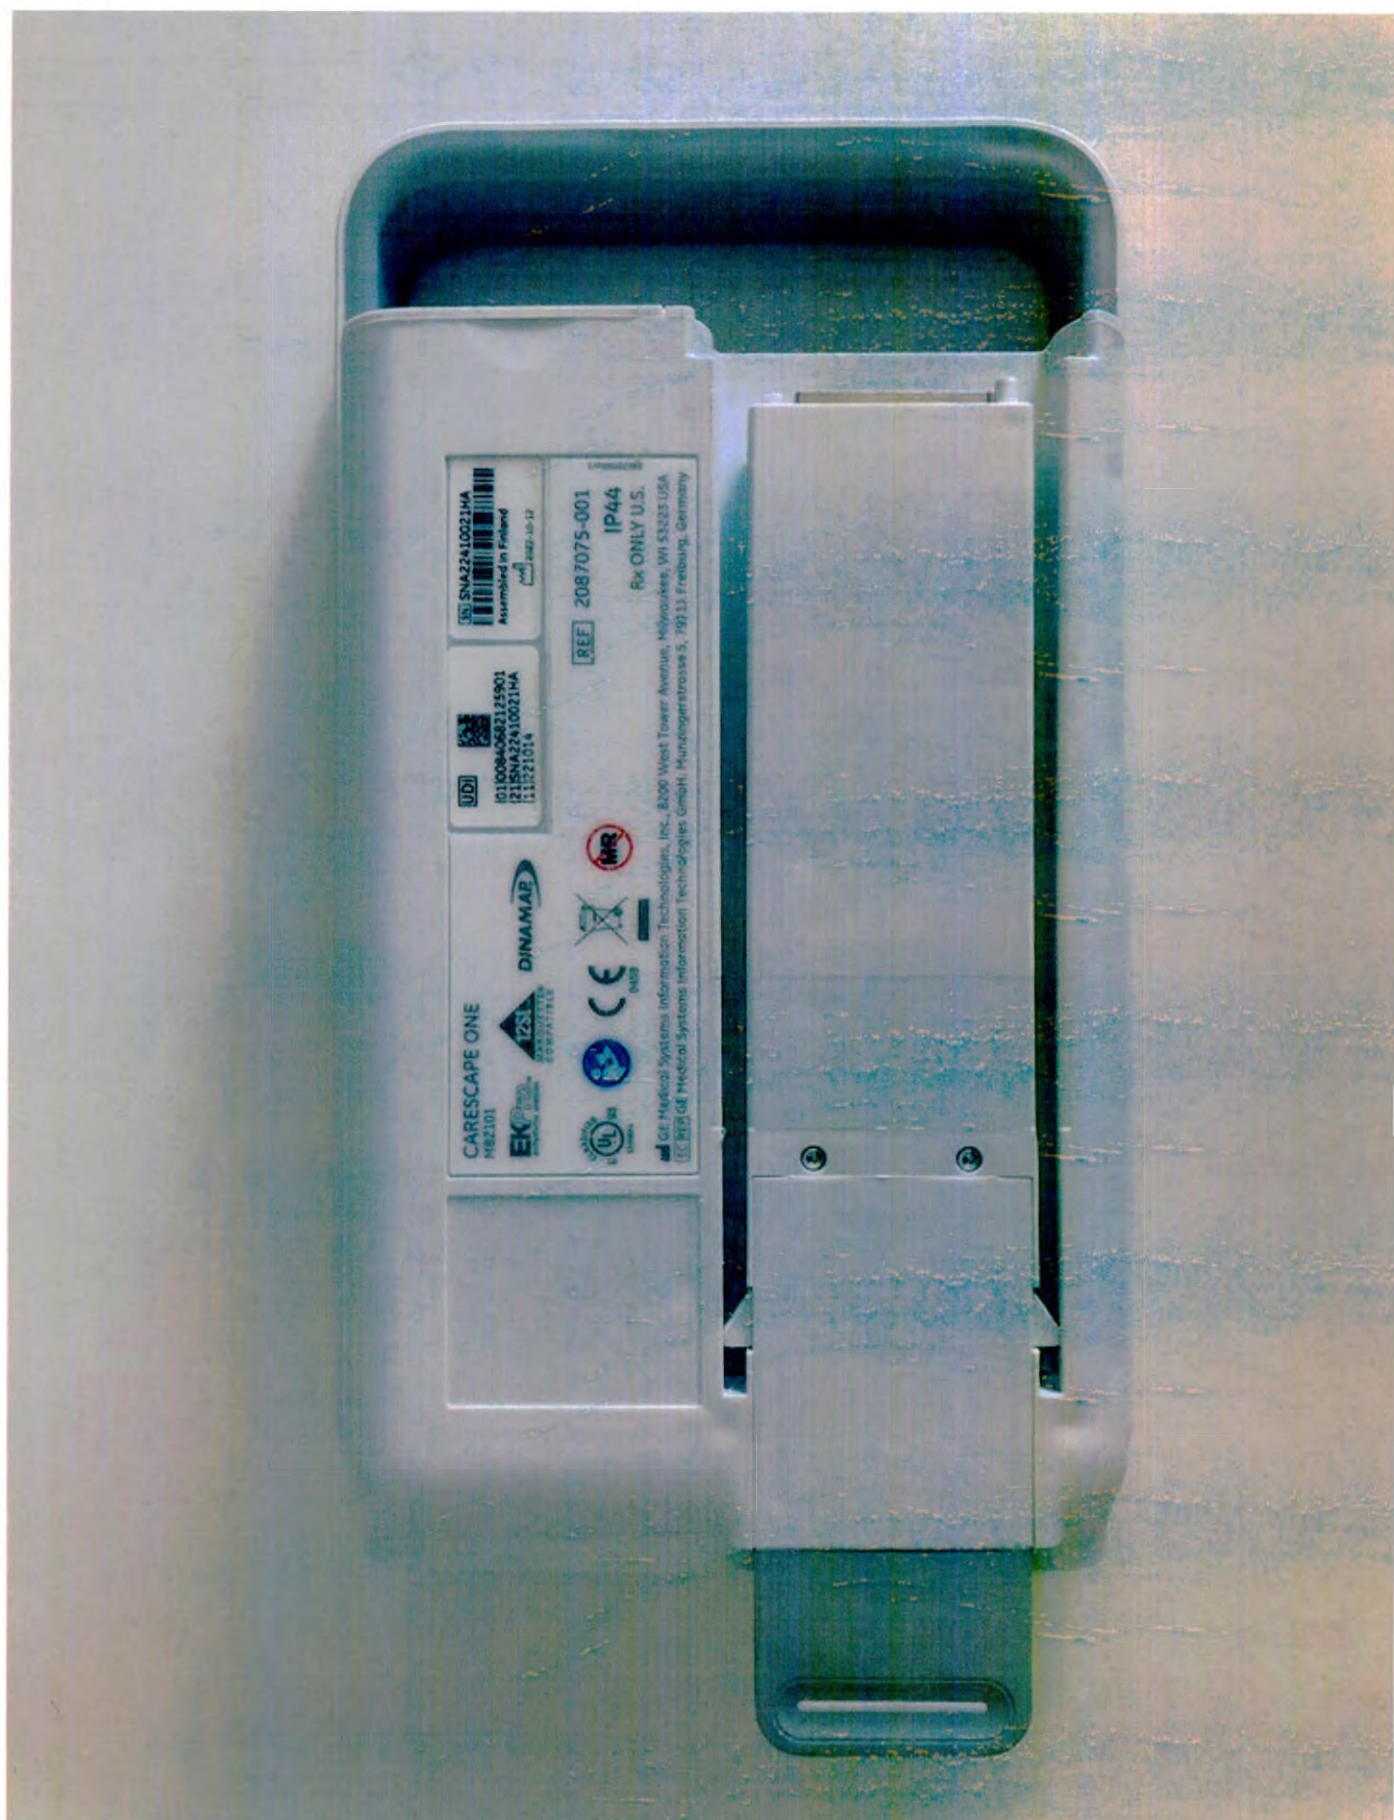

2. Кабели питания (не более 10 шт.).

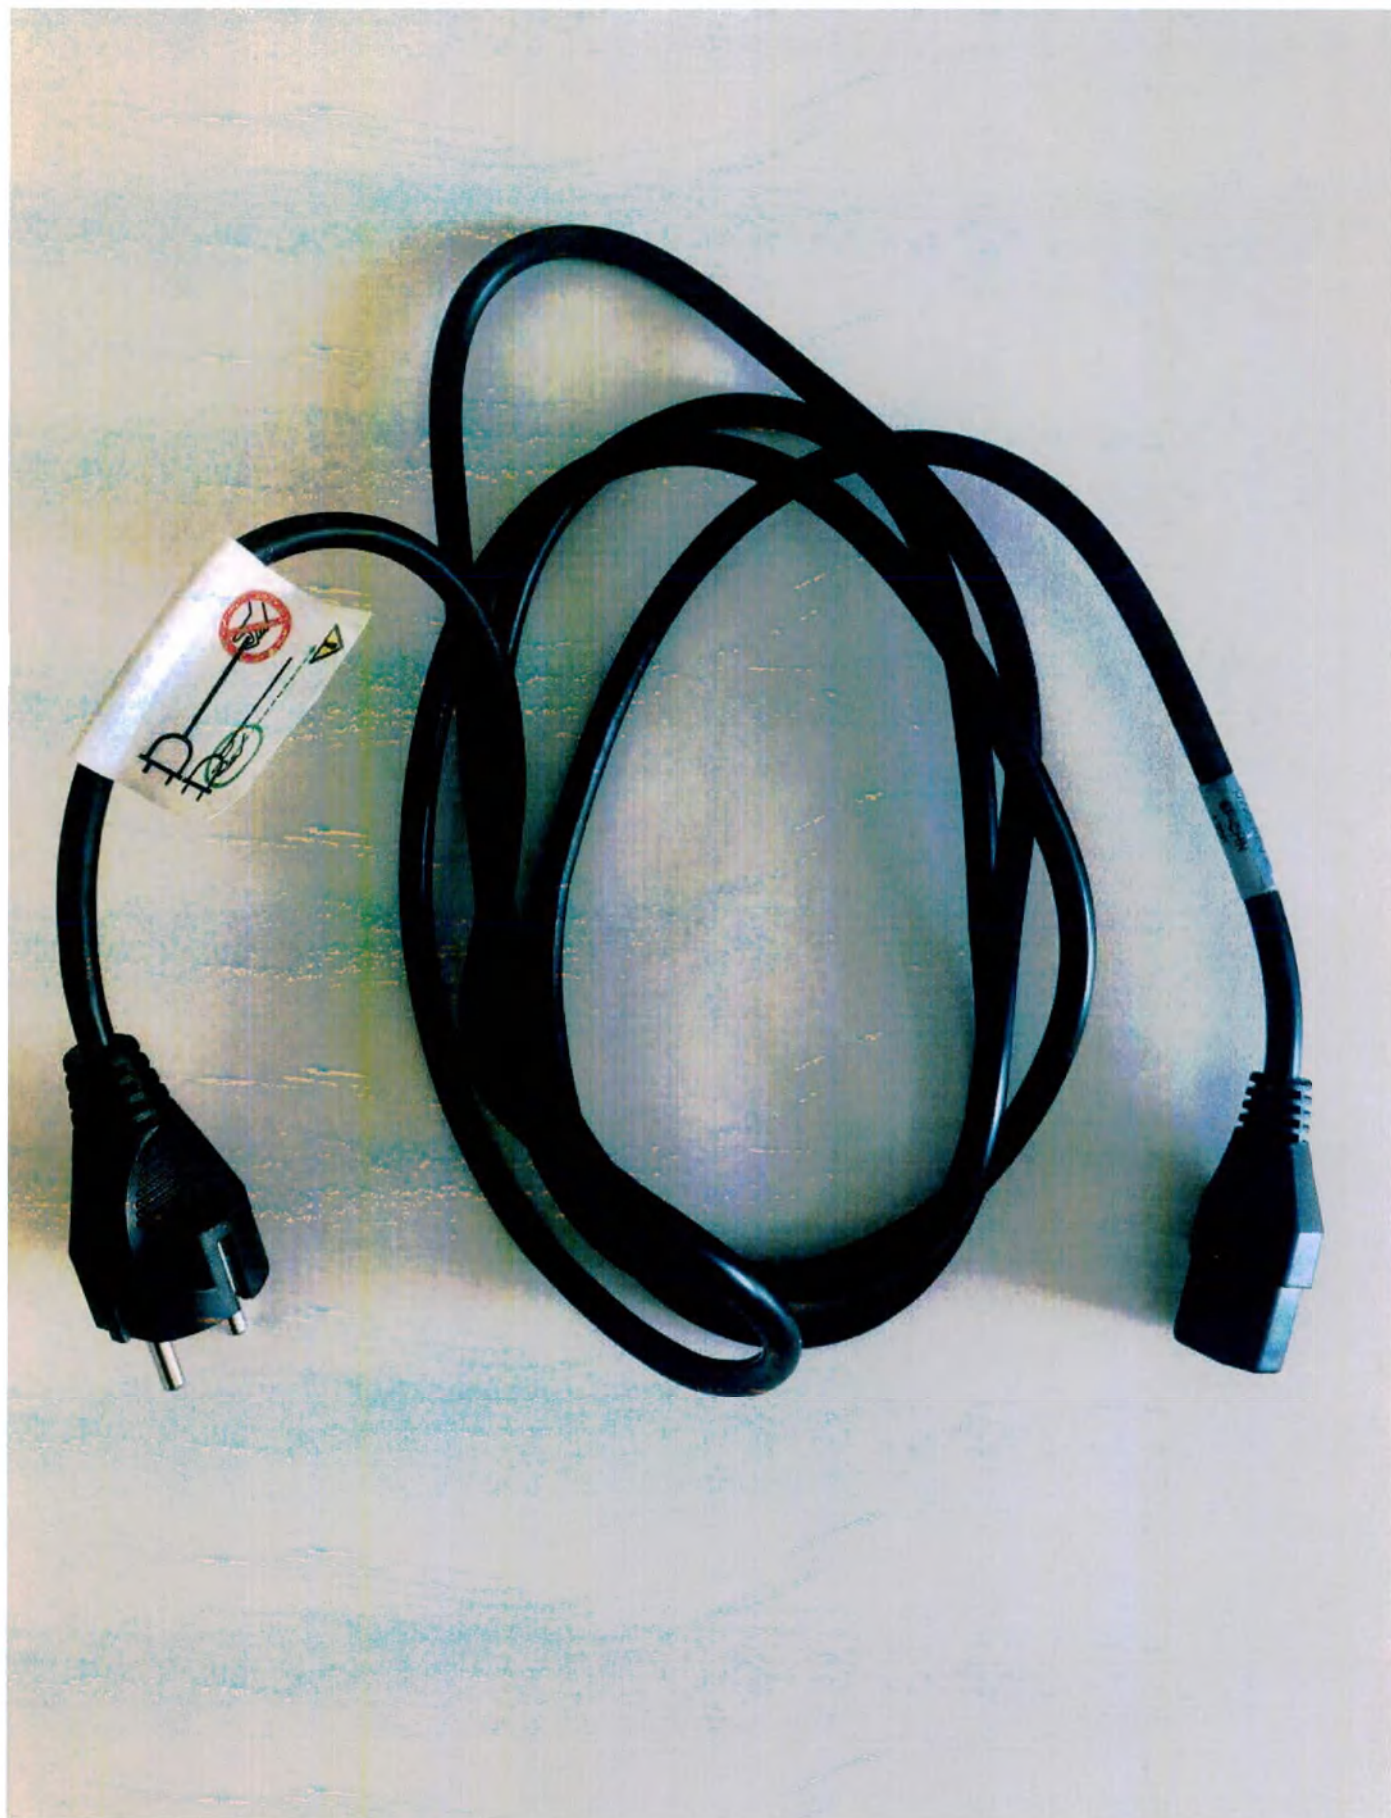

3. Эксплуатационная документация (не более 10 шт.) (при необходимости).

CARESCAPE ONE

Руководство пользователя


Программное обеспечение версии 3.2



County of Waukesha

I Certify this is a true and correct copy of a document in possession of ANSSI RUCKENEN needed on 29-Nov-2023


Anssi Ruckenen
Program Manager, Regulatory Affairs
GE Medical Systems Information Technologies Inc.
24 November 2023

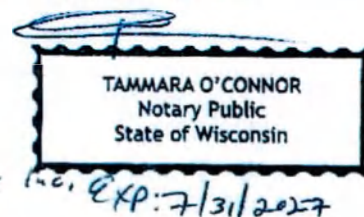

CARESCAPE ONE
Russian/Русский
3-е издание
5825065-28
© 2020-2022 General Electric Company.
Все права защищены.

Система мониторинга физиологических показателей с принадлежностями Carescape
One
Physiological Monitoring System Carescape One with Accessories

Addendum to user manual for the Russian Federation
Приложение к руководству пользователя для Российской Федерации.

Configurations for the Russian Federation.
Конфигурация для Российской Федерации.

20 May 2024

«Approved»
GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
Program Manager, Regulatory Affairs, Monitoring Solutions



Anssi Ruokonen
GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

County of Waukesha

I Certify this is a true and correct copy of a
document in possession of ANSSI RUOKONEN
copied on 29-MAY-2024


GE Medical Systems Information
Technologies, Inc.
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
USA





TAMMARA O'CONNOR
Notary Public
State of Wisconsin


EXP: 7/31/2027

4. Блок питания (не более 10 шт.).

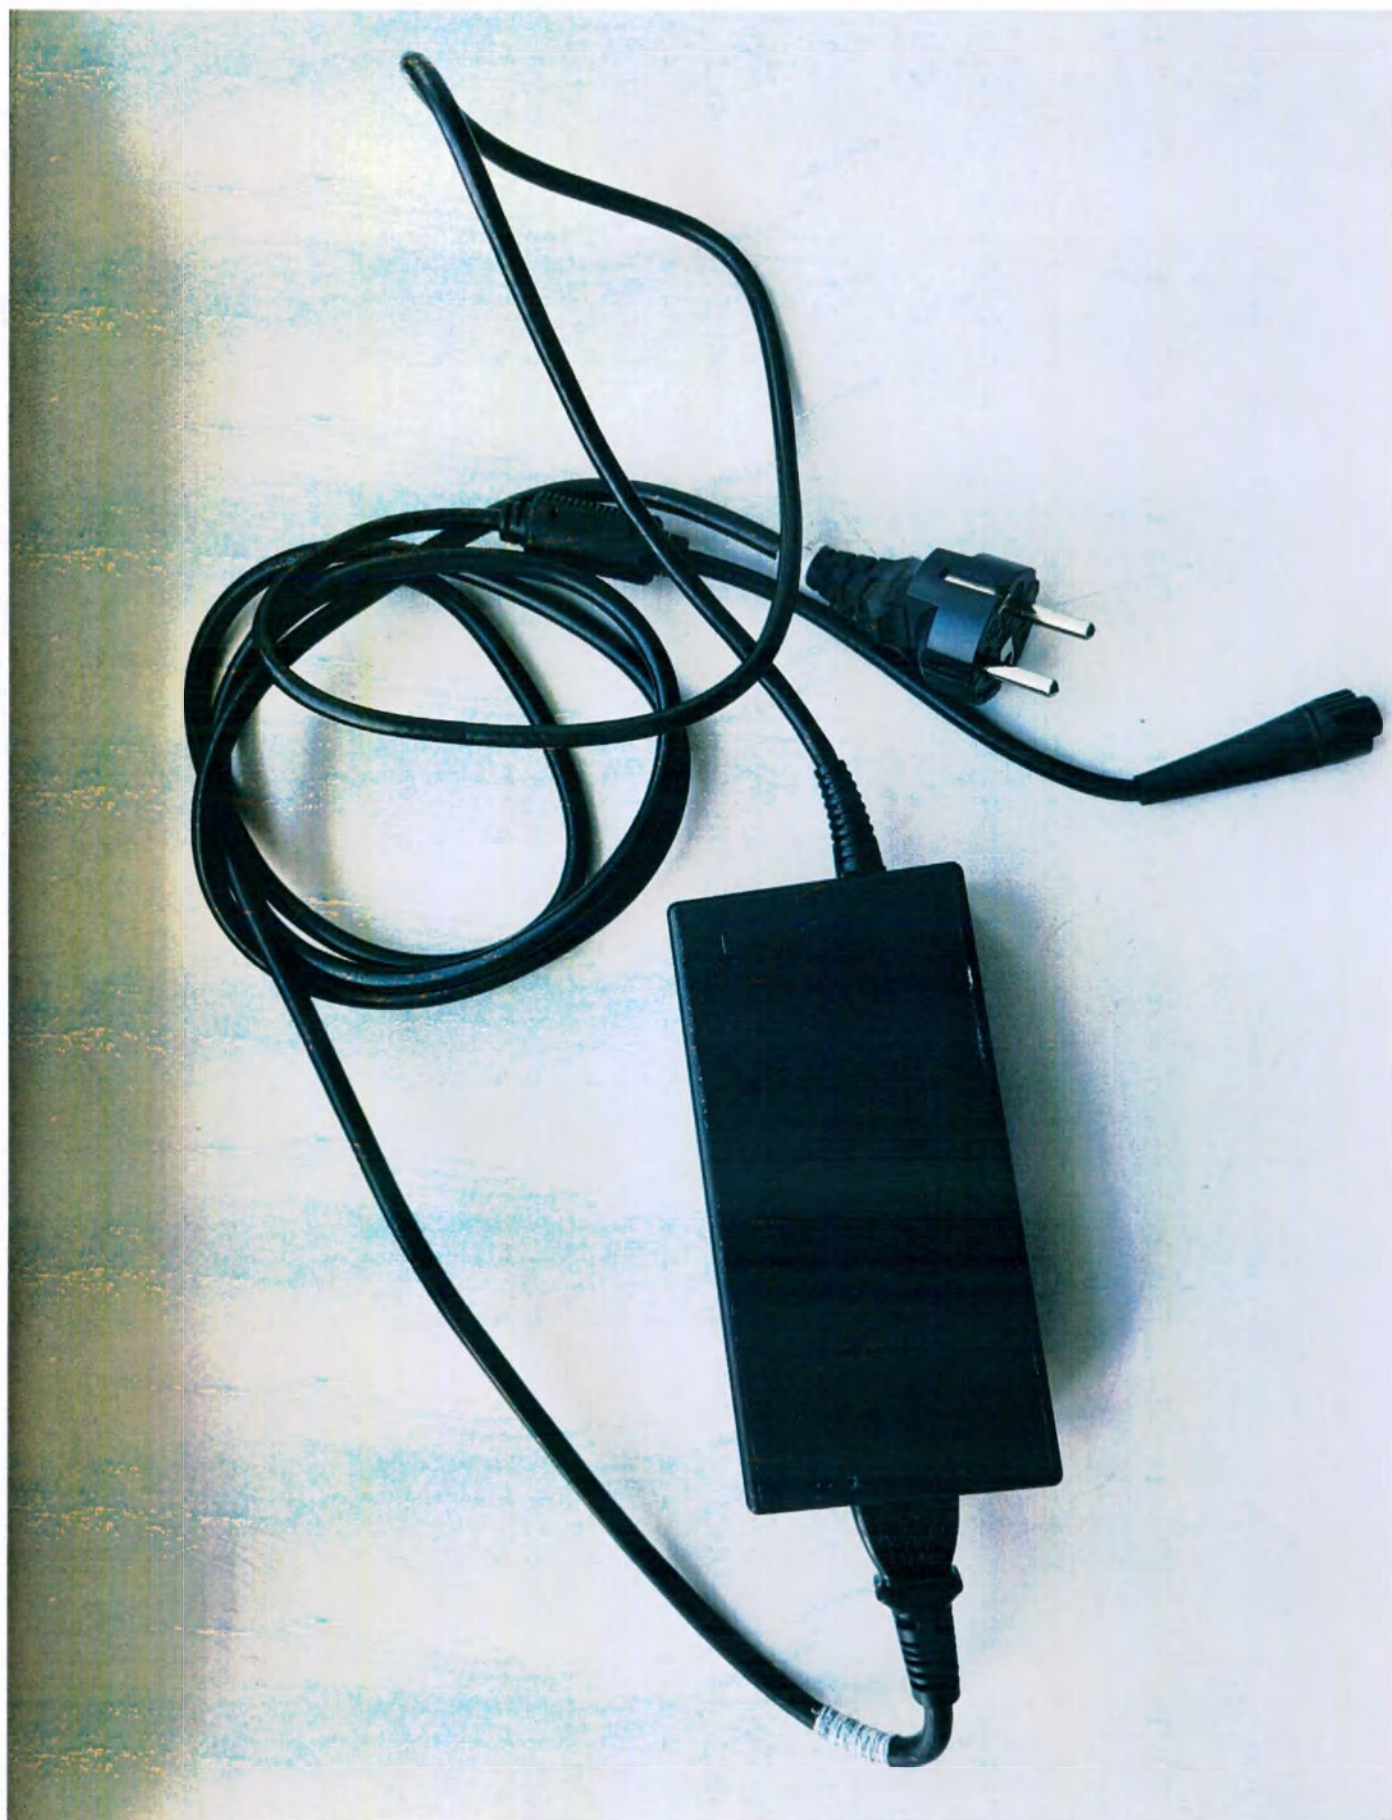



5. Док-станции монитора, вариант исполнения CARESCAPE Dock F0 (не более 5 шт.) (при необходимости).

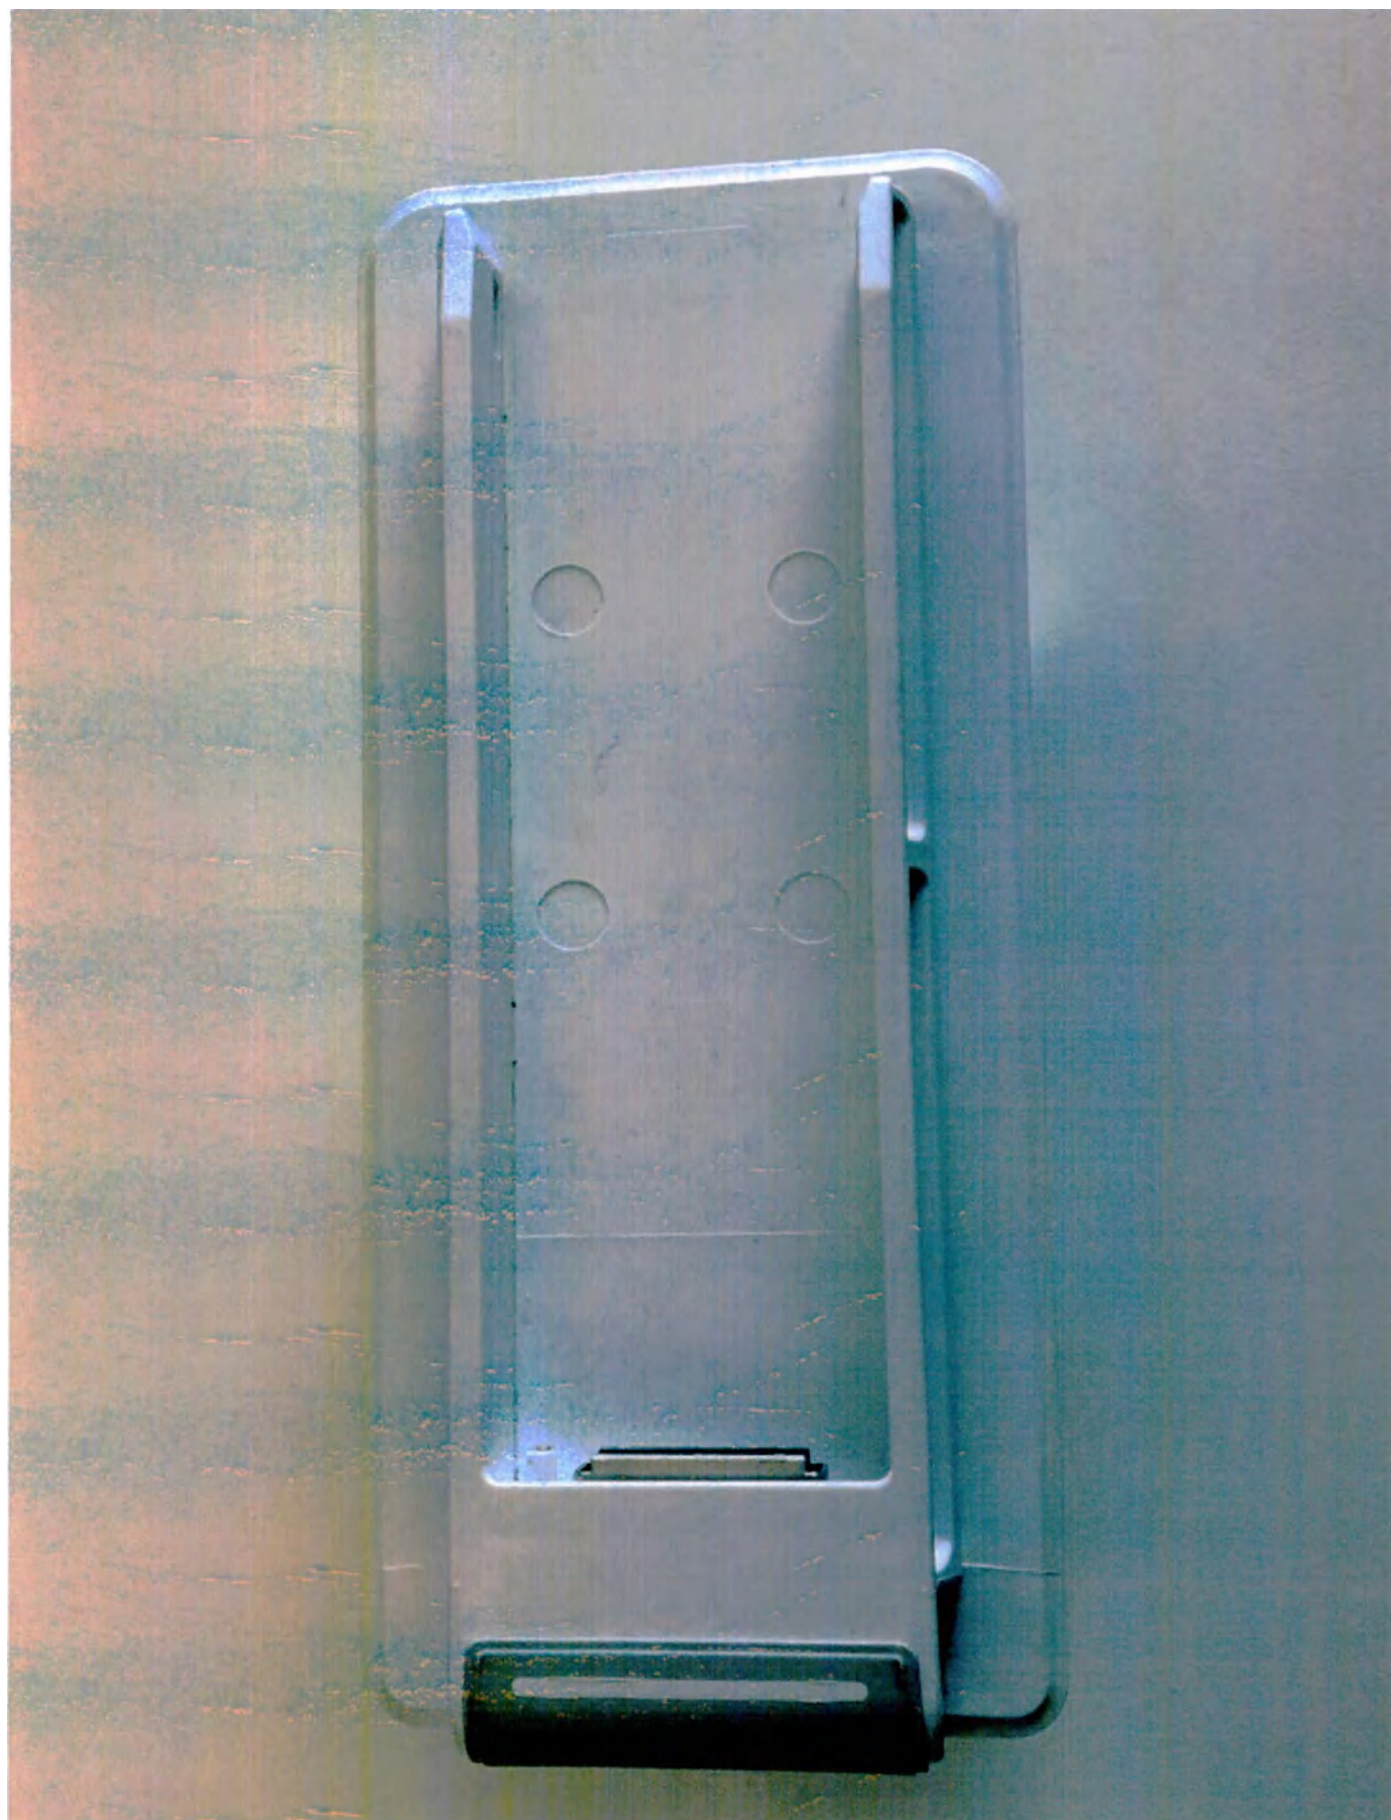

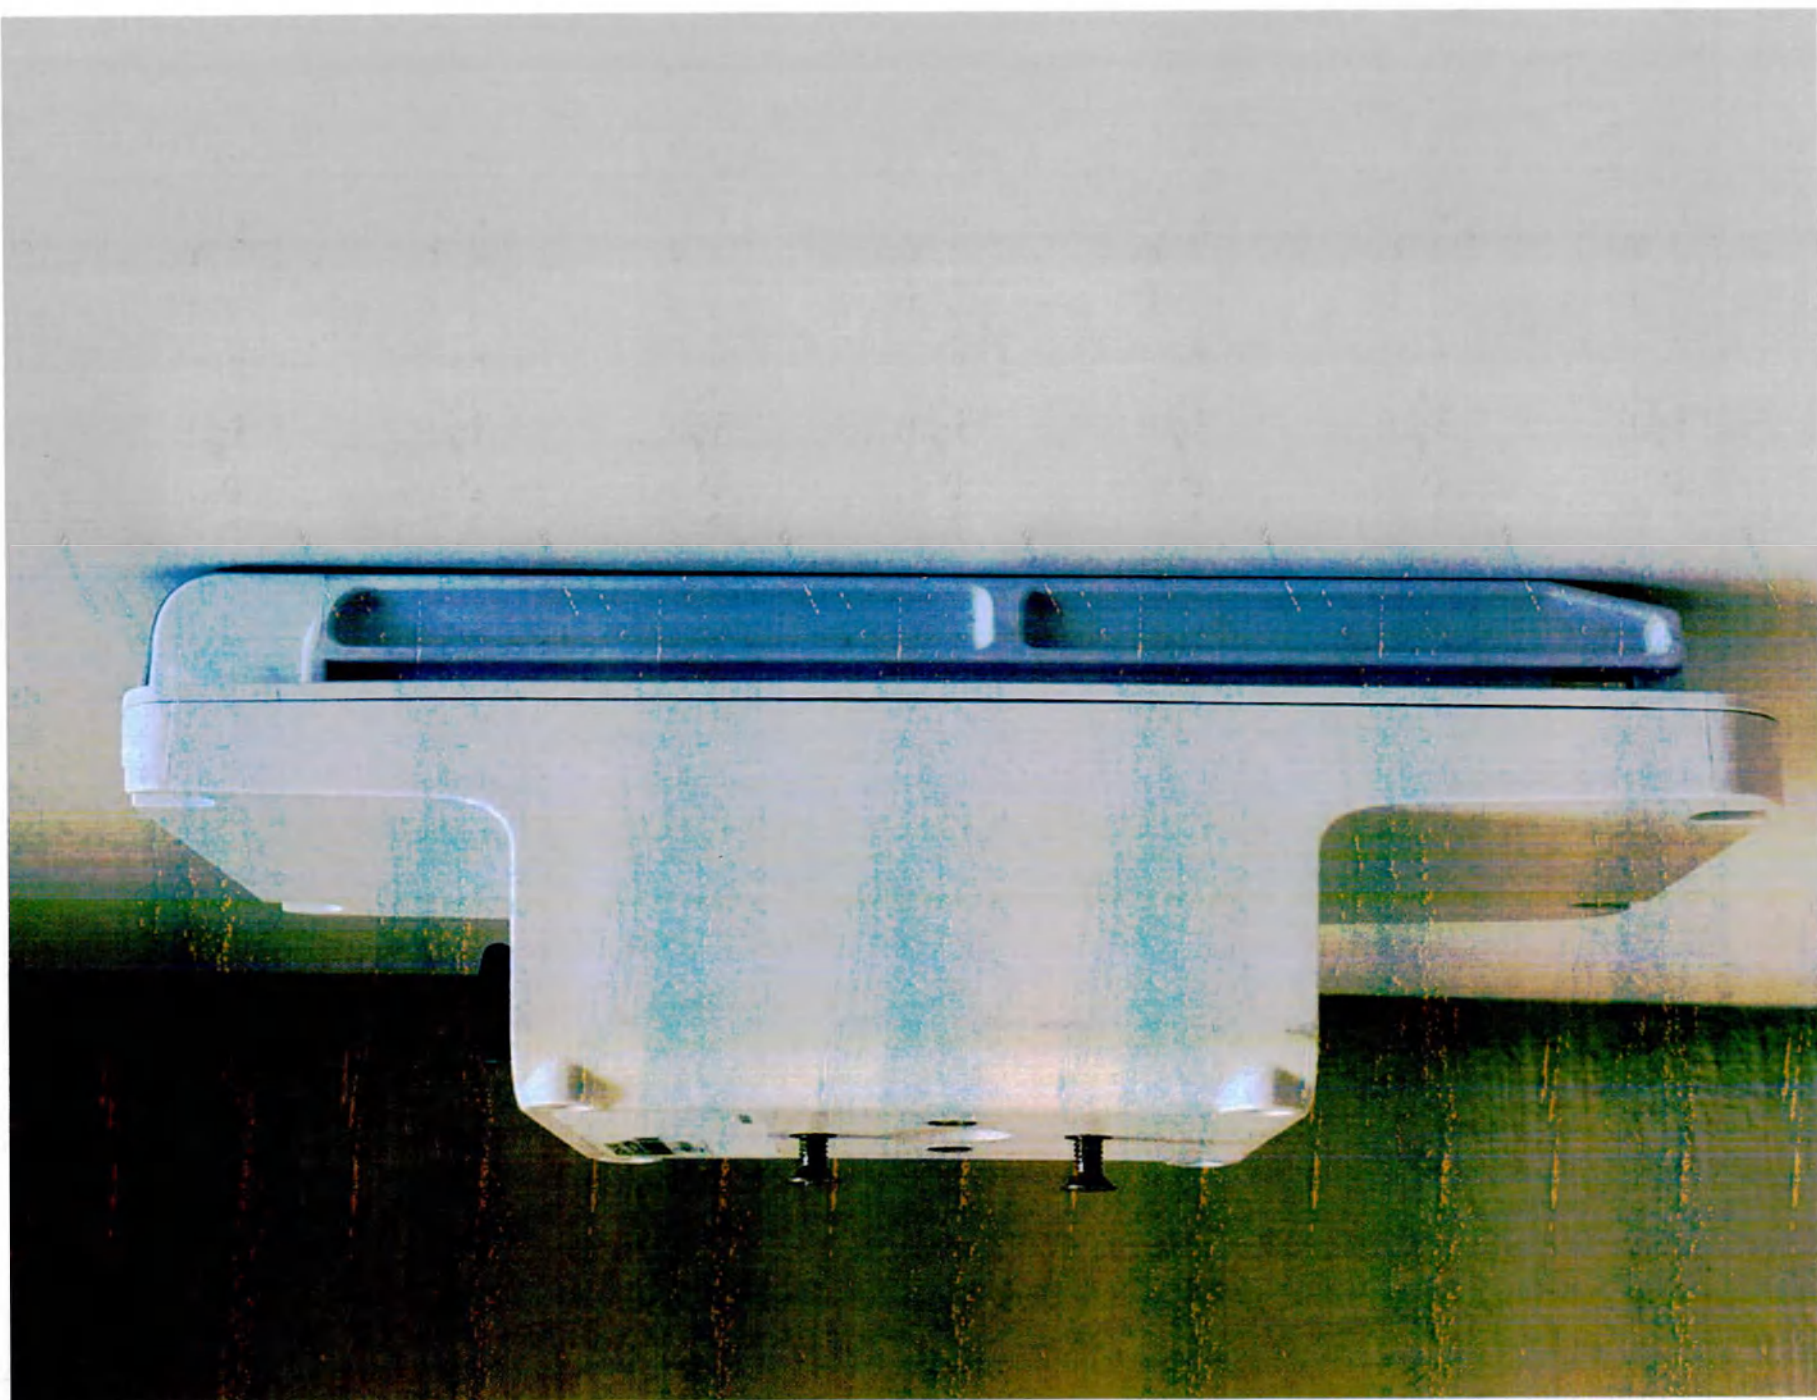


6. Аккумулятор (не более 5 шт.) (при необходимости).

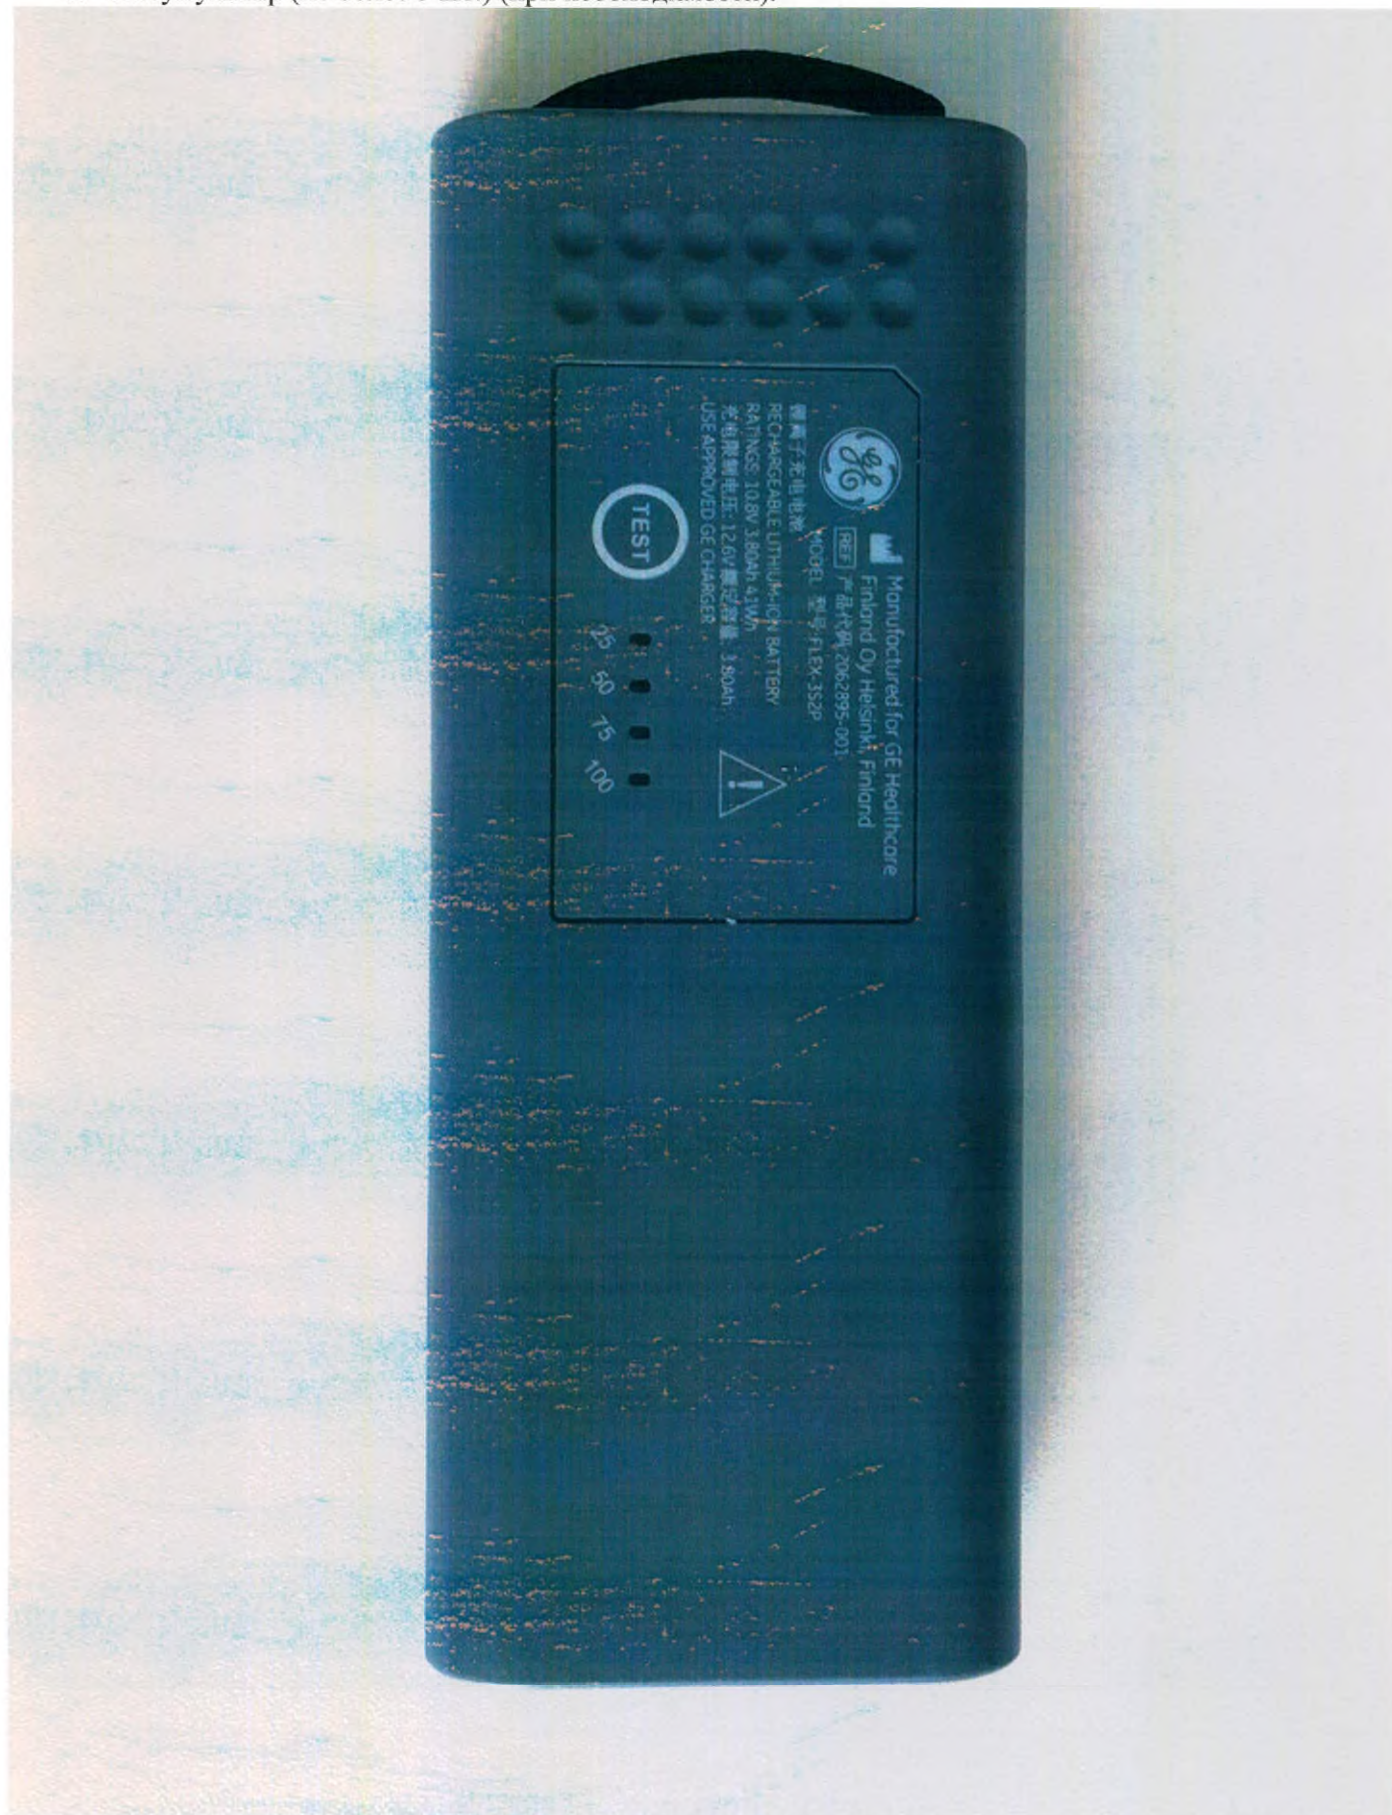


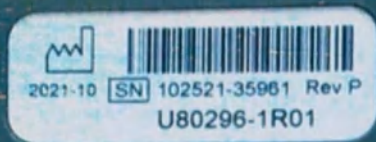

7. Модули капнометрии (не более 10 шт.) (при необходимости).

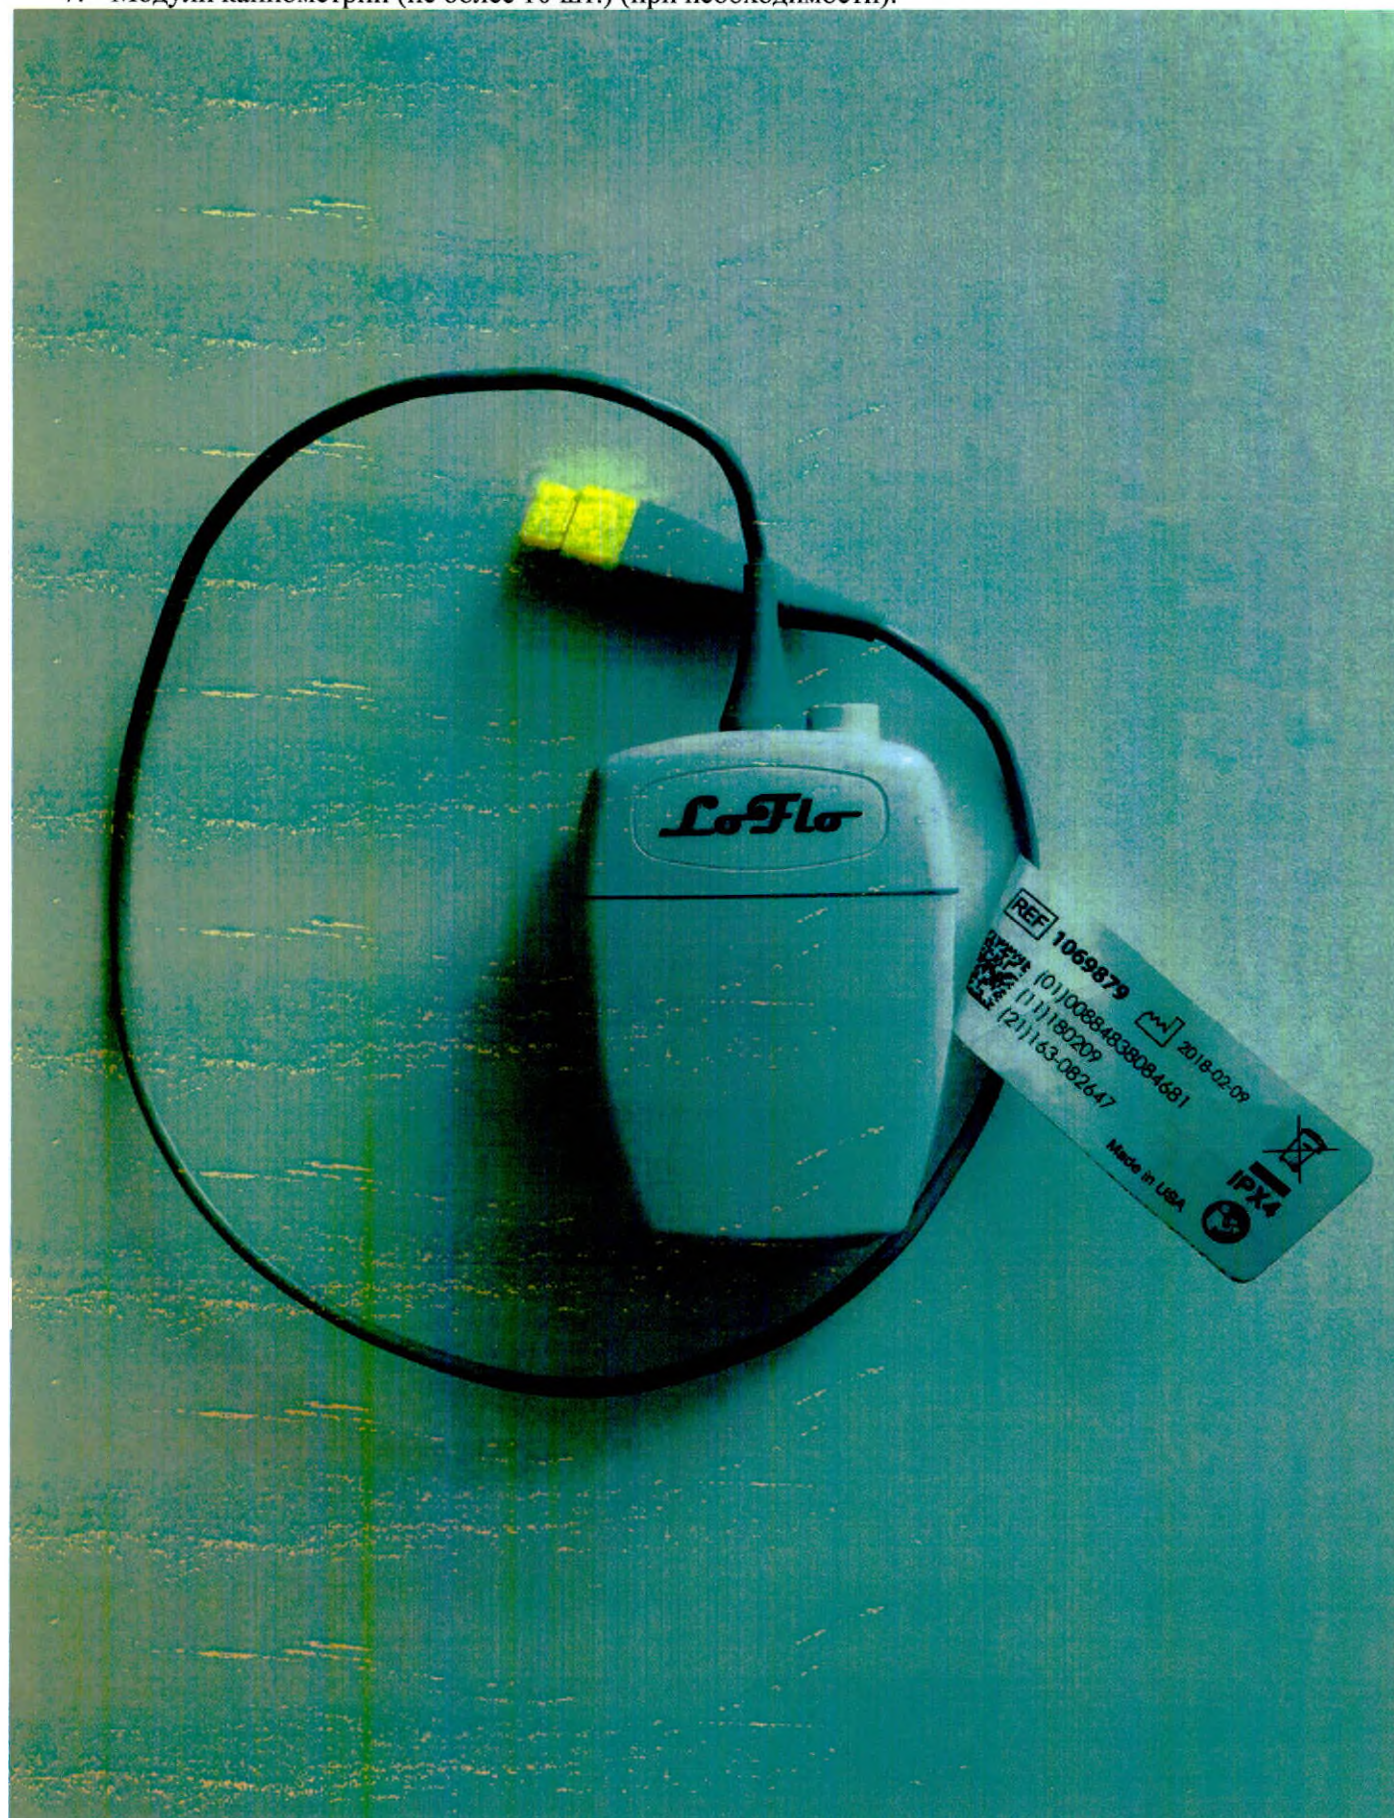

8. Кабели капнометрии CARESCAPE CO₂ – LoFlo (не более 10 шт.) (при необходимости).

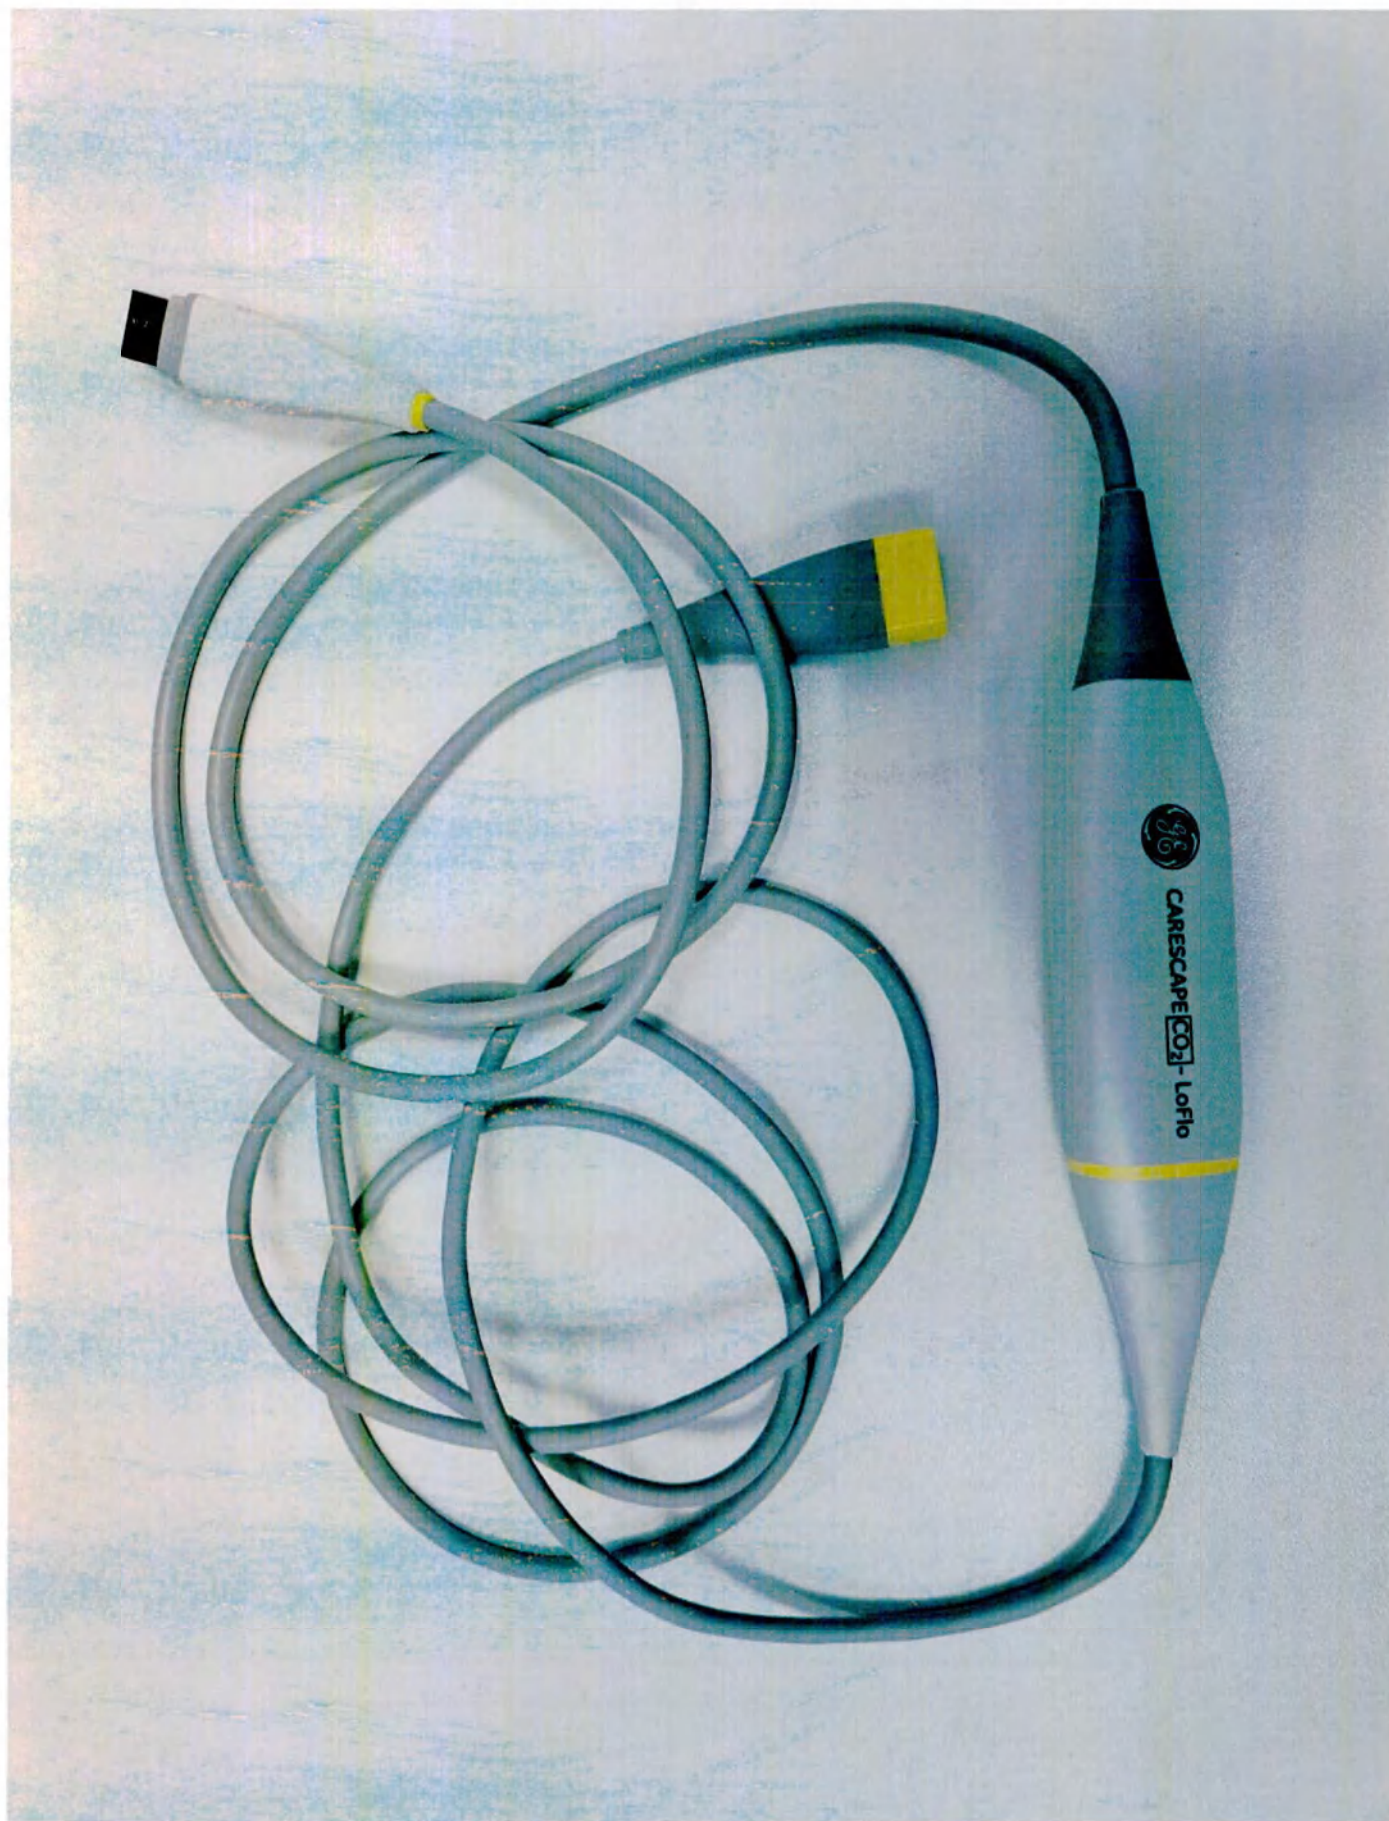


9. Лицензии ПО (не более 100 шт.), в составе: «Отделение интенсивной терапии», «Отделение экстренной помощи» (при необходимости), «Неонатальное отделение интенсивной терапии» (при необходимости), «Операционная» (при необходимости), «Отделение постнаркозного наблюдения» (при необходимости)




Лицензии ПО (не более 100 шт.), в составе: «Отделение интенсивной терапии»




Лицензии ПО (не более 100 шт.), в составе: «Отделение экстренной помощи» (при необходимости)

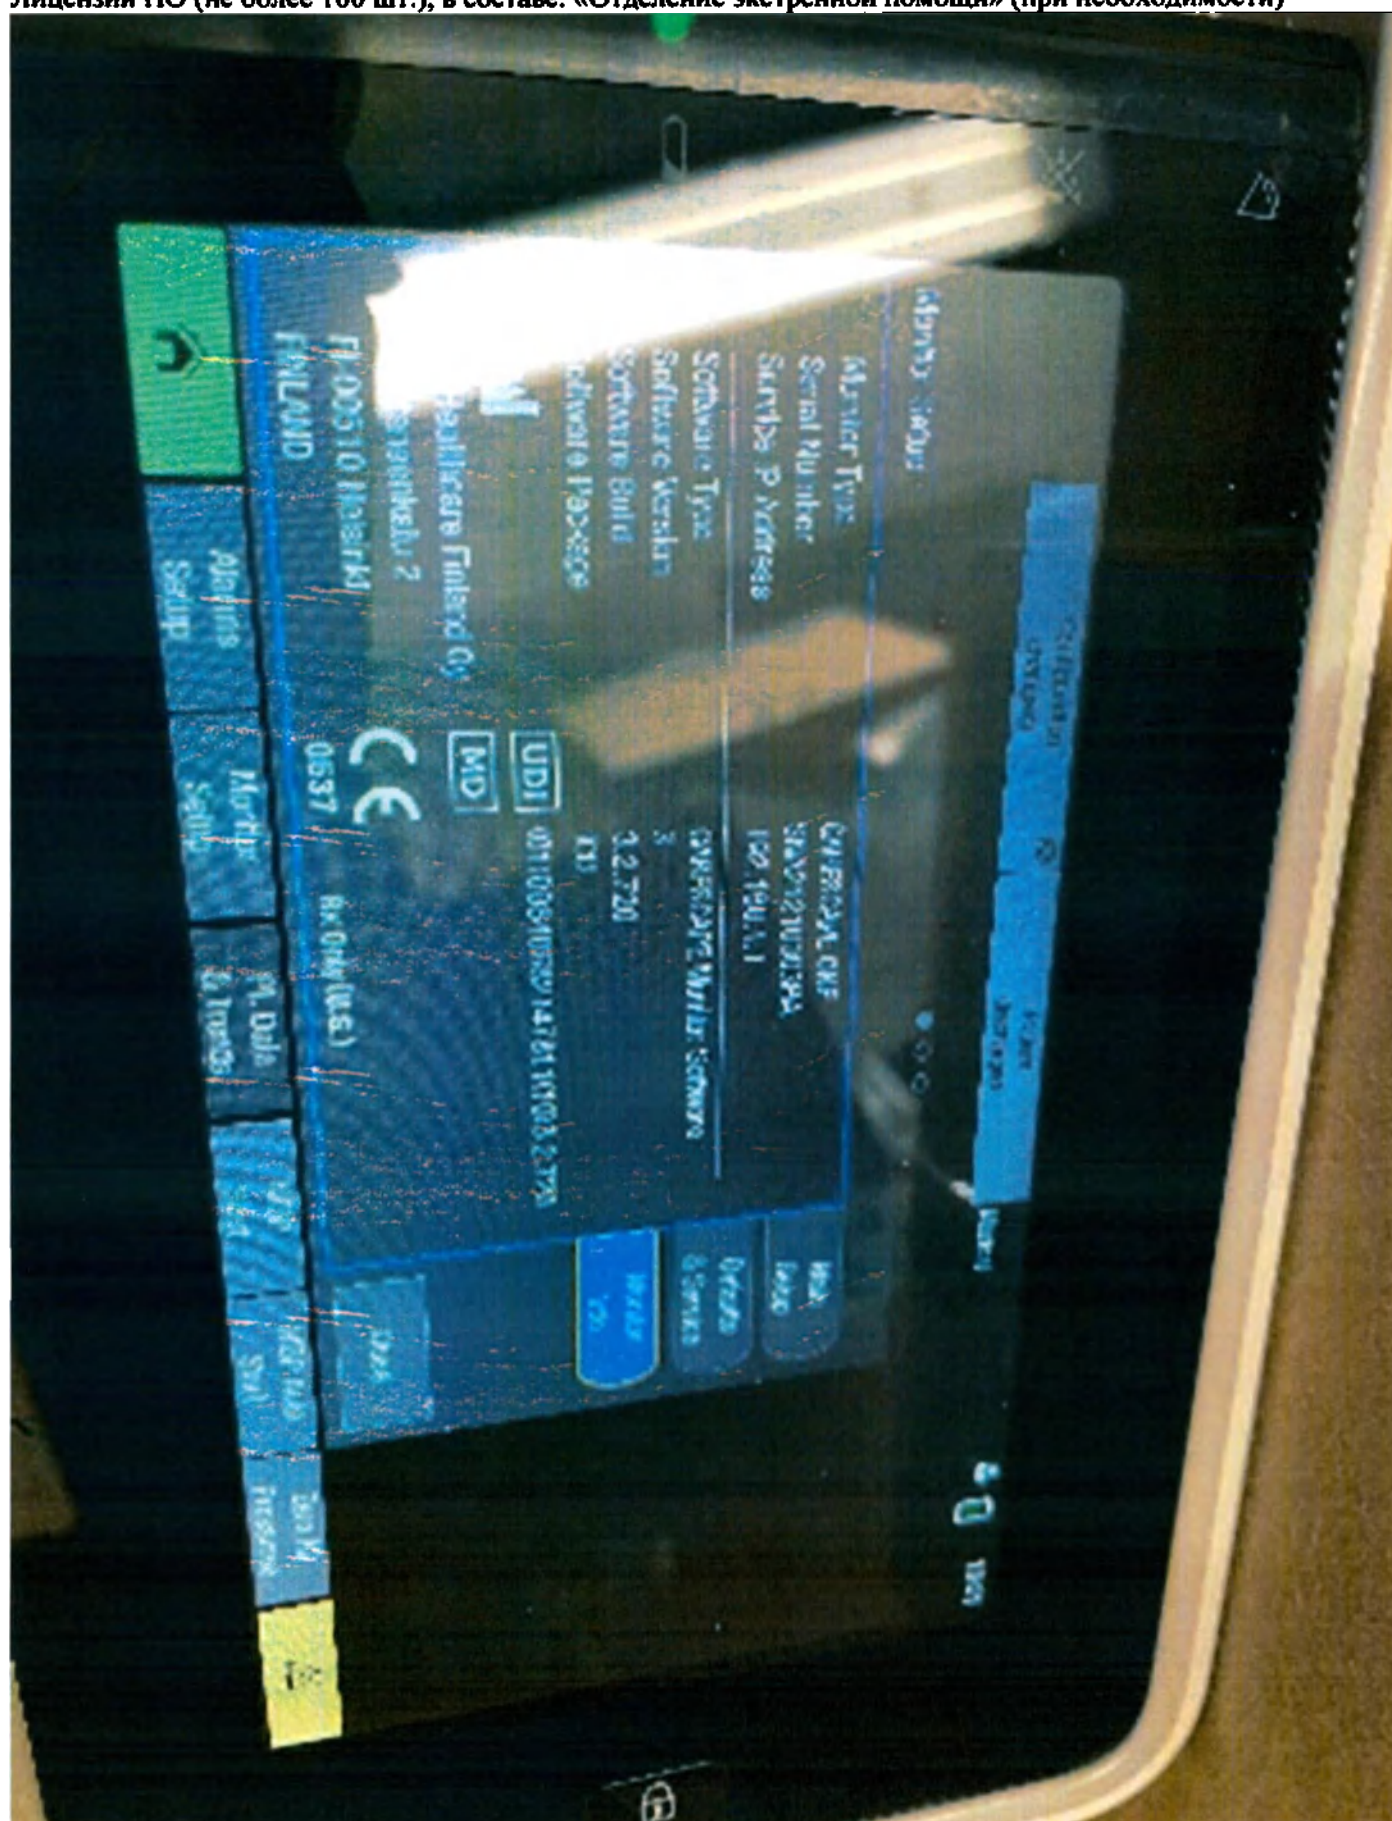


Лицензии ПО (не более 100 шт.), в составе: «Неонатальное отделение интенсивной терапии» (при необходимости)

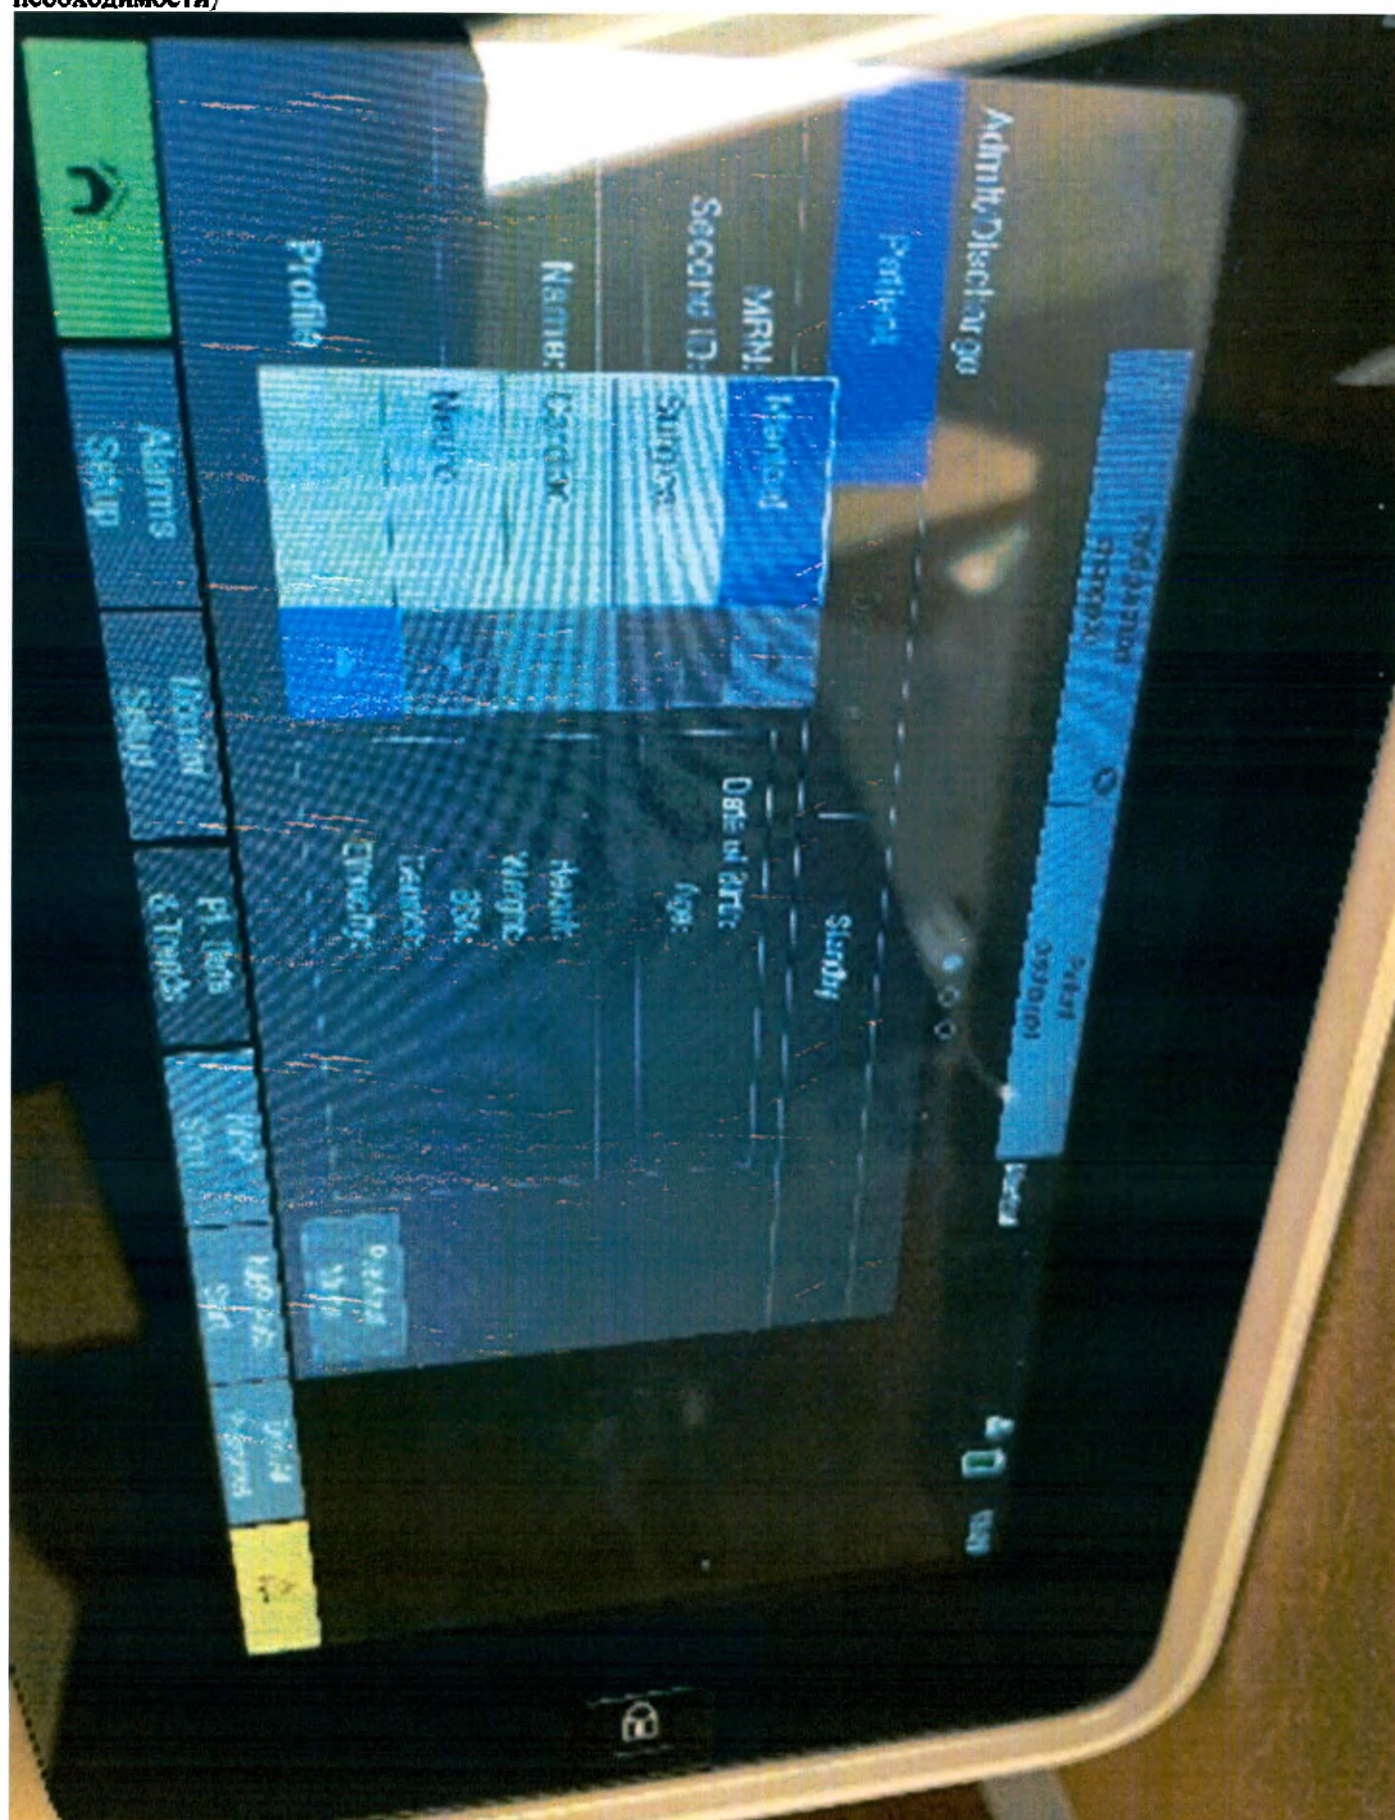

Лицензии ПО (не более 100 шт.), в составе: «Отделение постнаркозного наблюдения» (при необходимости)

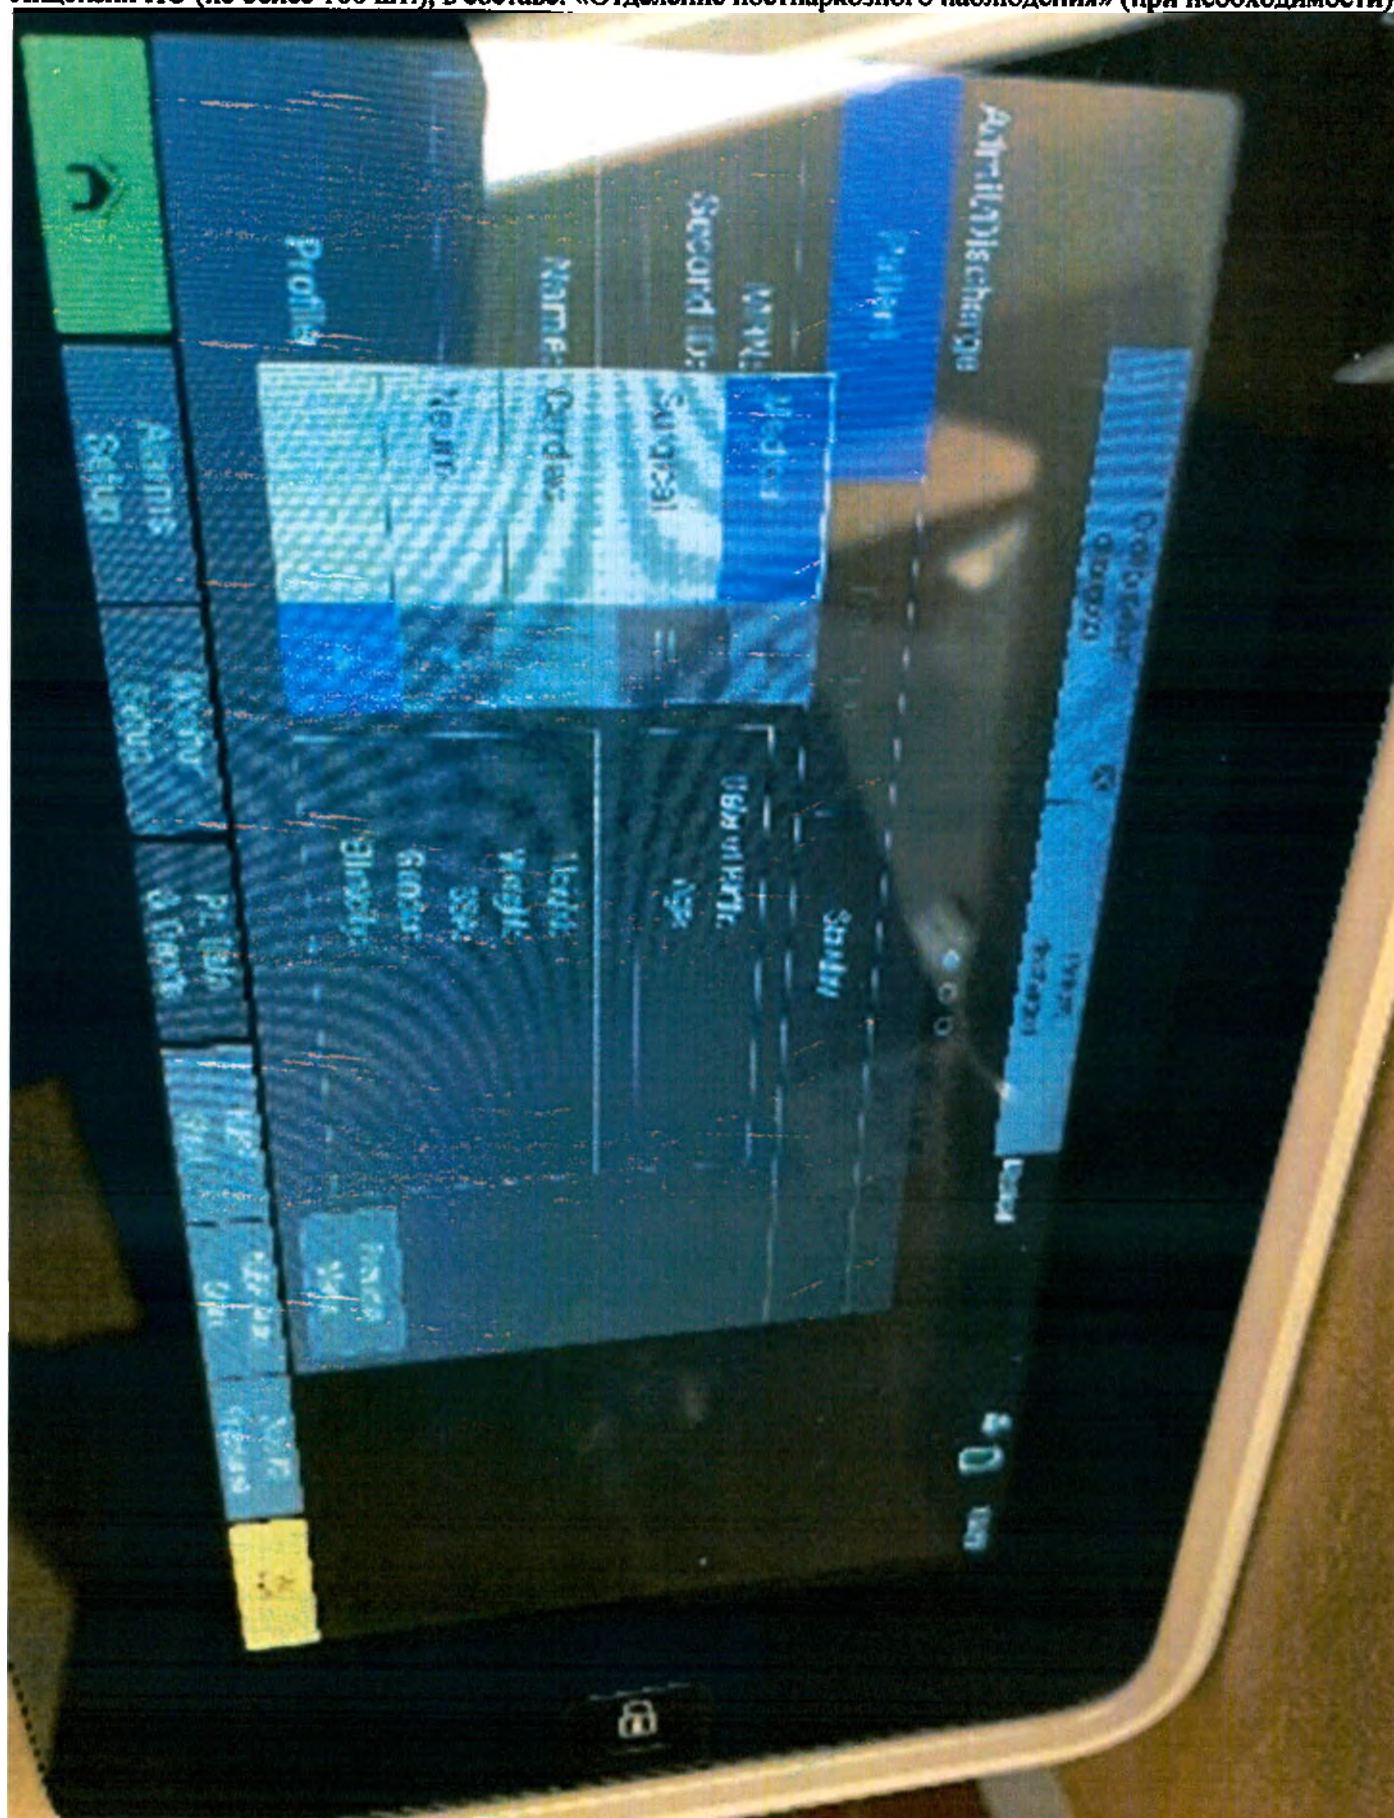


10. Проводники ЭКГ, варианты исполнения «на 3 отведения», «на 4 отведения», «на 5 отведений», «на 6 отведений» (не более 100 шт.) (при необходимости):
вариант исполнения «на 3 отведения»:

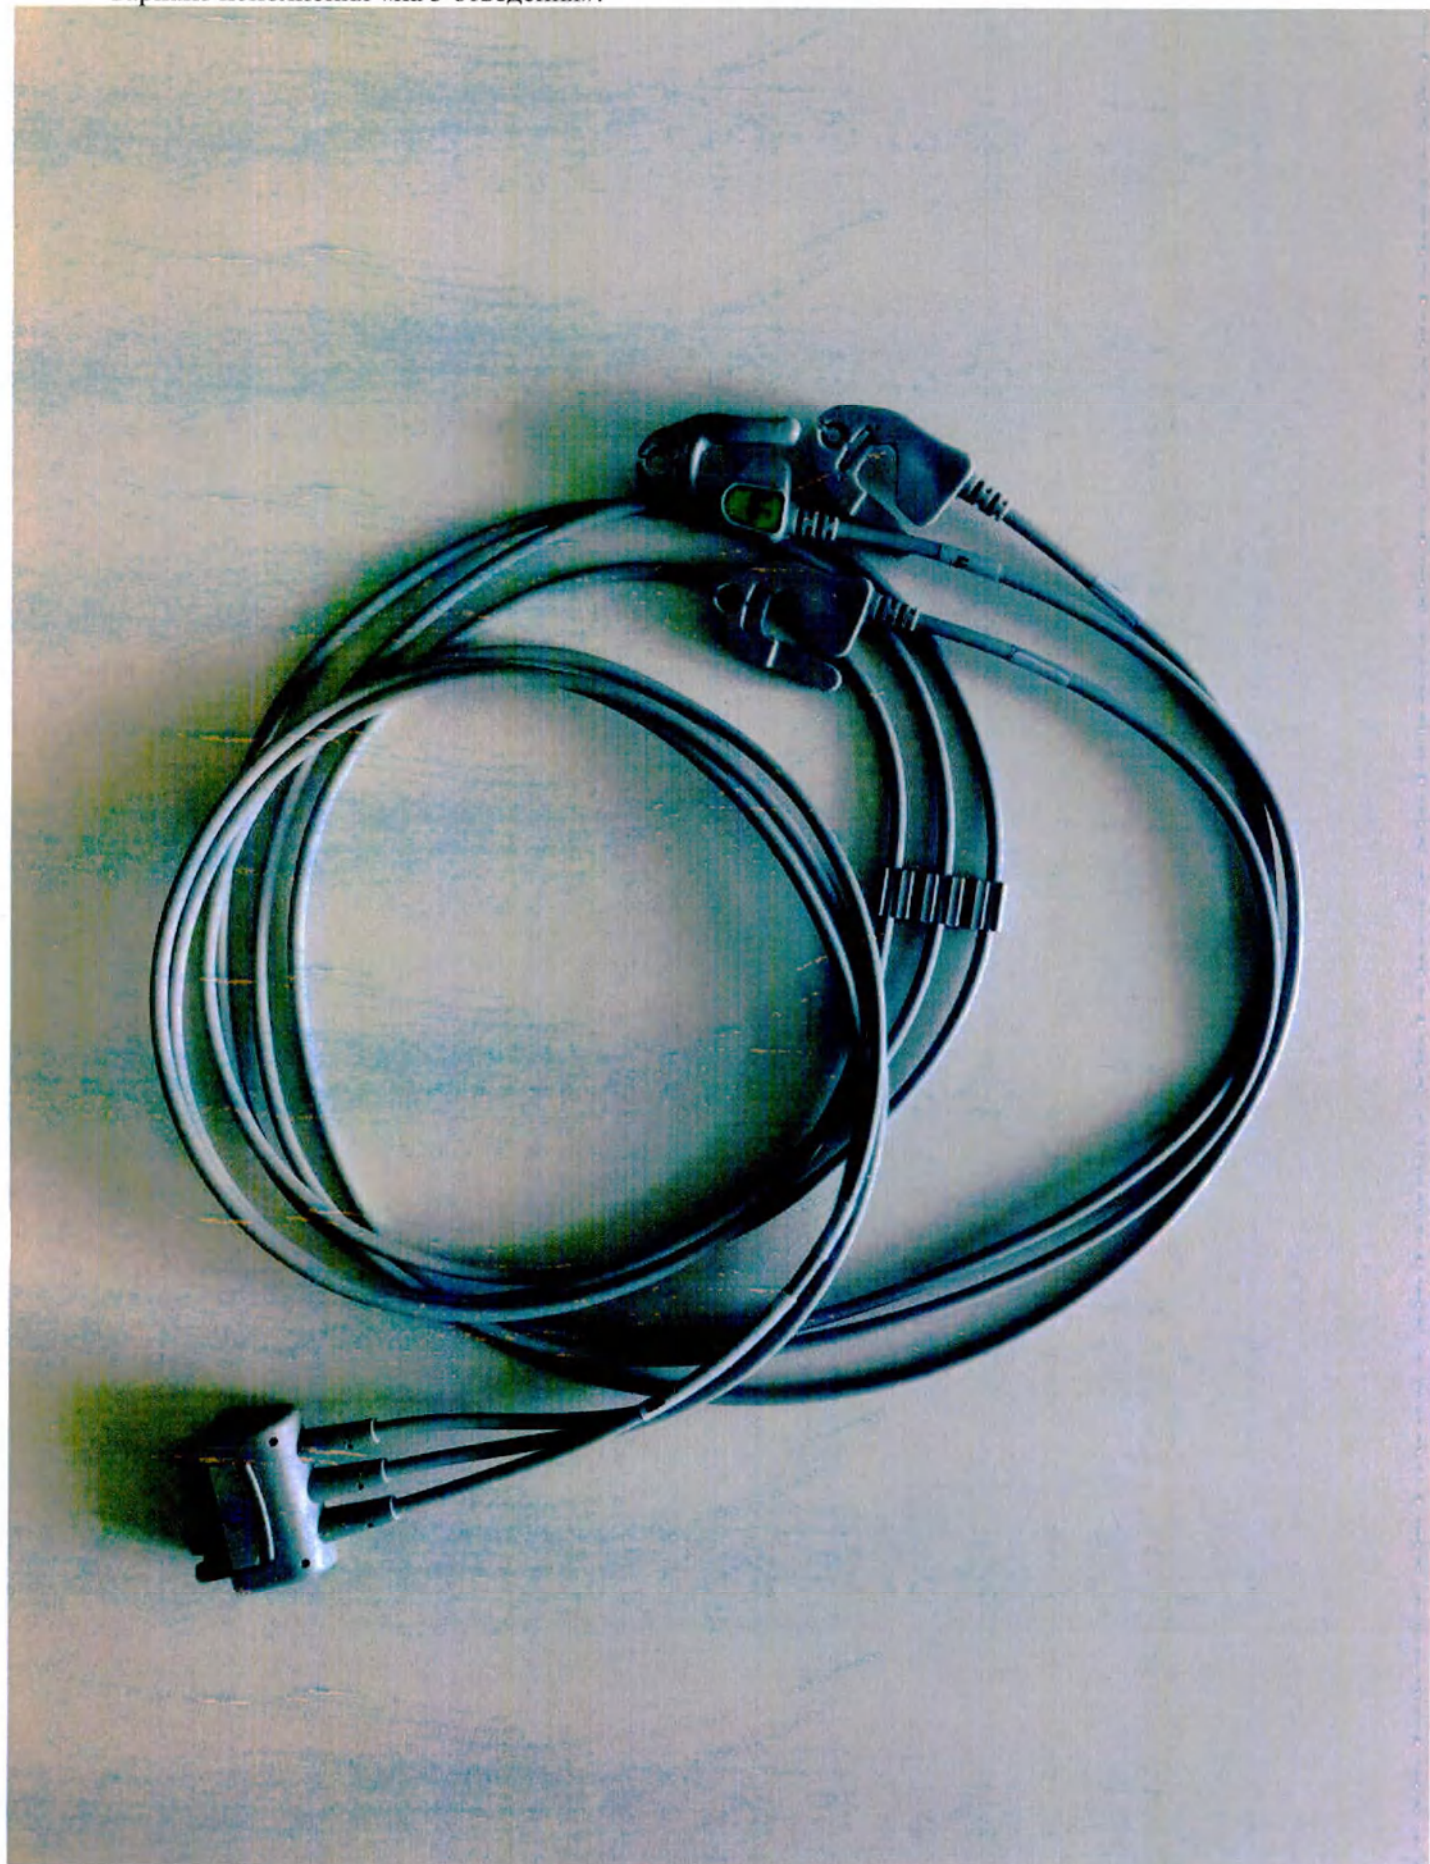

вариант исполнения «на 4 отведения»:



вариант исполнения «на 5 отведений»:

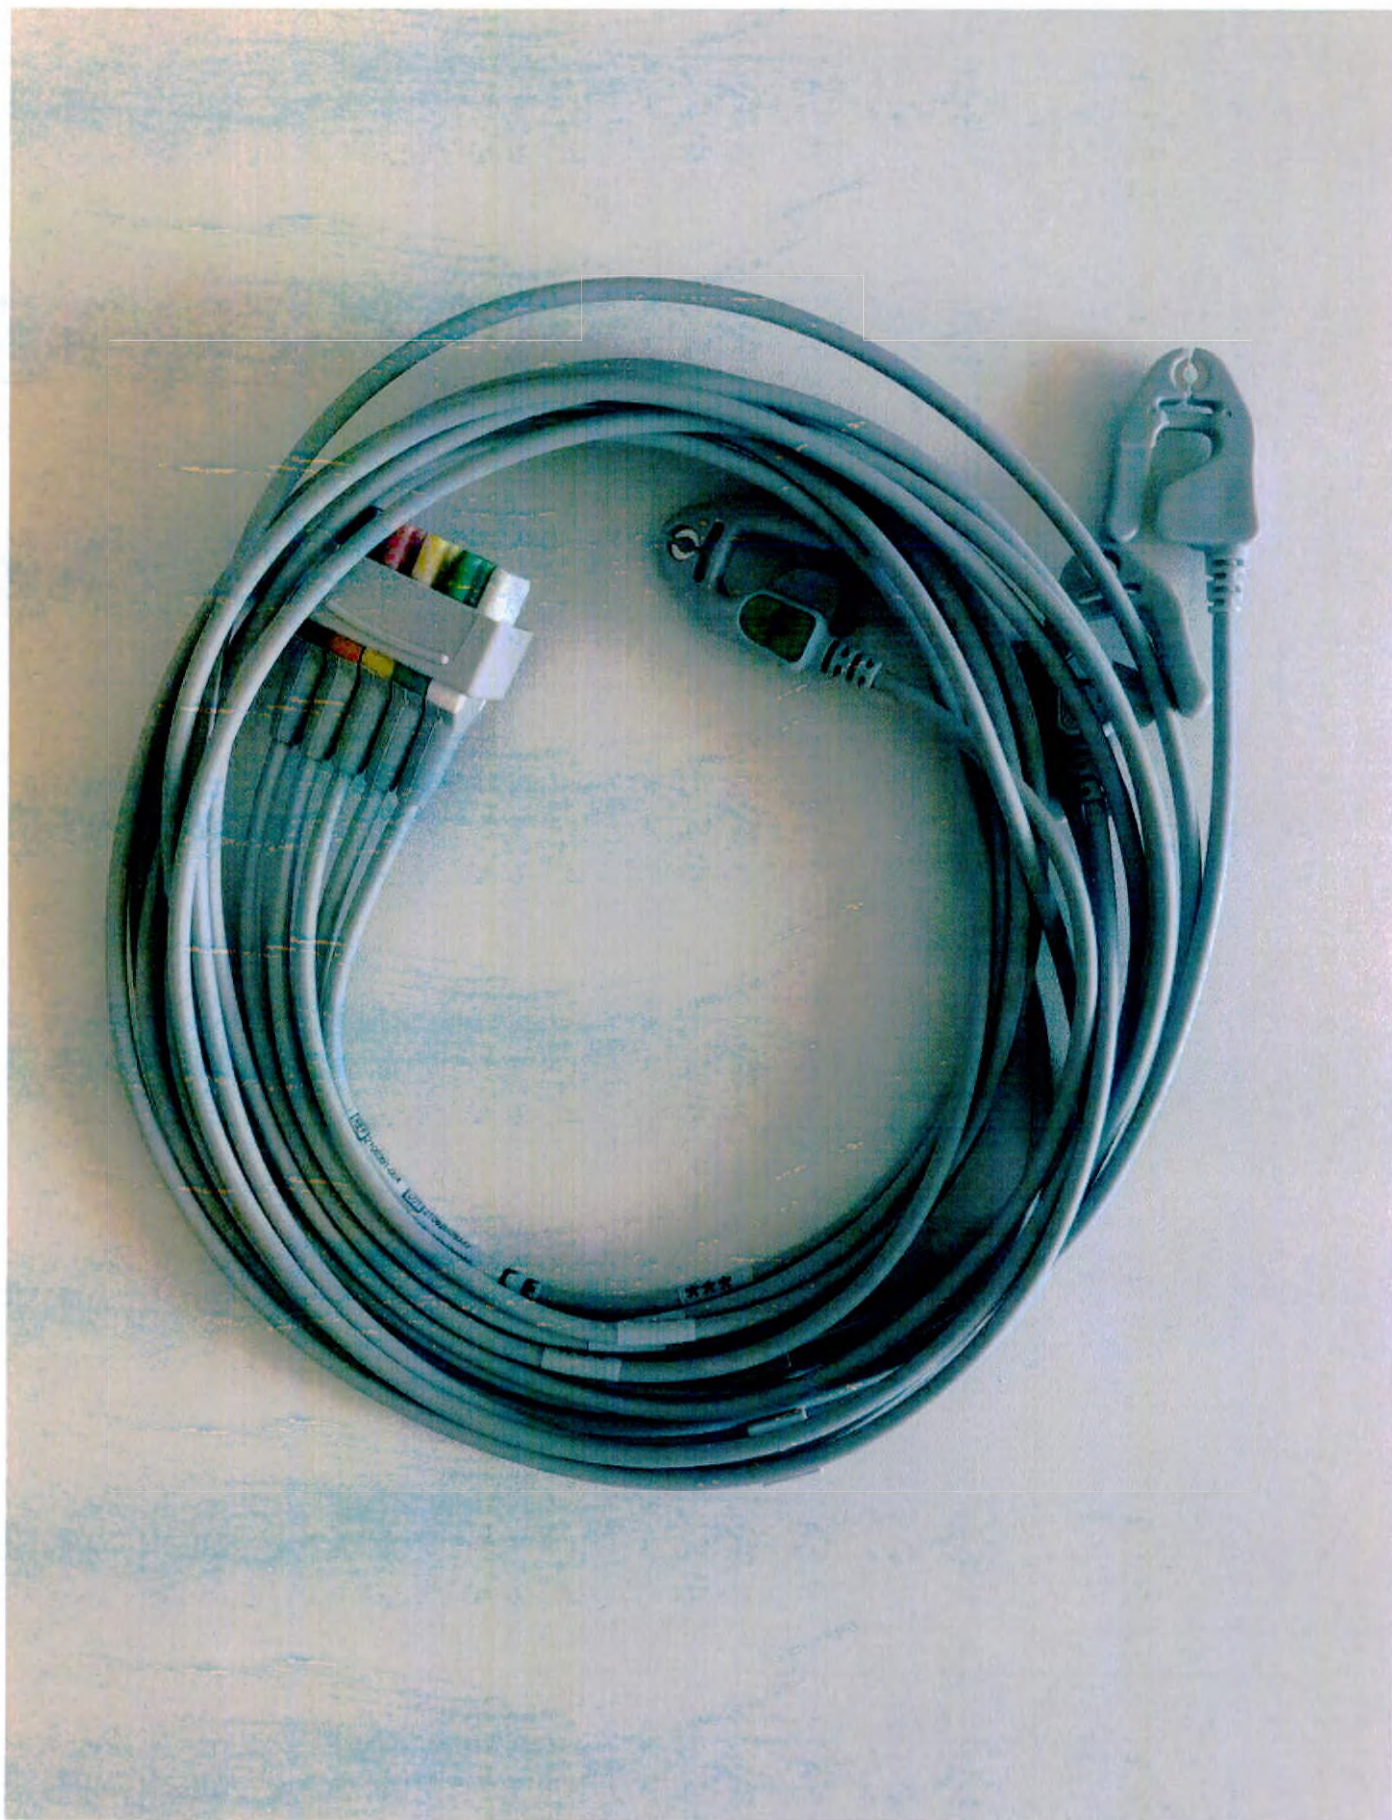


вариант исполнения «на 6 отведений»:




11. Электроды ЭКГ, варианты исполнения «универсальные», «неонатальные» (не более 1000 шт.) (при необходимости).

вариант исполнения «универсальные»:

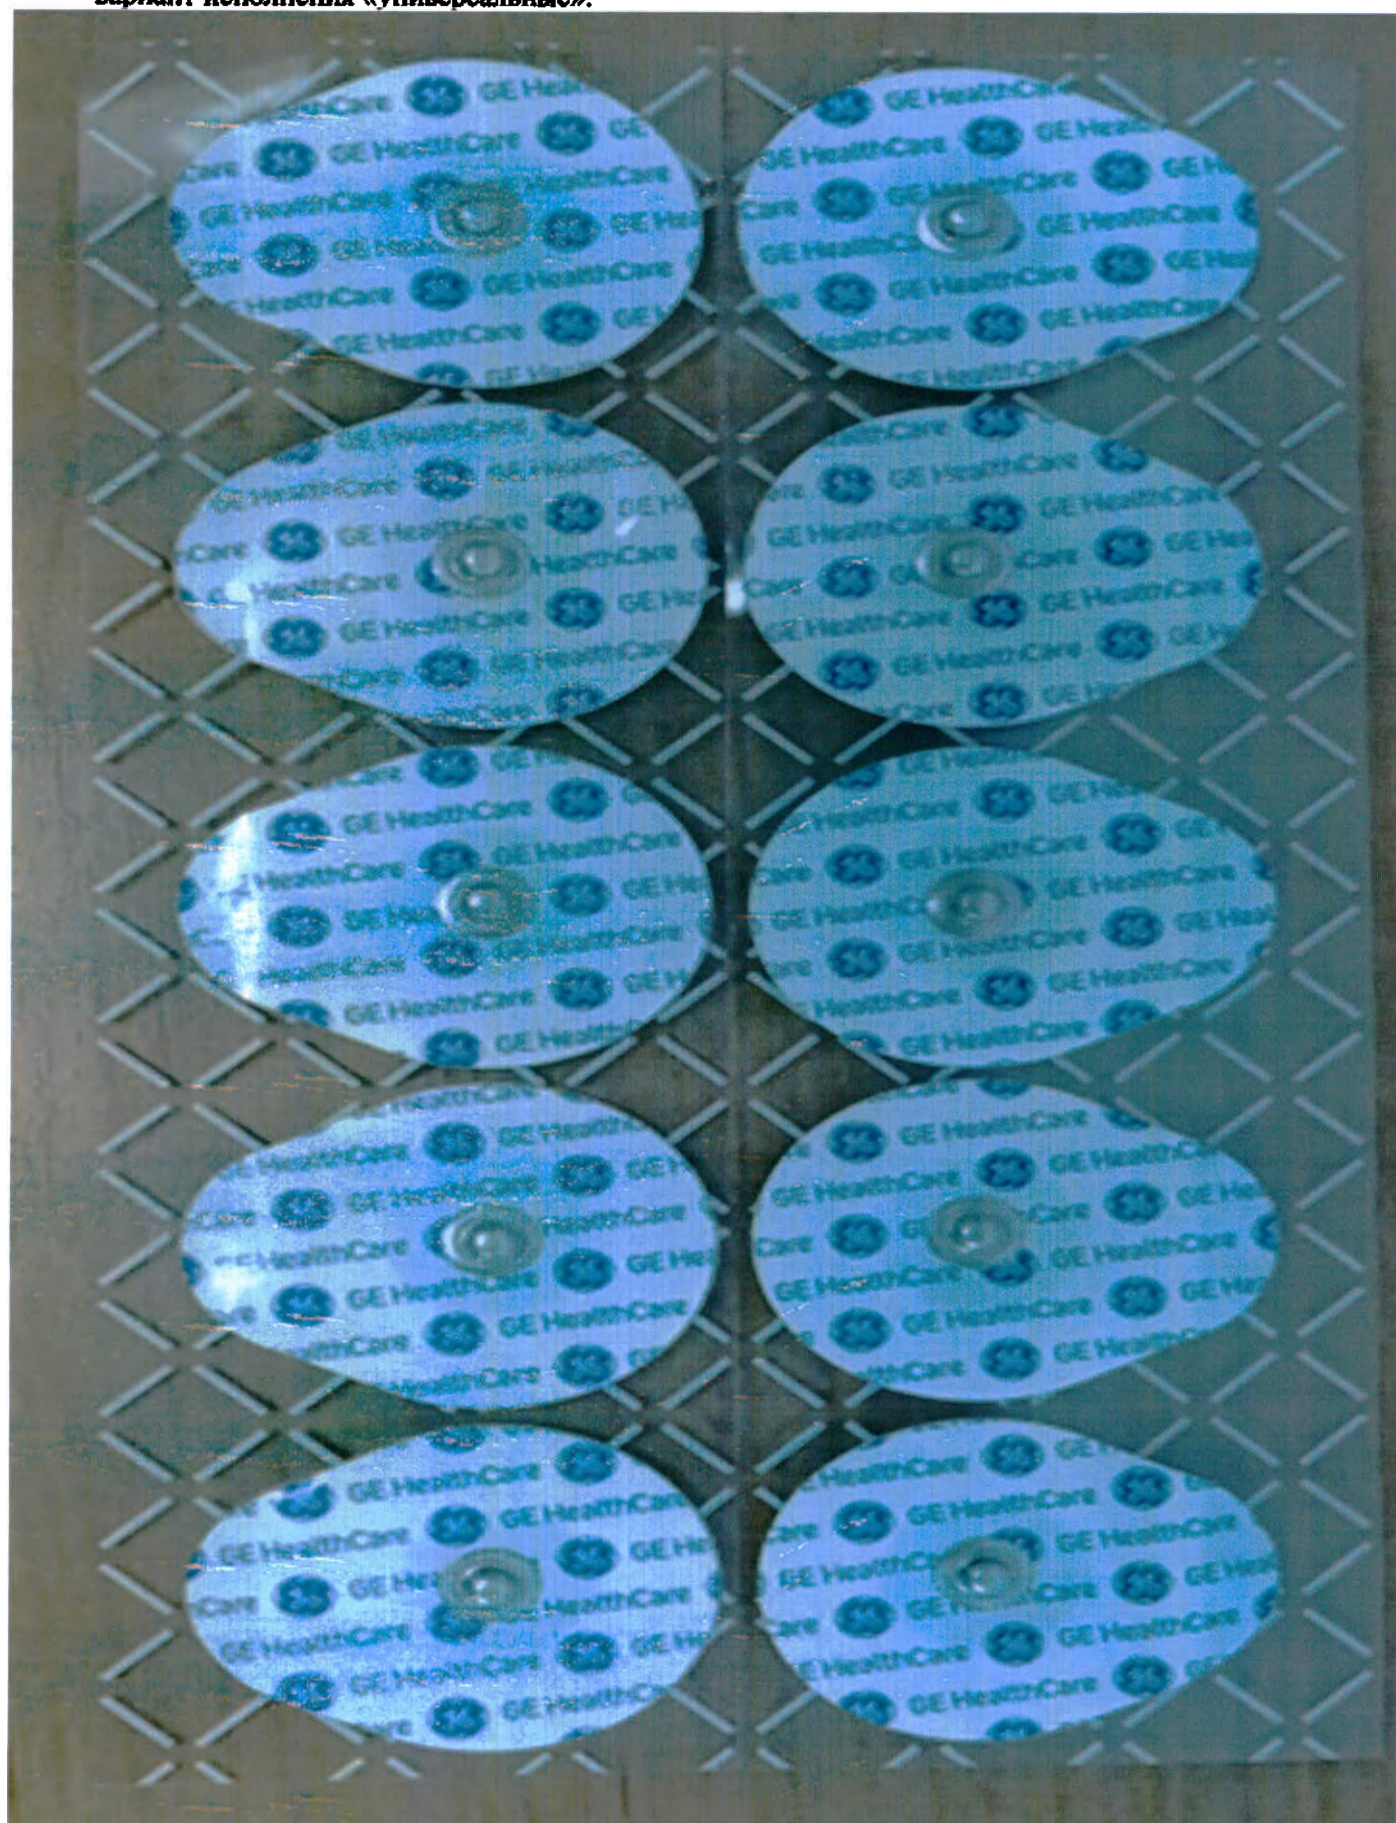



вариант исполнения «неонатальные»:

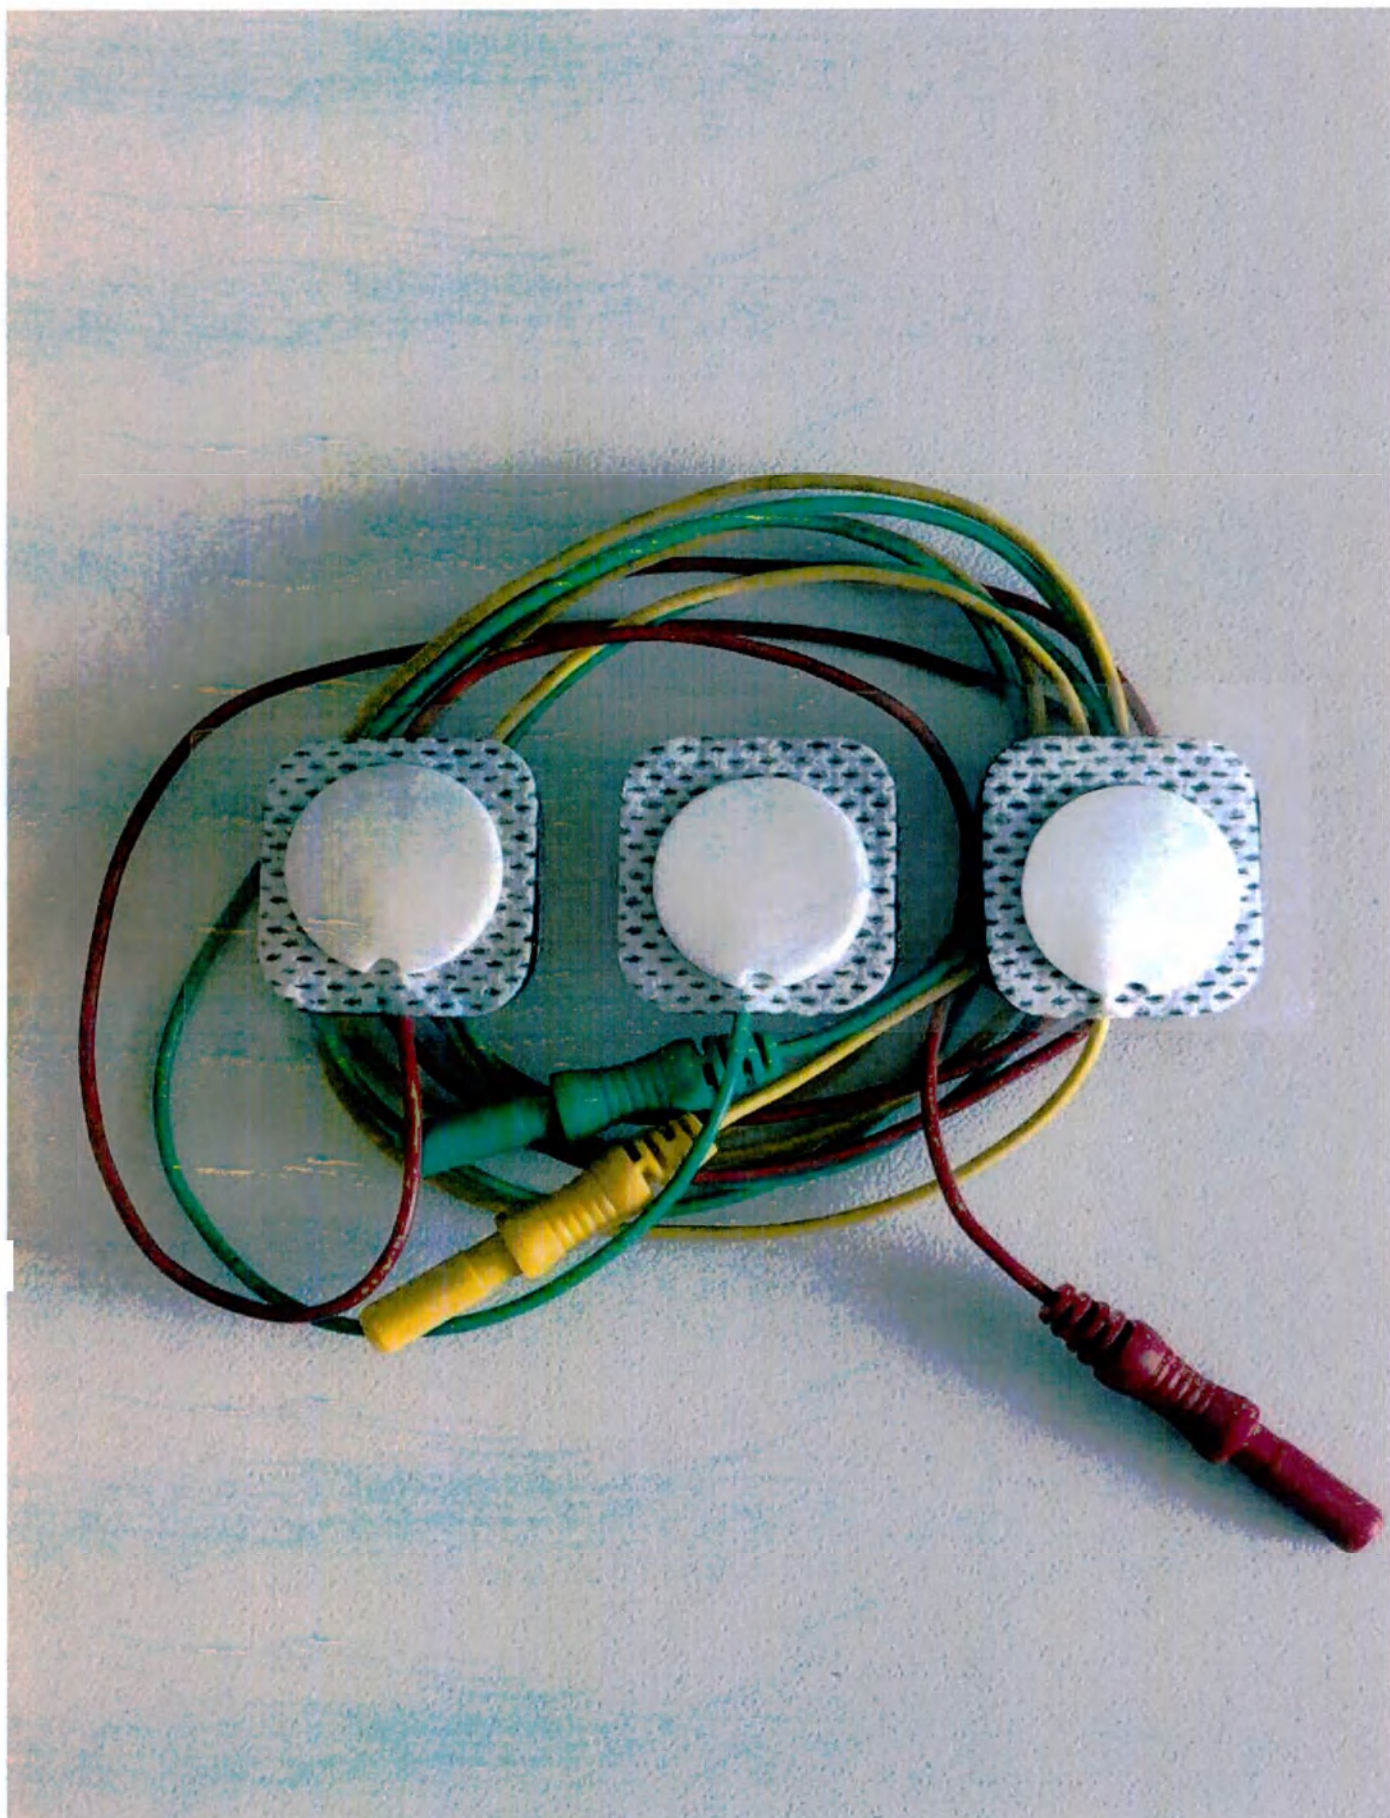


12. Датчики пульсоксиметрии, варианты исполнения Trusignal (пальцевой), Trusignal (накожный), Masimo RD Set (пальцевой), Masimo LNCS (пальцевой), Nellcor OxiMax (пальцевой) (не более 300 шт.) (при необходимости).

вариант исполнения Trusignal (пальцевой)

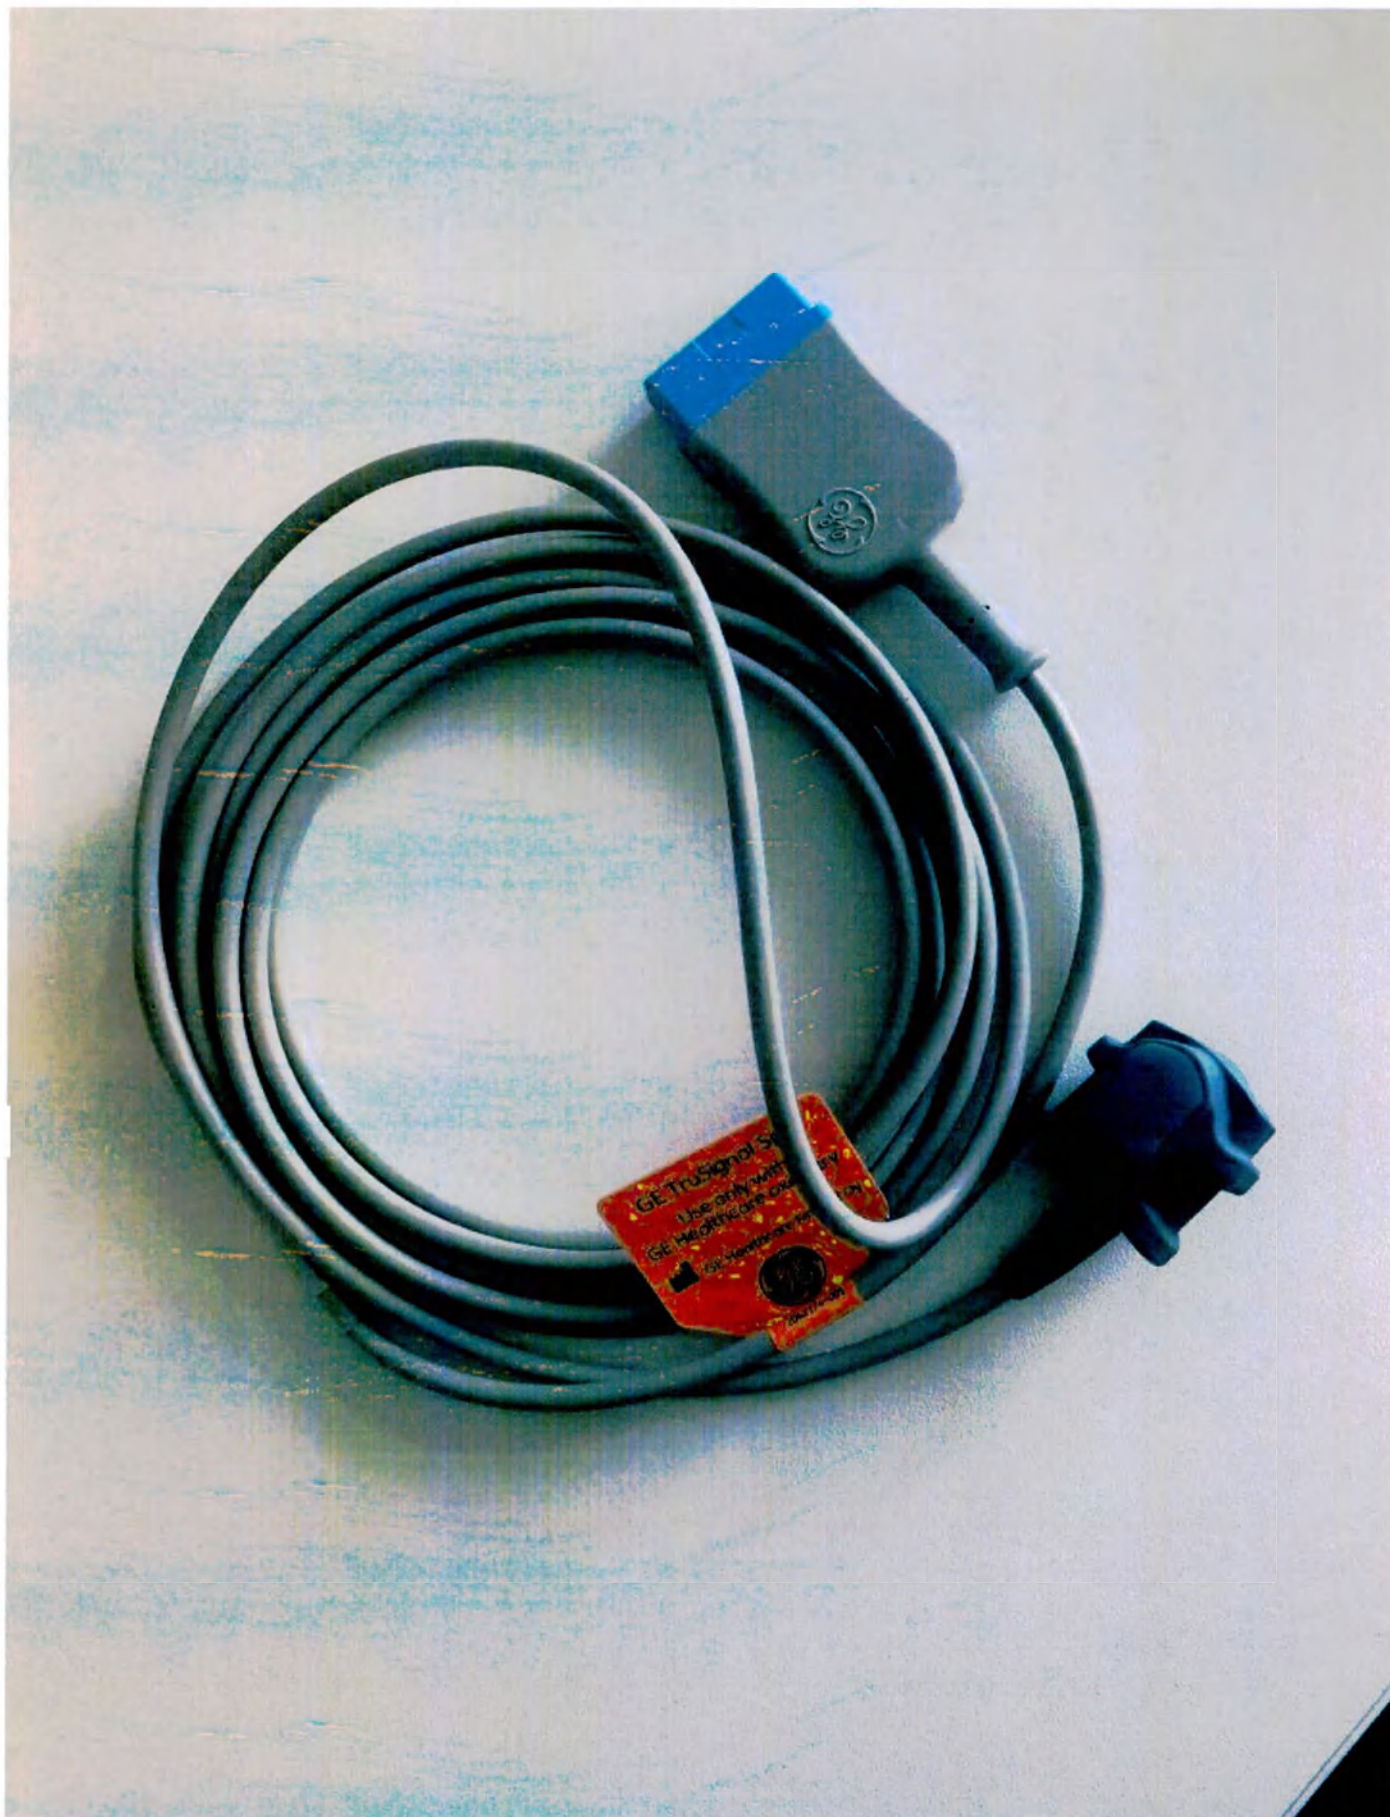

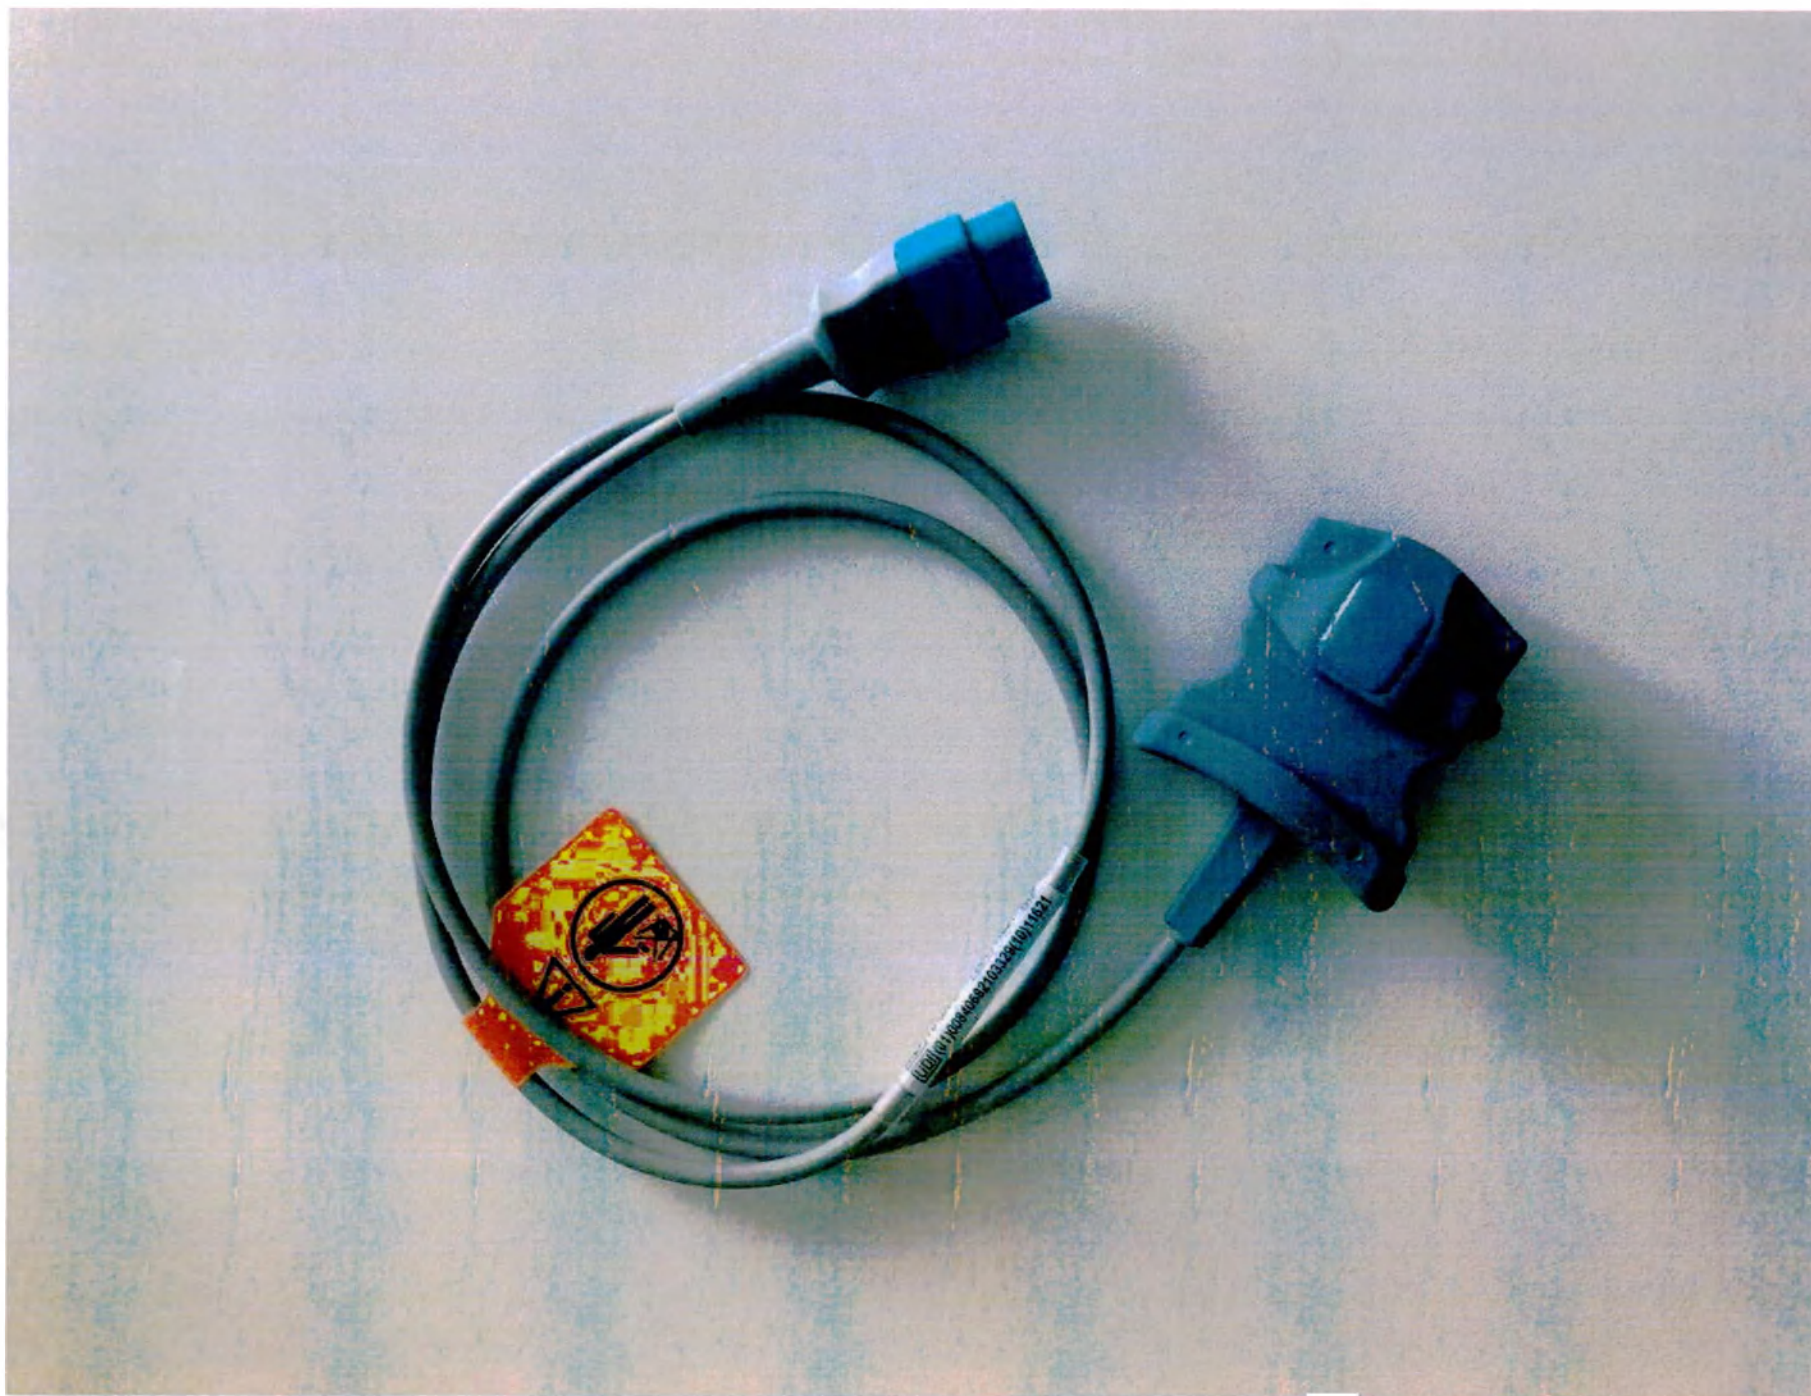

вариант исполнения Trusignal (накожный)

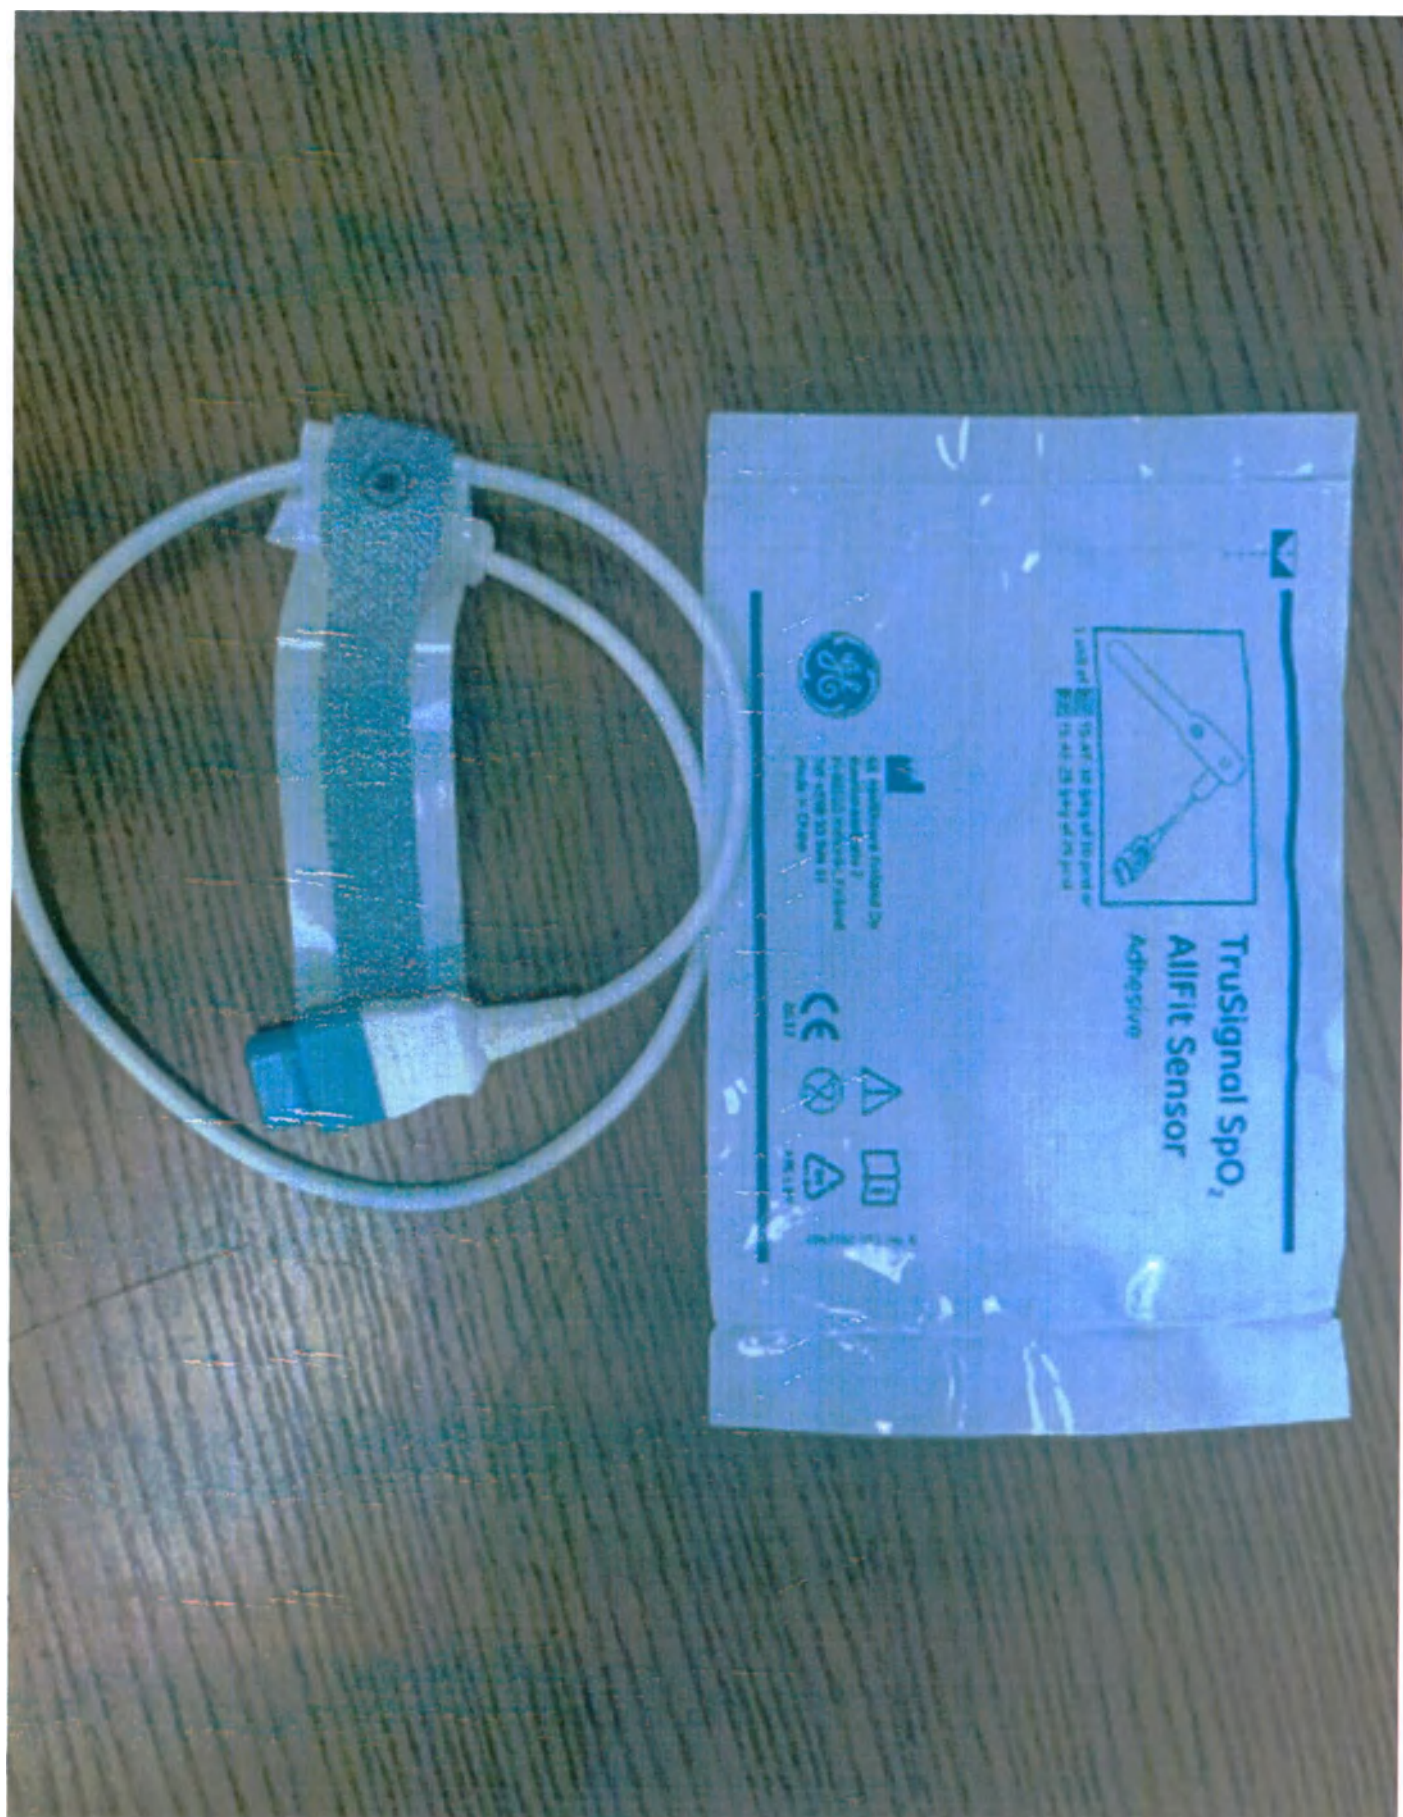

вариант исполнения Masimo RD Set (пальцевой)




вариант исполнения Masimo LNCS (пальцевой)



вариант исполнения Nellcor OxiMax (пальцевой)



13. Адгезивные ленты (не более 1000 шт.) (при необходимости).

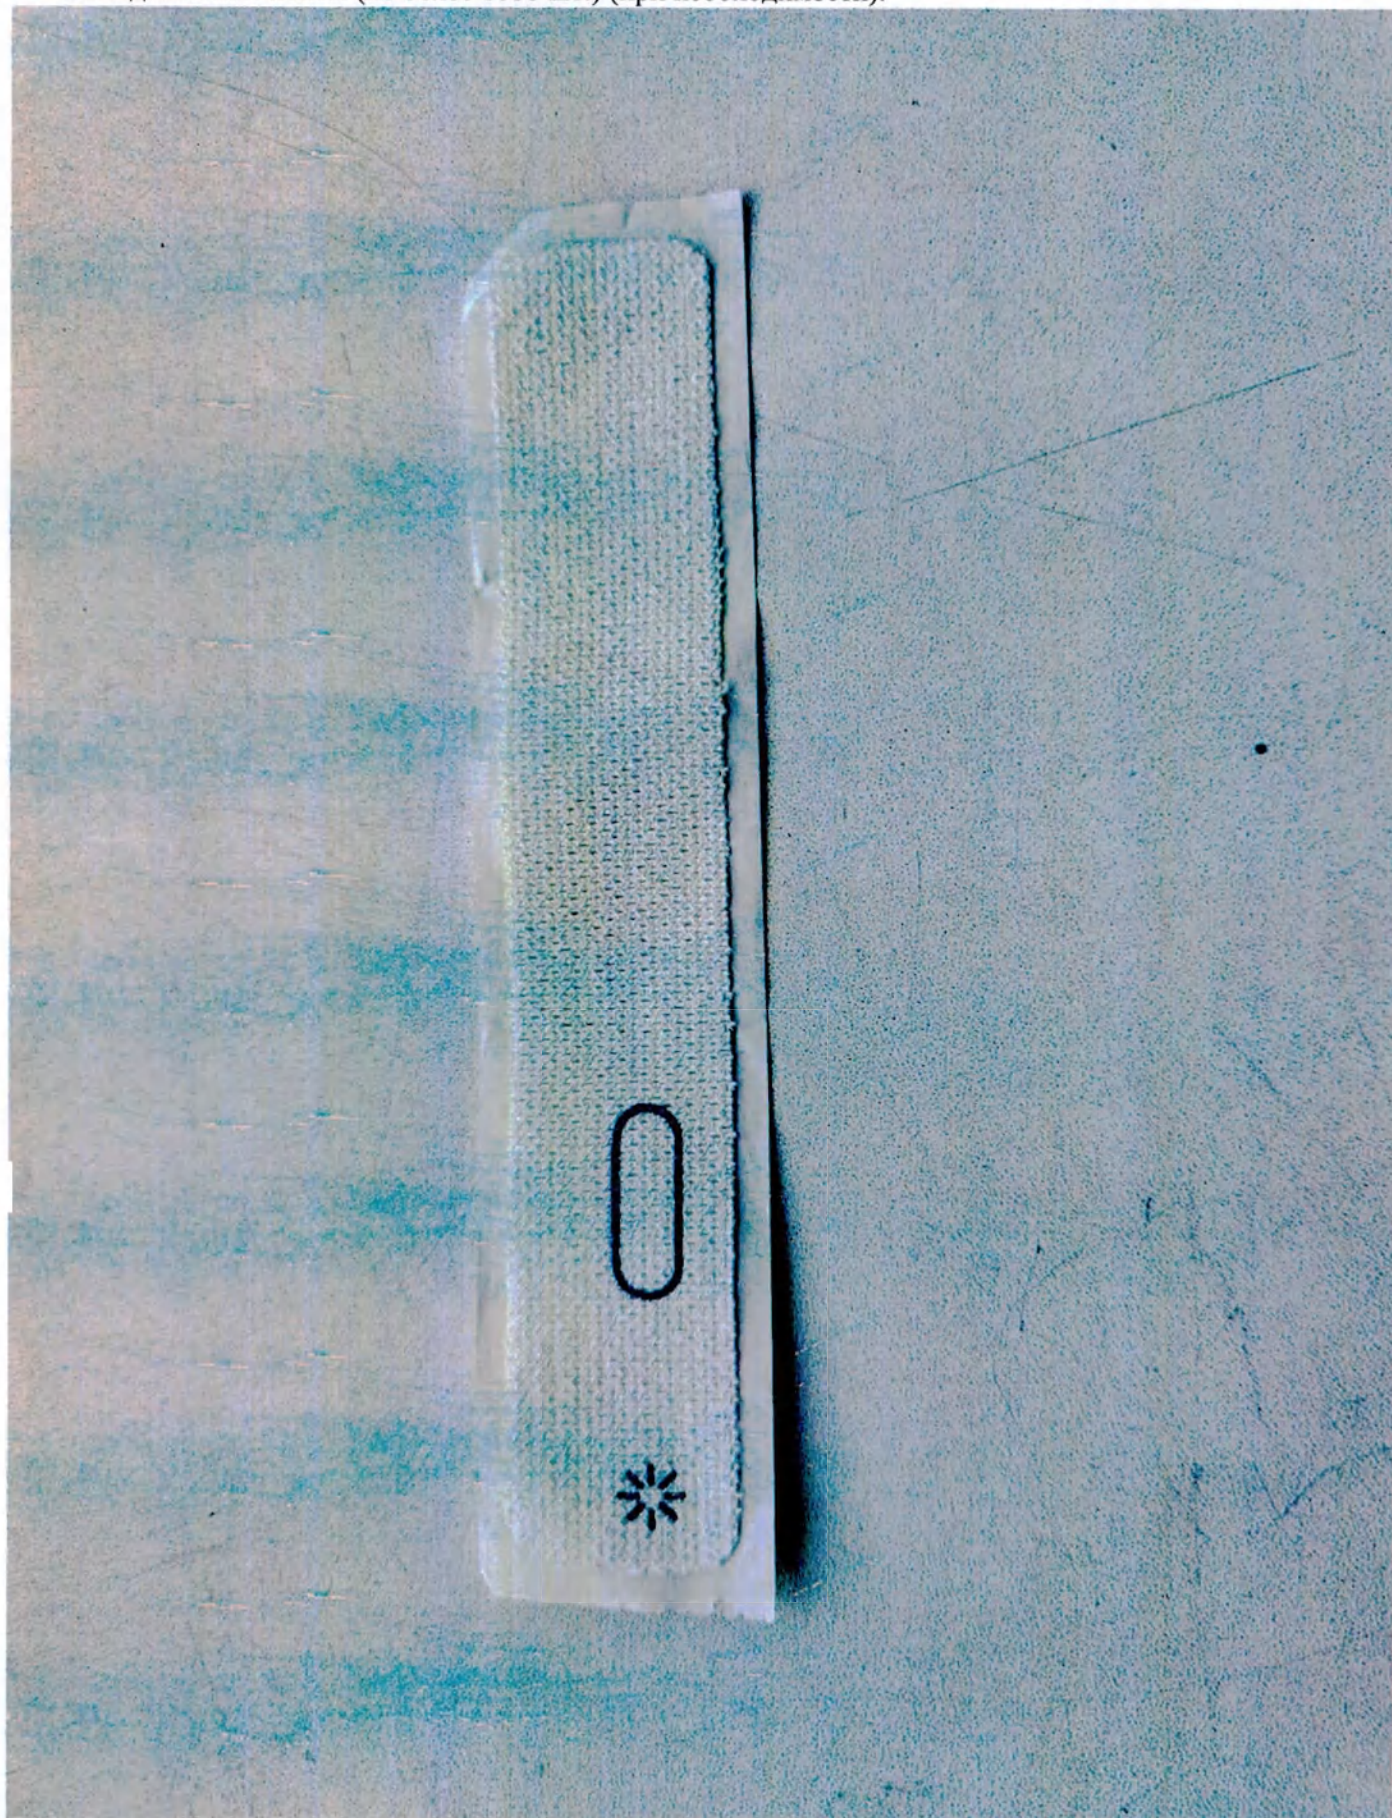

14. Манжеты НИАД, варианты исполнения «взрослые DURA-CUF», «детские DURA-CUF», «взрослые SOFT-CUF», «детские SOFT-CUF», «неонатальные SOFT-CUF», «взрослые CLASSIC-CUF», «детские CLASSIC-CUF», «неонатальные CLASSIC-CUF», «взрослые RADIAL-CUF» (не более 100 шт.) (при необходимости).

вариант исполнения «взрослые DURA-CUF»:



вариант исполнения «детские DURA-CUF»:



вариант исполнения «взрослые SOFT-CUF»:



вариант исполнения «детские SOFT-CUF»:



вариант исполнения «неонатальные SOFT-CUF»:











вариант исполнения «взрослые CLASSIC-CUF»:







вариант исполнения «детские CLASSIC-CUF»:



вариант исполнения «неонатальные CLASSIC-CUF»:

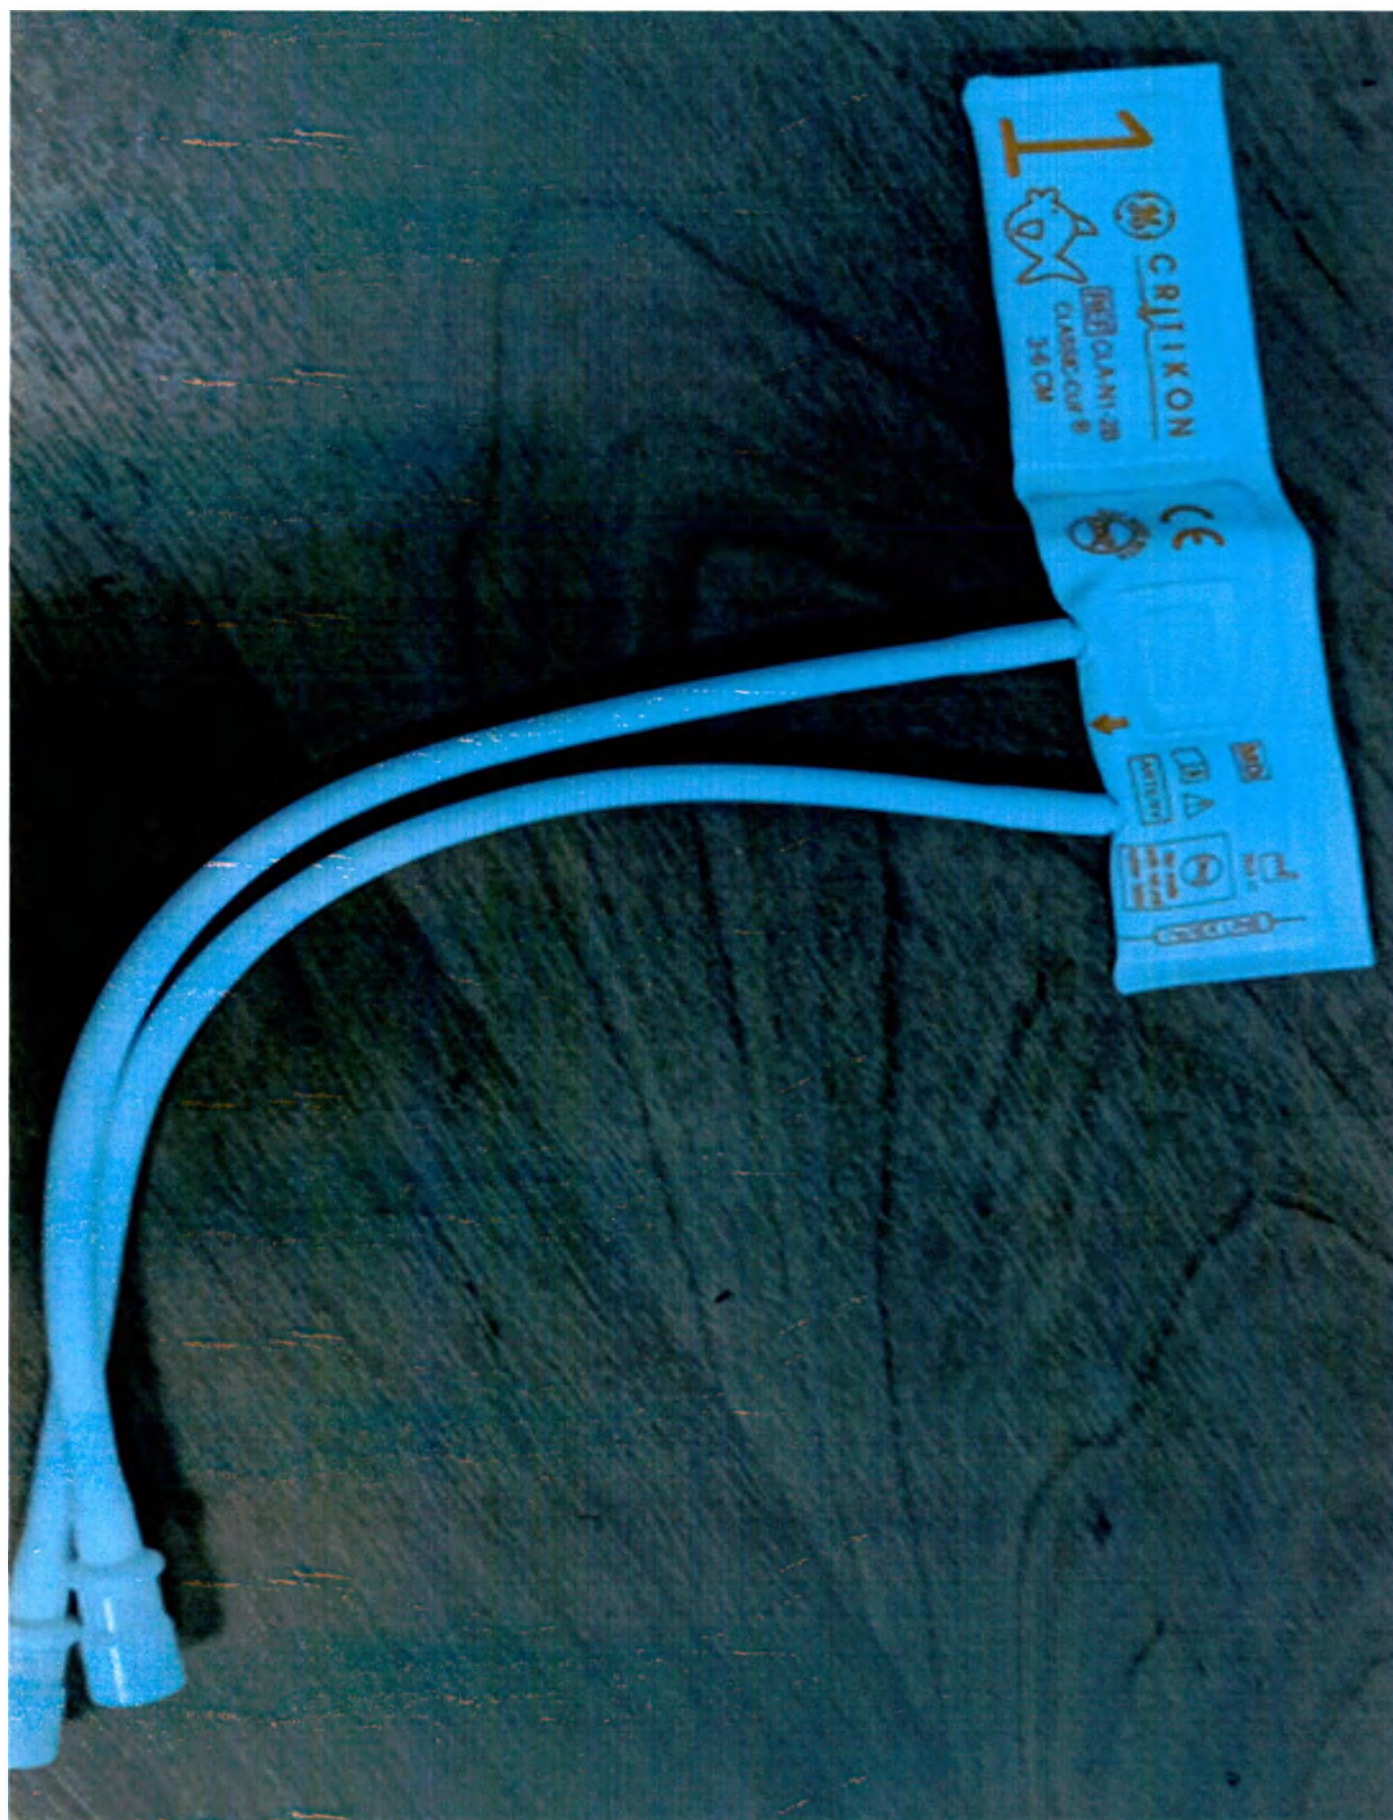

вариант исполнения «взрослые RADIAL-CUF»:

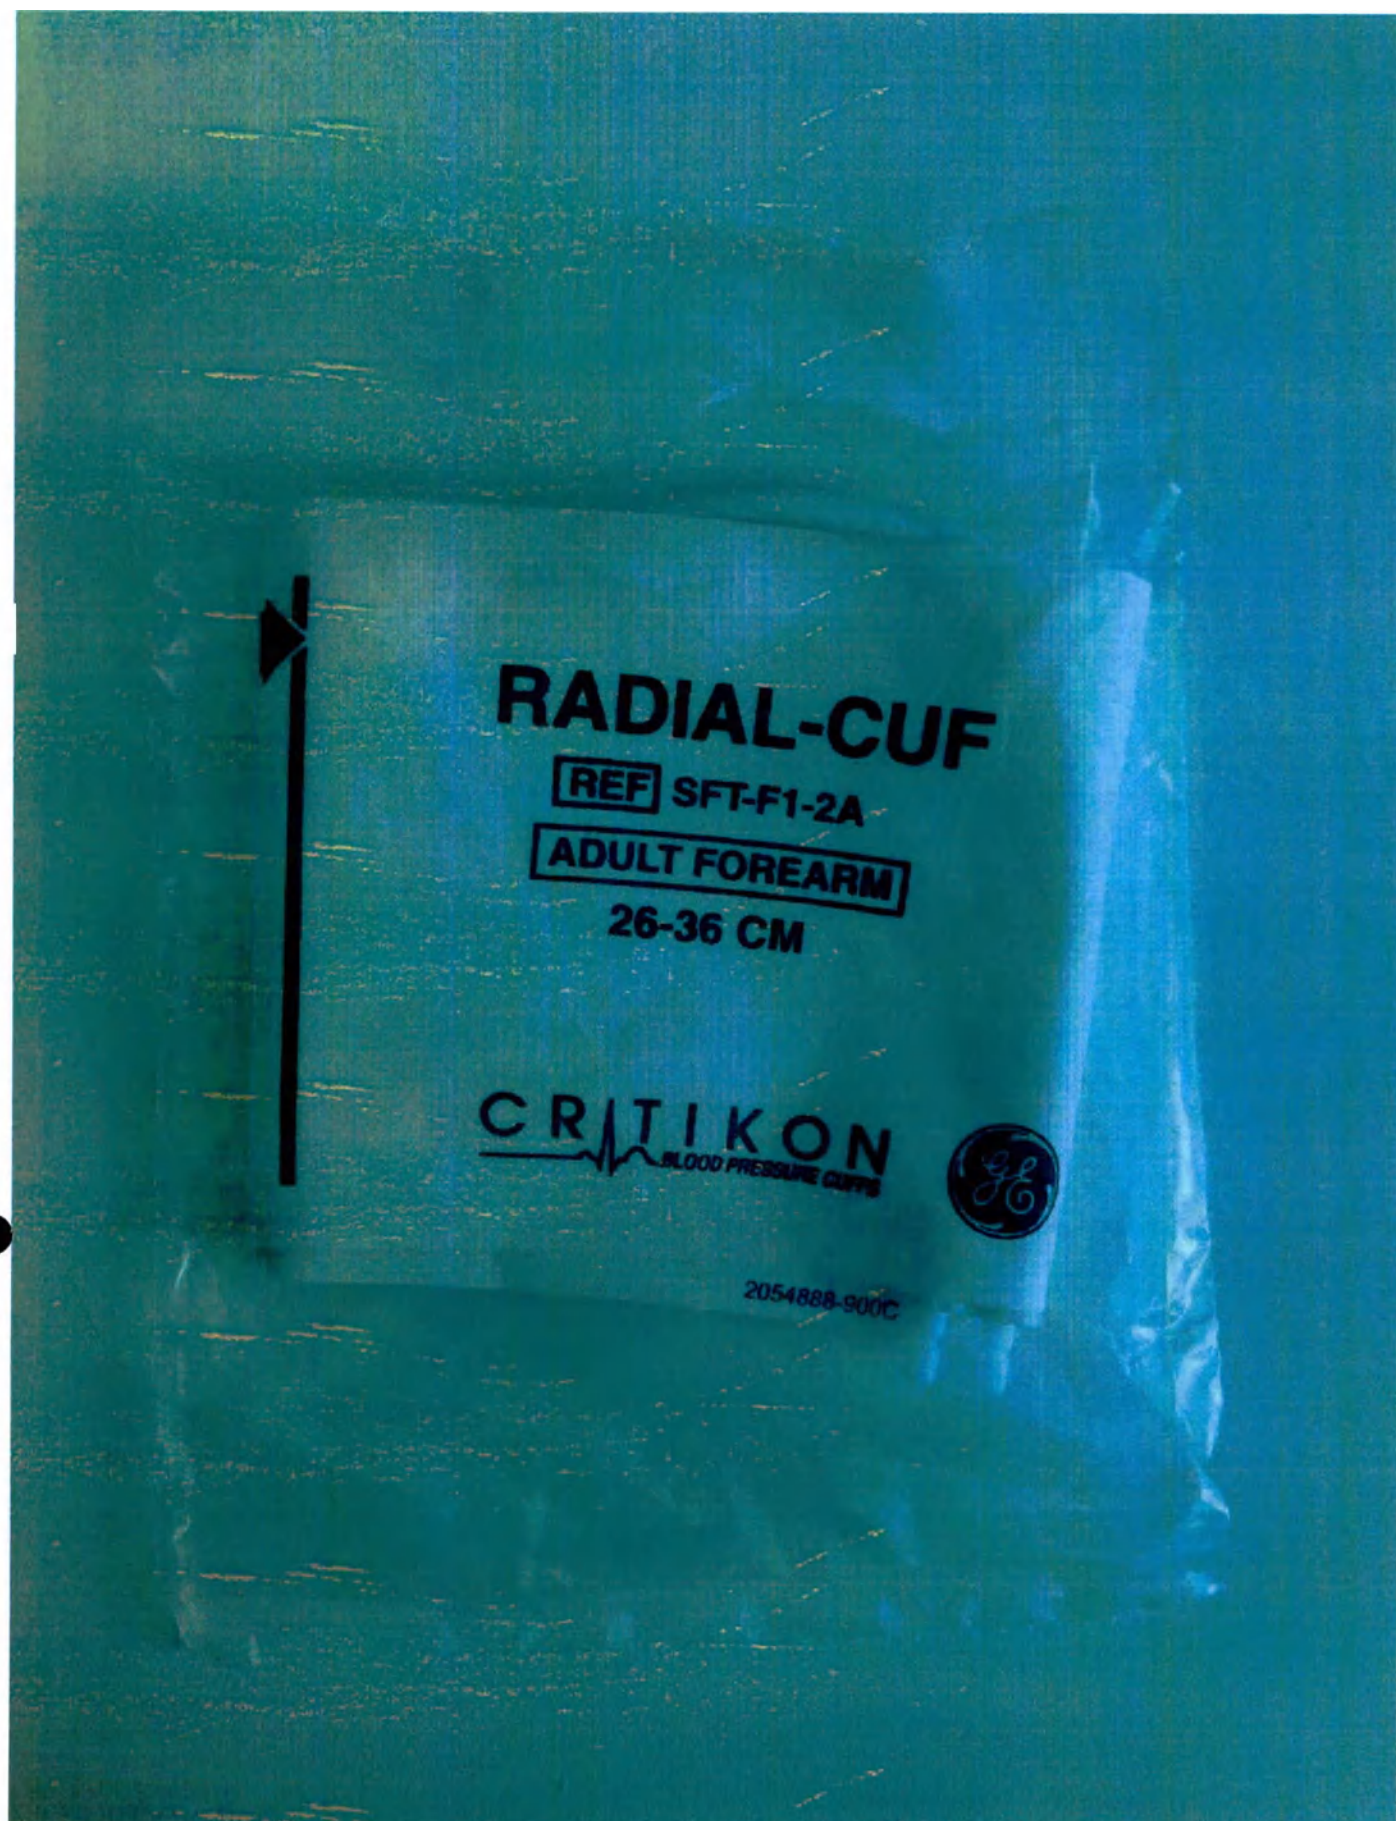


15. Шланги НИАД, варианты исполнения «взрослый», «детский» (не более 20 шт.) (при необходимости)

вариант исполнения «взрослый»:



вариант исполнения «детский»:

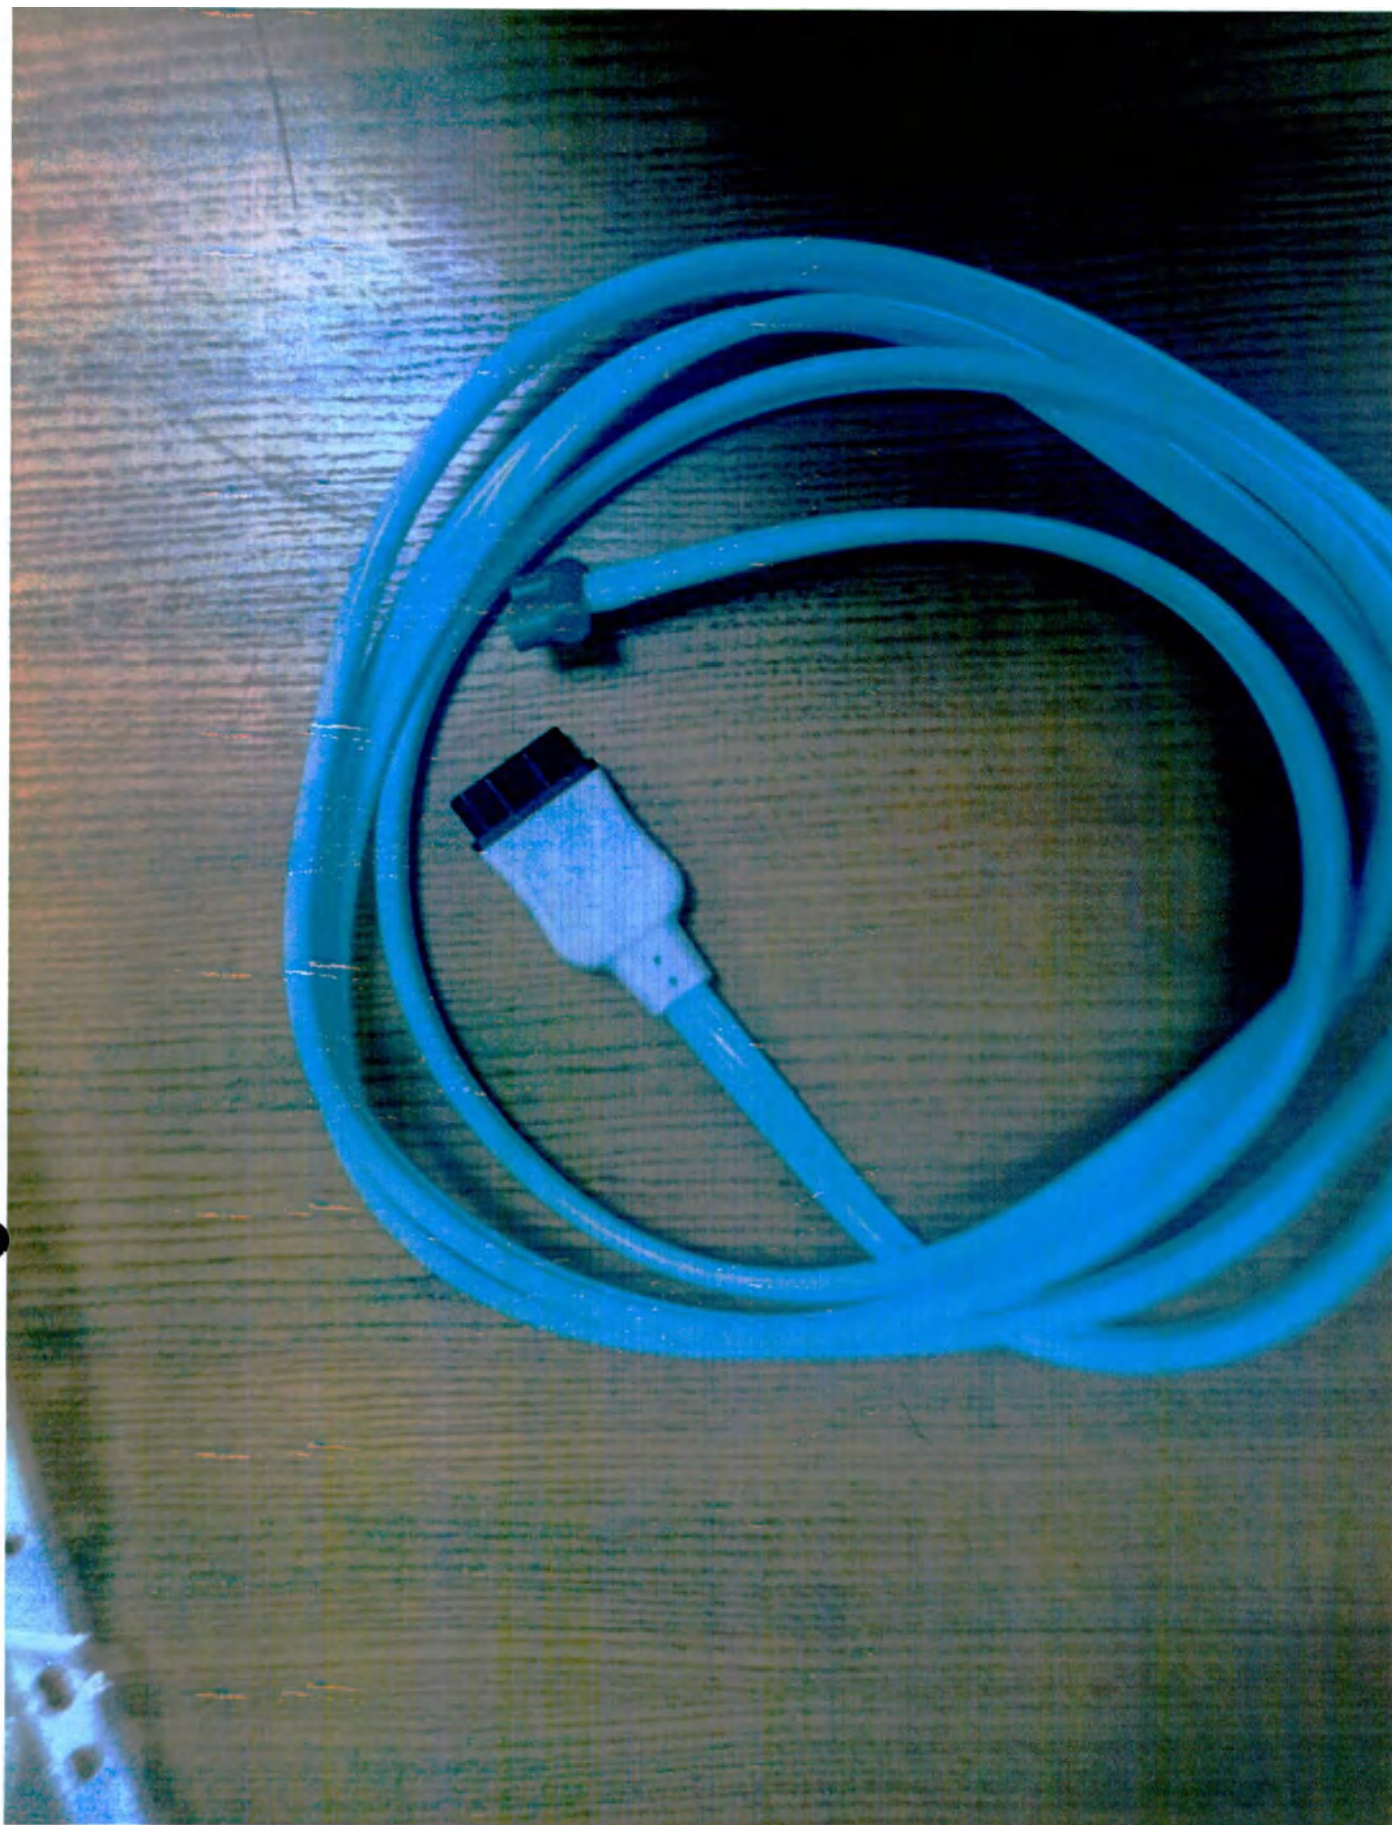

16. Датчики температуры, варианты исполнения «накожный», «полостной» (не более 100 шт.) (при необходимости).

вариант исполнения «накожный»:



вариант исполнения «полостной»:



17. Газозаборные канюли (не более 500 шт.) (при необходимости).




18. Адаптеры, варианты исполнения «прямой», «угловой» (не более 500 шт.) (при необходимости)

вариант исполнения «прямой»:



вариант исполнения «угловой»:

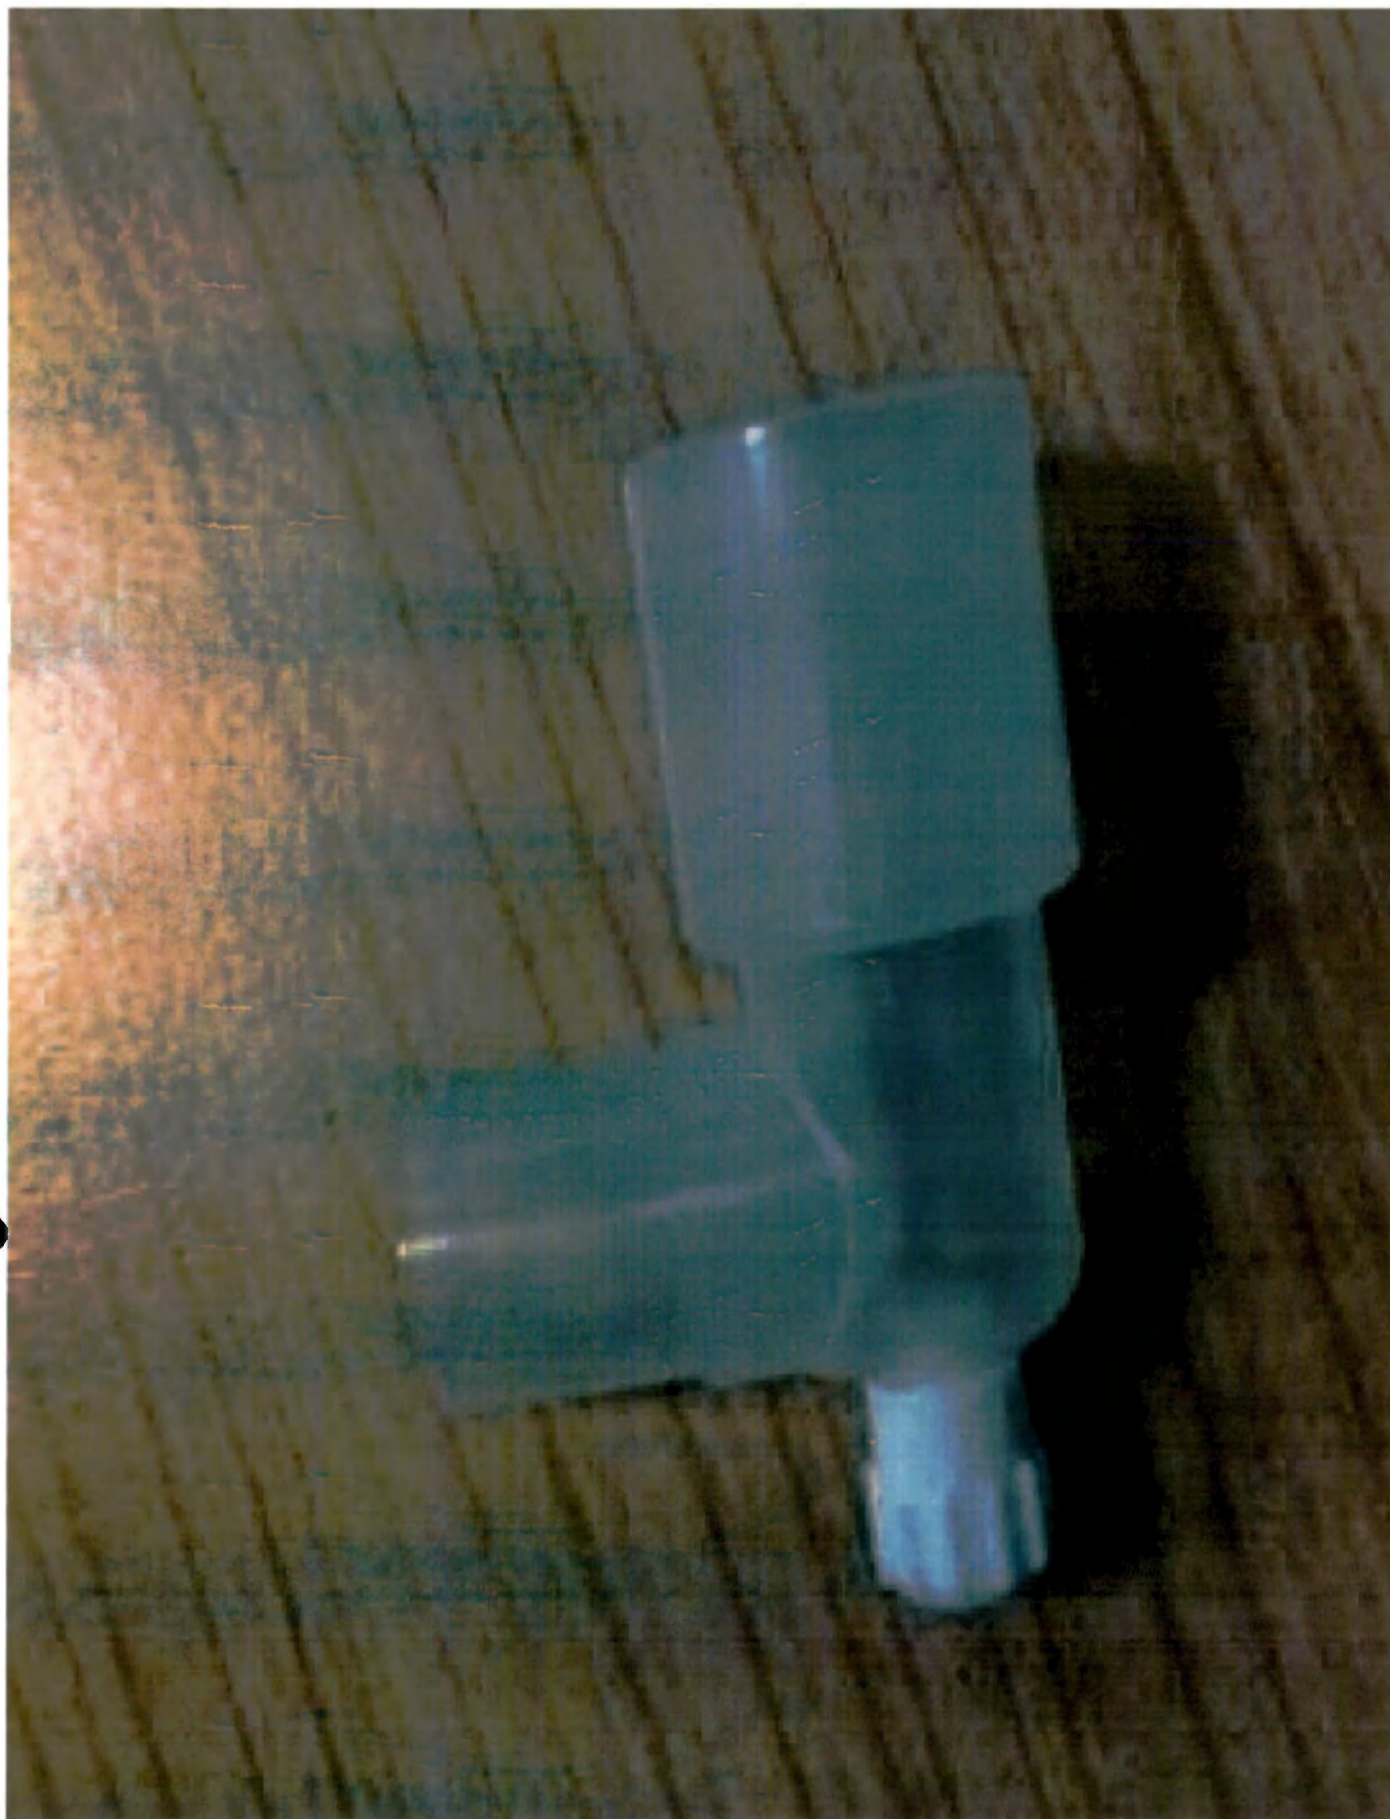

19. Газозаборные линии (не более 500 шт.) (при необходимости):



20. Датчики инвазивного давления (не более 500 шт.) (при необходимости):



21. Линии промывки инвазивного давления (не более 1000 шт.) (при необходимости):




22. Кабели ЭКГ CARESCAPE ECG (не более 20 шт.) (при необходимости):



23. Кабели инвазивного давления CARESCAPE Pressure, варианты исполнения «на два канала», «универсальный» (не более 20 шт.) (при необходимости).

вариант исполнения «на два канала»:

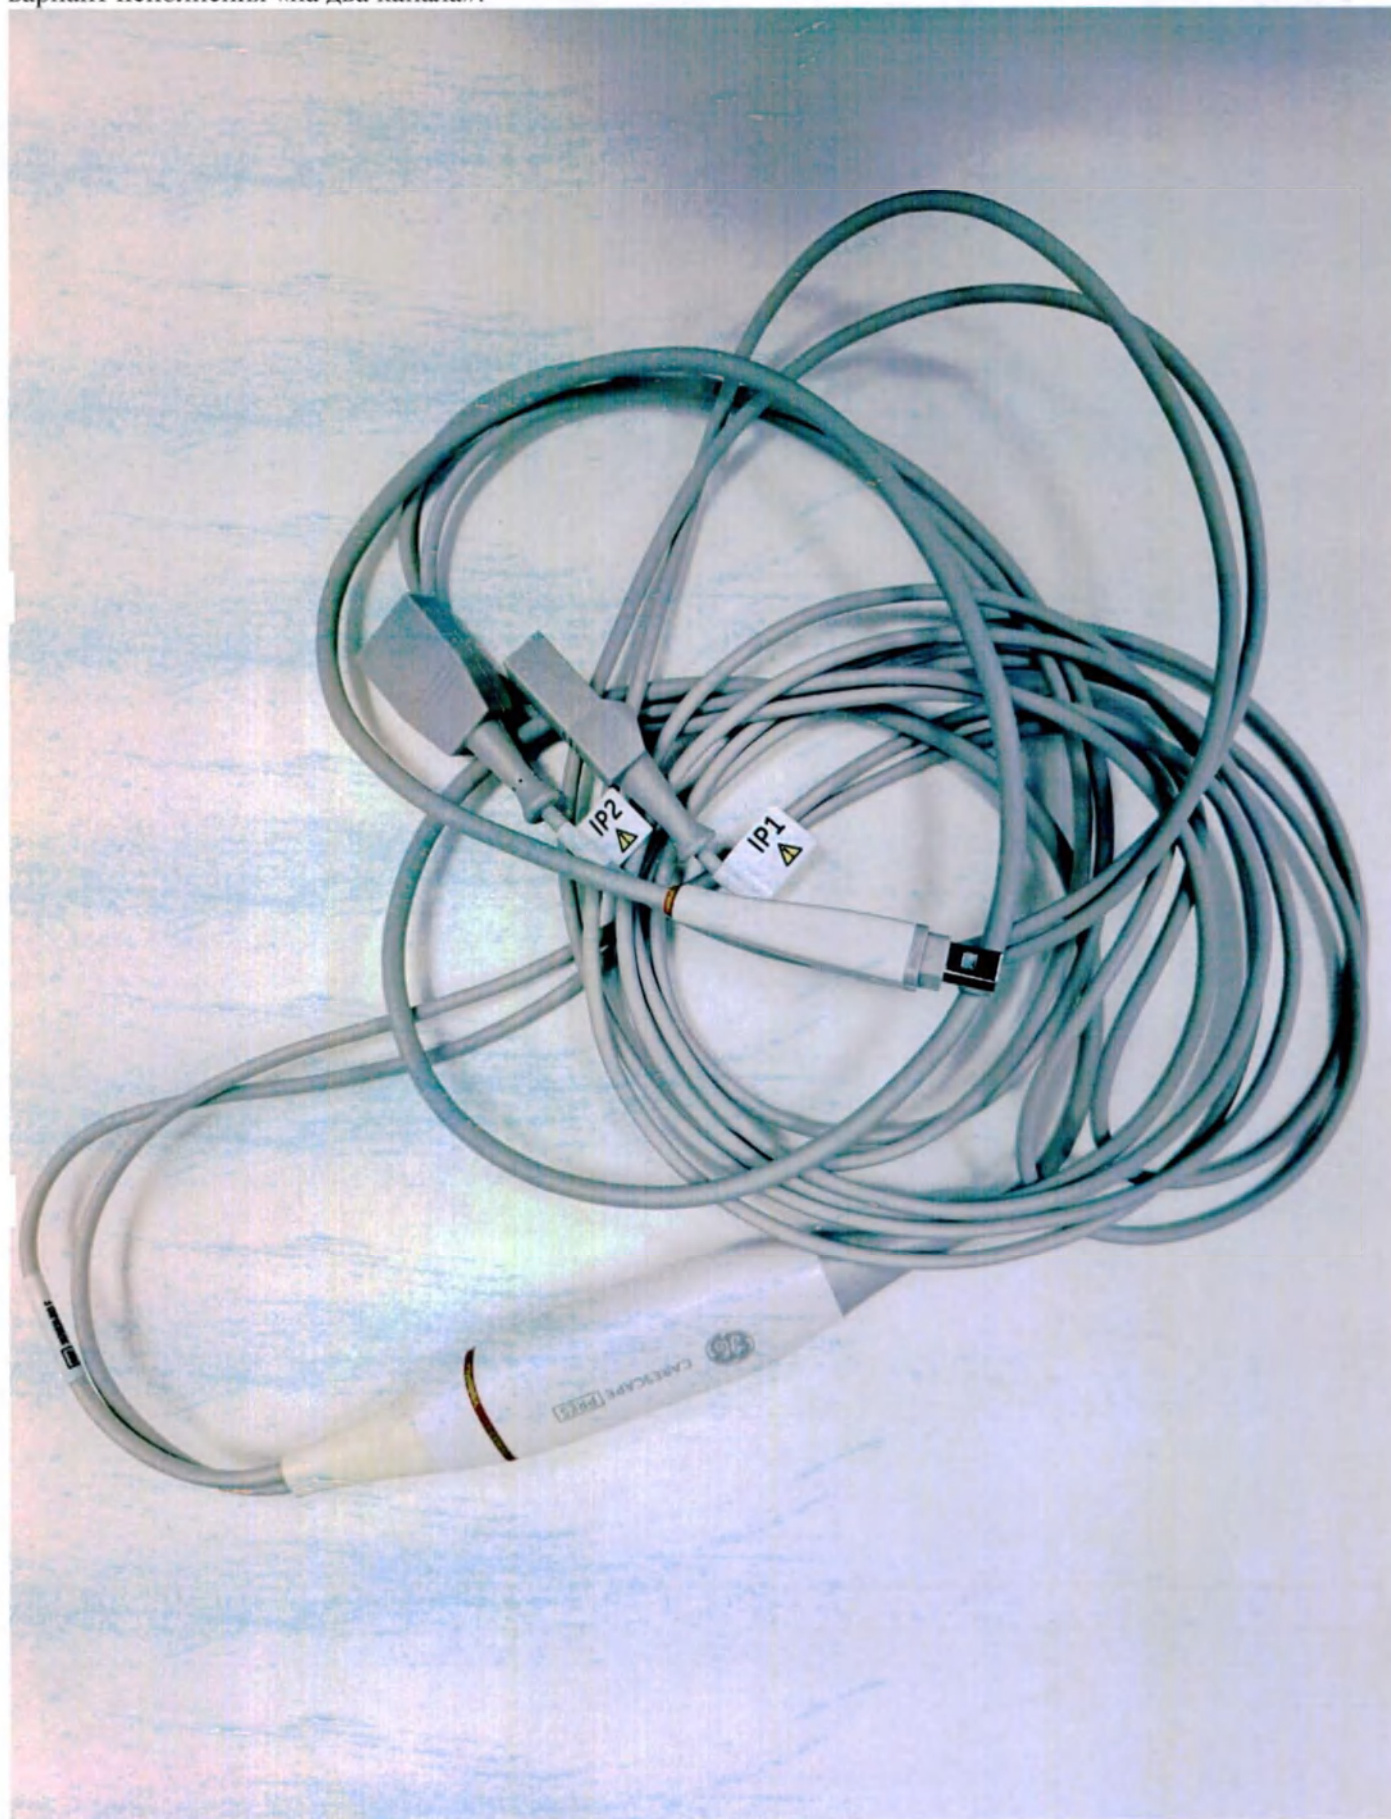


вариант исполнения «универсальный»:




24. Кабели температуры CARESCAPE Temperature (не более 20 шт.) (при необходимости)




25. Кабели пульсоксиметрии CARESCAPE SpO2 (не более 20 шт.) (при необходимости):

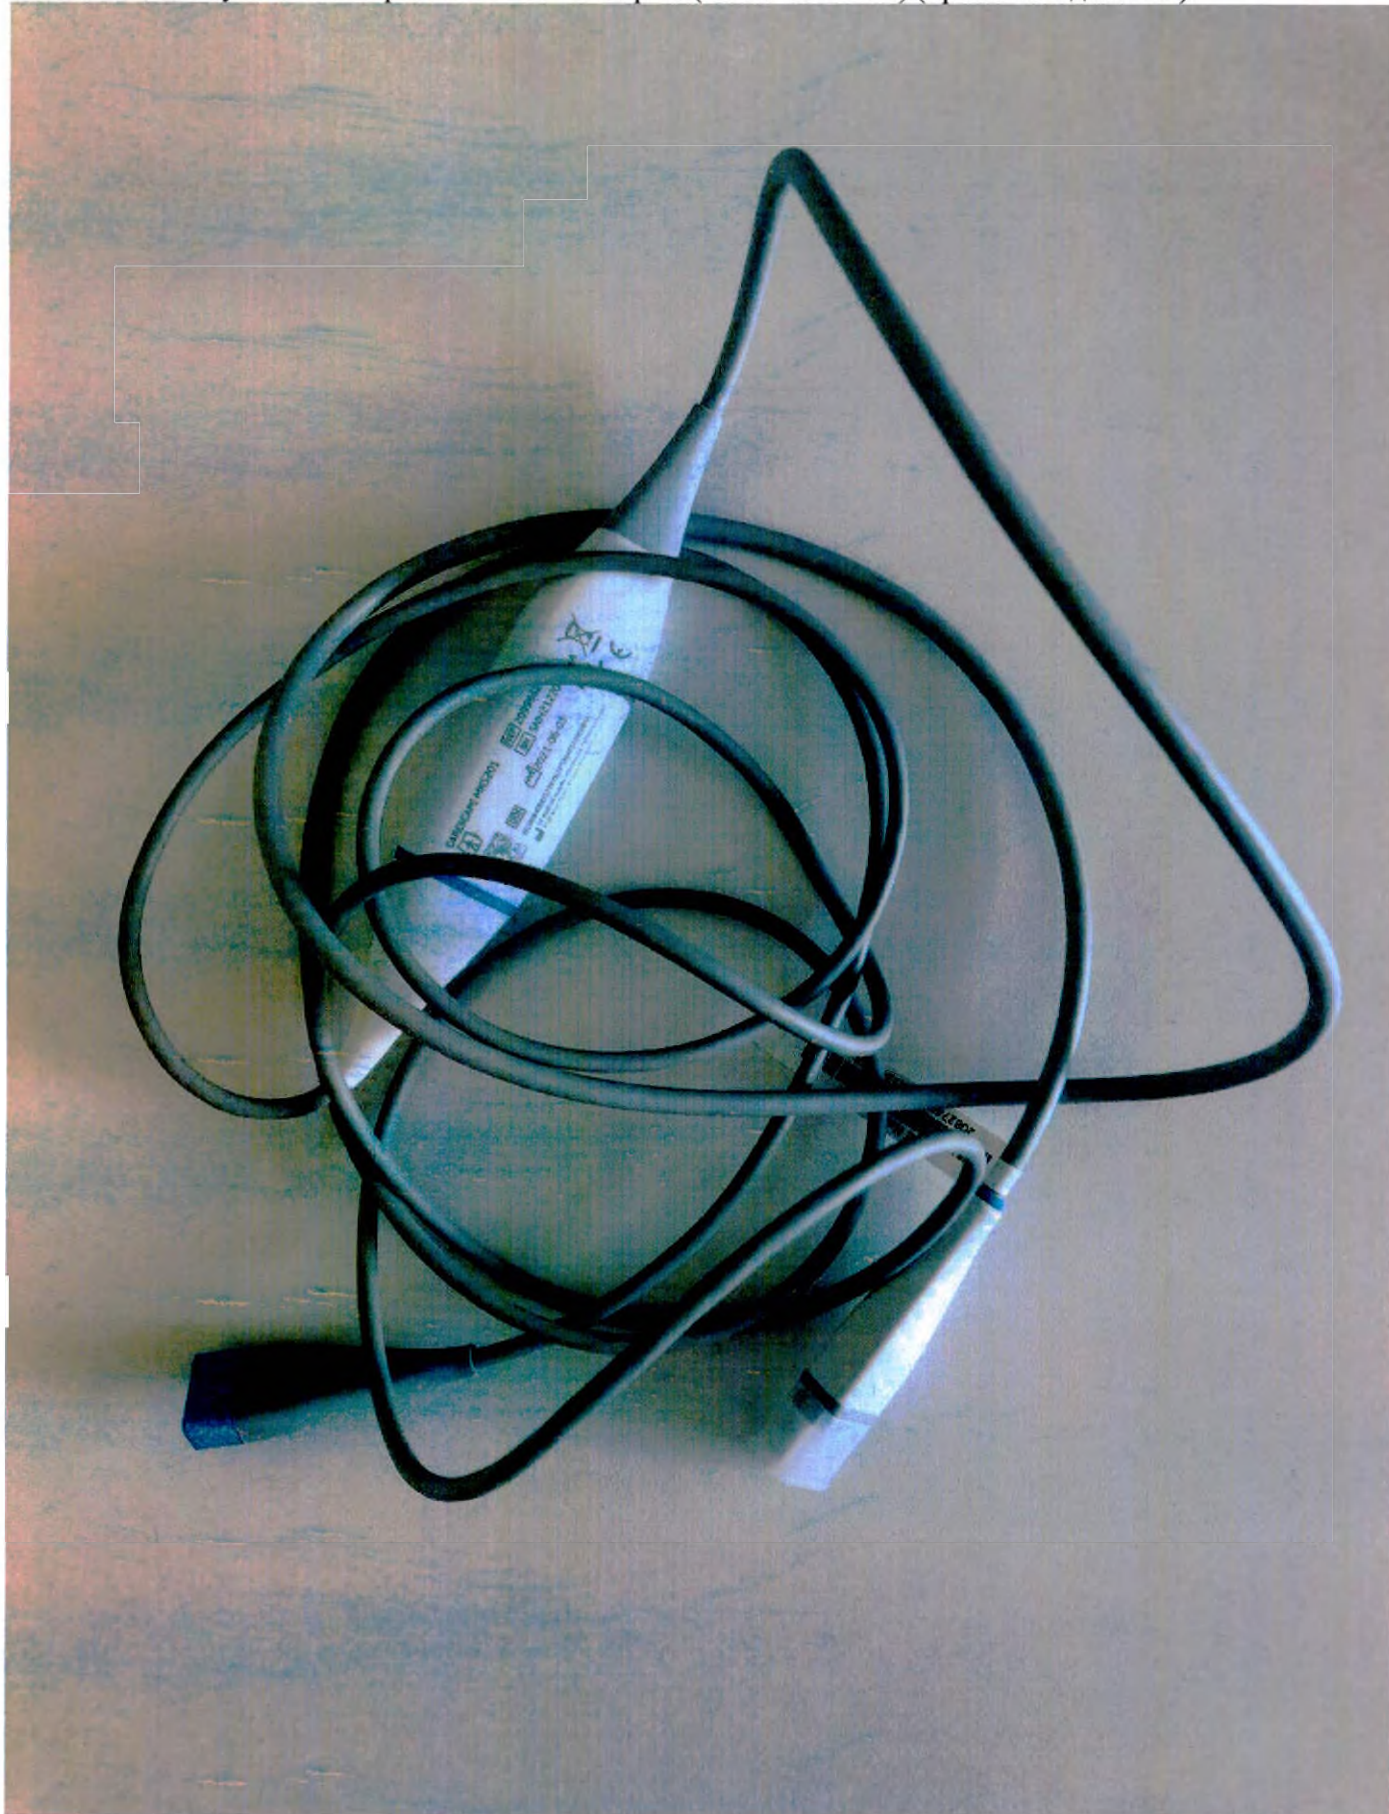


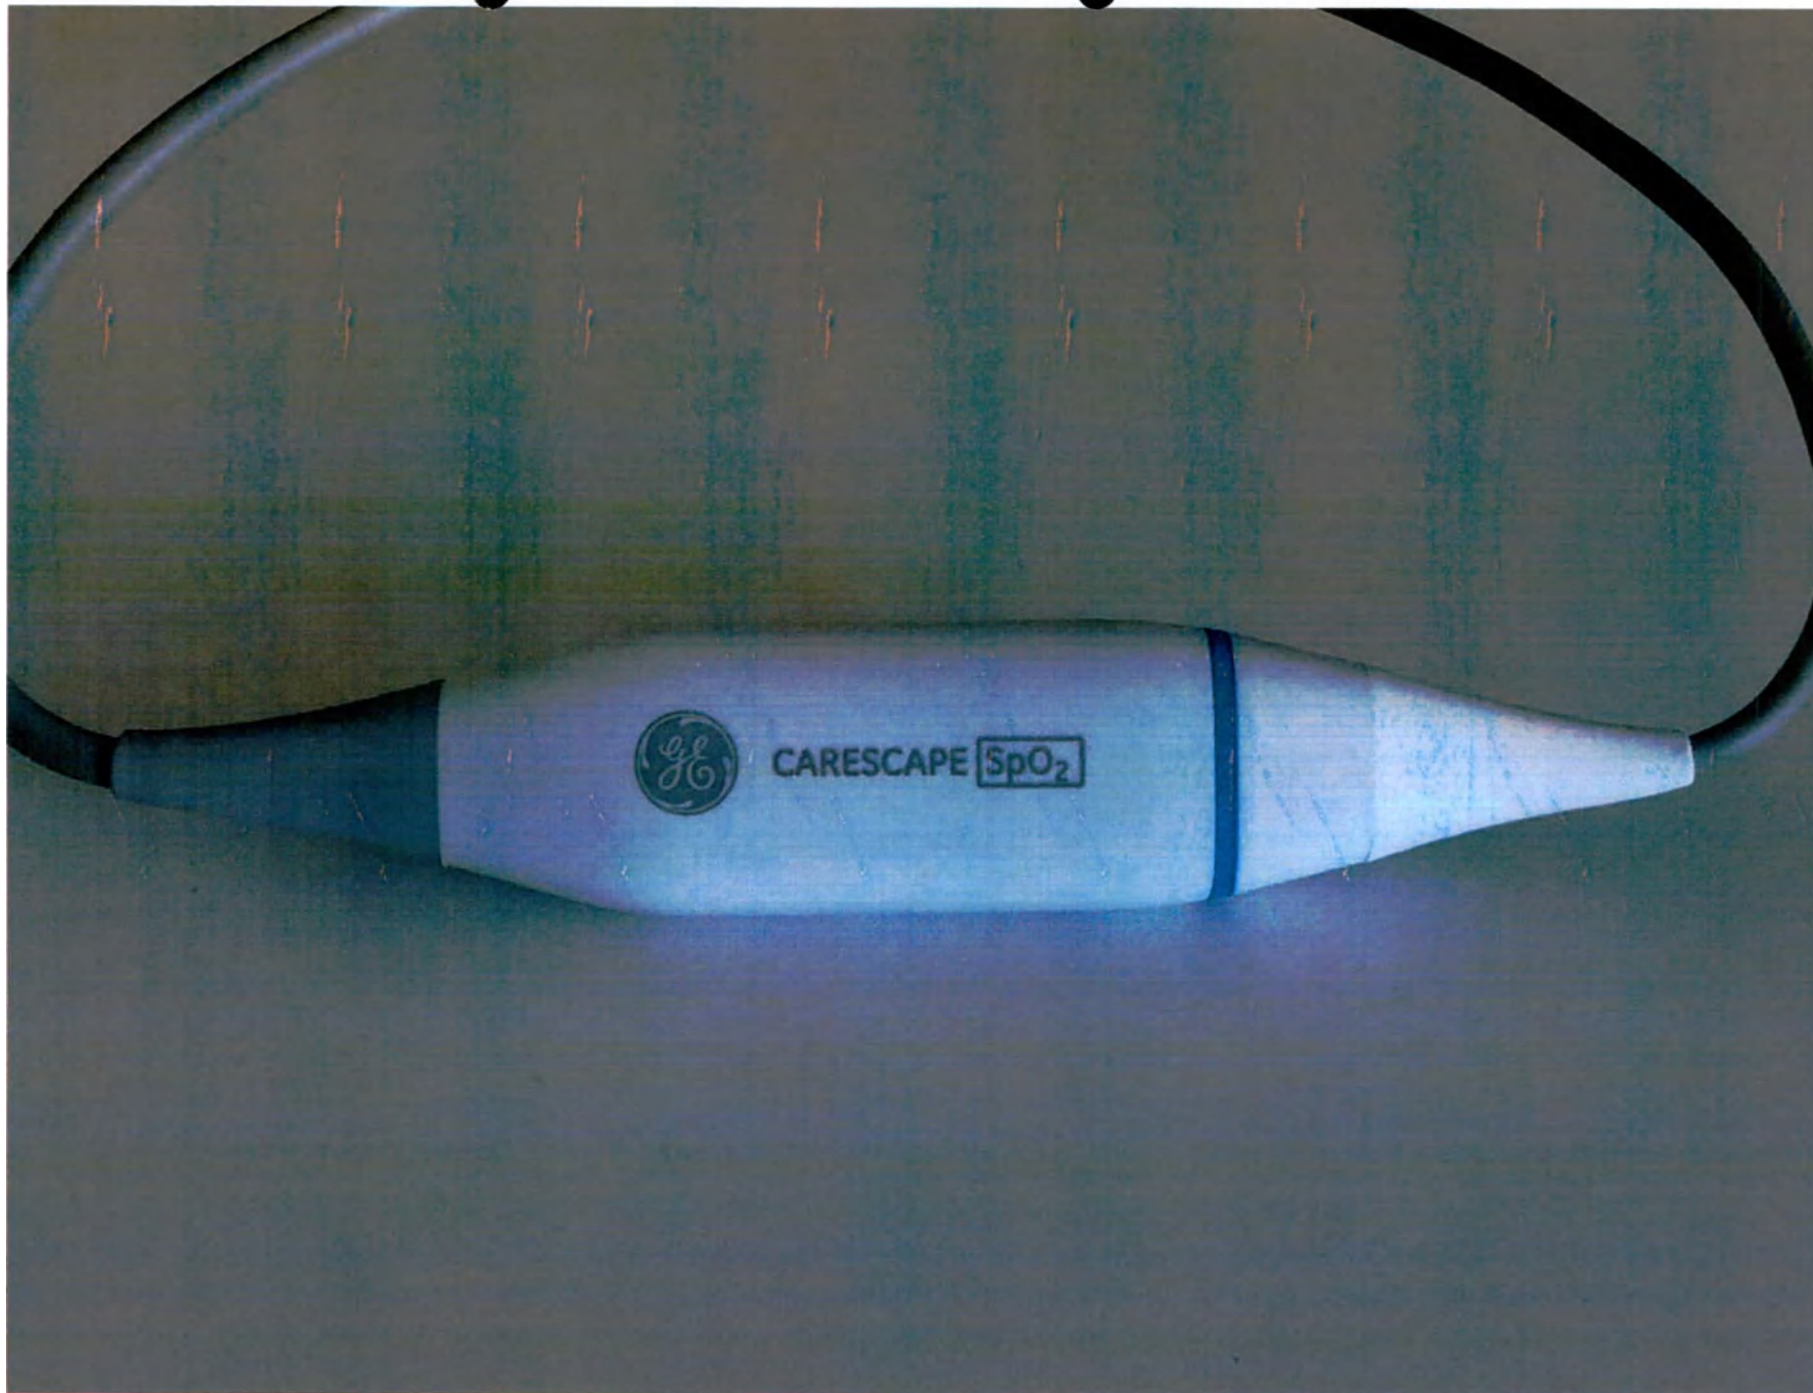


26. Интерфейсный кабель пульсоксиметрии Masimo (не более 20 шт.) (при необходимости):

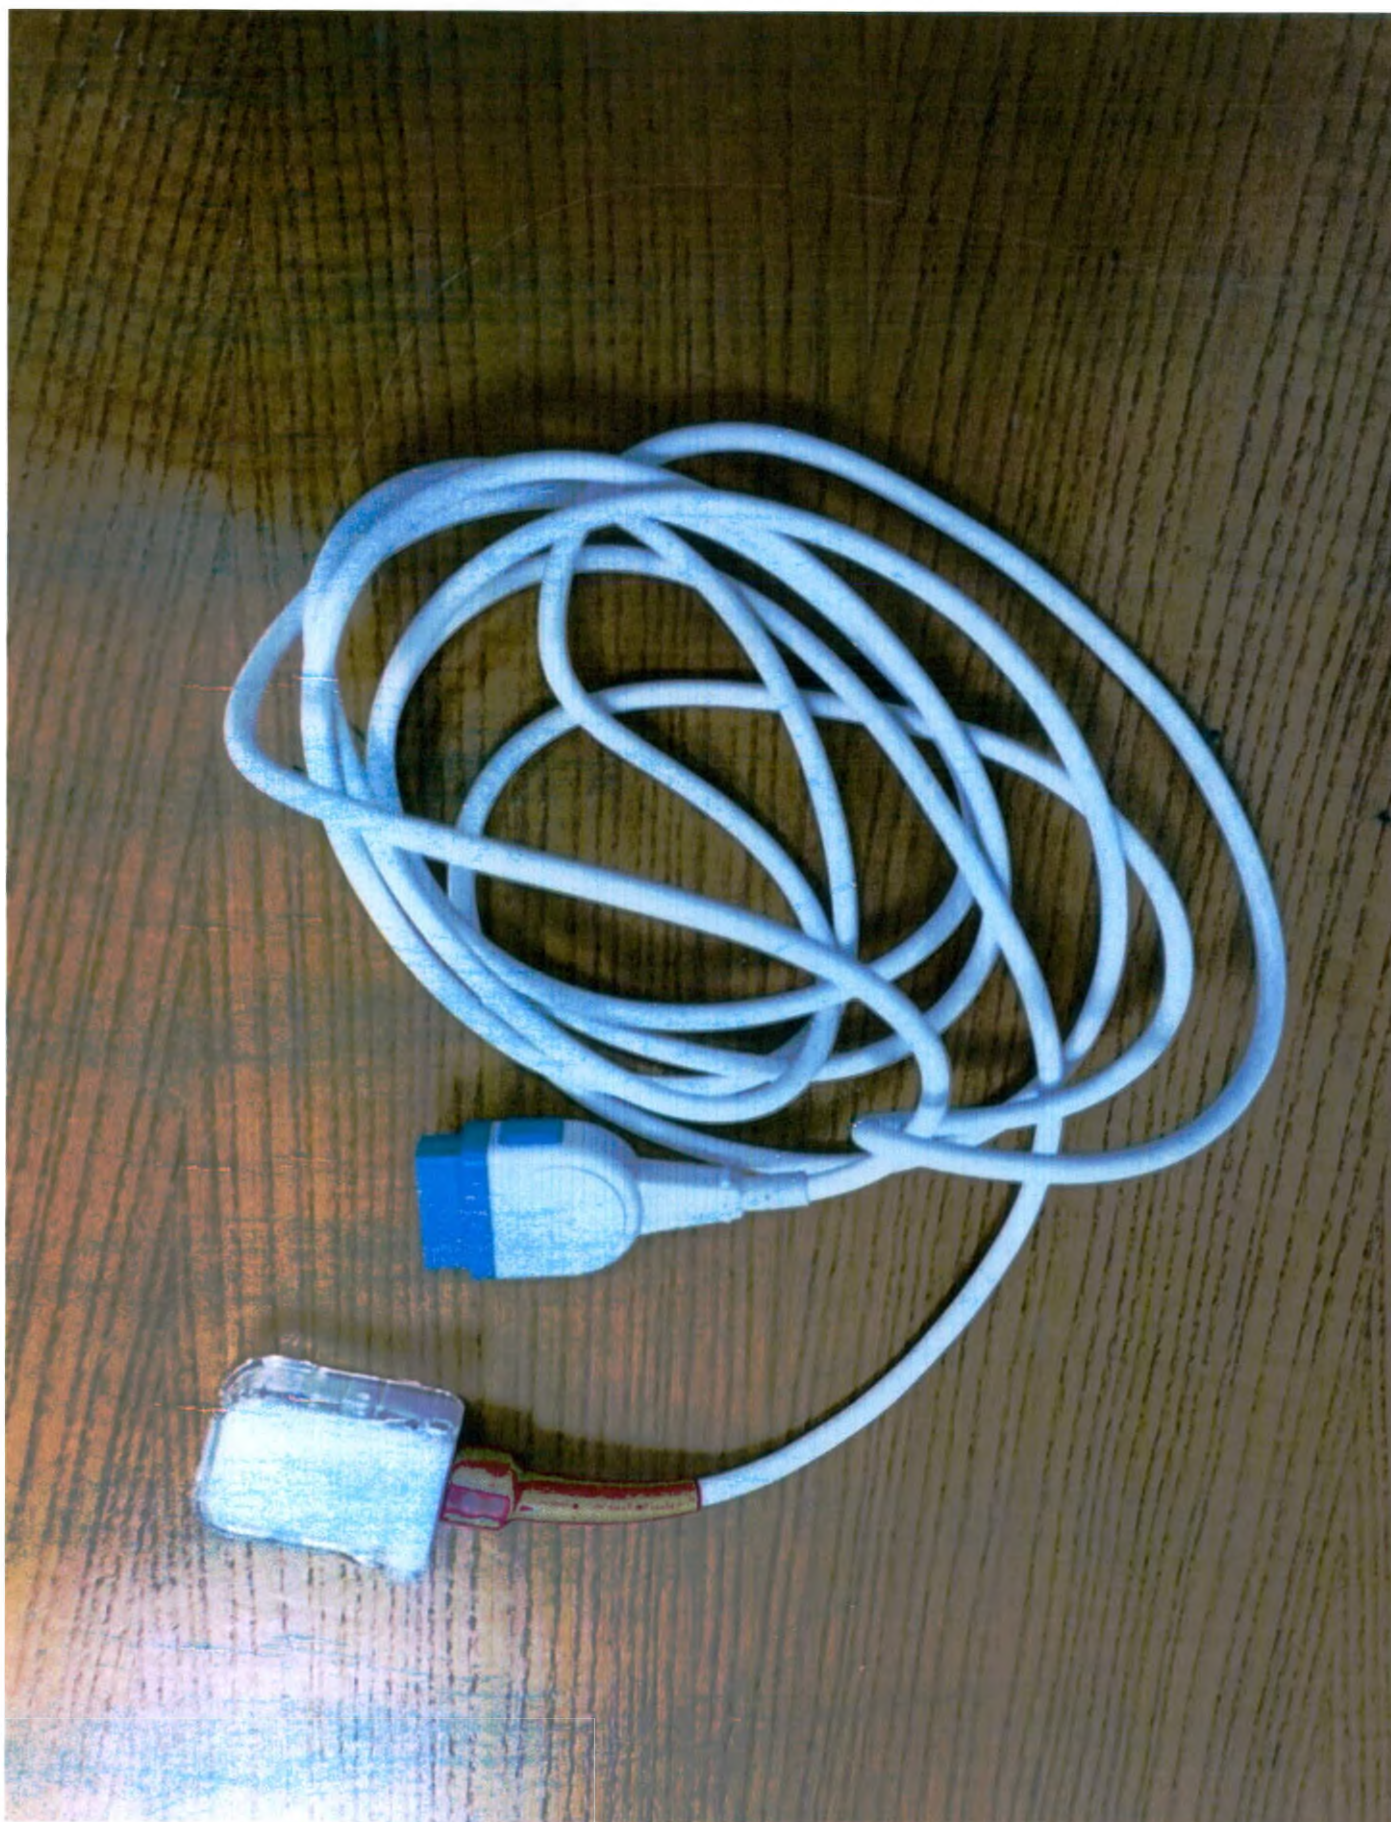



Принадлежности:
1. Ролл-стенды

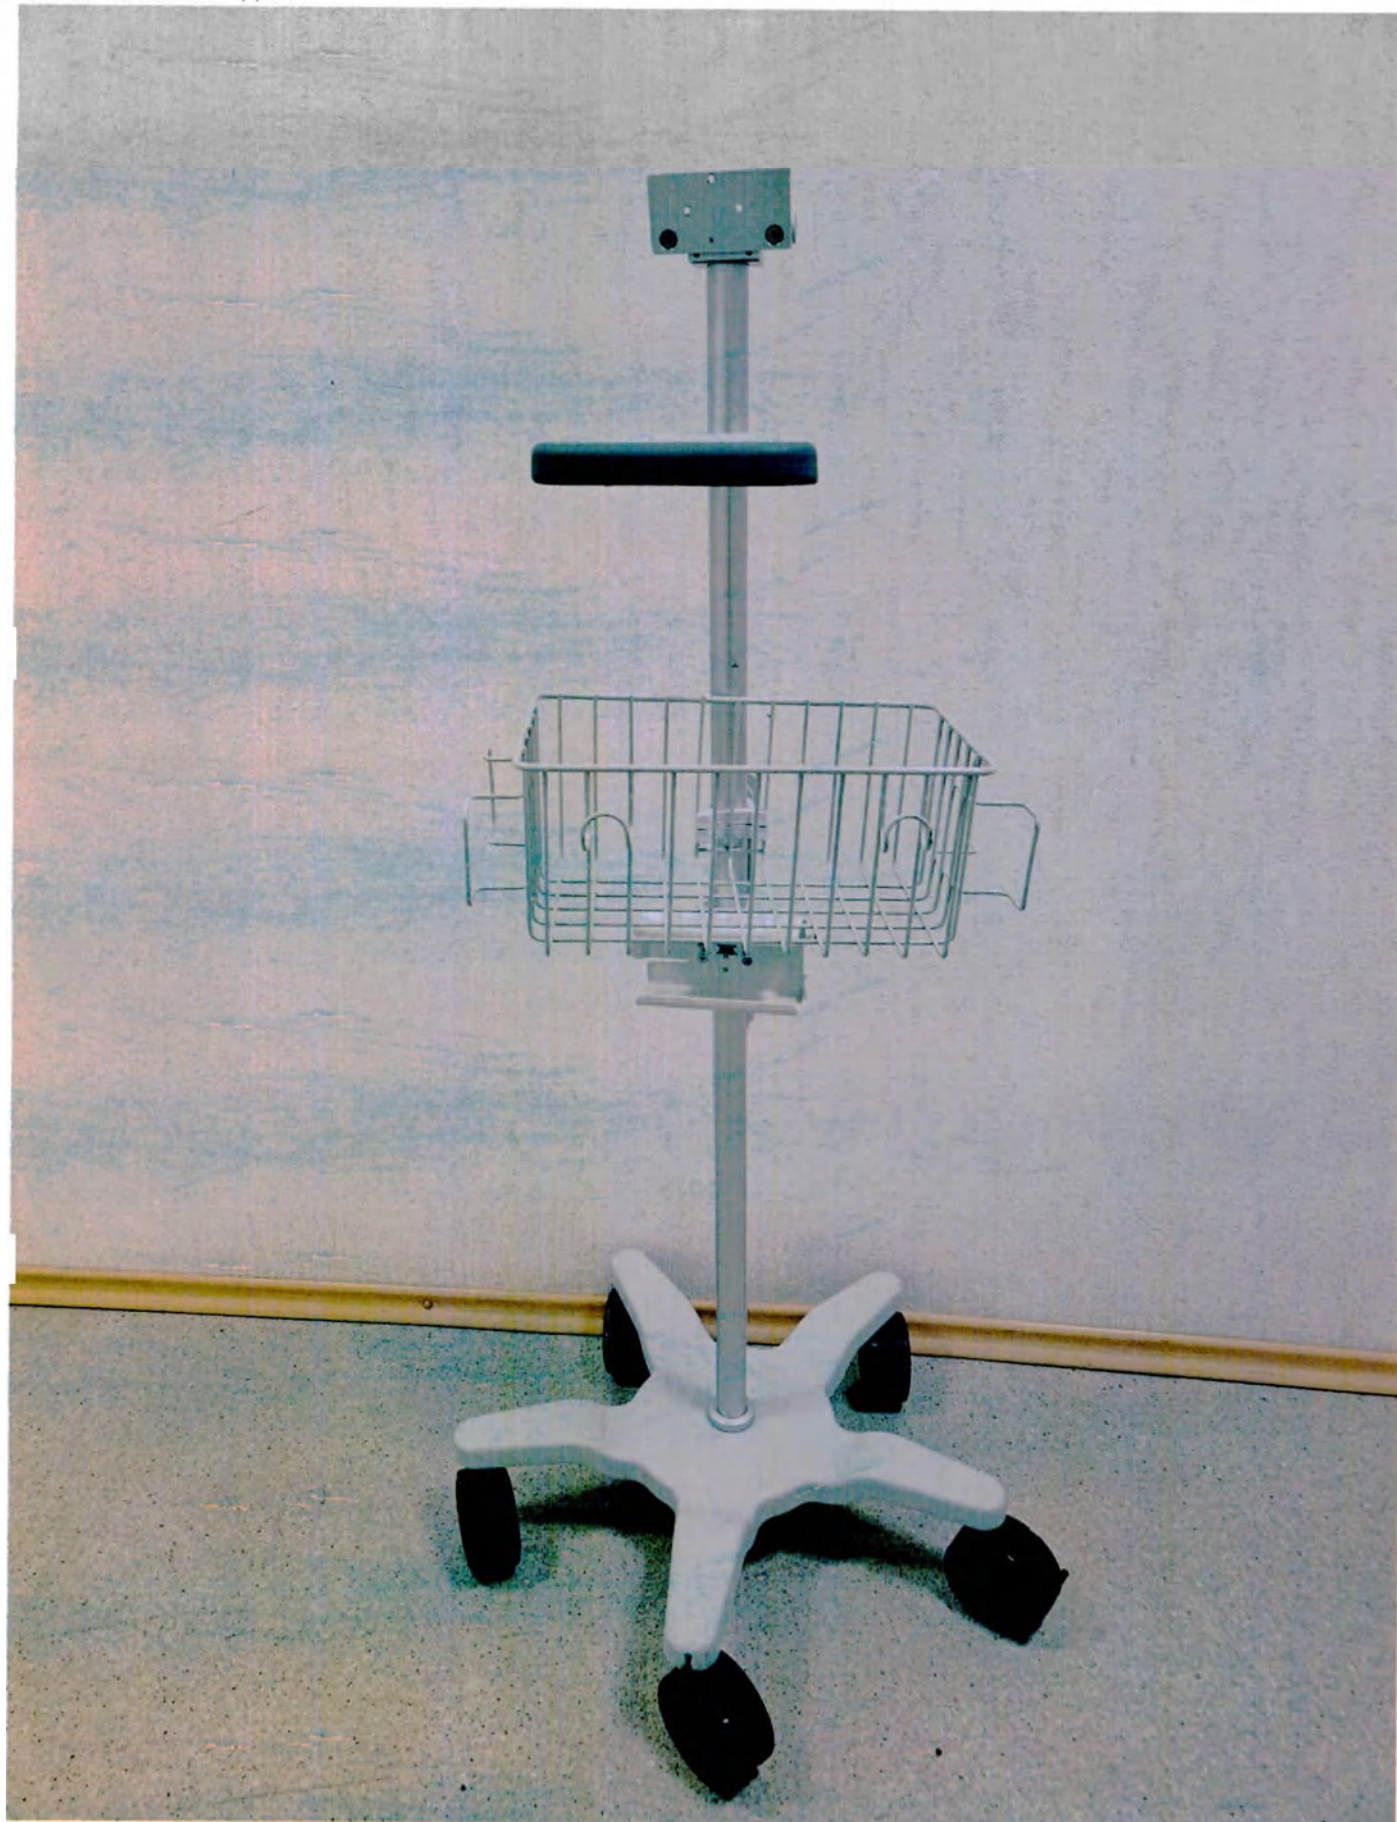



2. Крепления

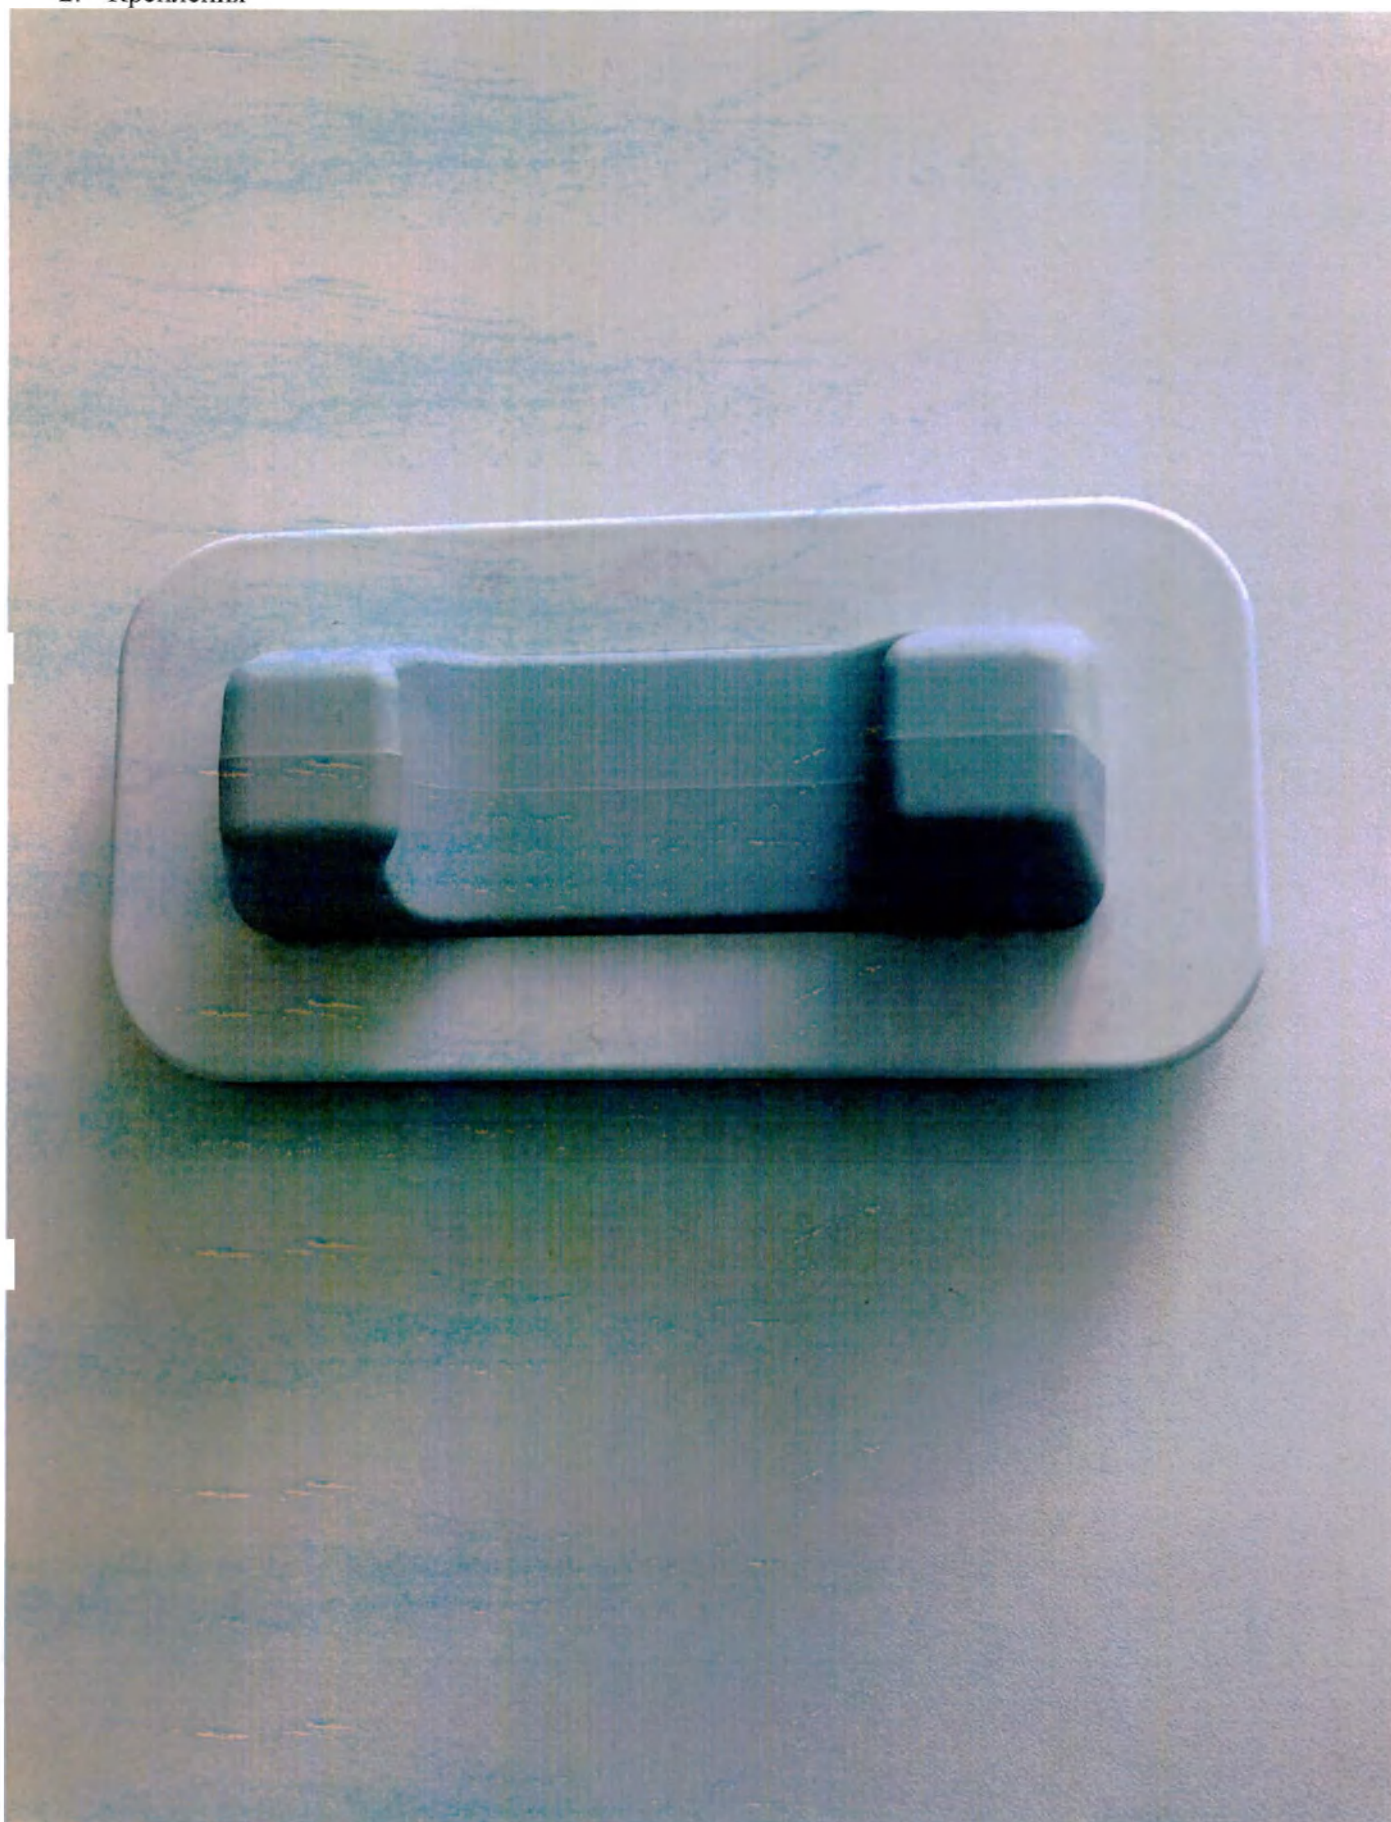


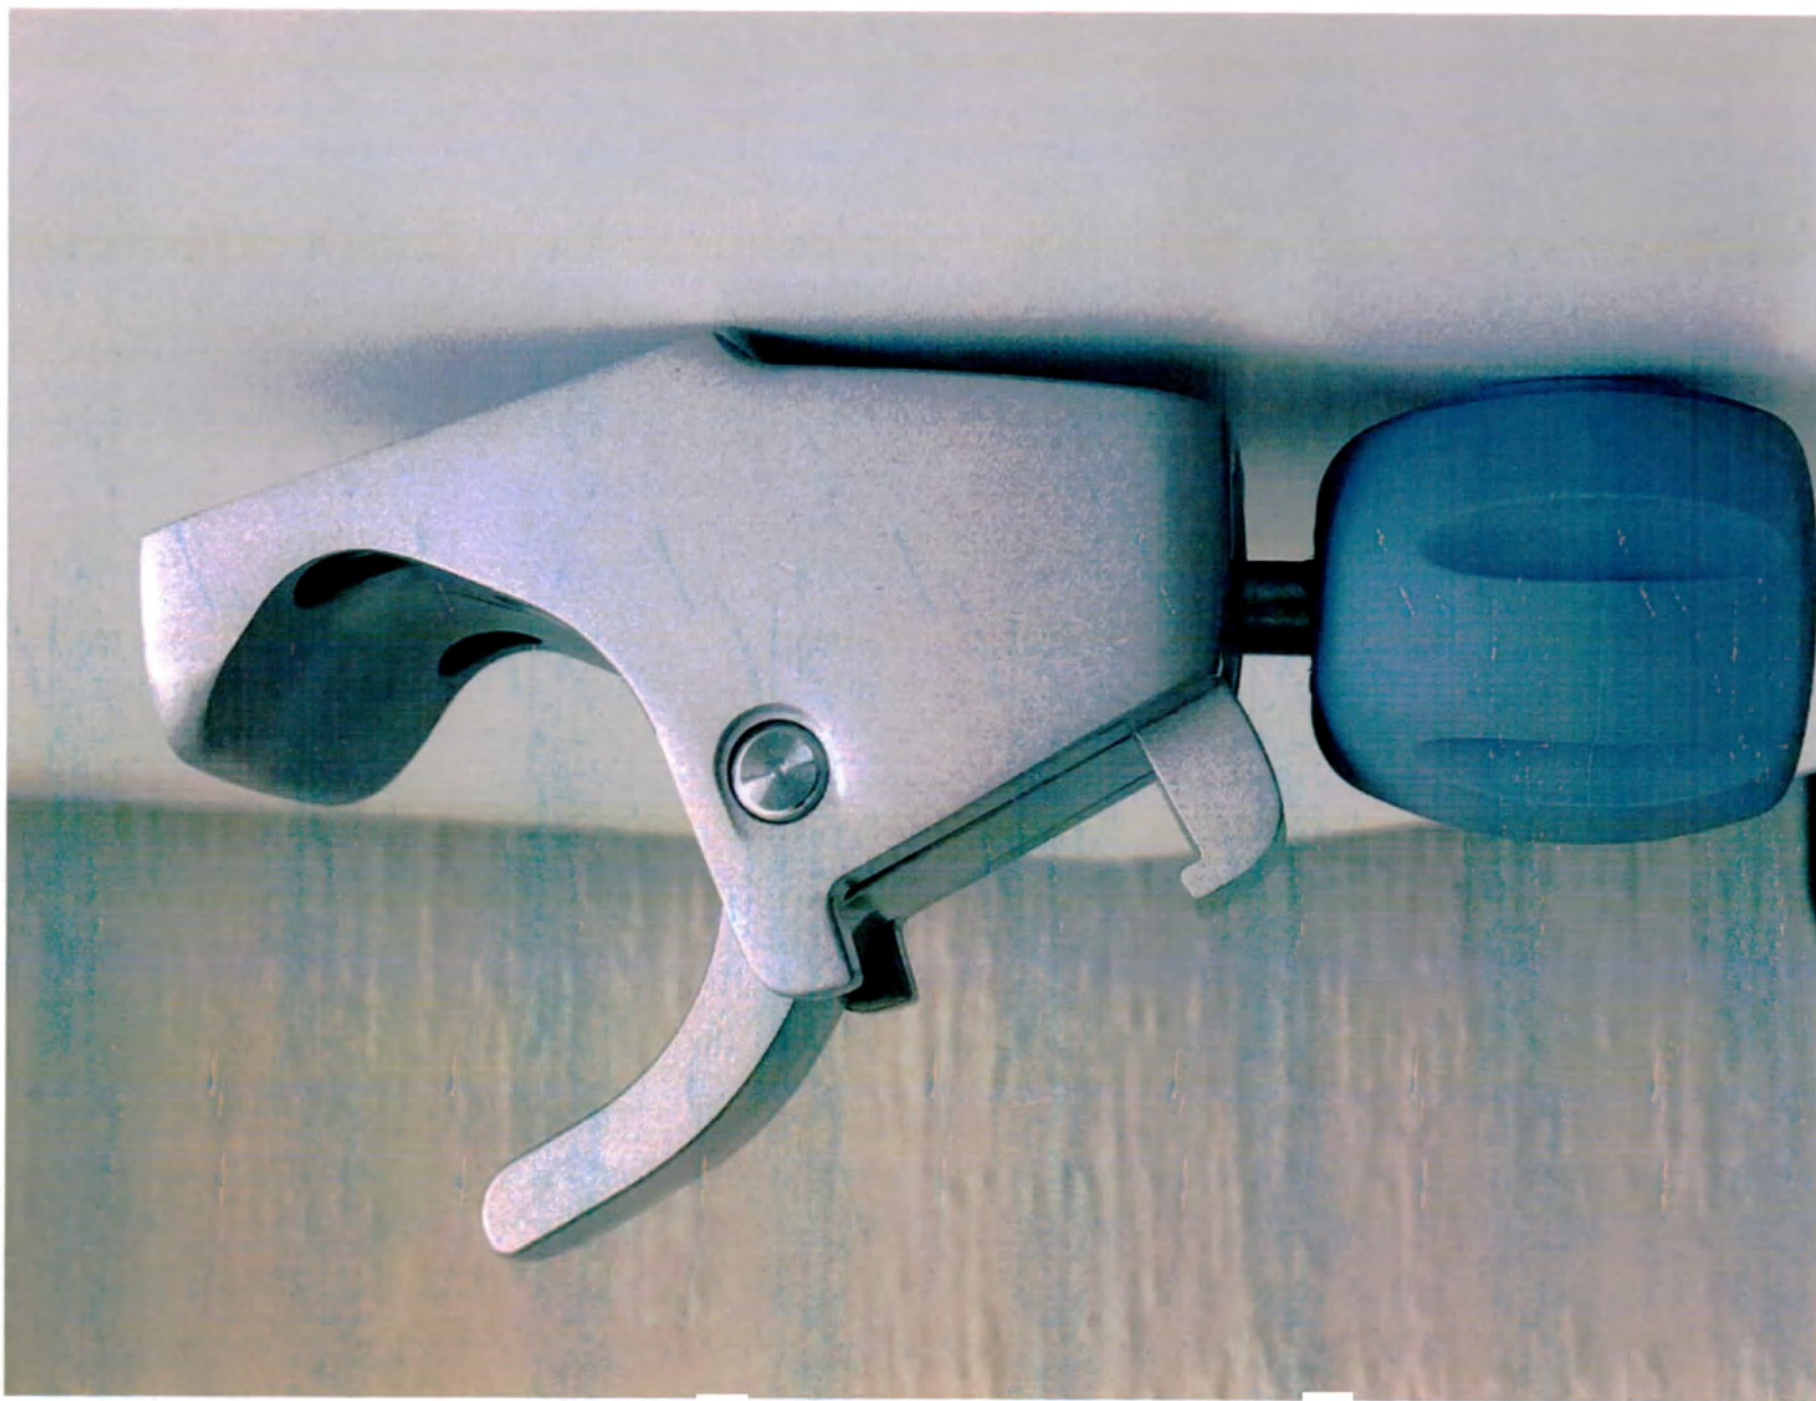


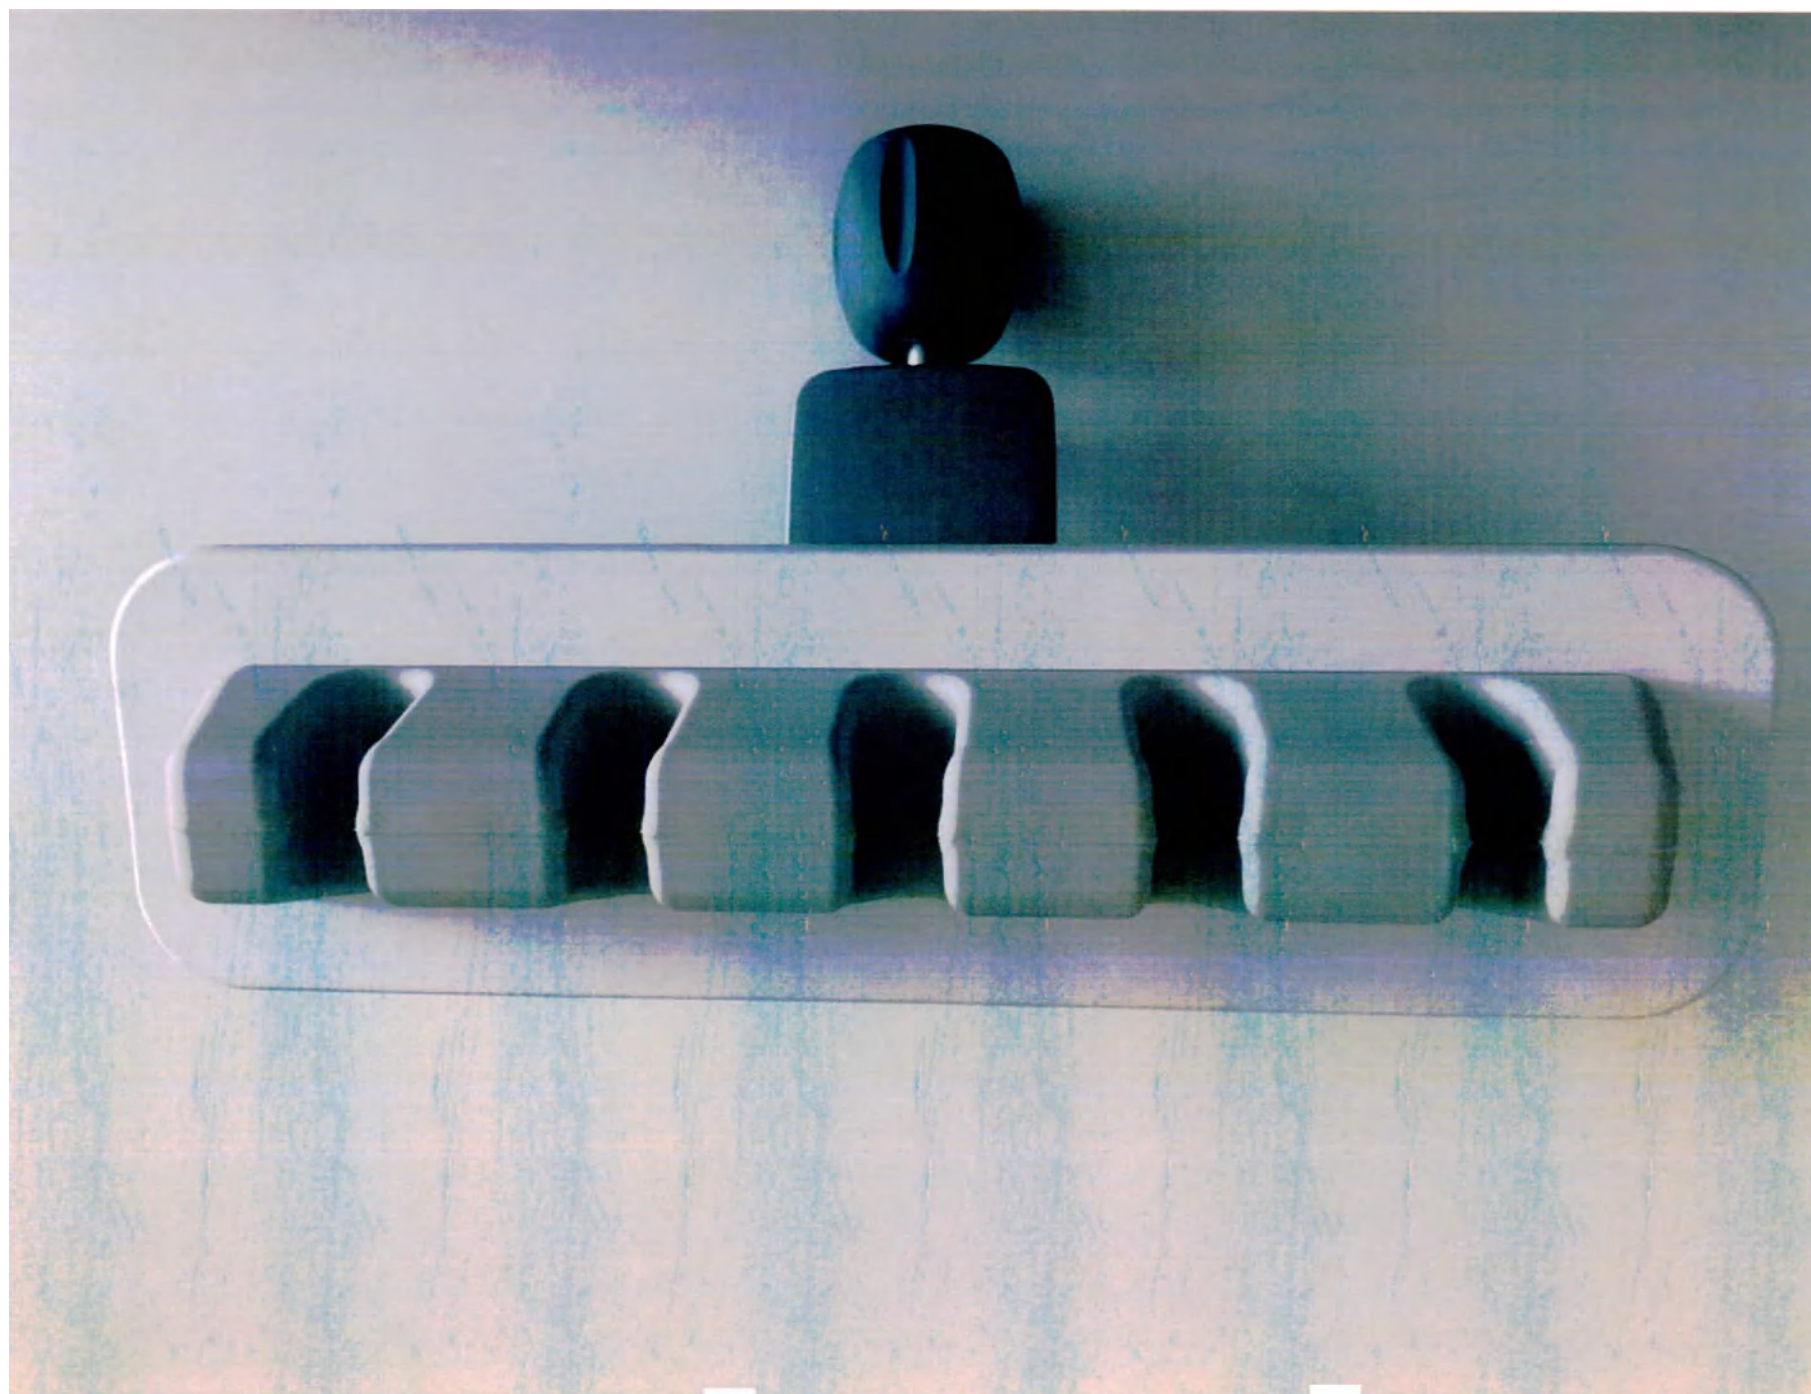

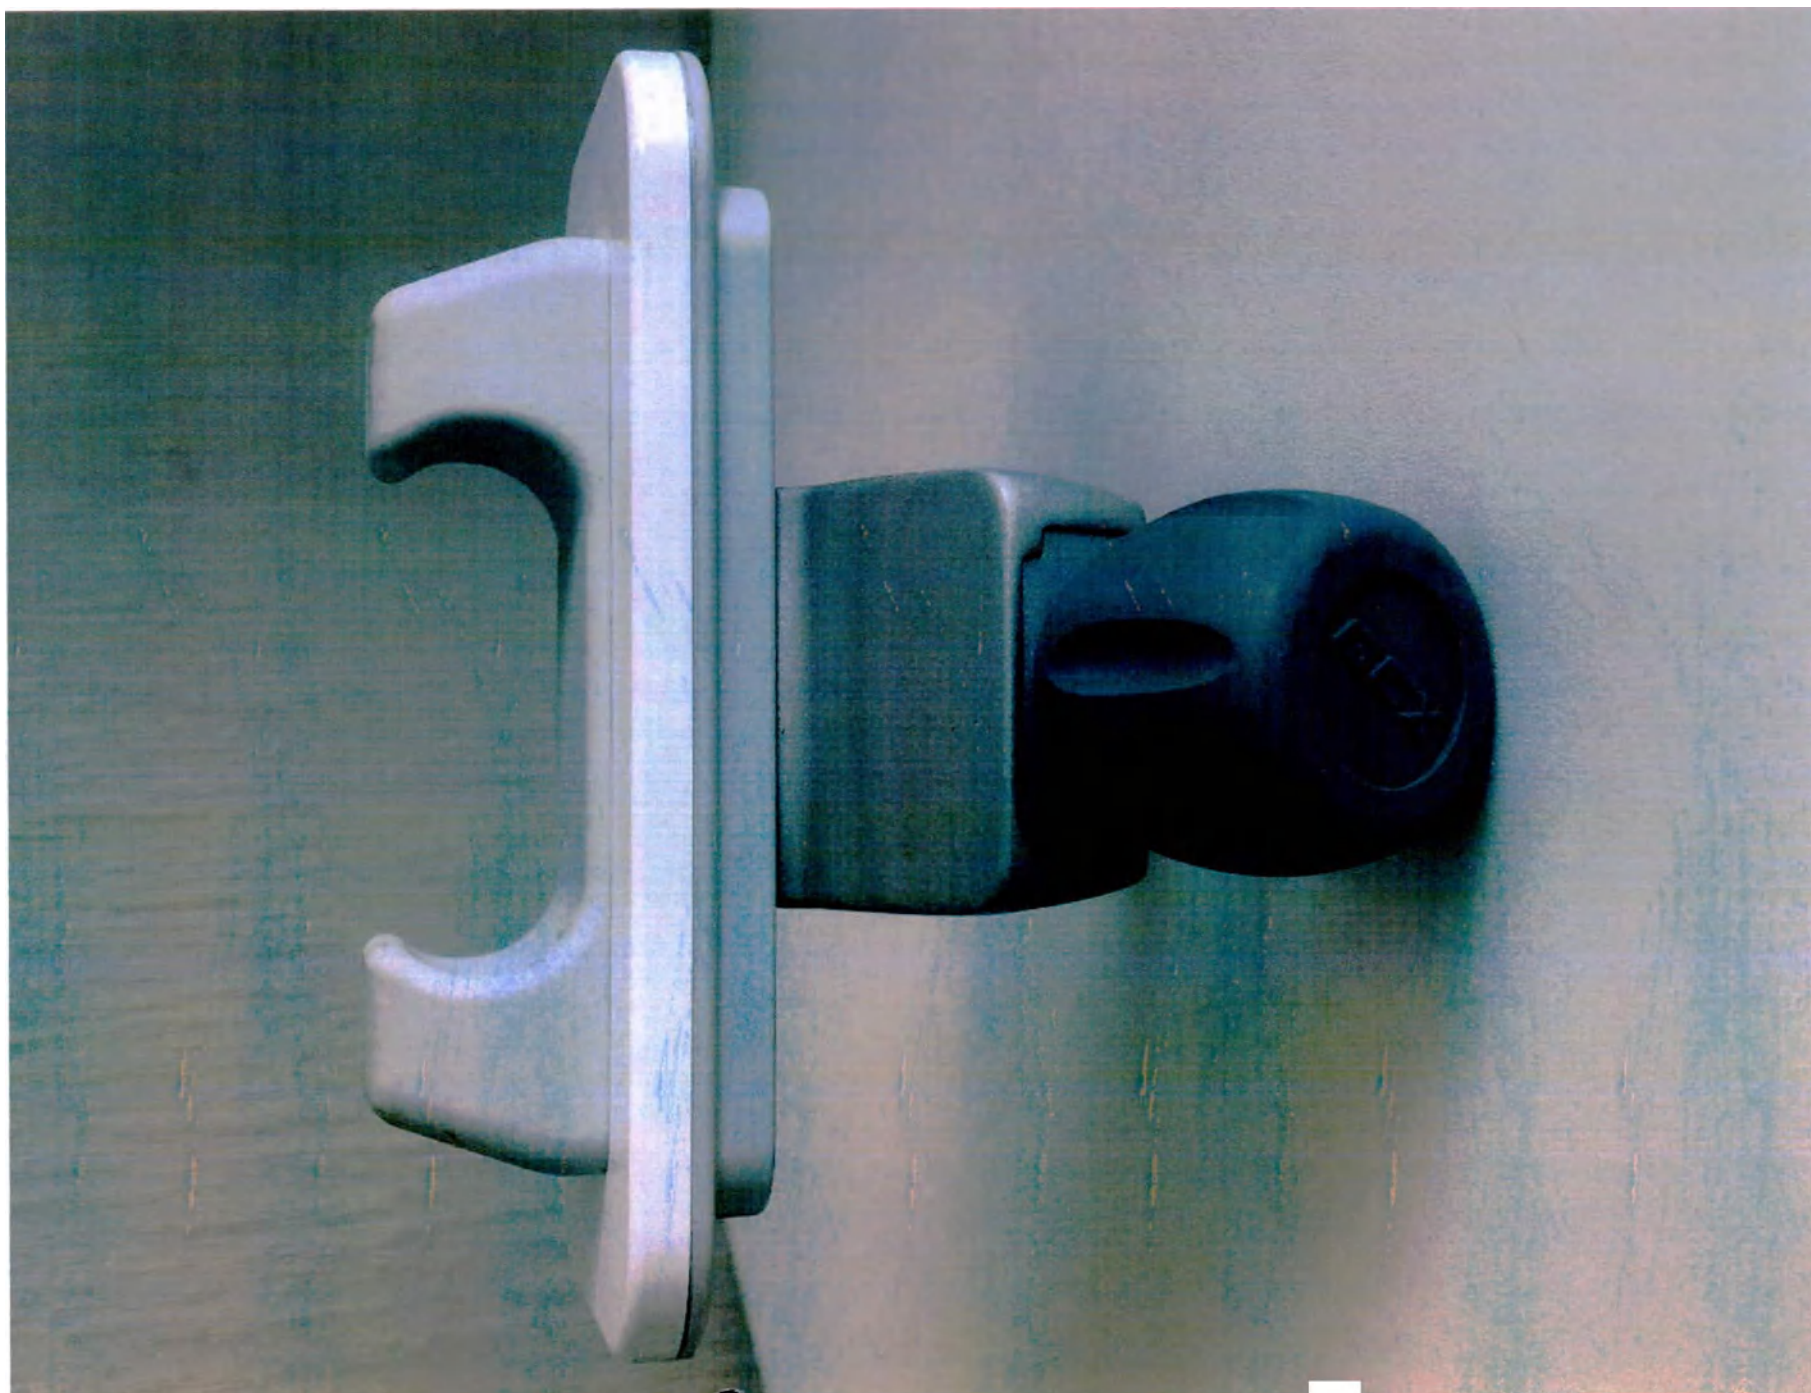


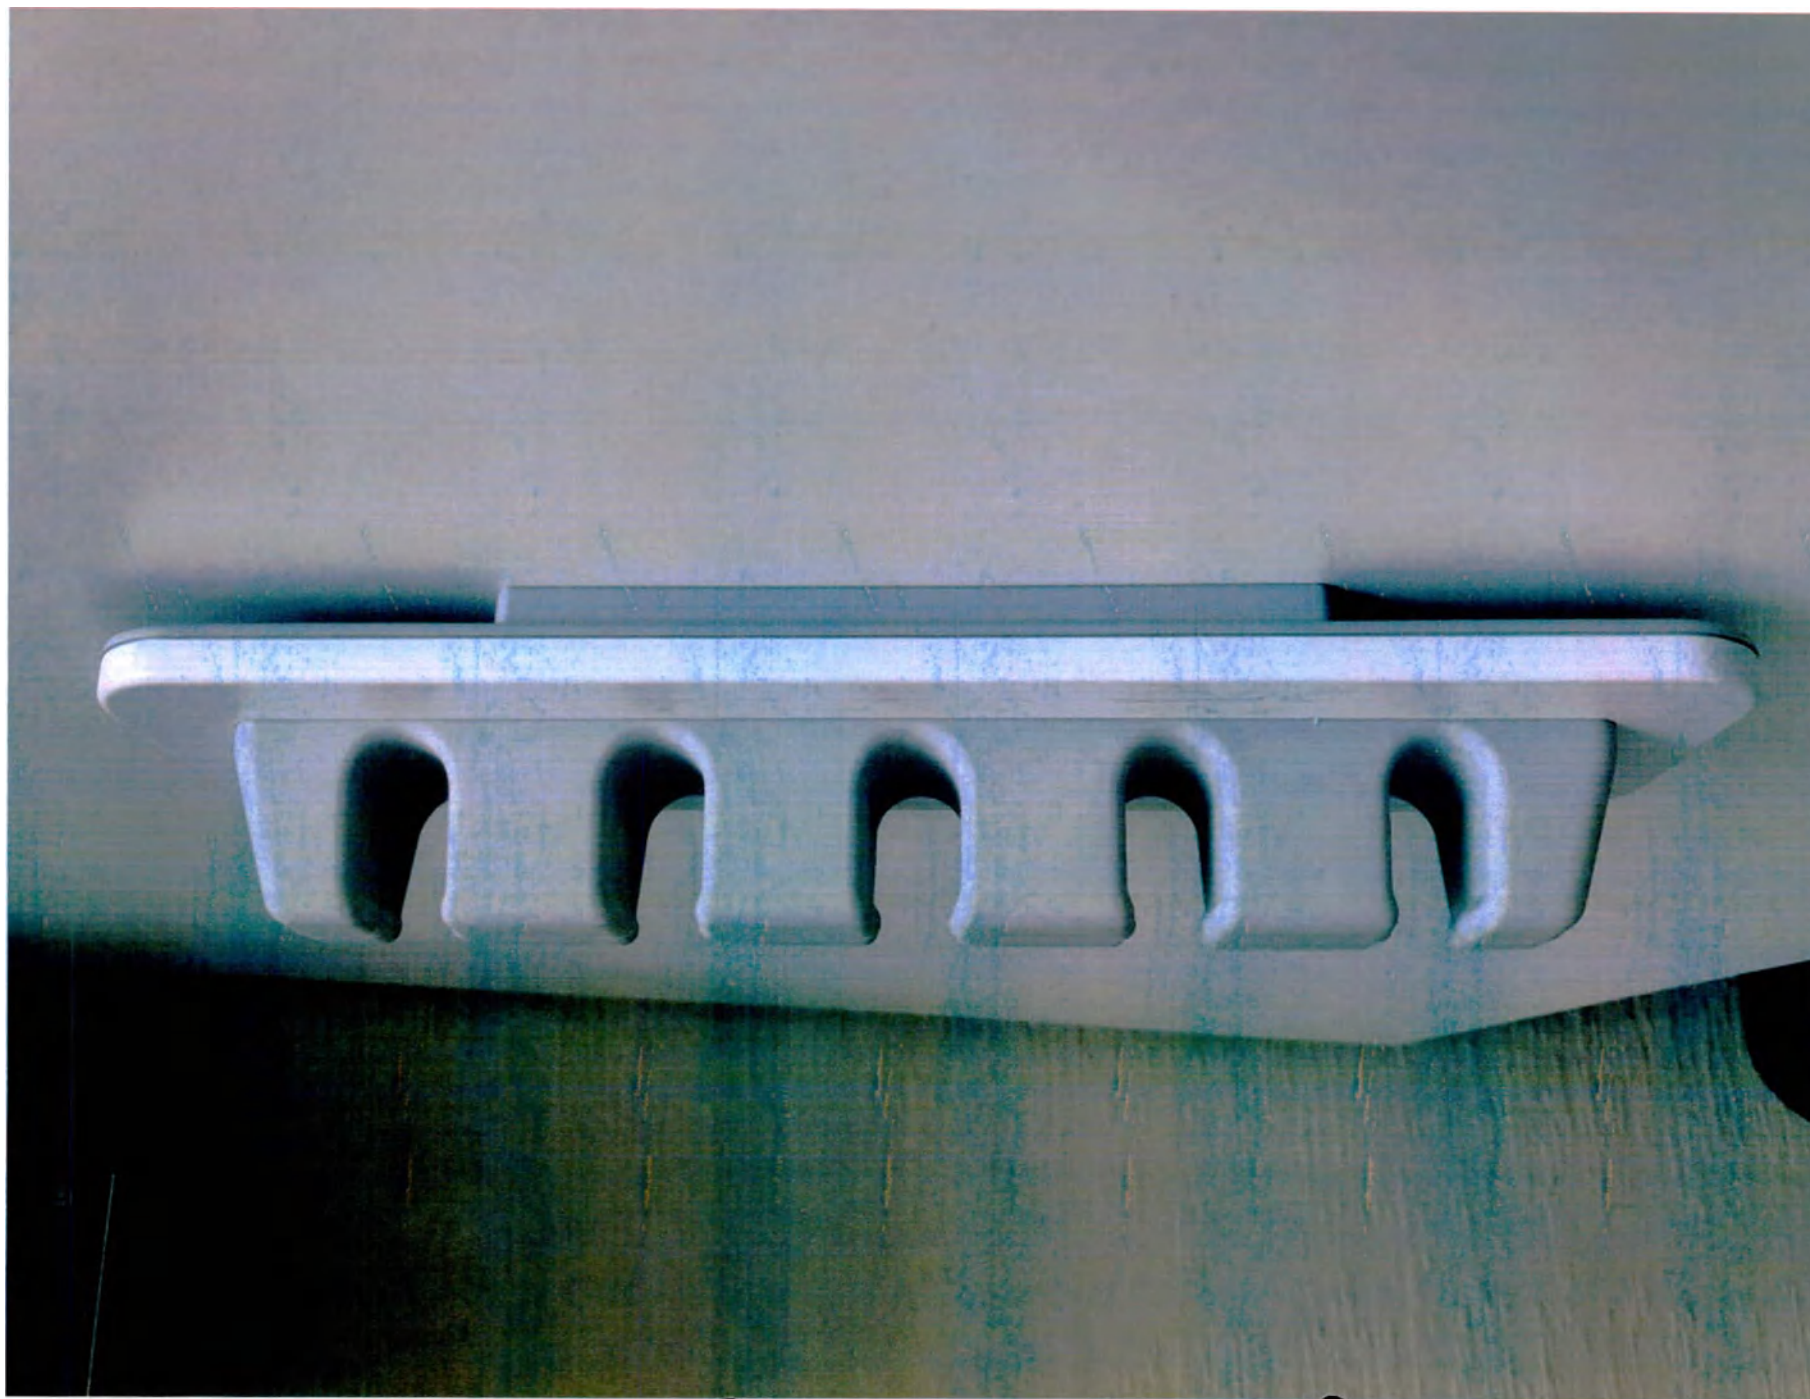

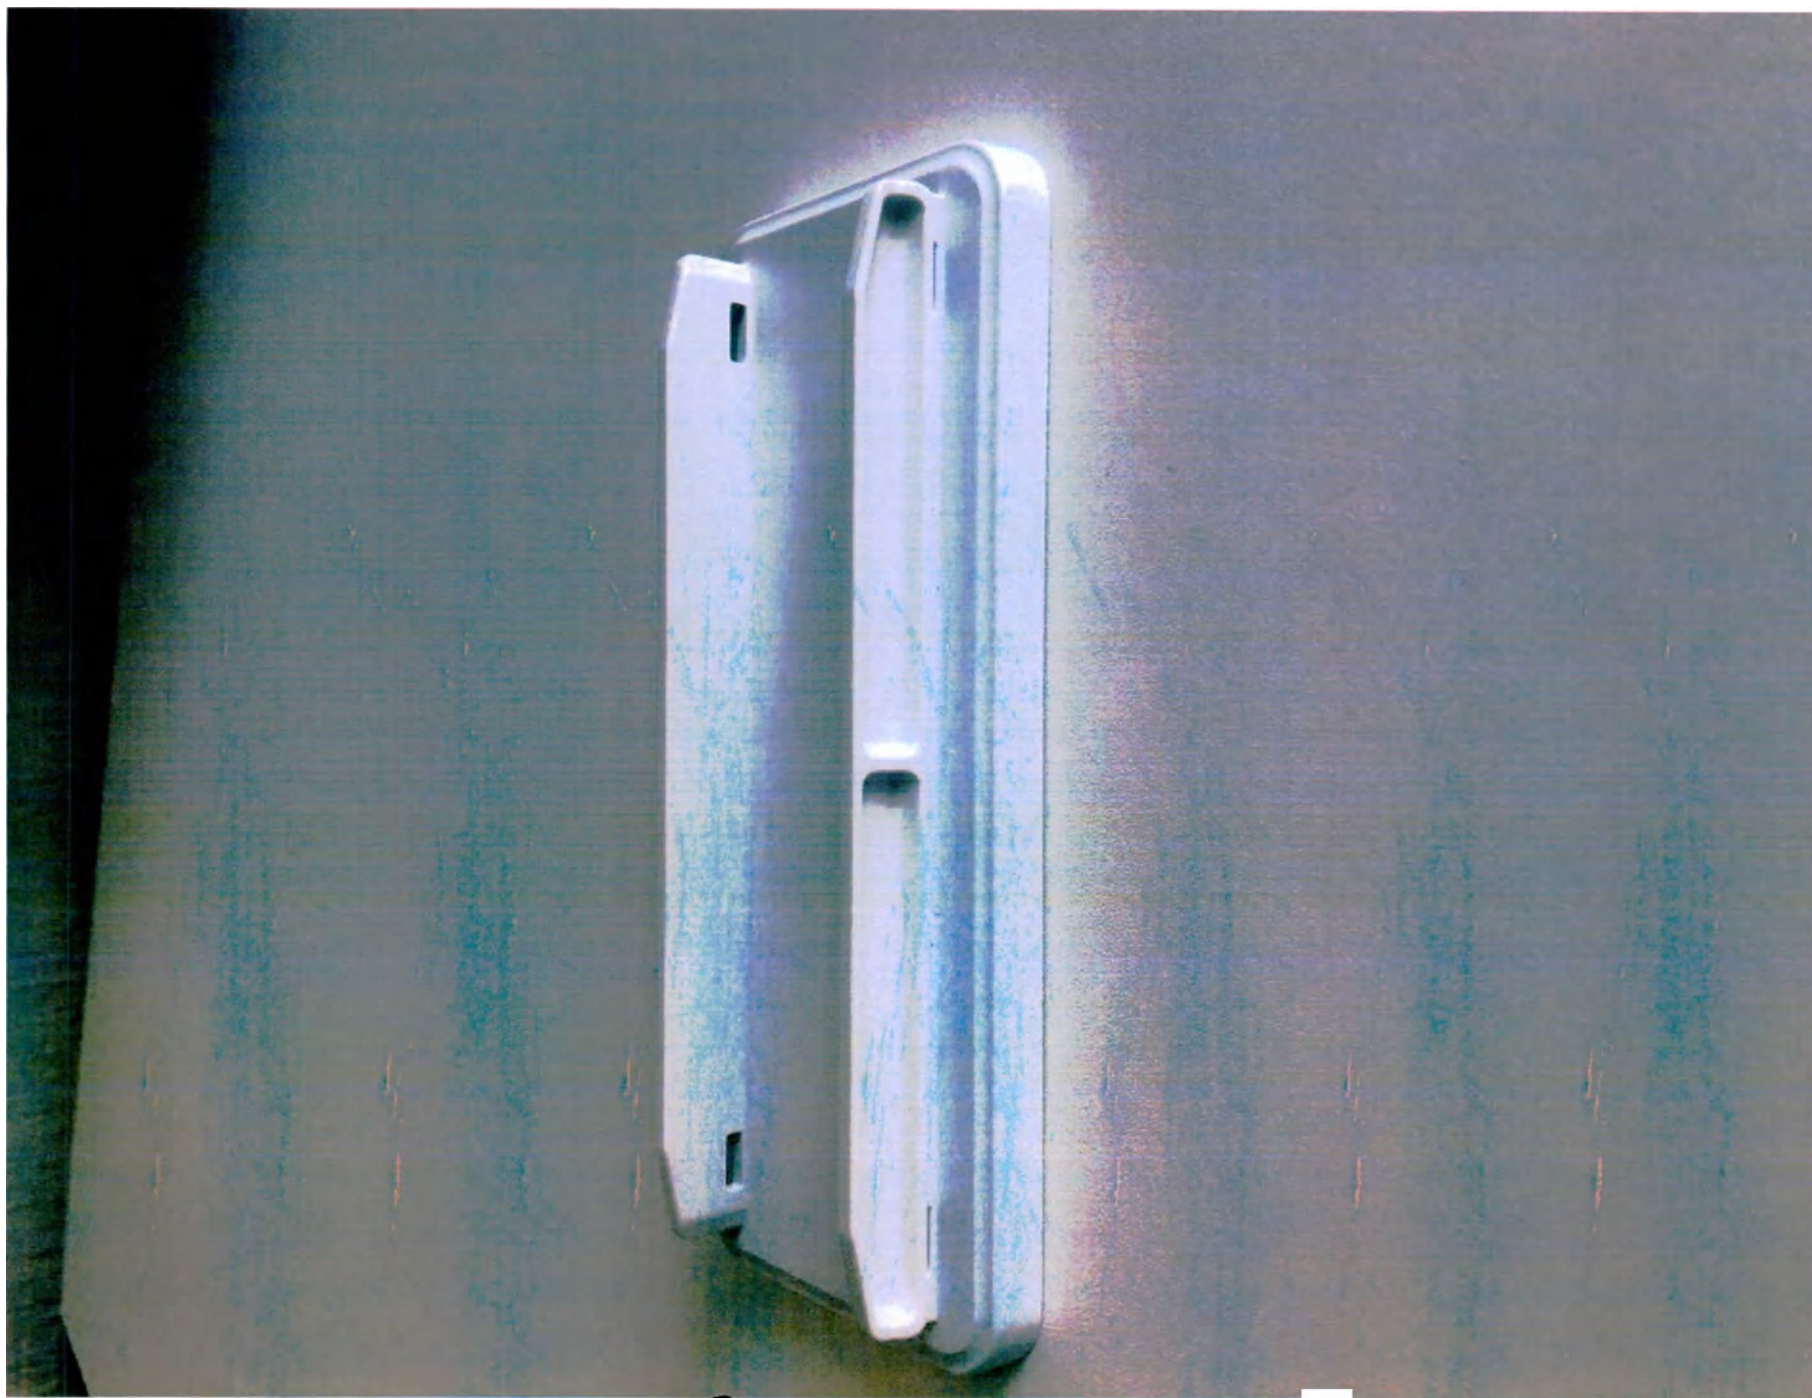

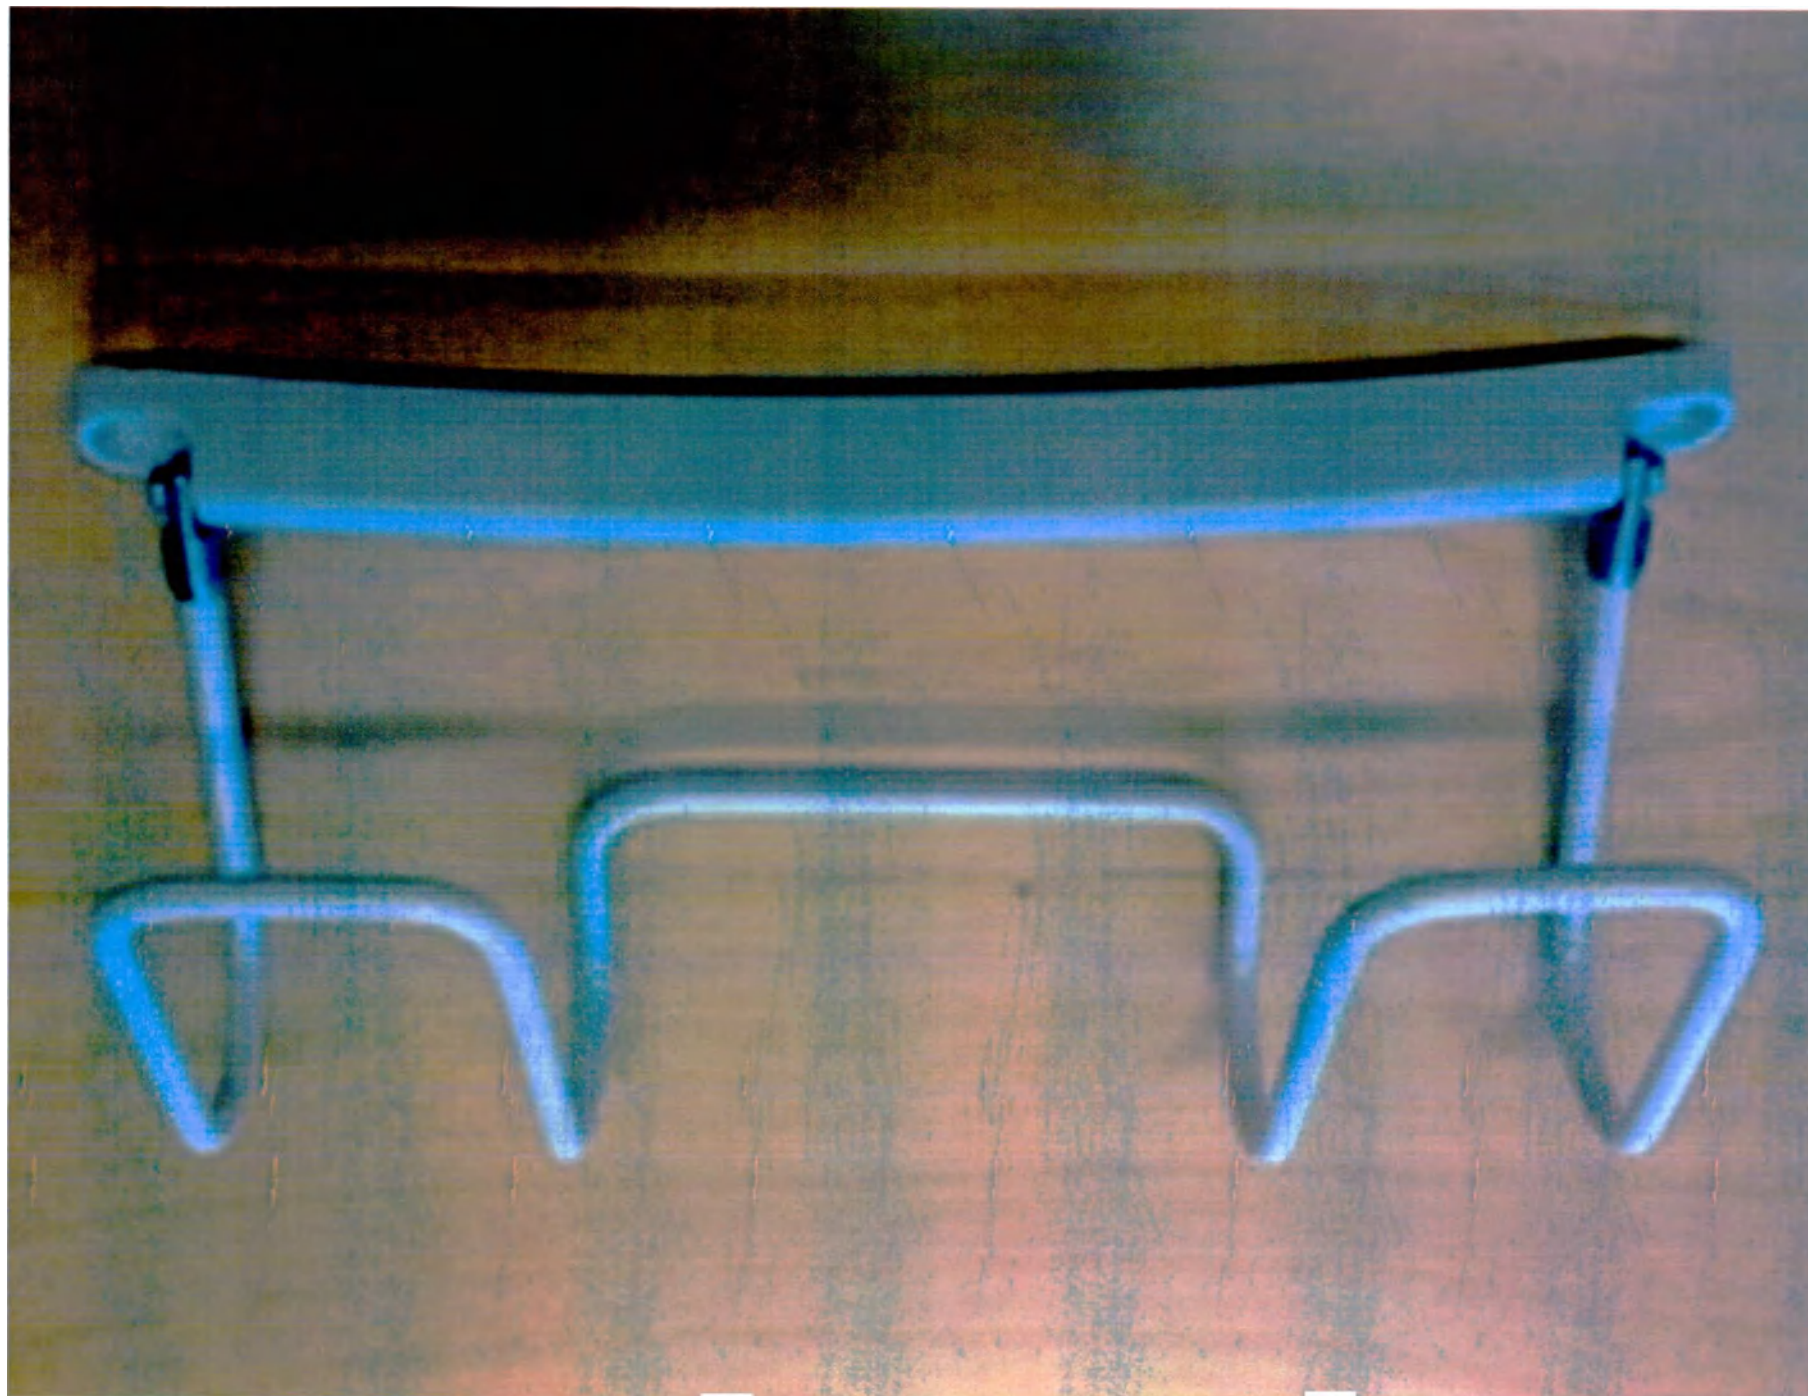


3. Кабели

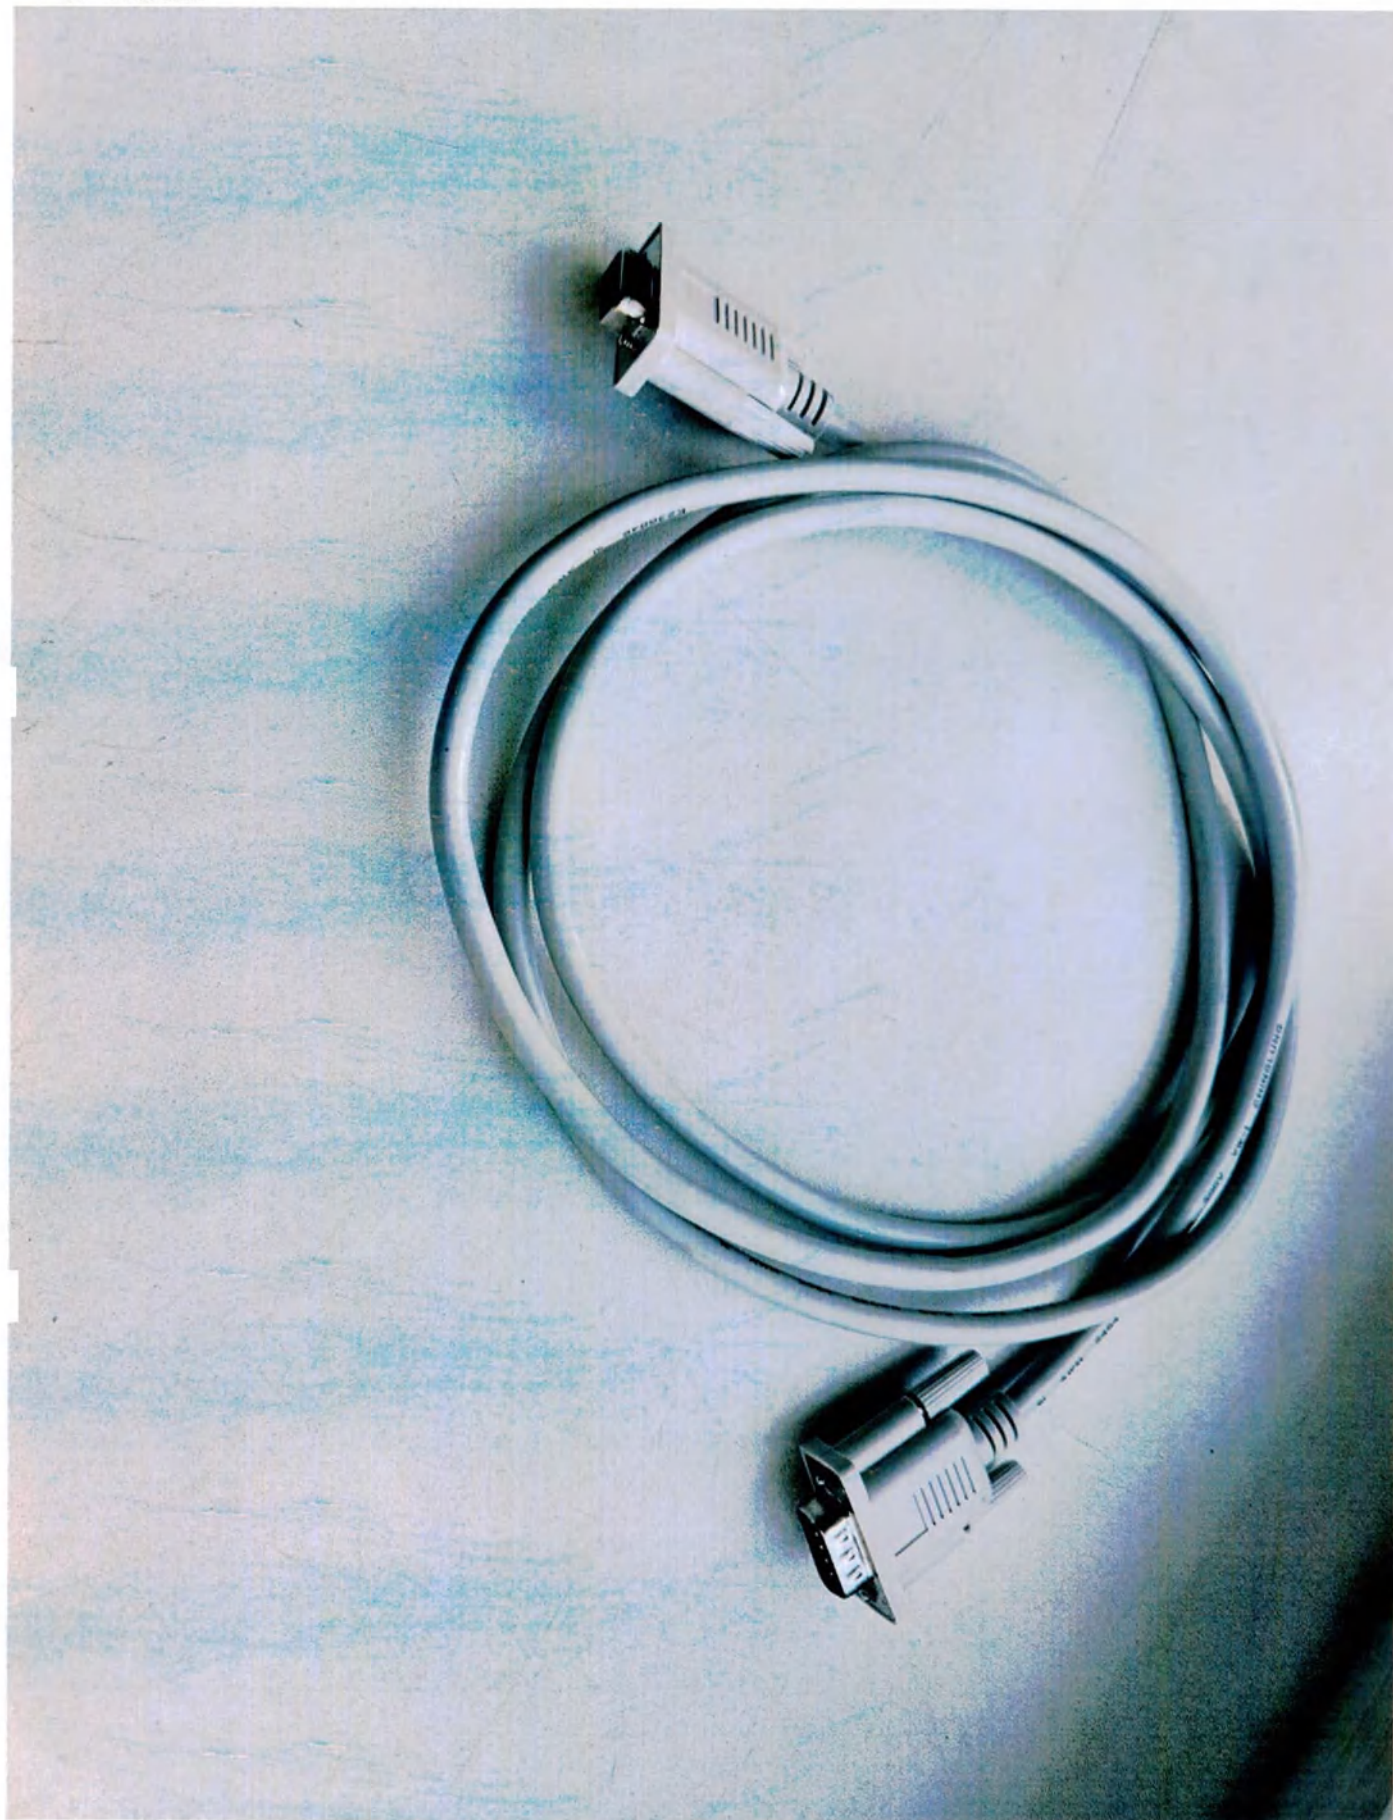

4. Клипсы



5. Переходники

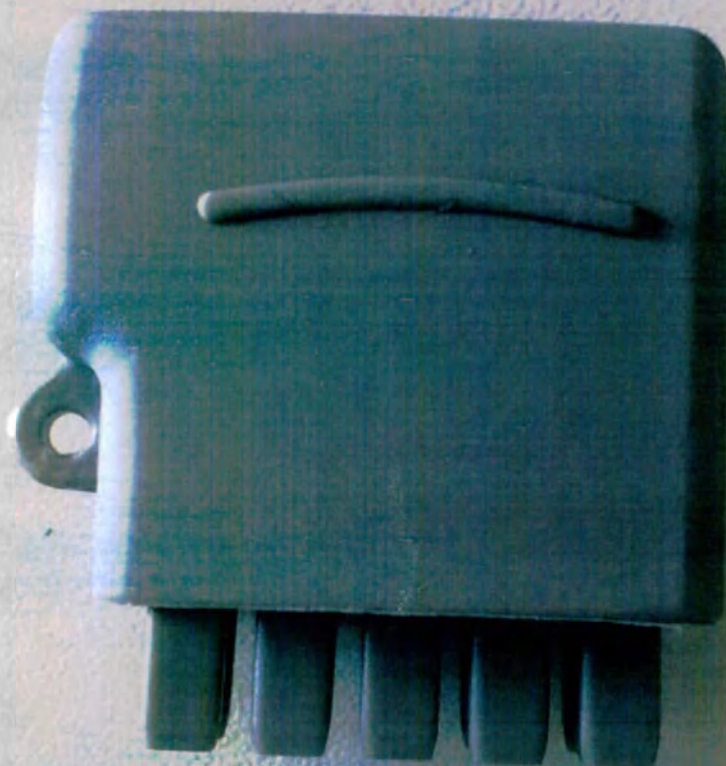

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
77 ЛИСТОВ

Shonitkova

