



Утверждаю

Генеральный директор

ООО «РАПИД БИО»

А. Ц. Жимбиев

» апреля 2024 г.

Образцы маркировки медицинского изделия

Набор реагентов

«Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена
вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека

методом иммунохроматографического анализа

«РАПИД-ВГВ-ИХА»

для диагностики in vitro»

по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

1) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023, Комплект №1:



2) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023, Комплект №2:

РАПИД-ВГВ-ИХА

Набор реагентов

«Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа

«РАПИД-ВГВ-ИХА»

для диагностики in vitro»

по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023


Комплект №2

Состав набора:

- | | | |
|---|--------|--------------------------|
| - Тест-картридж для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | 10 шт. | ТЕСТ
БР |
| - Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) | 1 шт. | |
| - Пипетка одноразовая | | |
| <i>(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)</i> | | |
| - Скарификатор одноразовый | 10 шт. | |
| <i>(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения. 7. Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow однократного применения (21 Г, 1,8 мм угла), РУ № ФСЗ 2009/04308)</i> | | |
| - Салфетка антисептическая | 10 шт. | |
| <i>(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСЗ 2009/05438)</i> | | |
| - Инструкция по применению | 1 шт. | |

REF LNBP100

2024-04



LOT LNBPZ24D01

2026-04

Для профессионального применения!

РАПИД-ВГВ-ИХА

ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

РУ _____ от _____

Штрих-код продукта



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4,
www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС» 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д. 5, помещ. 1, ком. 1 РМ. 12, info@lifediagnosics.ru

3) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023, Комплект №3:

РАПИД-ВГВ-ИХА

Набор реагентов

«Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА»

для диагностики in vitro»
по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

Комплект №3

Состав набора:

- Тест-картридж для определения поверхностного антигена вируса гепатита В 25 шт. **ТЕСТ**
- Флакон-капельница с буферным раствором (5,0 мл) 1 шт. **БР**
- Пипетка одноразовая 25 шт.
(изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)
- Скарификатор одноразовый 25 шт.
(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения. 7. Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow однократного применения (21 G, 1.8 мм игла), РУ № ФСЗ 2009/04308)
- Салфетка антисептическая 25 шт.
(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438)
- Инструкция по применению 1 шт.

Для профессионального применения!

РАПИД-ВГВ-ИХА

ТУ 21.20.23-015-44090553-2023 РУ _____ ОТ _____


Штрих-код продукта

REF LHBP100

LOT LHBPZ24D01

 2024-04

 2026-04



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС» 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д. 5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12, info@lifediagnosics.ru

4) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023, Комплект №4:

РАПИД-ВГВ-ИХА

Набор реагентов
«Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного
антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной
крови человека методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВГВ-ИХА»
для диагностики in vitro»
по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

Комплект №4

Состав набора:

- | | | |
|---|--------|-------------|
| - Тест-картридж для определения поверхностного антигена вируса гепатита В | 25 шт. | ТЕСТ |
| - Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) | 2 шт. | БР |
| - Пипетка одноразовая
<small>(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)</small> | 25 шт. | |
| - Скарификатор одноразовый
<small>(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения. 7. Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow однократного применения (21 G, 1.8 мм игла), РУ № ФСЗ 2009/04308)</small> | 25 шт. | |
| - Салфетка антисептическая
<small>(Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438)</small> | 25 шт. | |
| - Инструкция по применению | 1 шт. | |

Для профессионального применения!

РАПИД-ВГВ-ИХА

ТУ 21.20.23-015-44090553-2023 РУ _____ ОТ _____

Штрих-код продукта

REF LHBP100

LOT LHBPZ24D01

2024-04

2026-04



30°C
2°C



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС» 121205, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля,
д. 5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12, info@lifediagnosics.ru

5) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023, Комплект №5:

РАПИД-ВГВ-ИХА

Набор реагентов
«Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

Комплект №5

Состав набора:

- Тест-картридж для определения поверхностного антигена вируса гепатита В

10 шт.

ТЕСТ

- Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл)

1 шт.

БР

- Инструкция по применению

1 шт.

REF LHP100

 2024-04

  30°C 2°C  10

LOT LHBPZ24D01

 2026-04

Для профессионального применения!

РАПИД-ВГВ-ИХА

ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

РУ _____ от _____

Штрих-код продукта

 ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru
Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.
Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС» 121205, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля, д. 5, помещ. 1, ком. 1 РМ. 12, info@lifediagnosics.ru

6) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023, Комплект №6:

РАПИД-ВГВ-ИХА

Набор реагентов
«Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного
антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной
крови человека методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВГВ-ИХА»
для диагностики in vitro»
по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

Комплект №6

Состав набора:

- | | | |
|--|--------|-------------|
| - Тест-картридж для определения поверхностного антигена
вируса гепатита В | 30 шт. | ТЕСТ |
| - Флакон-капельница с буферным раствором (5,0 мл) | 1 шт. | БР |
| - Инструкция по применению | 1 шт. | |

Для профессионального применения!

РАПИД-ВГВ-ИХА

ТУ 21.20.23-015-44090553-2023 РУ _____ ОТ _____

Штрих-код продукта

REF LHBP100

LOT LHBPZ24D01

 2024-04

 2026-04



30°C
2°C



 ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС» 121205, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля,
д. 5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12, info@lifediagnosics.ru

7) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023, Комплект №7:

РАПИД-ВГВ-ИХА

Набор реагентов
«Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного
антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной
крови человека методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-ВГВ-ИХА»
для диагностики in vitro»
по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

Комплект №7

Состав набора:

- | | | |
|--|--------|-------------|
| - Тест-картридж для определения поверхностного антигена
вируса гепатита В | 30 шт. | ТЕСТ |
| - Флакон-капельница с буферным раствором (2,0 мл) | 3 шт. | БР |
| - Инструкция по применению | 1 шт. | |

Для профессионального применения!

РАПИД-ВГВ-ИХА

ТУ 21.20.23-015-44090553-2023 РУ _____ от _____

Штрих-код продукта

REF LHBP100

LOT LHBPZ24D01

 2024-04

 2026-04



30°C
2°C



 ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «ЛАЙФ ДИАГНОСТИКС» 121205, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного центра, ул. Нобеля,
д. 5, помещ. 1, ком. 1 Р.М. 12, info@lifediagnosics.ru

8) Образец маркировки Тест-картриджа для определения поверхностного антигена вируса гепатита В::



РАПИД-ВГВ-ИХА

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 2024-04 2026-04

ТЕСТ 1 шт **LOT: LHBPZ24D01**

REF: LHBP100

9) Образец маркировки флакона-капельницы с буферным раствором 2,0 мл, 5,0 мл:

РАПИД-ВГВ-ИХА

БР Флакон-капельница
с буферным раствором (2,0
мл)

LOT LHBPZ24D01

 **Rapid Bio**

 **2024-04**

 **2026-04**

IVD



РАПИД-ВГВ-ИХА

БР

Флакон-капельница
с буферным раствором (5,0
мл)

LOT

LHBPZ24D01

IVD




Rapid Bio



2024-04



2026-04

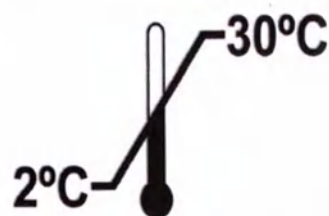

10) Образец маркировки пластиковой пробирки с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,1 мл):

РАПИД-ВГВ-ИХА

БР

Пластиковая пробирка с
насадкой-капельницей с
буферным раствором (0,1
мл)



Rapid Bio

LOT

LHBPZ24D01



2024-04



2026-04



IVD



11) Образец маркировки индивидуальной/групповой упаковки пипетки одноразовой:



РАПИД-ВГВ-ИХА

Rapid Bio

Пипетка одноразовая - 1 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

LOT

LHBPZ24D01

IVD



Rapid Bio

РАПИД-ВГВ-ИХА

Пипетка одноразовая - 10 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

LOT

LHBPZ24D01

IVD



Rapid Bio

РАПИД-ВГВ-ИХА


Пипетка одноразовая - 25 шт.

(Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857)

LOT

LHBPZ24D01

IVD



12) Образец маркировки индивидуальной/групповой упаковки скарификатора одноразового:




РАПИД-ВГВ-ИХА

Rapid Bio

Скарификатор одноразовый - 1 шт.
(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance
однократного применения. 7. Ланцет
(скарификатор) Prolance Normal Flow
однократного применения (21 G, 1.8 мм игла), РУ
№ ФСЗ 2009/04308)

LOT LHBPZ24D01 **IVD** 





РАПИД-ВГВ-ИХА

Rapid Bio

Скарификатор одноразовый - 10 шт.
(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного
применения. 7. Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow
однократного применения (21 G, 1.8 мм игла), РУ № ФСЗ 2009/04308)

LOT LHBPZ24D01 **IVD** 





РАПИД-ВГВ-ИХА


Rapid Bio

Скарификатор одноразовый - 25 шт.
(Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного
применения. 7. Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow
однократного применения (21 G, 1.8 мм игла), РУ № ФСЗ 2009/04308)

LOT LHBPZ24D01 **IVD** 



13) Образец маркировки транспортной тары:

РАПИД-ВГВ-ИХА									
 Рapid Био Быстрая диагностика	<table><tr><td>REF</td><td>LHBP100</td><td></td><td>202X-XX</td></tr><tr><td>LOT</td><td>XXXXXXXXXX</td><td></td><td>202X-XX</td></tr></table> Комплект №X	REF	LHBP100		202X-XX	LOT	XXXXXXXXXX		202X-XX
REF	LHBP100		202X-XX						
LOT	XXXXXXXXXX		202X-XX						
Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-ВГВ-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023 ПУ №XXX от XX.XX.XXXX									
Кол. наборов: XX шт Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг Масса нетто: XX кг (потребительской упаковки)	Штрих-код продукта  Возможно транспортирование не более 7 суток при температуре от -20°C до +30°C								
 ООО "РАПИД БИО" Россия, 670017, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4									

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

13 лист (ов)

Подпись Жимбиев А.Ц.
М.П.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов

«Экспресс-тест для качественного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В


в сыворотке, плазме и цельной крови человека


методом иммунохроматографического анализа

«РАПИД-ВГВ-ИХА»

для диагностики in vitro»

по ТУ 21.20.23-015-44090553-2023

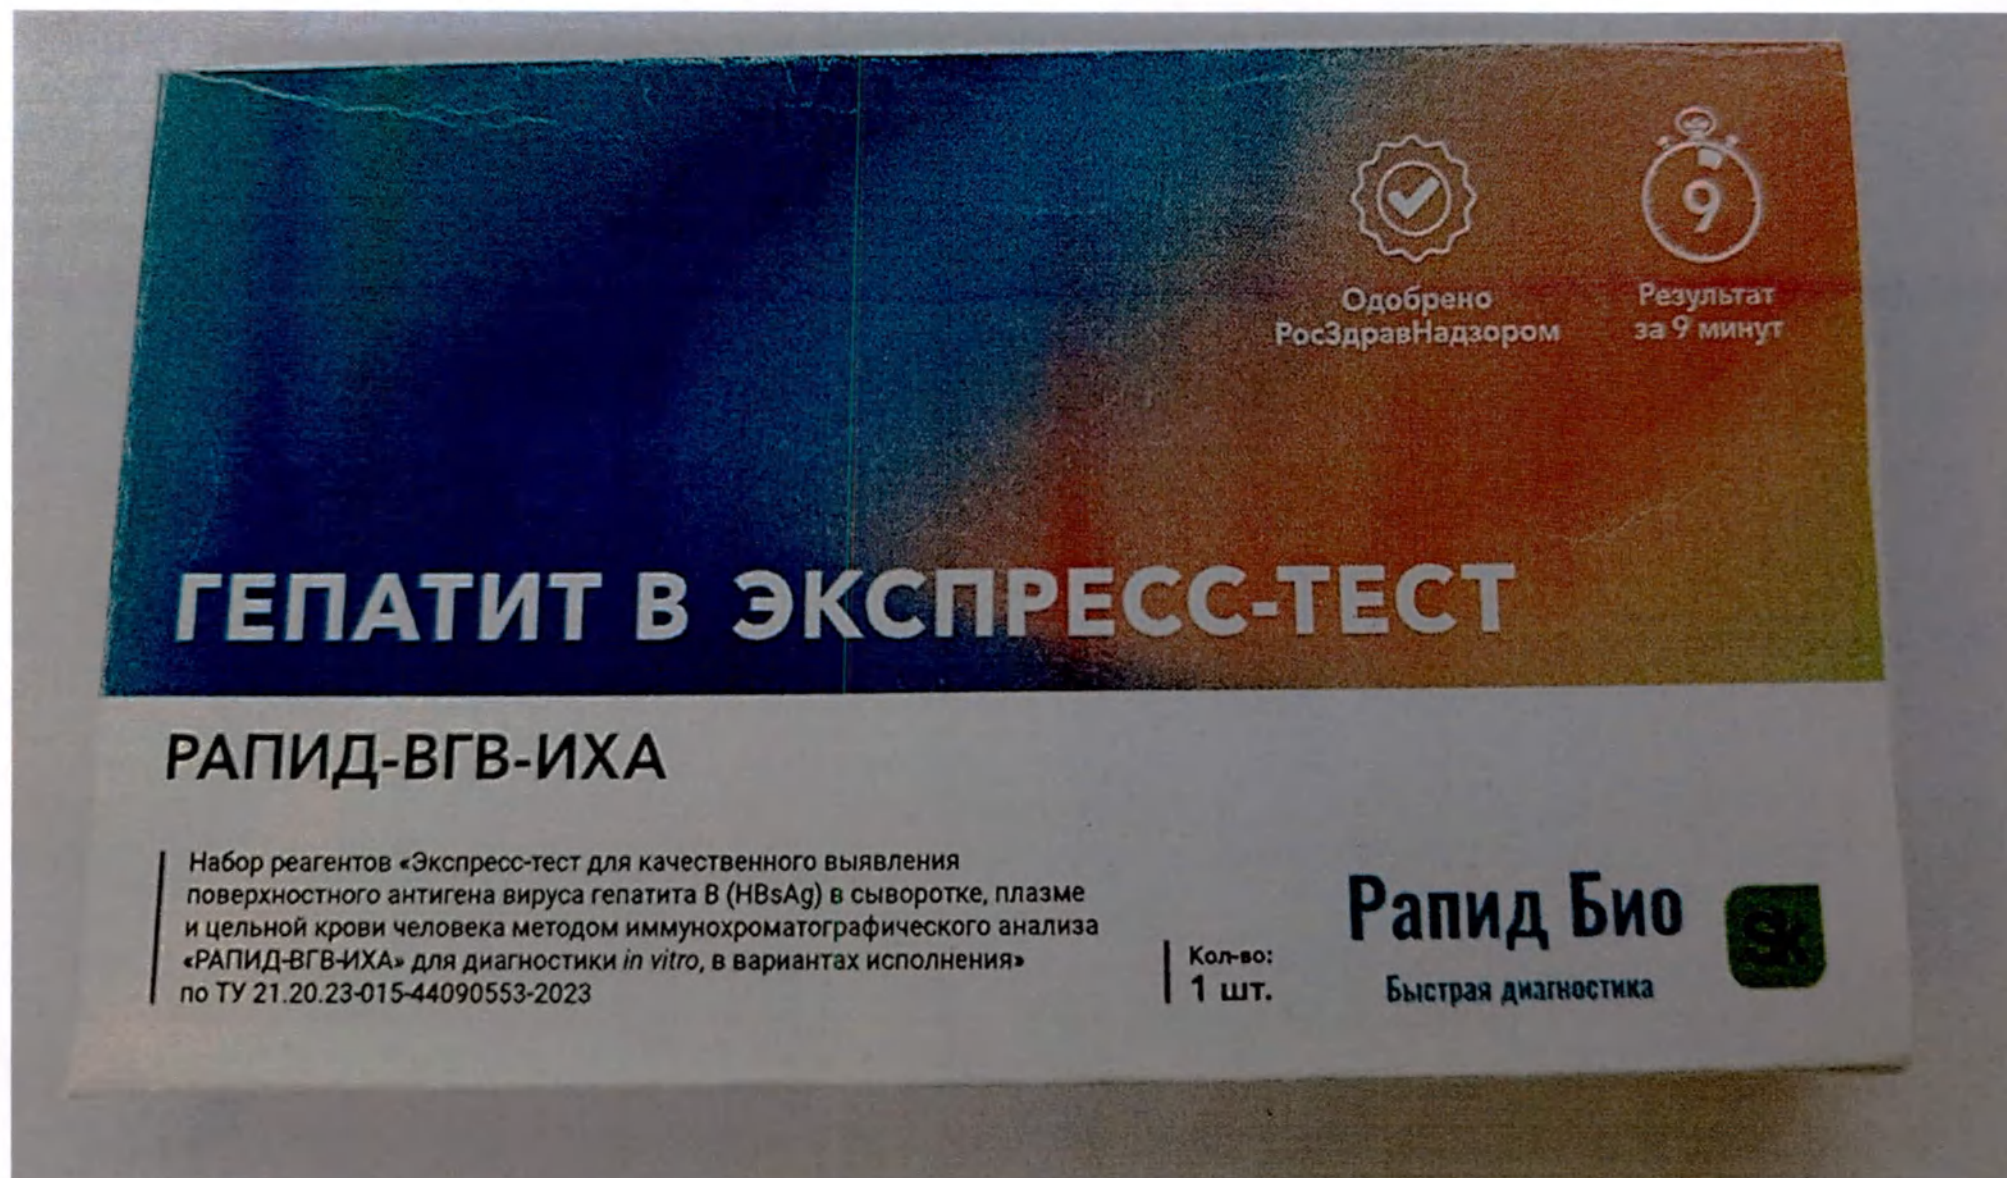

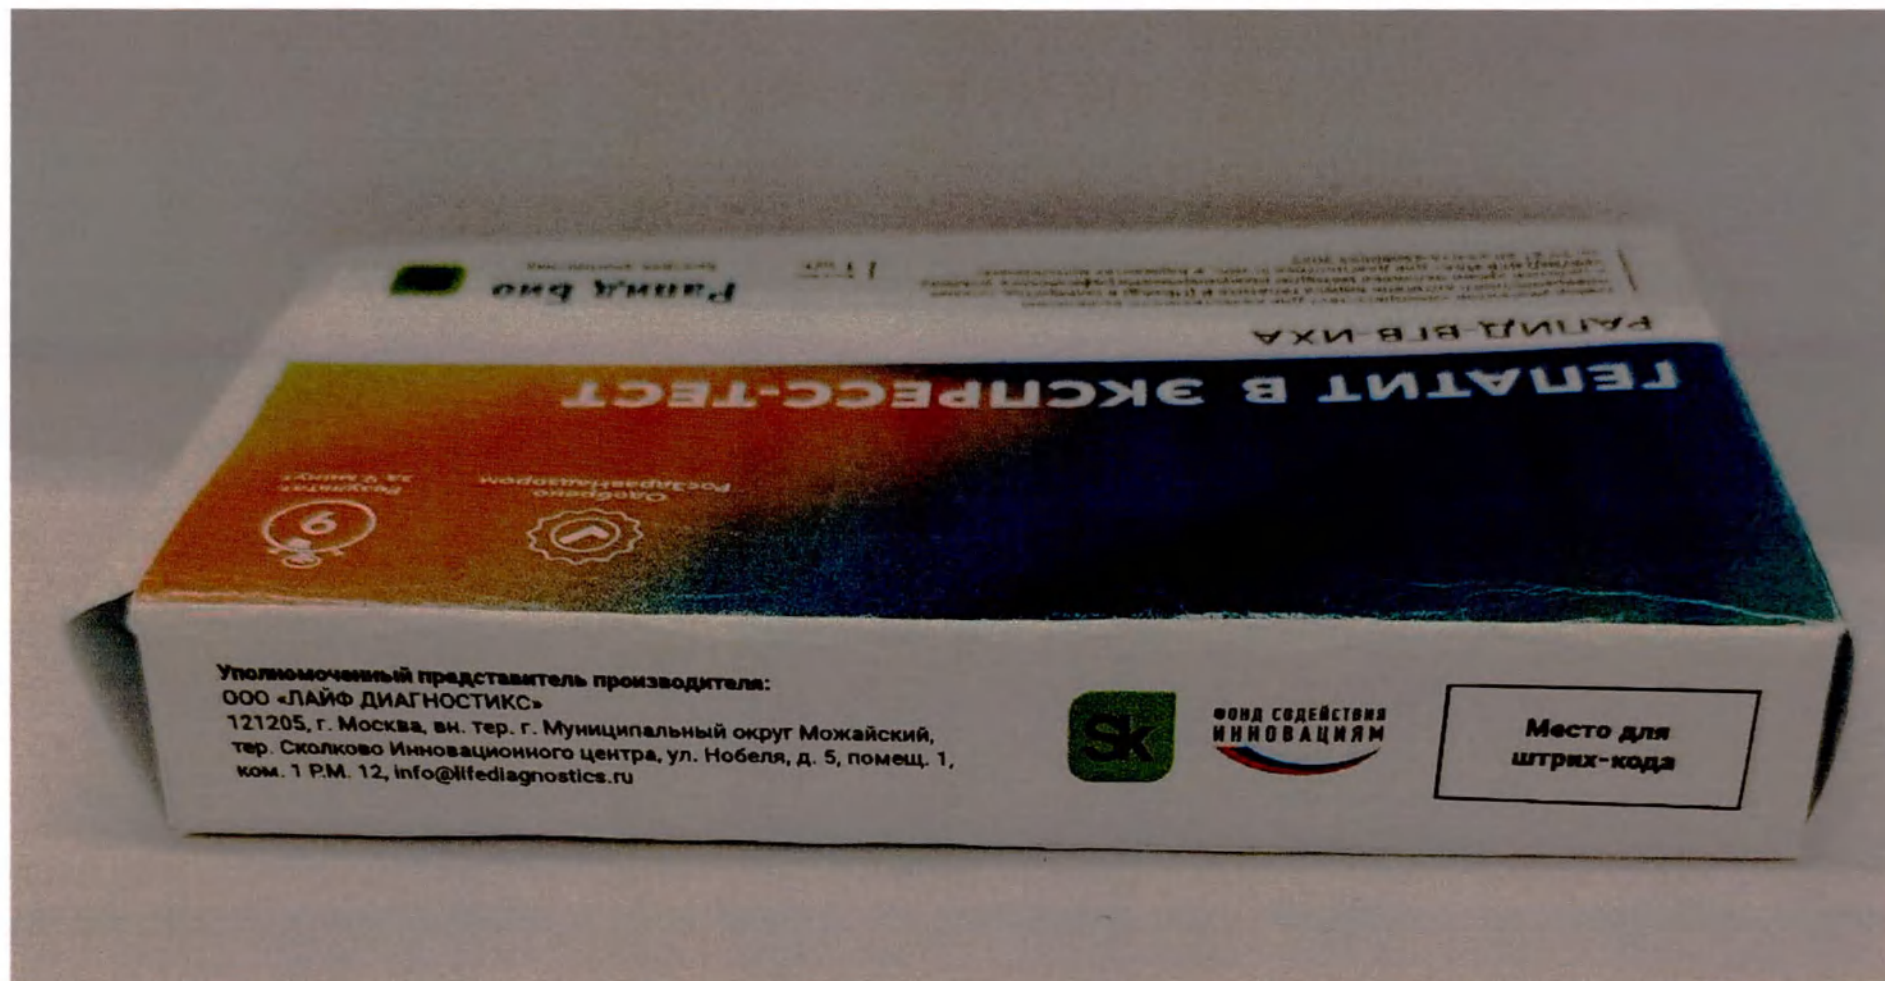




ГЕПАТИТ

РАПИД-ВГВ-У

Новый препарат для быстрого
поверхностного антигена вируса
и вирусной ДНК гепатита В
РАПИД-ВГВ-У для диагностики
по ТУ 21.20.23-015-4400553



LHBPZ24D01



2024-04



2026-04

ГЕПАТИТ В ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

Комплект №1

Состав набора:

- Тест-картридж для определения поверхностного антигена вируса гепатита В
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором (0,1 мкл)
- Пипетка одноразовая
Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов: пипетки серологические и для переноса жидкостей (Пастера), РУ № ФСЗ 2012/11857
- Скарификатор одноразовый
Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения. 7. Ланцет (скарификатор) Prolance Normal Flow однократного применения (21 G, 1.8 мм игла), РУ № ФСЗ 2009/04308
- Салфетка антисептическая
Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438

! Для профессионального применения.



1 шт.

Отрицательный результат:

Появление в тестовом окне только контрольной полосы «С». Окрашивание тестовой полосы «Т» не происходит.




1 шт.

1 шт.

Положительный результат:

Появление в тестовом окне двух окрашенных полос: контрольной полосы «С» и тестовой полосы «Т».




1 шт.

Недействительный результат:


В тестовом окне контрольная полоса «С» не появляется, независимо от наличия тестовой полосы «Т».

Фотографическое изображение 2. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №1



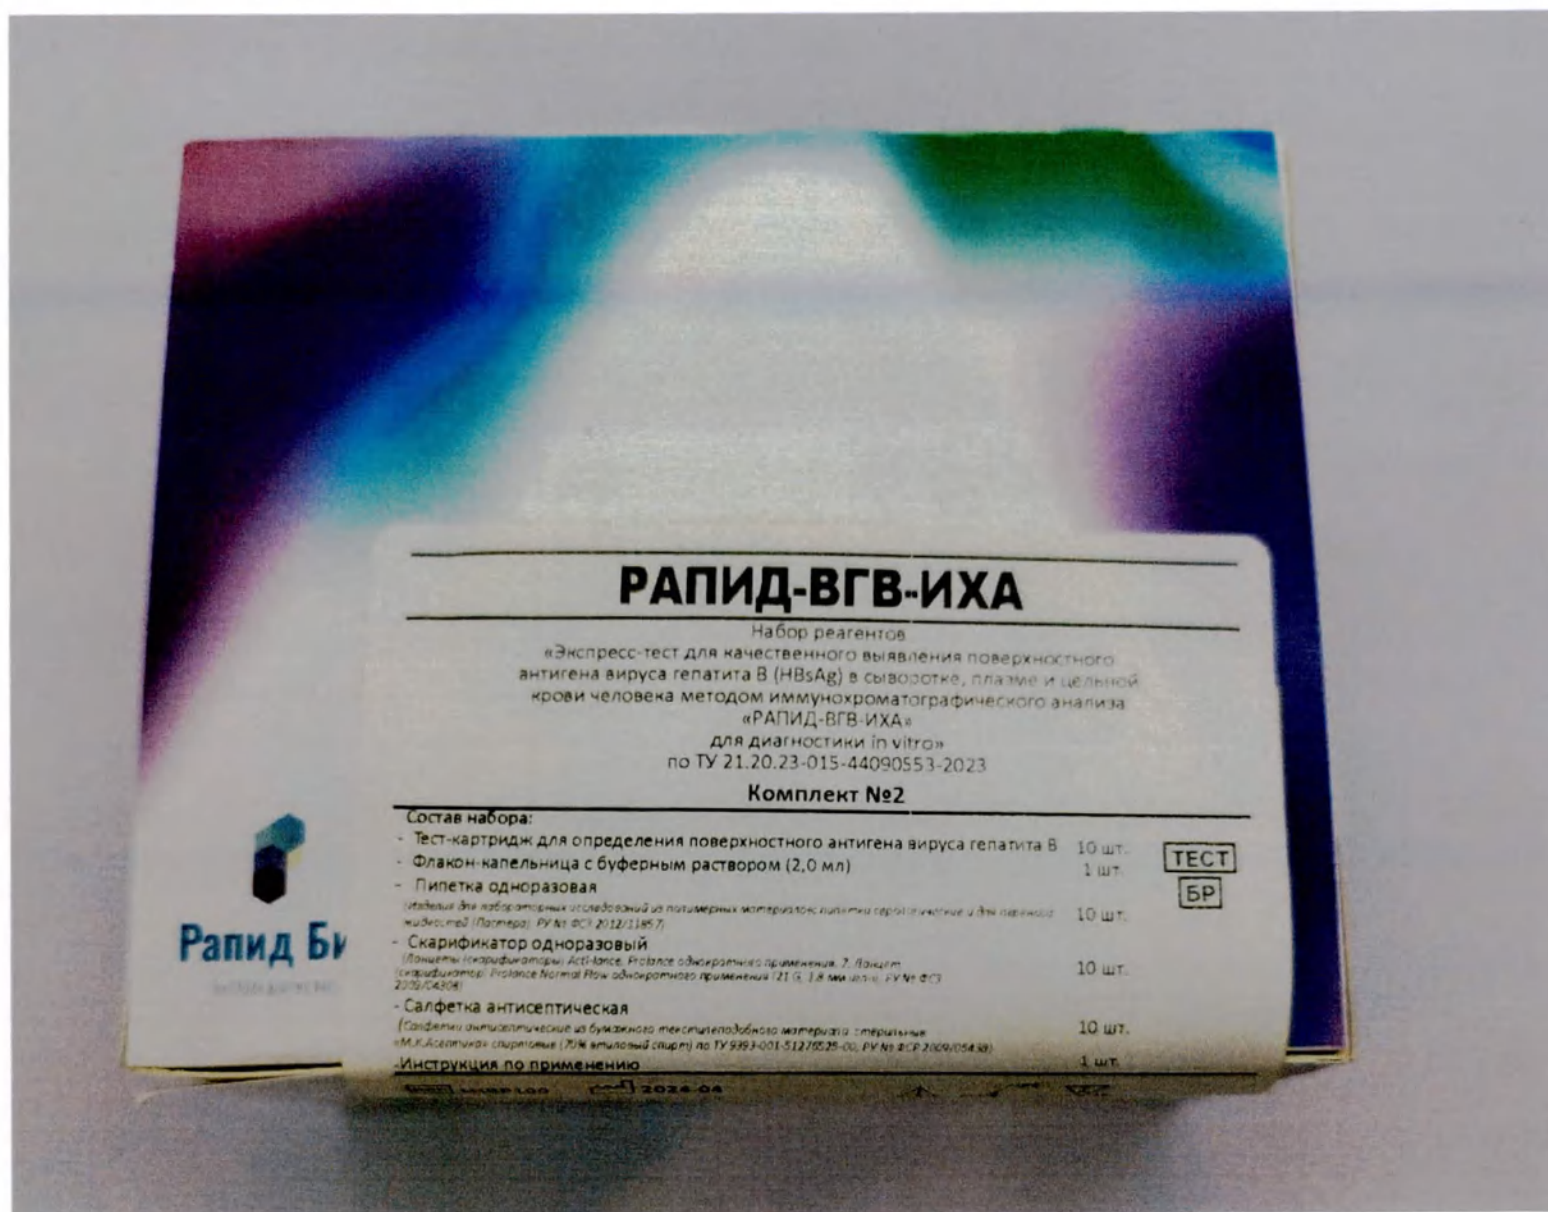


Фотографическое изображение 4. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №2

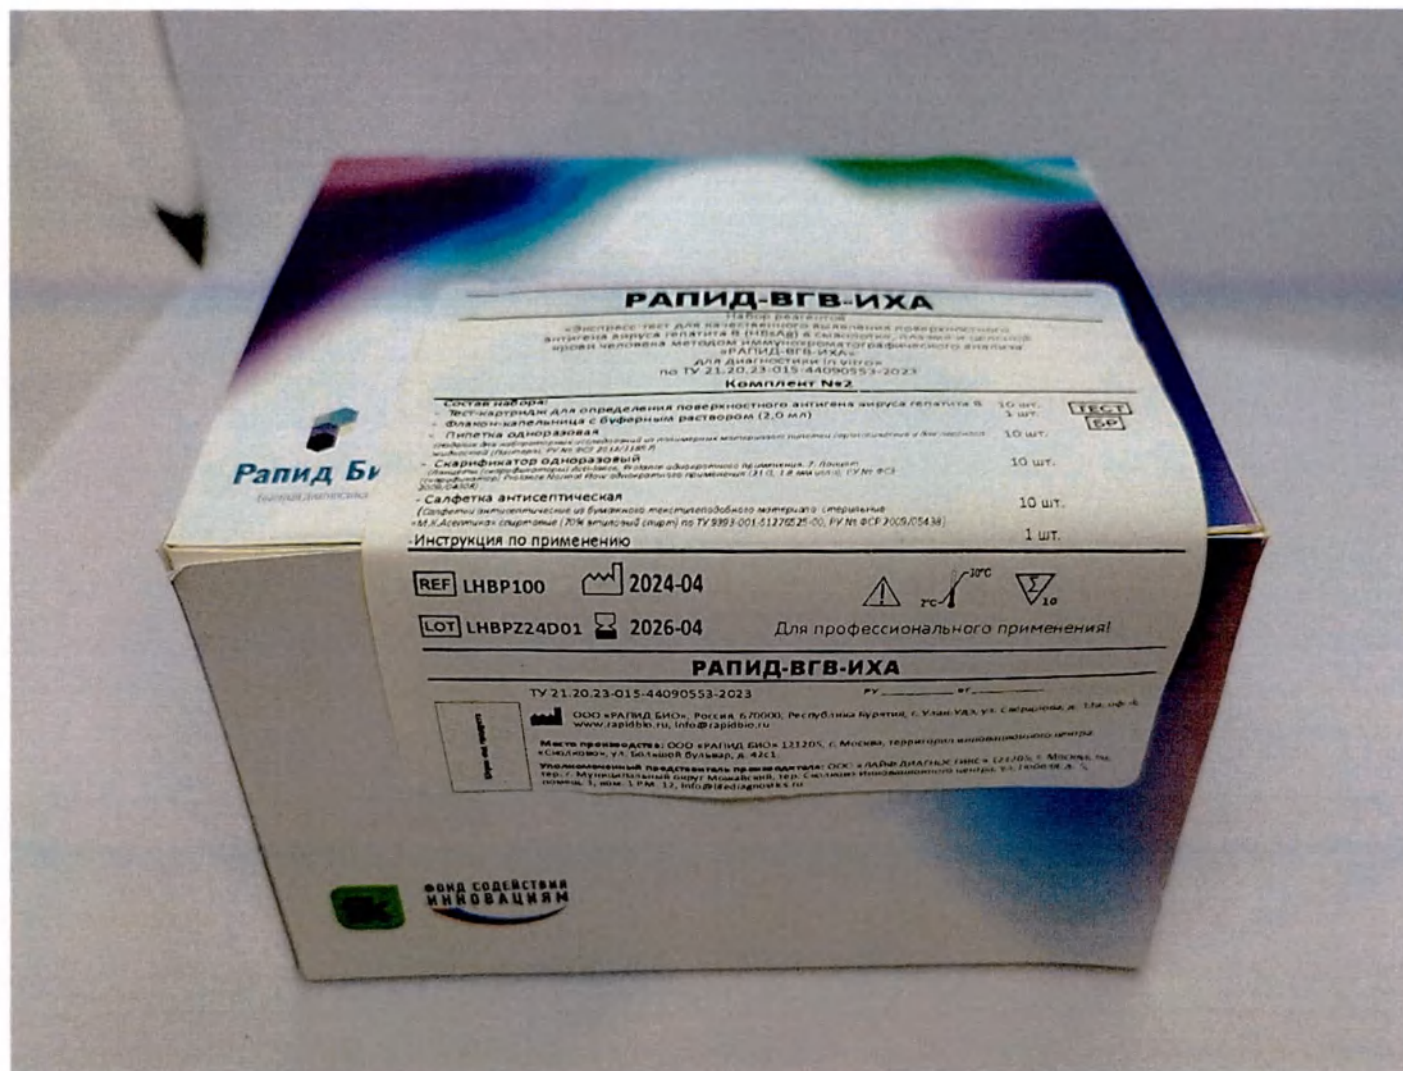

Фотографическое изображение 5. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №2. Состав набора




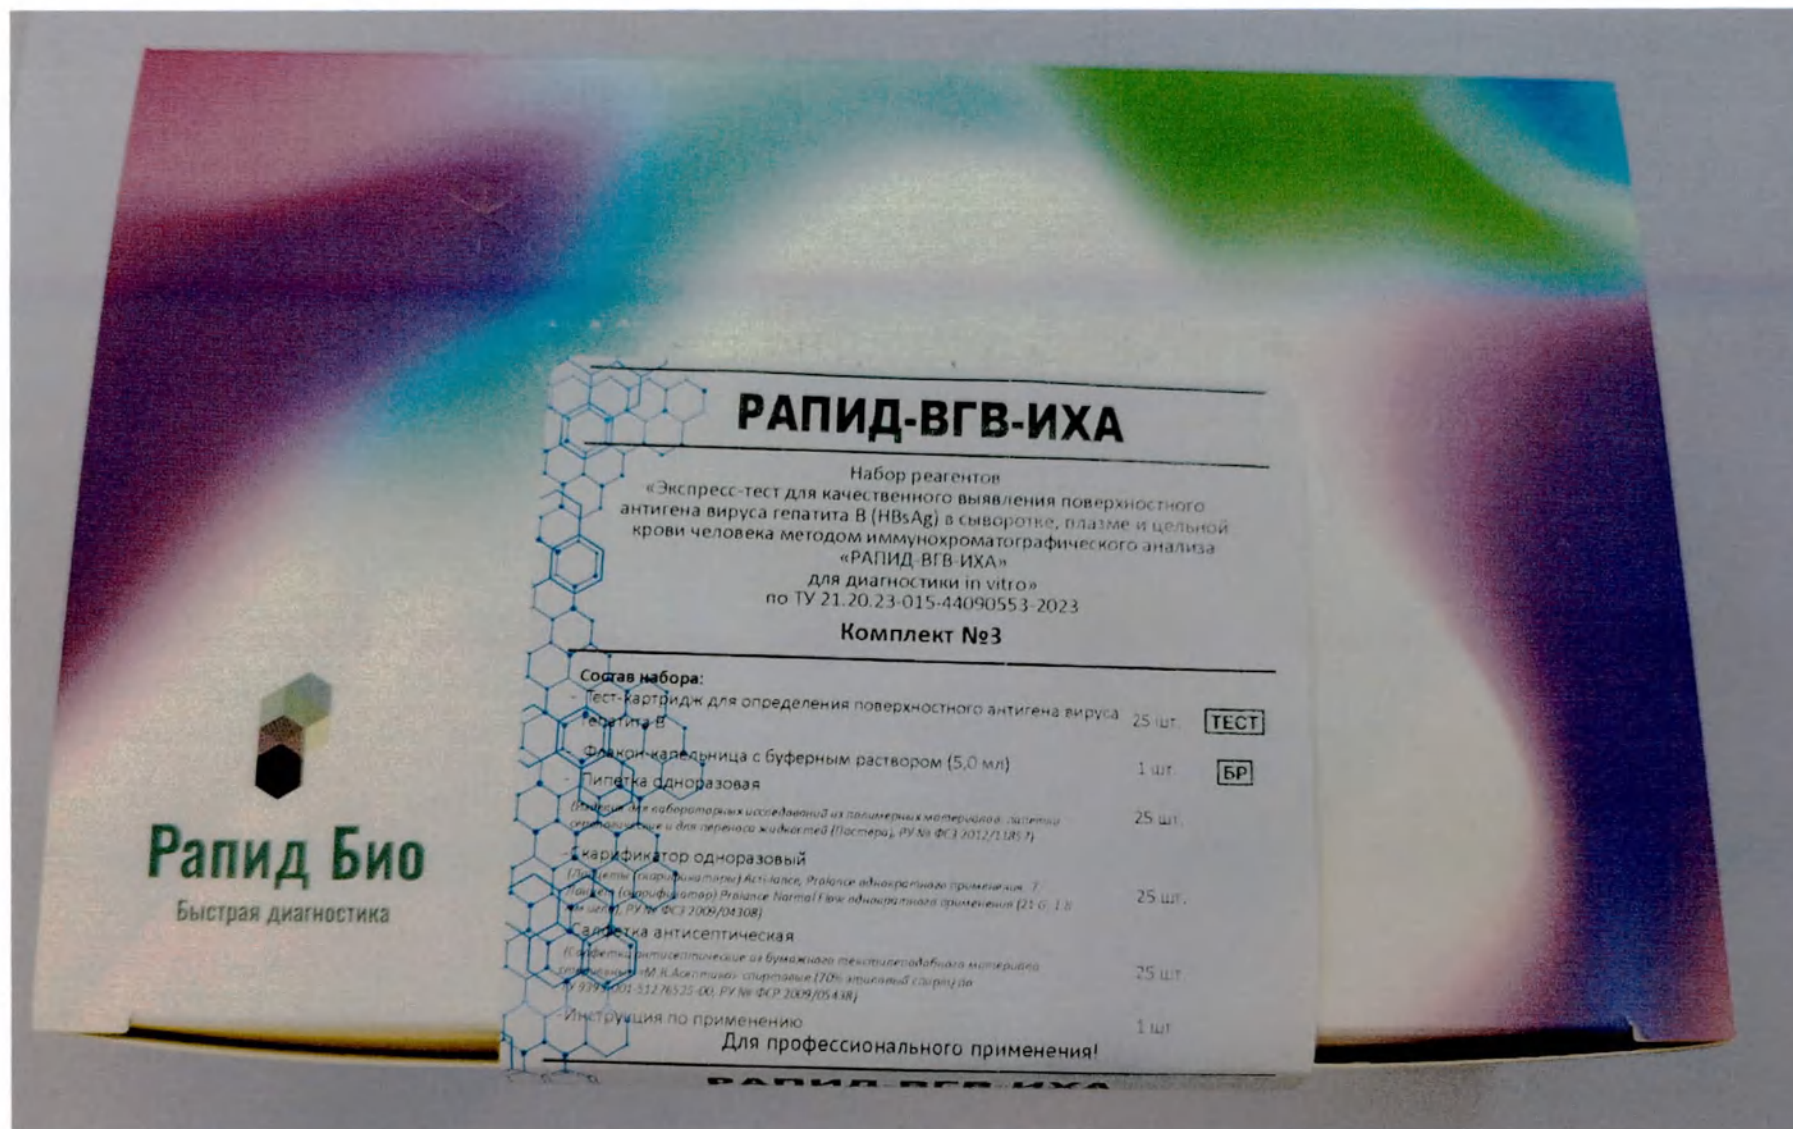


Фотографическое изображение 7. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №3




Фотографическое изображение 8. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №3. Состав набора

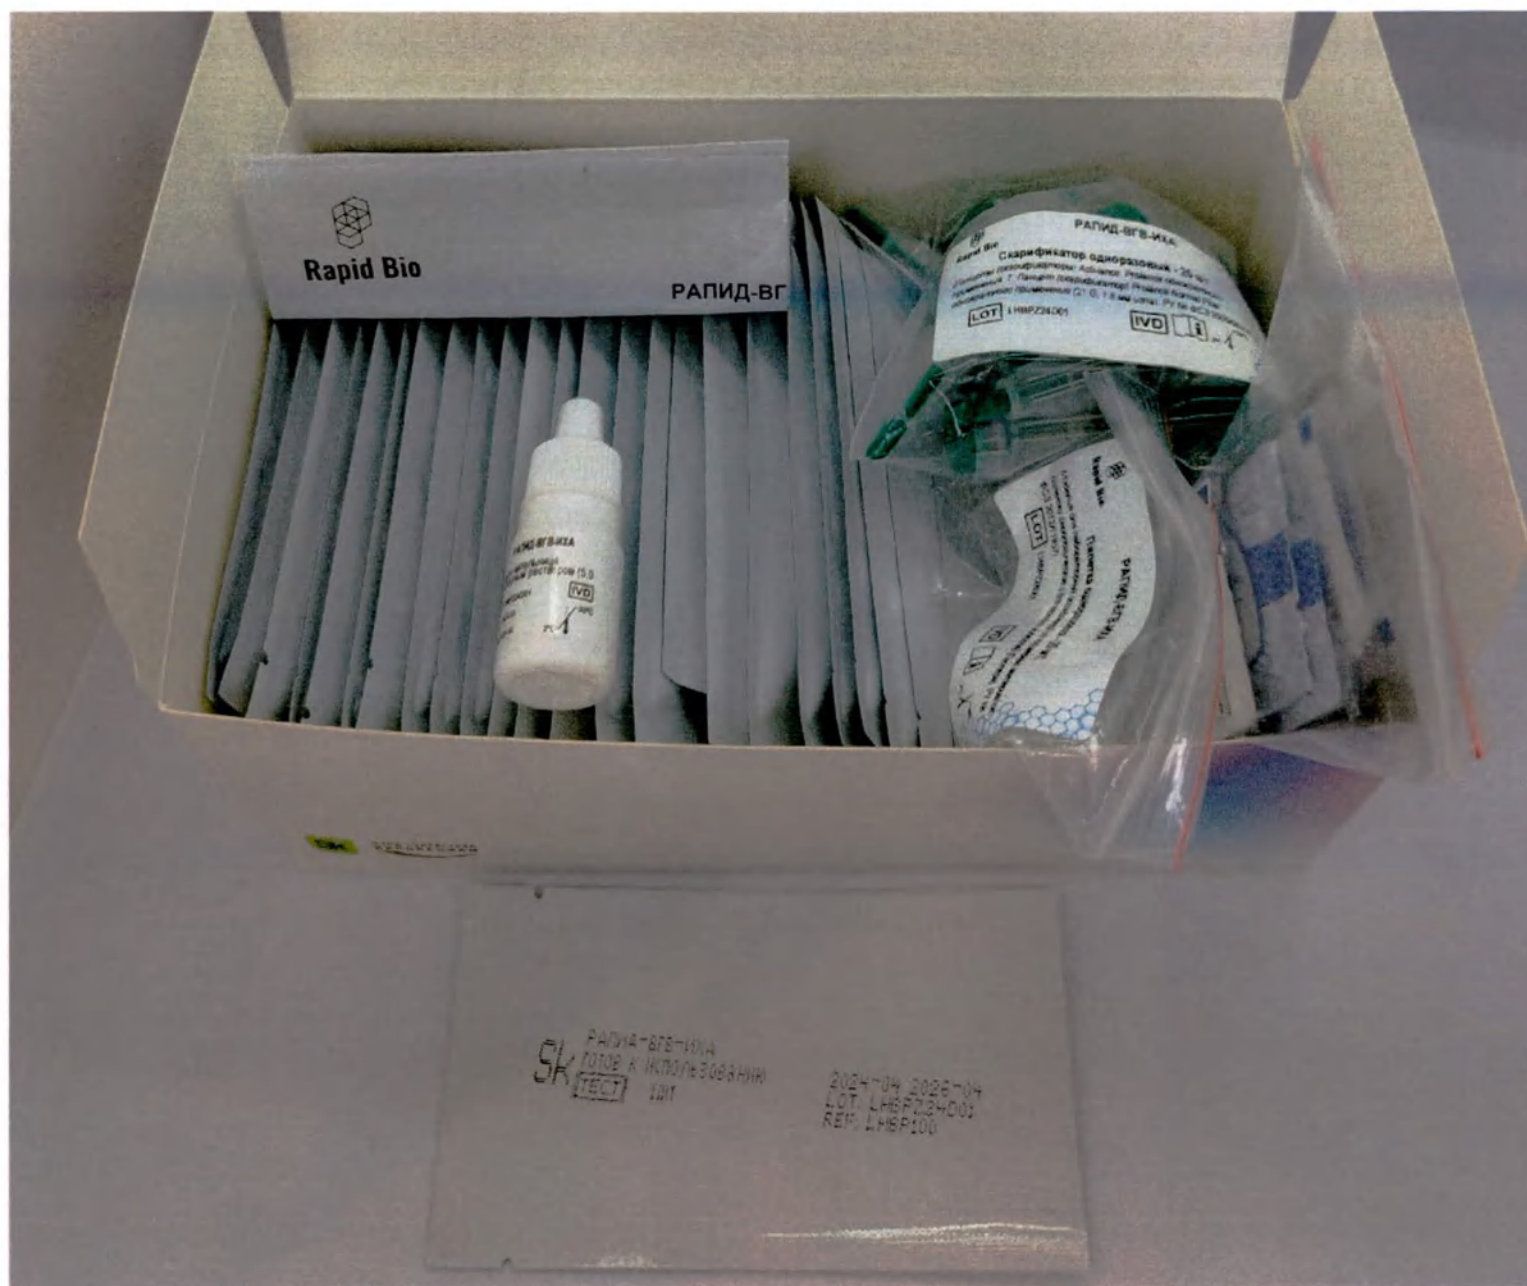



Фотографическое изображение 9. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект 4

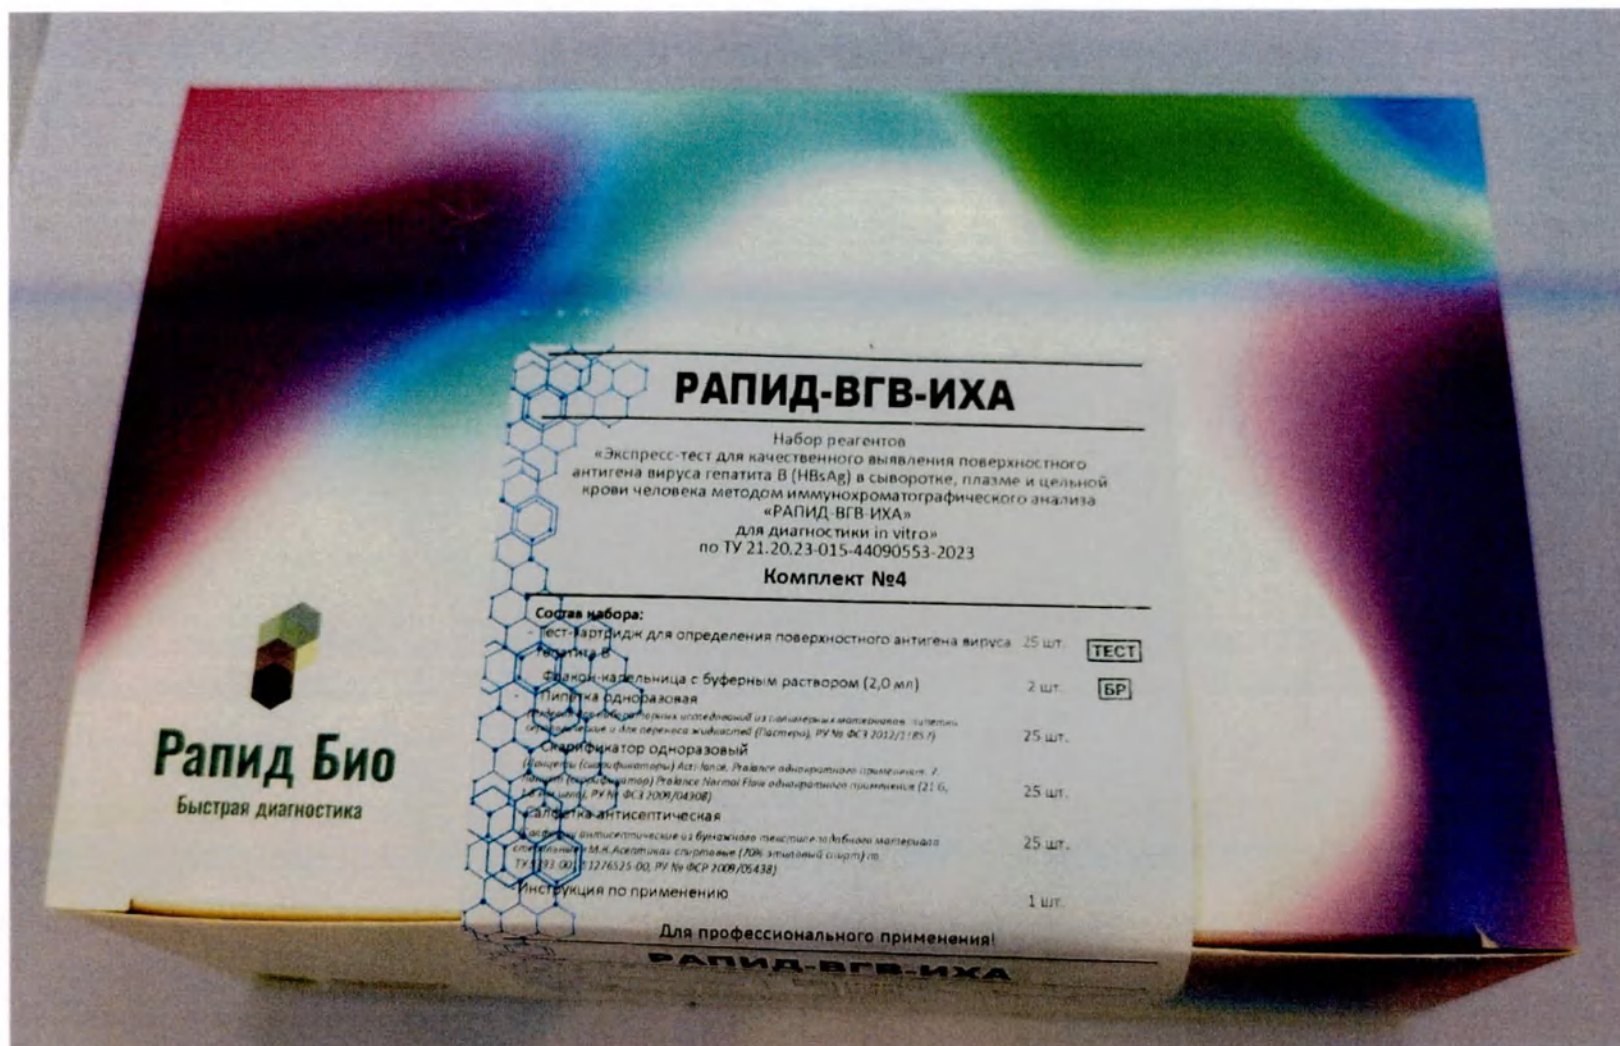

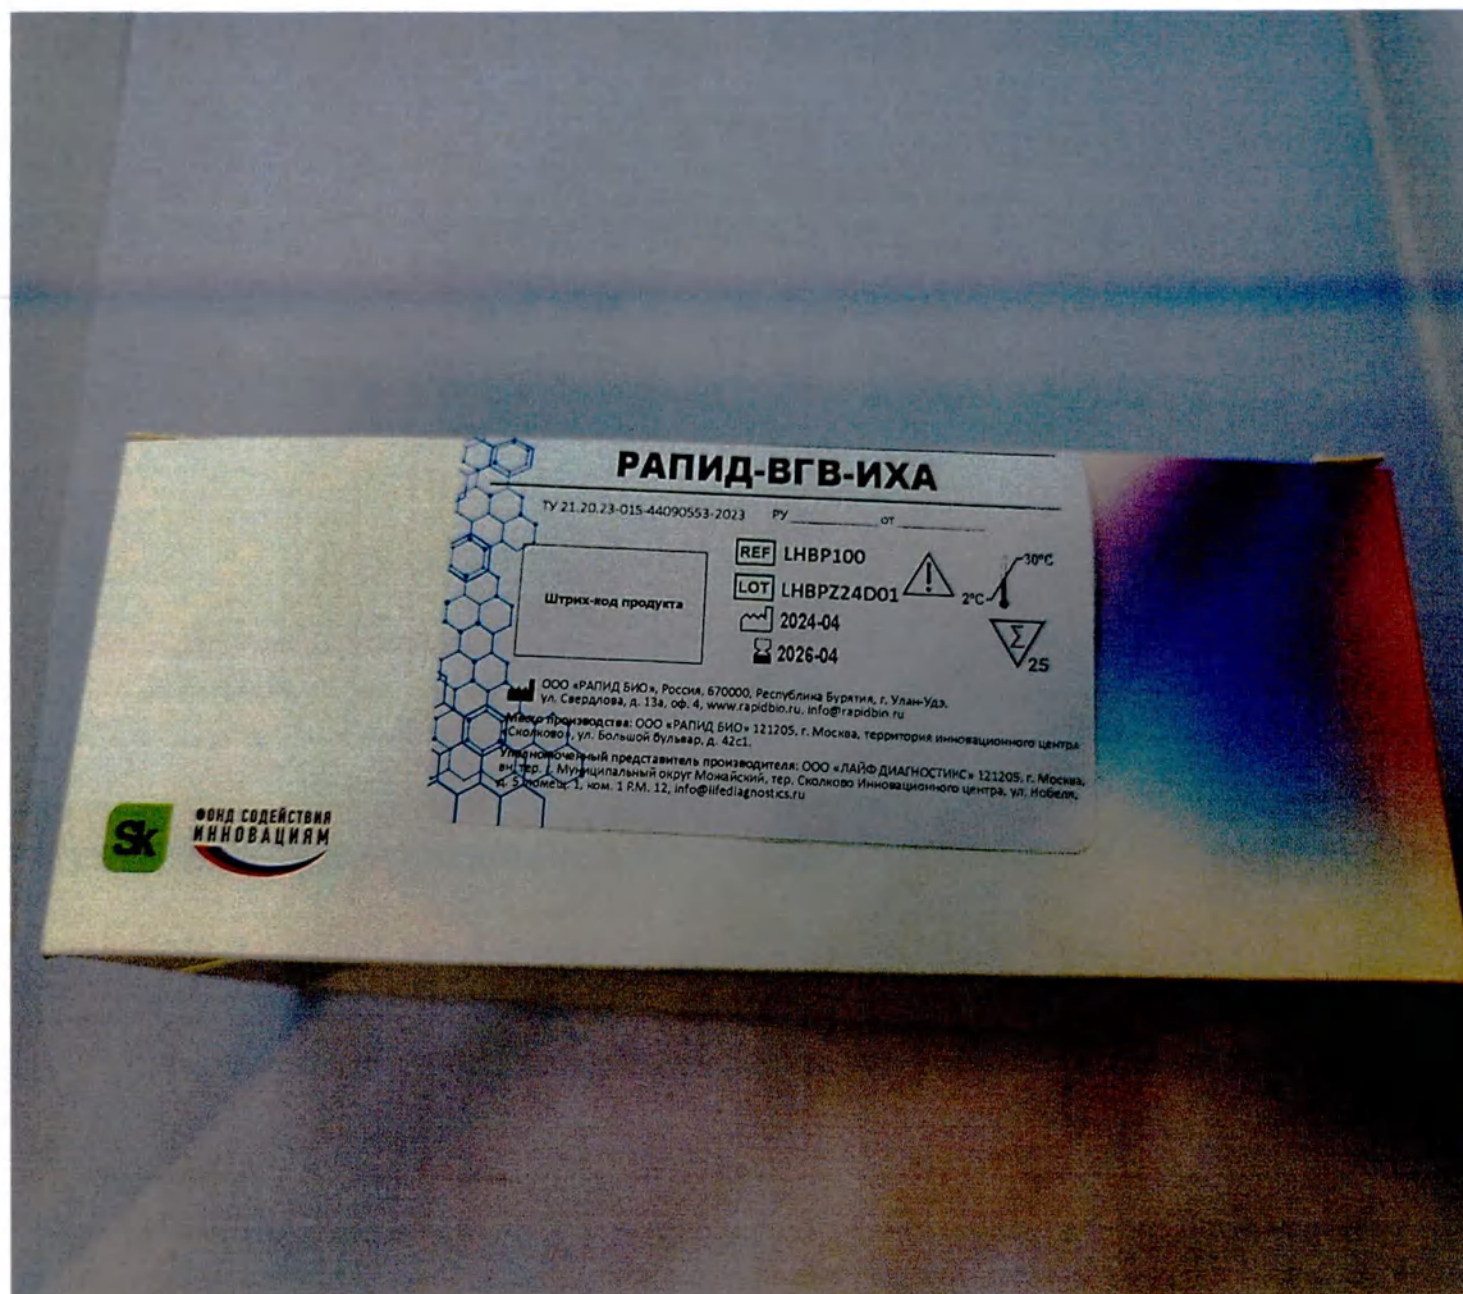


Фотографическое изображение 11. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №4. Состав набора

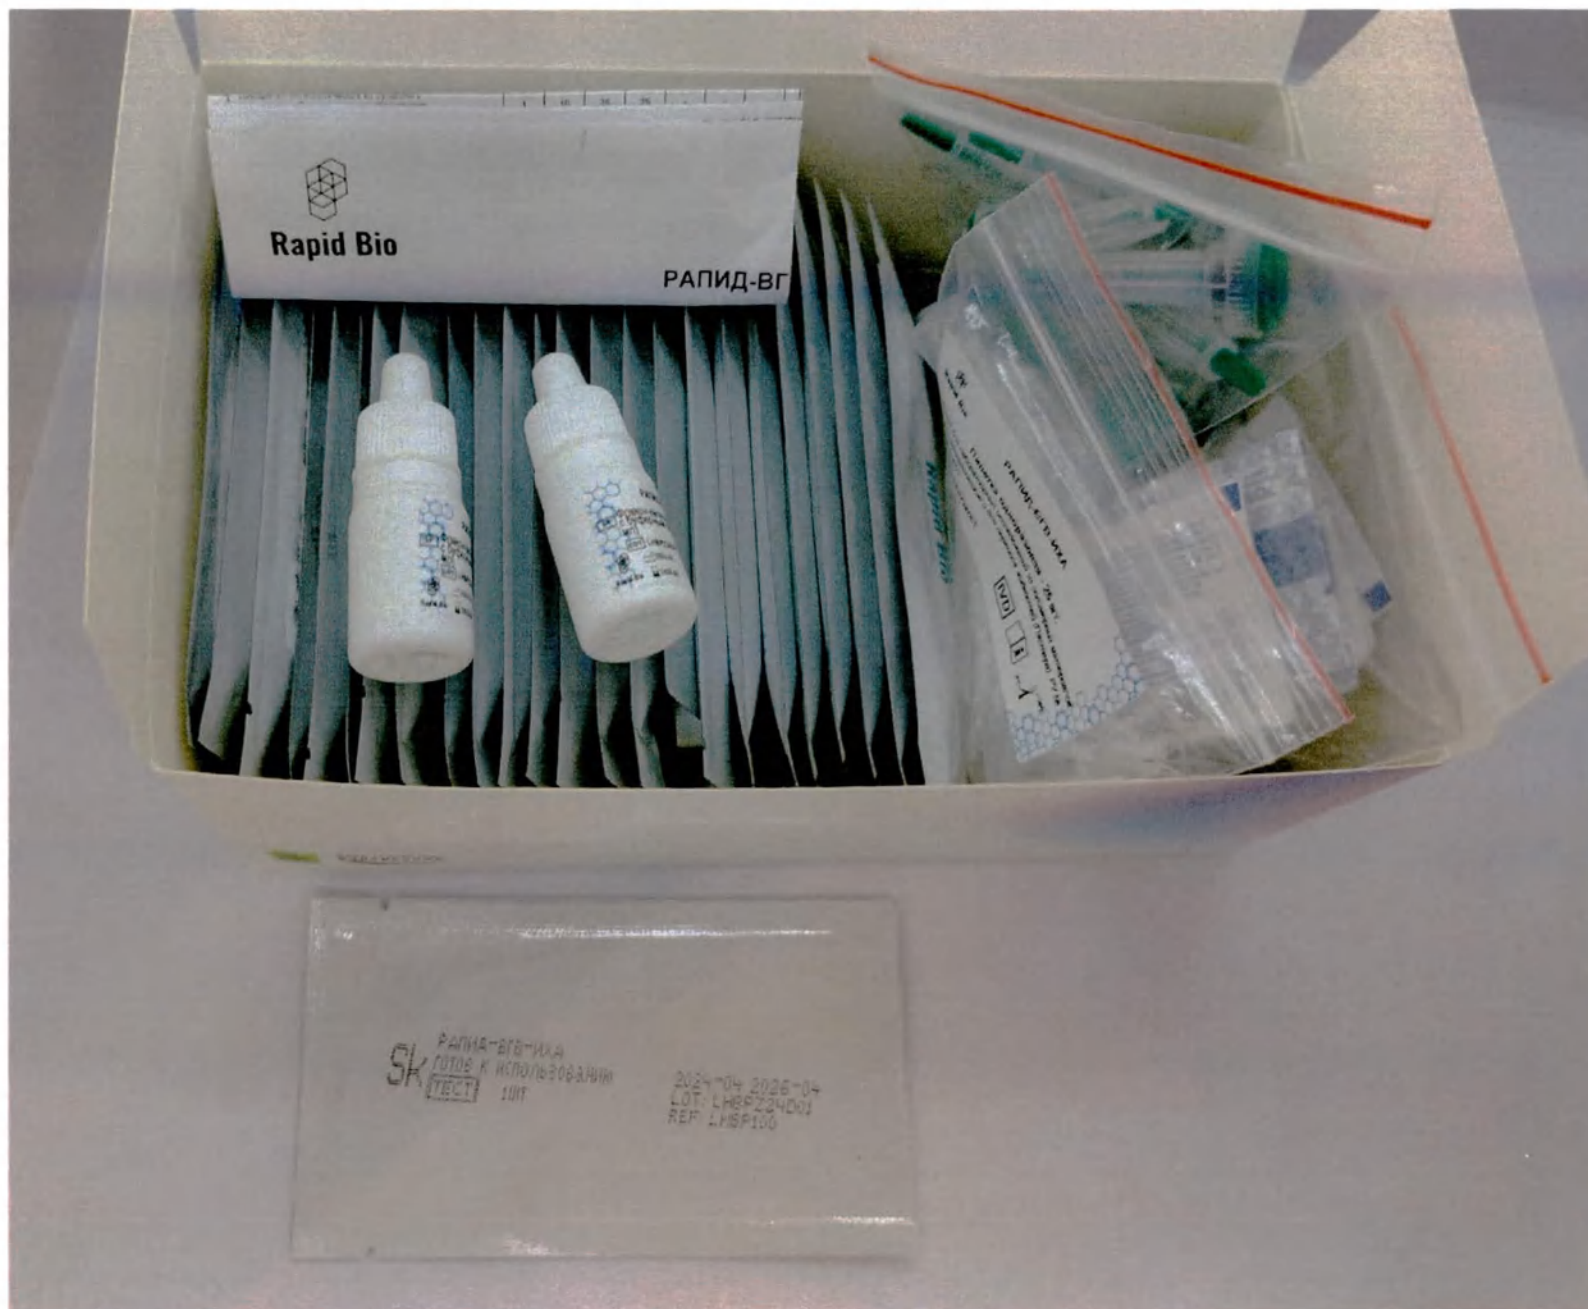


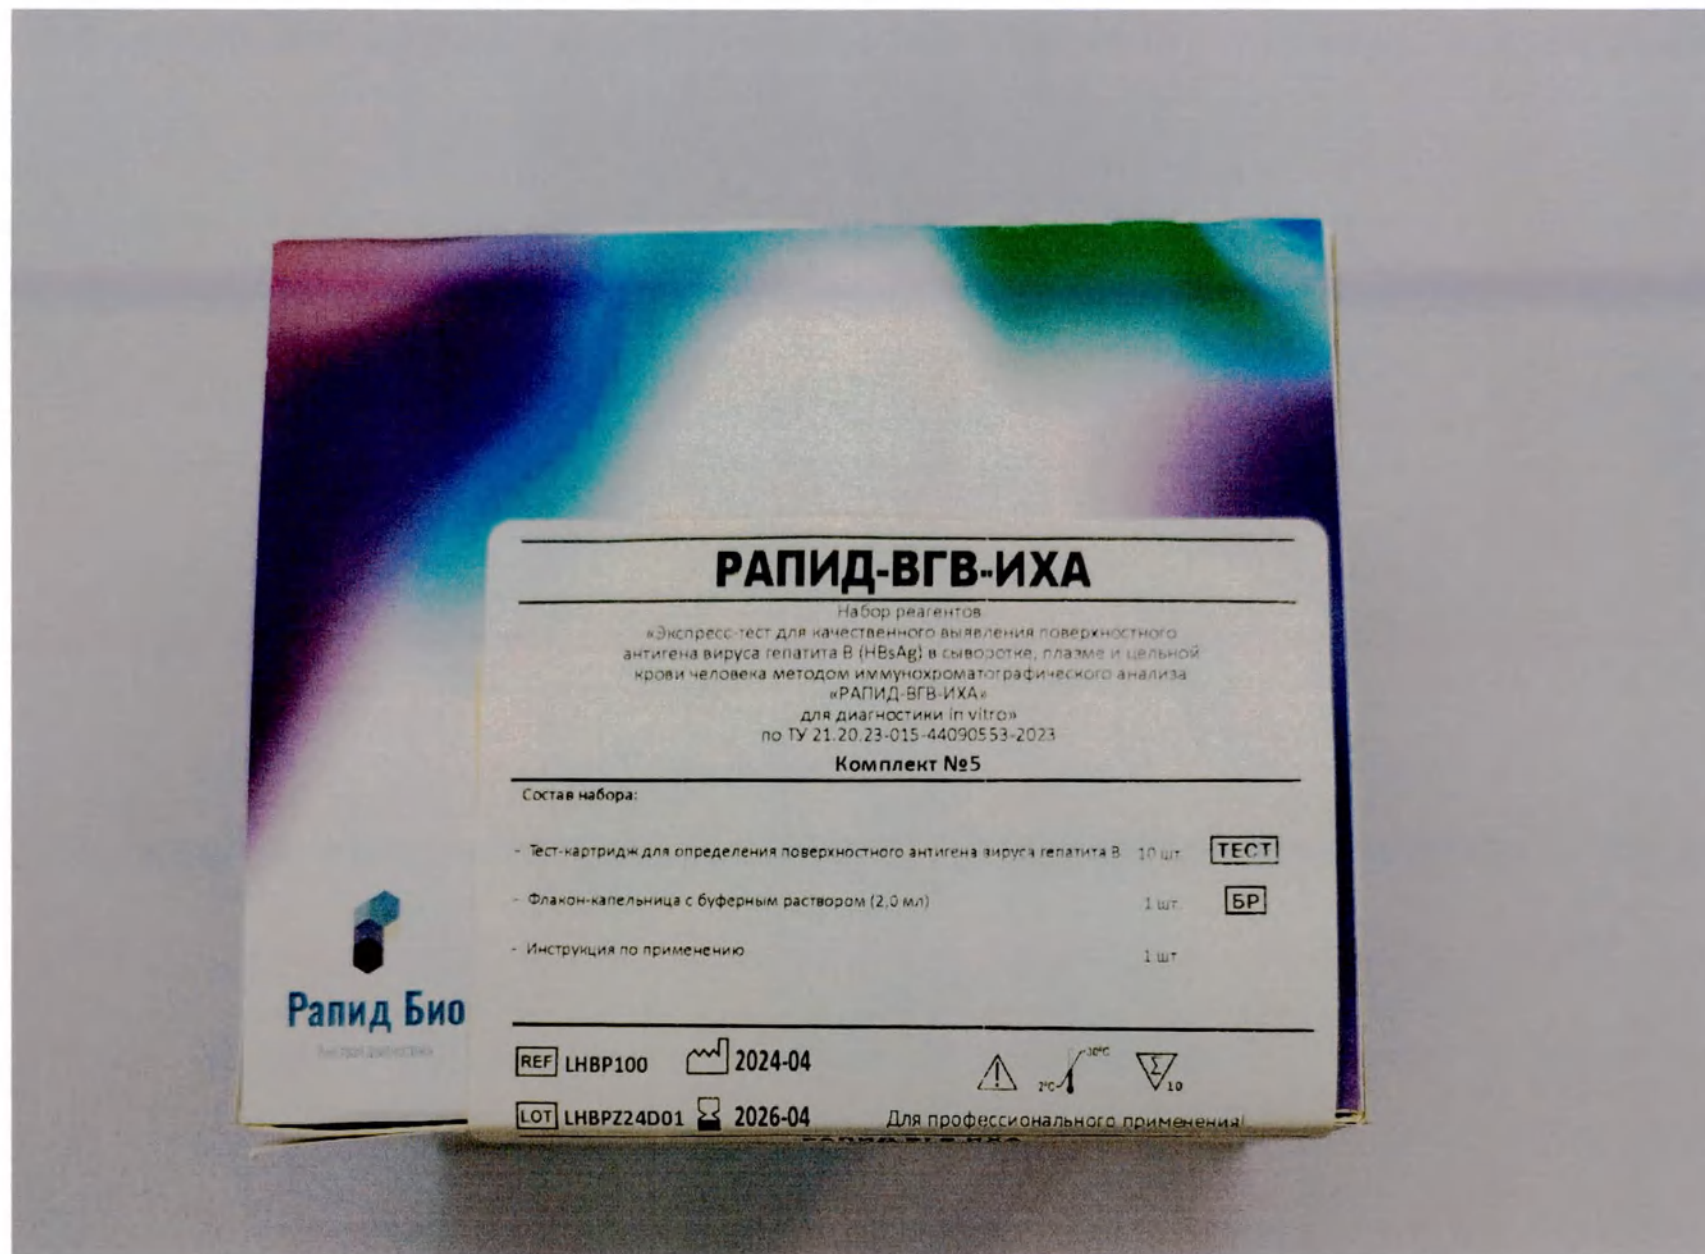


Фотографическое изображение 13. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №5.

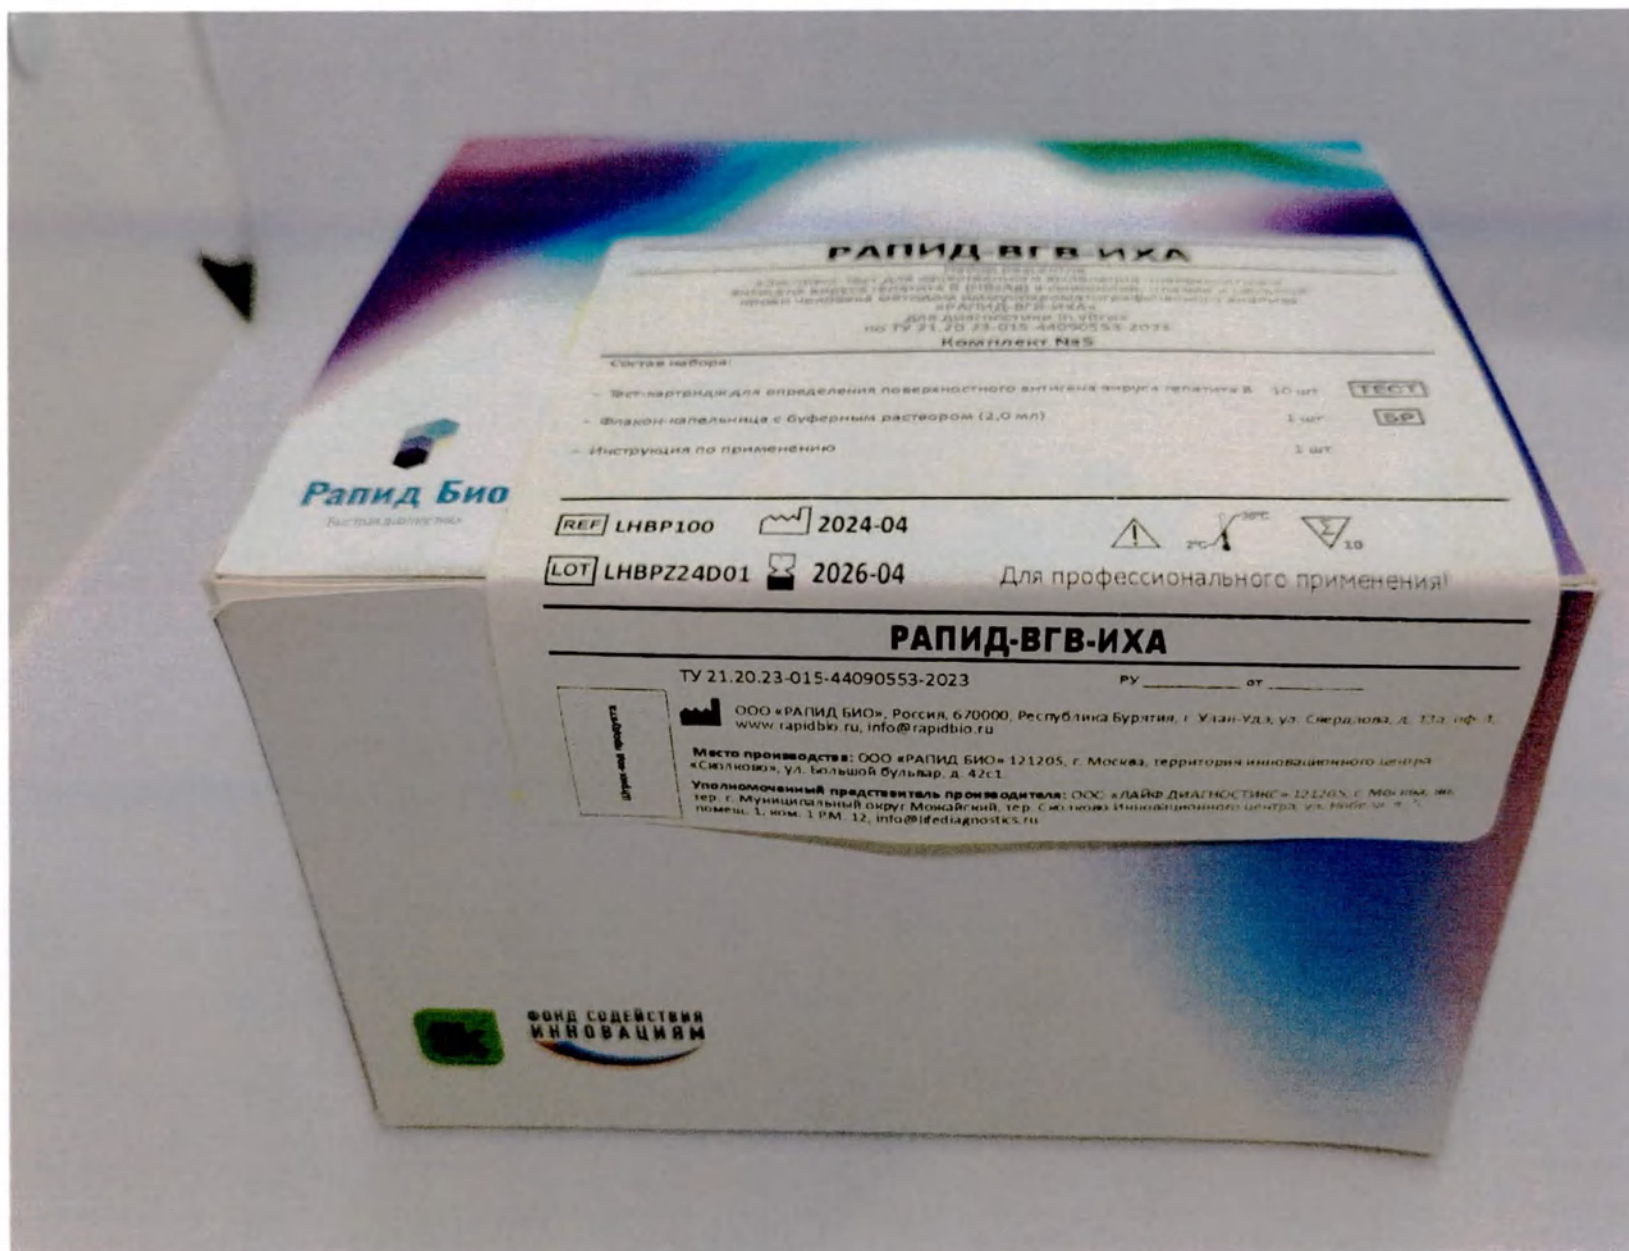


Фотографическое изображение 14. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №5. Состав набора

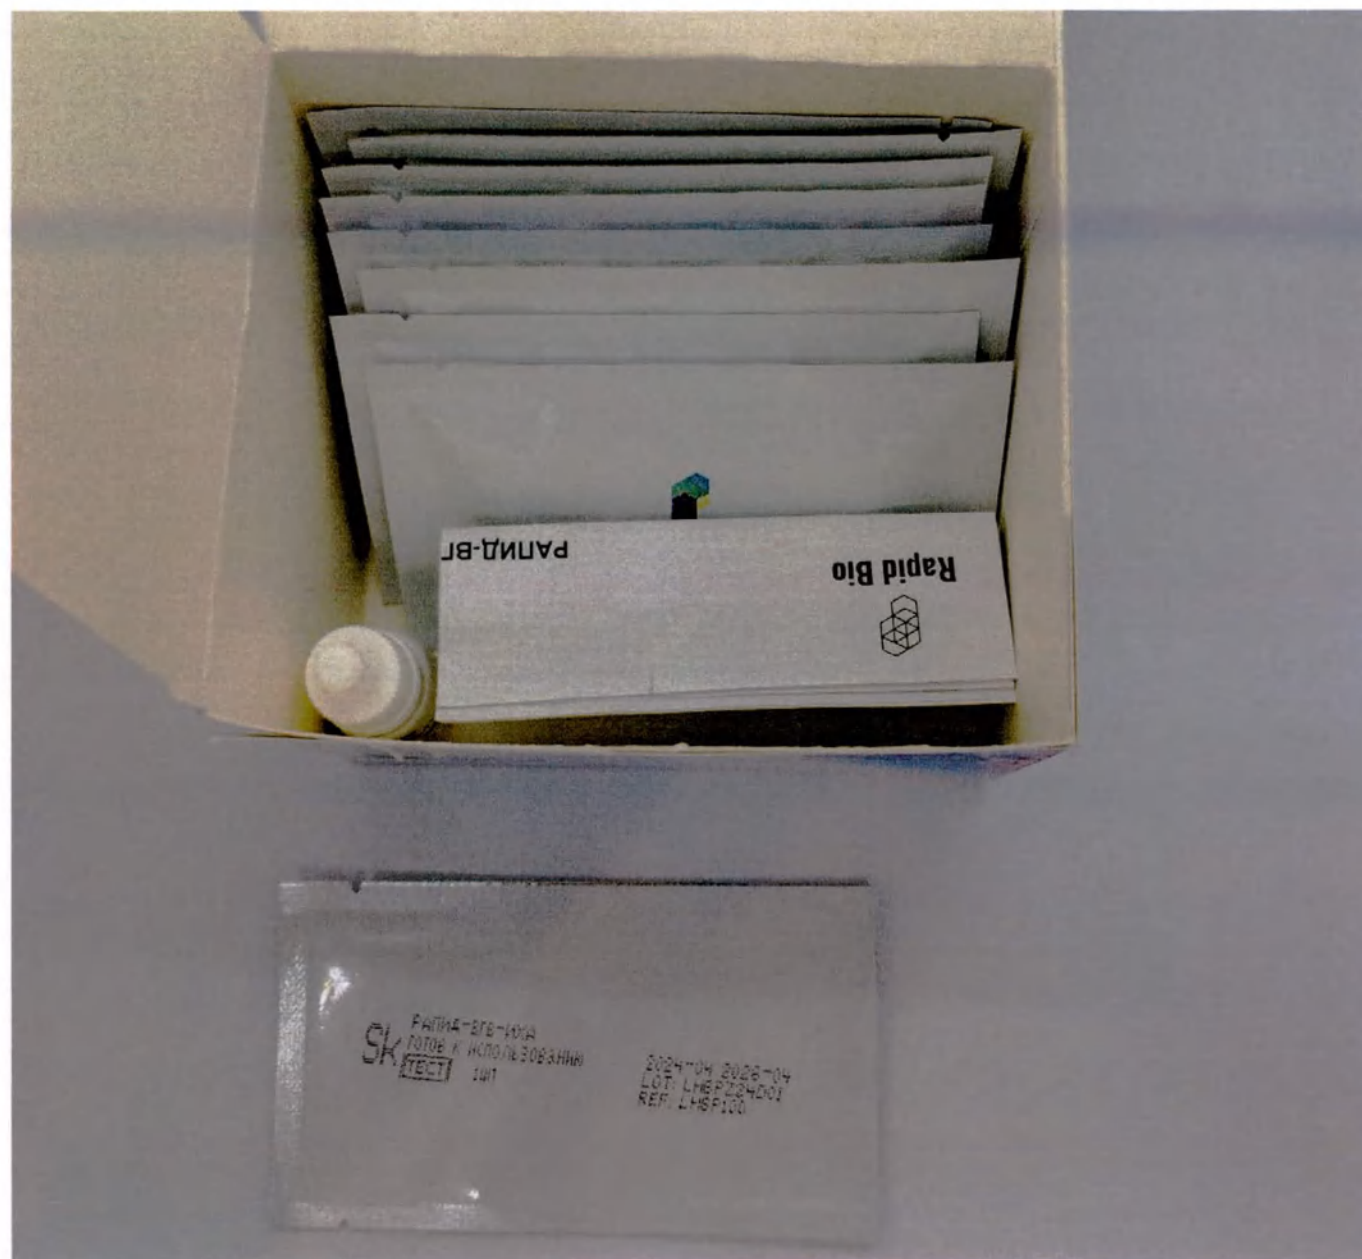

Фотографическое изображение 15. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №6.

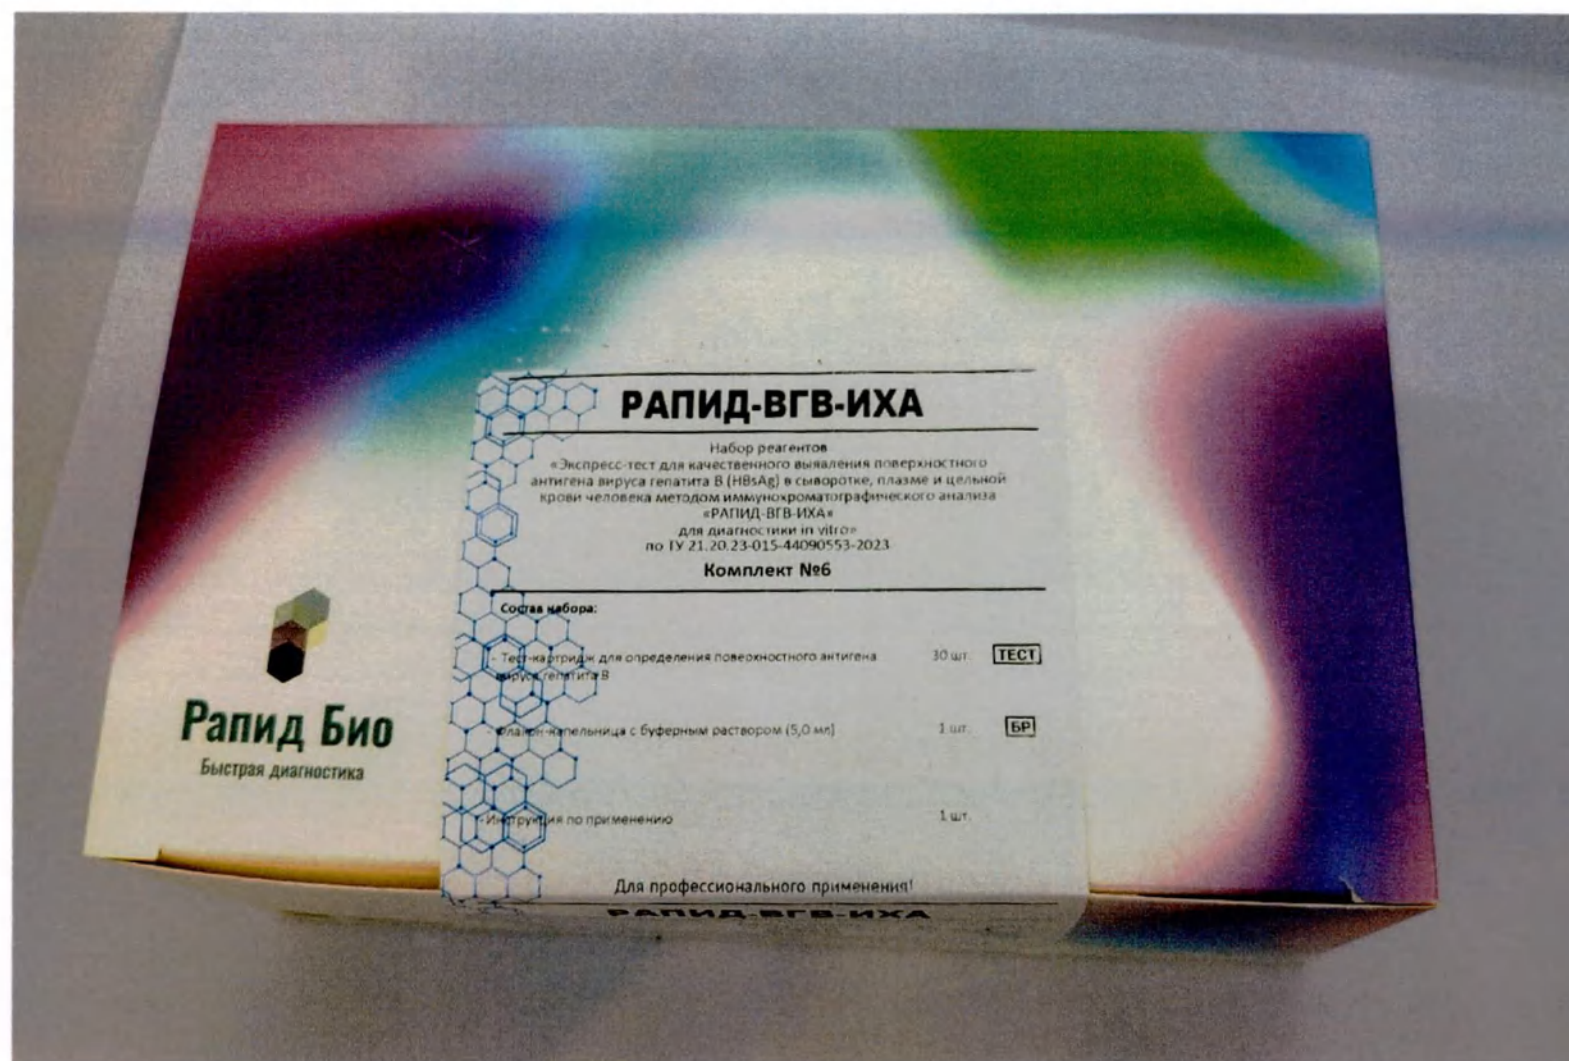

Фотографическое изображение 16. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №6.

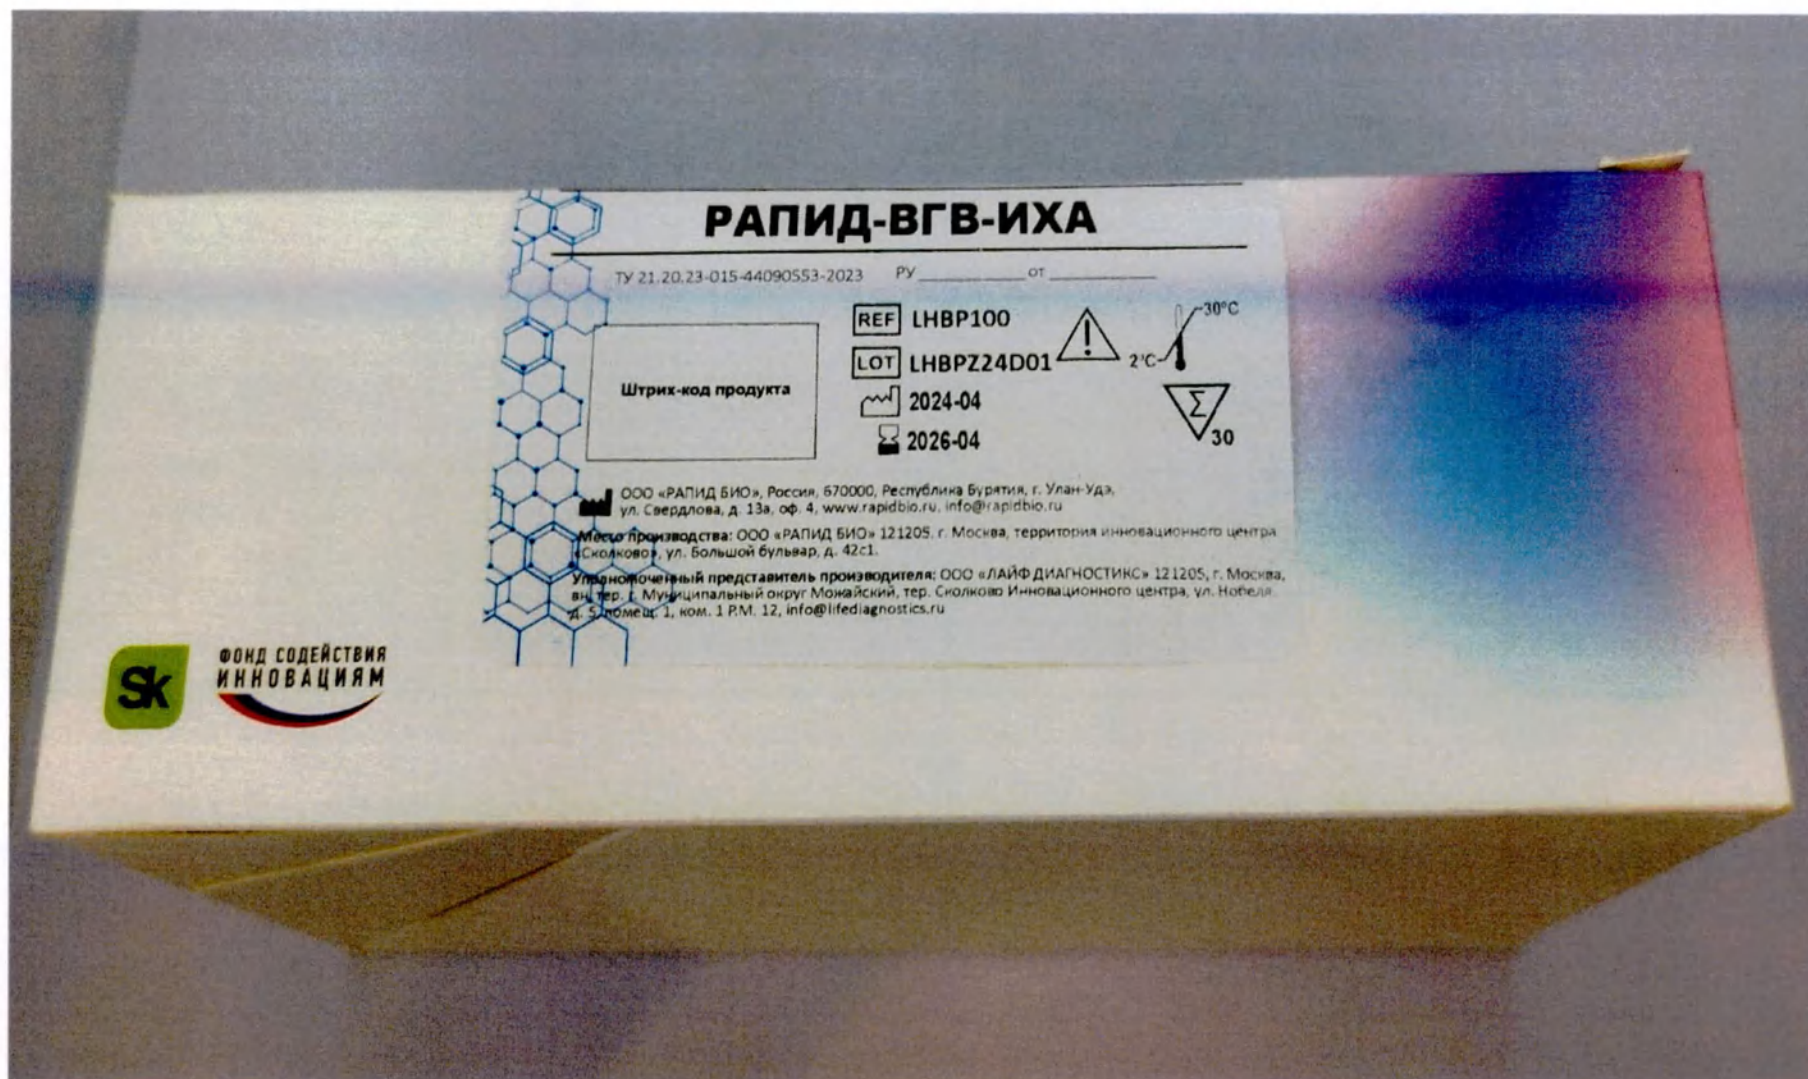


Фотографическое изображение 17. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №6. Состав набора







Фотографическое изображение 19. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №7.

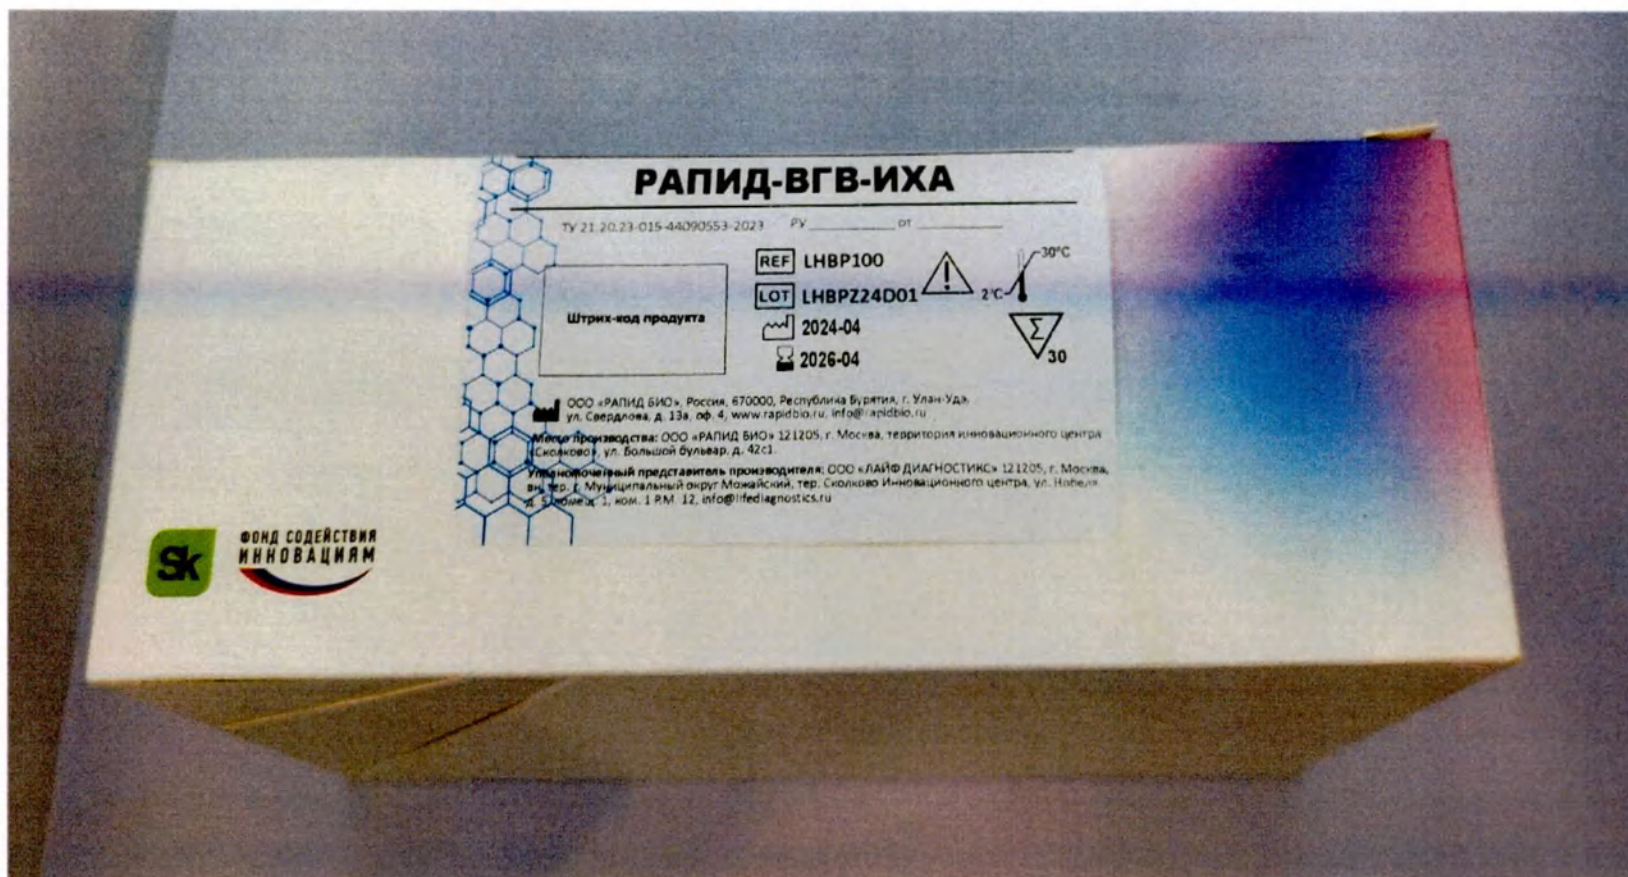


Фотографическое изображение 20. Набор реагентов «РАПИД-ВГВ-ИХА», комплект №7. Состав набора




Фотографическое изображение 21. Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей с буферным раствором 0,1 мл

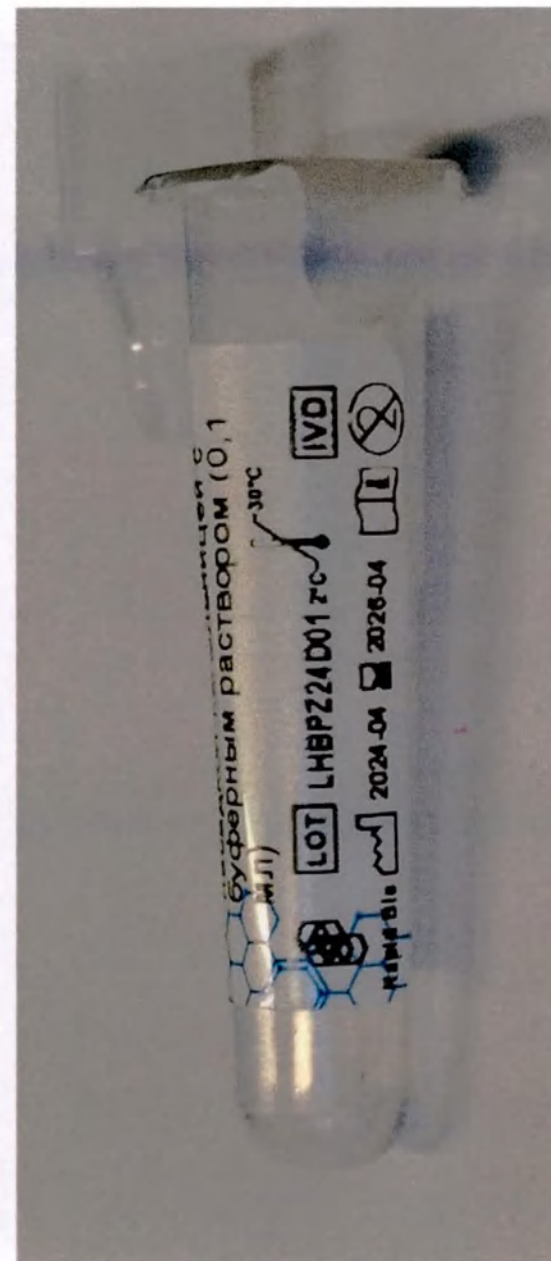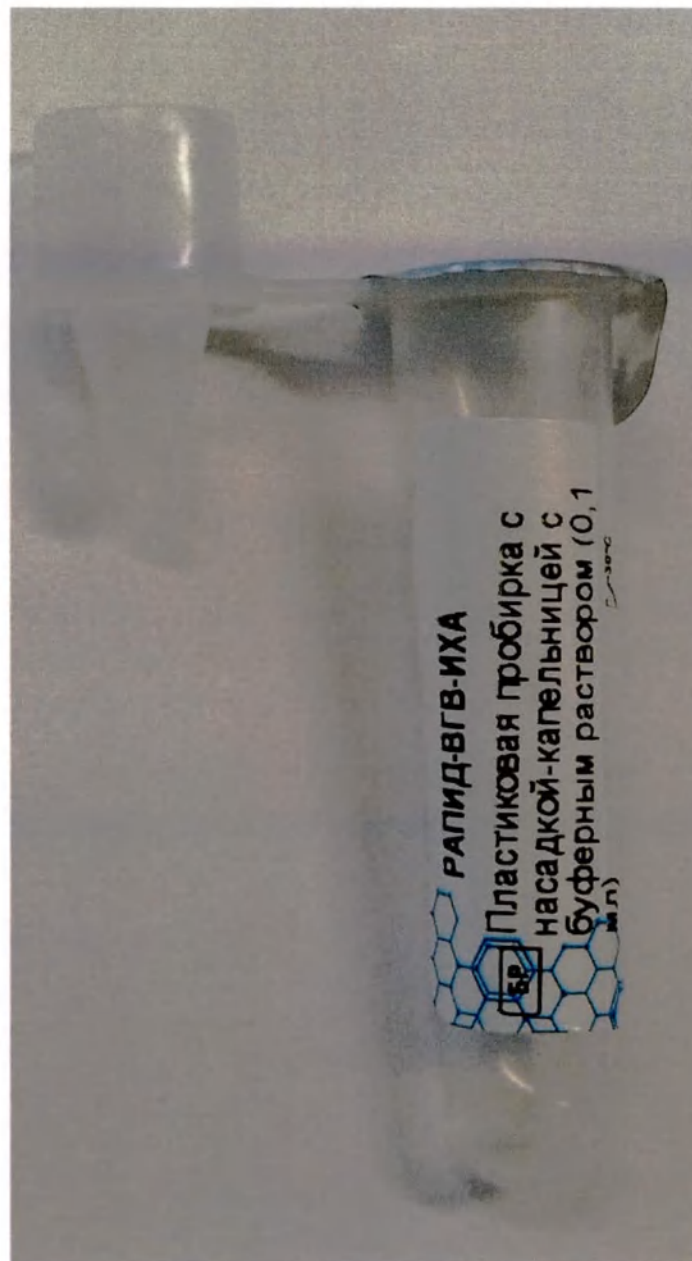

Фотографическое изображение 22. Флакон-капельница с буферным раствором: 2,0 мл

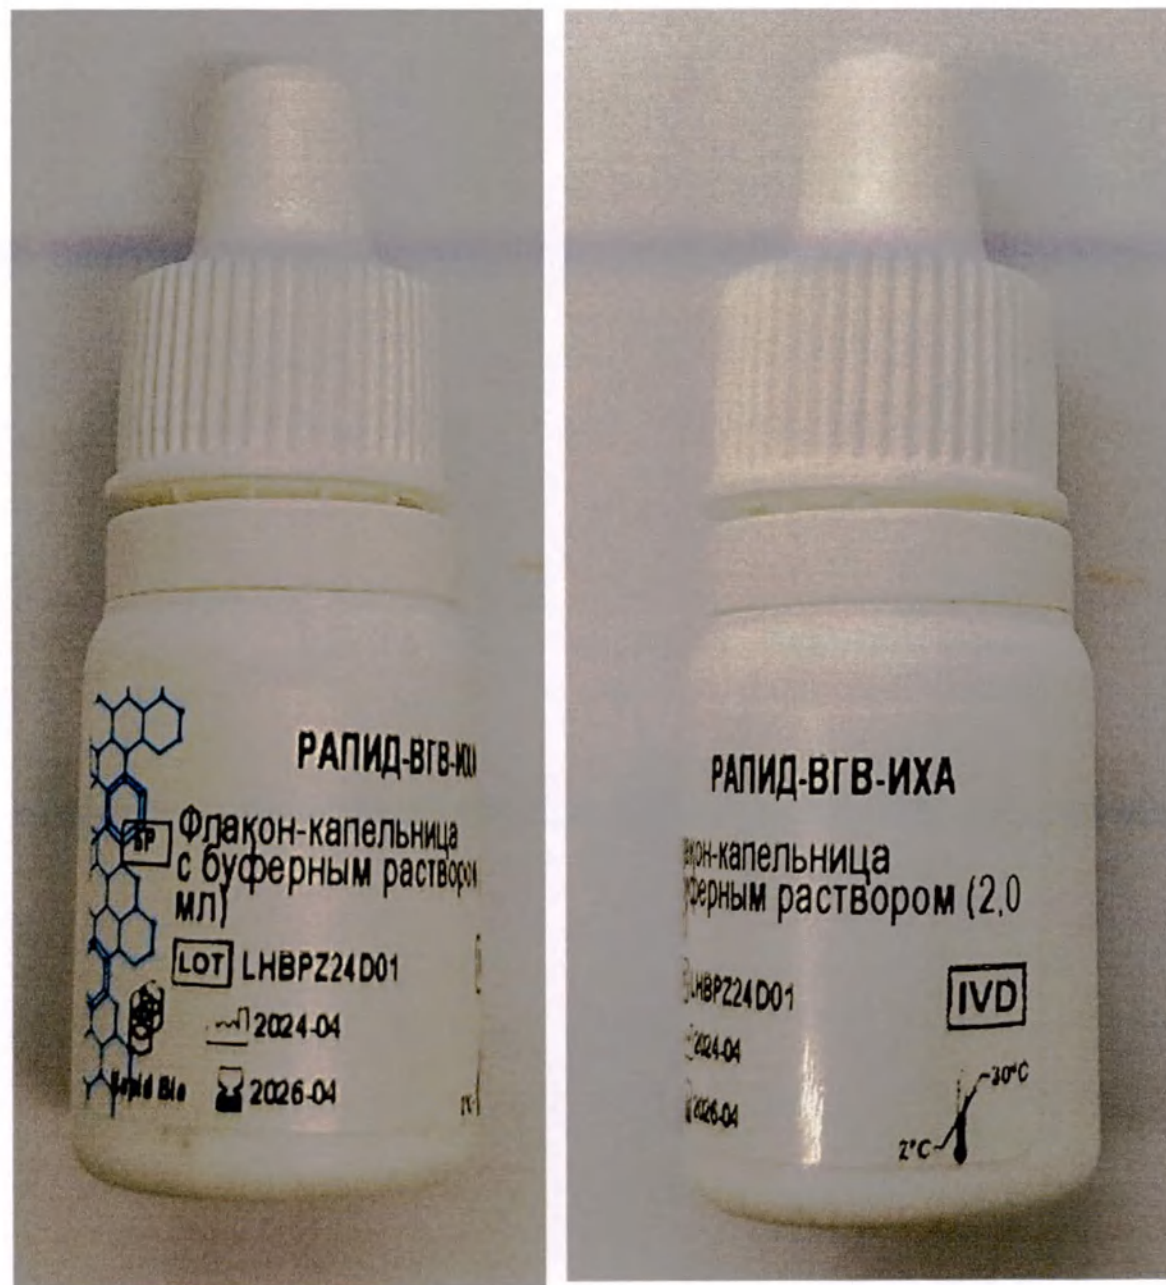

Фотографическое изображение 23. Флакон-капельница с буферным раствором: 5,0 мл

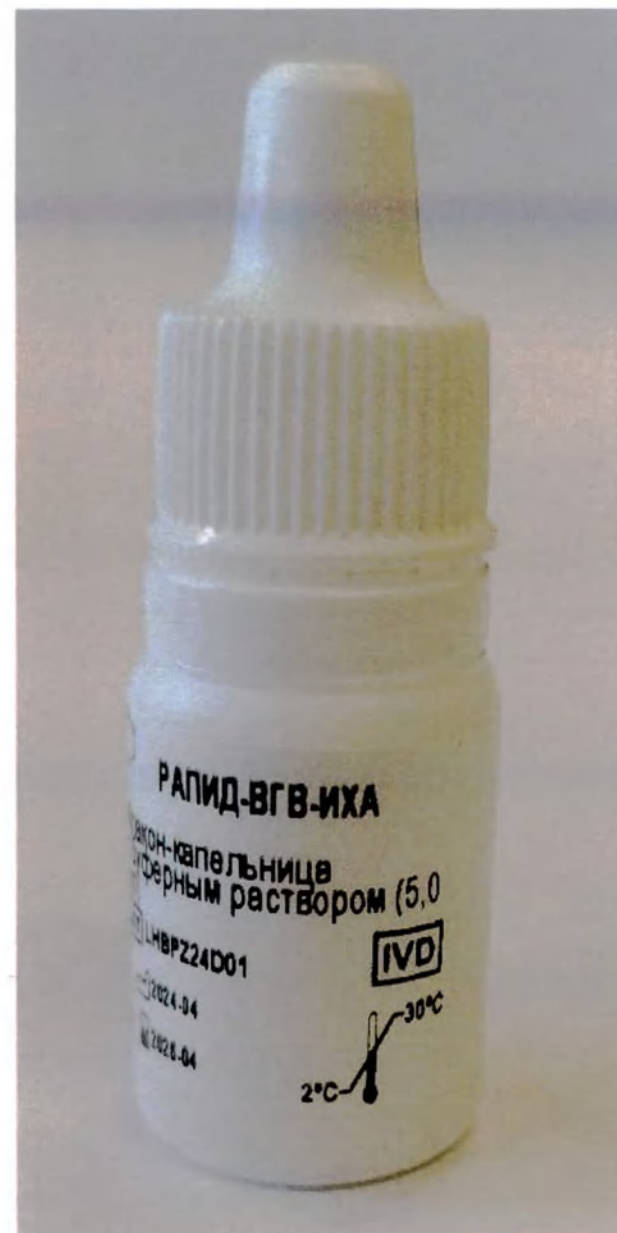

Фотографическое изображение 24. Скарifikатор одноразовый (Ланцеты (скарifikаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения, РУ № ФСЗ 2009/04308)




Фотографическое изображение 25. Индивидуальная/групповая упаковка скарификатора одноразового (Ланцеты (скарификаторы) Acti-lance, Prolance однократного применения, РУ № ФСЗ 2009/04308)




Фотографическое изображение 26. Салфетка антисептическая (Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70 % этиловый спирт)
по ТУ 9393-001-51276525-00, РУ № ФСР 2009/05438)




Фотографическое изображение 27. Пипетка одноразовая (Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов, РУ № ФСЗ 2012/11857)

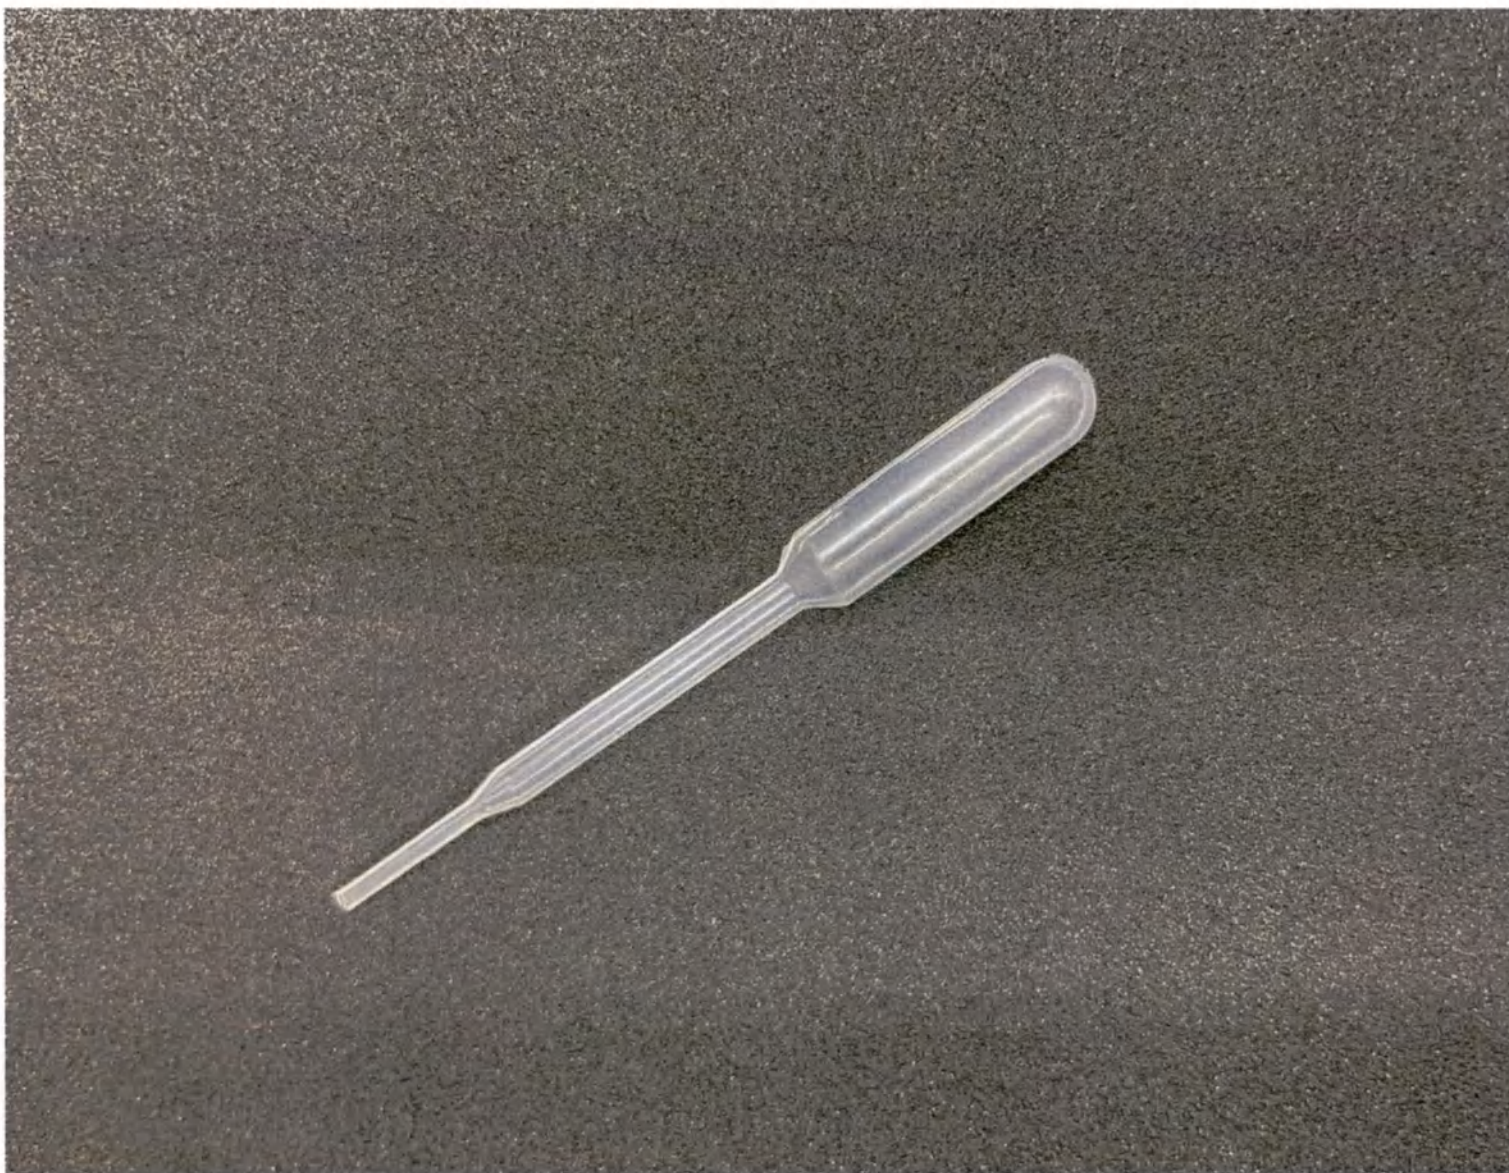

Фотографическое изображение 28. Индивидуальная/групповая упаковка пипетки одноразовой (Изделия для лабораторных исследований из полимерных материалов, РУ № ФСЗ 2012/11857)

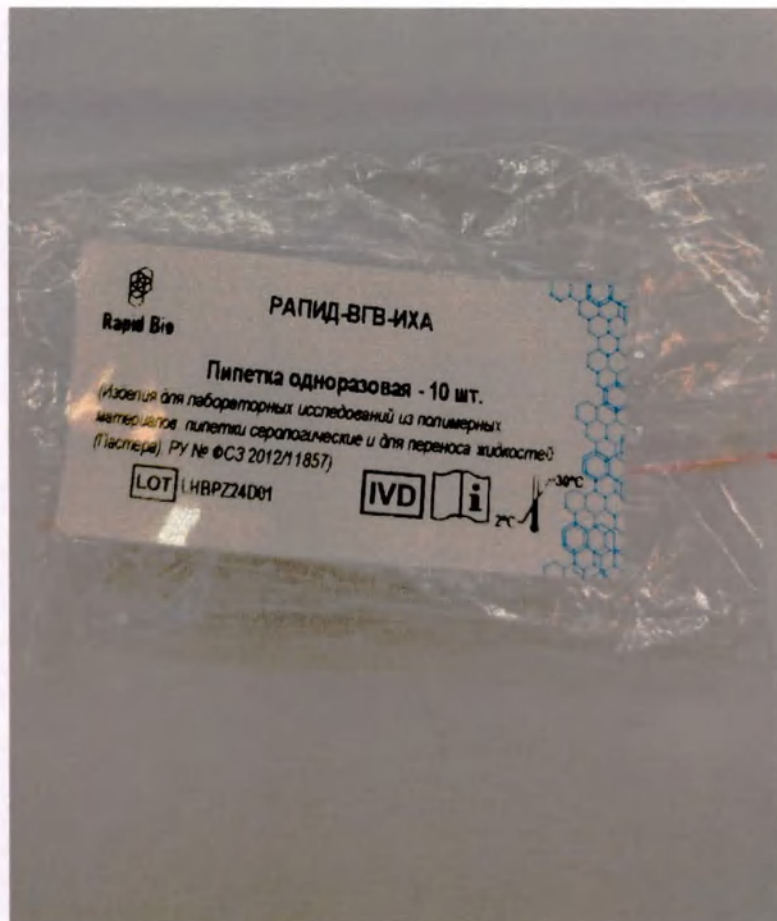

Фотографическое изображение 29. Тест-картридж для определения поверхностного антигена вируса гепатита В

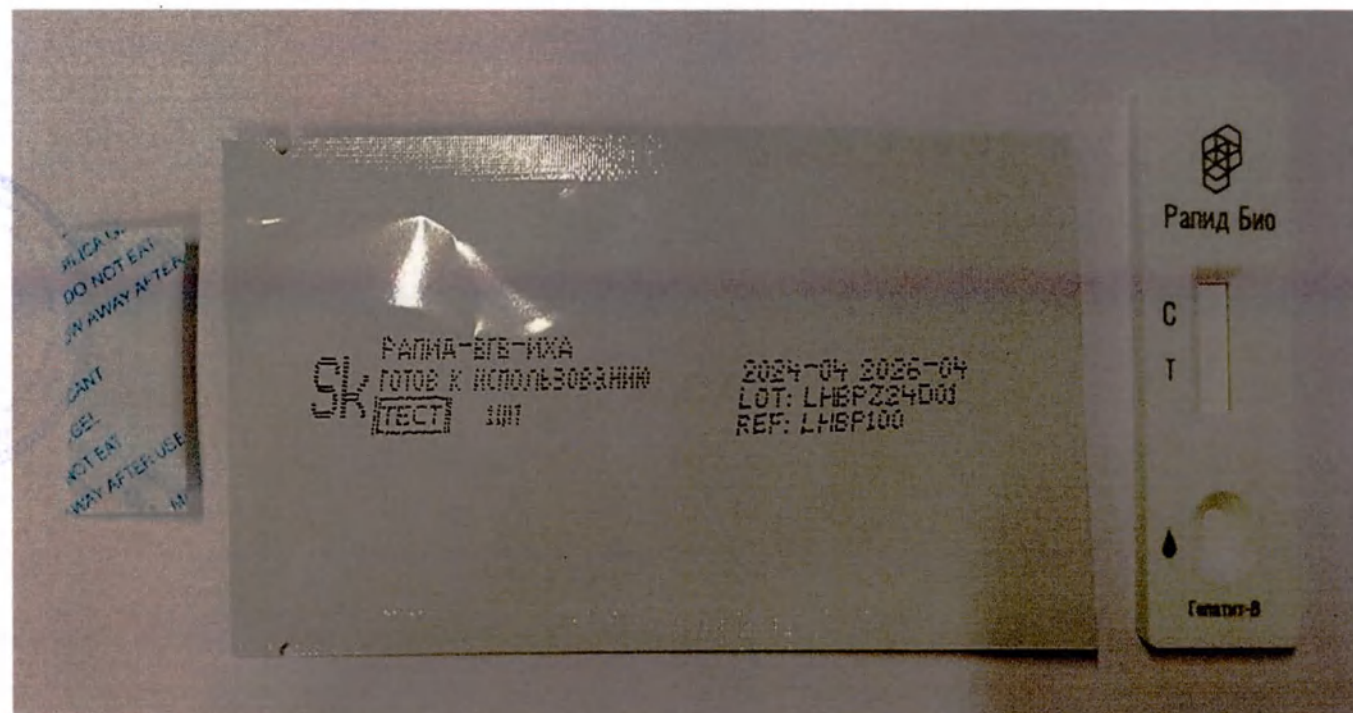

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

34 лист (ов)

Подпись _____ Жимбиев А.Ц.
М.П. _____

