

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Носова Т.А.

2024 г.



## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе  
доставки**

Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd. («Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко.,  
Лтд.»), Китай

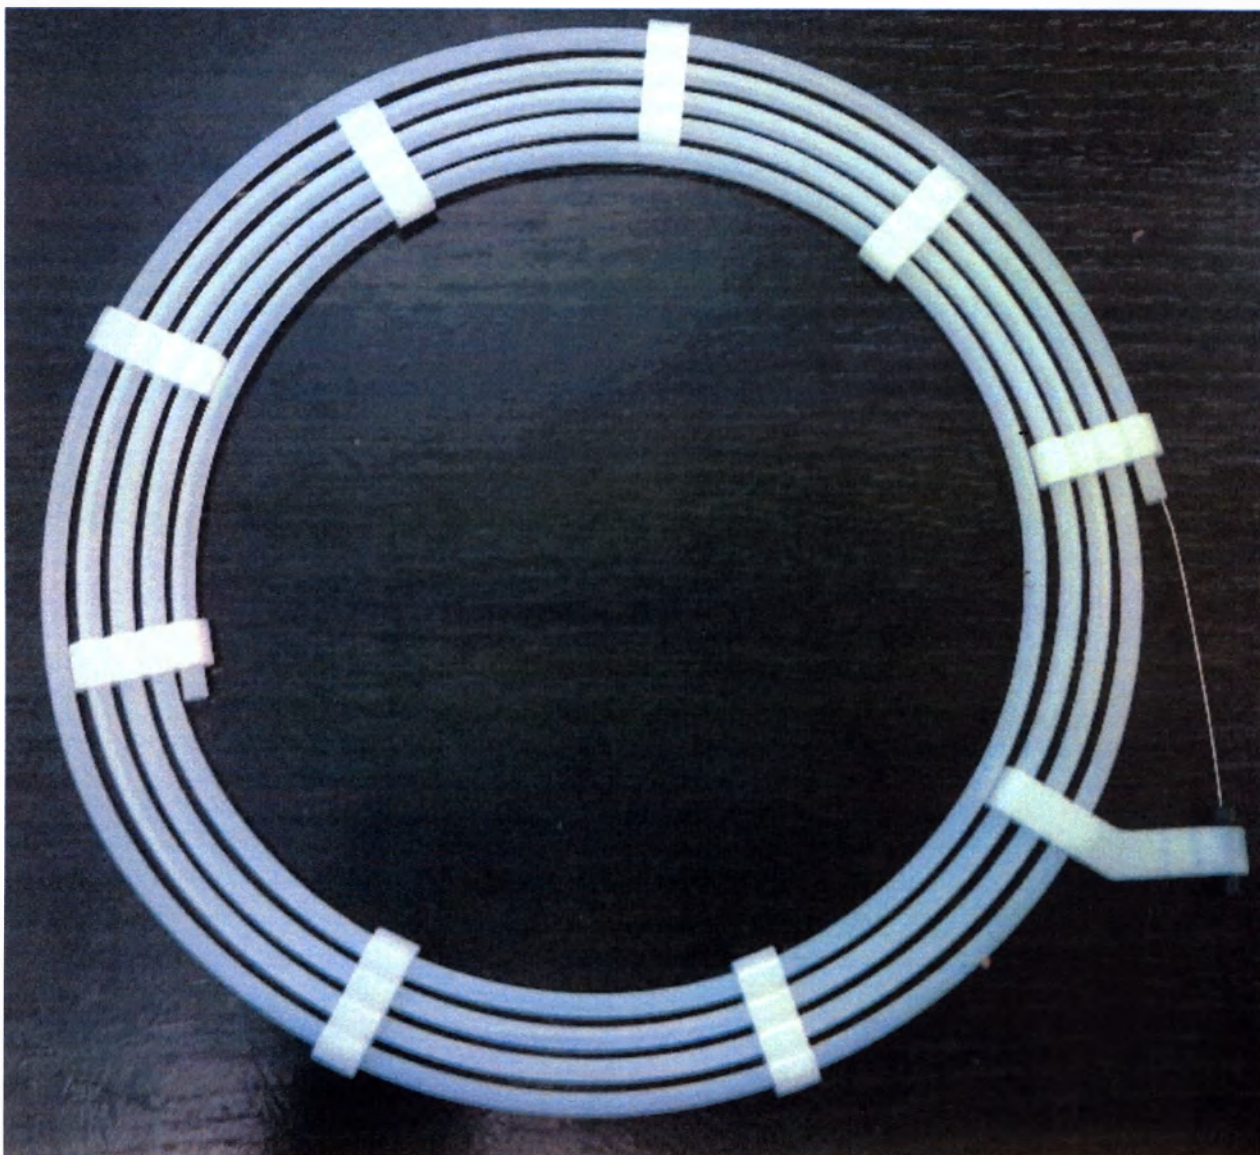
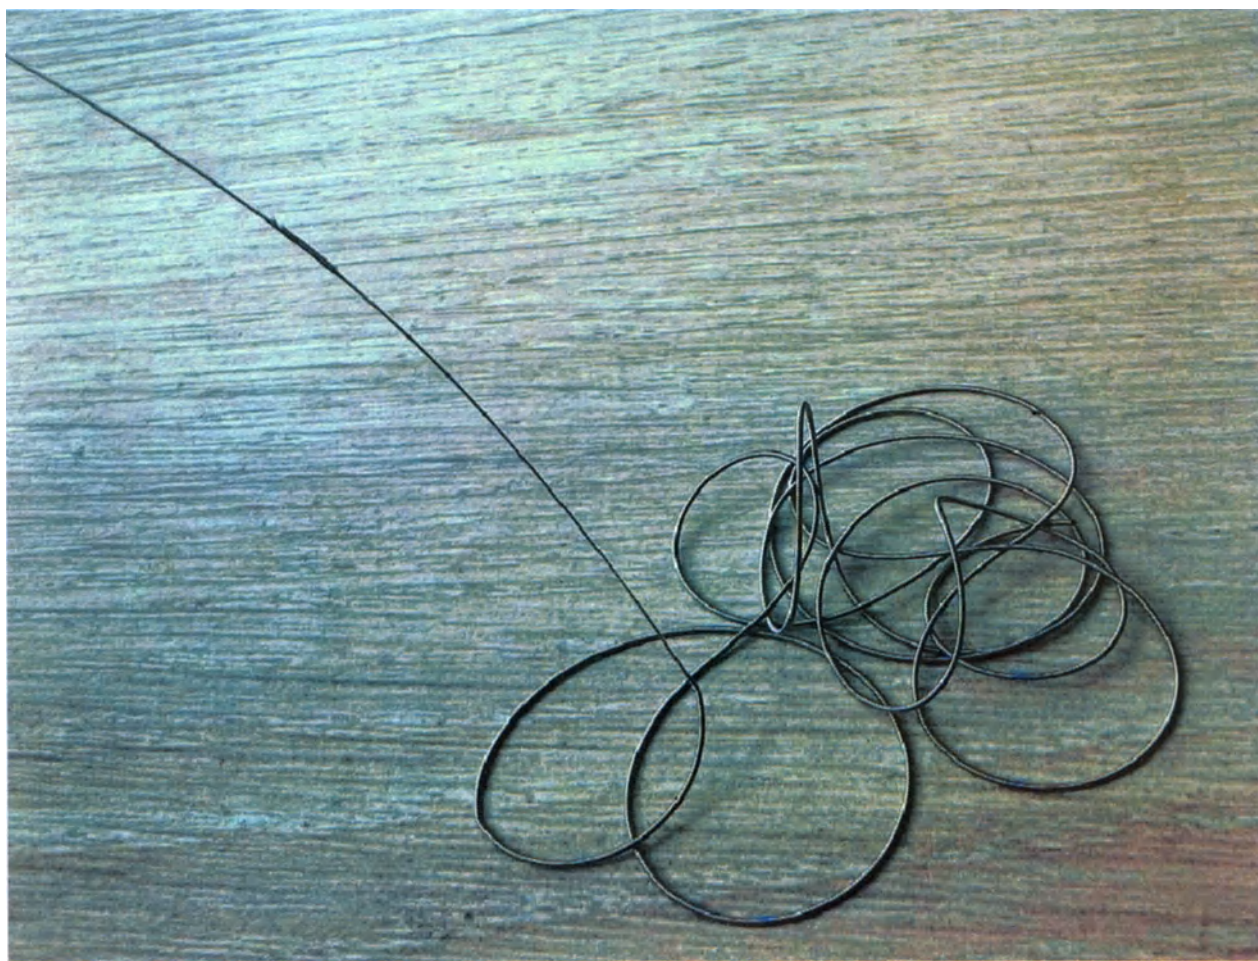


Рисунок 1 – Внешний вид изделия в транспортировочном обode с зажимами



Рисунок 2 – Внешний вид спирали для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки



**Рисунок 3 – Внешний вид спирали для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки**



Рисунок 4 – Внешний вид индивидуальной упаковки изделия (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали Helix)

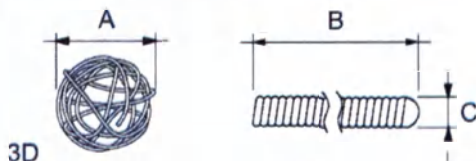


Рисунок 5 – Внешний вид индивидуальной упаковки изделия (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали 3D)

# Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки



REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX



3D

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A Диаметр имплантируемой спирали<br>X мм         | B Длина имплантируемой спирали в растянутом состоянии<br>X см      |
| C Диаметр проволоки спирали<br>X.XX мм (X.XXXX") | Внутренний диаметр совместимого микрокатетера<br>X.XX мм (X.XXXX") |

Состав: Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки, в варианте исполнения xxx-xx-xx-x  
- Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки в конфигурации 3D, - диаметром x мм, длиной x см - 1 шт.  
- Инструкция по применению - 1 шт.

Верс. 03/21

Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd.  
(«Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд.»), Китай  
Адрес производителя: Unit 1-B, Building 4, CFC  
High Tech Industrial Park, Zhuhai City, China.  
Тел.: +86-756-3313003  
Факс.: +86-756-3313003



TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
(XX)XXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
(XX)XXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
(XX)XXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи».  
ИНН: 7722385440  
129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.  
Тел. +7 (499) 281-67-68 Адрес электронной почты: info@beawire.com  
Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X

Диаметр имплантируемой спирали X мм

Длина имплантируемой спирали в растянутом состоянии X см

LOT XXXXXXXXXXXX XX.XX.XXXX

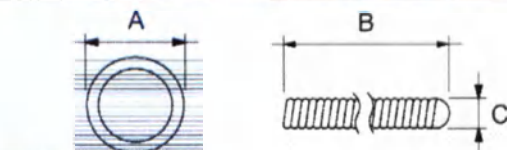


Рисунок 6 – Макет маркировки индивидуальной упаковки (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали 3D)

# Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки



REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX



2D

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A Диаметр имплантируемой спирали<br>X мм         | B Длина имплантируемой спирали в растянутом состоянии<br>X см      |
| C Диаметр проволоки спирали<br>X.XX мм (X.XXXX") | Внутренний диаметр совместимого микрокатетера<br>X.XX мм (X.XXXX") |

Состав: Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки, в варианте исполнения xxx-xx-xx-x  
- Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки в конфигурации Helix, диаметром x мм, длиной x см - 1 шт.  
- Инструкция по применению - 1 шт.

Верс. 03/21

Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd.  
(«Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд.»), Китай  
Адрес производителя: Unit 1-B, Building 4, CFC  
High Tech Industrial Park, Zhuhai City, China.  
Тел.: +86-756-3313003  
Факс.: +86-756-3313003



TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
(XX)XXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
(XX)XXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
(XX)XXXXXXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX(XX)XXXXXXXXXX

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи».  
ИНН: 7722385440  
129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.  
Тел. +7 (499) 281-67-68 Адрес электронной почты: info@beawire.com  
Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X

Диаметр имплантируемой спирали X мм

Длина имплантируемой спирали в растянутом состоянии X см

LOT XXXXXXXXXXXX XX.XX.XXXX

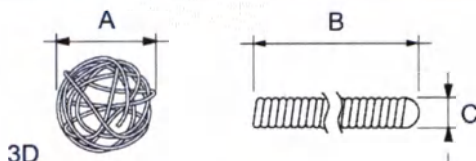


Рисунок 7 – Макет маркировки индивидуальной упаковки (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали Helix)

# Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки



REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX



3D

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A Диаметр имплантируемой спирали<br>X мм         | B Длина имплантируемой спирали в растянутом состоянии<br>X см      |
| C Диаметр проволоки спирали<br>X.XX мм (X.XXXX") | Внутренний диаметр совместимого микрокатетера<br>X.XX мм (X.XXXX") |

Состав: Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки, в варианте исполнения xxx-xx-xx-x.  
- Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки в конфигурации 3D, диаметром x мм, длиной x см – 1 шт.  
- Инструкция по применению – 1 шт.

Верс. 03/21

Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd.  
(«Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд.»), Китай  
Адрес производителя: Unit 1-B, Building 4, CFC  
High Tech Industrial Park, Zhuhai City, China.  
Тел.: +86-756-3313003  
Факс.: +86-756-3313003



TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи».  
ИНН: 7722385440  
129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.  
Тел. +7 (499) 281-67-68 Адрес электронной почты: info@beawire.com  
Регистрационное удостоверение № от

TONBRIDGE  
Gekko

REF

XXX-XX-XX-X

Диаметр имплантируемой спирали  
X мм

Длина имплантируемой спирали в растянутом состоянии  
X см

LOT

XXXXXXXXXX  
XX.XX.XXXX


TONBRIDGE  
MEDICAL

Рисунок 8 – Макет маркировки потребительской упаковки (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали 3D)

# Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки



REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX

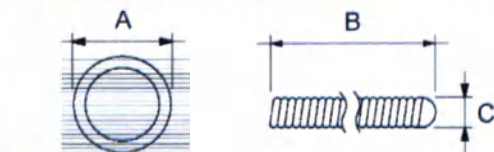

2D

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A Диаметр имплантируемой спирали<br>X мм         | B Длина имплантируемой спирали в растянутом состоянии<br>X см      |
| C Диаметр проволоки спирали<br>X.XX мм (X.XXXX") | Внутренний диаметр совместимого микрокатетера<br>X.XX мм (X.XXXX") |

Состав: Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки, в варианте исполнения xxx-xx-xx-x.  
- Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки в конфигурации Helix, диаметром x мм, длиной x см – 1 шт.  
- Инструкция по применению – 1 шт.

Верс. 03/21

Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd.  
(«Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд.»), Китай  
Адрес производителя: Unit 1-B, Building 4, CFC  
High Tech Industrial Park, Zhuhai City, China.  
Тел.: +86-756-3313003  
Факс.: +86-756-3313003



TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX

TONBRIDGE Gekko REF XXX-XX-XX-X LOT XXXXXXXXXXXX  
XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи».  
ИНН: 7722385440  
129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.  
Тел. +7 (499) 281-67-68 Адрес электронной почты: info@beawire.com  
Регистрационное удостоверение № от

TONBRIDGE  
Gekko

REF

XXX-XX-XX-X

Диаметр имплантируемой спирали  
X мм

Длина имплантируемой спирали в растянутом состоянии  
X см

LOT

XXXXXXXXXX  
XX.XX.XXXX

TONBRIDGE  
MEDICAL

Рисунок 9 – Макет маркировки потребительской упаковки (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали Helix)



TONBRIDGE  
MEDICAL

DETACHABLE  
COIL  
SYSTEM



TONBRIDGE  
**Gekko**  
Detachable  
Coil System

Рисунок 10 – Внешний вид потребительской упаковки. Вид спереди

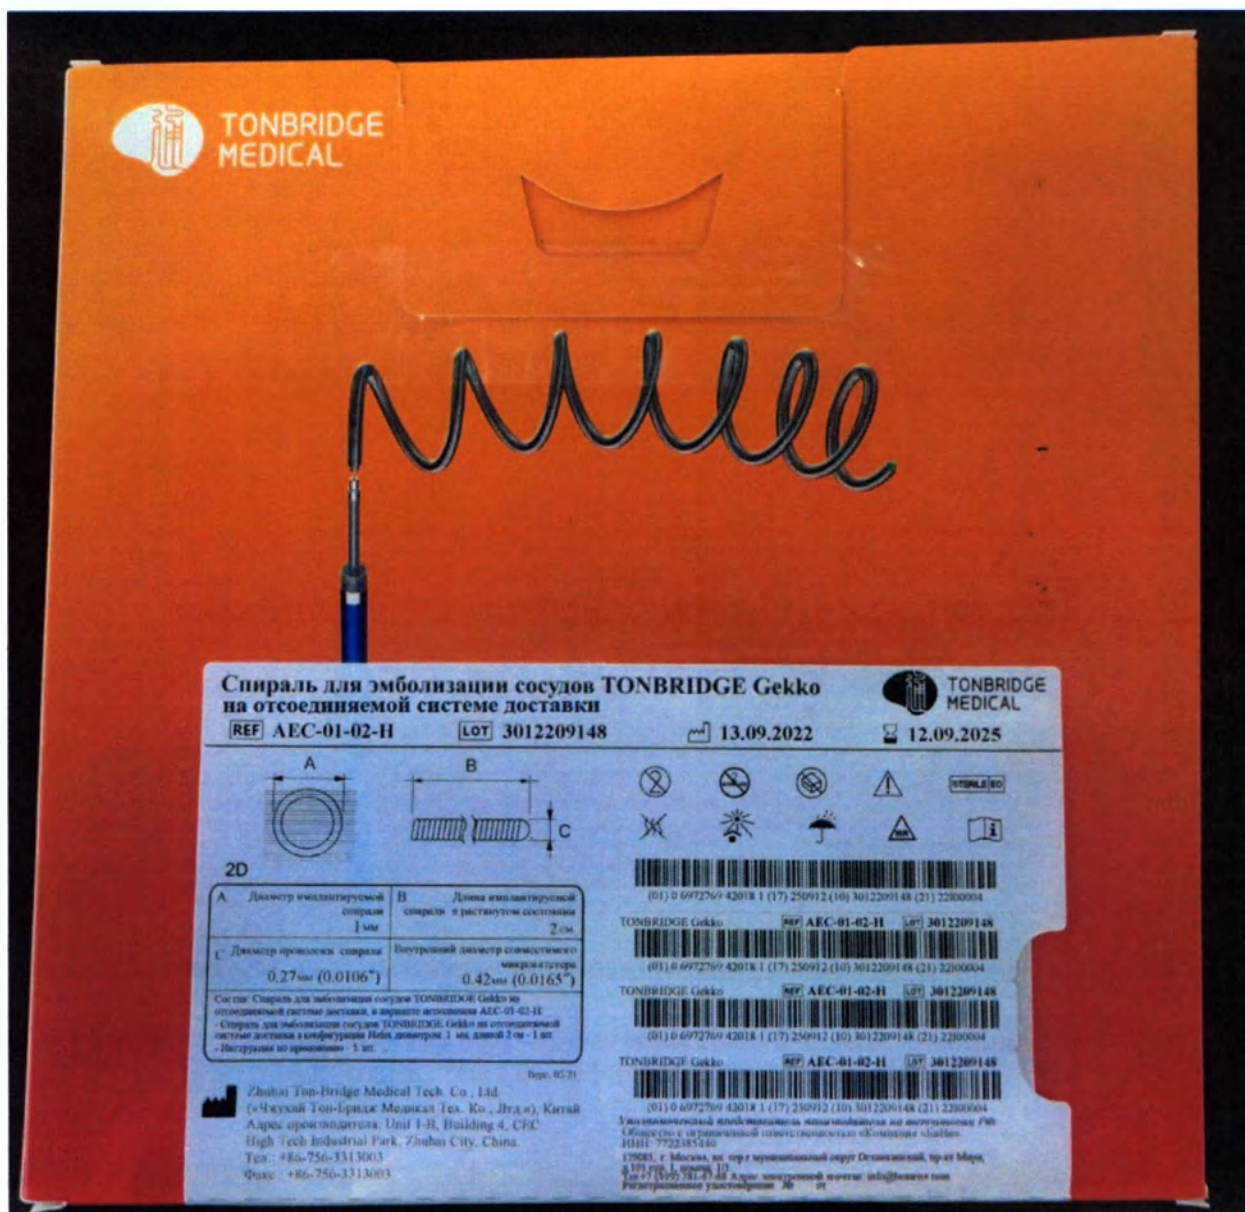


Рисунок 10 – Внешний вид потребительской упаковки. Вид сзади (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали Helix)

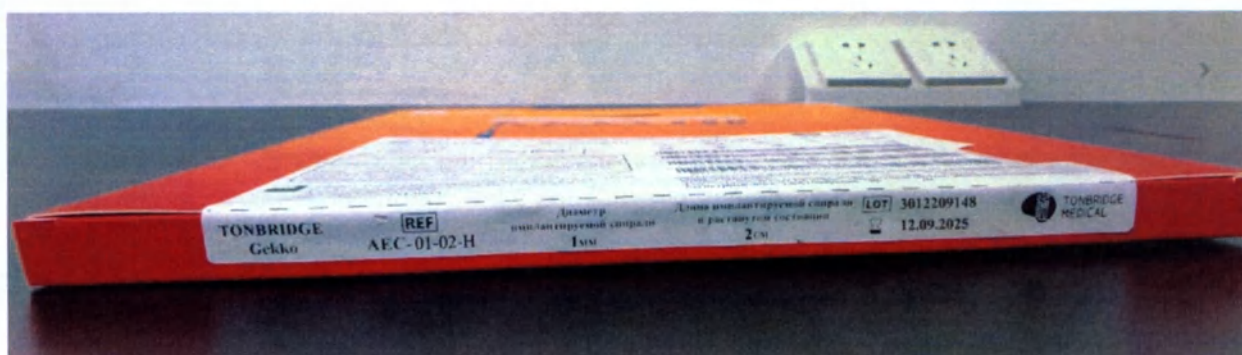


Рисунок 11 – Внешний вид потребительской упаковки. Вид сбоку (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали Helix)

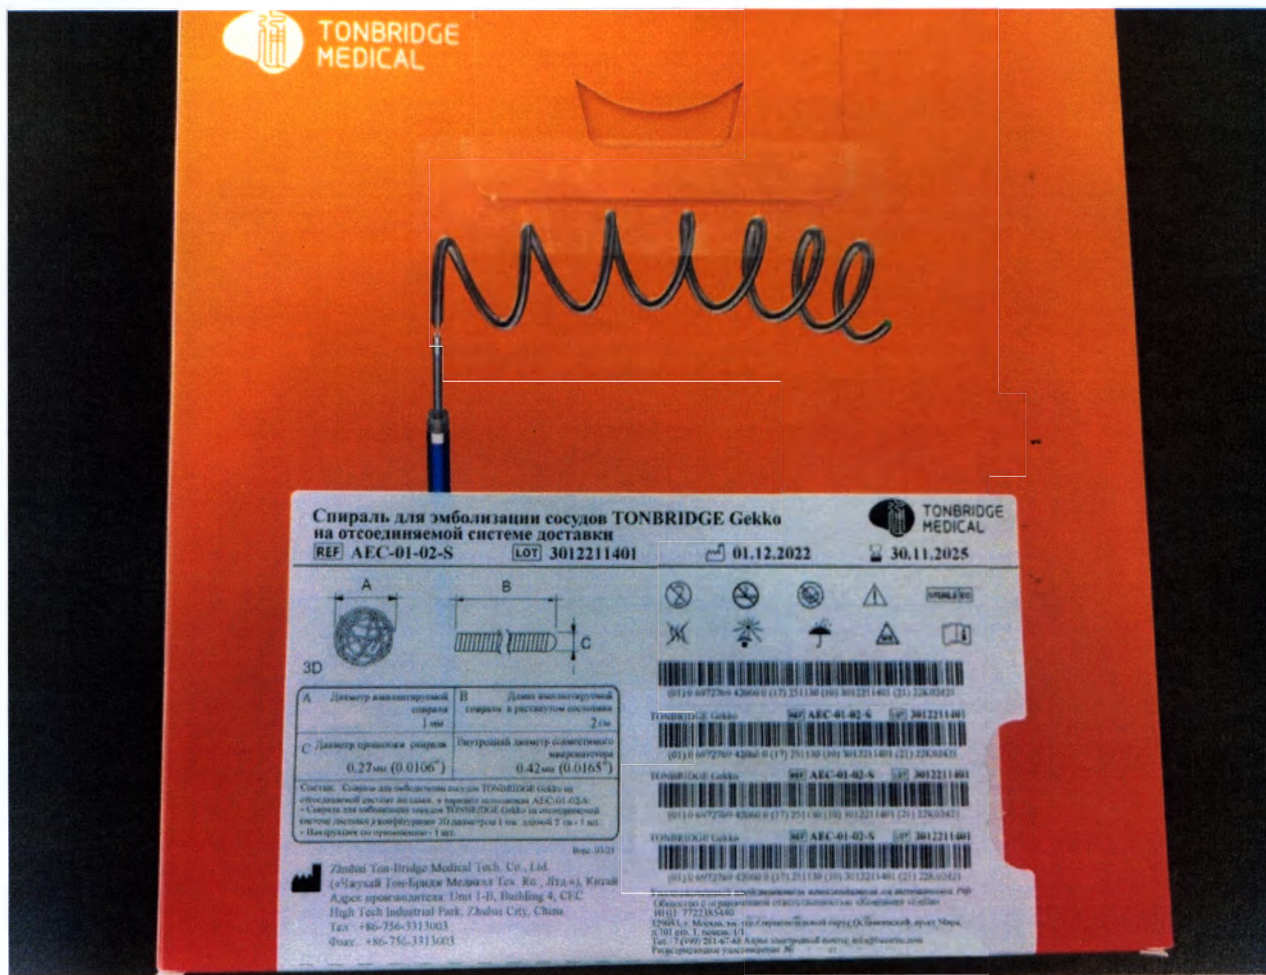


Рисунок 12 – Внешний вид потребительской упаковки. Вид сзади (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали 3D)



Рисунок 13 – Внешний вид потребительской упаковки. Вид сбоку (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали 3D)



**Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки**

Количество изделий в транспортной упаковке: 20 шт.

Размер транспортной упаковки: 37 x 32 x 34,5 см

Вес брутто:



**AEC-XX-XX-S**



XXXXXXXXXX



Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd.

(«Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд.»), Китай

Адрес производителя: Unit 1-B, Building 4, CEC High Tech Industrial Park, Zhuhai City, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

**Вариант исполнения: AEC-XX-XX-S**

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»

129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.

ИНН 7722385440

Тел.: +7 (499) 281-67-68

[info@beawire.com](mailto:info@beawire.com)

Регистрационное удостоверение №

от



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



Рисунок 15 – Макет маркировки транспортной упаковки (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали 3D)

**Спираль для эмболизации сосудов TONBRIDGE Gekko на отсоединяемой системе доставки**

Количество изделий в транспортной упаковке: 20 шт.

Размер транспортной упаковки: 37 x 32 x 34,5 см

Вес брутто:



**AEC-XX-XX-H**



XXXXXXXXXX



Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd.

(«Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд.»), Китай

Адрес производителя: Unit 1-B, Building 4, CEC High Tech Industrial Park, Zhuhai City, China.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

**Вариант исполнения: AEC-XX-XX-H**

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи»

129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1.

ИНН 7722385440

Тел.: +7 (499) 281-67-68

[info@beawire.com](mailto:info@beawire.com)

Регистрационное удостоверение №

от



XX.XX.XXXX



XX.XX.XXXX



Рисунок 16– Макет маркировки транспортной упаковки (для вариантов исполнения с конфигурацией спирали Helix)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью и подписью: 13 листа (-ов)

Генеральный директор г / Носова Т. А.



МИТРОХИНА Ю.Ю.  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ 77АД3555350