

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**«Станция анестезиологическая APUS», с принадлежностями,
в вариантах исполнения»**

Станция анестезиологическая APUS x1

I. Станция анестезиологическая APUS x1, в составе:

1. Основной модуль APUS x1, в составе:

1.0 Впускная система подачи анестезирующих газов, 1 шт.

1.1 Впускная система подачи кислорода, 1 шт.

1.2 Впускная система подачи сжатого воздуха, 1 шт.

1.3 Система удаления анестезирующего газа, 1 шт.

1.4 Анестезиологический аппарат ИВЛ, 1 шт.

1.5 Узел расходомера, 1 шт.

1.6 Анестезиологическая дыхательная система, 1 шт.

1.7 Монитор работы станции, 1 шт.

1.8 Корпус на тележке, 1 шт.

1.9 Выдвижной ящик, не более 2шт.

1.10 Тележка – 1 шт.

2. Многопараметрический монитор пациента «aXcent medical» моделей: PAVO, CETUS x12, CETUS x15, CETUS xL с принадлежностями – РУ №РЗН 2022/19281 (при необходимости), 1 шт.

3. Устройство удаления мокроты с отрицательным давлением (при необходимости), 1 шт.

4. Компрессор медицинского воздуха (при необходимости), 1 шт.

5. Кронштейн монитора пациента (при необходимости), 1 шт.

6. Поручень, 1 шт.

7. Аккумулятор литий-ионный, 1 шт. (при необходимости, 2 шт) – не более 2 шт.

8. Кабель электропитания, 1 шт.

9. Кабель заземления, 1 шт.

10. Руководство по эксплуатации, 1 шт.


Станция анестезиологическая APUS x1



I. Станция анестезиологическая APUS x1, в составе:

- 1. Основной модуль APUS x1, в составе:
 - 1.0 Впускная система подачи анестезирующих газов, 1 шт.
 - 1.1 Впускная система подачи кислорода, 1 шт.
 - 1.2 Впускная система подачи сжатого воздуха, 1 шт.
 - 1.3 Система удаления анестезирующего газа, 1 шт.
 - 1.4 Анестезиологический аппарат ИВЛ, 1 шт.
 - 1.5 Узел расходомера, 1 шт.
 - 1.6 Анестезиологическая дыхательная система, 1 шт.
 - 1.7 Монитор работы станции, 1 шт.
 - 1.8 Корпус на тележке, 1 шт.
 - 1.9 Выдвижной ящик, не более 2шт.
 - 1.10 Тележка – 1 шт.


Система удаления анестезирующего газа, 1 шт.

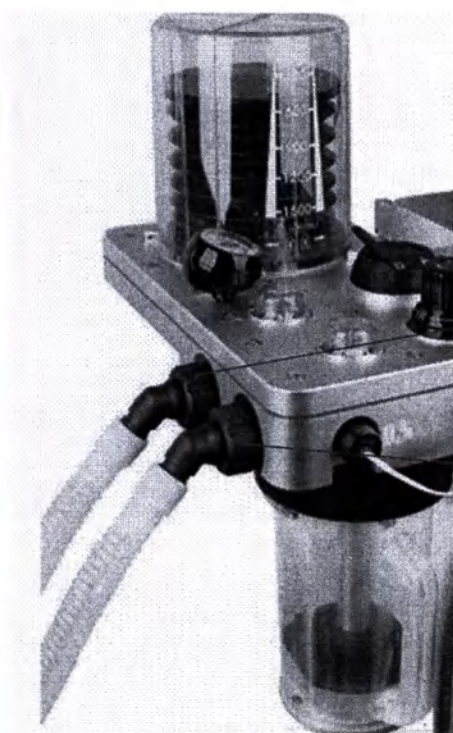

1 Впускная система подачи кислорода, 1 шт.

2 Впускная система подачи сжатого воздуха, 1 шт.

2. Многопараметрический монитор пациента – РУ №РЗН 2022/19281 (при необходимости), 1 шт.

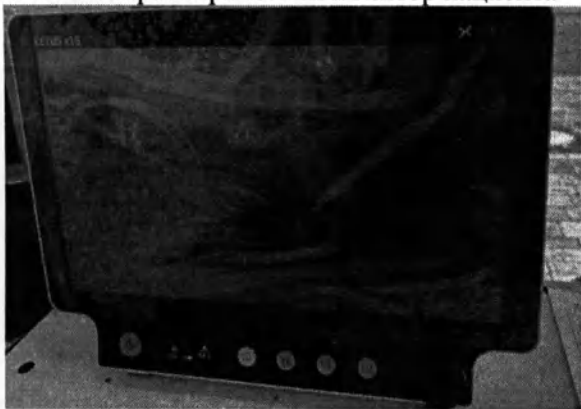


3. Устройство удаления мокроты с отрицательным давлением (при необходимости), 1 шт.




4. Компрессор медицинского воздуха (при необходимости), 1 шт.



5. Кронштейн монитора пациента (при необходимости), 1 шт.

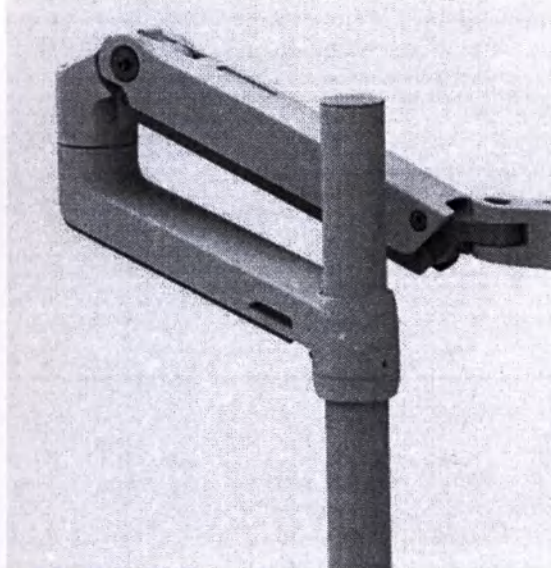


6. Поручень, 1 шт.

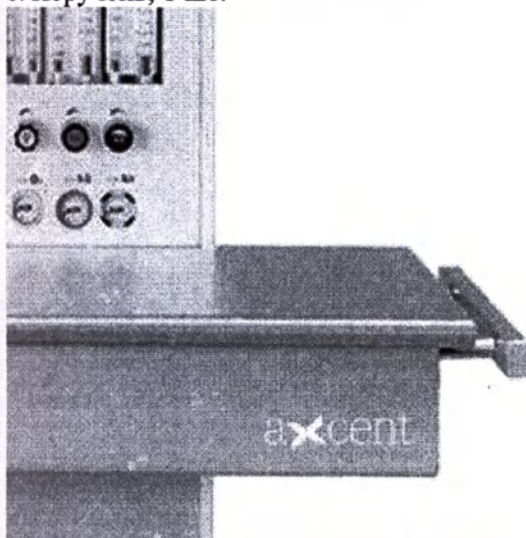


7. Аккумулятор литий-ионный, 1 шт. (при необходимости, 2 шт) – не более 2 шт.



8. Кабель электропитания, 1 шт.

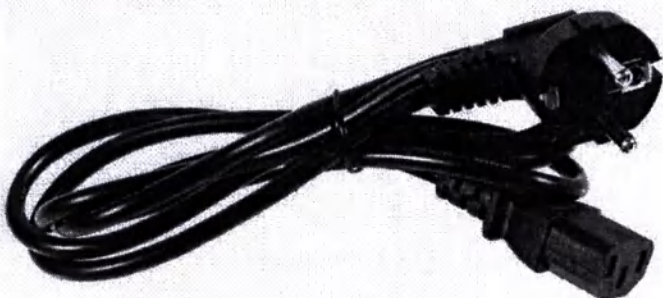


9. Кабель заземления, 1 шт.

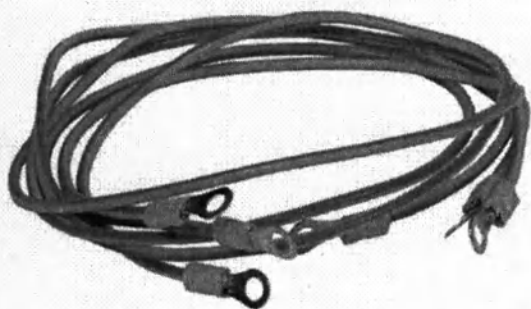


10. Руководство по эксплуатации, 1 шт.

Станция анестезиологическая APUS x2

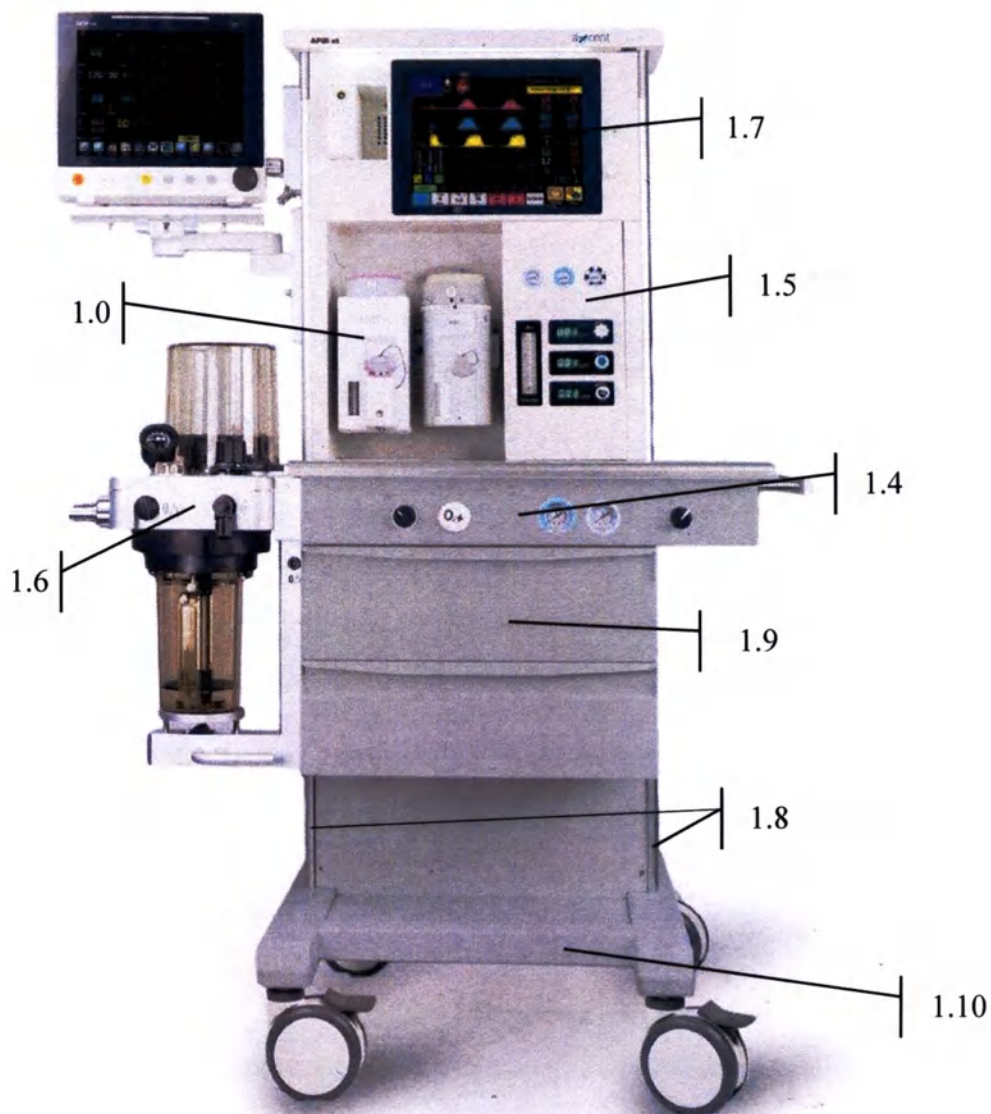

1. Основной модуль APUS x2, в составе:
 - 1.0 Впускная система подачи анестезирующих газов, 1 шт.
 - 1.1 Впускная система подачи кислорода, 1 шт.
 - 1.2 Впускная система подачи сжатого воздуха, 1 шт.
 - 1.3 Система удаления анестезирующего газа, 1 шт.
 - 1.4 Анестезиологический аппарат ИВЛ, 1 шт.
 - 1.5 Узел расходомера, 1 шт.
 - 1.6 Анестезиологическая дыхательная система, 1 шт.
 - 1.7 Монитор работы станции, 1 шт.
 - 1.8 Корпус на тележке, 1 шт.
 - 1.9 Выдвижной ящик, не более 2 шт.

Система удаления анестезирующего газа, 1 шт.

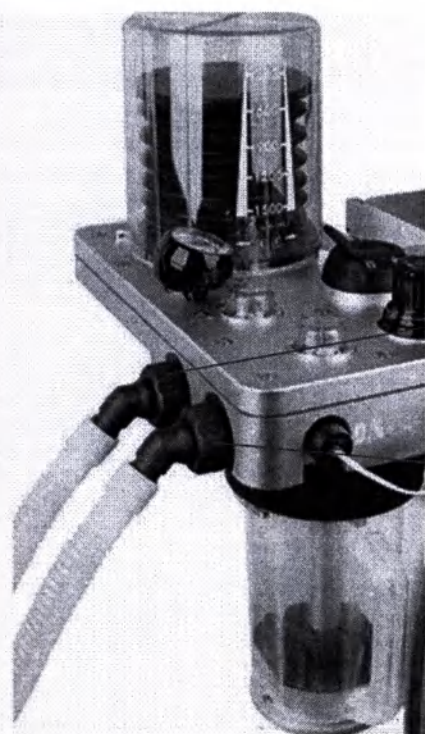

1 Впускная система подачи кислорода, 1 шт.

2 Впускная система подачи сжатого воздуха, 1 шт.

2. Многопараметрический монитор пациента – РУ №РЗН 2022/19281 (при необходимости), 1 шт.




3. Устройство удаления мокроты с отрицательным давлением (при необходимости), 1 шт.




4. Компрессор медицинского воздуха (при необходимости), 1 шт.



5. Кронштейн монитора пациента (при необходимости), 1 шт.

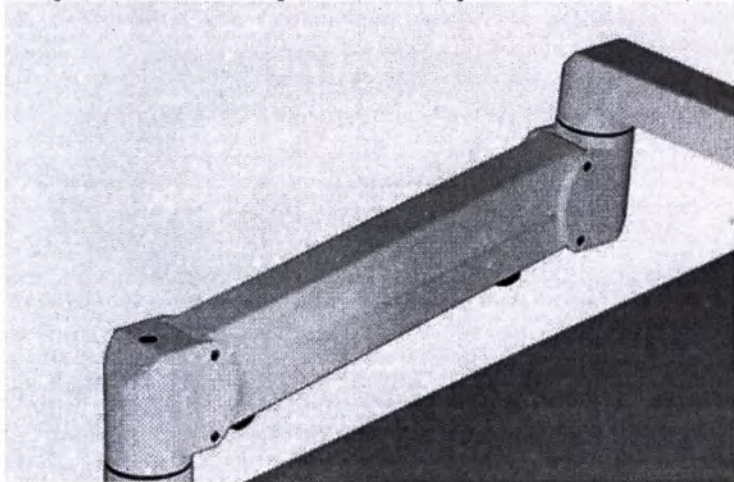


6. Поручень, 1 шт.

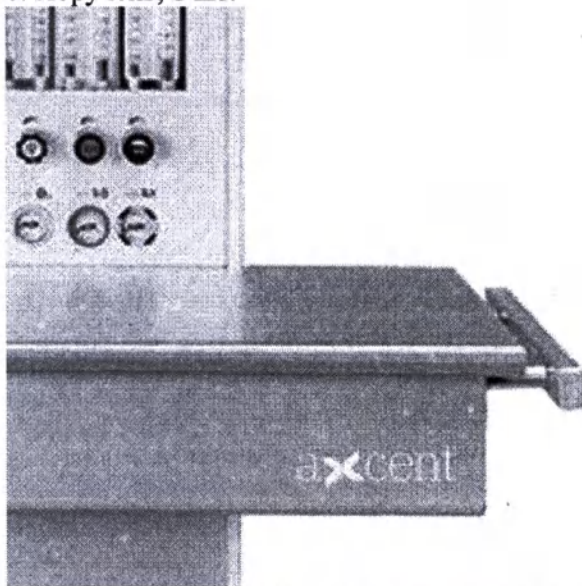


7. Аккумулятор литий-ионный, 1 шт. (при необходимости, 2 шт.) – не более 2 шт.



8. Кабель электропитания, 1 шт.

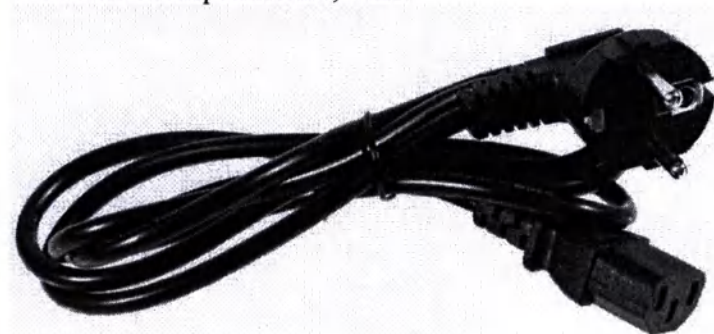


9. Кабель заземления, 1 шт.

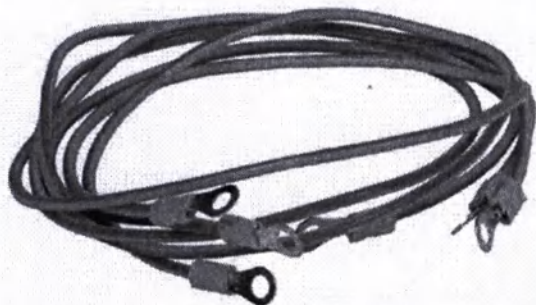

10. Руководство по эксплуатации, 1 шт.


Станция анестезиологическая APUS x3

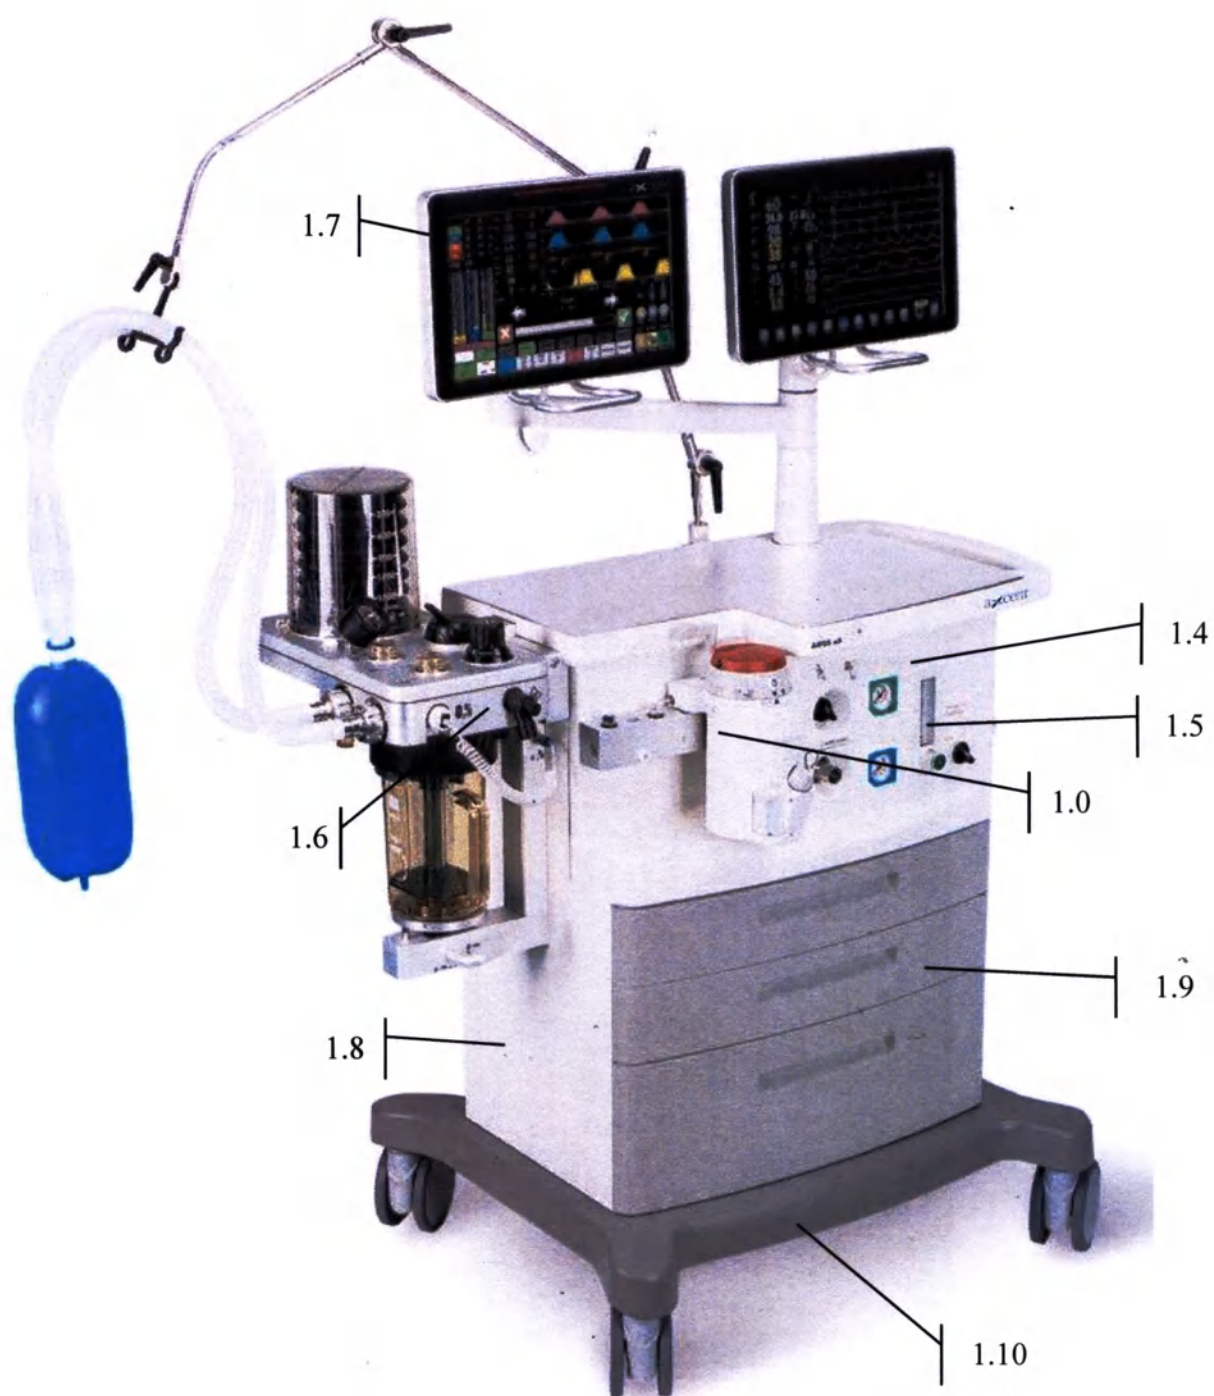

1. Основной модуль APUS x3, в составе:
 - 1.0 Впускная система подачи анестезирующих газов, 1 шт.
 - 1.1 Впускная система подачи кислорода, 1 шт.
 - 1.2 Впускная система подачи сжатого воздуха, 1 шт.
 - 1.3 Система удаления анестезирующего газа, 1 шт.
 - 1.4 Анестезиологический аппарат ИВЛ, 1шт.
 - 1.5 Узел расходомера, 1 шт.
 - 1.6 Анестезиологическая дыхательная система, 1 шт.
 - 1.7 Монитор работы станции, 1 шт.
 - 1.8 Корпус на тележке, 1 шт.
 - 1.9 Выдвижной ящик, не более 3 шт.
 - 1.10 Тележка – 1 шт.
2. Многопараметрический монитор пациента «aXcent medical» моделей: PAVO, CETUS x12, CETUS x15, CETUS xL с принадлежностями – РУ №РЗН 2022/19281 (при необходимости), 1 шт.
3. Устройство удаления мокроты с отрицательным давлением (при необходимости), 1 шт.
4. Компрессор медицинского воздуха (при необходимости), 1 шт.
5. Кронштейн монитора пациента (при необходимости), 1 шт.
6. Поручень, 1 шт.
7. Аккумулятор литий-ионный, 1 шт. (при необходимости, 2 шт.) – не более 2 шт.
8. Кабель электропитания, 1 шт.
9. Кабель заземления, 1шт.

Система удаления анестезирующего газа, 1 шт.




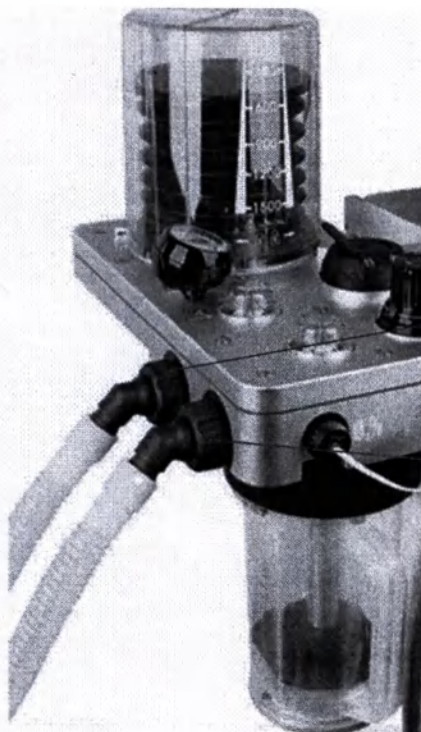

1 Впускная система подачи кислорода, 1 шт.

2 Впускная система подачи сжатого воздуха, 1 шт.

2. Многопараметрический монитор пациента – РУ №РЗН 2022/19281 (при необходимости), 1 шт.

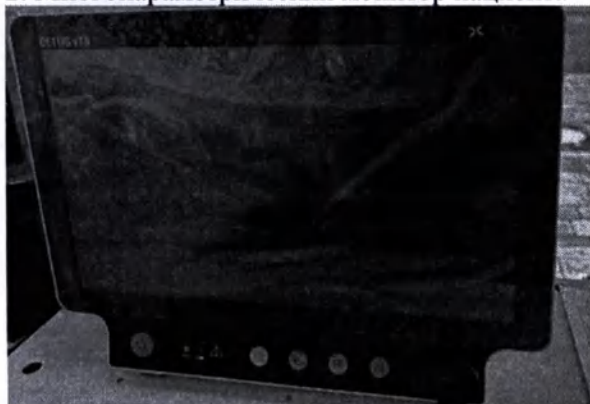


3. Устройство удаления мокроты с отрицательным давлением (при необходимости), 1 шт.




4. Компрессор медицинского воздуха (при необходимости), 1 шт.



5. Кронштейн монитора пациента (при необходимости), 1 шт.

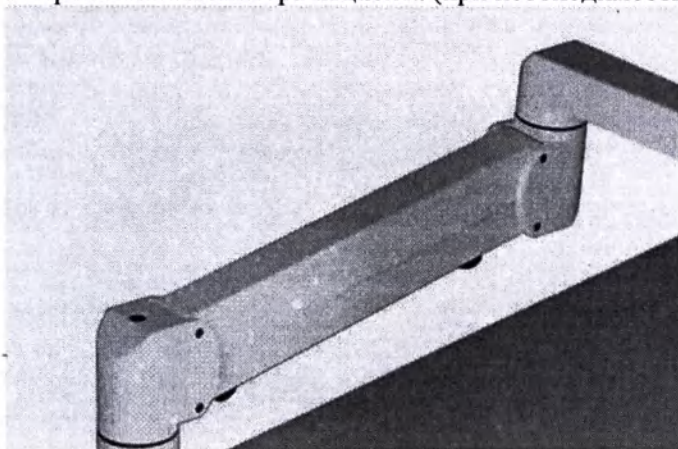


6. Поручень, 1 шт.

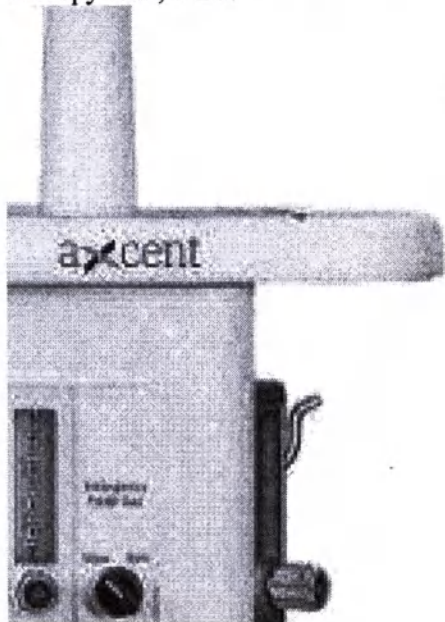


7. Аккумулятор литий-ионный, 1 шт. (при необходимости, 2 шт.) – не более 2 шт.



8. Кабель электропитания, 1 шт.

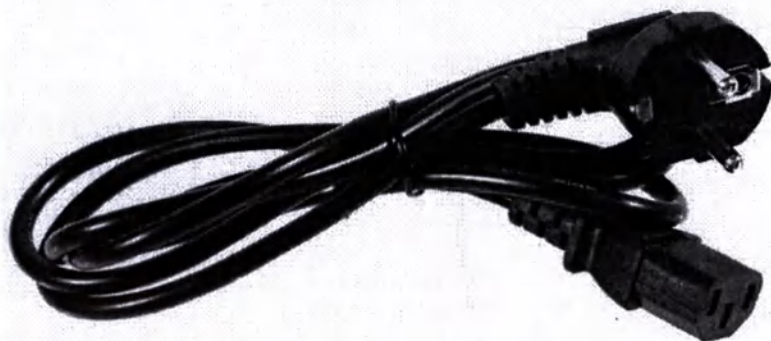

9. Кабель заземления, 1 шт.

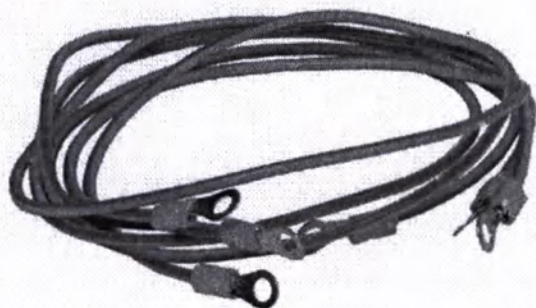

Принадлежности:

1. Контур дыхательный взрослый многоразовый, варианты исполнения: G-328001; G-328000, VADI Medical Technology Co., Ltd., (Китай), РУ ФСЗ 2010/08292



2. Контур дыхательный взрослый одноразовый, варианты исполнения: G-316001; G-316001-1; G-316001-2; G-316001-3; G-316002-134, VADI Medical Technology Co., Ltd., (Китай), РУ ФСЗ 2010/08292



3. Контур дыхательный детский многоразовый, варианты исполнения: G-333001; G-330000, VADI Medical Technology Co., Ltd., (Китай), РУ ФСЗ 2010/08292



4. Контур дыхательный детский одноразовый: D-330000, производства VADI Medical Technology Co., Ltd., (Китай), РУ ФСЗ 2010/08292



5. Контур дыхательный для новорожденных многоразовый, варианты исполнения: G-329001-2; G-329000, производства VADI Medical Technology Co., Ltd., (Китай), РУ ФСЗ 2010/08292



6. Контур дыхательный для новорожденных одноразовый: D-329000, производства VADI Medical Technology Co., Ltd., (Китай), РУ ФСЗ 2010/08292



7. Дыхательный мешок, без латекса, 1 л, одноразовый



8. Дыхательный мешок, без латекса, 2 л, одноразовый



9. Дыхательный мешок, без латекса, 3 л, одноразовый



10. Дыхательный мешок, силикон, 1 л, многоразовый



11. Дыхательный мешок, силикон, 2 л, многоразовый



12. Испаритель для галотана



13. Испаритель для энфлюрана



14. Испаритель для изофлурана



15. Испаритель для севофлурана




16. Датчик потока вдоха



17. Датчик потока выдоха



18. Датчик кислорода

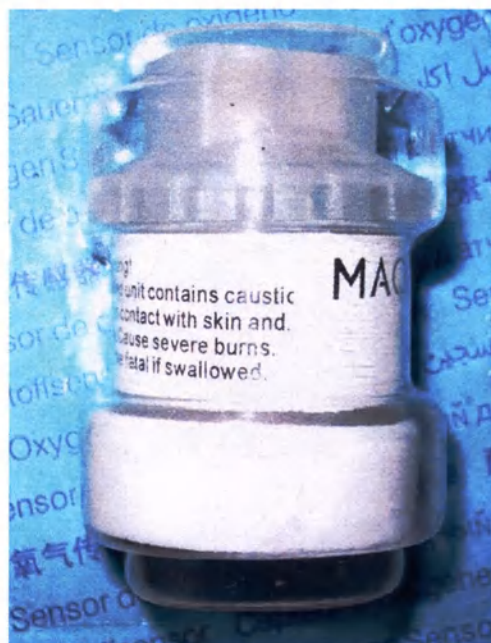

19. Модуль CO2 бокового потока



20. Модуль CO2 основного потока



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 25
листов

Генеральный директор _____ /
СВИЩЕВА Е.Н. 