

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Инфомед-Нейро»

/В.А. Шаповал /

«18» июля 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Аппарат ударно-волновой терапии (УВТ), моделей SALUS-RSWT-DUET и
SALUS-FSWT**

Производства: REMED Co., Ltd., Республика Корея



Рисунок 1. Транспортная упаковка модели SALUS-FSWT



Рисунок 2. Транспортная упаковка модели SALUS-RSWT-DUET



Рисунок 3. Гелевые подушки

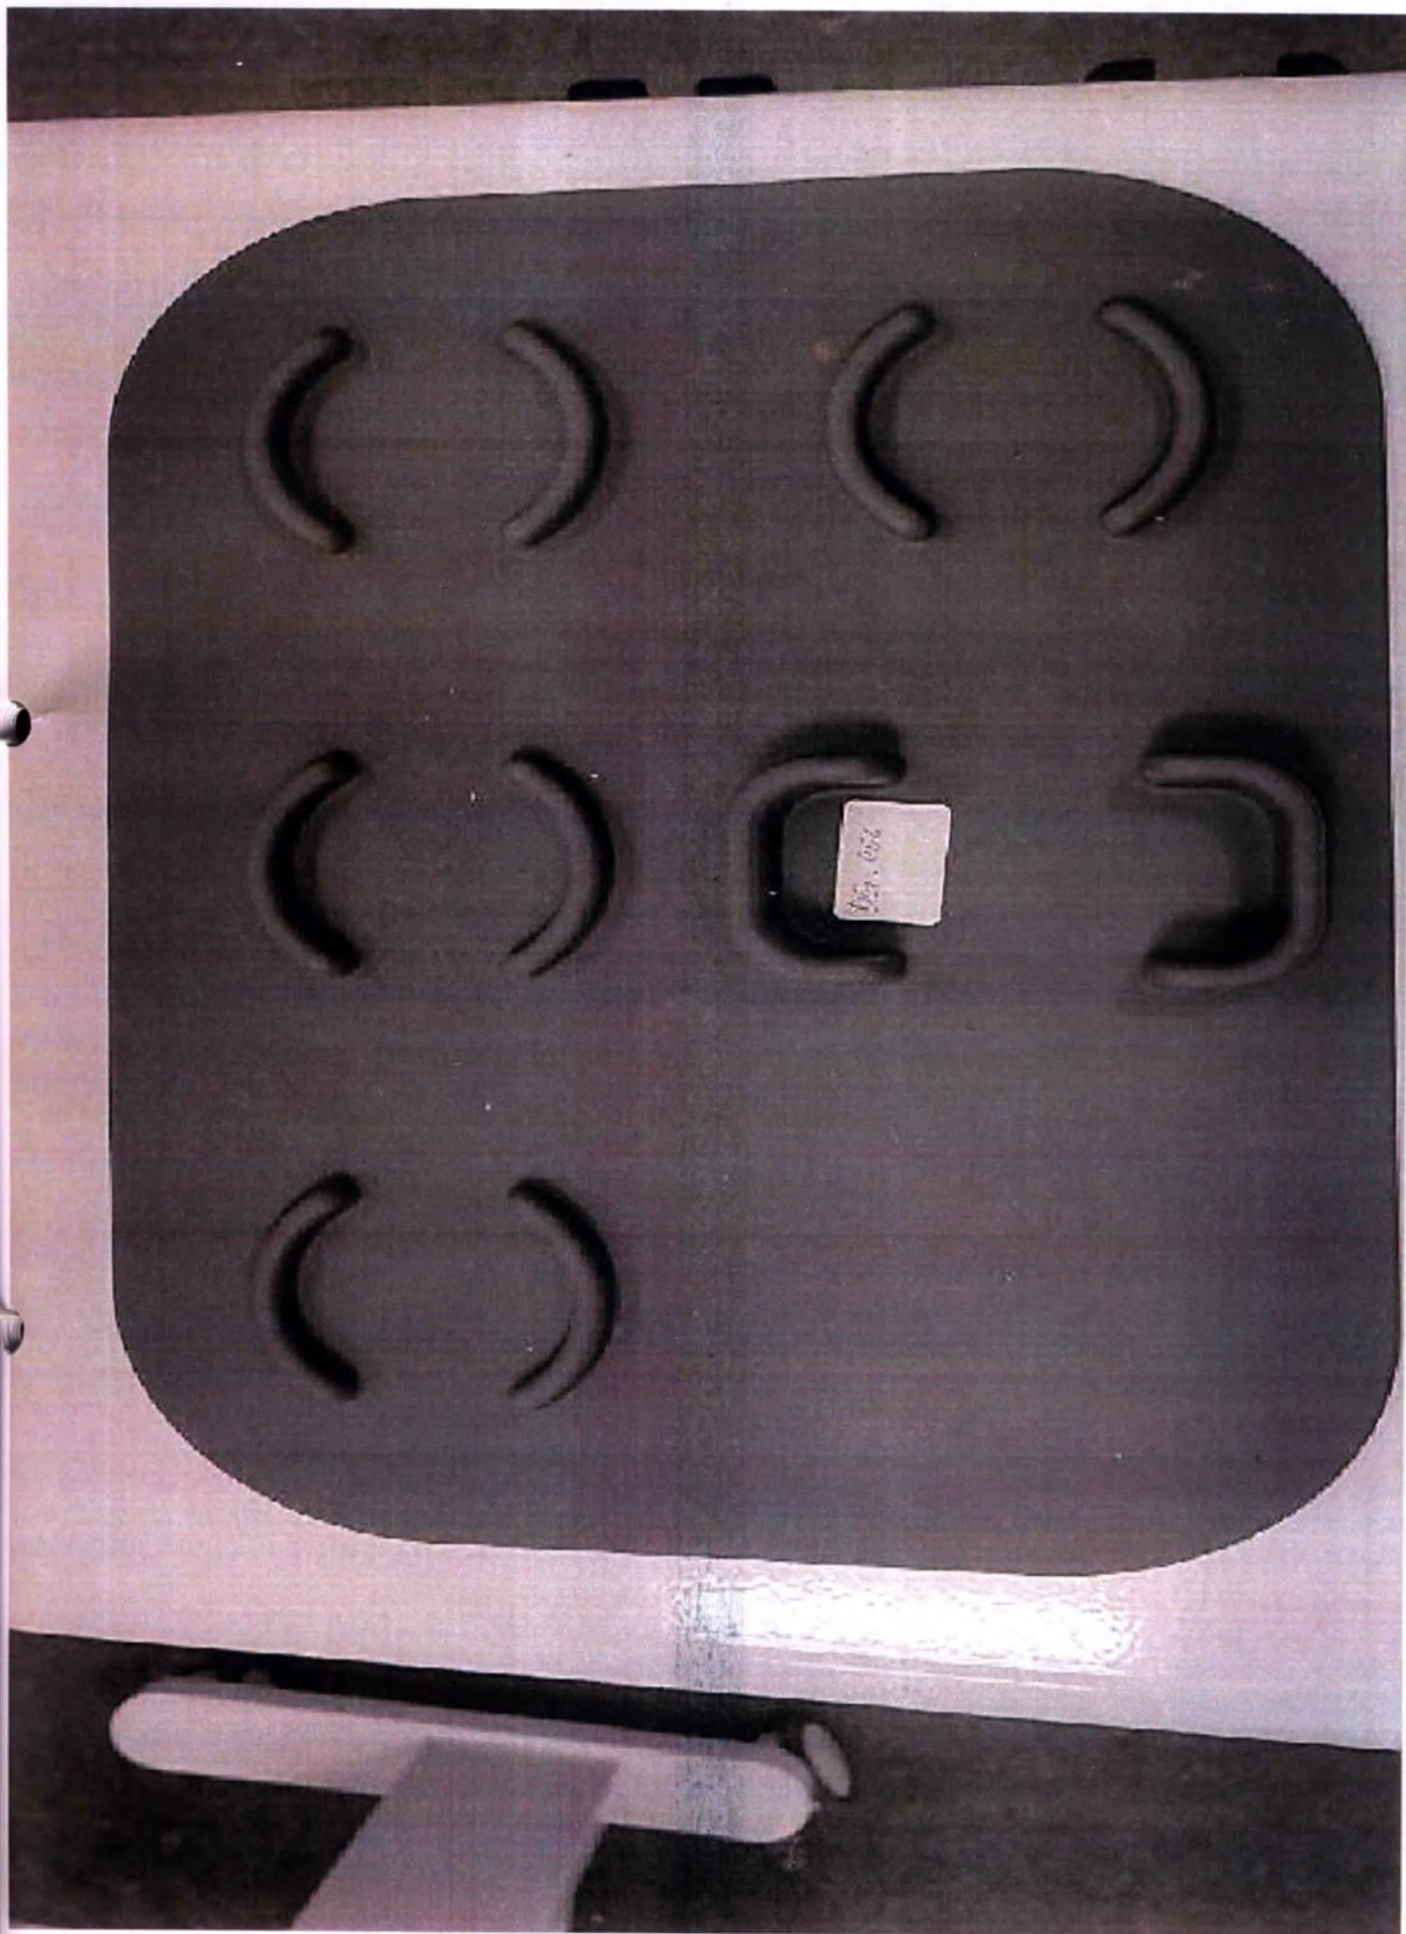


Рисунок 4. Держатель гелевых подушек



Рисунок 5. Тележка



Рисунок 6. Аппарат УВТ, модель SALUS-FSWT



Рисунок 7. Держатель гелевых подушек

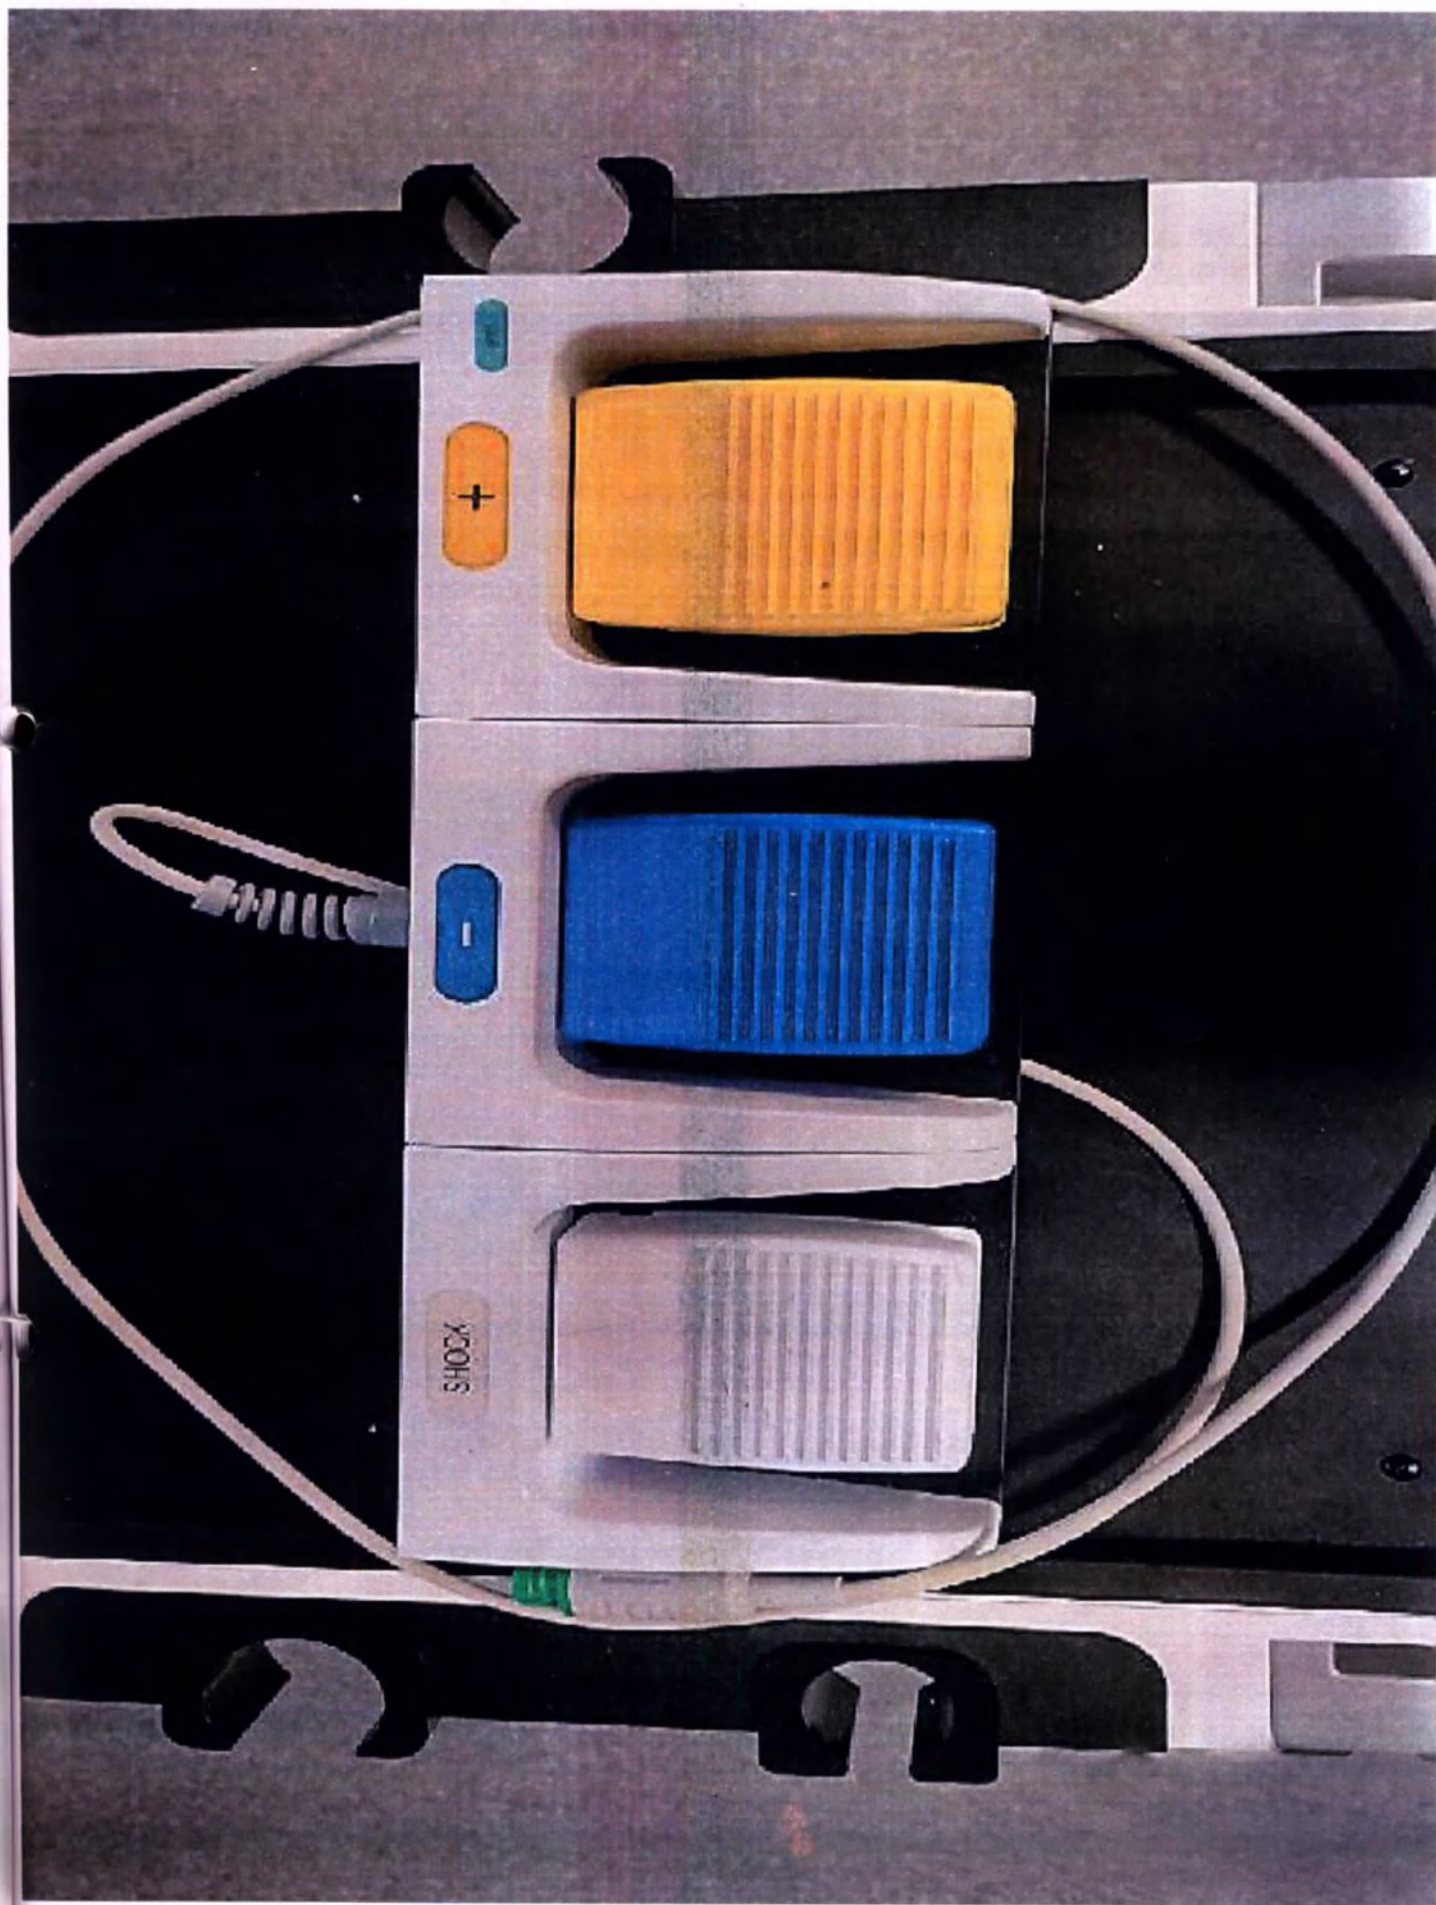


Рисунок 8. Ножной переключатель



Рисунок 9. Аппарат УВТ, модель SALUS-RSWT-DUET

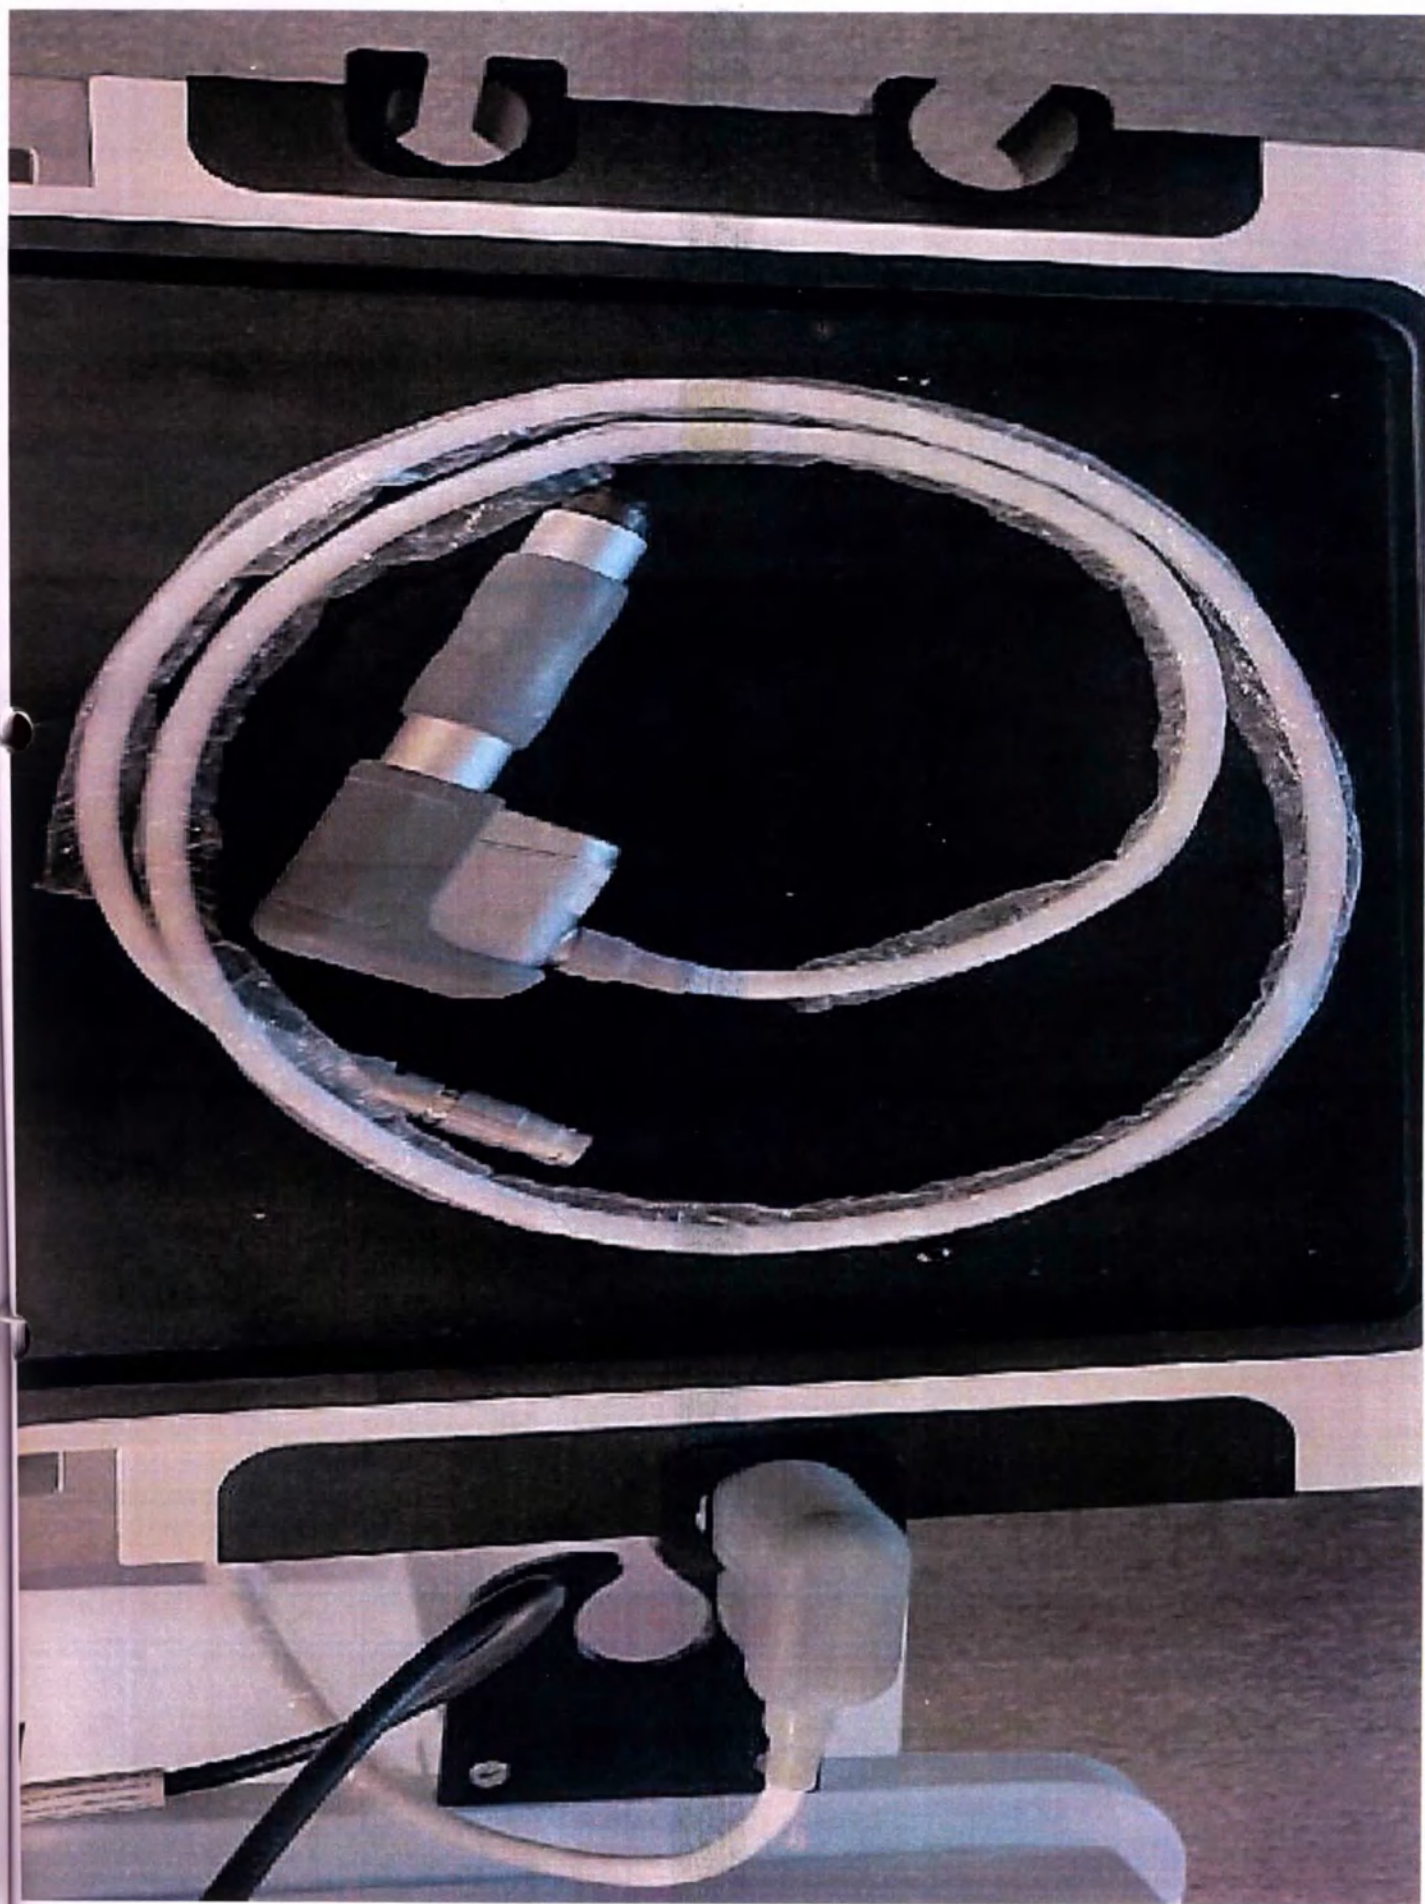


Рисунок 10. Рукоятка стимулирующая для УВТ

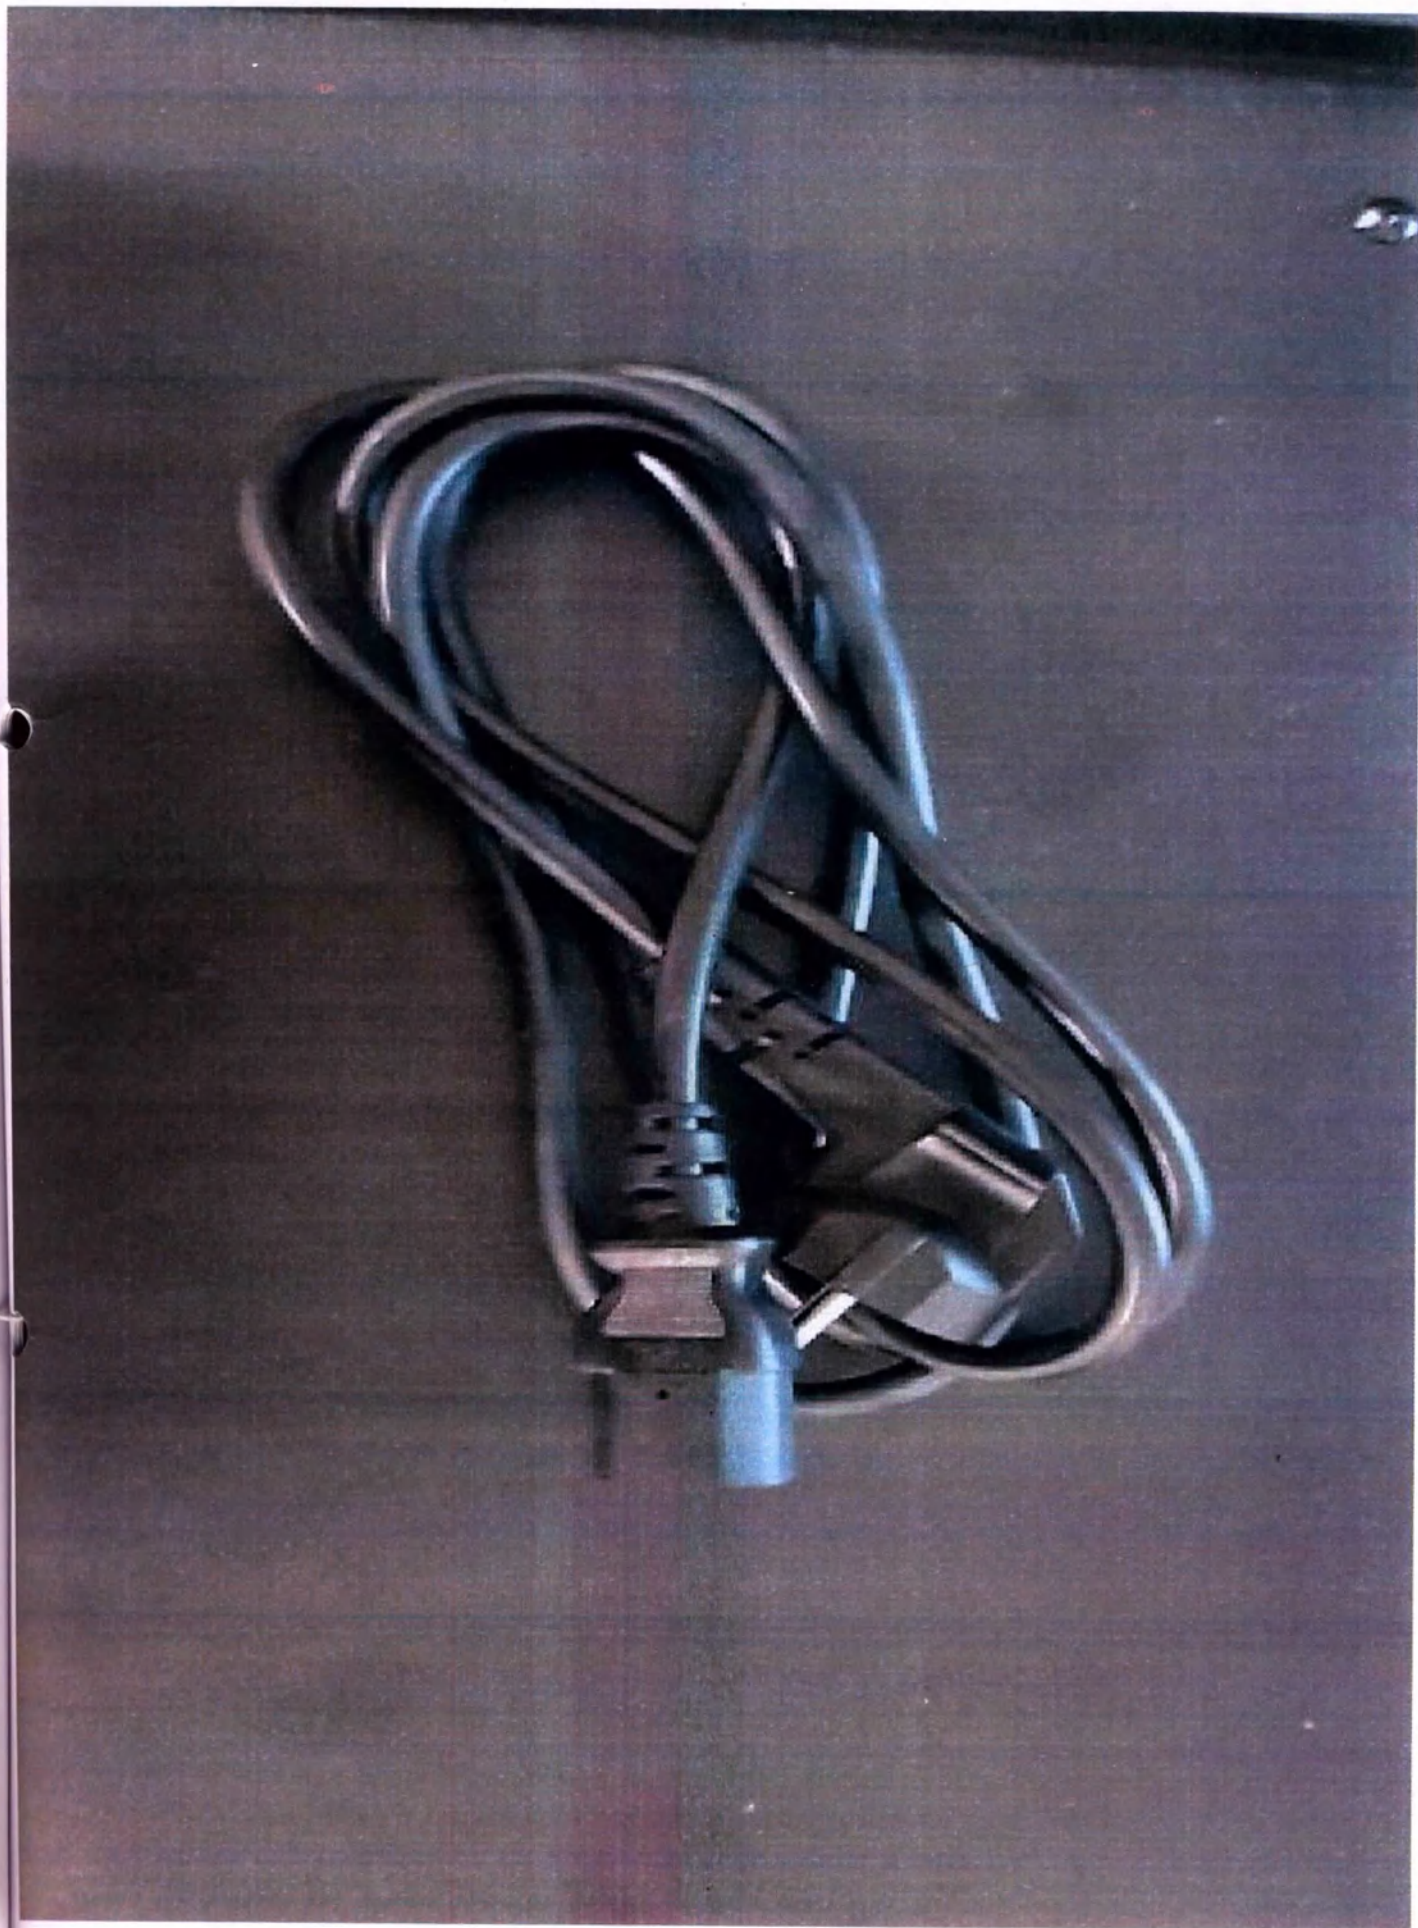


Рисунок 11. Шнур питания

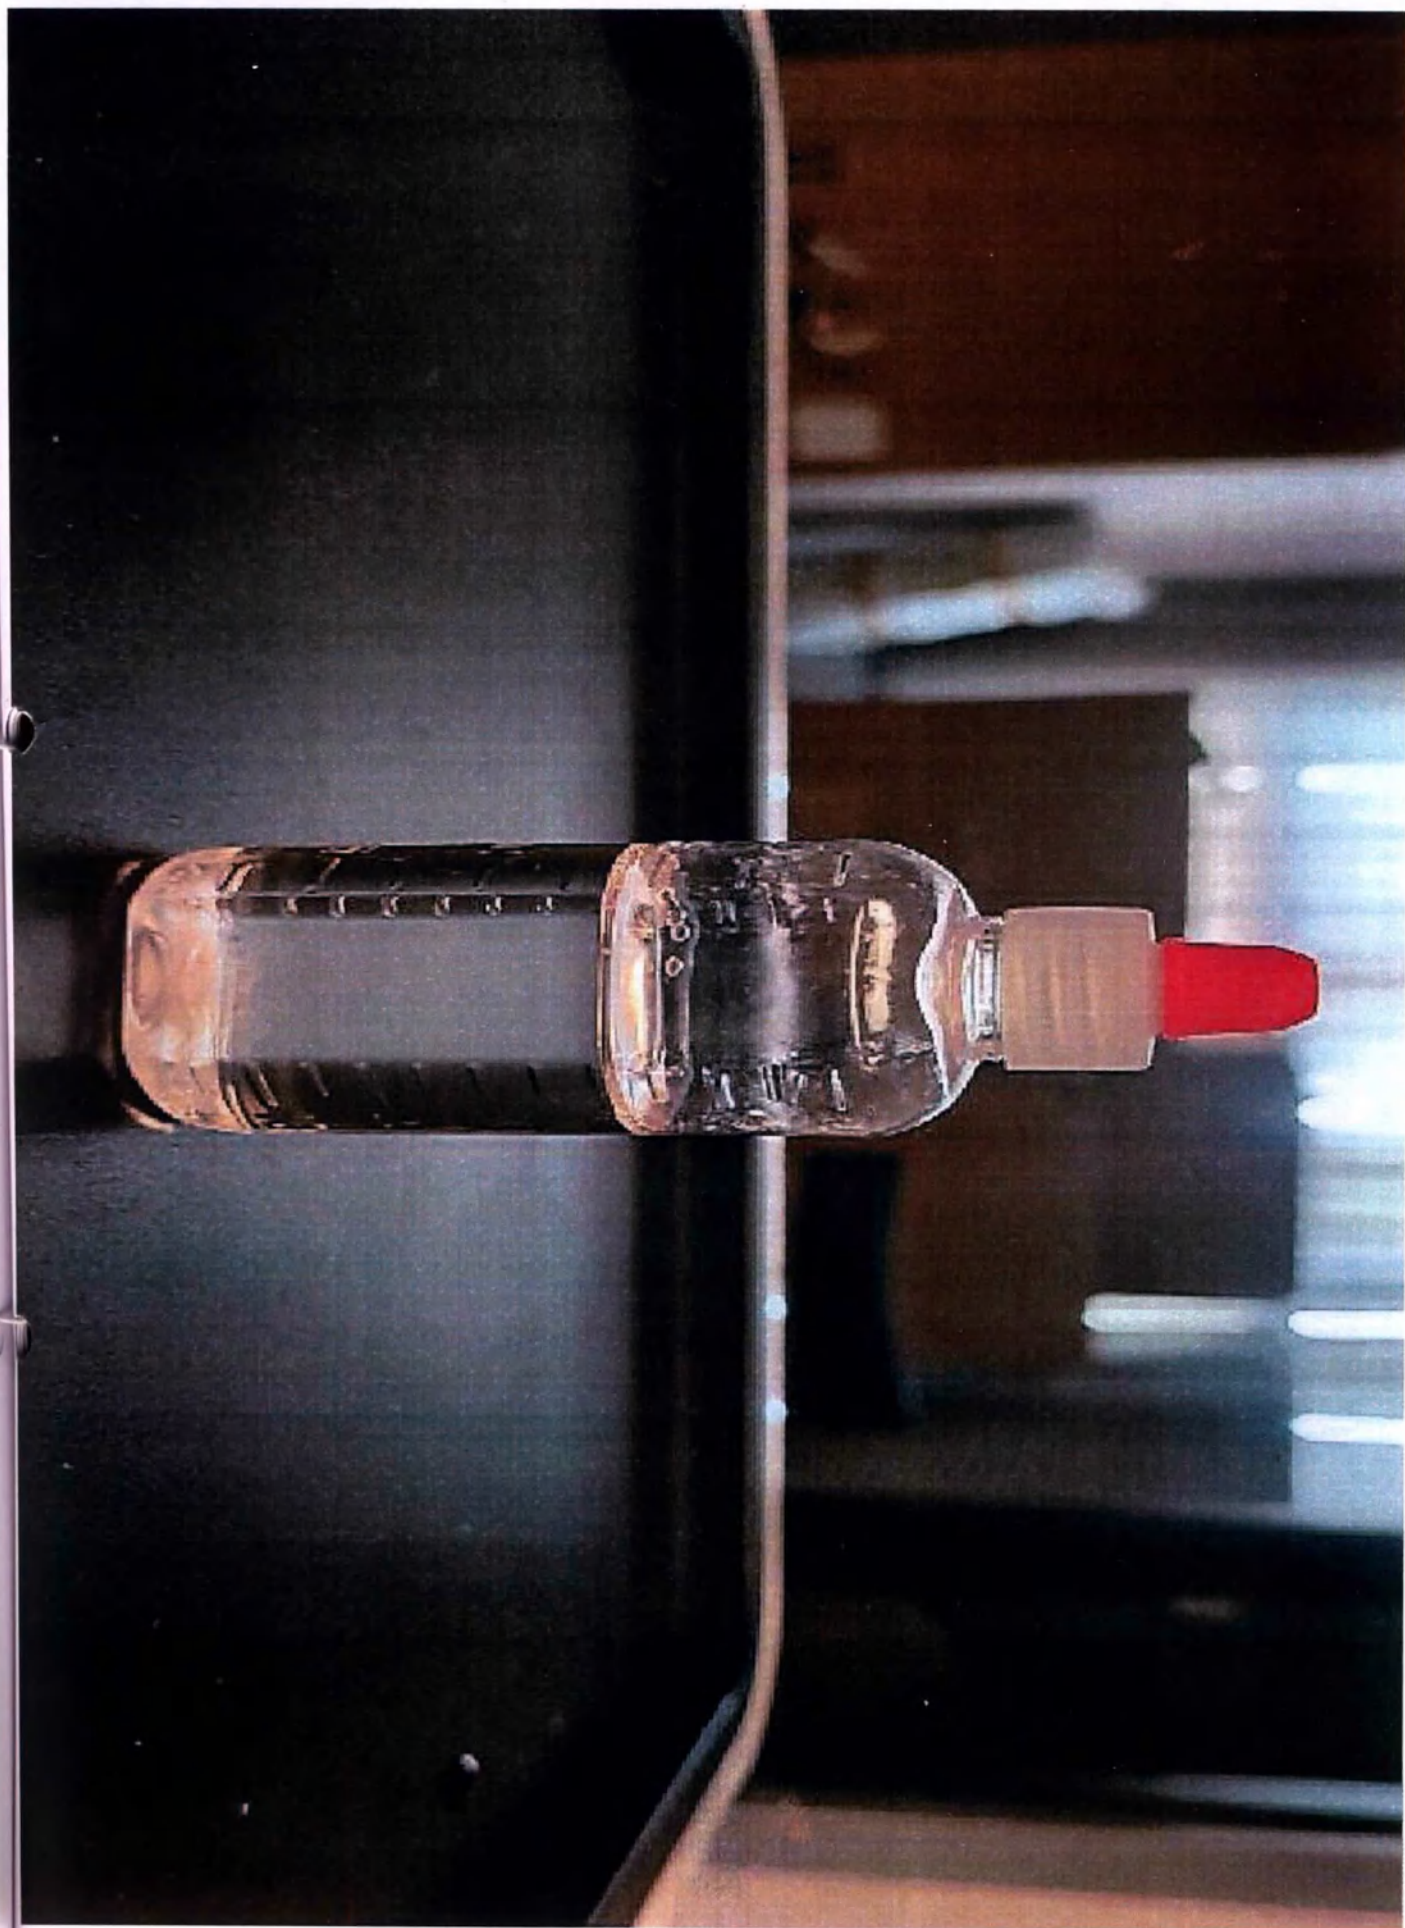


Рисунок 12. Трансмиссионный гель CARE SONIC, 250 мл

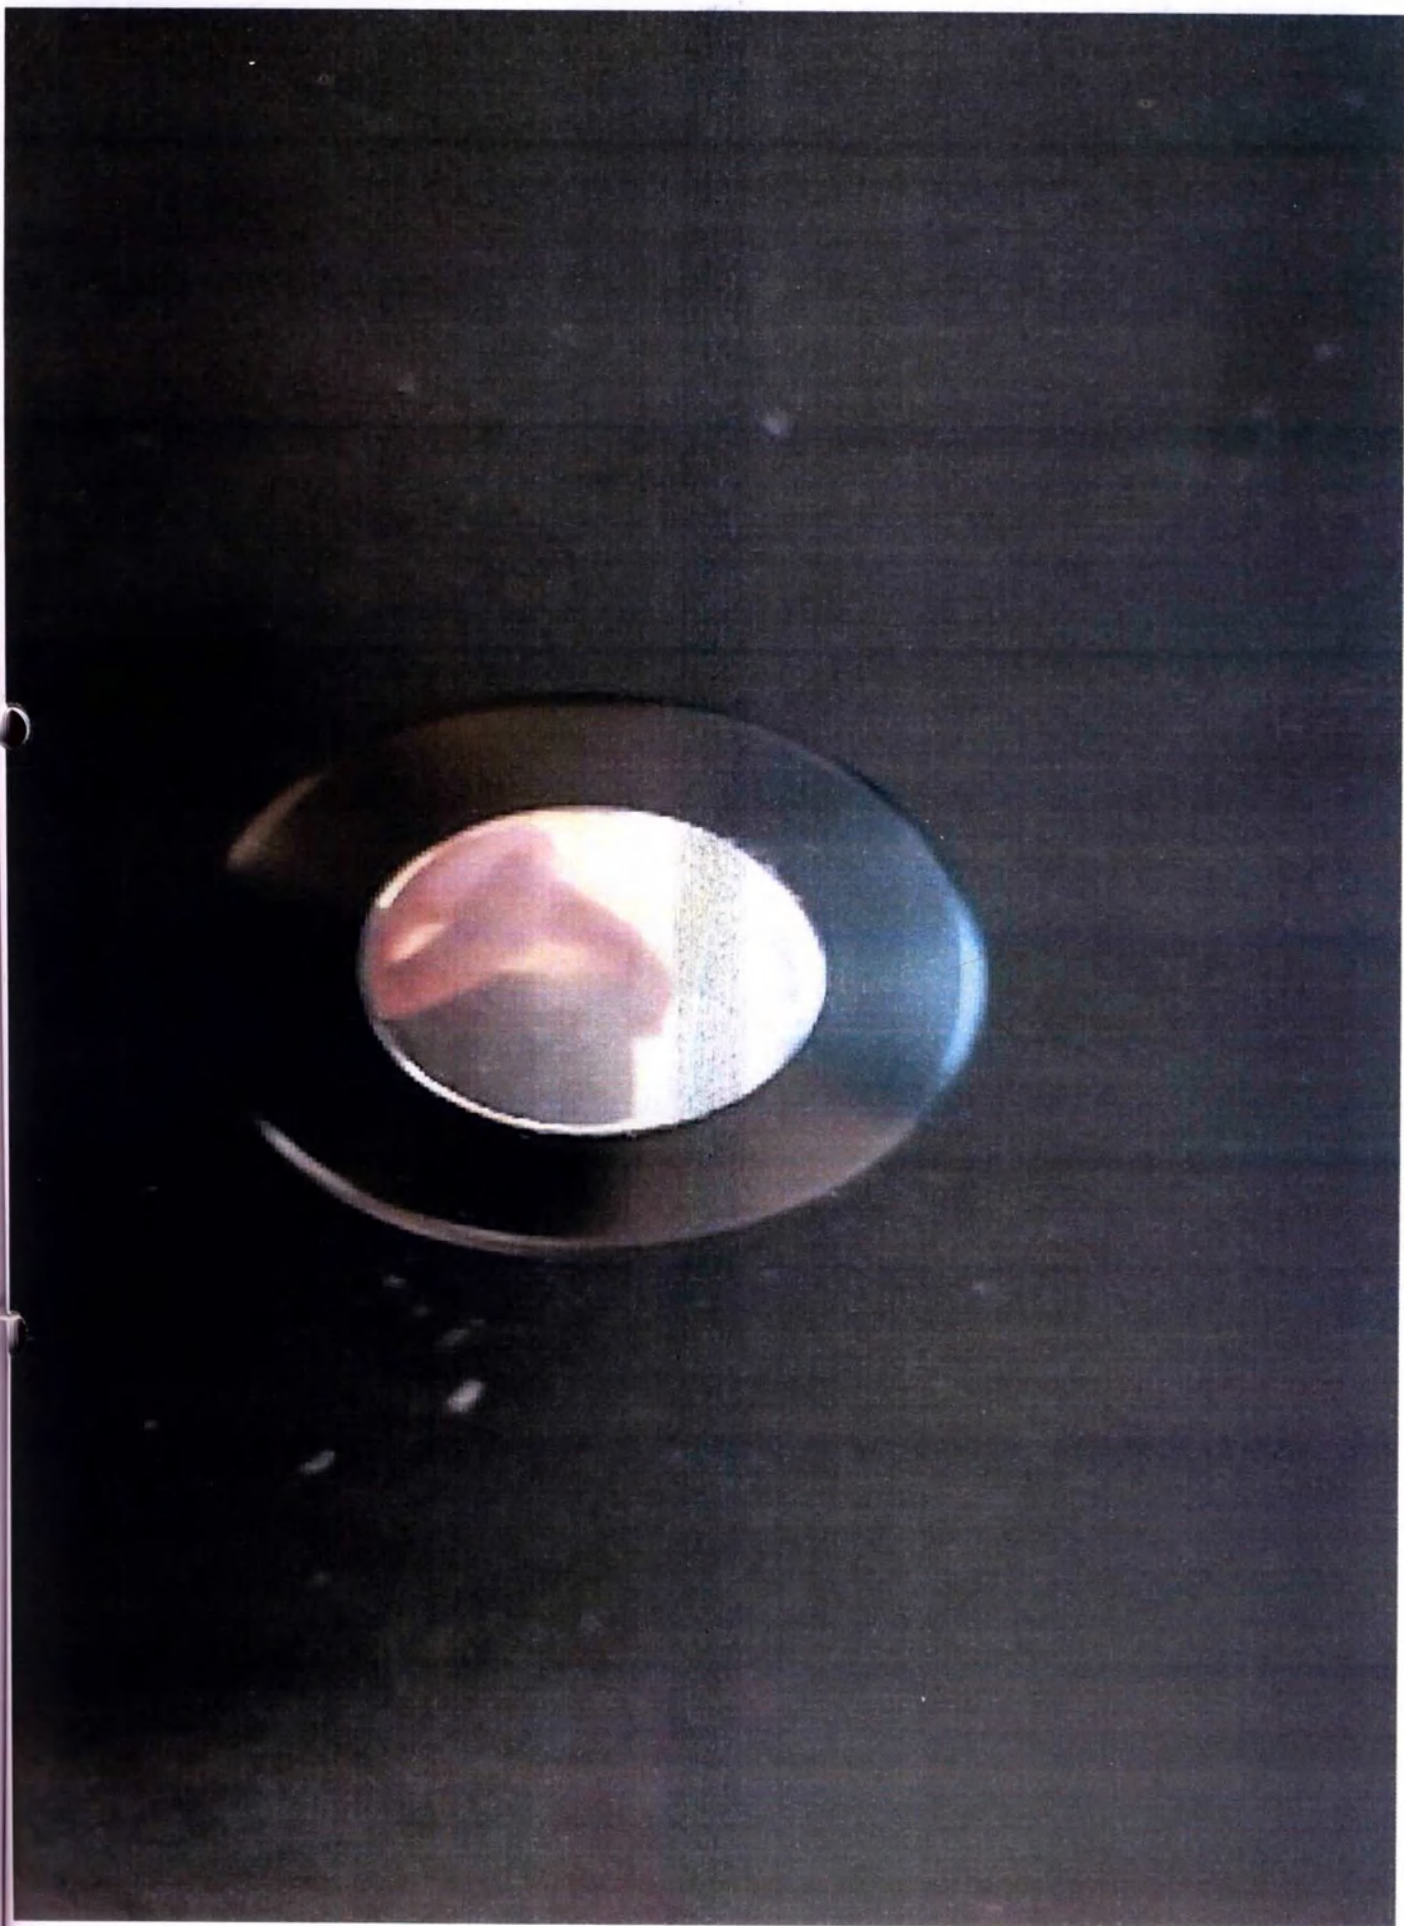


Рисунок 13. Аппликатор 20 мм



Рисунок 14. Аппликатор 15 мм

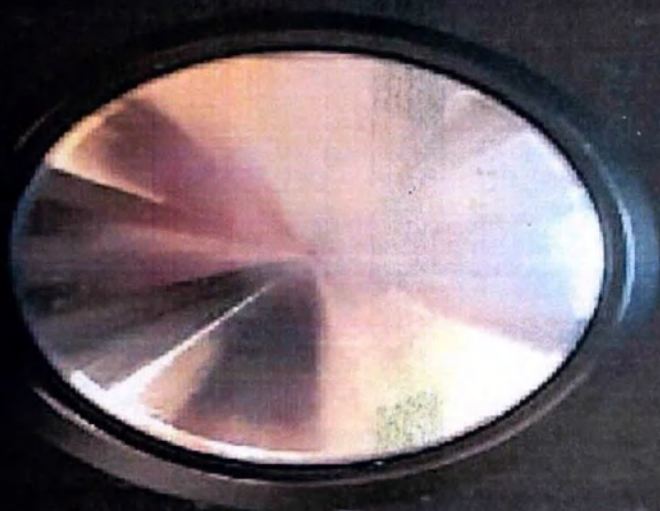


Рисунок 15. Аппликатор 35 мм



Рисунок 16. Аппликатор 6 мм

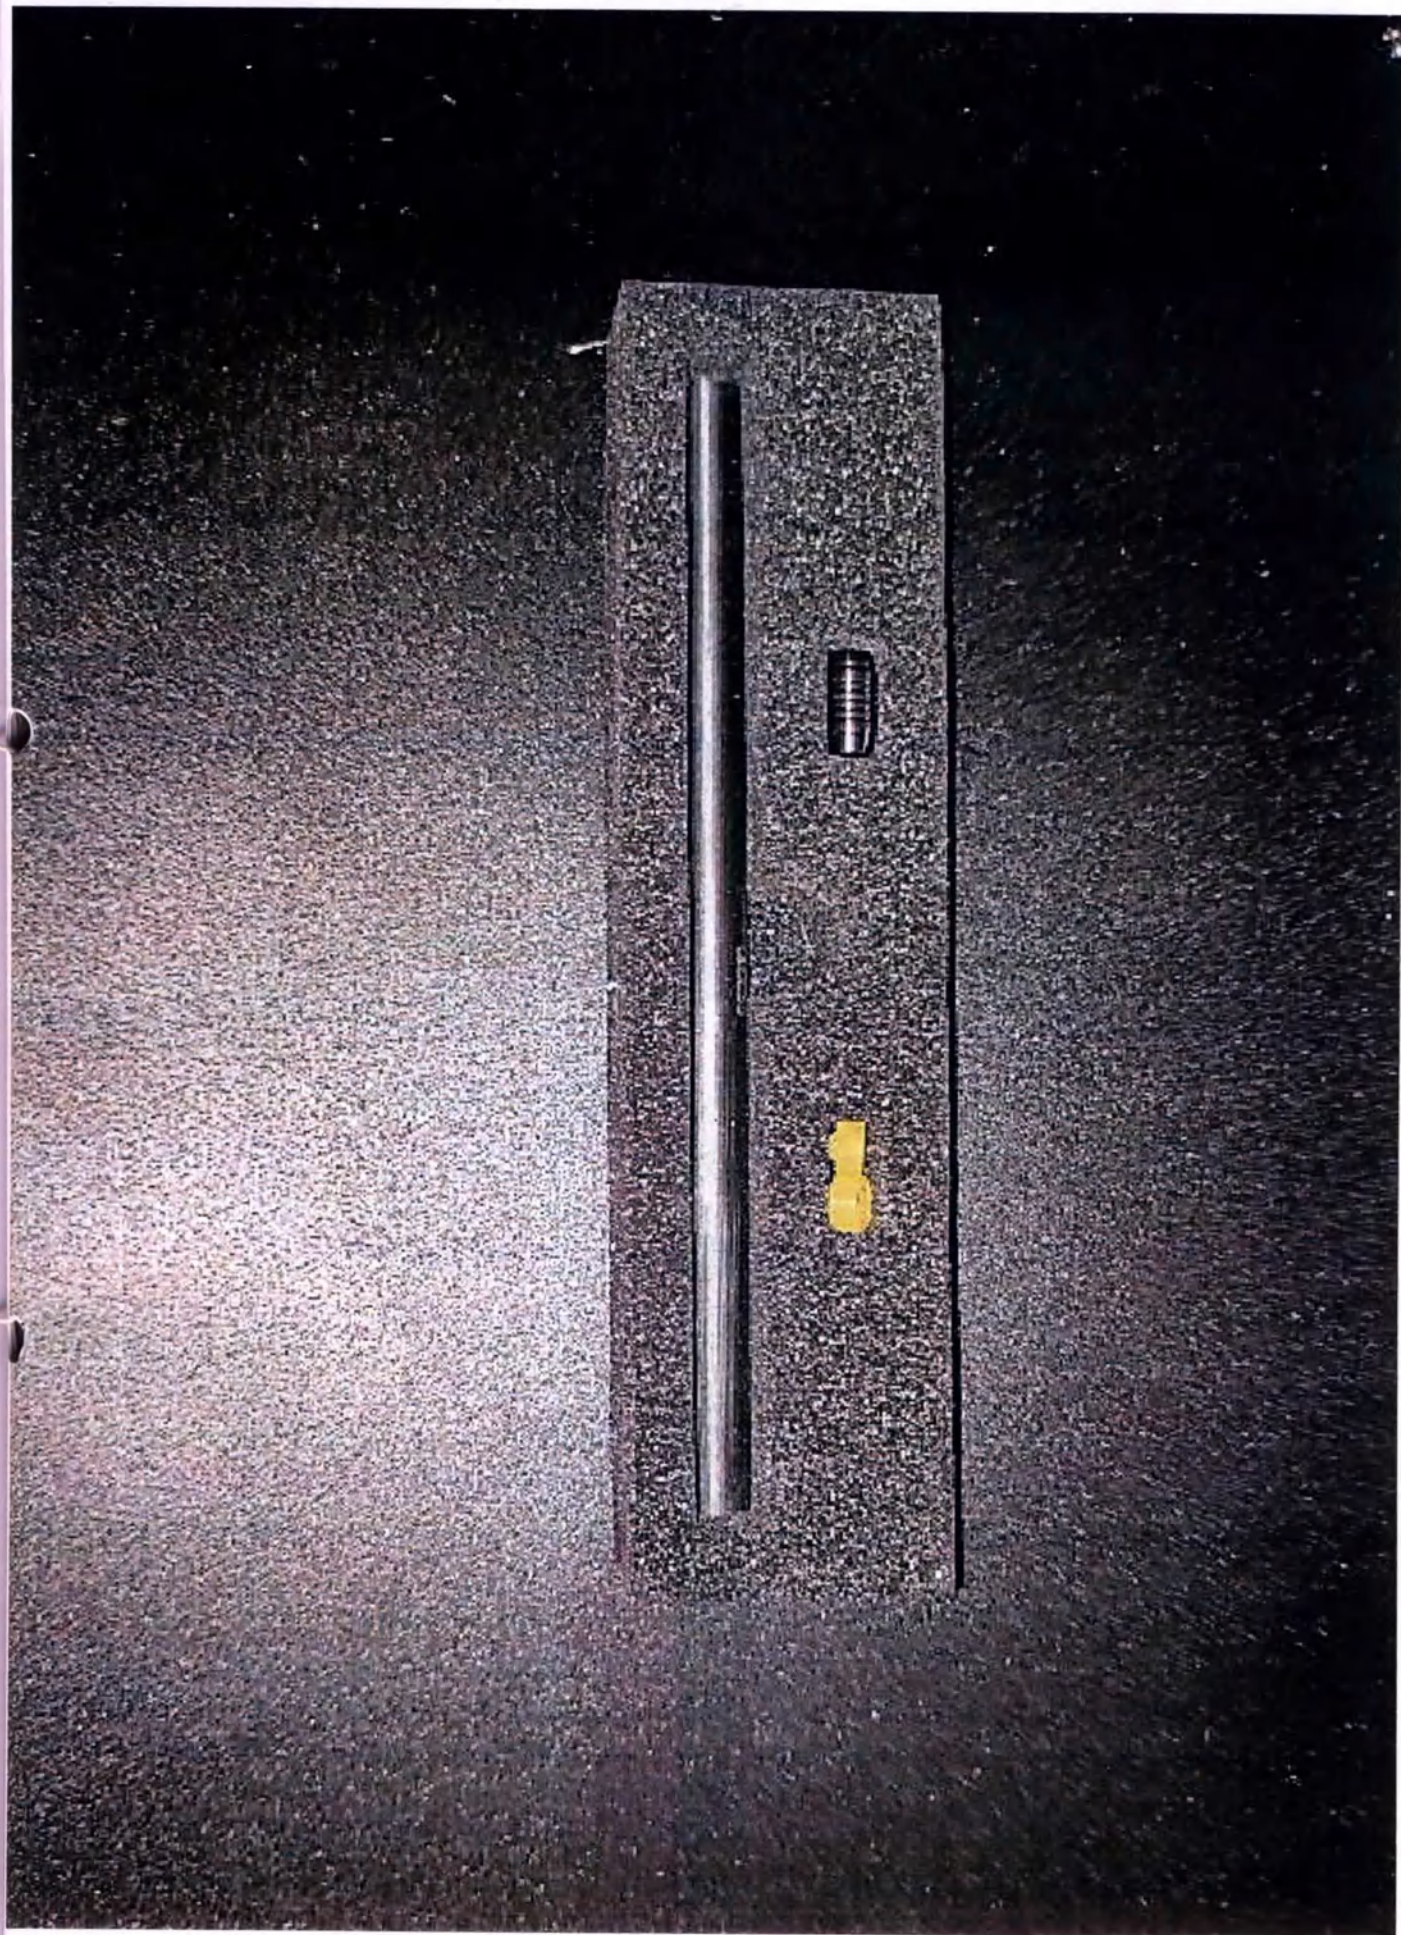


Рисунок 17. Пьезо-наконечник

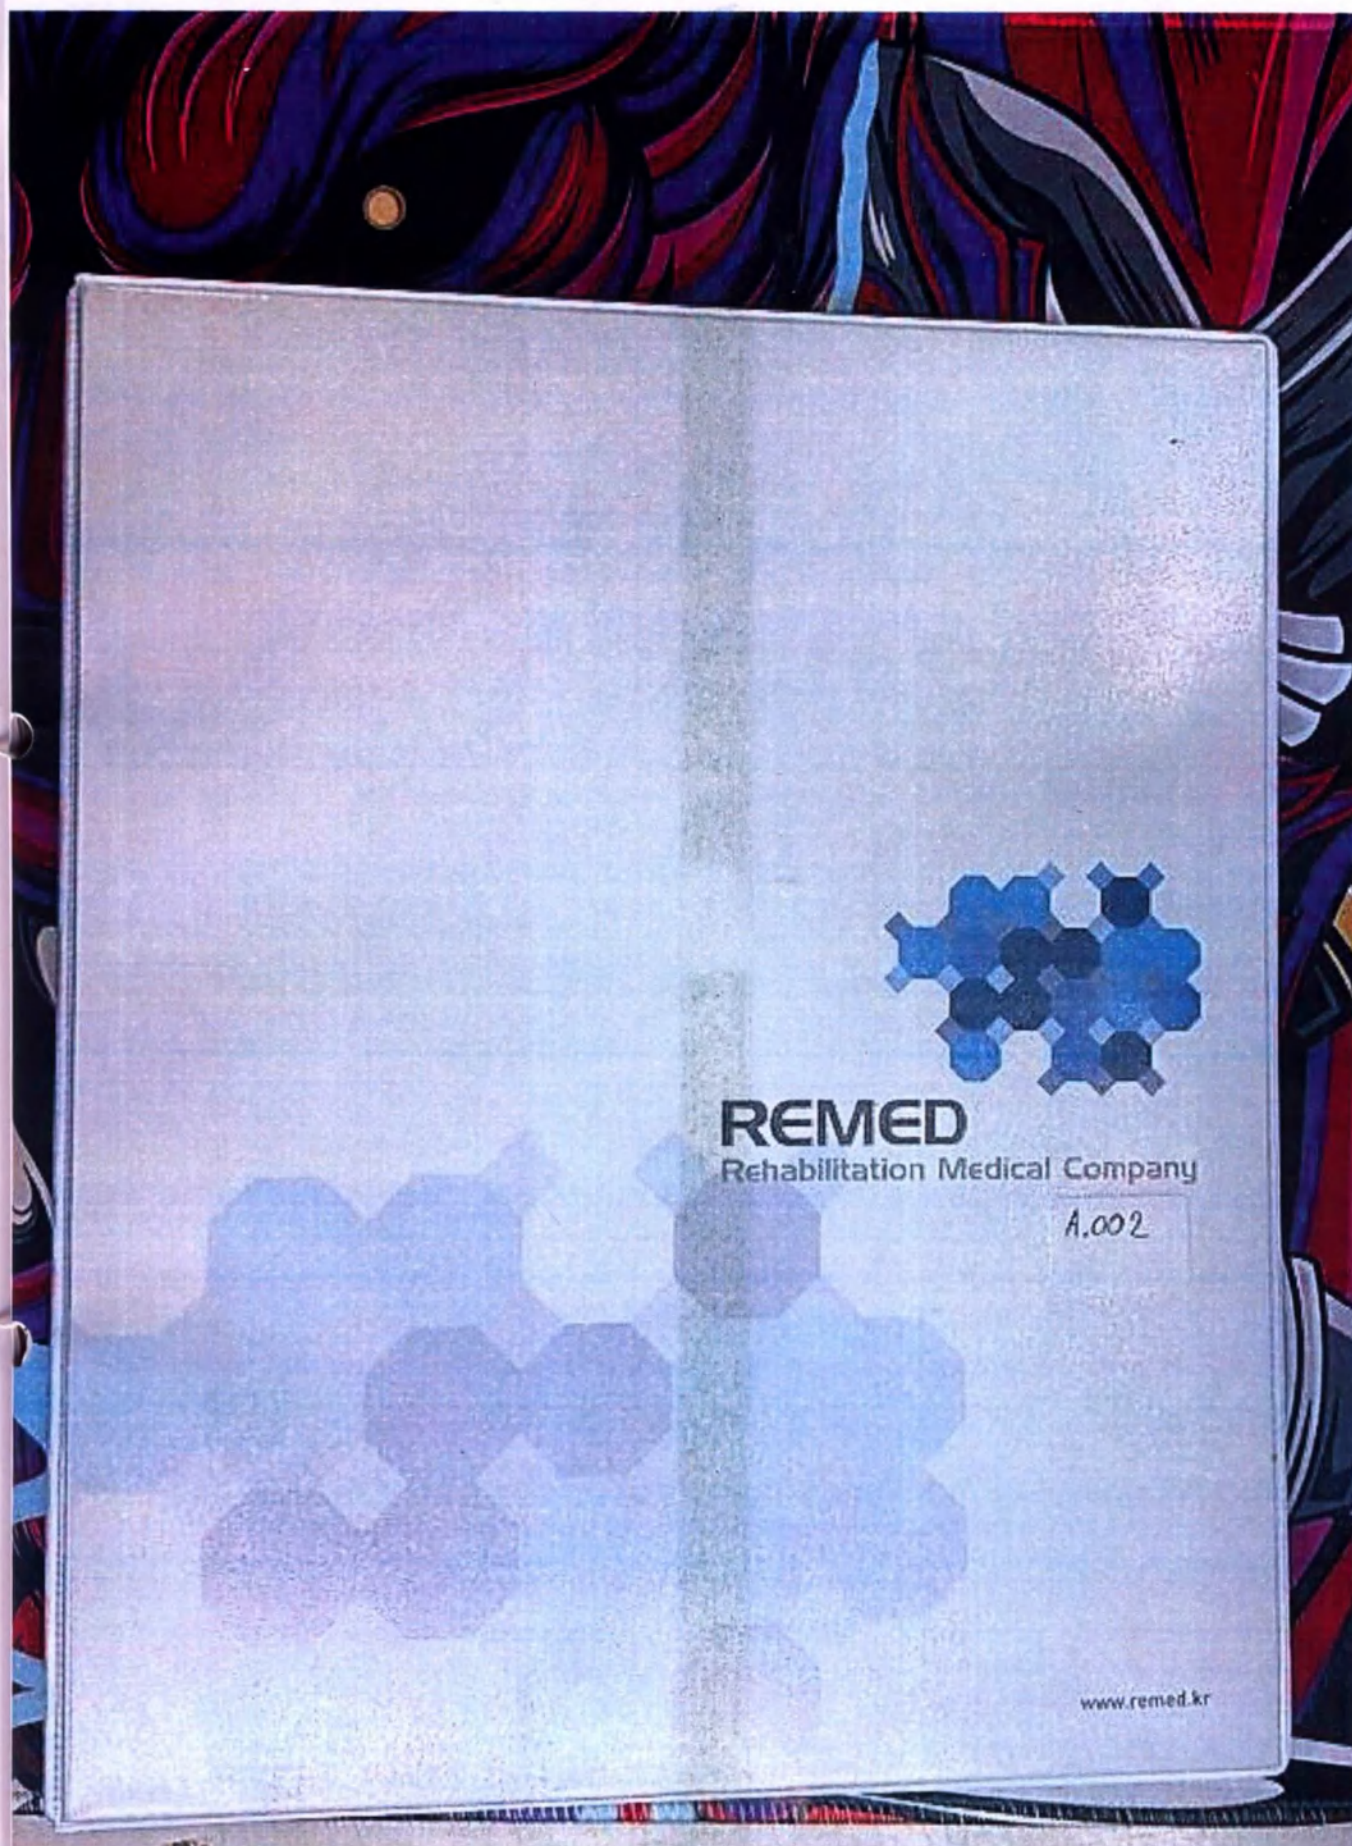


Рисунок 18. Внешний вид руководства по эксплуатации на модель SALUS-FSWT



REMED
Rehabilitation Medical Center

SALUS-FSWT
Instructions For Use
Extracorporeal Shock Wave Therapy



REMED Co., Ltd.

CE₂₂₆₅

Рисунок 19. Титульный лист руководства по эксплуатации на модель SALUS-FSWT

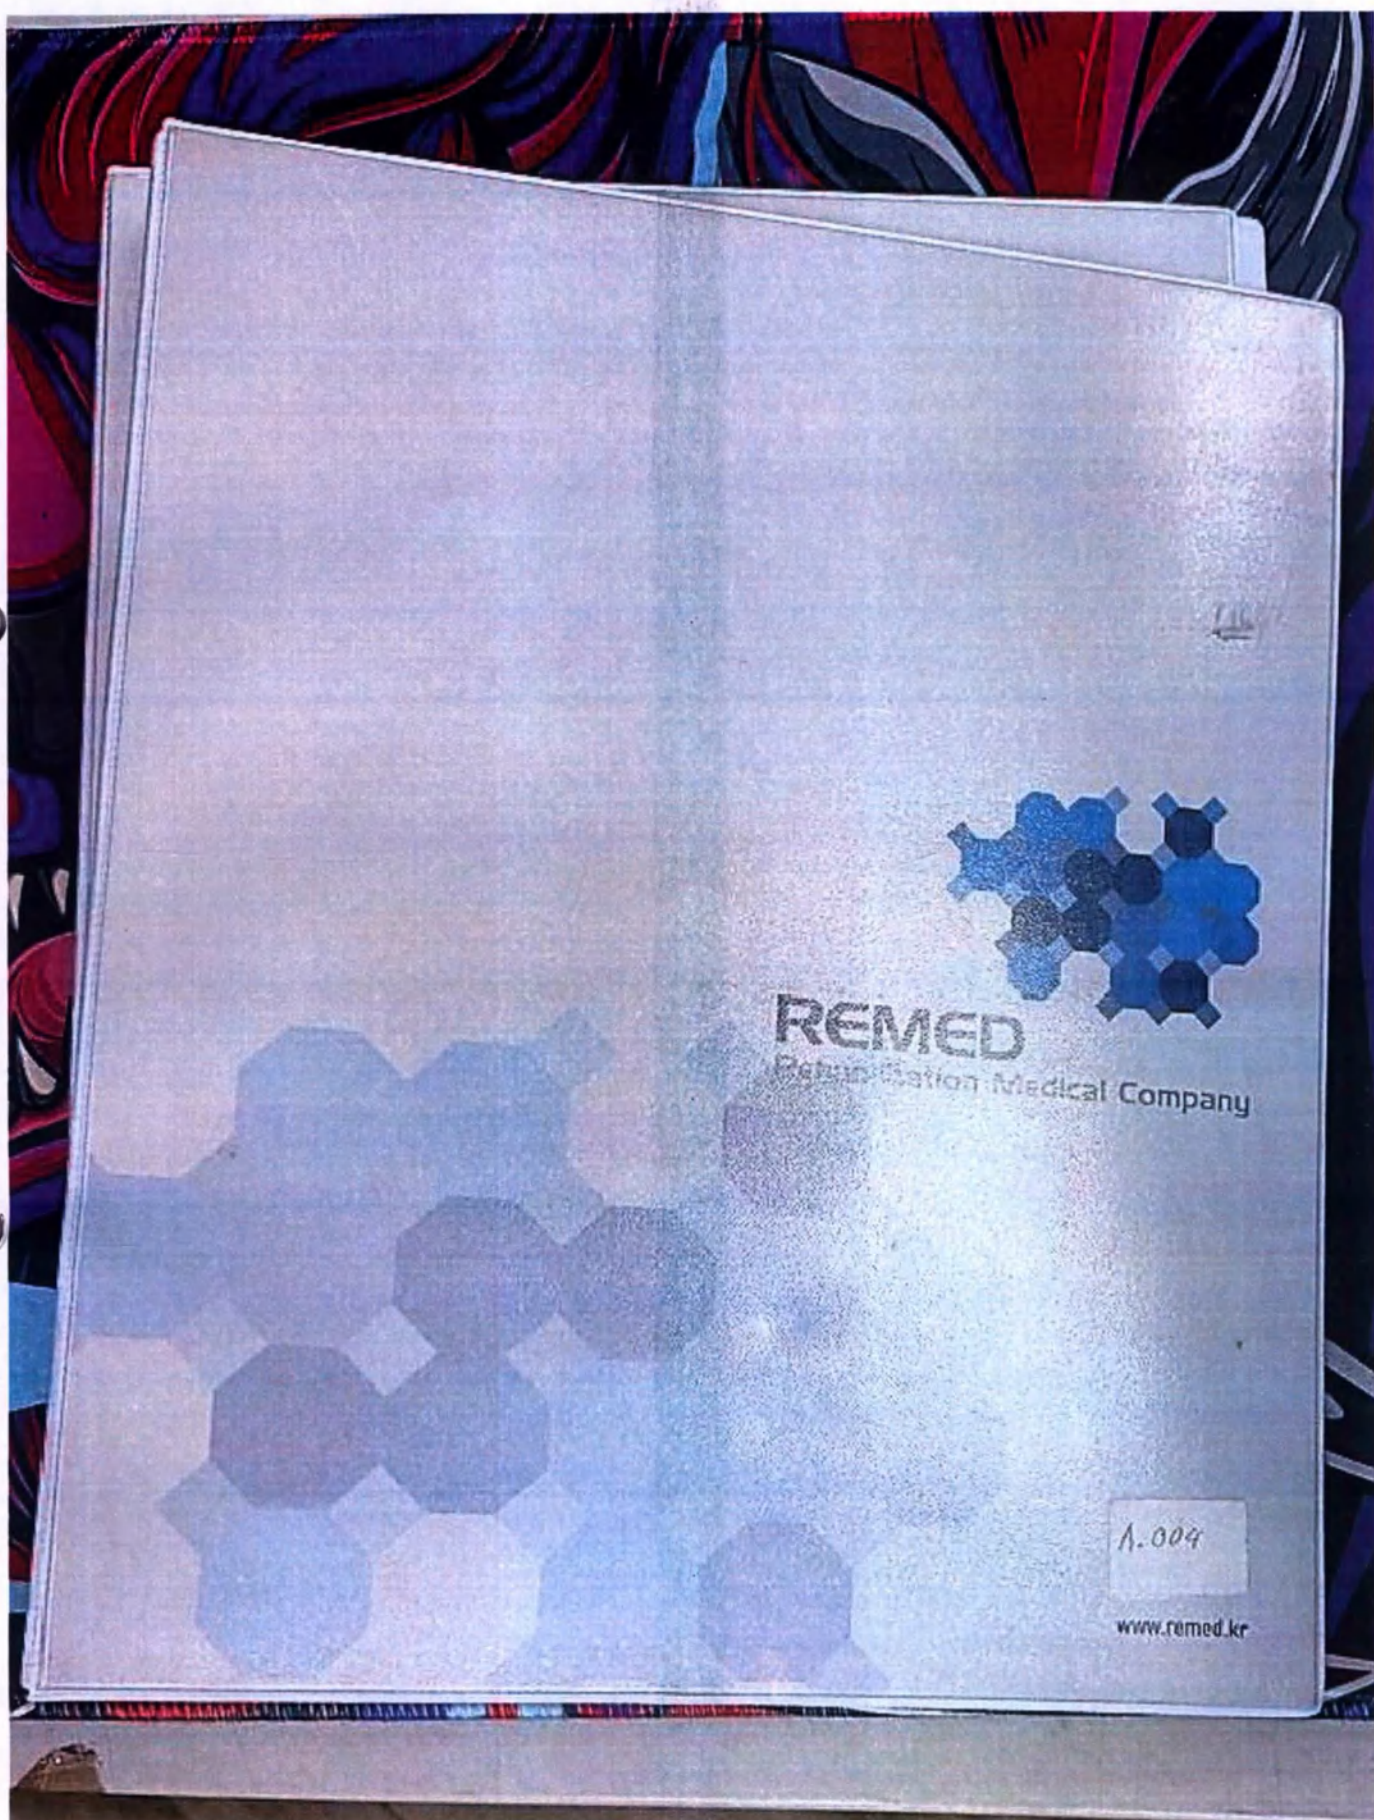


Рисунок 20. Внешний вид руководства по эксплуатации на модель SALUS-RSWT-DUET



SALUS-RSWT-DUET
Instructions For Use
Extracorporeal Shock Wave Therapy



REMED Co., Ltd.

Рисунок 21. Титульный лист руководства по эксплуатации на модель SALUS-RSWT-DUET

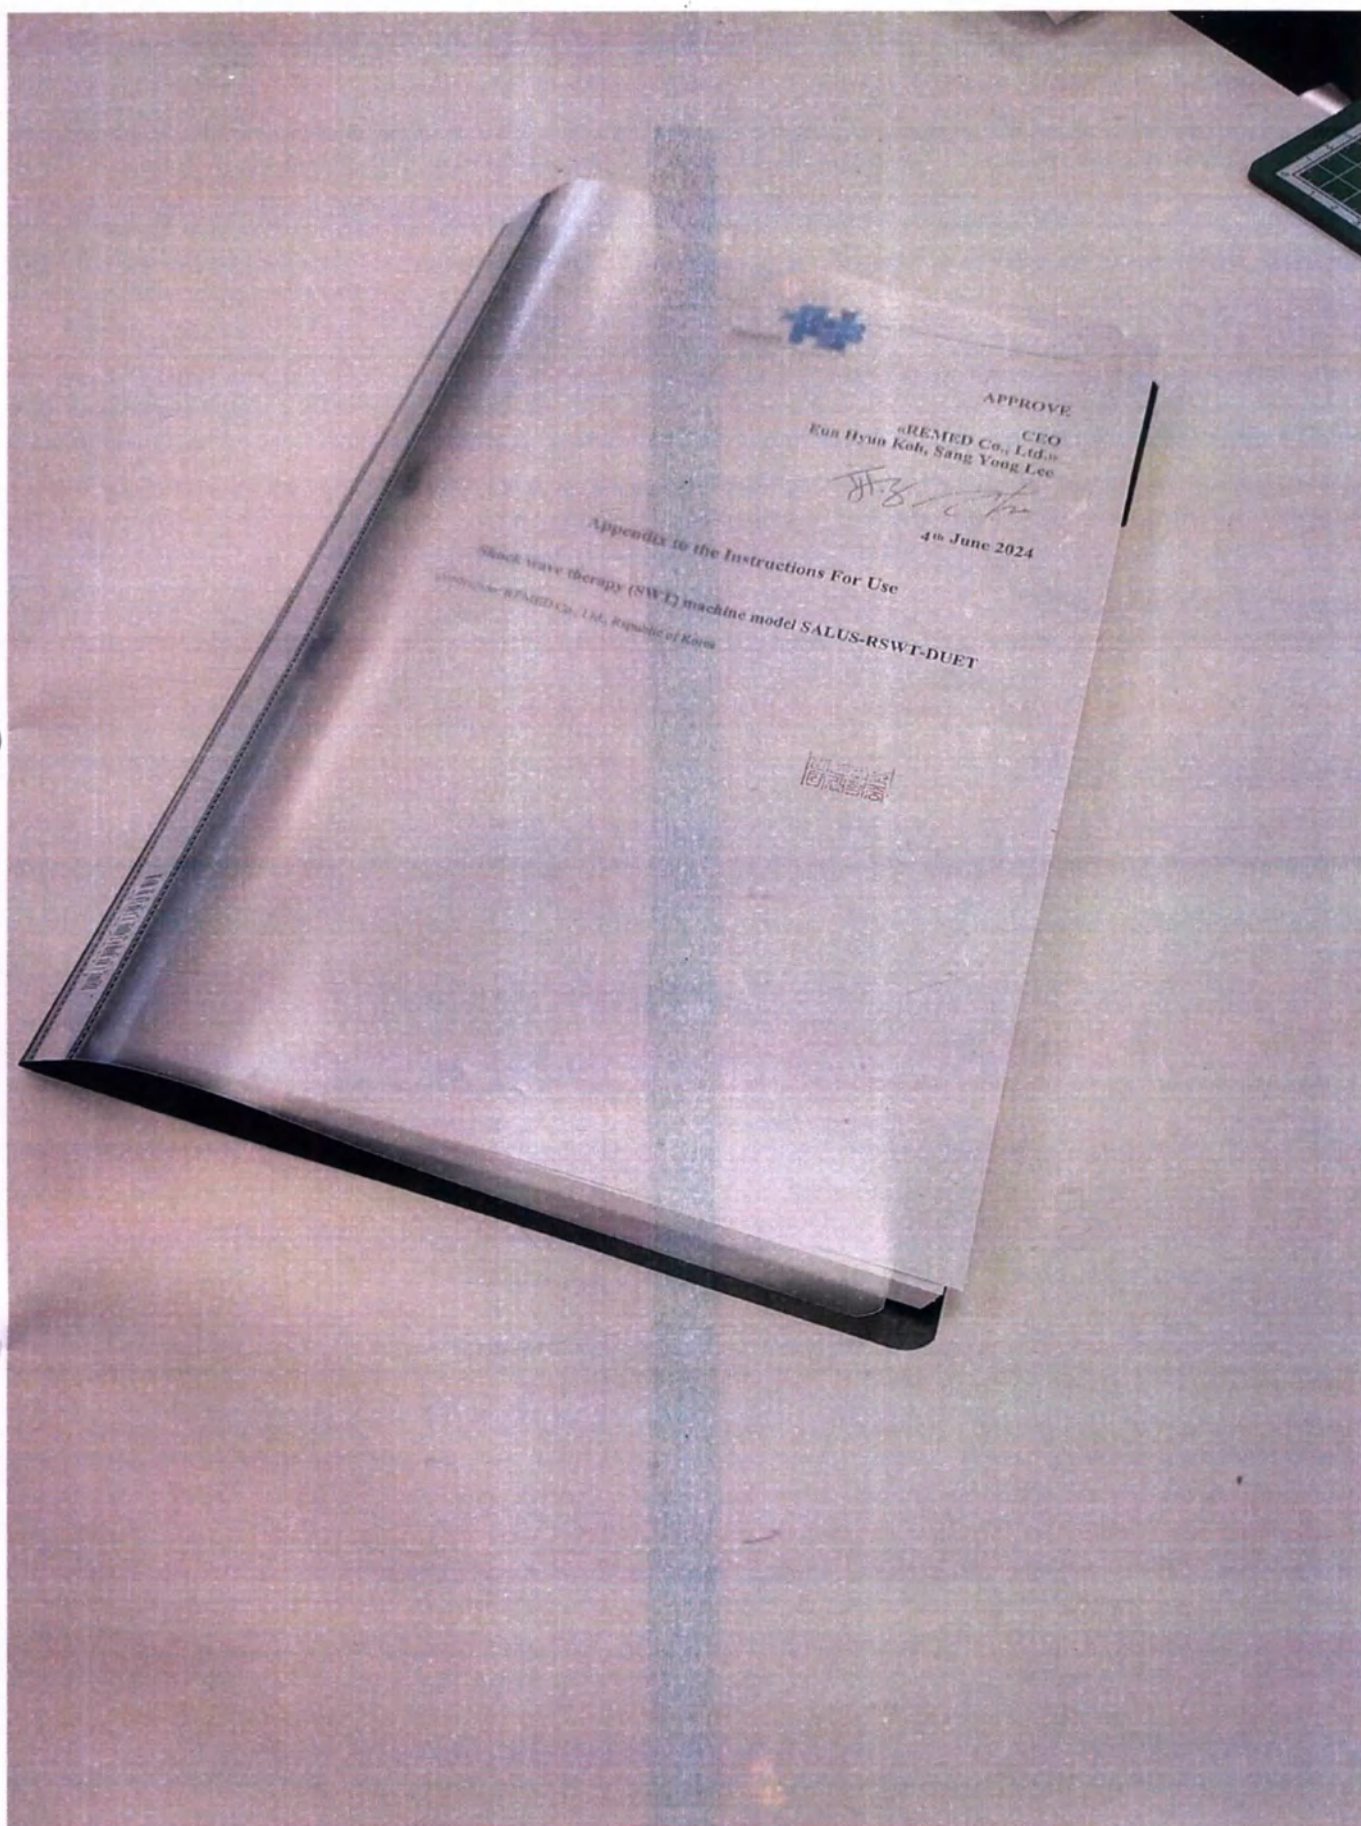


Рисунок 22. Приложение к руководству по эксплуатации (модель SALUS-RSWT-DUET)

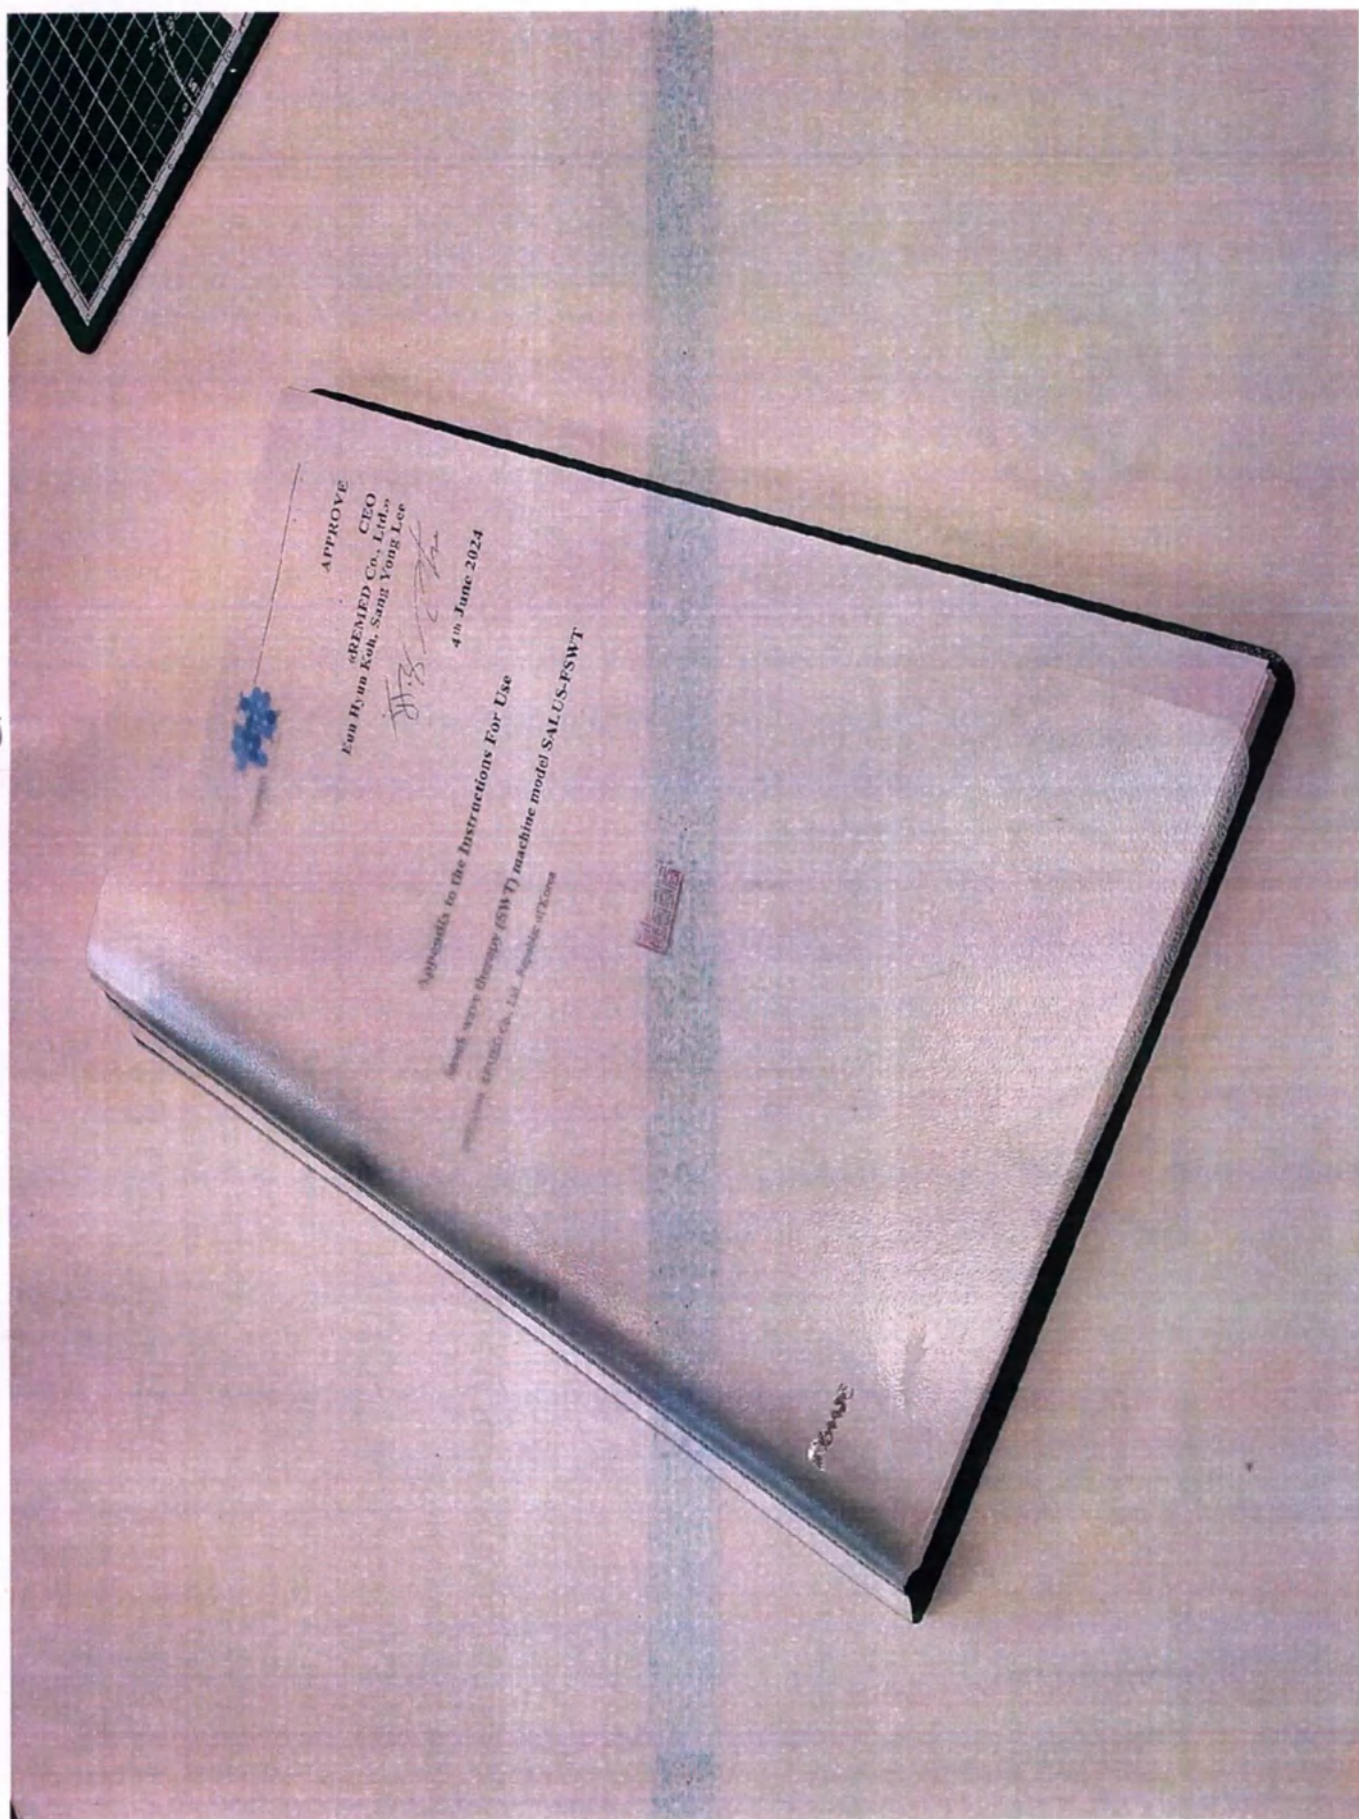


Рисунок 23. Приложение к руководству по эксплуатации (модель SALUS-FSWT)

REMED




РЕМЕД Ко., Лтд (REMED Co., Ltd)

#301~303, Migun Techno World II, 187, Techno 2-ro,
Yuseong-gu, Daejeon, 34025, Republic of Korea/
#301~303, Мигуи Техно Ворлд II, 187, Техно 2-ро,
Юсеонг-гу, Тэджон, 34025, Республика Корея,

Модель: SALUS-RSWT-DUET

Номинальное напряжение: 230 В~, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 1600 ВА



2301004



2023-01-16



Чтобы убедиться в понимании всех функций и обеспечить эффективное использование этого оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием.



REMED




РЕМЕД Ко., Лтд (REMED Co., Ltd)

#301~303, Migun Techno World II, 187, Techno 2-ro,
Yuseong-gu, Daejeon, 34025, Republic of Korea/
#301~303, Мигуи Техно Ворлд II, 187, Техно 2-ро,
Юсеонг-гу, Тэджон, 34025, Республика Корея,

Модель: SALUS-FSWT

Номинальное напряжение: 220 В~, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 300 ВА



2301006



2023-01-16



Чтобы убедиться в понимании всех функций и обеспечить эффективное использование этого оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием.



Прошито и пронумеровано

26

листов

