


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«31» мая 2023 г.


М.П.

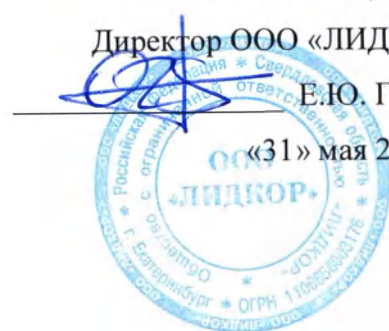

Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ФСГ» для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ, FSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 224-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

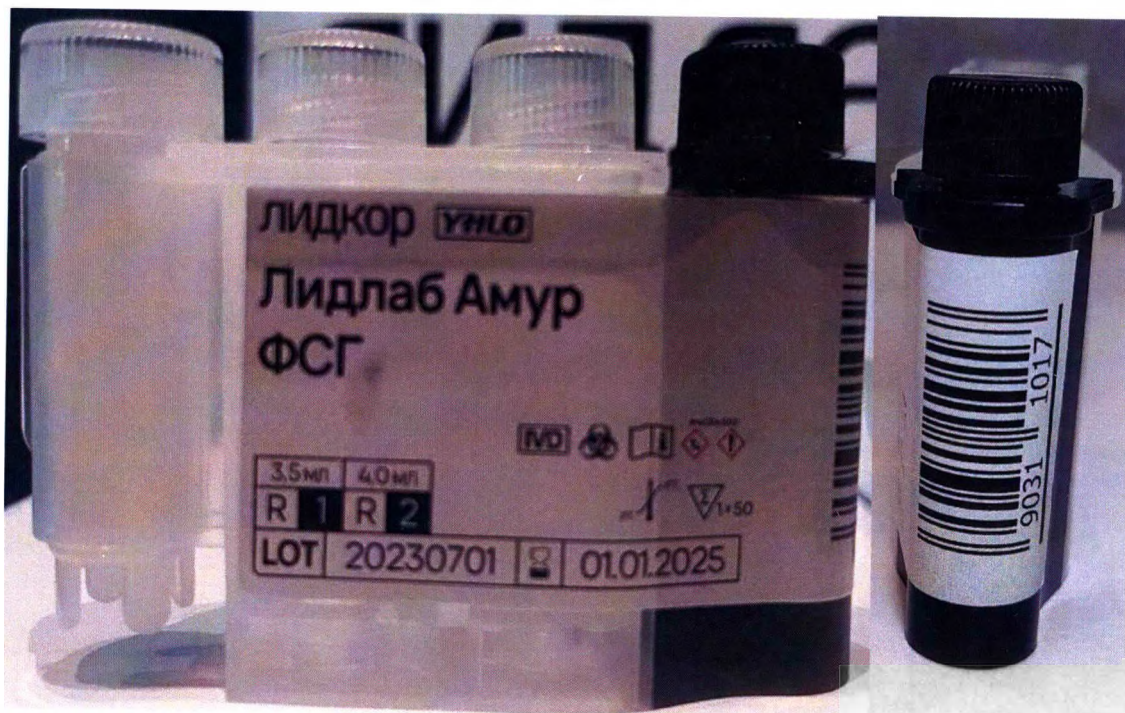


Пароизоляционные крышки



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон




Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

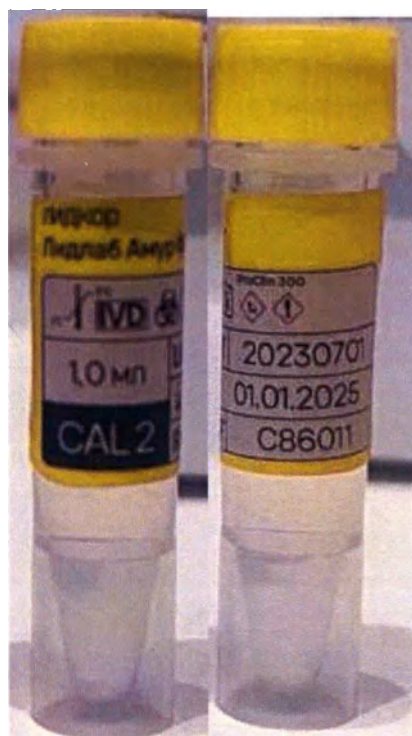


Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон



Потребительская упаковка

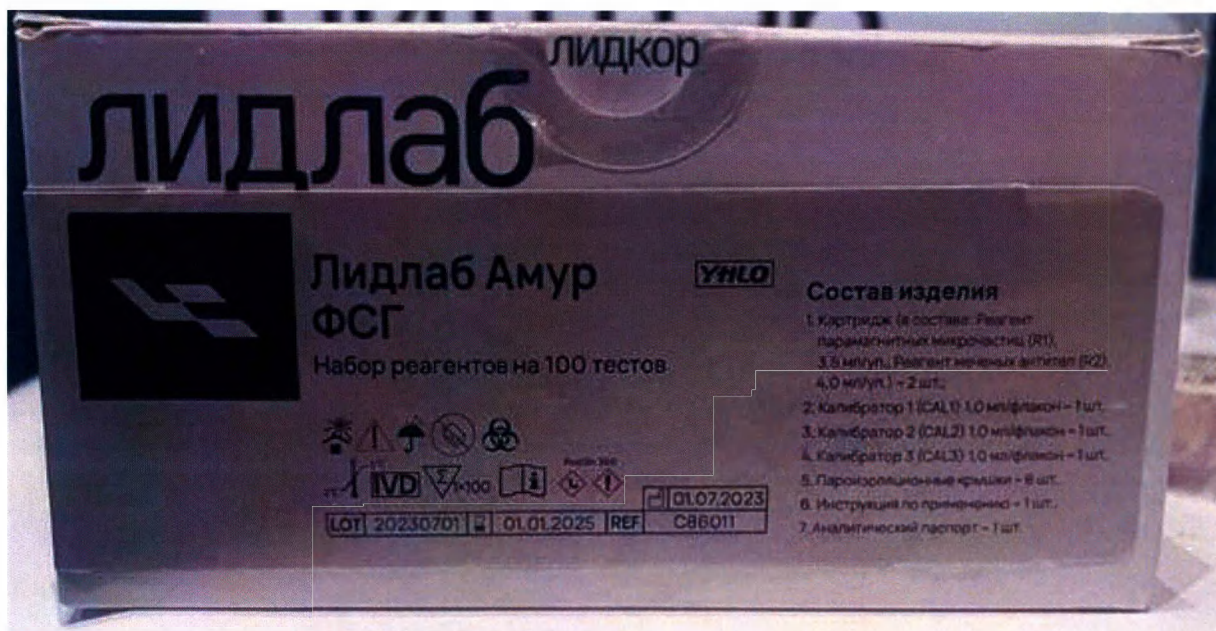


Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)

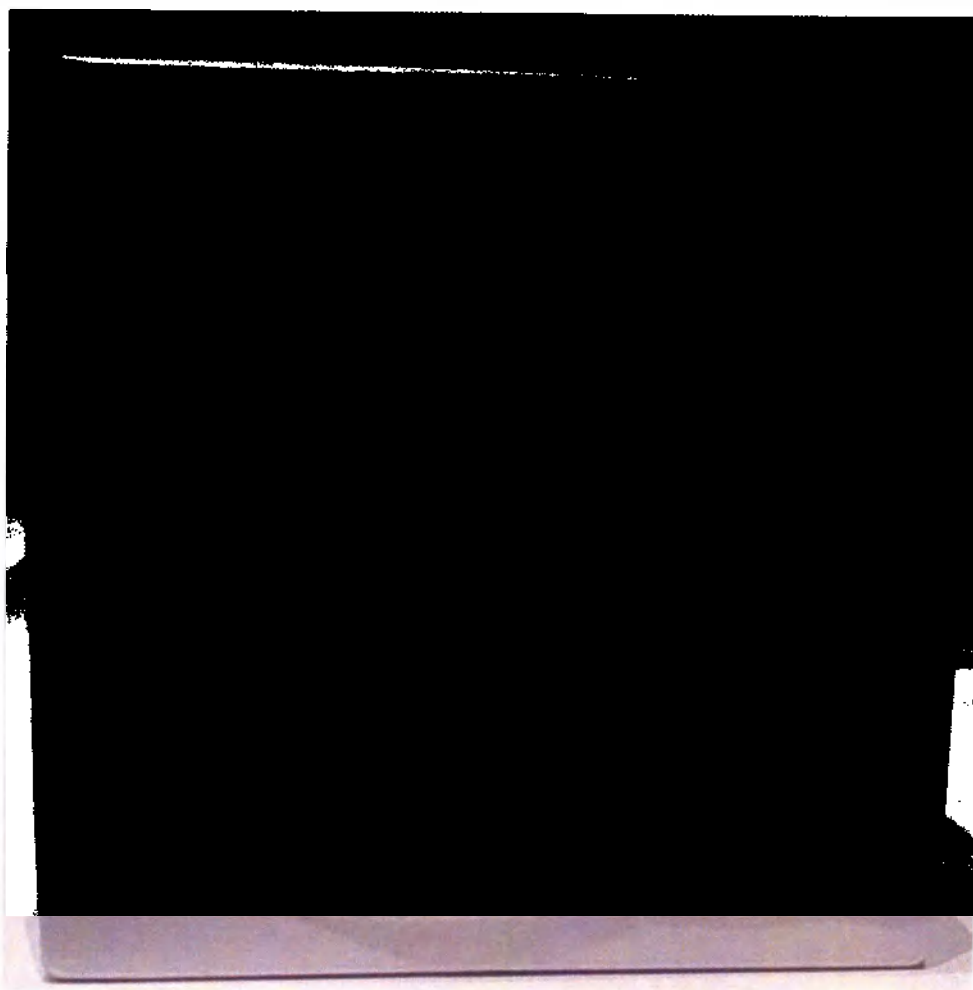


Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

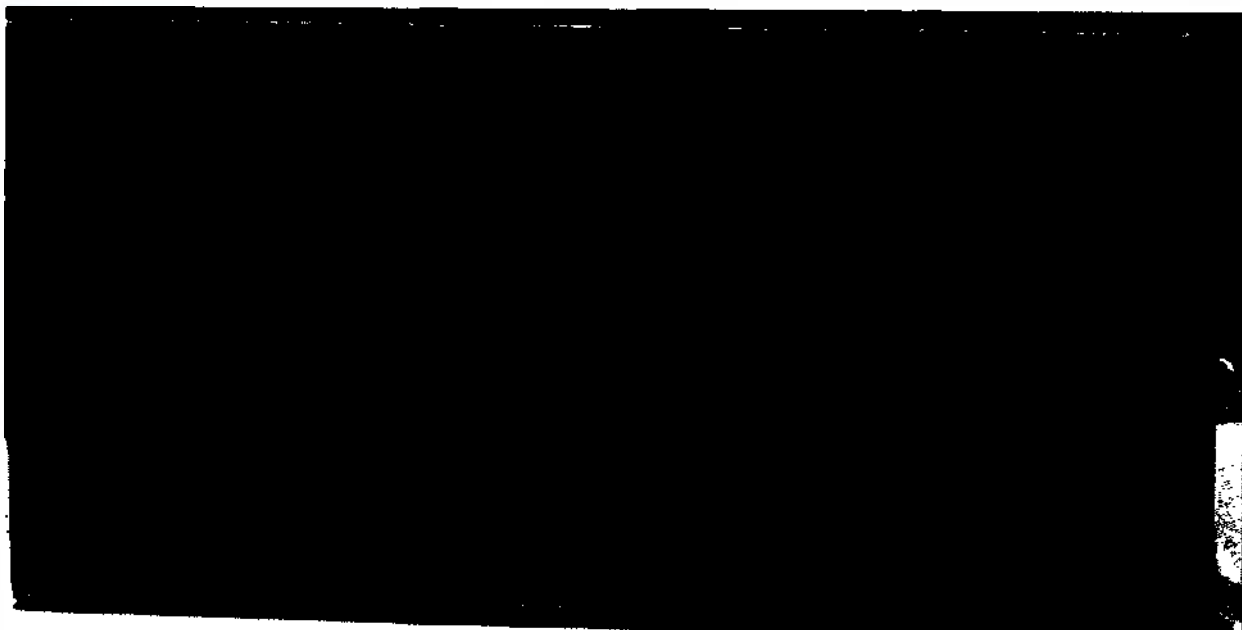


Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

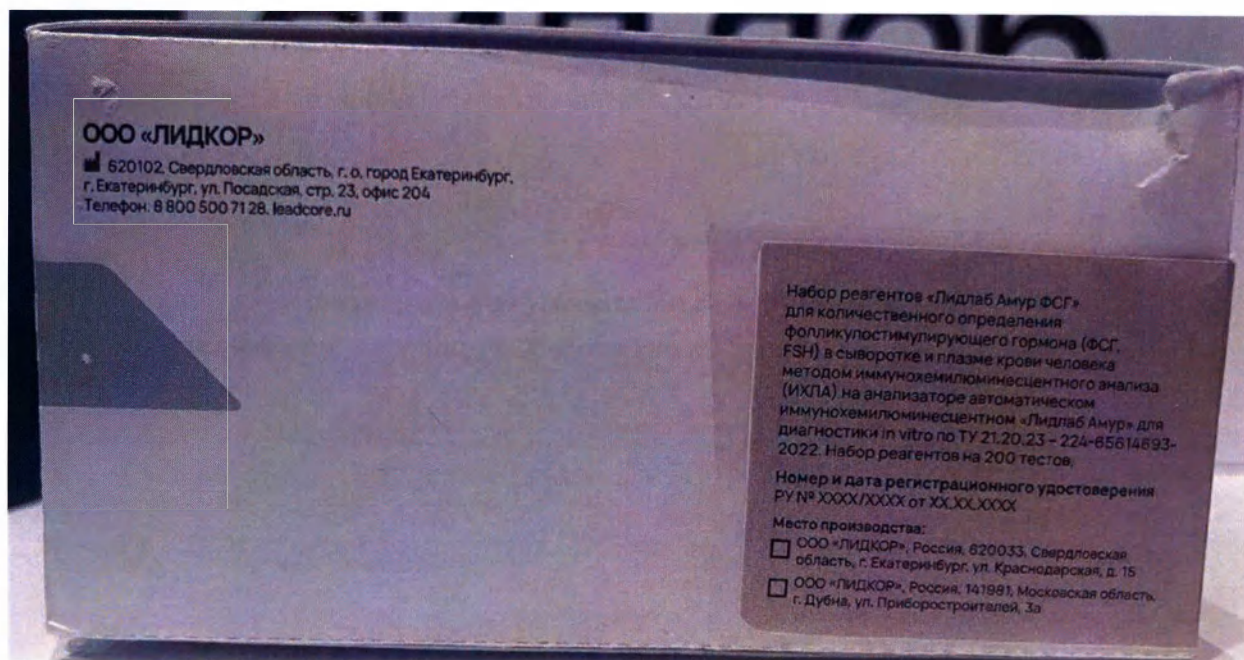


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)

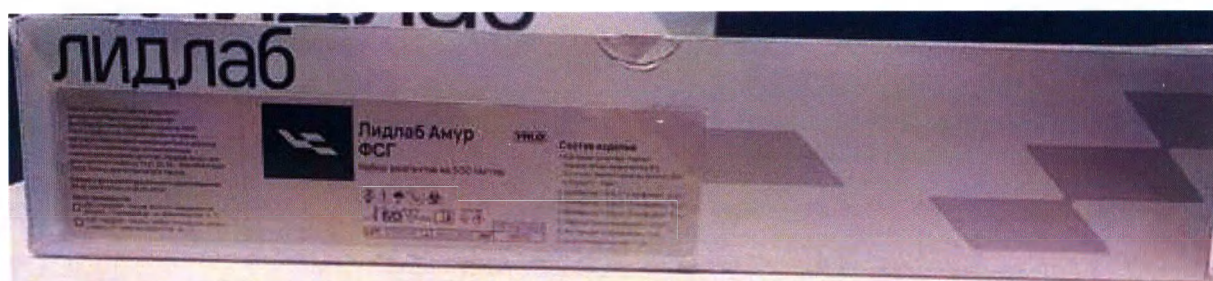

Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

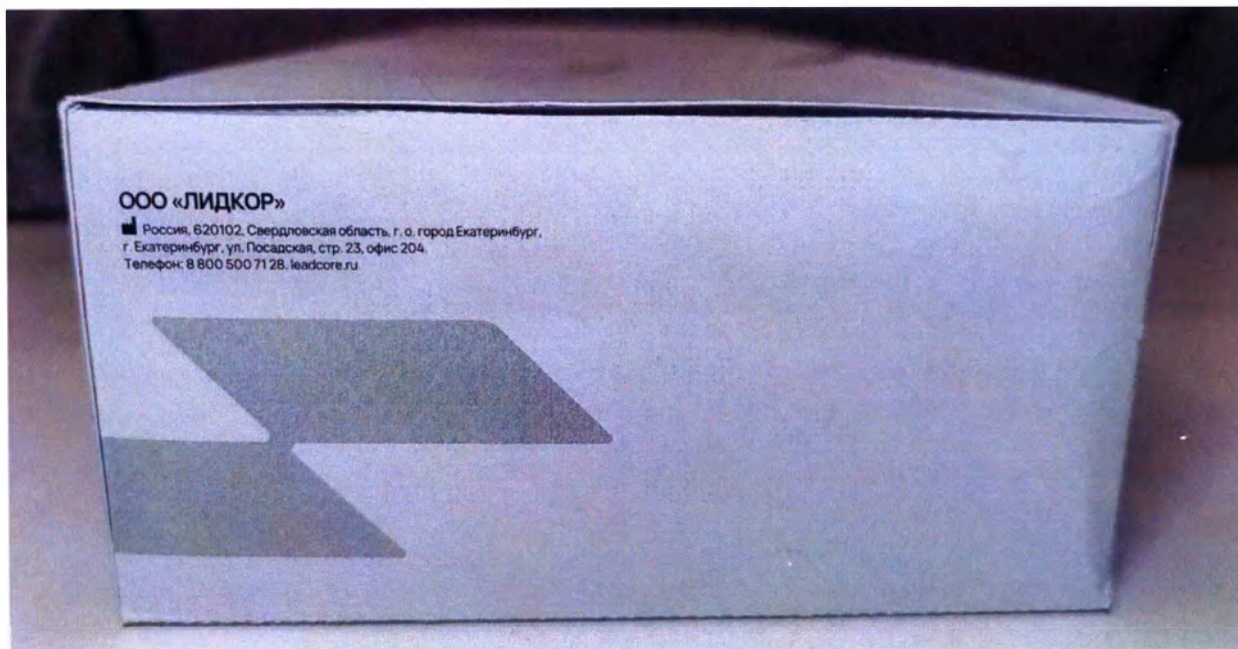

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)

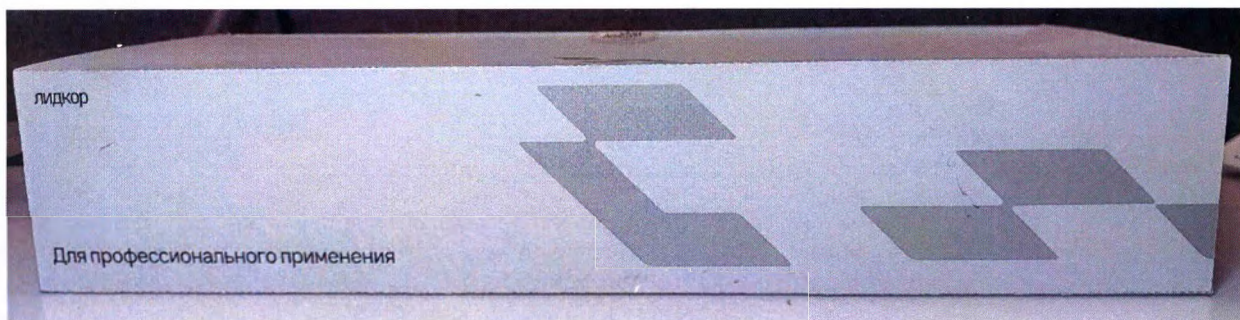


Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

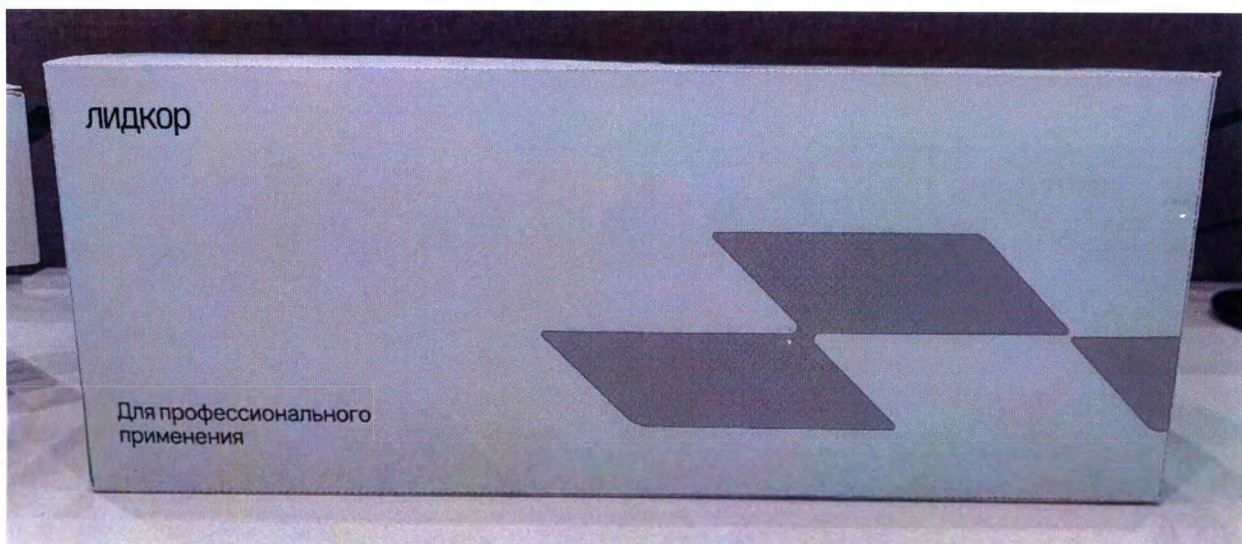

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)

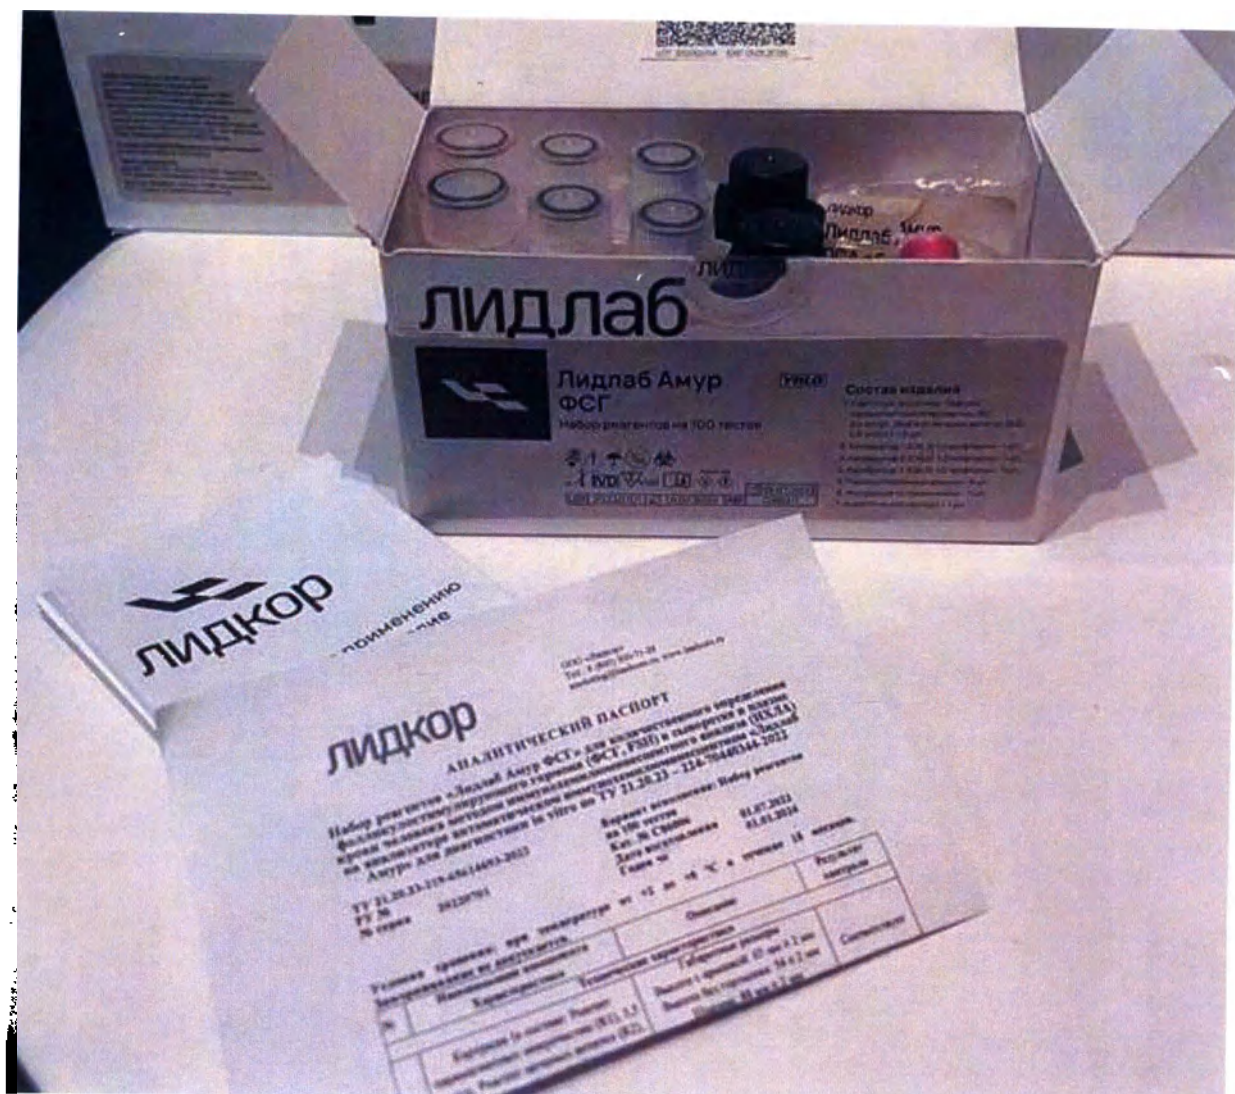



Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.



Групповое фото.

Транспортная упаковка

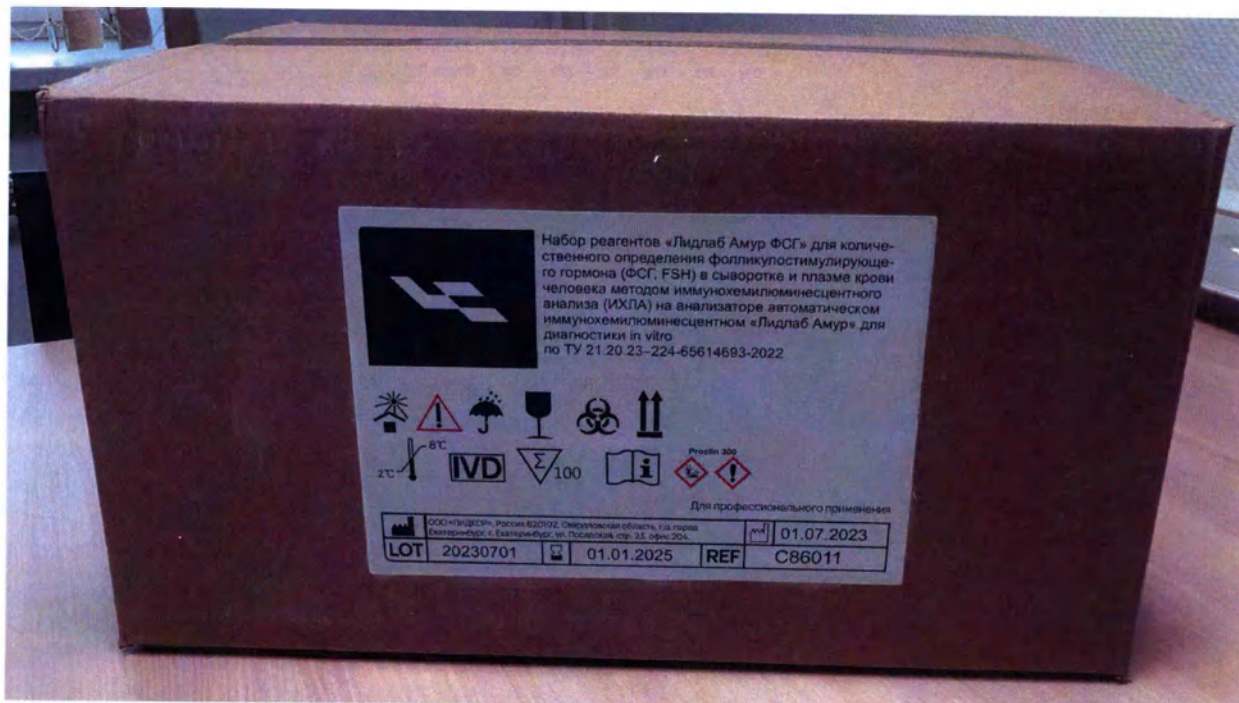

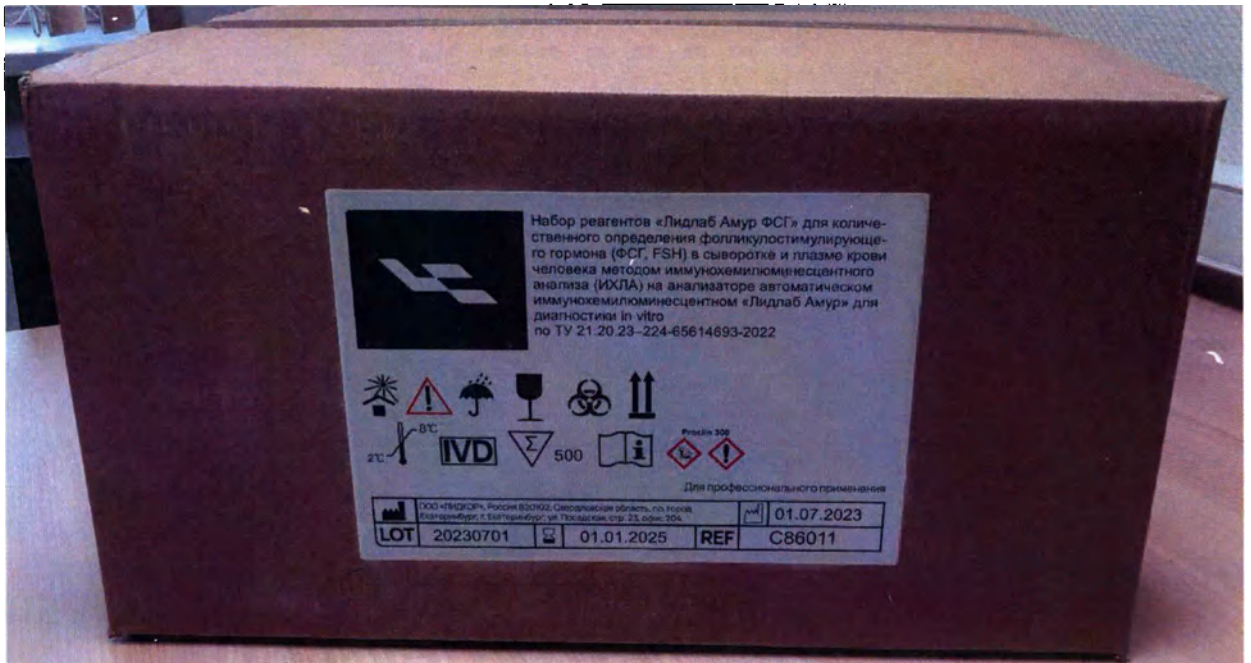

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
13 (прилагаются) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.



М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Лидлаб Амур ФСГ» для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ, FSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 224-65614693-2022

2023

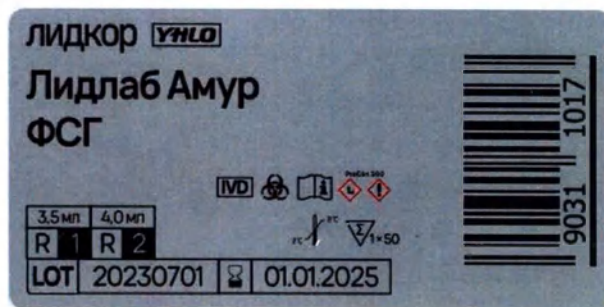

Набор реагентов «Лидлаб Амур ФСГ» для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ, FSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 - 224-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ФСГ

Набор реагентов на 100 тестов



LOT 20230701 01.07.2025 REF C86011

YHLO

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4.0 мл/уп.) - 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1) 1.0 мл/флакон - 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2) 1.0 мл/флакон - 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3) 1.0 мл/флакон - 1 шт.;
5. Паронепроницаемые крышки - 8 шт.;
6. Инструкция по применению - 1 шт.;
7. Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ФСГ» для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ, FSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 - 224-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ФСГ

Набор реагентов на 200 тестов



LOT 20230701 01.07.2025 REF C86011

YHLO

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4.0 мл/уп.) - 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1) 1.0 мл/флакон - 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2) 1.0 мл/флакон - 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3) 1.0 мл/флакон - 2 шт.;
5. Паронепроницаемые крышки - 16 шт.;
6. Инструкция по применению - 1 шт.;
7. Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ФСГ» для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ, FSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 - 224-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ФСГ

Набор реагентов на 500 тестов



LOT 20230701 01.07.2025 REF C86011

YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4.0 мл/уп.) - 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1) 1.0 мл/флакон - 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2) 1.0 мл/флакон - 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3) 1.0 мл/флакон - 5 шт.;
5. Паронепроницаемые крышки - 40 шт.;
6. Инструкция по применению - 1 шт.;
7. Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ФСГ» для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ, FSH) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 - 224-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ФСГ

Набор реагентов на 1000 тестов




LOT 20230701 01.07.2025 REF C86011

YHLO

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4.0 мл/уп.) - 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1) 1.0 мл/флакон - 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2) 1.0 мл/флакон - 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3) 1.0 мл/флакон - 10 шт.;
5. Паронепроницаемые крышки - 80 шт.;
6. Инструкция по применению - 1 шт.;
7. Аналитический паспорт - 1 шт.

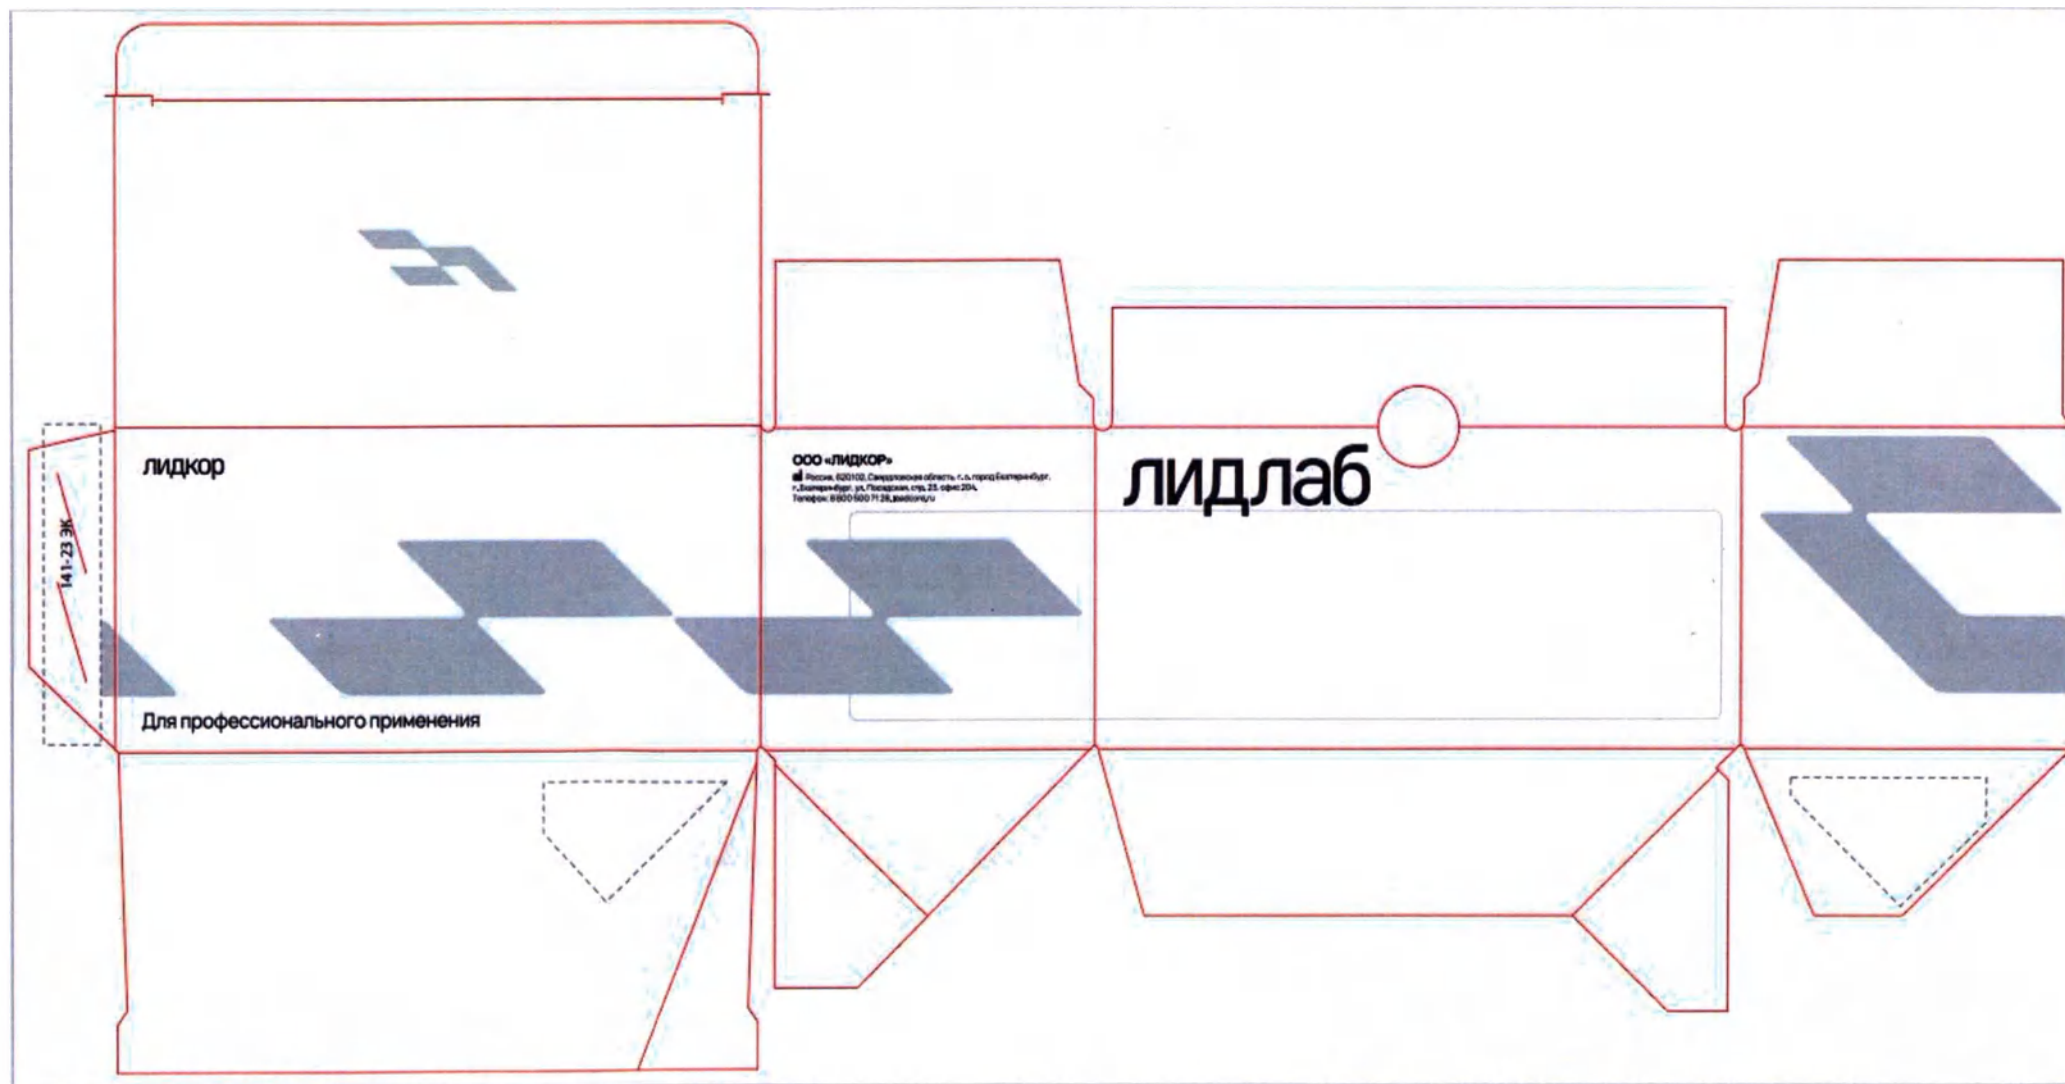

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____) и.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

