

АО «РЕНТГЕНПРОМ»

Аппарат рентгеномаммографический автоматизированный «Маммо-РП», исполнение 1

Фото общего вида





Аппарат рентгеномаммографический
автоматизированный "Маммо-РП"
ТУ 9442-023-42254364-2009

Потребляемая мощность – 4,5 кВА
Напряжение – 198 В-242 В~
Частота – 50 Гц
Сопротивление - 1 Ом

IP20



РЕНТГЕНПРОМ



Россия, 143560, Московская обл.,
г.Истра, пос.Румянцево,
квартал 0080204, здание 173

АППАРАТ РЕНТГЕНОМАММОГРАФИЧЕСКИЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ "МАММО - РП"
(Исполнение 1)

ТУ 9442-023-42254364-2009


SN

EAC



Штатив маммографа



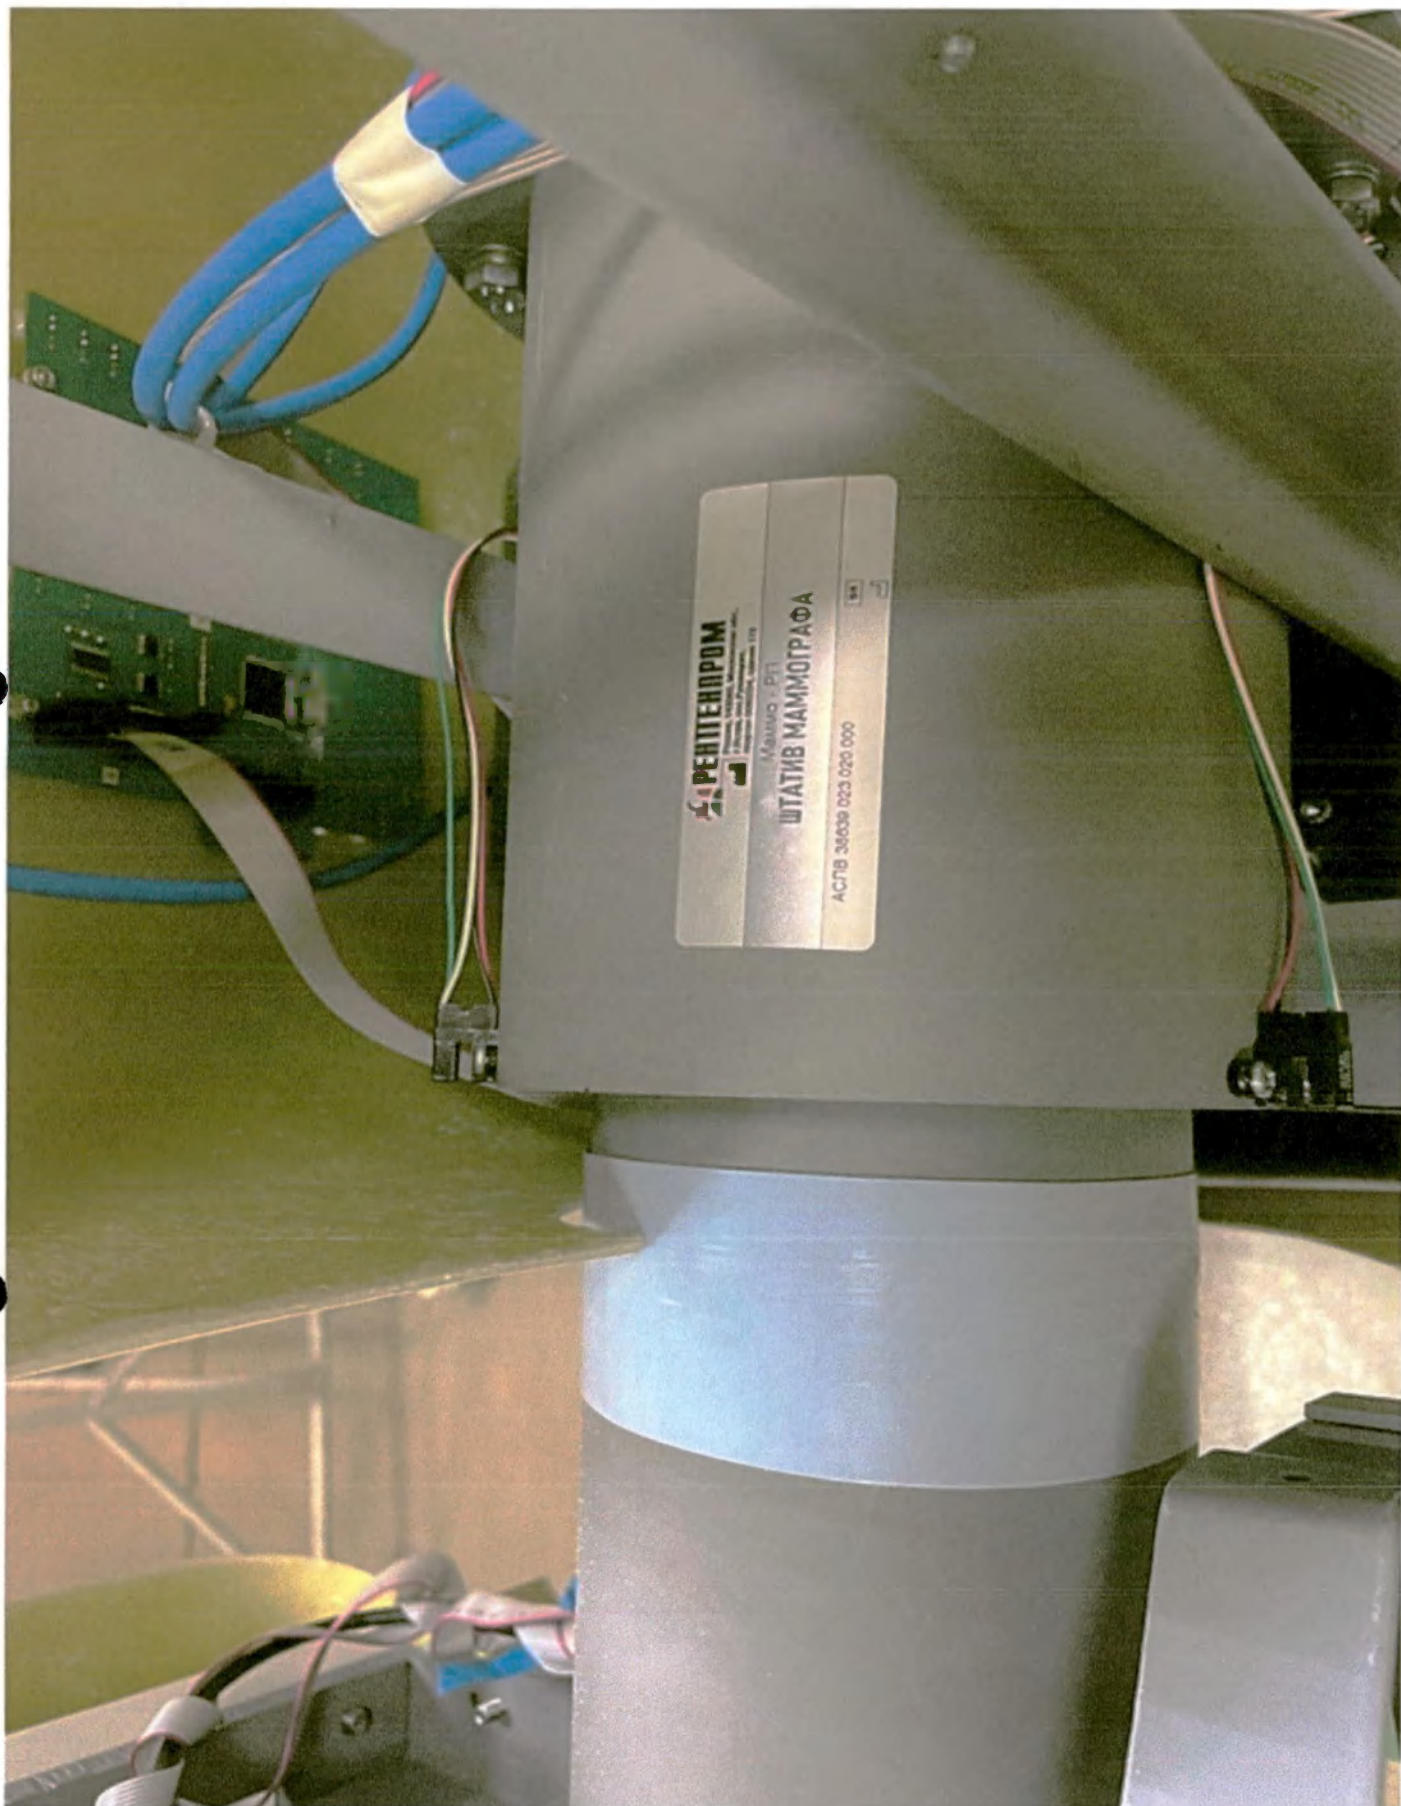




Маркировка съемочного узла





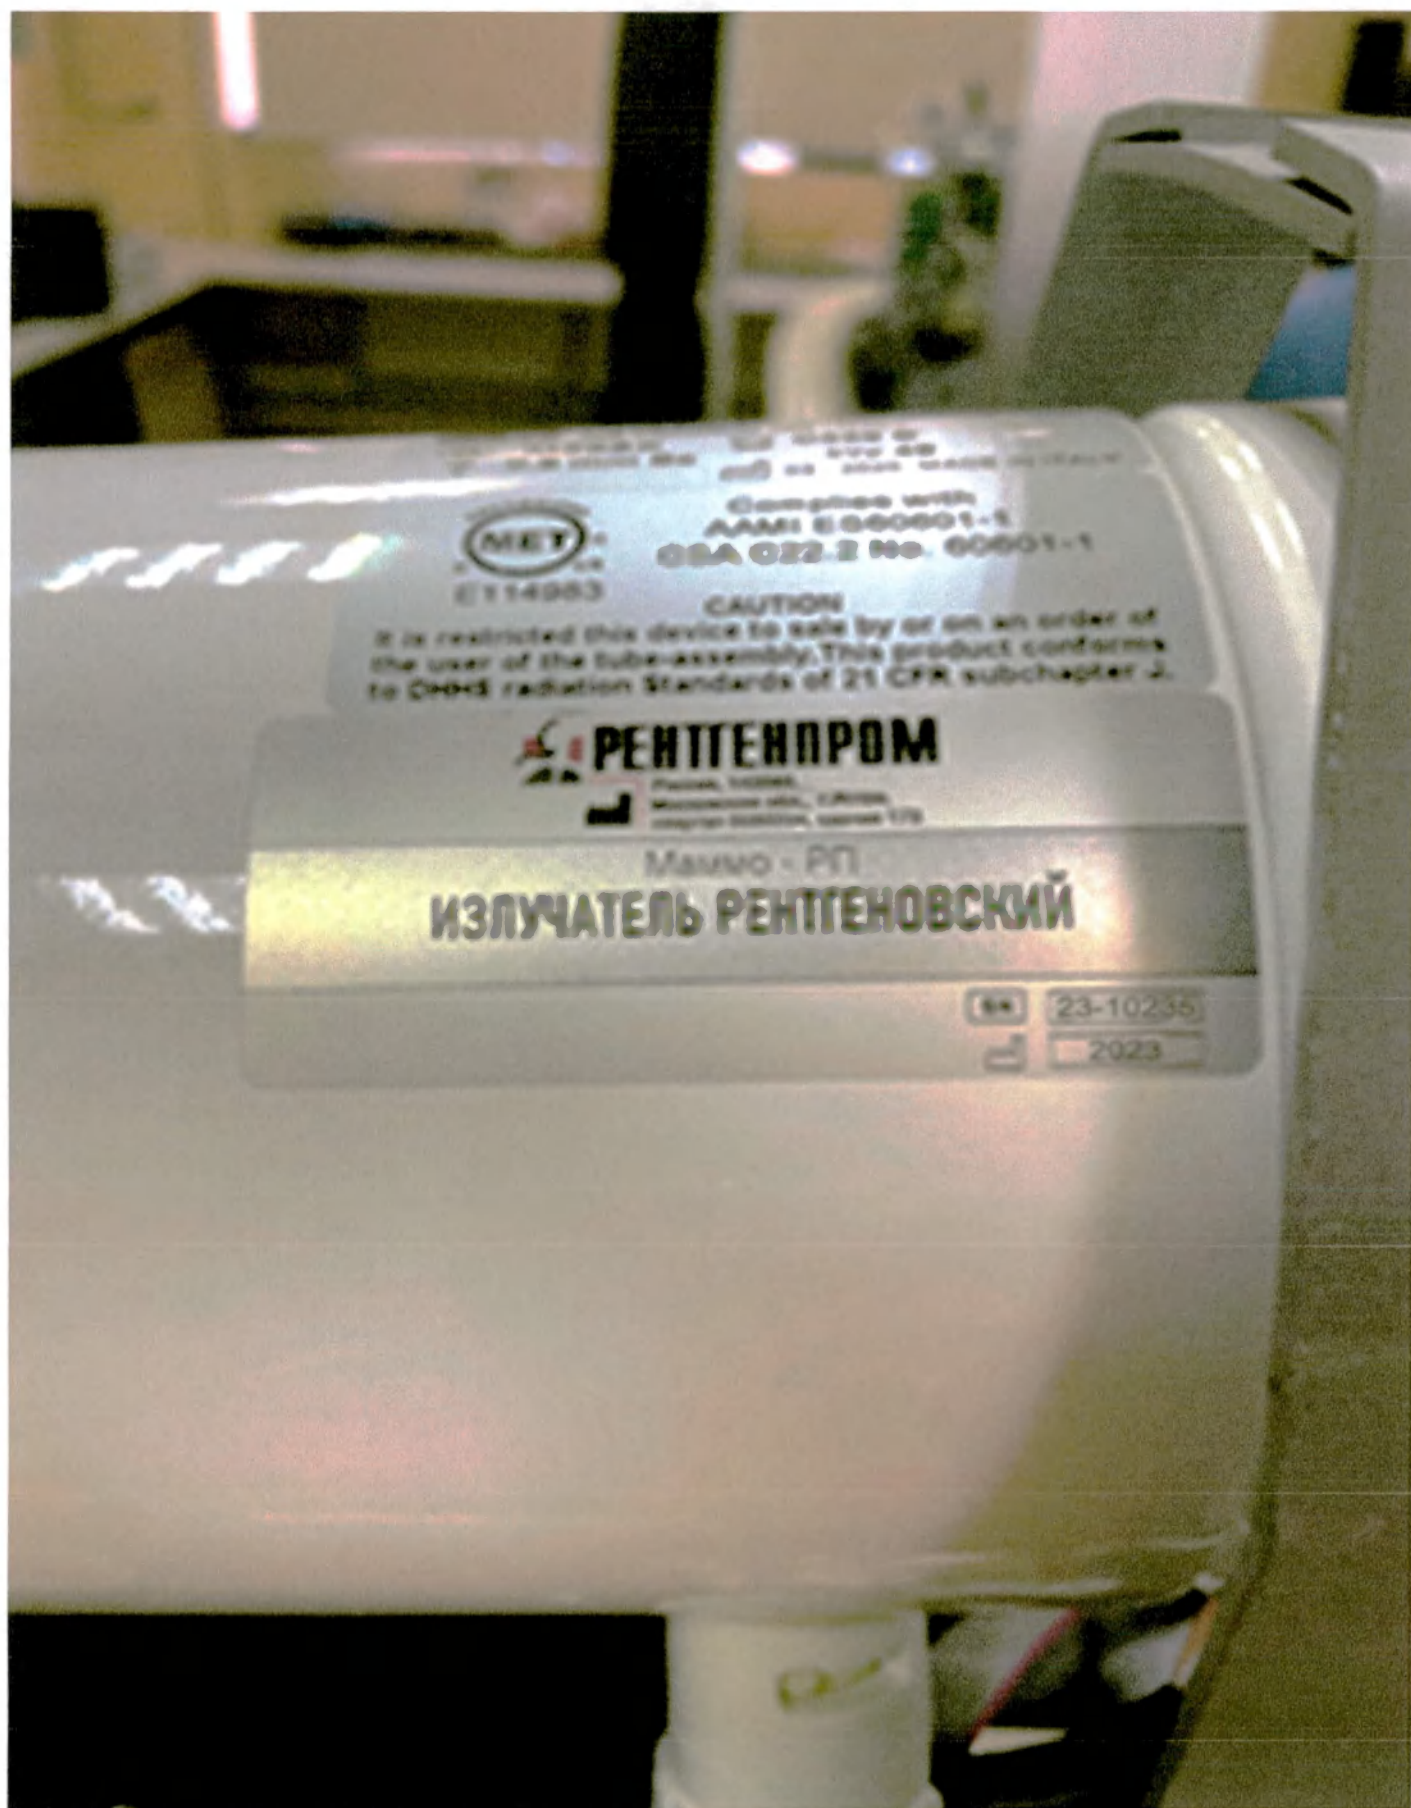


Принадлежности: Диафрагма 18x24, Заглушка, Диафрагма 6x6








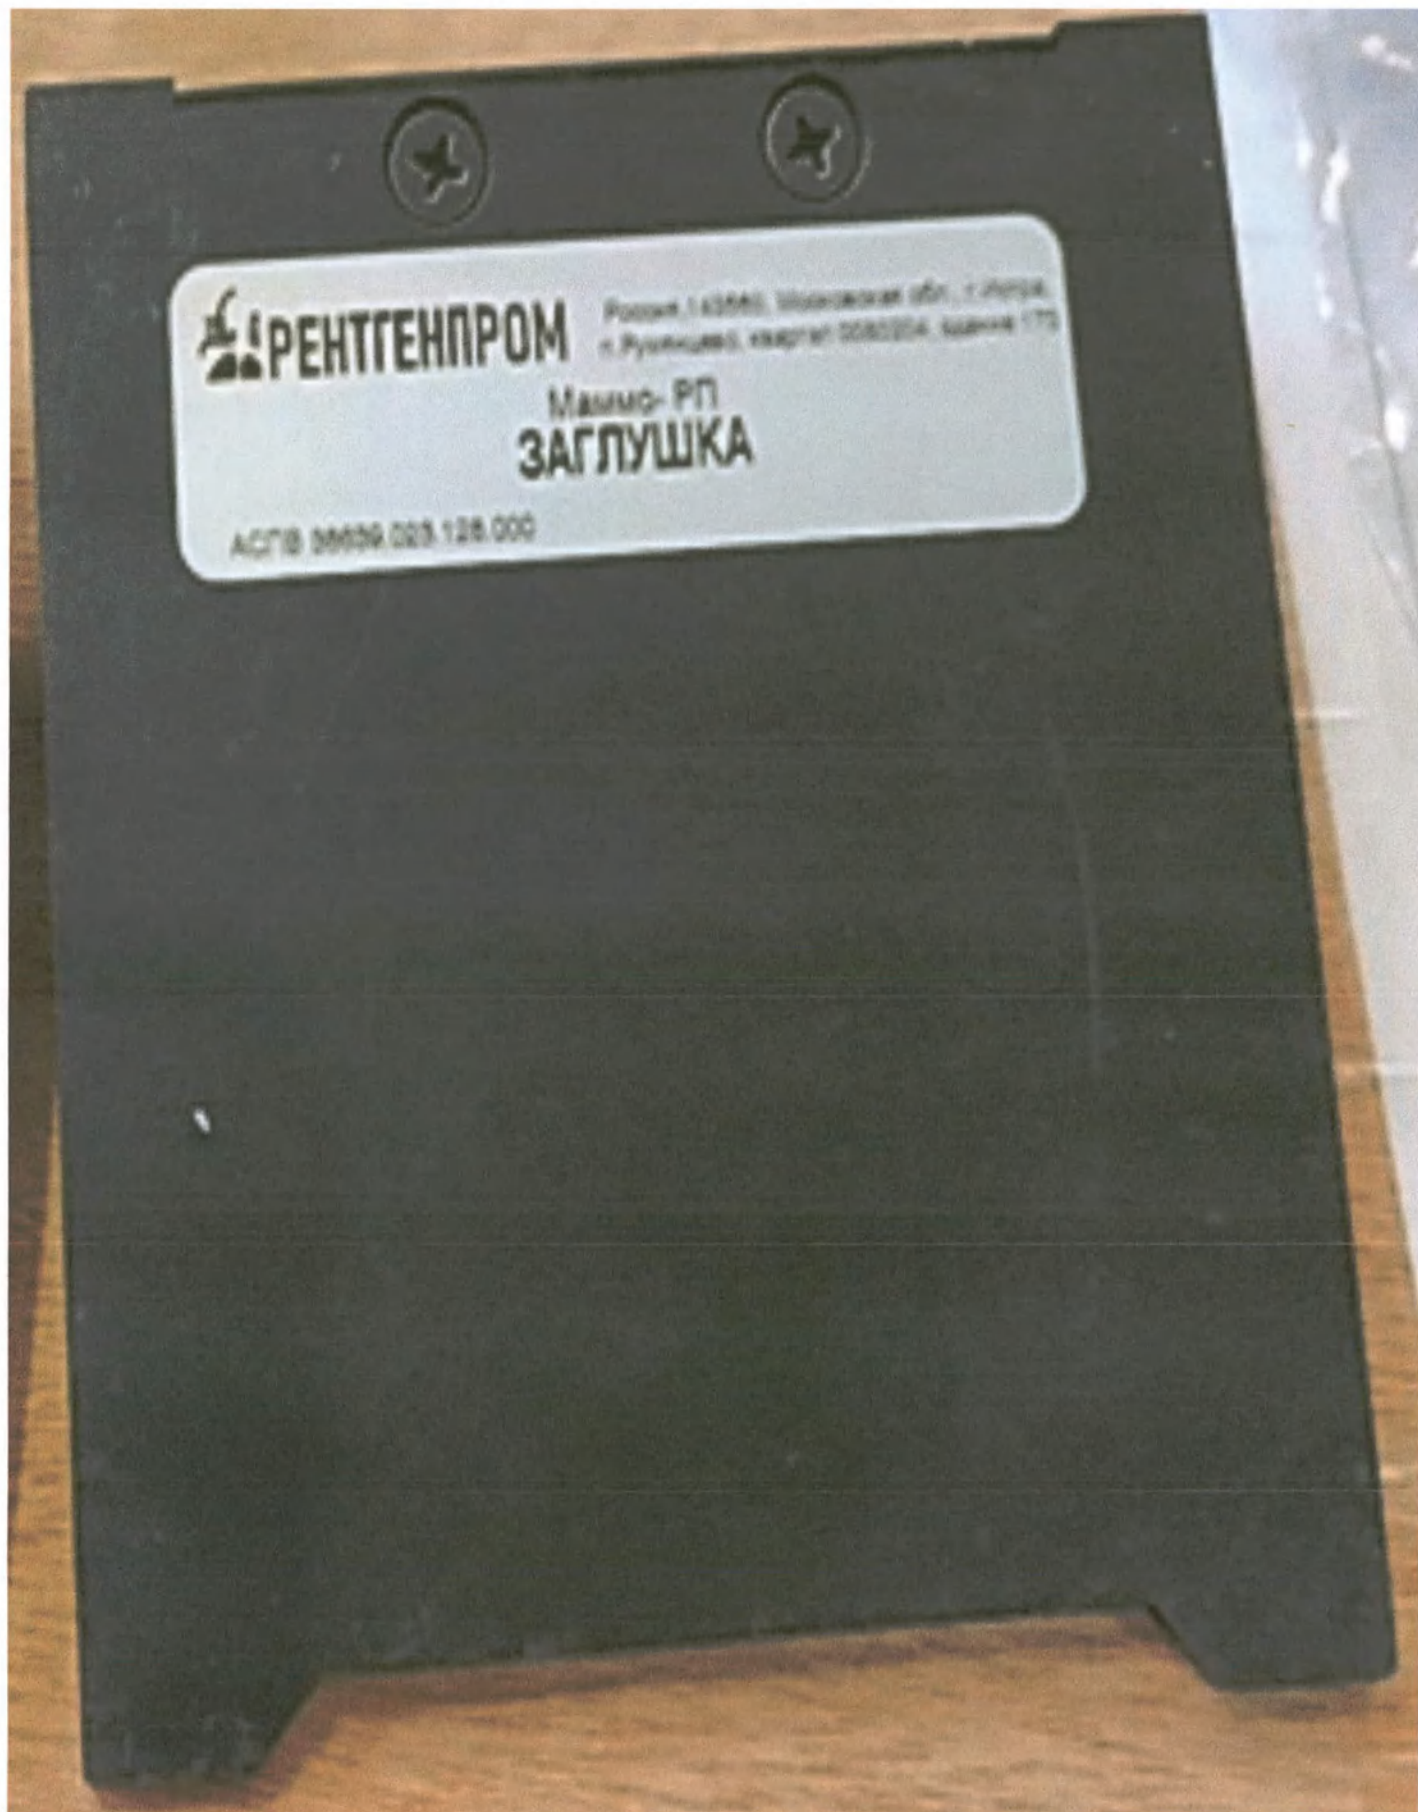

Экран защитный (козырек) с маркировкой




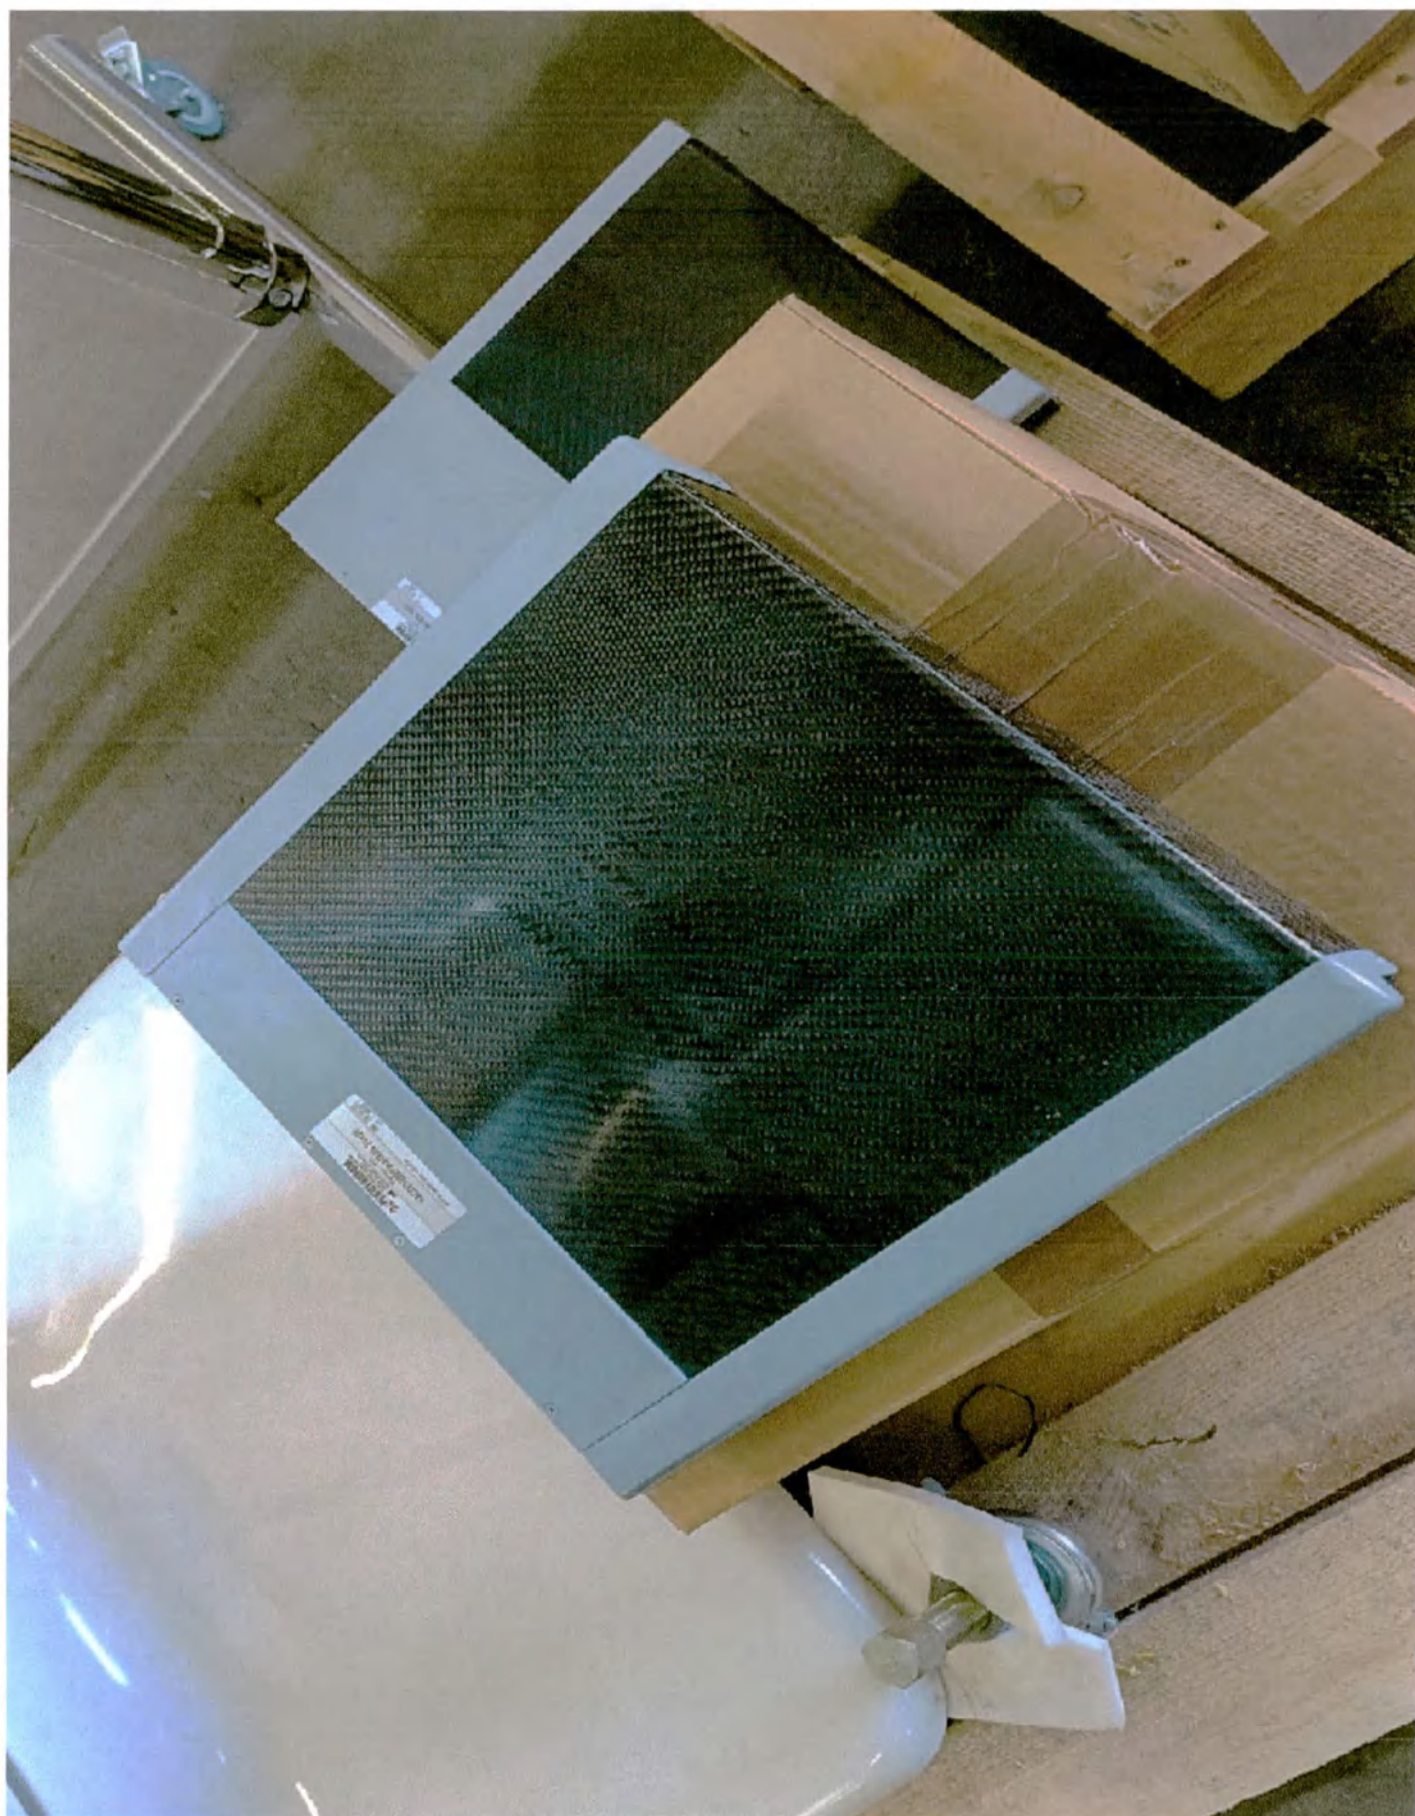



Кассетодержатель 24x30 (с маркировкой)



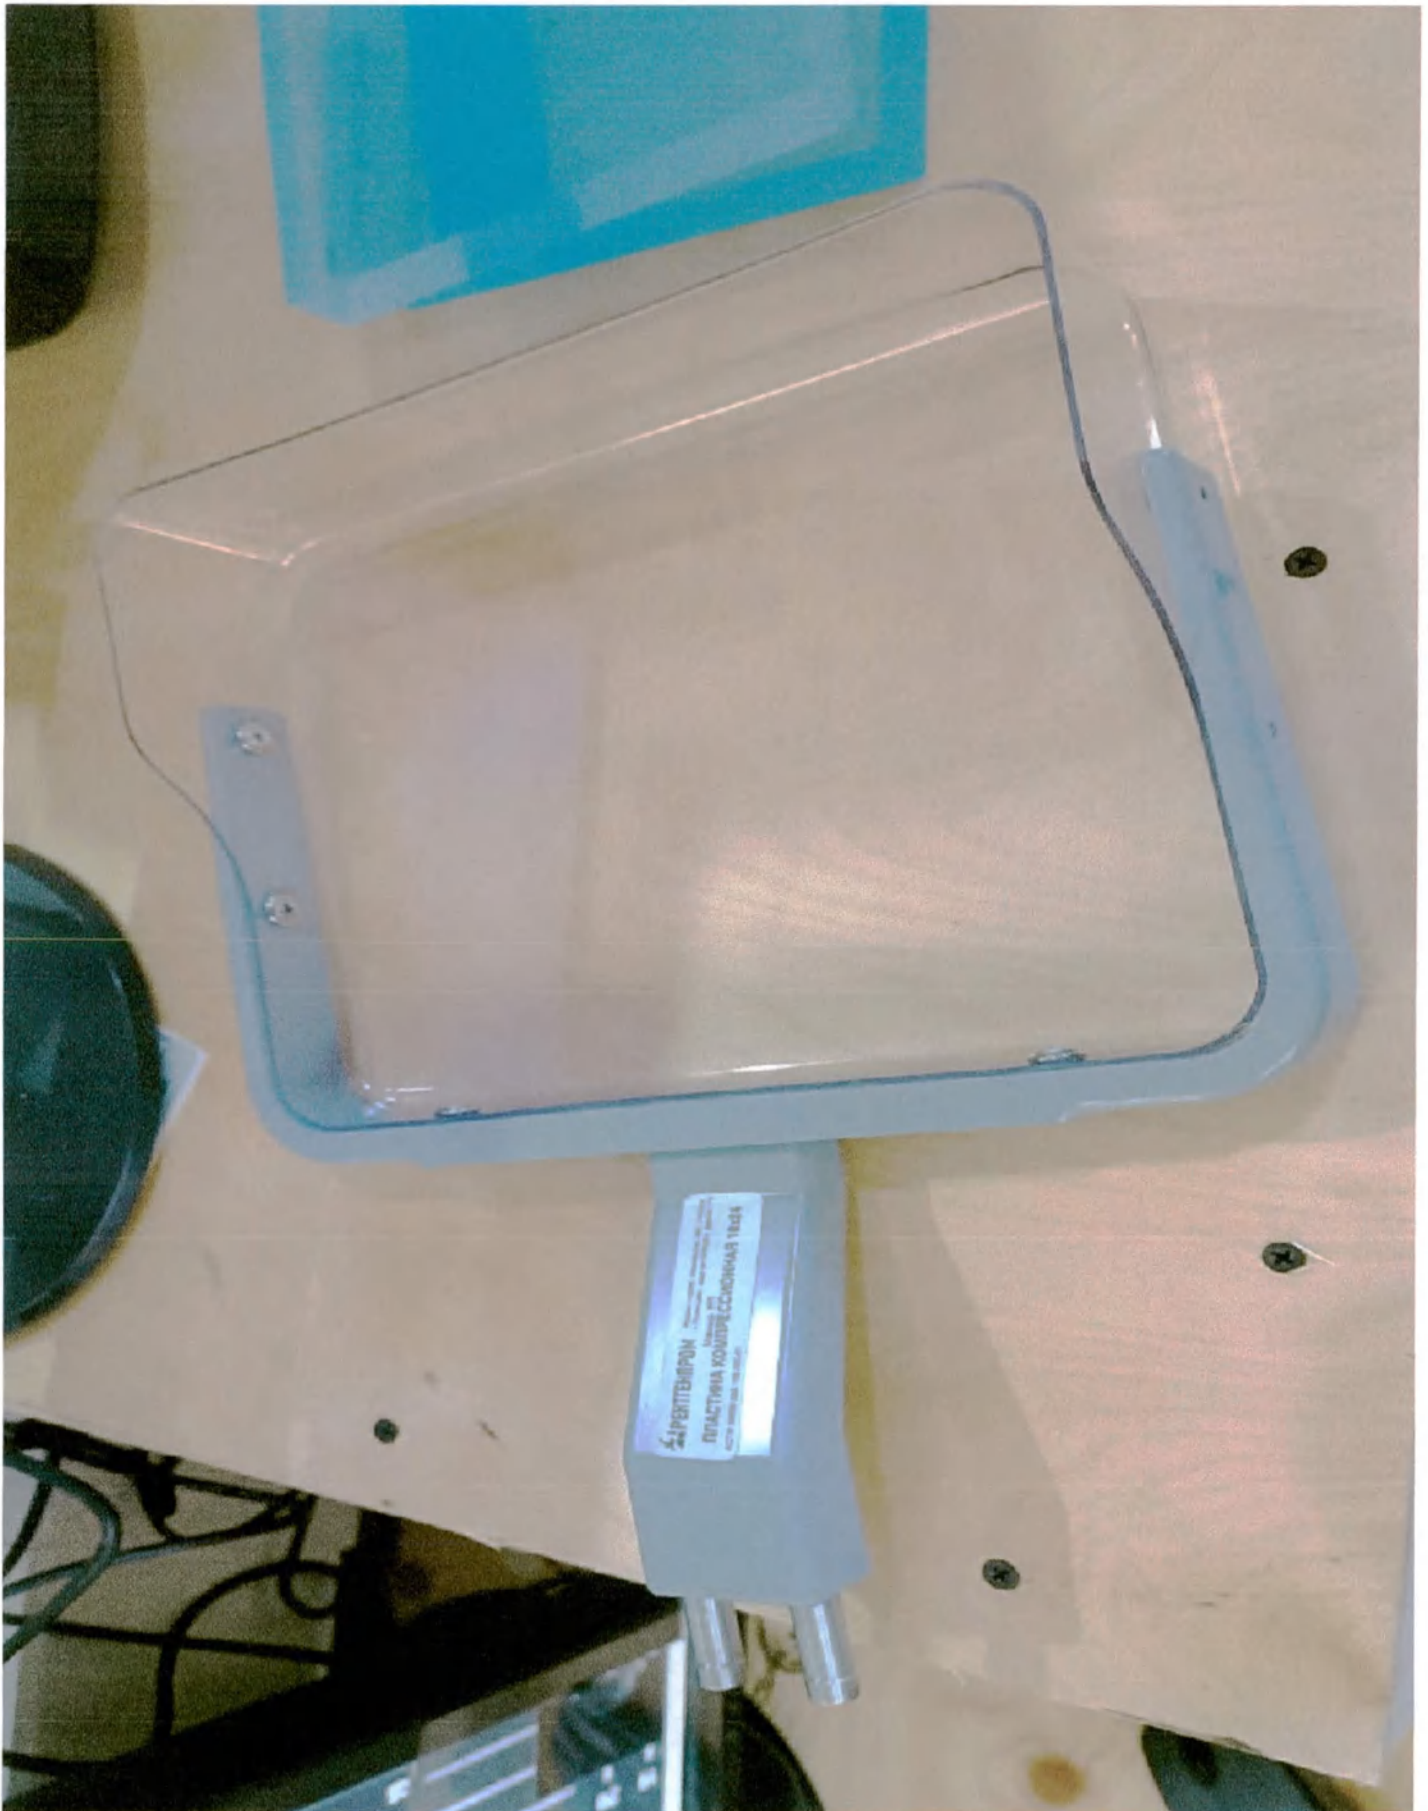

Маркировка пластины компрессионной 18x24





Маркировка пластины компрессионной 18х24, для аксиллярной проекции (правая)



Маркировка пластины компрессионной 18х24, для аксиллярной проекции (левая)



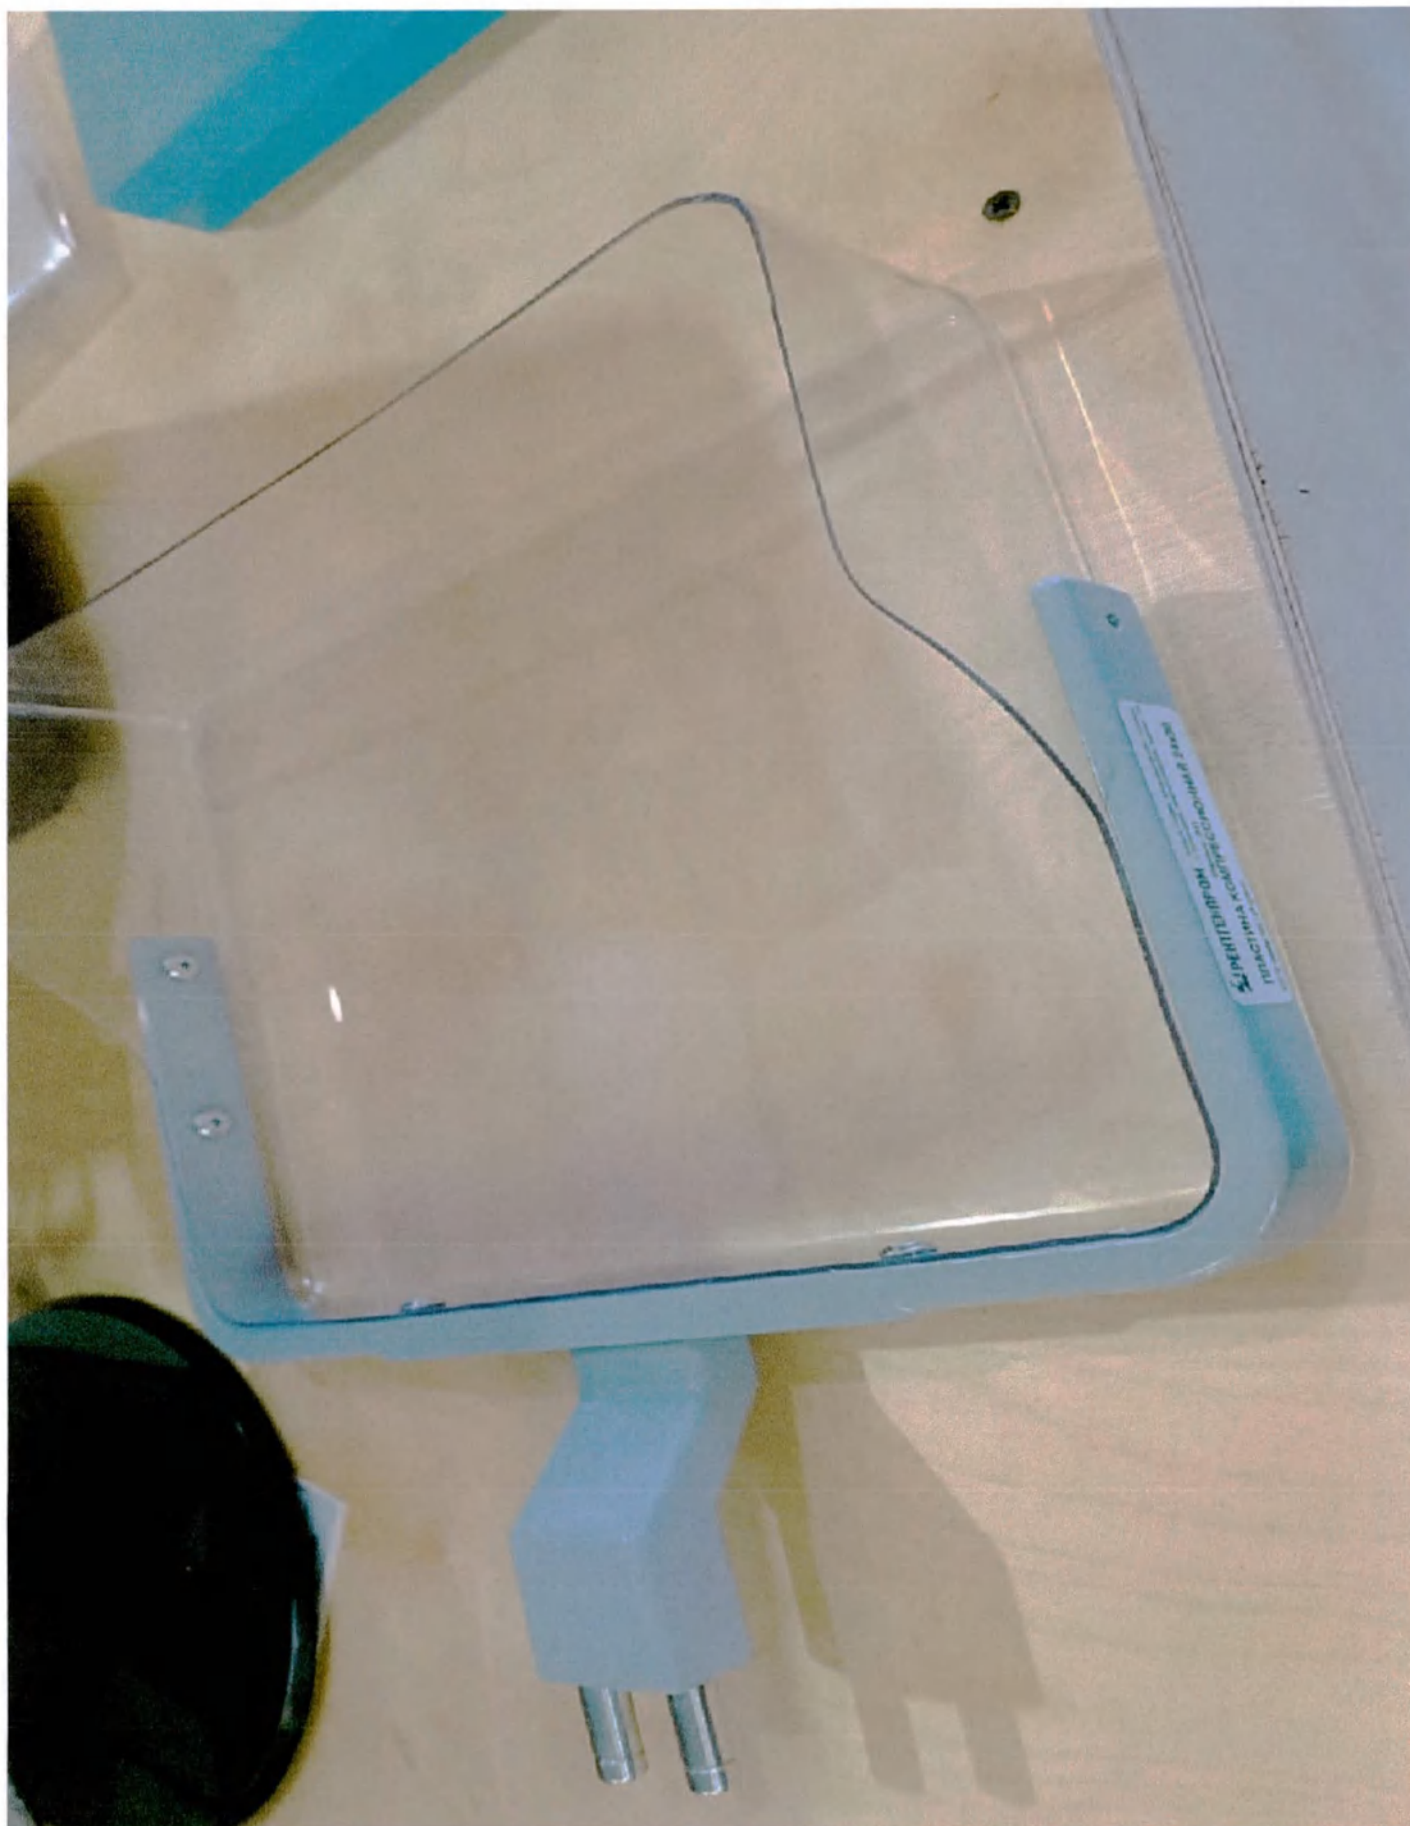

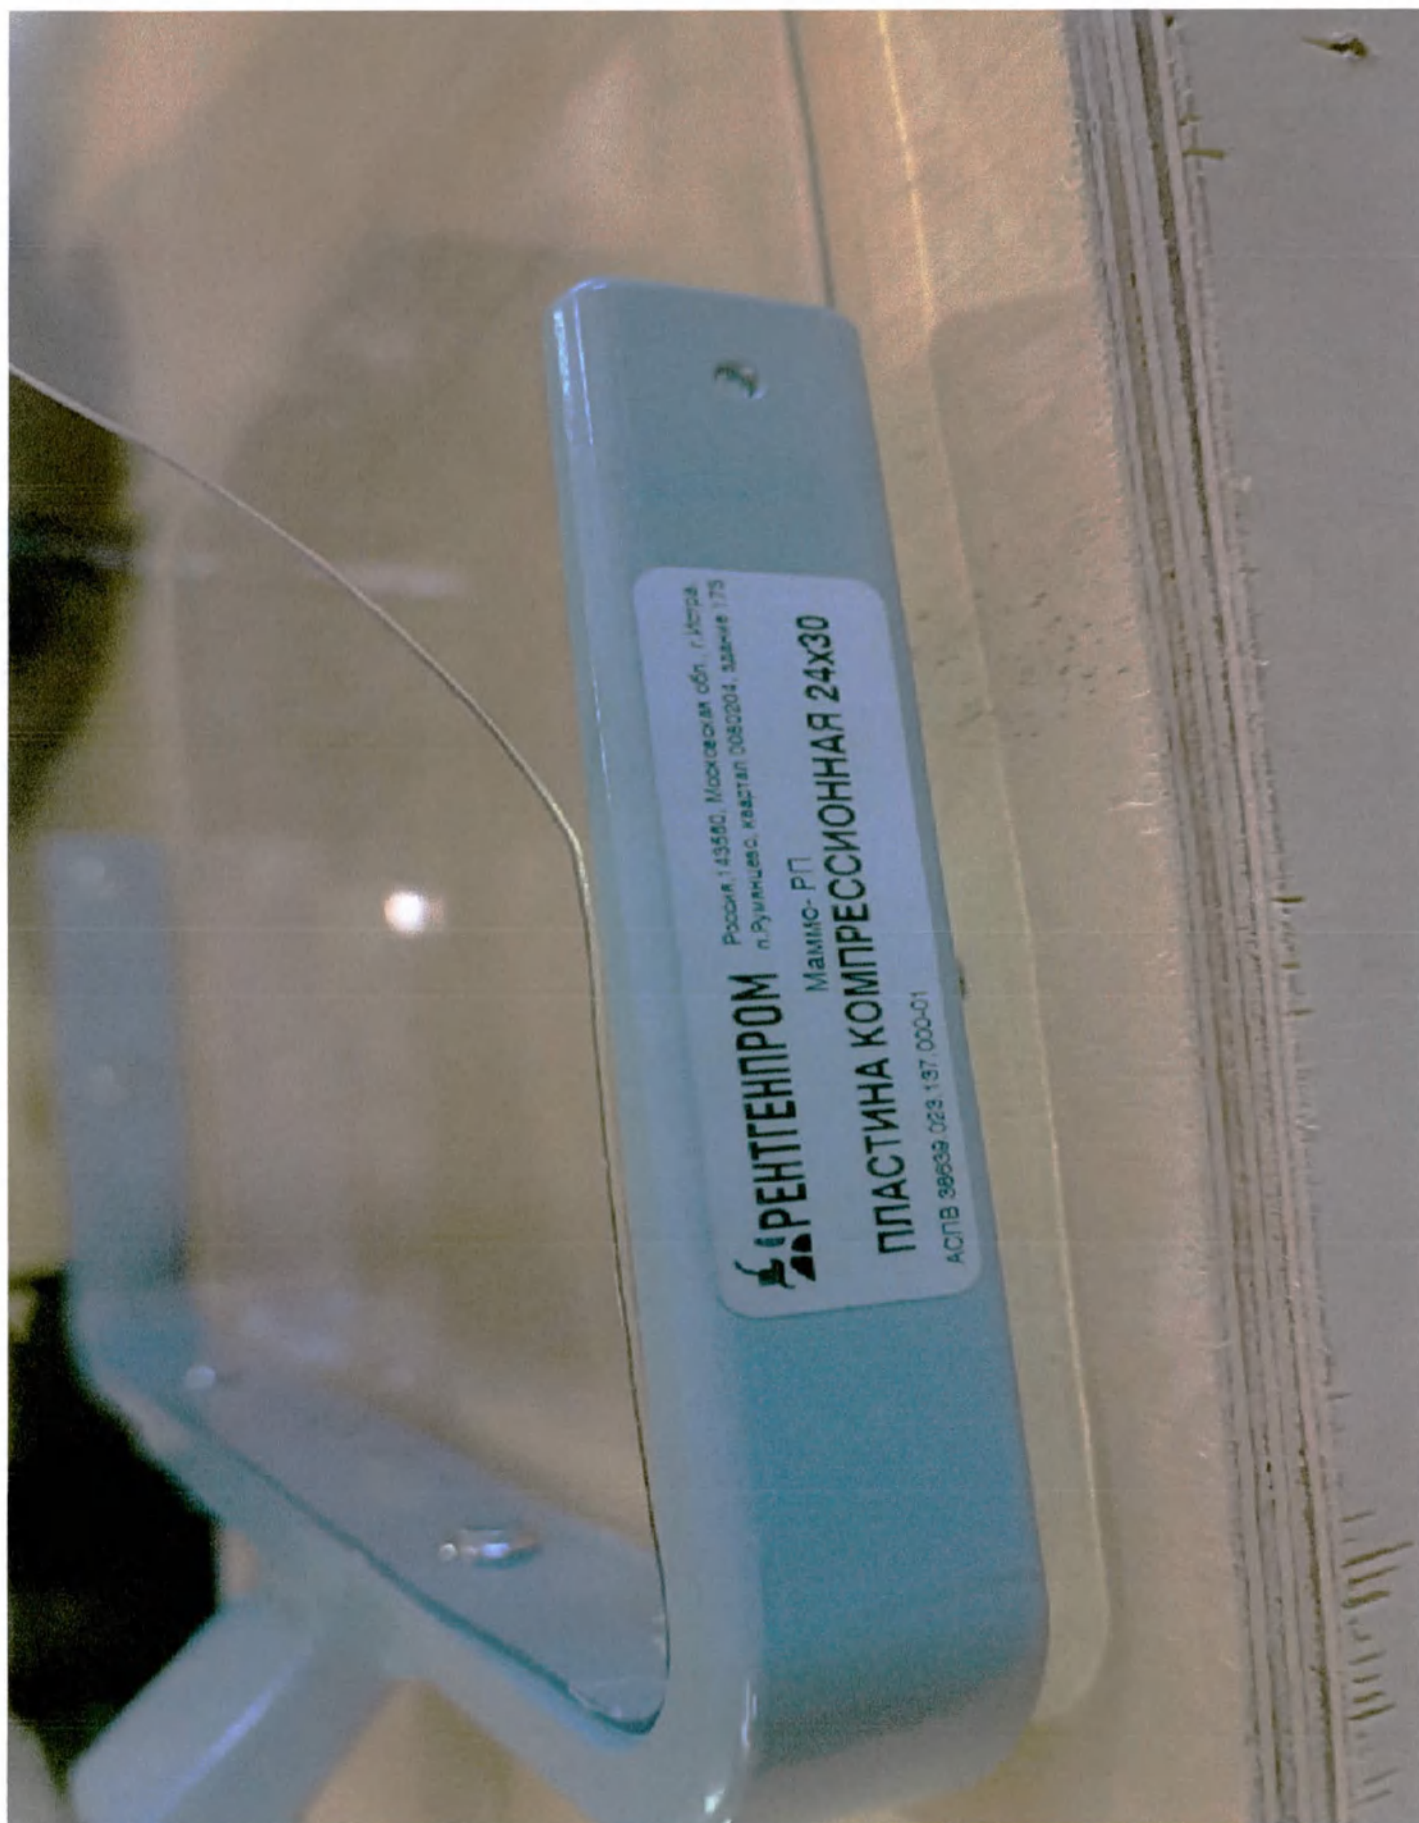










Маркировка пластины компрессионной увеличения



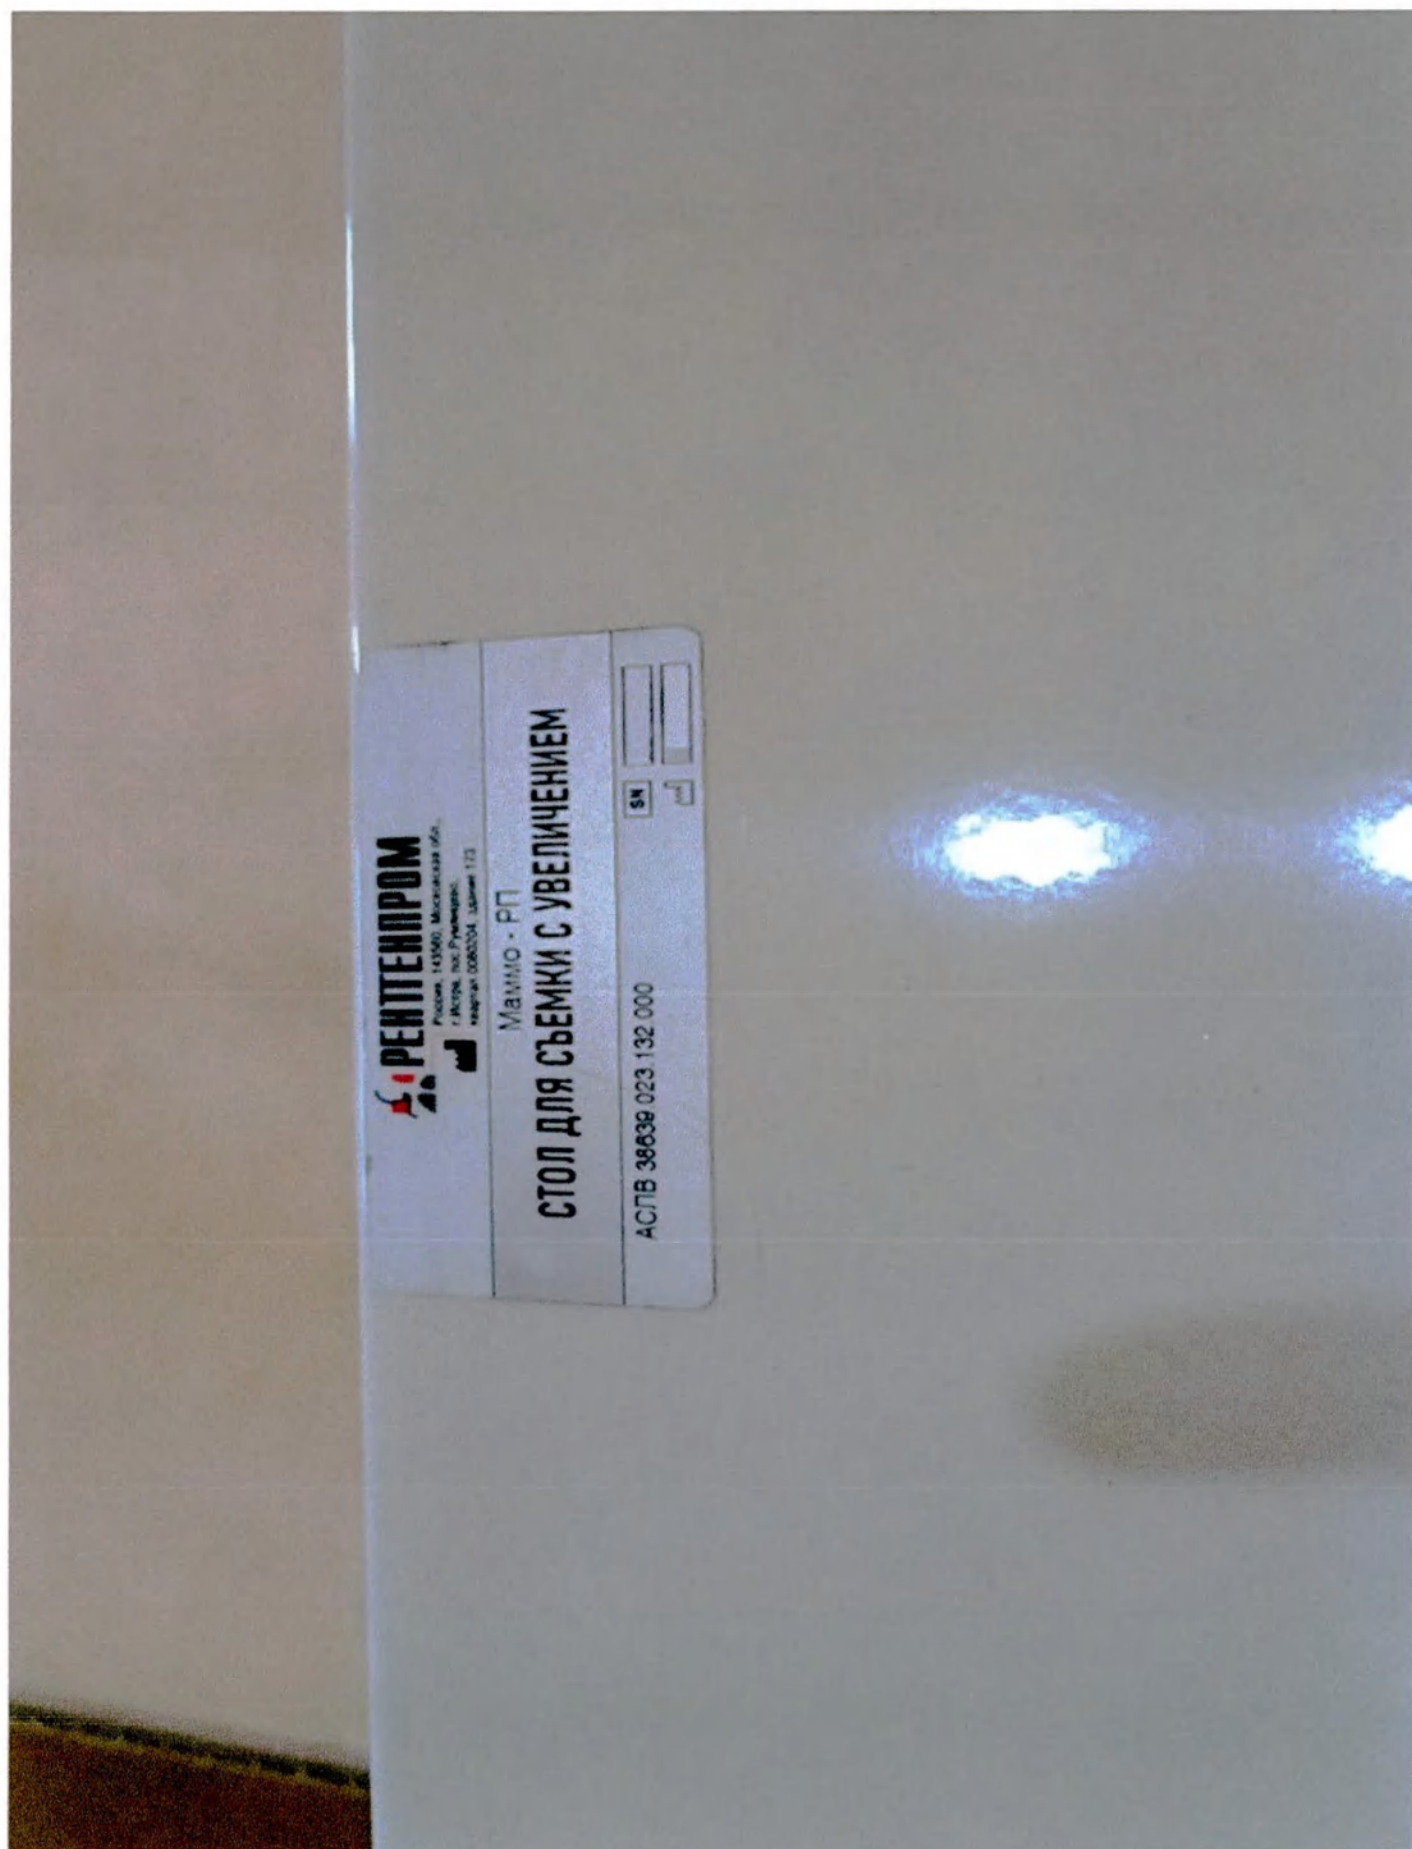









РЕНТГЕНПРОМ



Россия, 143560, Московская обл.,
г.Истра, пос.Румянцево,
квартал 0080204, здание 173


Маммо-РП

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

АСЛВ 38639.023.310.000


SN




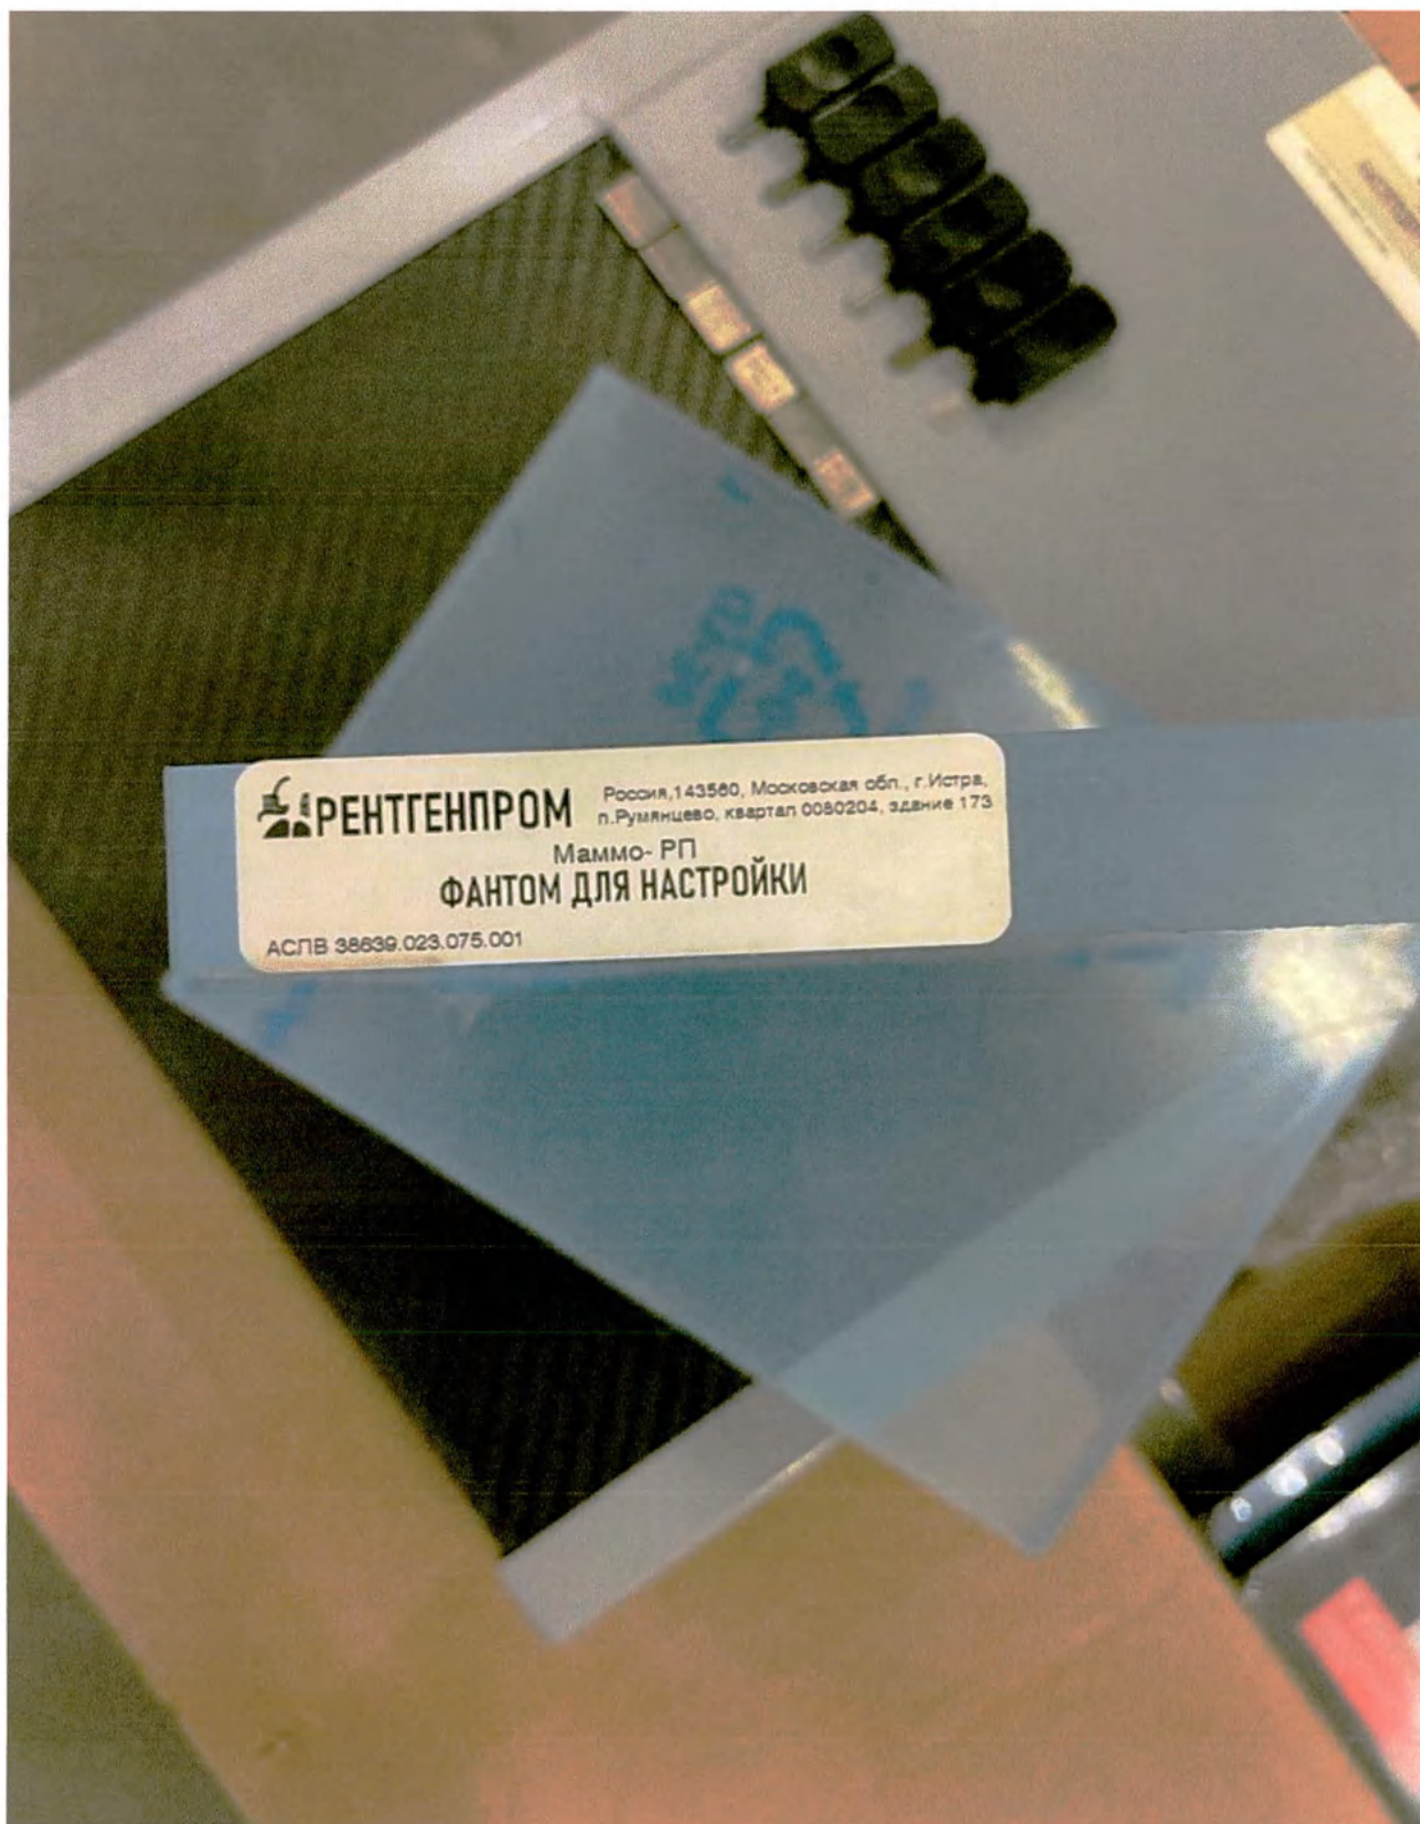

«ОПТИМАКС-АМИКО»



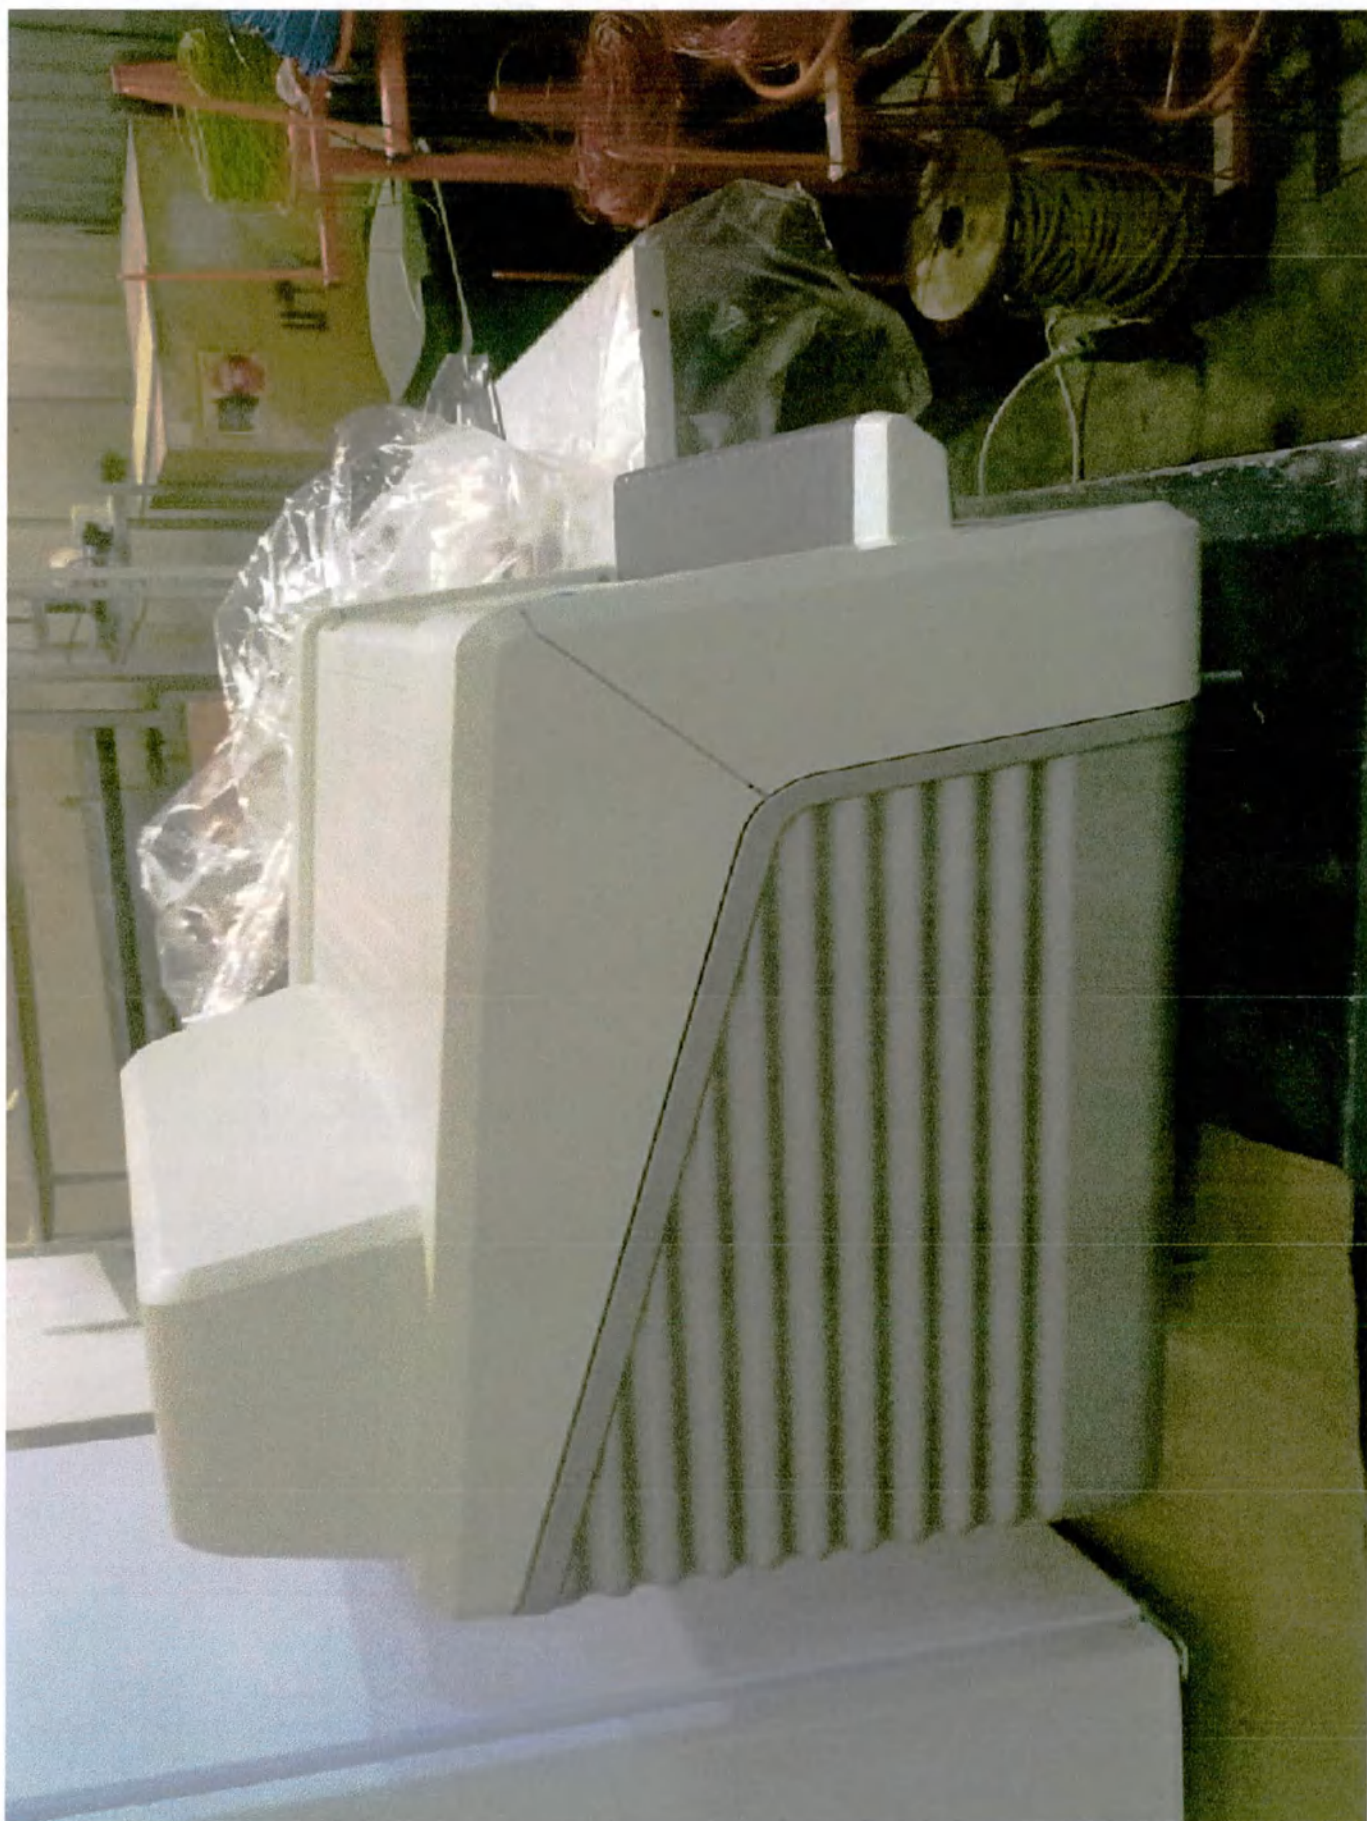

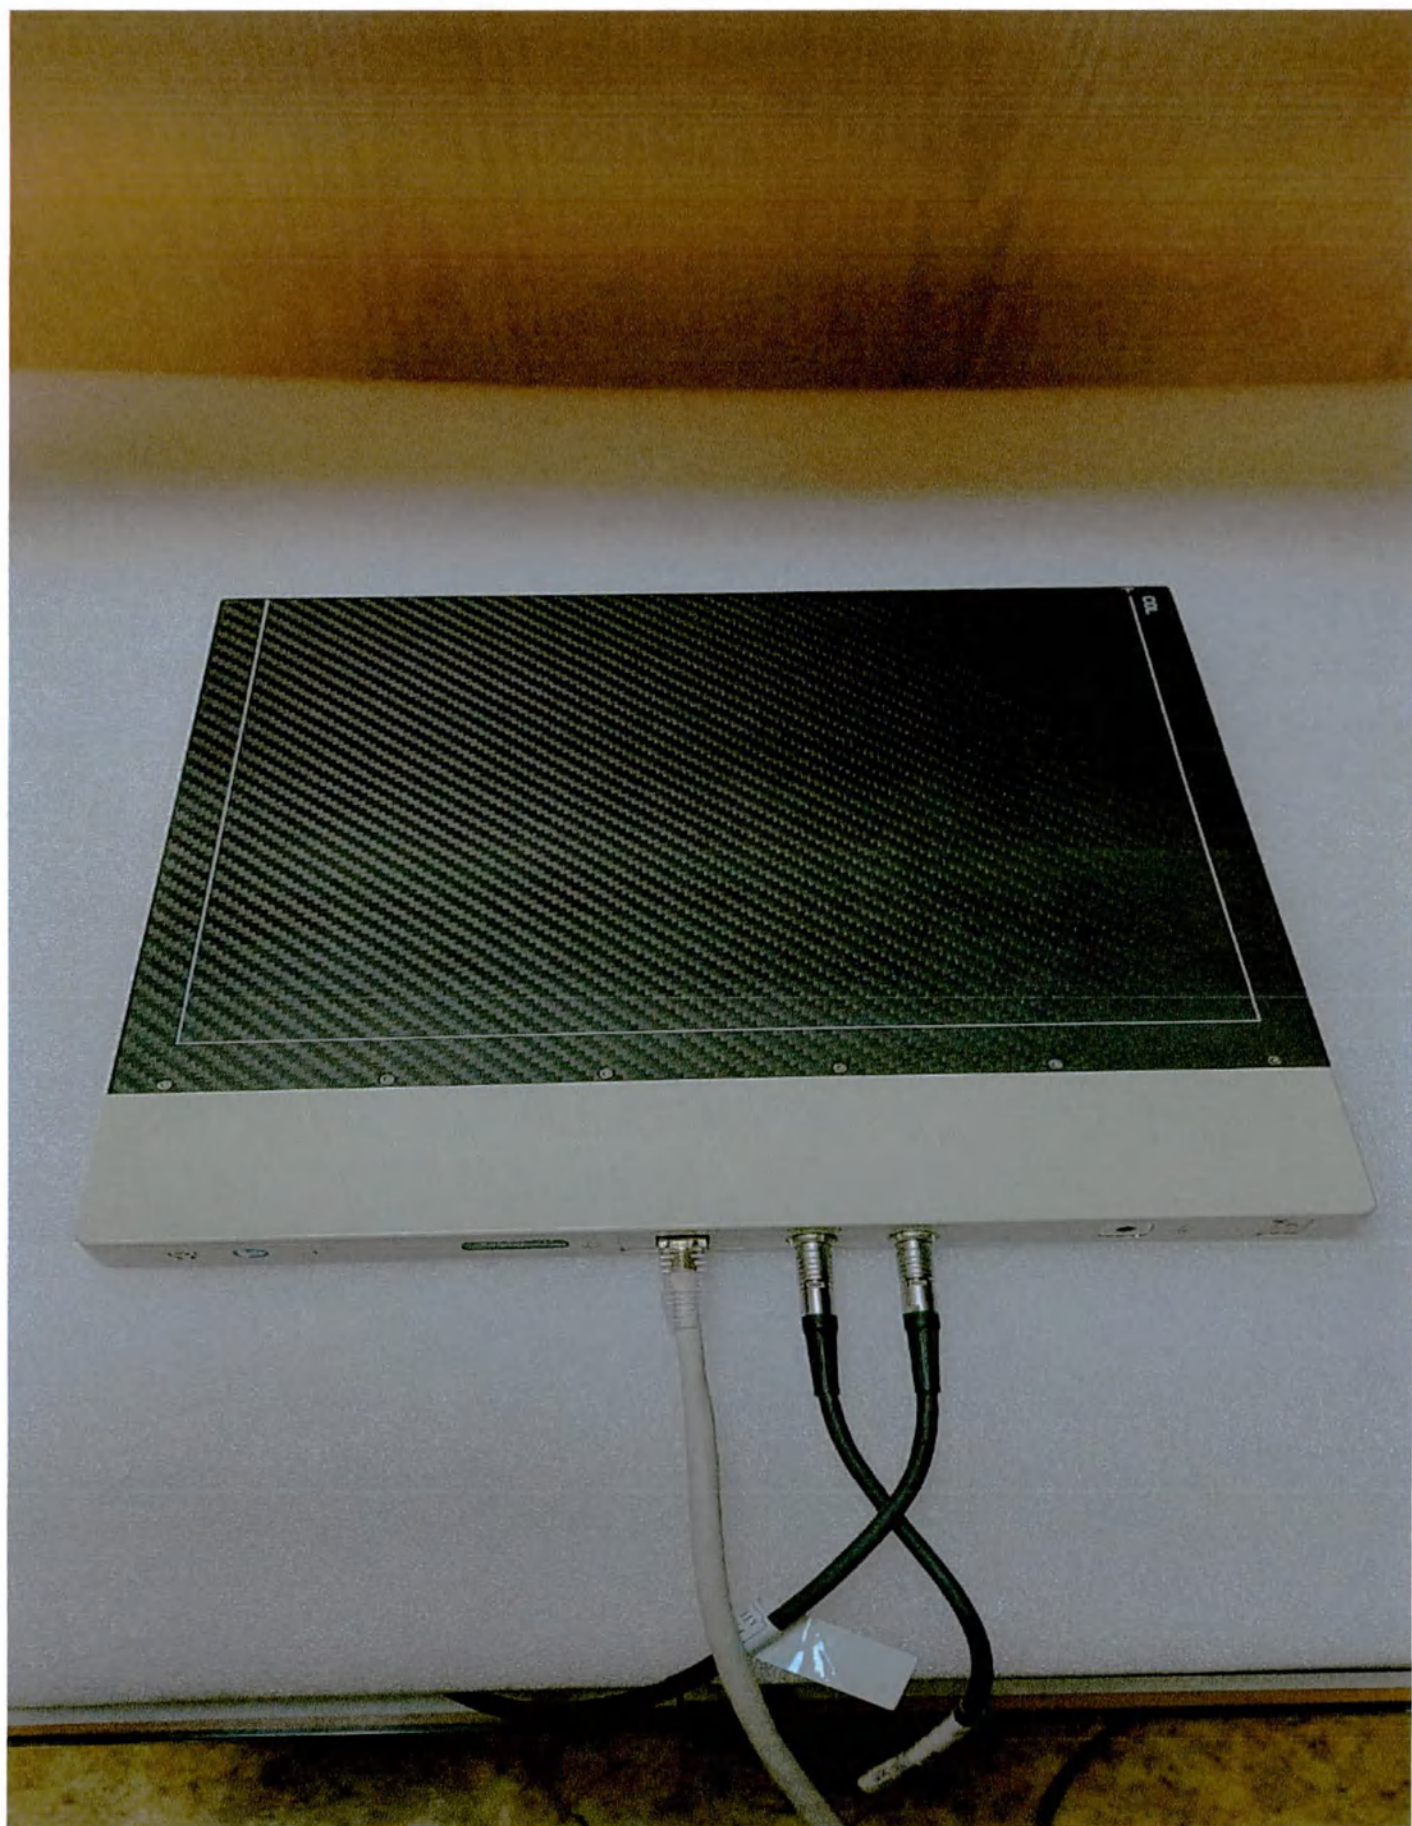

数字乳腺X射线平板探测器



产品型号: Mammo1012P

接入电源: 输入 24V $\pm$ 1.25A

配置型号: Mammo1012P - CSM

附属设备 Mammo1012X GB9706.24-2005



2022-05



奕瑞影像科技(太仓)有限公司
中国江苏省
太仓港经济技术开发区兴港路33号


Digital Mammography
X-Ray Flat Panel Detector



Model: Mammo1012P

Power: Input 24V $\pm$ 1.25A

Configuration: Mammo1012P-CSM




0197



2022-05




iRay Technology Taicang Ltd.
No.33Xinggang Road, Taicang Port Economic and
Technological Development Zone, Taicang, 215434
Jiangsu P.R. China
www.iraygroup.com



iRay Europe GmbH
In den Dorfweiden 14, 71720 Oberstenfeld Germany



41 36018501220002

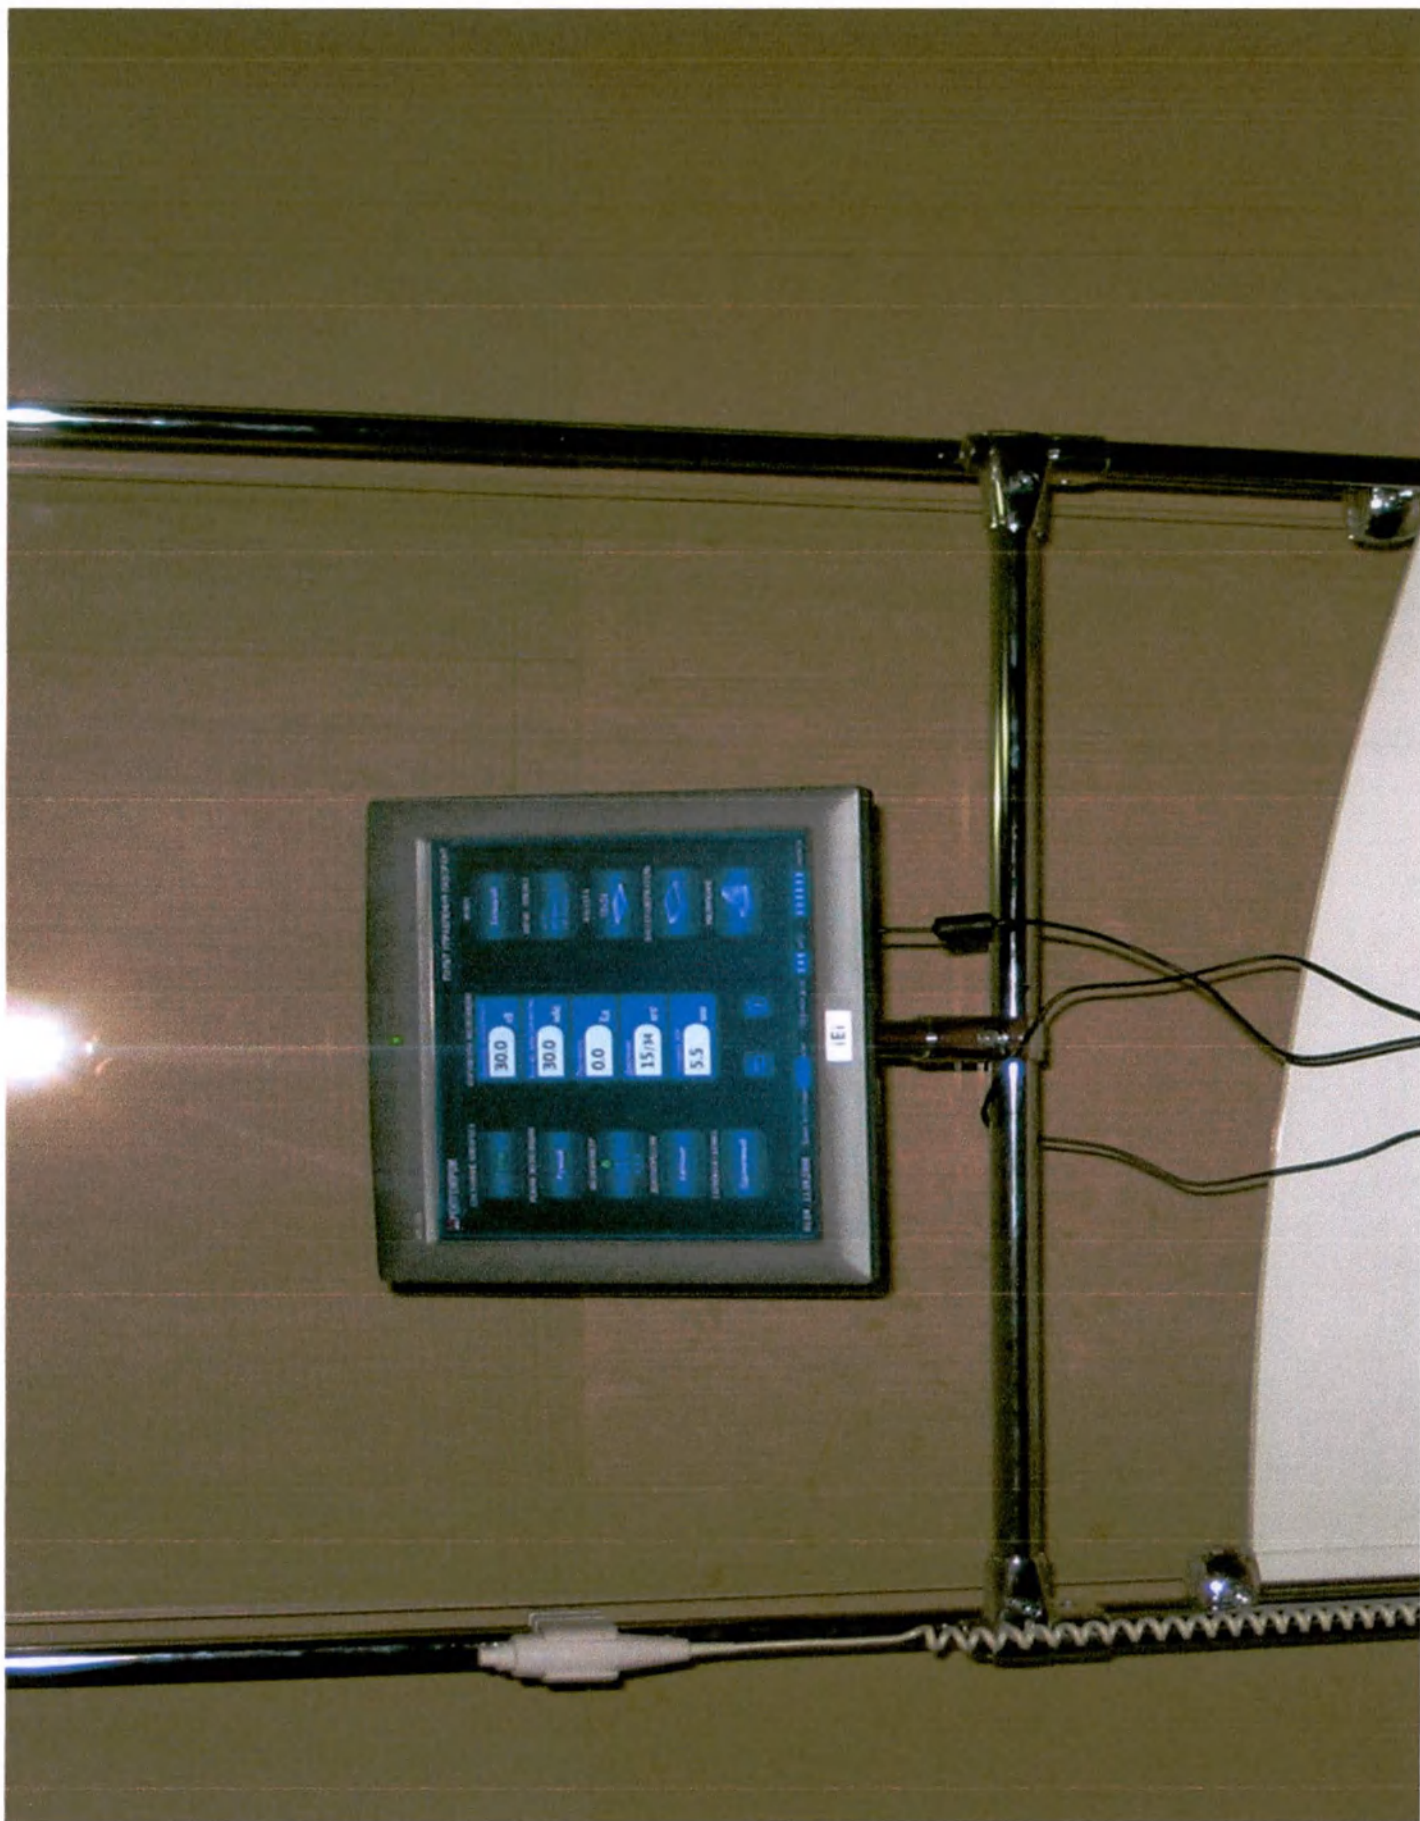



Набор мебели в составе:

Стол компьютерный ООО «Гранд», Россия или АСЛВ 38639.020. 77.00




Маркировка стола компьютерного ООО «Гранд», Россия или АСЛВ 38639.020.77.00



Россия, 143560, Московская обл., г. Истра,
п. Румянцево, квартал 0080204, здание 173

Маммо- РП
СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ




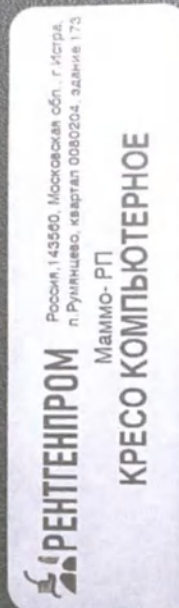



Маркировка автоматизированного рабочего места врача-маммолога (АРМ)



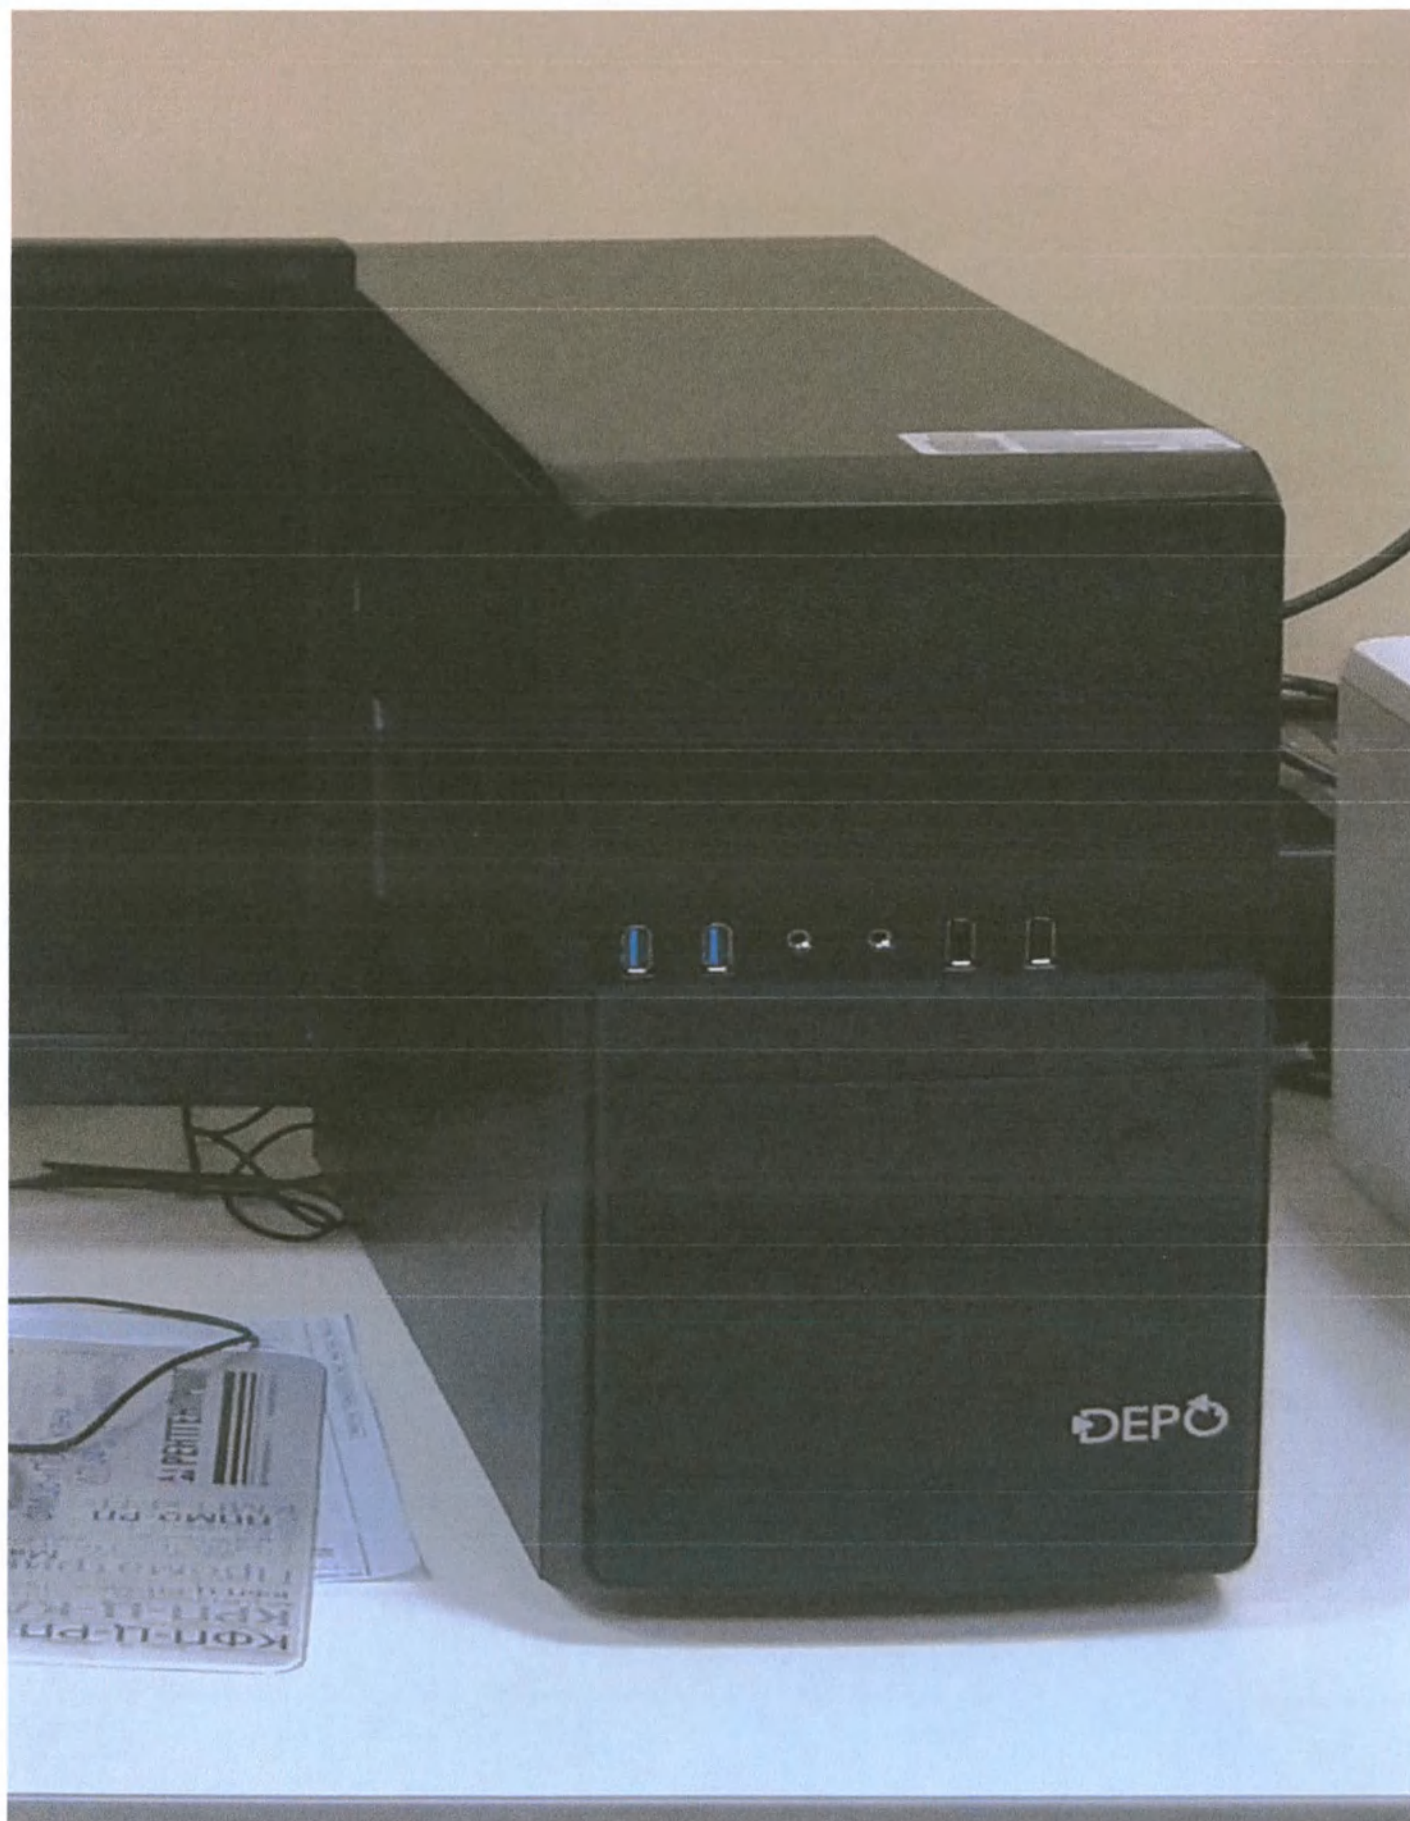



Системный блок: DEPO
Модель: Neos DH529
(1366385)

i3-10100/8GDDR4/T1Tb/T1Tb/DGLAN/KBu/Mu/400W/CAR3PCB

Сделано в России. ООО "ДЕПО Электроникс"

Питание: 220В 50Гц 3А

ДАЦН.466219.020 ТУ

Дата производства: 09/2022

Гарантия: 36 мес. CAR3PCB

*Профессиональное оборудование,
не предназначено для домашнего использования.*





S/N:491204-058







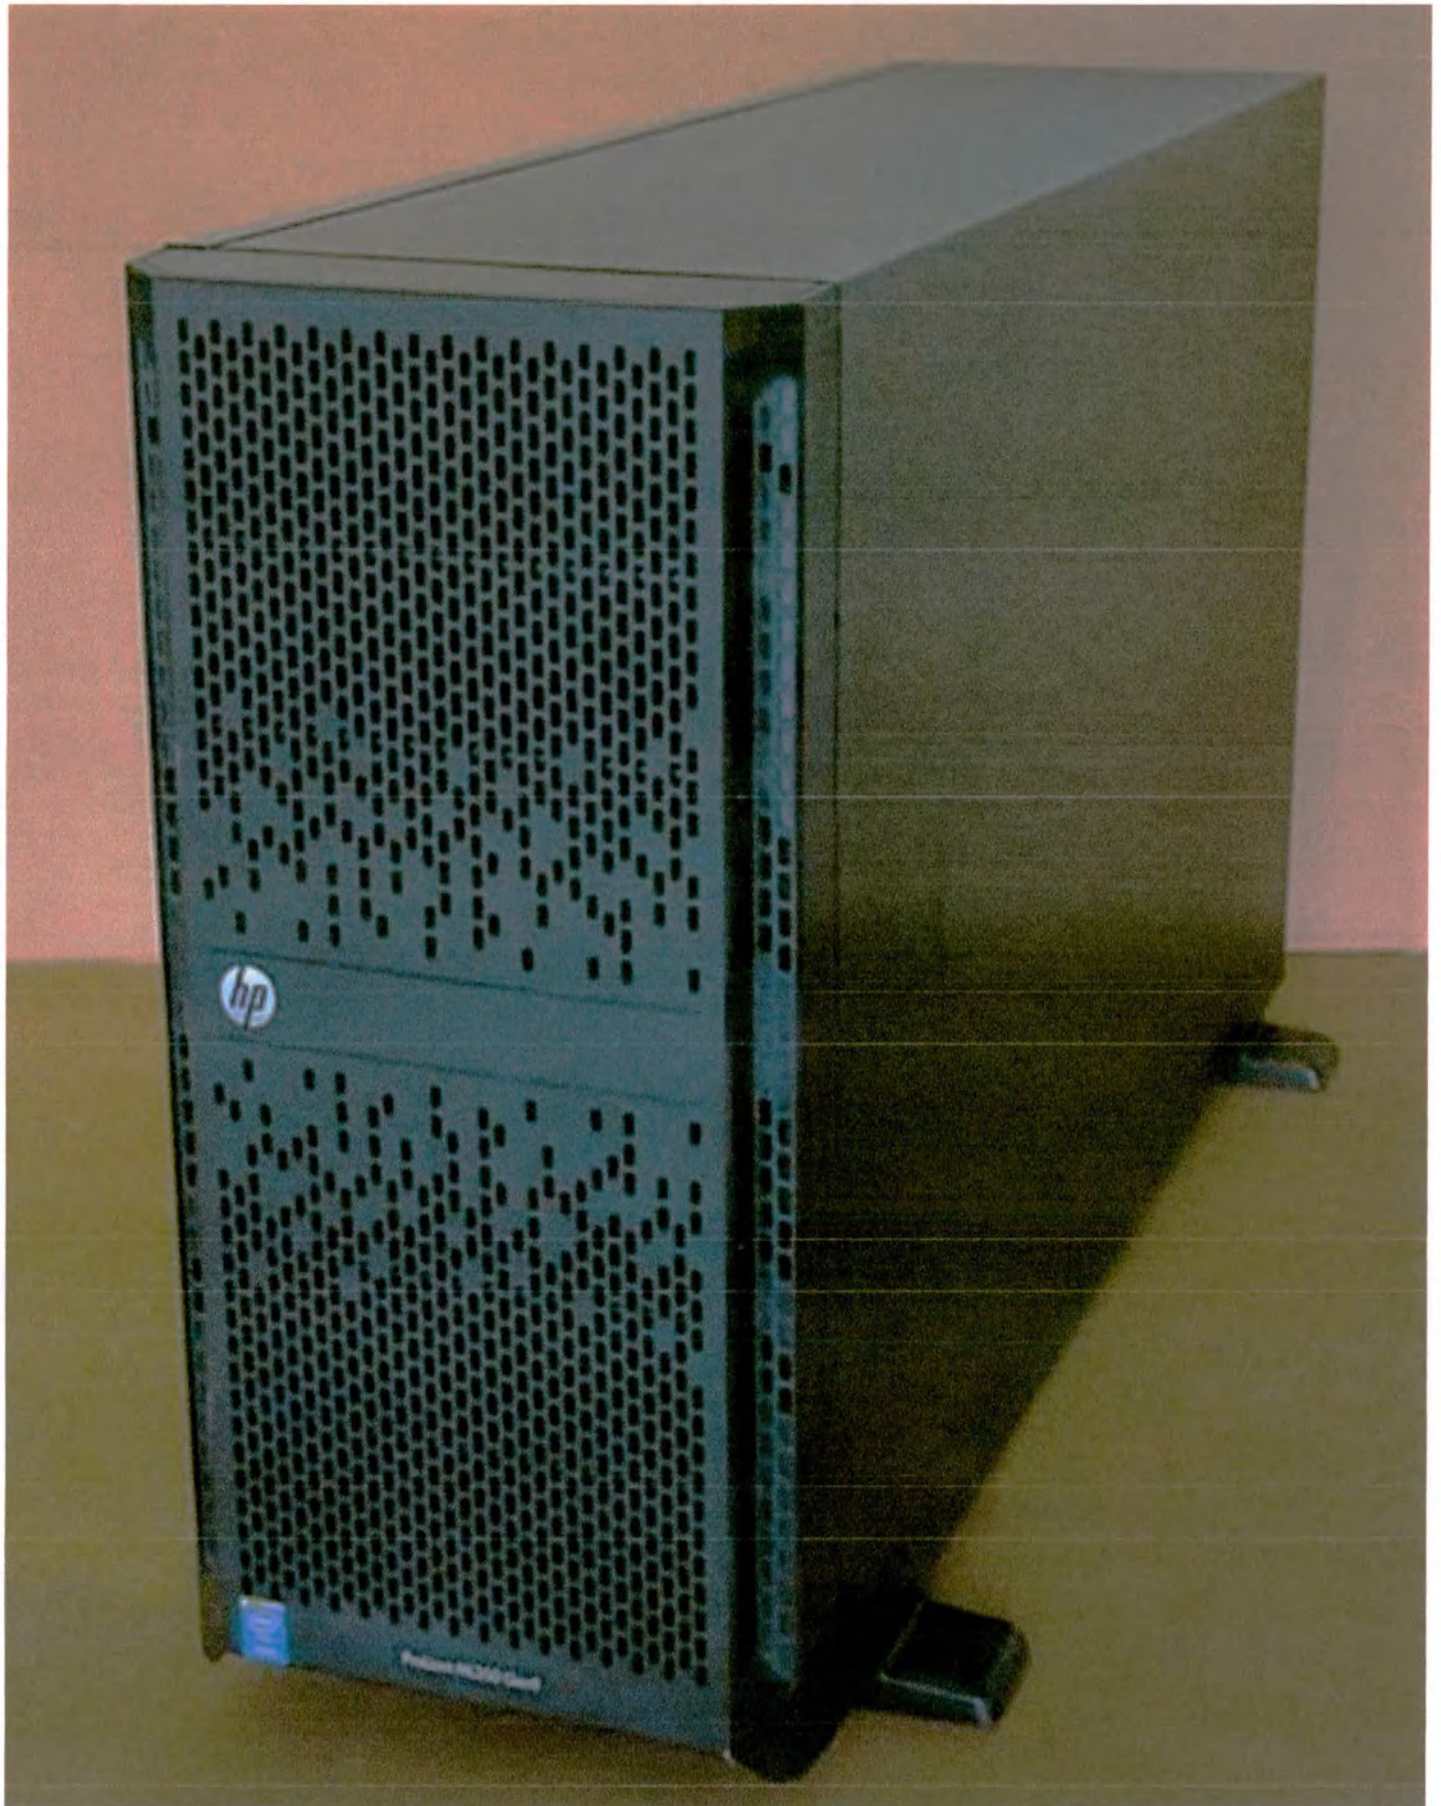


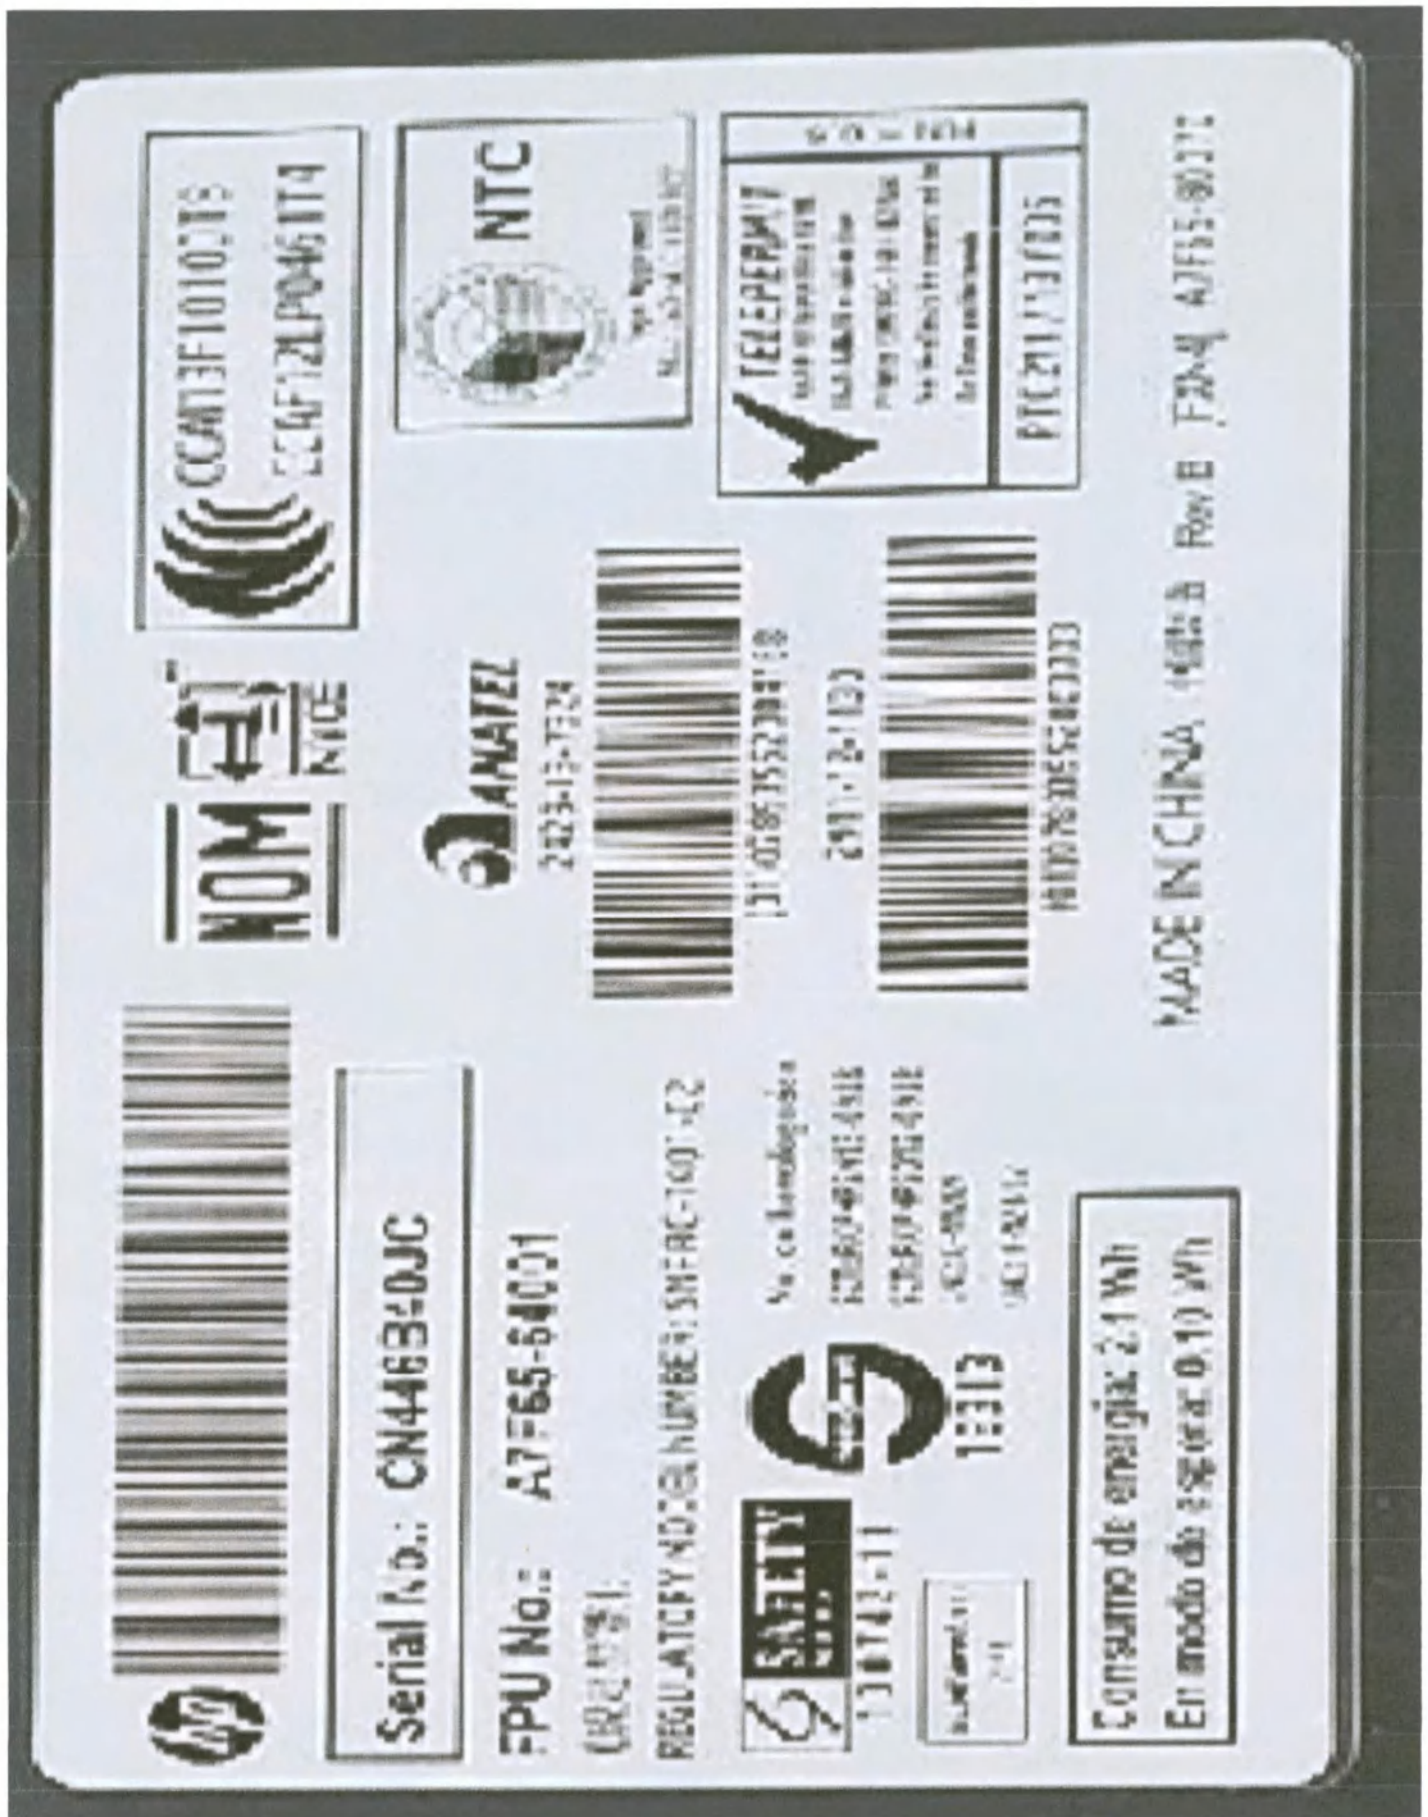







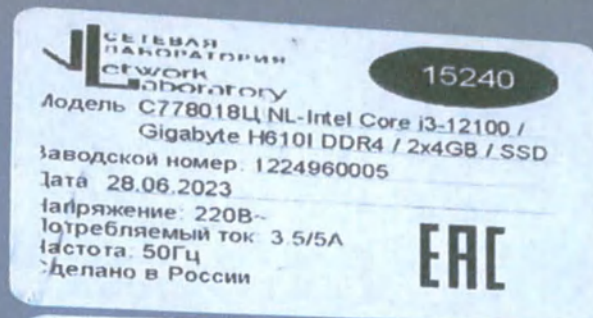

ВНИМАНИЕ!

Претензии по комплектации, начальной работоспособности, наличию внутренних повреждений и качеству предустановки системы рассматриваются только при опечатанном системном блоке.

Дополнительную информацию можно получить в сервисном центре продавца.



ViewSonic VA903m

LCD Display/L'écran ACL/液晶显示器/液晶显示器

MODEL NO/NUMÉRO DE MODÈLE/型号/型号: VS11372

INPUT/ALIMENTATION/输入/输入: 100-240V ~ 50-60Hz 1.2A

企业标准号: Q/WC 1-2005

WARNING: TO reduce electric shock, do not open this apparatus!

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired Operation.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Serial No:

Número de serie:

序号/外號:

Date of Mfg:

Date de fabrication:

制造年月/製造年月:



The lamp in this product contains mercury. Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.

中国总经销: 优派显示设备国际贸易(上海)有限公司
上海市外高桥保税区芬菊路308号10号厂房第一层西部位
ViewSonic Corporation, 381 Brea Canyon Road, Walnut, California 91789, USA

Fabrique en Chine/Made in China
中国制造/中国製造

F102506191A10 JL

NOM





BenQ Product Name: **LCD Monitor**
 Название продукта: ЖК-монитор

Model ID
 Код модели: **PD2720U-T** Type/Тип: **PD2720U**

Rating/ Рейтинг: **100-240V~,50/60Hz, 2A**

Mfg. Date/Дата изг.: **April 2019**

R e v. : **00-006-AL**

P / N : **9H.LHKLA.TBE**


S / N : **ET64K01611019**



Ergonomie
 Regelmäßige
 Produktions-
 überwachung
 www.tuv.com
 ID 0235004564



Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
 som giver forbindelse til stikproppens jord
 Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan
 Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
 Apparaten skall anslutas till jordat uttag



BenQ Corporation (16 Jihu Road, Neihs, Taipei 114, Taiwan / Тайвань)

Importer: BenQ Europe B.V. Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Eindhoven, The Netherlands

Made in China /Сделано в Китае

Q40G032N-881-28A YHH







SAMSUNG

LED монитор/LED монитор

Typ № / Тип №: S24F350FH

Өнім / Модель: S24F350FH

Өнімнің коды/Код моделі/Код модели: LS24F350FHXC

HDMI

Қуат көзі/Джерело живлення/Источник питания:

Тұрақты ток/Постійний струм/Постоянный ток 14V(B)  1.78A

IP 20 Дерезелі құрал-жабдық III/Обладнання класу III/Оборудование класса III

Өндіру мерзімі/Дата виготовлення/Дата изготовления: 2018.05.

Қытайда жасалған. Өндіруші-зауыт: «ДонгГуан РИСАН
Электроник Ко., Лтд.» / Вироблено в КНР на потужностях.

«Дунгуань РИСАН Електронік Ко., Лтд.» / Произведено в КНР.

Завод-изготовитель: «ДонгГуан РИСАН Электроник Ко, Лтд.»



Сериялы нөмірі/Серійний номер/Серийный номер: ZZMTH4ZK502097T





Нұсқа №/Версія/Версия:

BB03

BN68-07103B-00



AOC



LCD MONITOR/液晶显示器/液晶顯示器/모니터

Product Name/Nama Produk/機種名/機種名/모델명:

Q2963PM

Model No. 型号/型號/모델명:

290LM00001

Power Rating/Tegangan/额定电源/額定電源/정격입력:

19V = 3.42A

福建捷联电子有限公司

福建省福清市元洪路上鄭

福建捷聯電子有限公司

福建省福清市元洪路上鄭

제조업체명: TPV Electronics(Fujian) Co., Ltd.

Shangzheng, Yuanhong Road

Fuqing, Fujian, China

Warning: Shock Hazard, Do Not Open.

高压注意: 非专业维修人员请勿打开后盖

高圧注意: 非專業維修人員請勿打開後蓋

판매처: (주)알파스캐디스플레이

제조A/S 문의처: 1544-7739



Marubeni



KCC-REM-TPV-290LM00001



007

002



This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

HGCGS56BEQK2DN

Serial No.: **FQZD2JA000357**

Manufactured: February 2013



4 038986 182140

For applicable power supplies see user manual

AOC International

Europe B.V. Amstelgebouw

6th floor Prins Bernhardplein

200 1097 JB Amsterdam

The Netherlands

www.aoc.com


Made in China/Buatan China

제조국: 중국/中國製造/中國製造

Q40G029E-615-01A XY

Маркировка монитора «TPV Electronics Co.», Китай



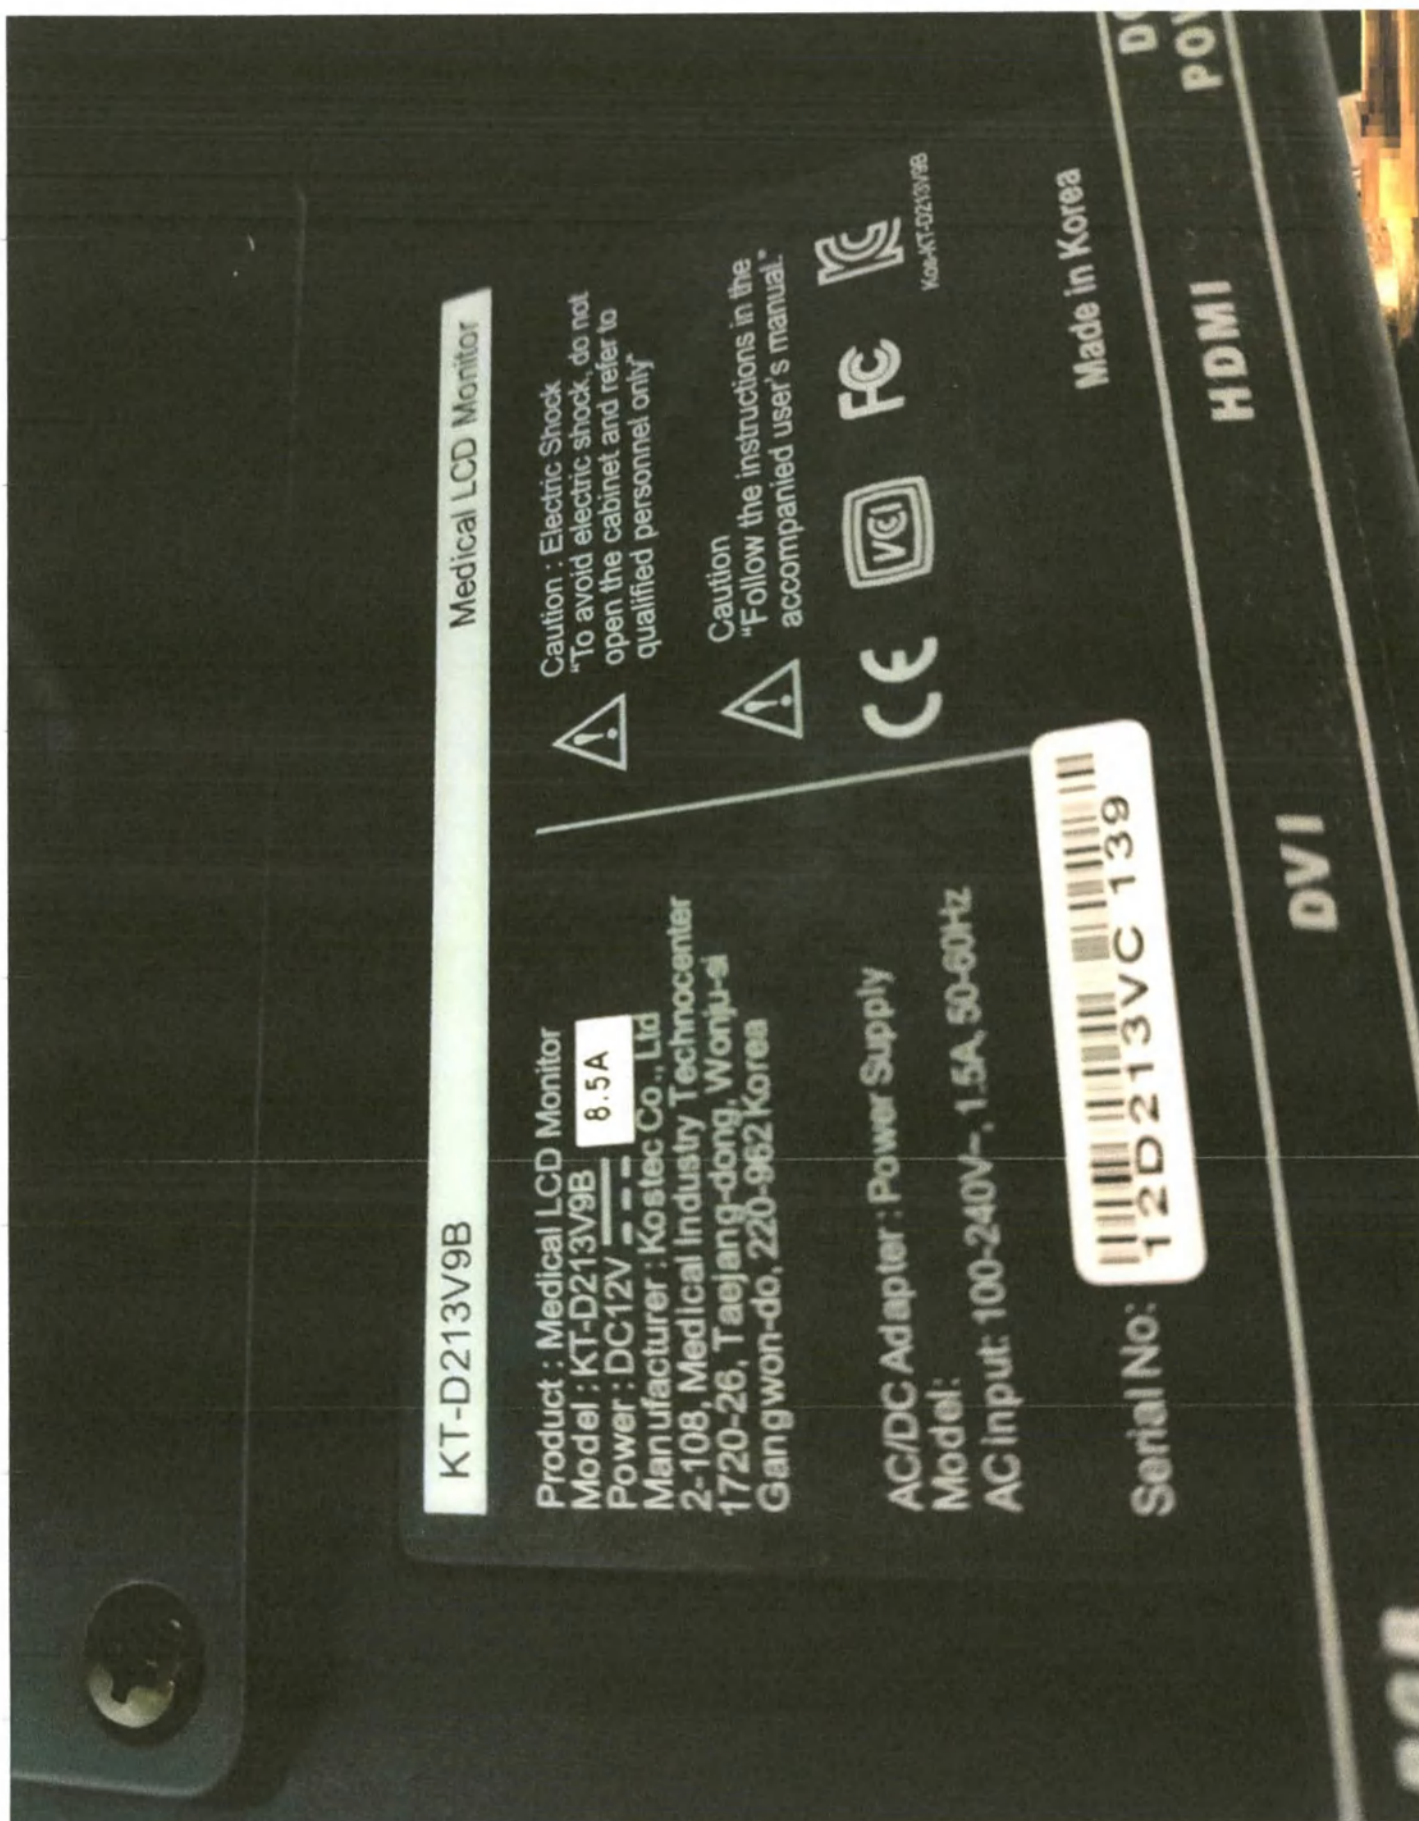





To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

FCC Verified : Class "A"


This device complies with the Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

警告使用者:

此為電腦資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

MPDP

- Monitor/모니터/Плазменный цветной/Плазменный катаросый монитор
- Model Name/모델명/Модель: OPM-4260
- Voltage/전압/Напряжение : 100 - 240V~ / 100-240 B~
- Current/전류/текущий : 4A
- Frequency/주파수/Частота : 50/60Hz / 50/60 Гц
- Manufacture/제조사 : Orion Co., LTD (주)오리온
- Serial No./제조년월 :



ORION CO., LTD.

韓國製造 / Made in Korea / Сделано в Корее /
Зроблено у Кореї / Кореяда жасалган

사용상의 주의사항

- 감전사고 예방을 위하여 덮개를 열지 마세요.
- 내부에는 소비자가 수리할 수 있는 부분이 없으므로 고장은 서비스센터로 연락 바랍니다. 서비스센터 : 024-660-5997

PC



IN



OUT

DVI-D



IN



OUT

RS-232C



IN




OUT





Монитор жидкокристаллический медицинский цветной «Нанкин Цзюйша Дисплей Технология Ко., Лтд.»
(«Nanjing Jusha Display Tech-nology Co., Ltd.»), Китай

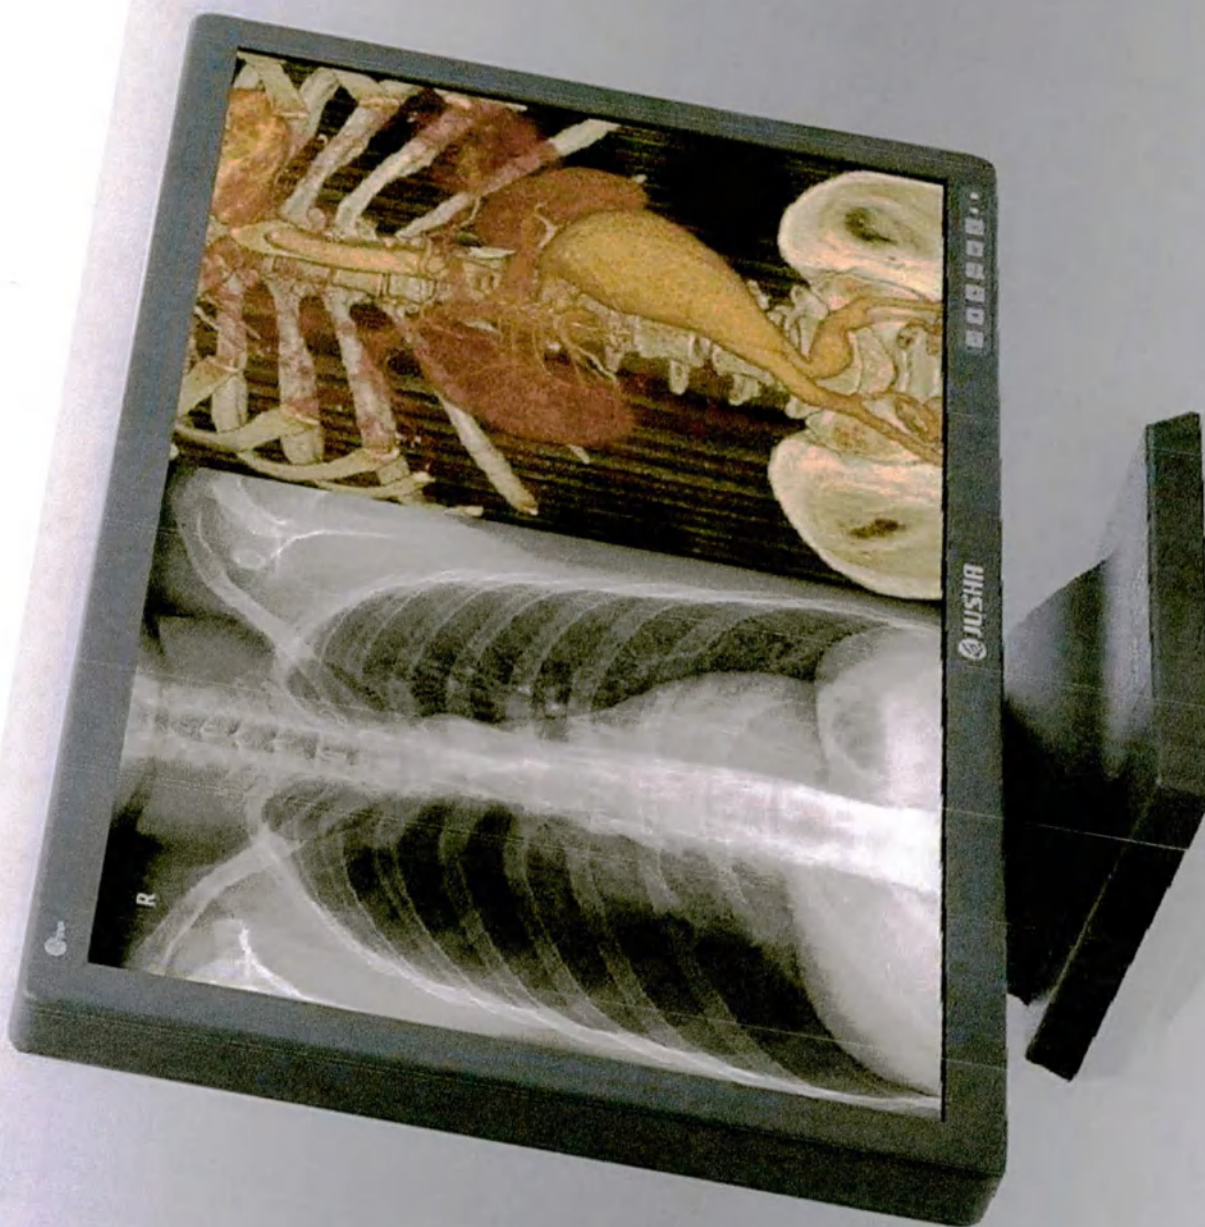






Маркировка монитора жидкокристаллического для визуализации в радиологии «ВАЙД Корпорейшн»
(«WIDE Corporation»), Корея



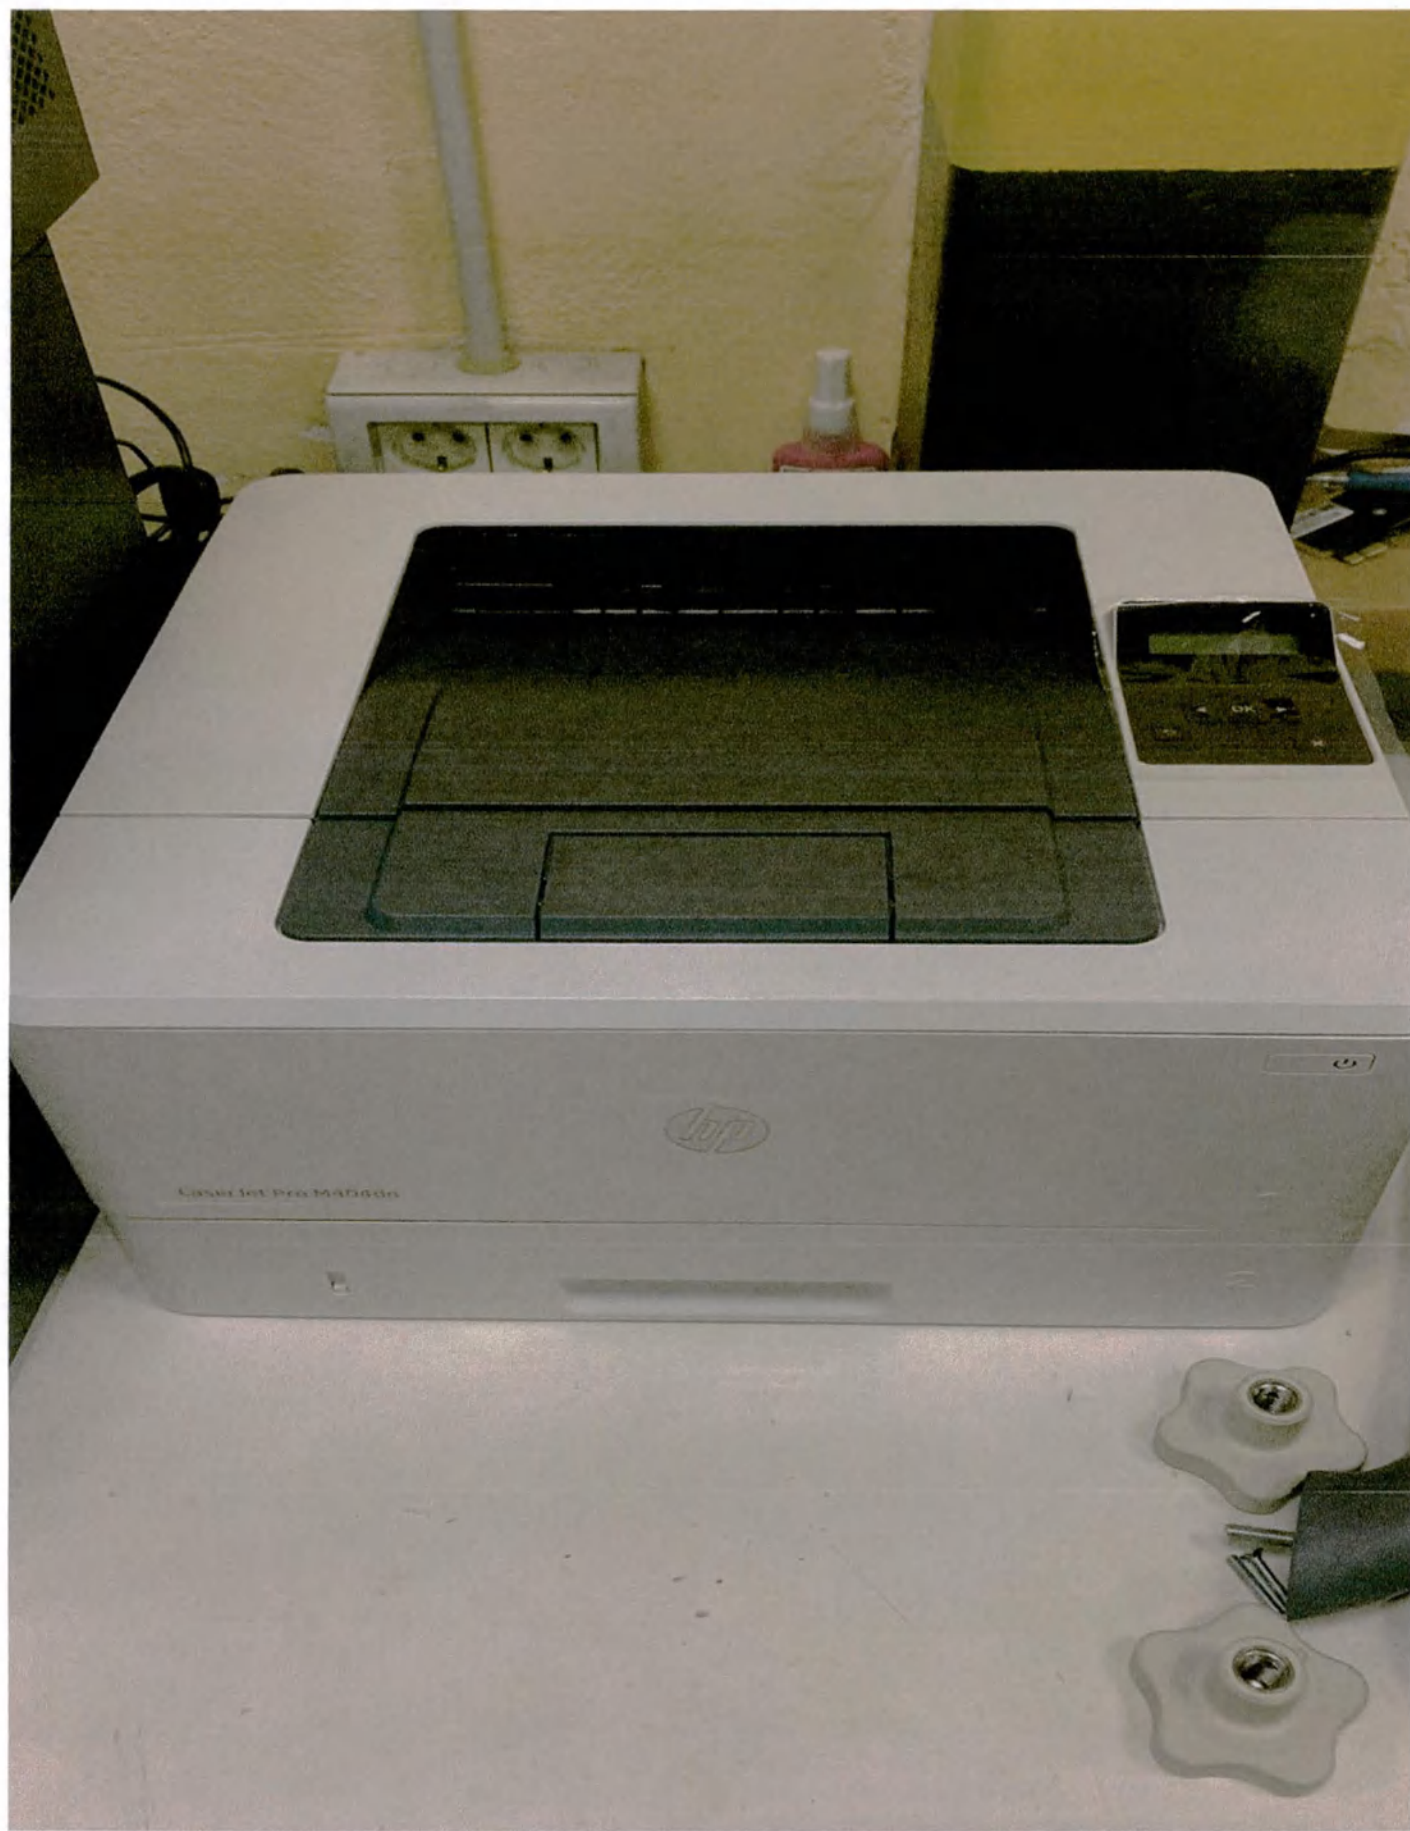



Serial No. **PHFMH39244**

Número de Serie

Número de Producto

Product No. W1A53A



Made in Philippines

Hecho en Filipinas

Regulatory Model Number

SHNGC-1800-00



220-240V ~AC
50/60Hz, 3.4A

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated June 24, 2007.

For FDA: HP Inc., No. 2727 Jinke Road, Shanghai, China 201203

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.



www.tuv.com
ID 0000051214



UK
CA

HP Inc UK Ltd, Regulatory
Enquiries, Earley West,
300 Thames Valley Park Drive,
Reading, RG6 1PT

SITE:PH1 >PET<




HP, HQ-TRE
71025 Boeblingen
Germany

0ND2







Xerox (UK)
Oxford Road
Uxbridge UB8 1HS

Complies with FDA performance
standards for laser products except for
deviations pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007



Serial No.: 3228156069

Phaser™ 3020

Volts: AC 220-240V
Hertz: 50/60Hz
Amps: 2.5 A
Manufactured: APRIL 2017



052



www.tuv.com
ID 1419037221



Made in China

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla
varustettuun pistorasiaan.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.







SAMSUNG

**Лазерный принтер
Лазерний принтер**

Модель : Xpress M2020

Напряжение/напруга: 220-240~ В

Частота/частота: 50/60 Гц

Ток/струм: 2.5 А

Произведено / Вироблено : 08.02.2017

Класс защиты / Клас захисту : I

М/С : SL-M2020/FEV



Серийный номер/Серійний номер: 07VFB8GJ2B007JL



CE EAC



CLASS 1 LASER PRODUCT

Сделано в Китае/Вироблено в Китаї
REV. 00 / Версія 00






Canon 激光打印机 L11121E

220-240V

50/60Hz

3.3A



MANUFACTURED: July 2008

CANON INC.
30-2, SHIMOMARUKO, 3-CHOME,
OHTA-KU, TOKYO, JAPAN

THIS PRODUCT CONFORMS WITH DHHS
RADIATION PERFORMANCE STANDARD,
21CFR CHAPTER 1 SUBCHAPTER J.

CANON INC. MADE IN
CPPC RUS

制造商:佳能公司
日本国东京都大田区下丸子3-30-2

中国制造



ECOSYS P2040dn
 Printer 220-240 V~ 50/60 Hz 4.2 A

CLASS 1 LASER PRODUCT
 KLASSE 1 LASER PRODUKT

SAFETY MARK
 160040-17

Apparatet må tilkoples jorden stikkontakt.
 Apparatet skall anslutas till jordet uttag.
 Laite on liitettävä suojakoskettimillä varustettuun pistoraasiaan.
 Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

CE **EMC** **RoHS** **GS** **REACH** **WEEE** **DO NOT DISCARD IN THE WASTE** **www.kyocera.com** **01-41962213** **>ABS<**

KYOCERA Document Solutions Inc.
 2-26, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka, Japan
 Designed in Japan / Assembled in Vietnam

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 1, 2132 NP, Hoofddorp The Netherlands


Устройство для печати монохромных медицинских изображений

«Сони Корпорейшн» («SONY Corporation»), Япония



Маркировка устройства для печати монохромных медицинских изображений

«Сони Корпорейшн» («SONY Corporation»), Япония

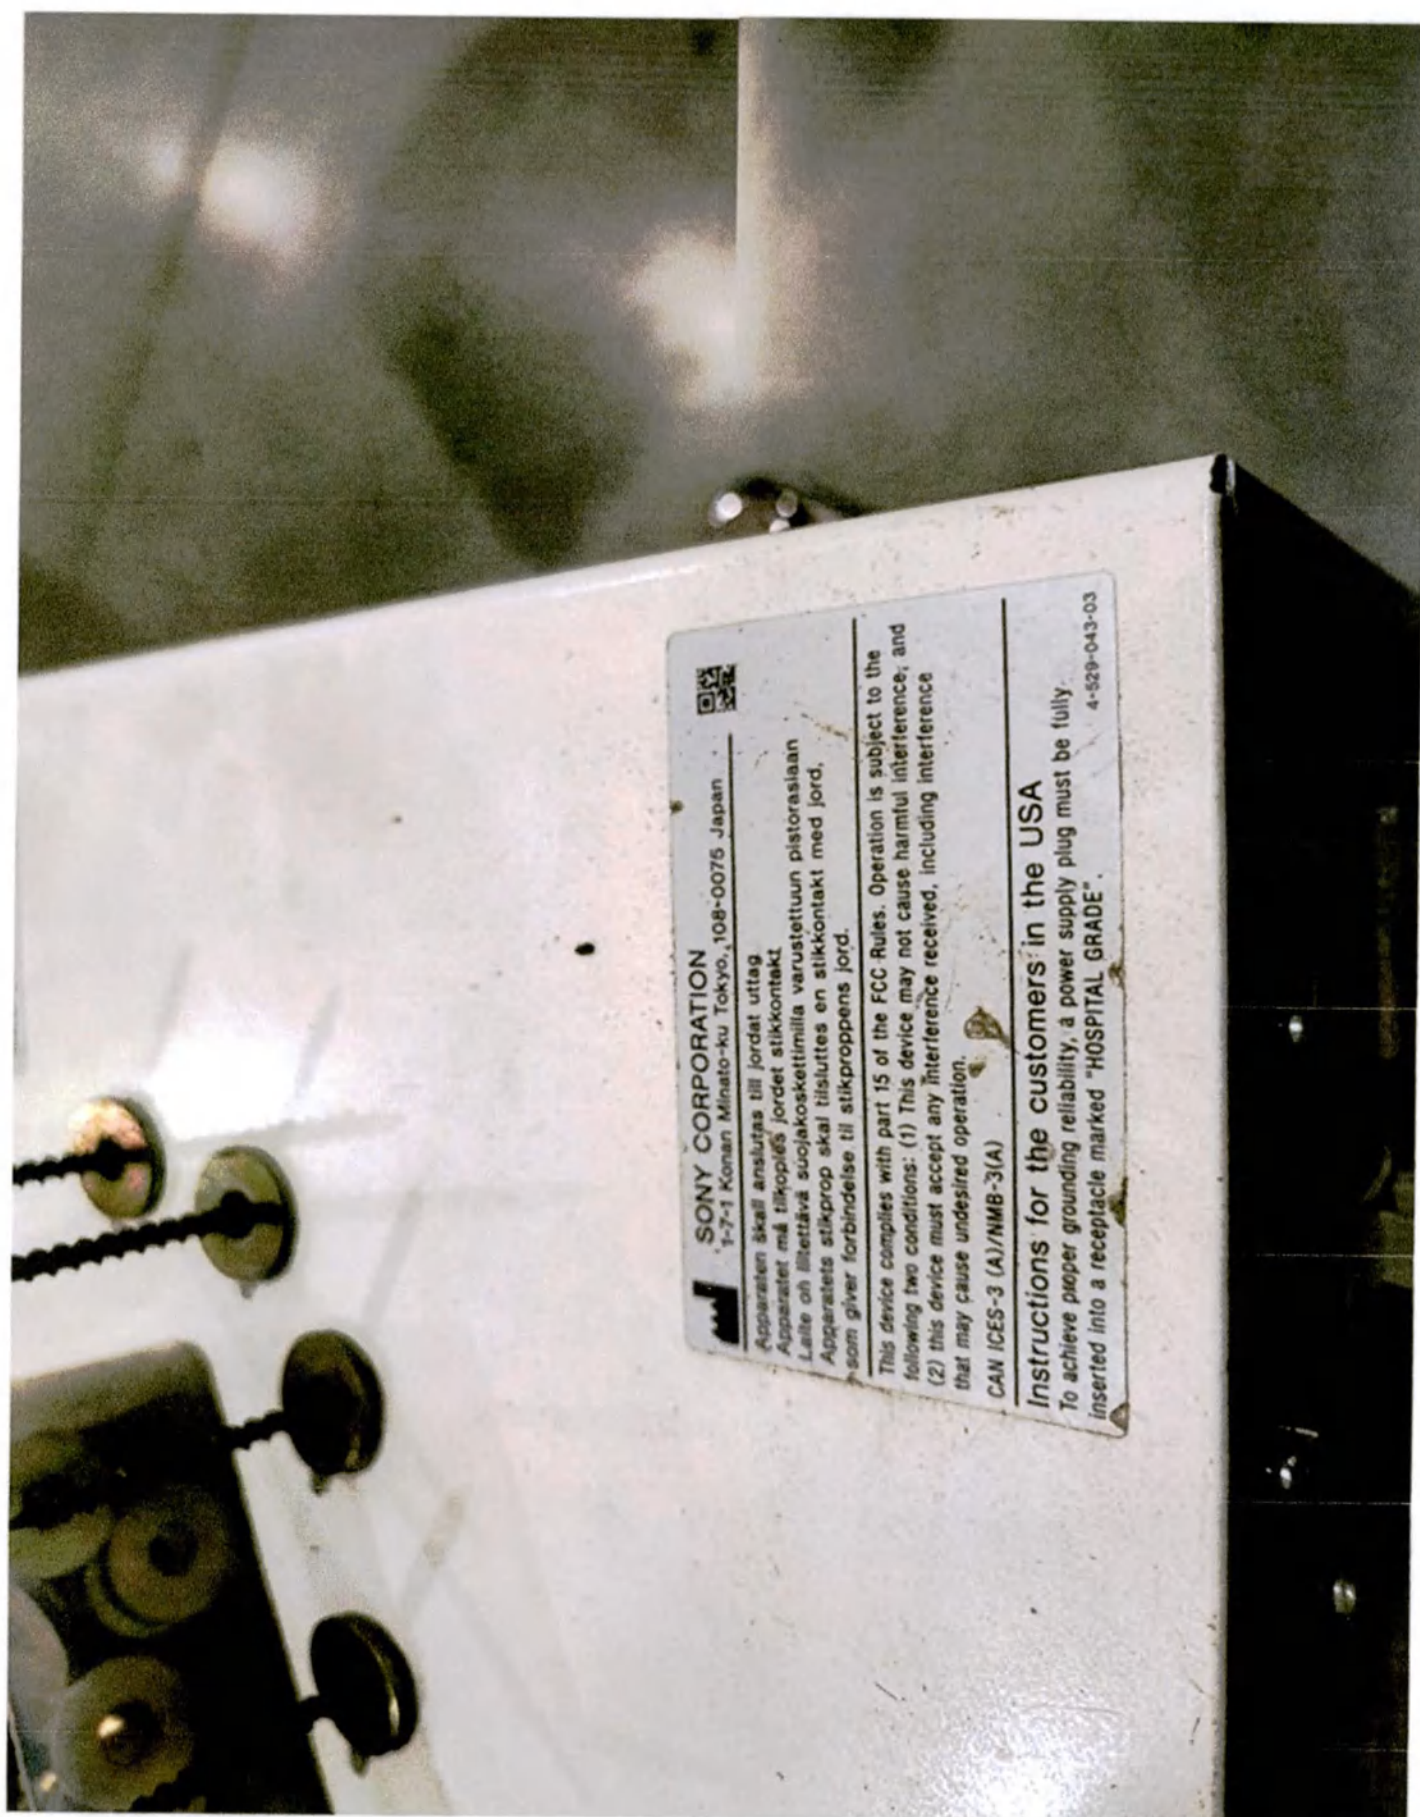

Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями
«Агфа Н.В.» («Agfa N.V.»), Германия



Маркировка камеры мультимедийной термографической Drystar AXYS с принадлежностями «Агфа Н.В.»
(«Agfa N.V.»), Германия





Камера лазерная мультиформатная DRYVIEW 5950 Laser Imaging System для печати медицинских изображений с принадлежностями «Кэарстрим Хэлс, Инк.» («Carestream Health, Inc.»), Китай



FCC ID: U729950
 * THIS CLASS A DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003
 * CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE A EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA
 IC: 7027A-5950
 COMPLIES WITH 21 CFR 104.10 AND 104.11 EXCEPT FOR DEVIATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE
 NO. 50, DATED JUNE 24, 2007



Уполномоченный представитель: ООО «Кэарстрим Хэлс». Адрес: 123007, РФ, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д.11, ком.7.
Тел. +7 (495) 660-5690, +7 (495) 660-5691.

干式激光成像仪

W	2022-12-03
V	200 - 240 V~
A	4 A
Hz	50/60Hz



WWW.CARESTREAM.COM
DOCUMENTATION

MD



10145

(01)60889971033857(21)69068617

формирования и сохранения



100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.














UPS MONITORING FEATURES (Option)

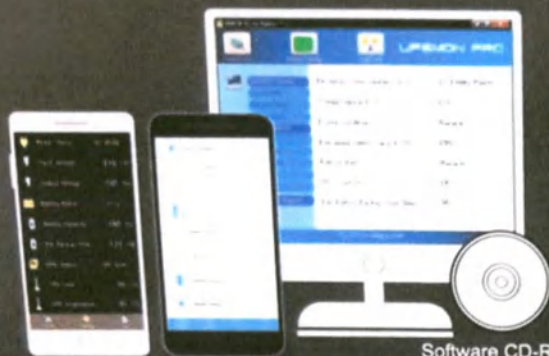

Software CD-ROM
(Option)

- UPS Communication Management
- Real Time Monitor
- Event Log
- UPS Status Scheduling
- VMware Compatible
- Instant Message Notification
- Multi Language Support



40192242212


Источник бесперебойного
питания SPD-850N, Powercom

Manufacturer/Производитель/Producent:
Powercom Co. Ltd, 9F, No.246, Lien Chen Road,
Chung Ho District, New Taipei City, 235, Taiwan;
886-2-2225-8552; info@pcm.ru
Made in China/Сделано в Китае/
Wyprodukowano w Chinach

ISO9001
CERTIFIED



RECEPTACLE



CAPACITY

SPD-450VA	E		SPD-650U	
	N			
SPD-650VA	E		SPD-850U	
	N			
SPD-850VA	E	✓	SPD-1000U	
	N			
SPD-1000VA	E			
	N			

SERIAL NO.



S/N 40192242212



4 712505 035932



SPD-0850-6G0-2442




SPD-850N



Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при
рентгенодиагностических исследованиях:

Передник для защиты голад ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия



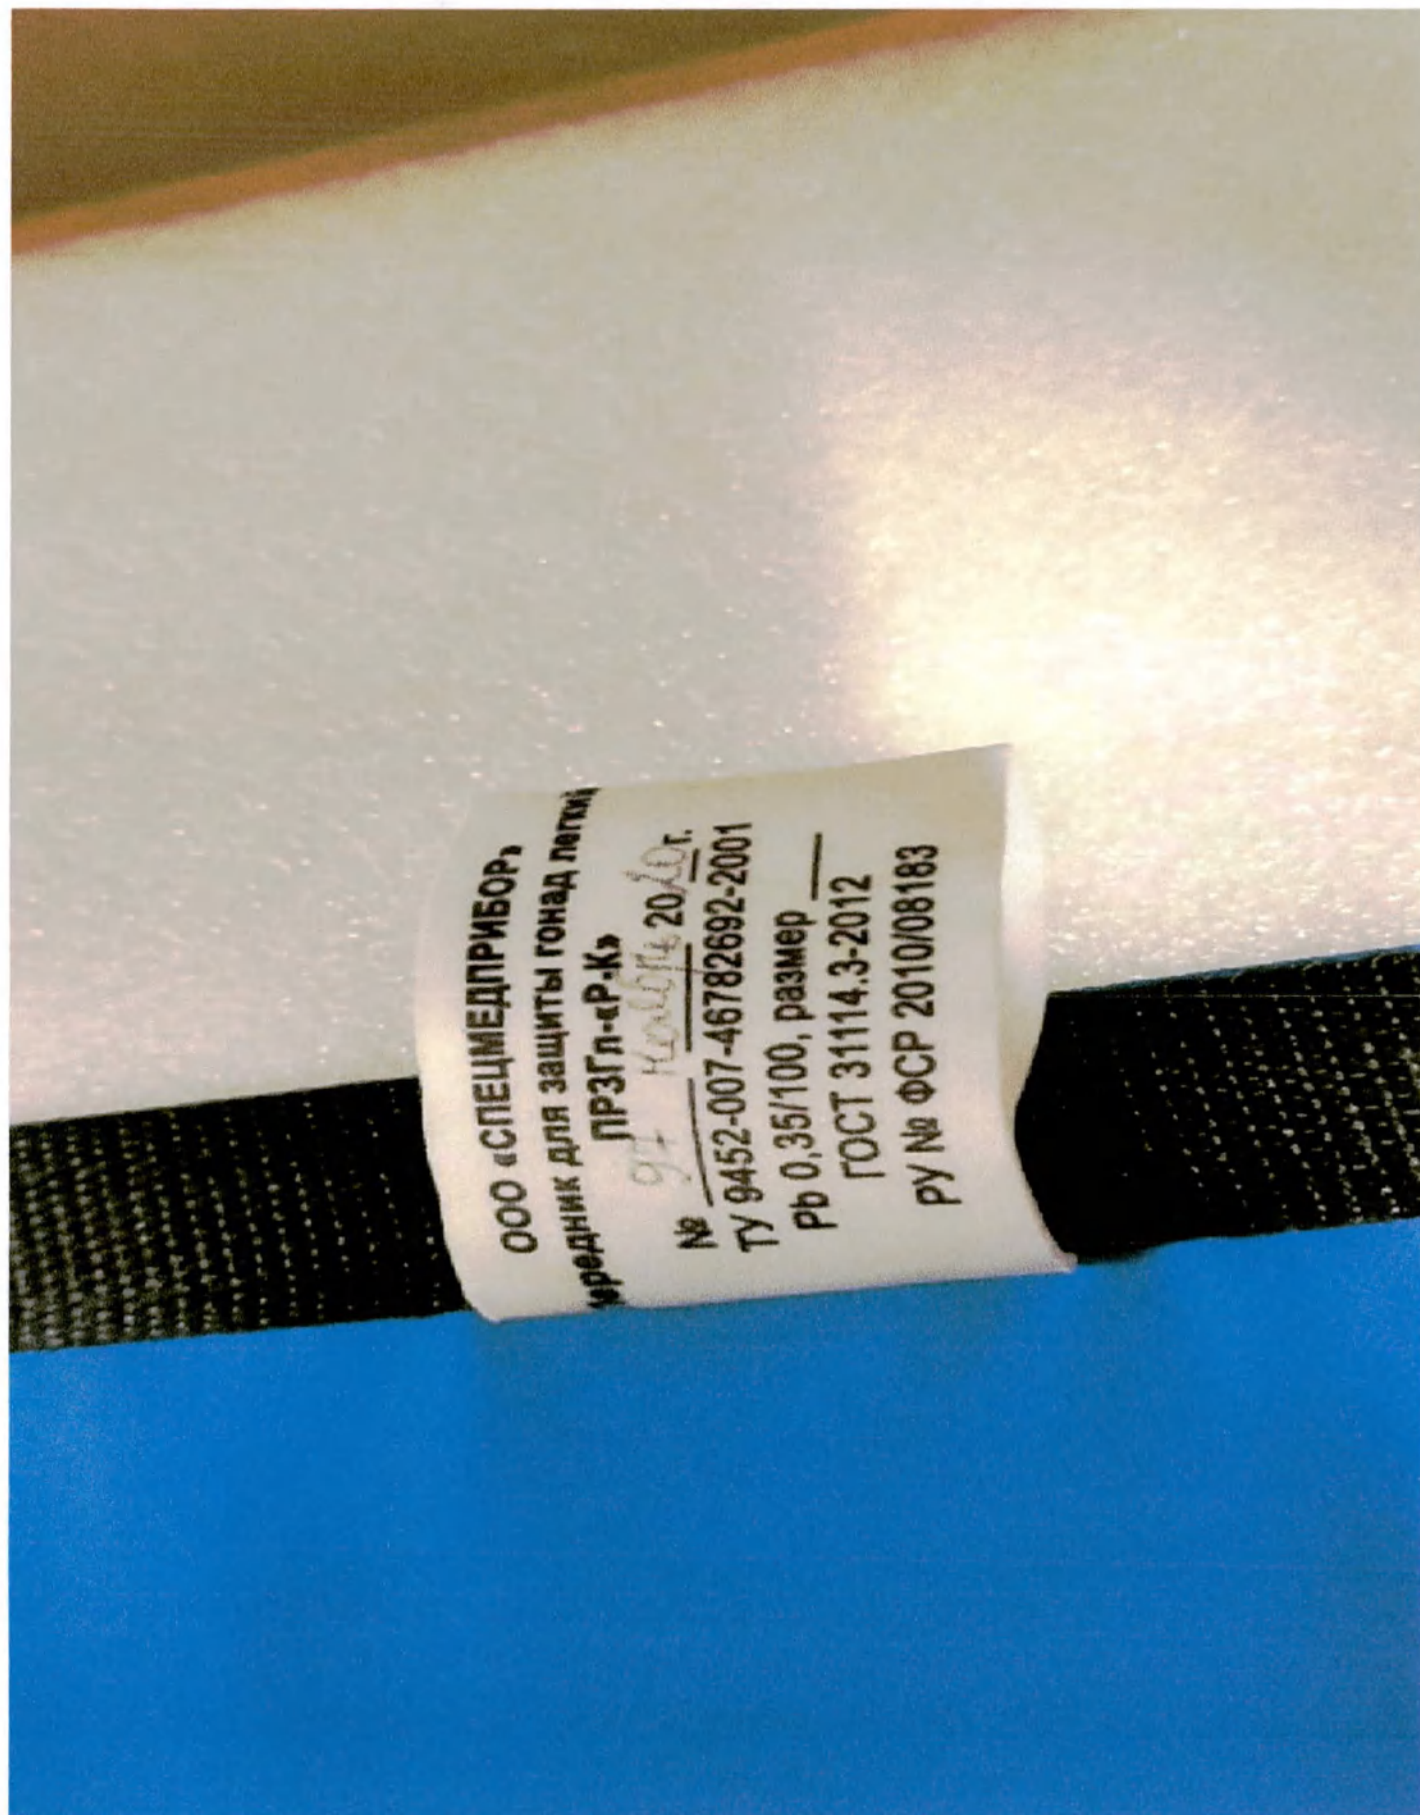



Маркировка воротника защитного ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия

ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

Воротник защитный

ВРЗ-«Р-К»

№ 142 ноябрь 2020 г.

ТУ 9452-007-46782692-2001

Рв 0,35/100, размер

ГОСТ 31114.3-2012

РУ № ФСР 2010/08183

Всего прошито и пронумеровано

104 (сто четыре) листов


Исполнительный директор АО "РЕНТГЕНПРОМ"


Сявбянов Мансур Рафитович







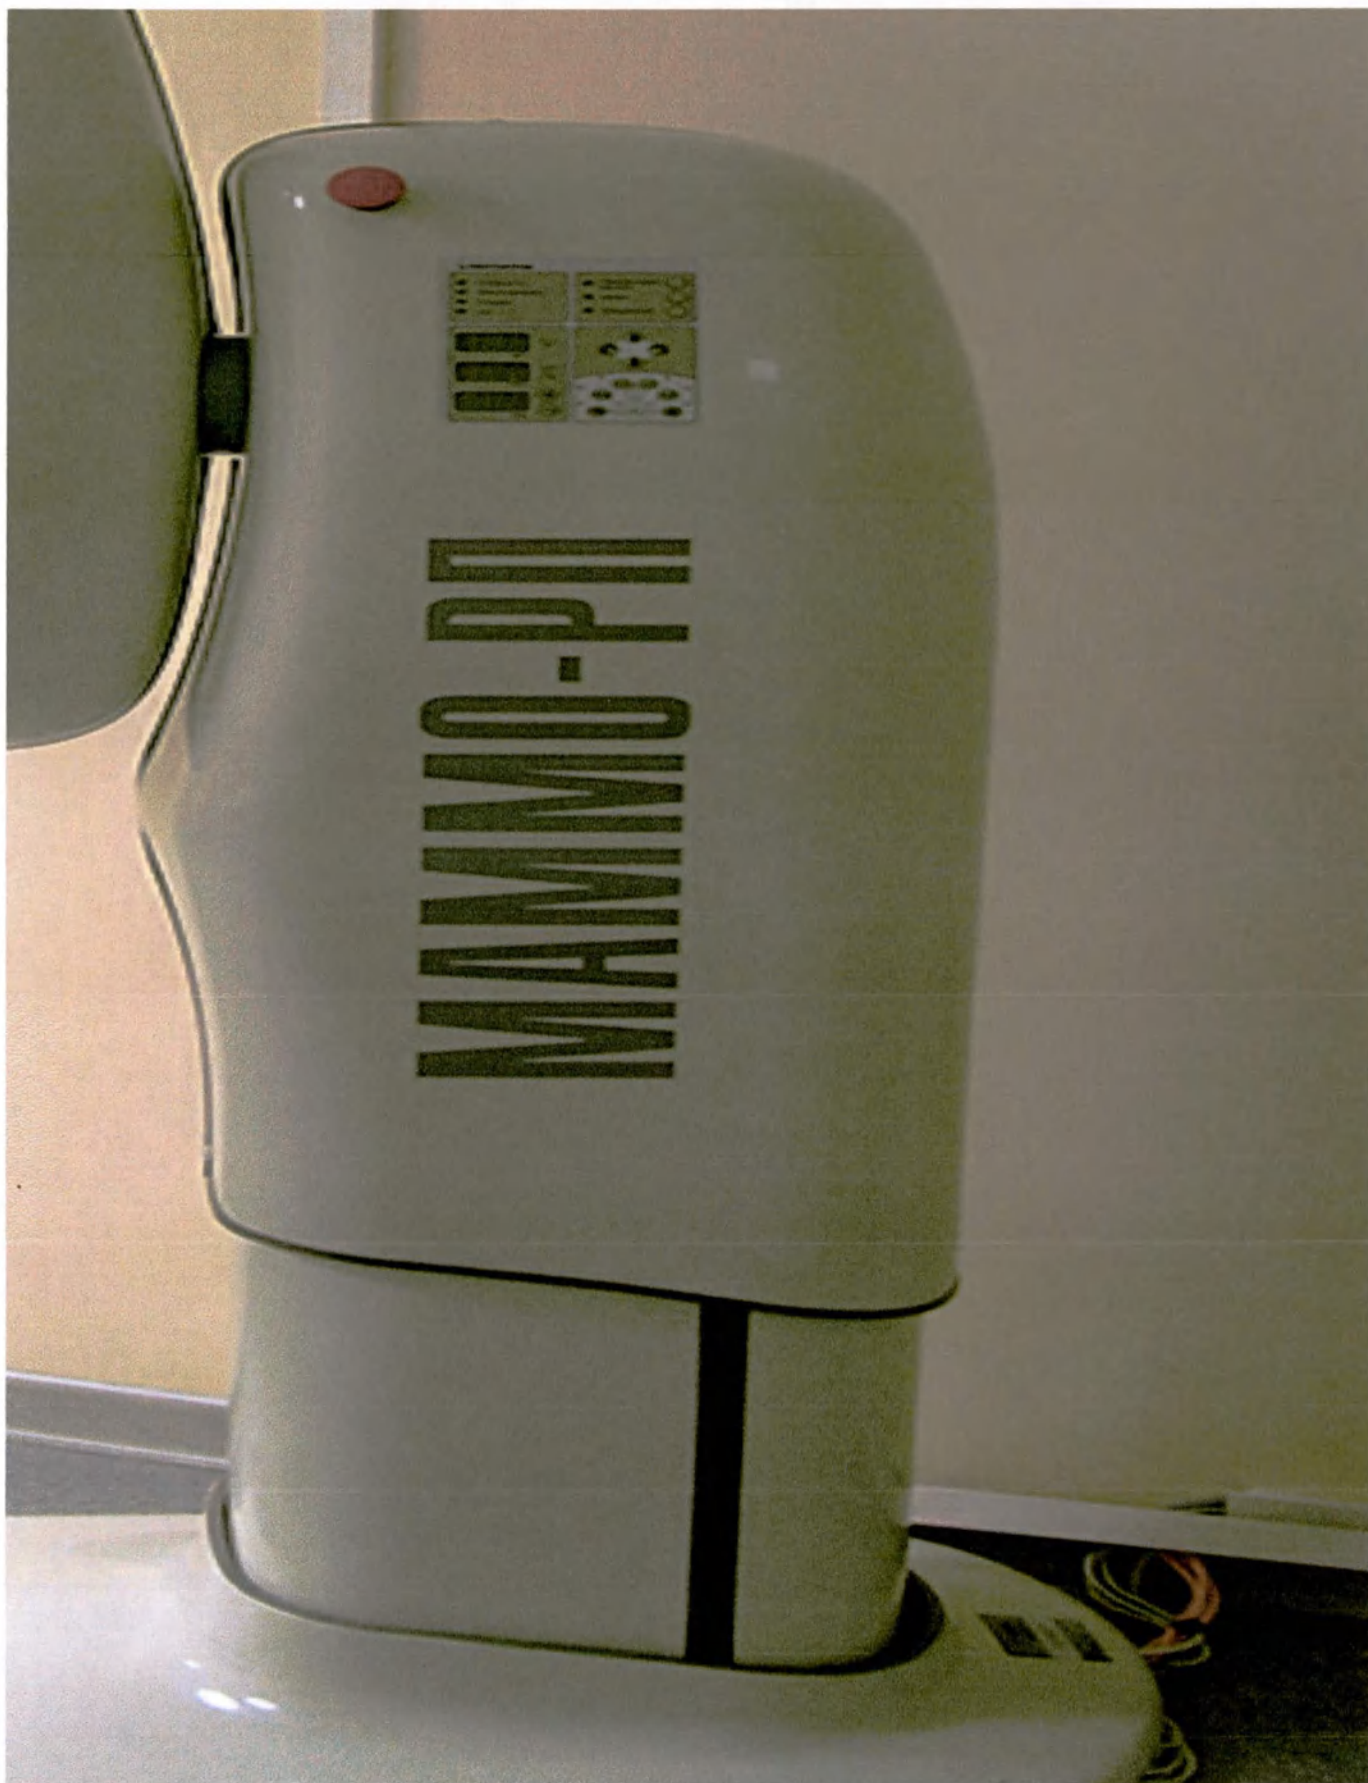


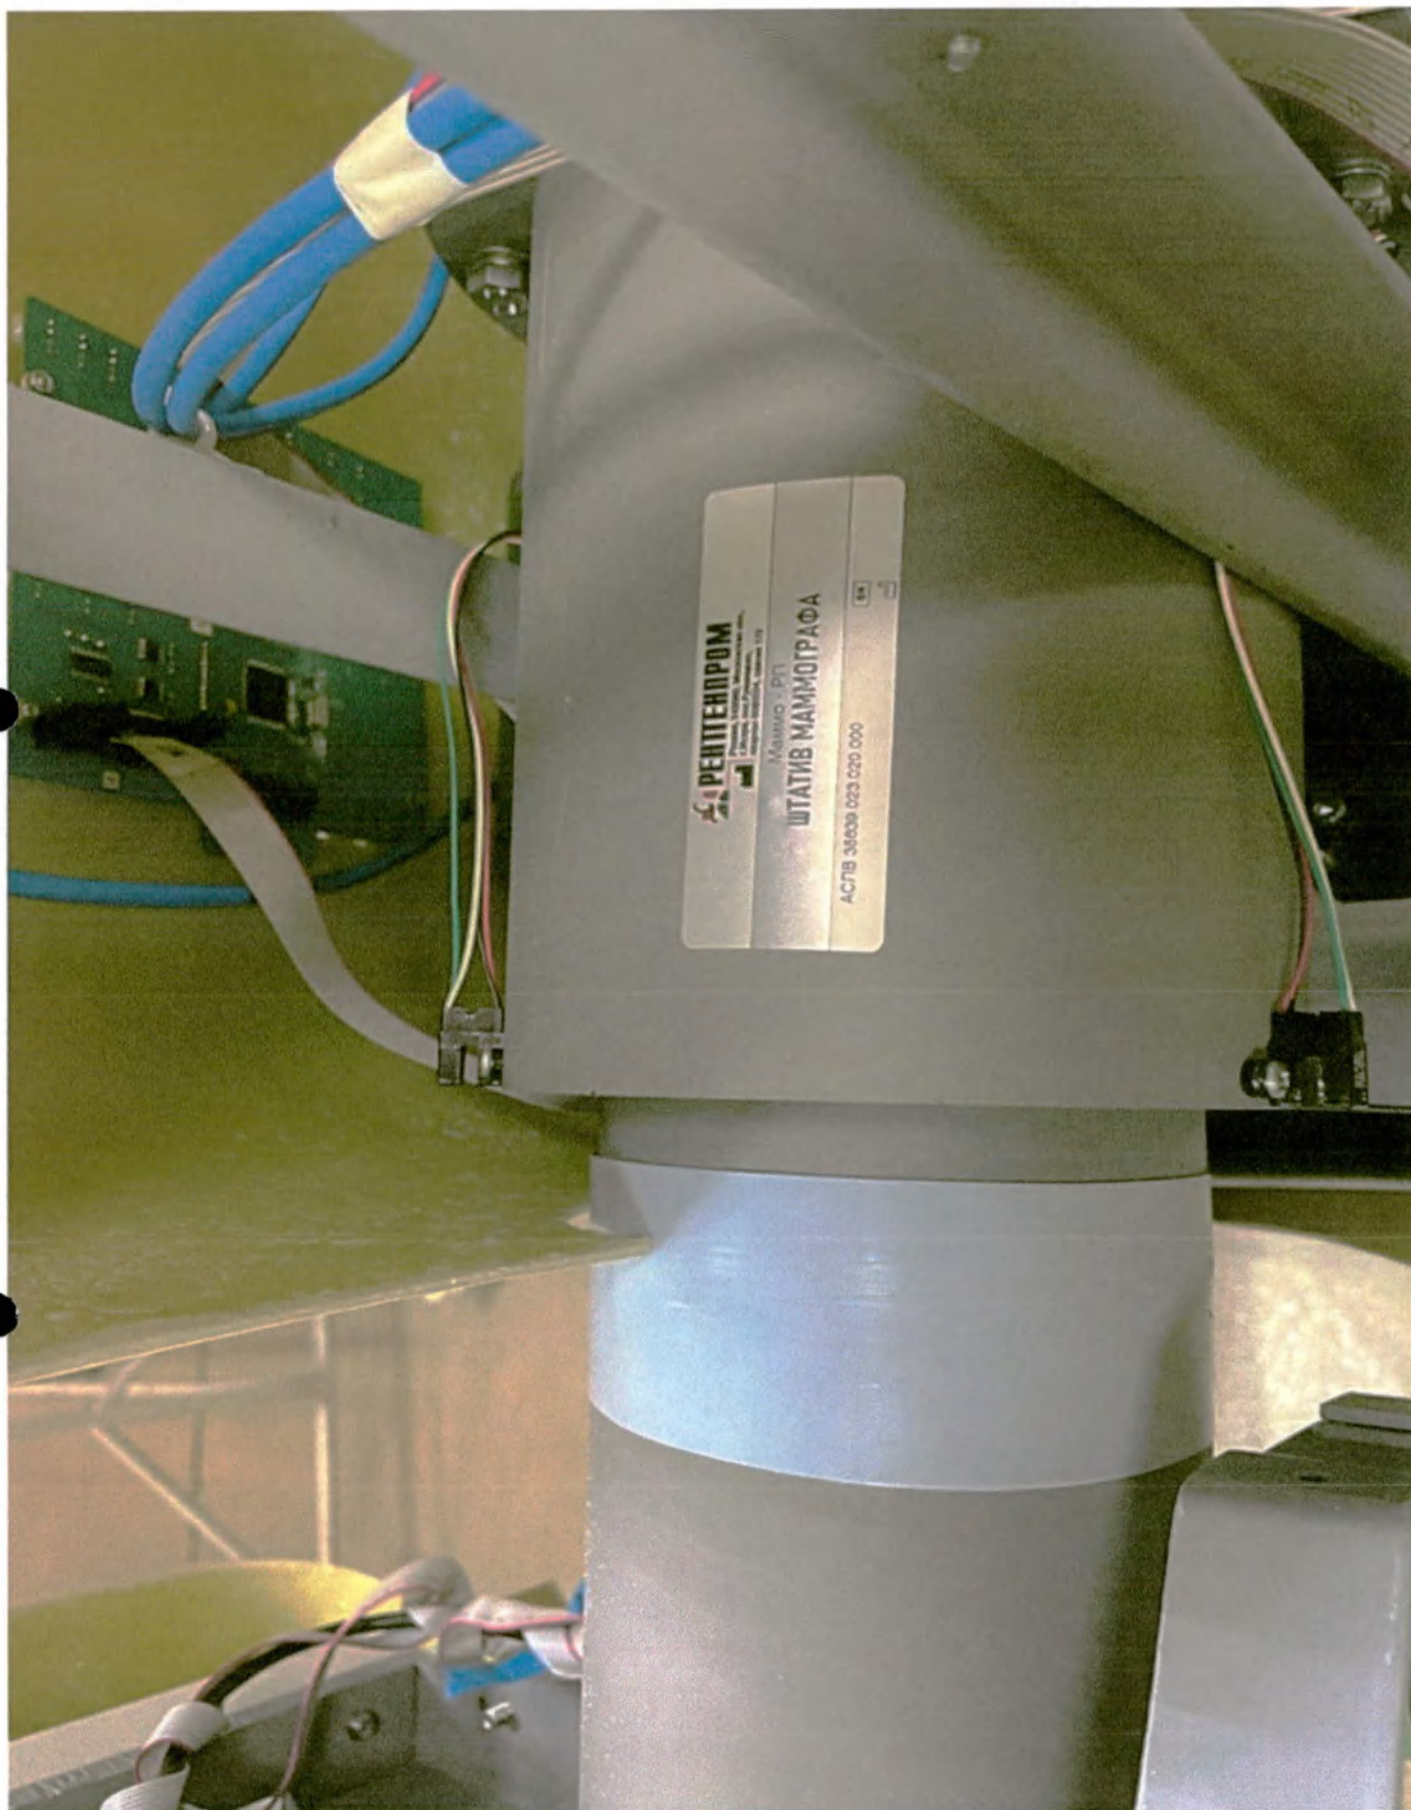








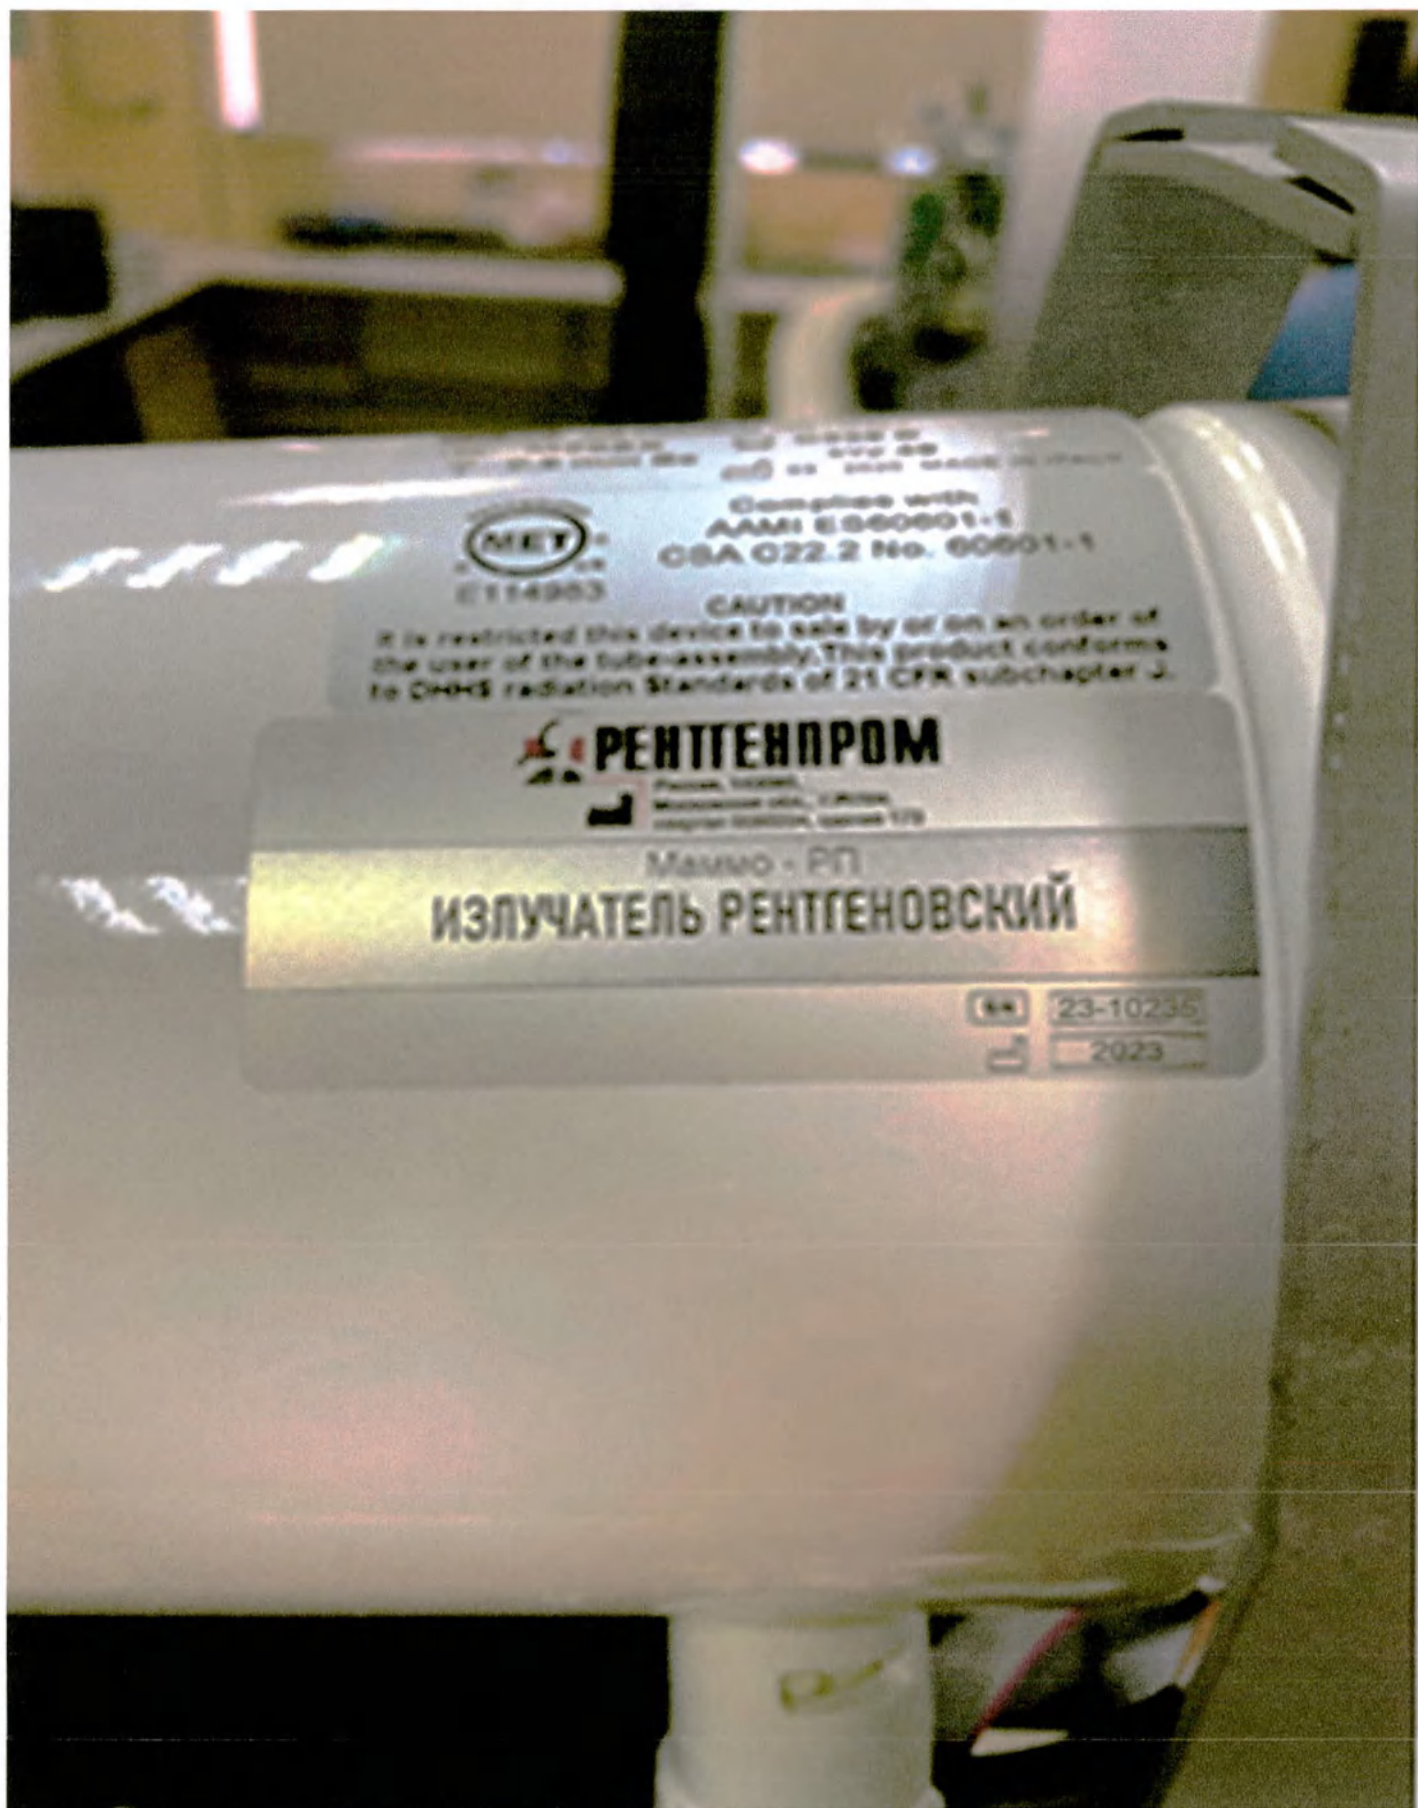

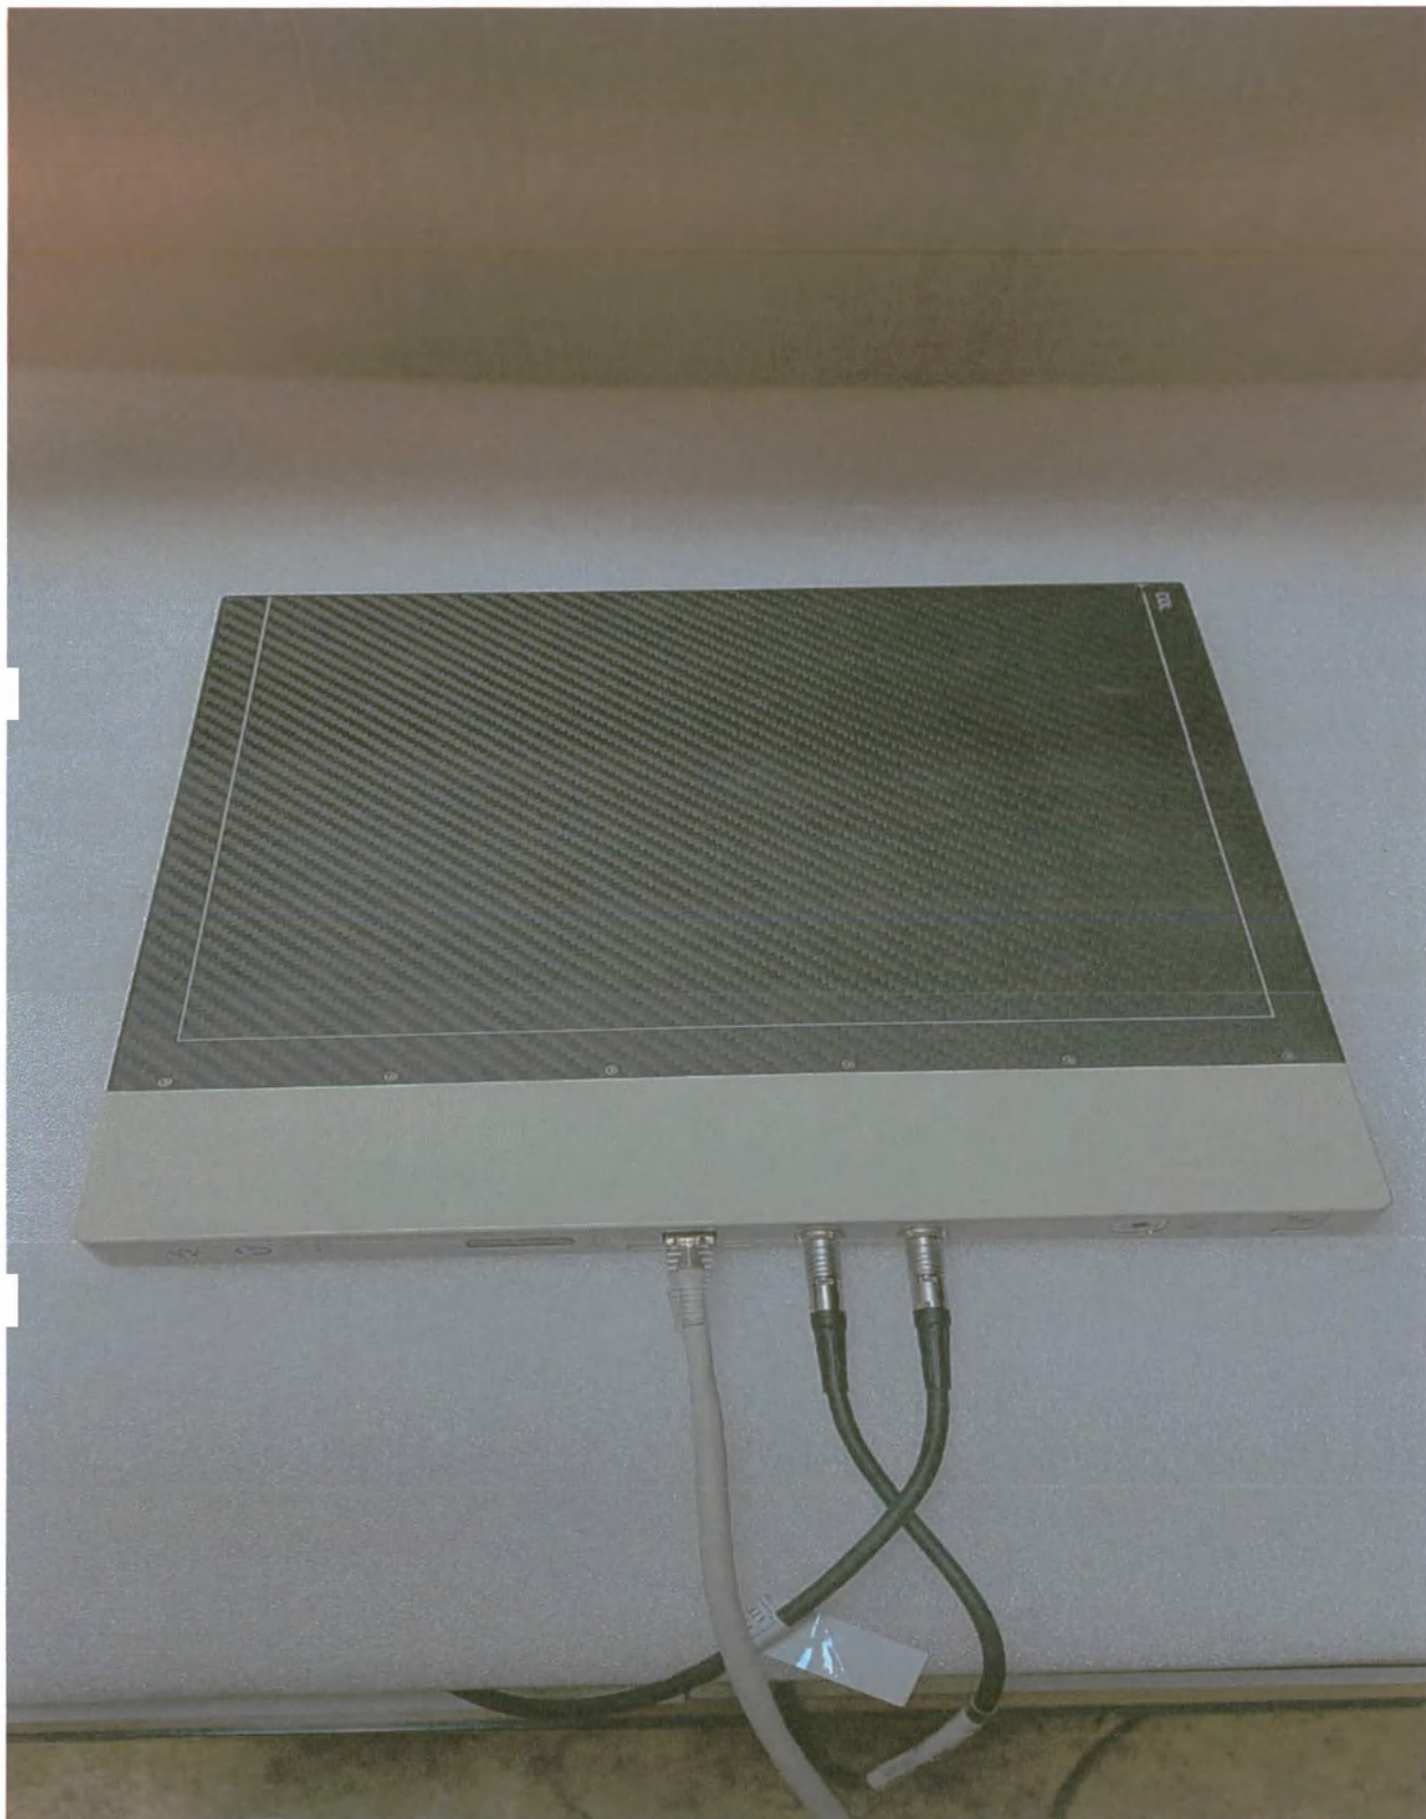

数字乳腺X射线平板探测器



产品型号: Mammo1012P

接入电源: 输入 24V — 1.25A

配置型号: Mammo1012P - CSM

附属设备 Mammo1012X GB9706.24-2005



2022-05



奕瑞影像科技(太仓)有限公司
中国江苏省
太仓港经济技术开发区兴港路33号

Digital Mammography
X-Ray Flat Panel Detector



Model: Mammo1012P

Power: Input 24V — 1.25A

Configuration: Mammo1012P-CSM



CE 0197



2022-05




iRay Technology Taicang Ltd.
No.33Xinggang Road, Taicang Port Economic and
Technological Development Zone, Taicang, 215434
Jiangsu P.R. China
www.iraygroup.com



iRay Europe GmbH
In den Dorfweiden 14, 71720 Oberstenfeld Germany





IFB1 20220501220002

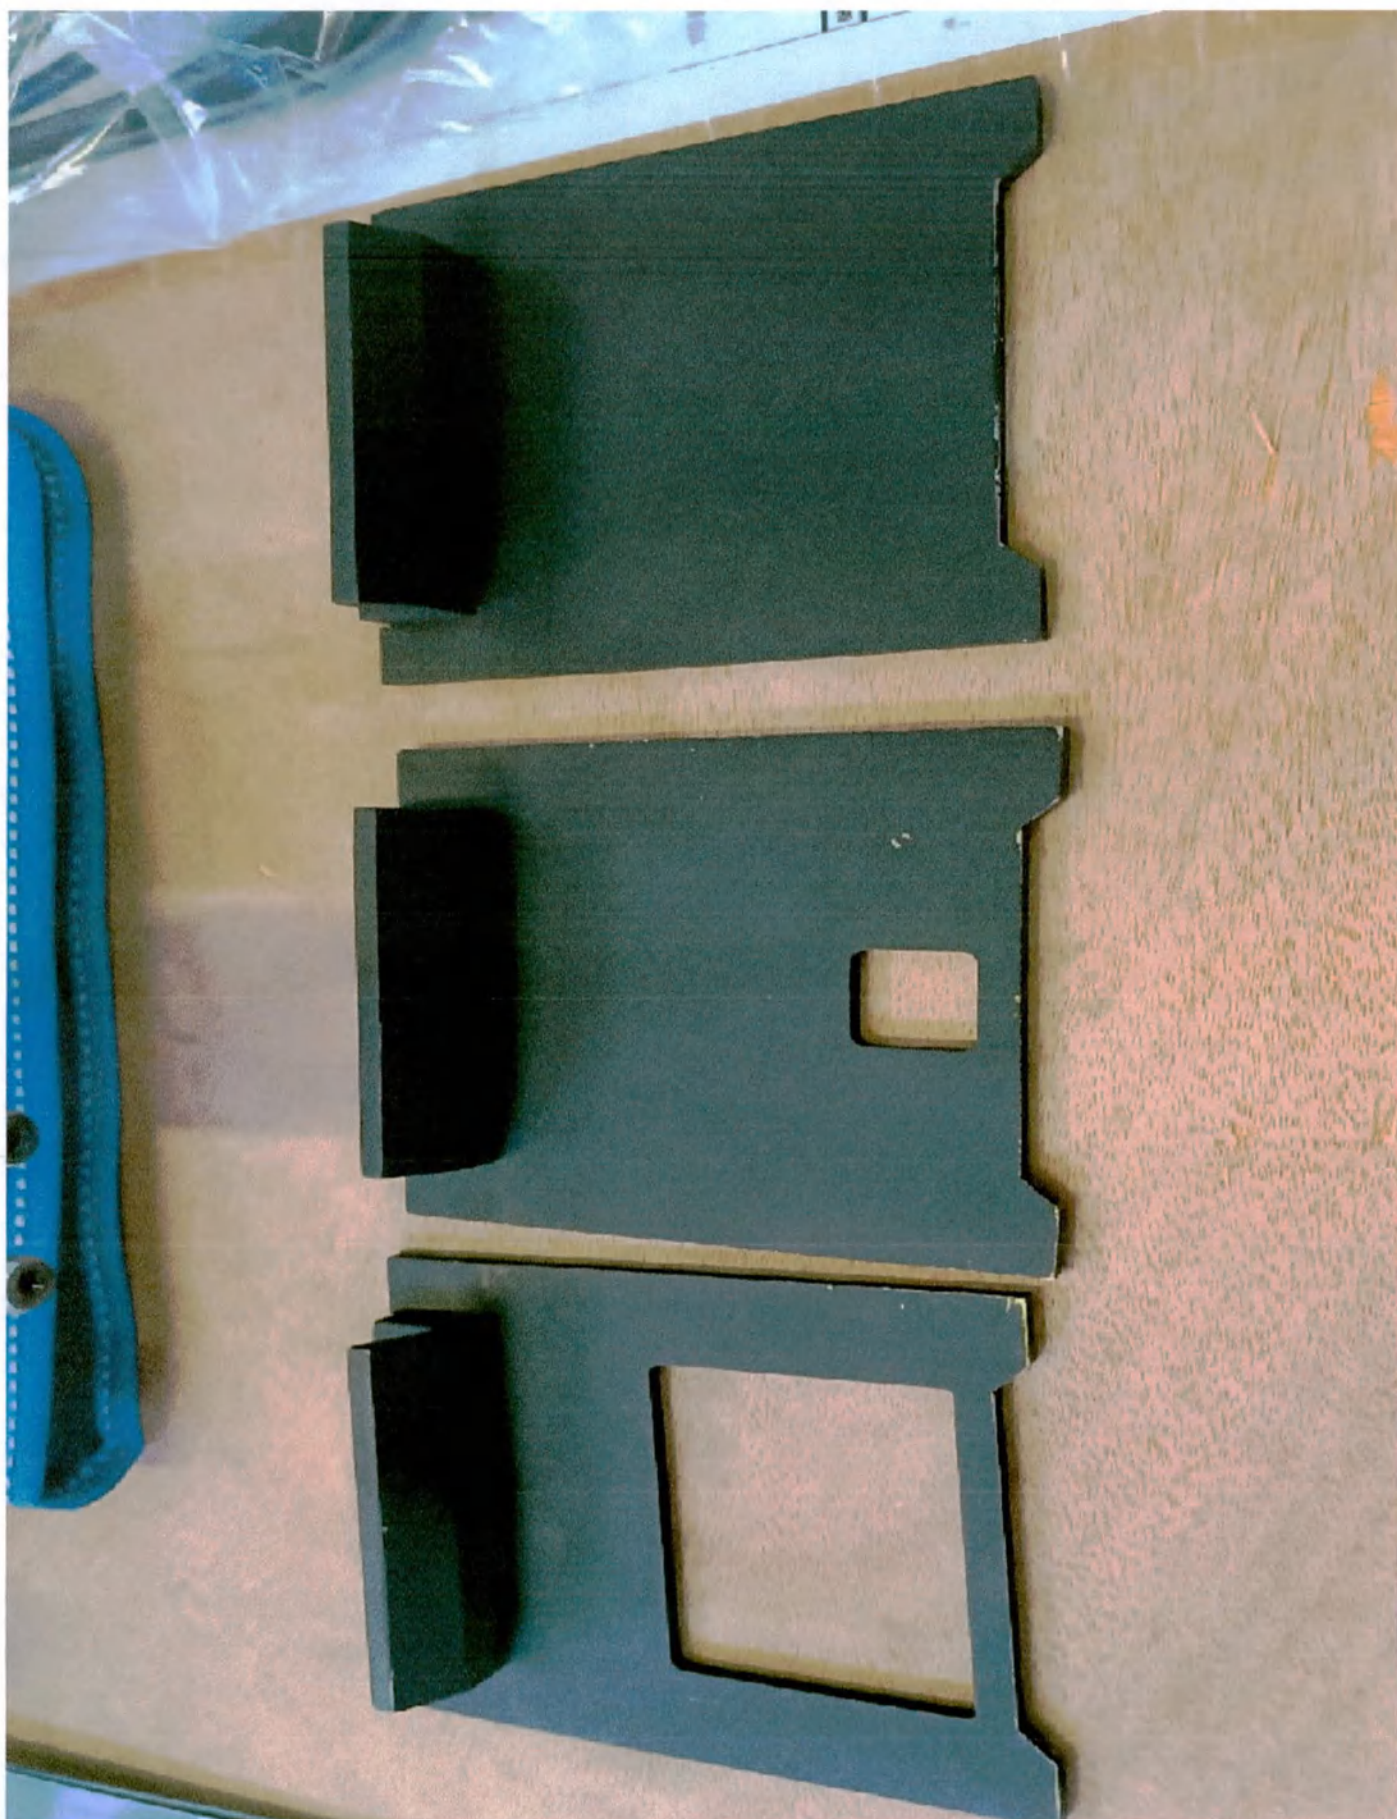






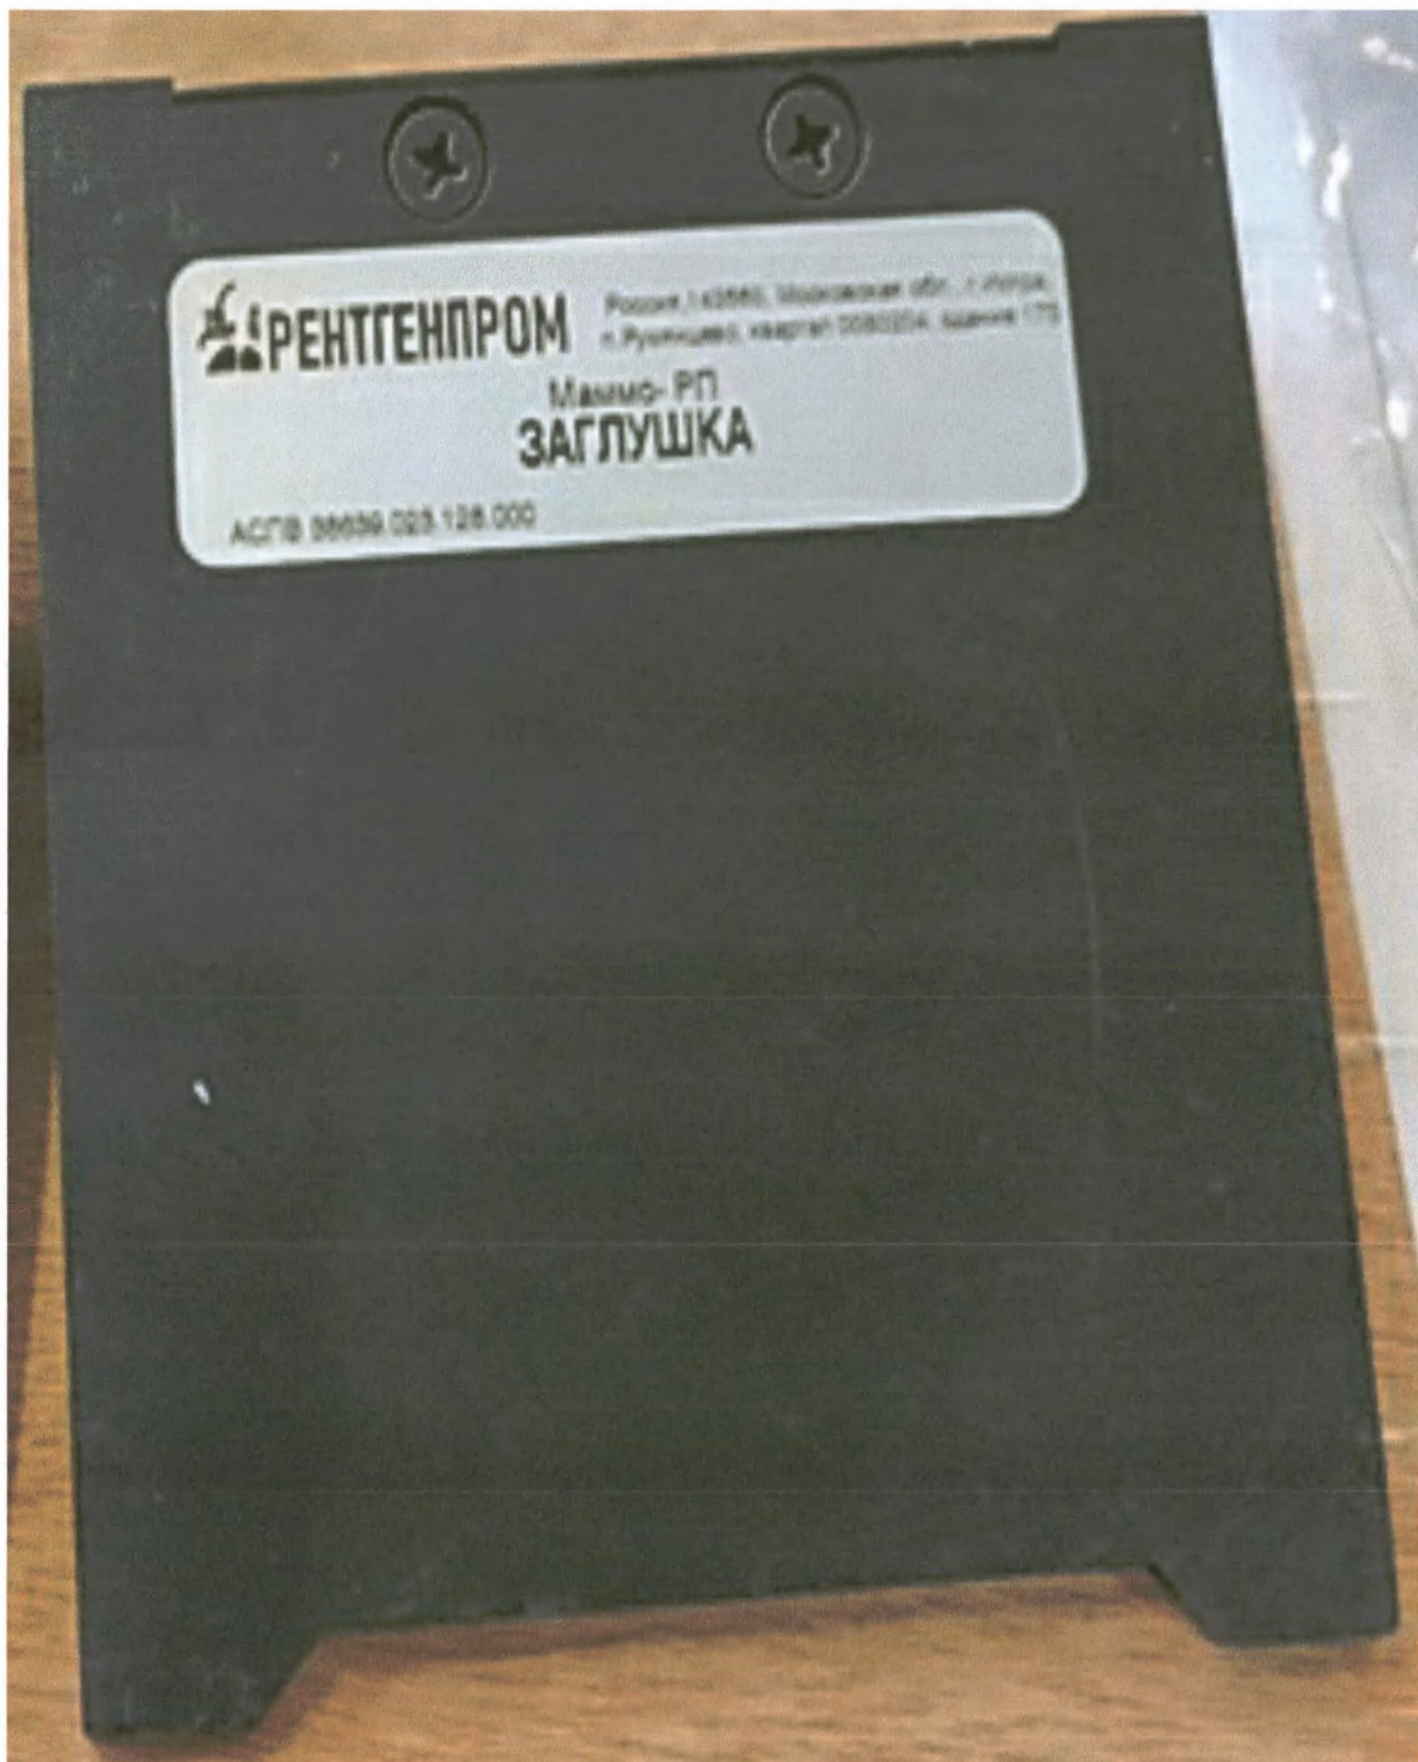

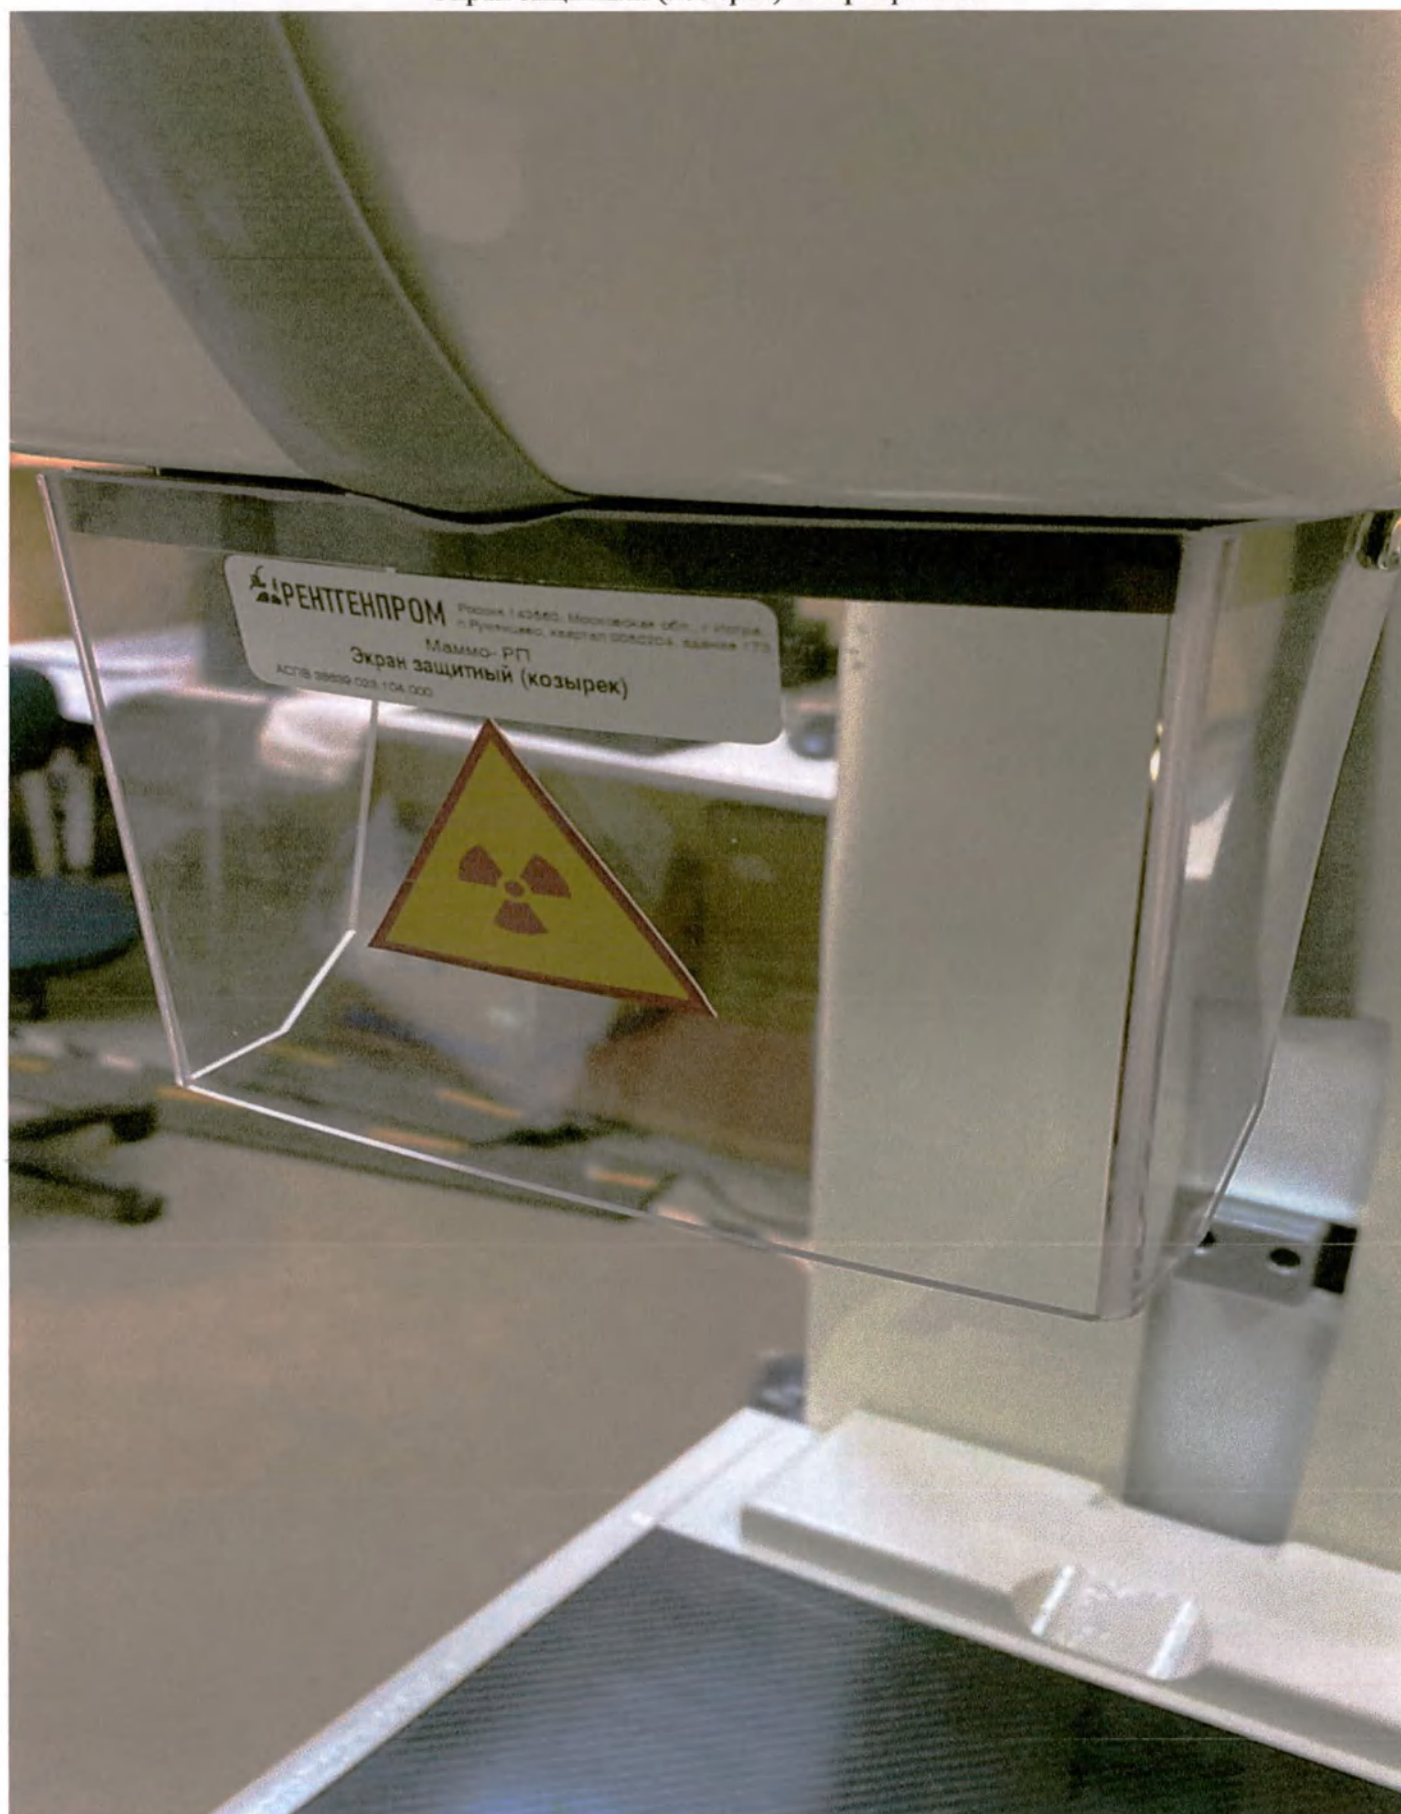

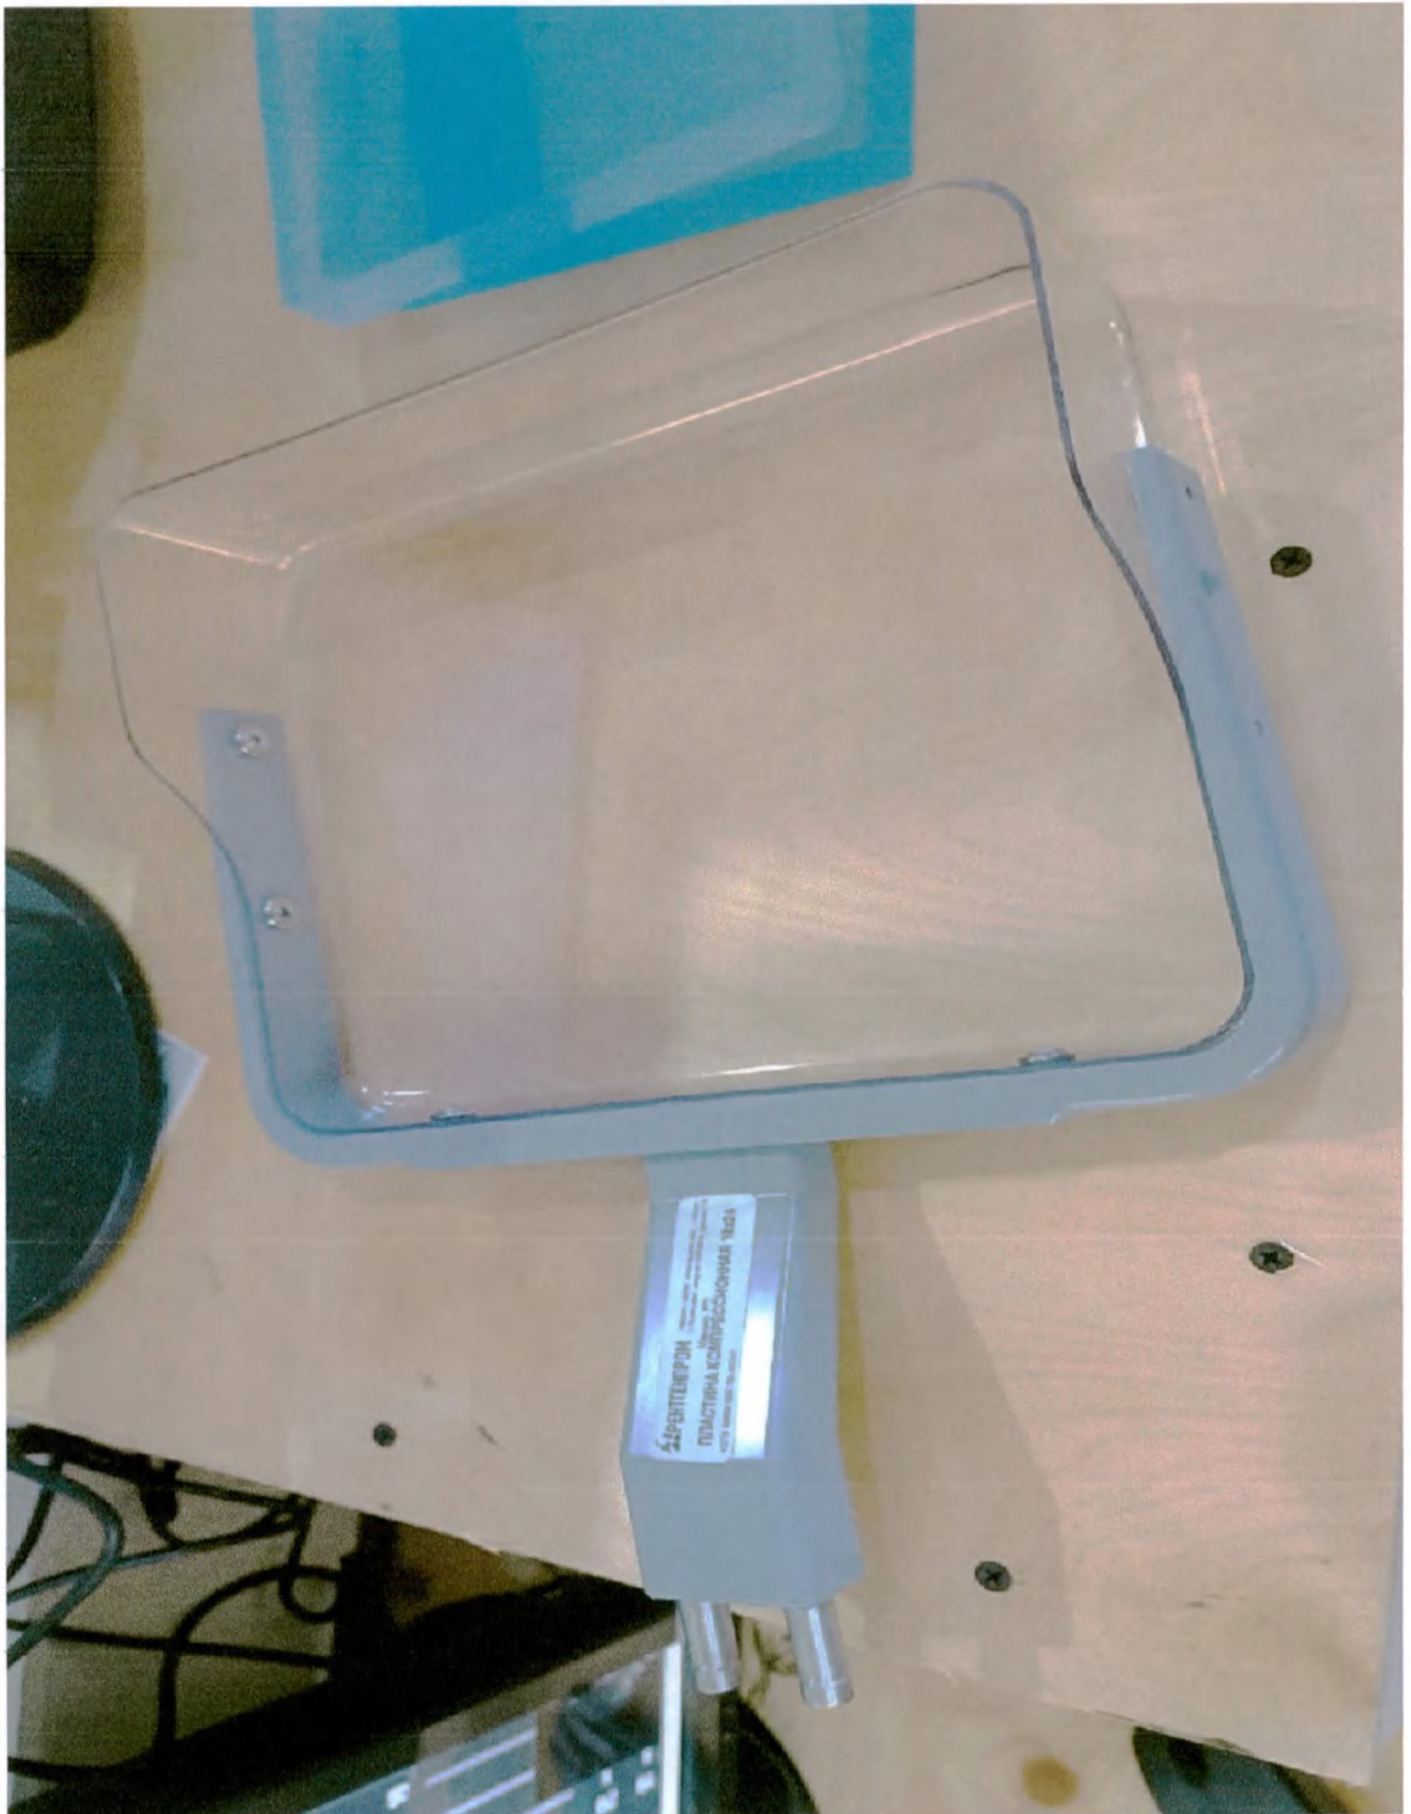



Маркировка пластины компрессионной 18х24, для аксиллярной проекции (правая)



 **РЕНТГЕНПРОМ**

Россия, 143560, Московская обл., г. Истрин,
п. Румянинское, квартал 0080204, здание 173

Маммо-РПц

**ПЛАСТИНА КОМПРЕССИОННАЯ 18х24
для аксиллярной проекции (правая)**

АСЛВ 38639.023.136.000-01

Маркировка пластины компрессионной 18х24, для аксиллярной проекции (левая)




 **РЕНТГЕНПРОМ**


Россия, 143580, Московская обл., г. Истра,
п. Рудничный, квартал 0080204, здание 173

Маммо-РПц

**ПЛАСТИНА КОМПРЕССИОННАЯ 18х24
для аксиллярной проекции (левая)**

АСЛВ 38639.023.136.000-02

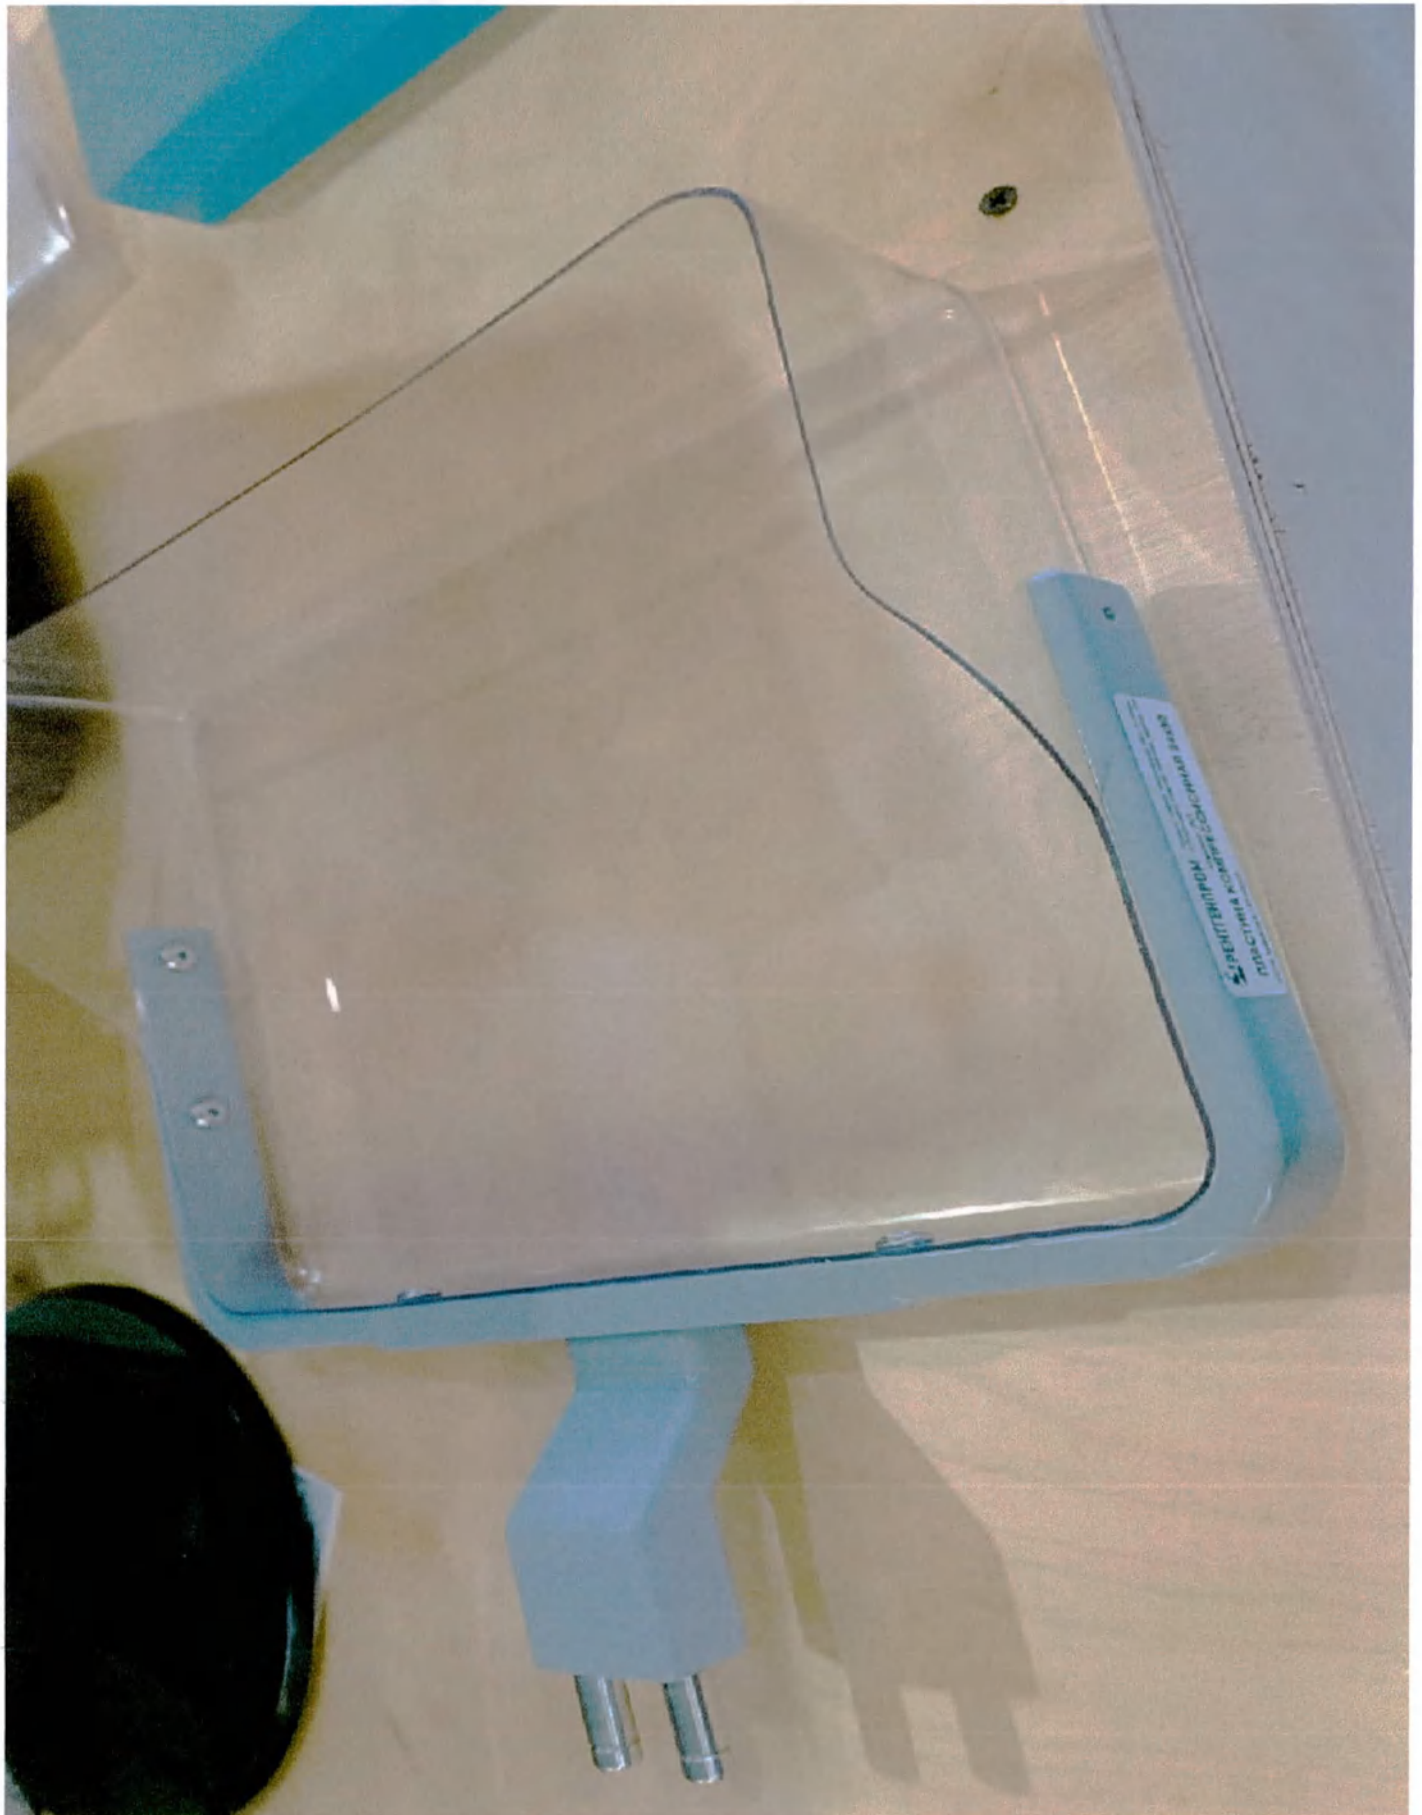

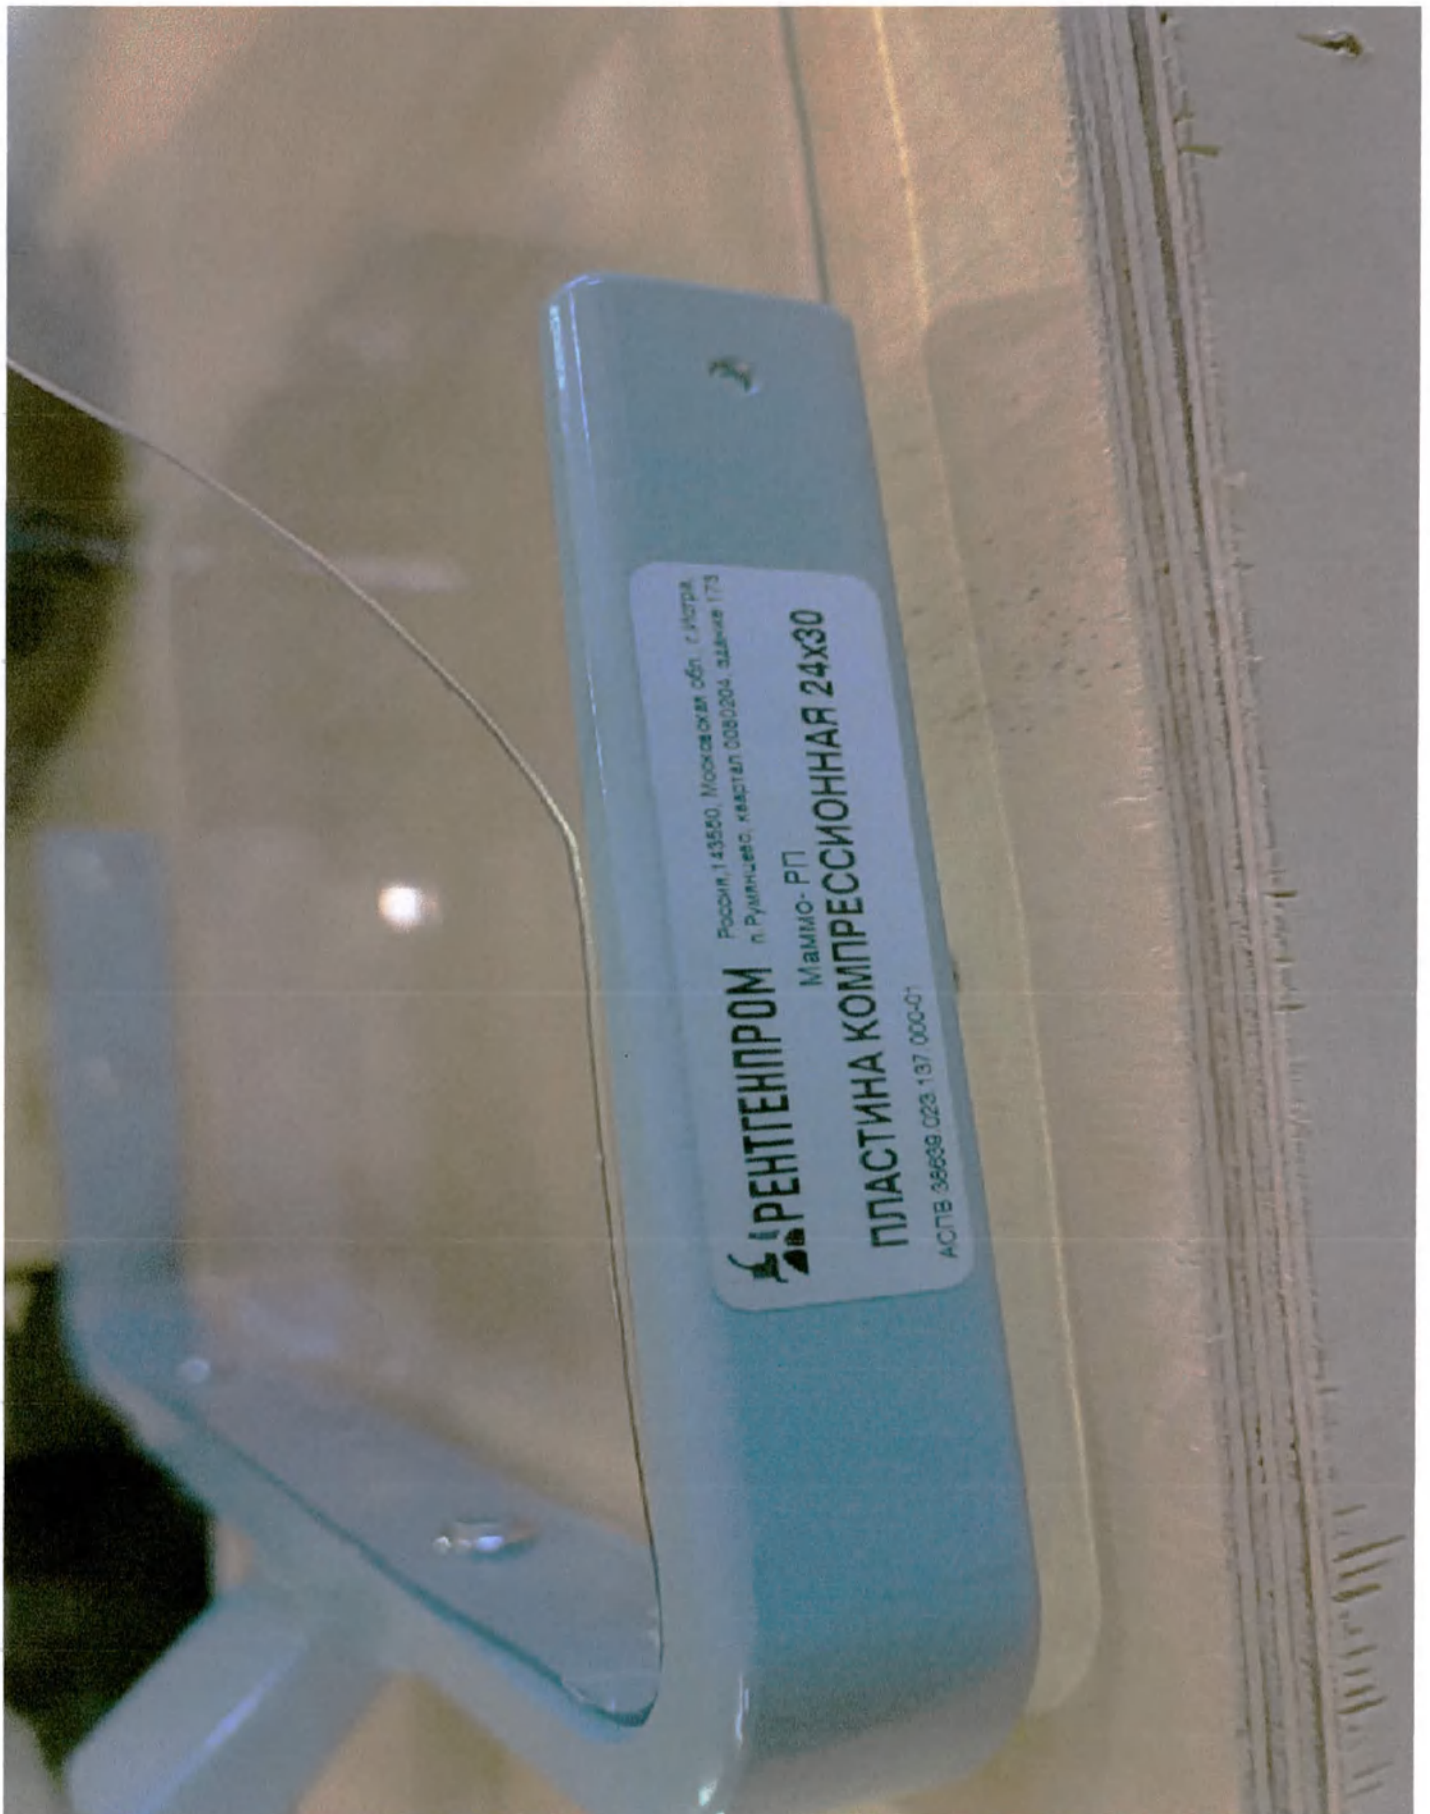





Россия, 143560, Московская обл., г. Истра,
п. Румянцево, квартал 0060204, здание 173

Маммо- РП

ПЛАСТИНА КОМПРЕССИОННАЯ ПРИЦЕЛЬНАЯ


АСПВ 38639 023.138 000-01







Маркировка пластины компрессионной увеличения



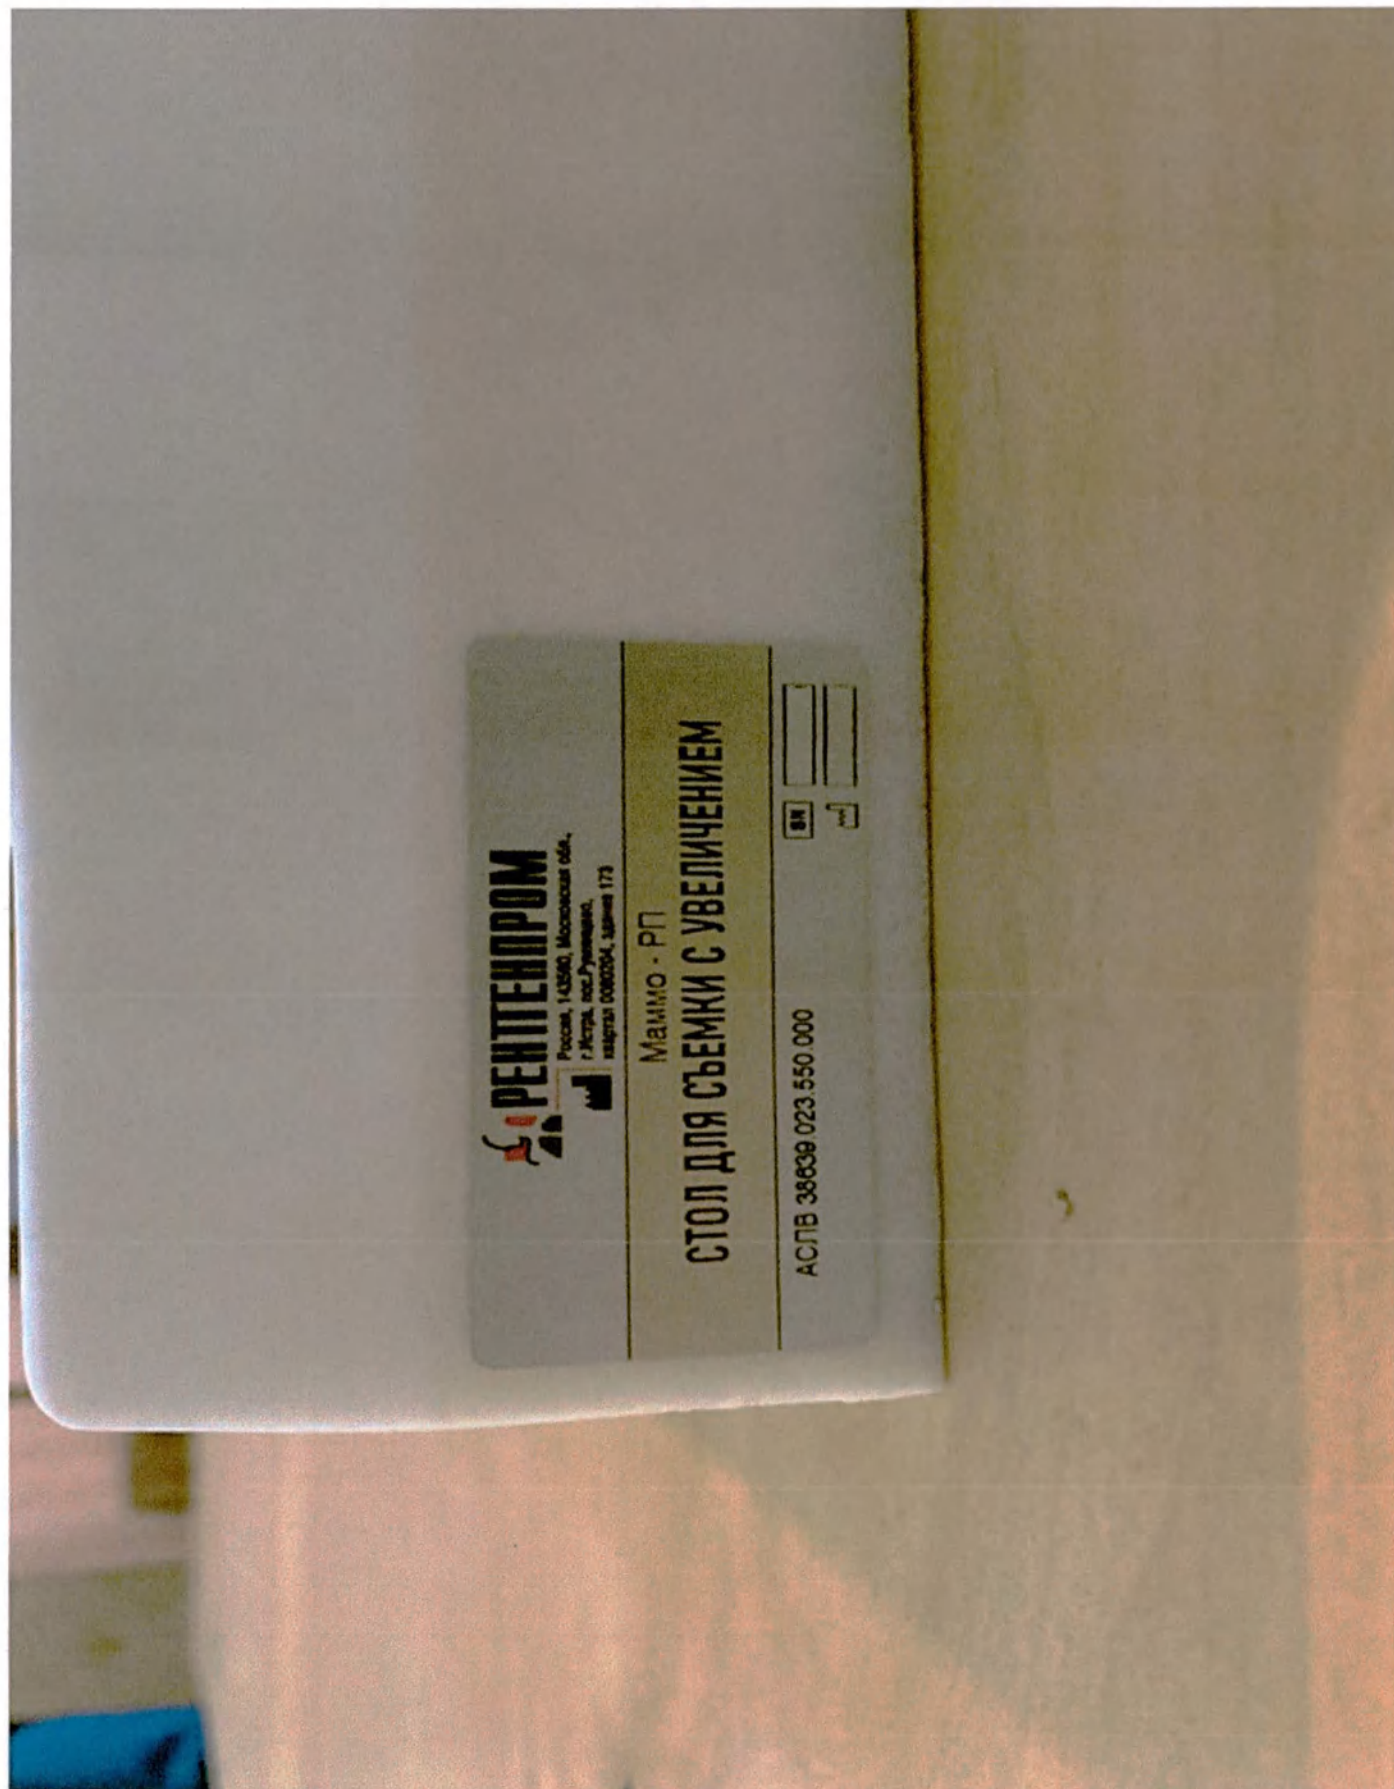

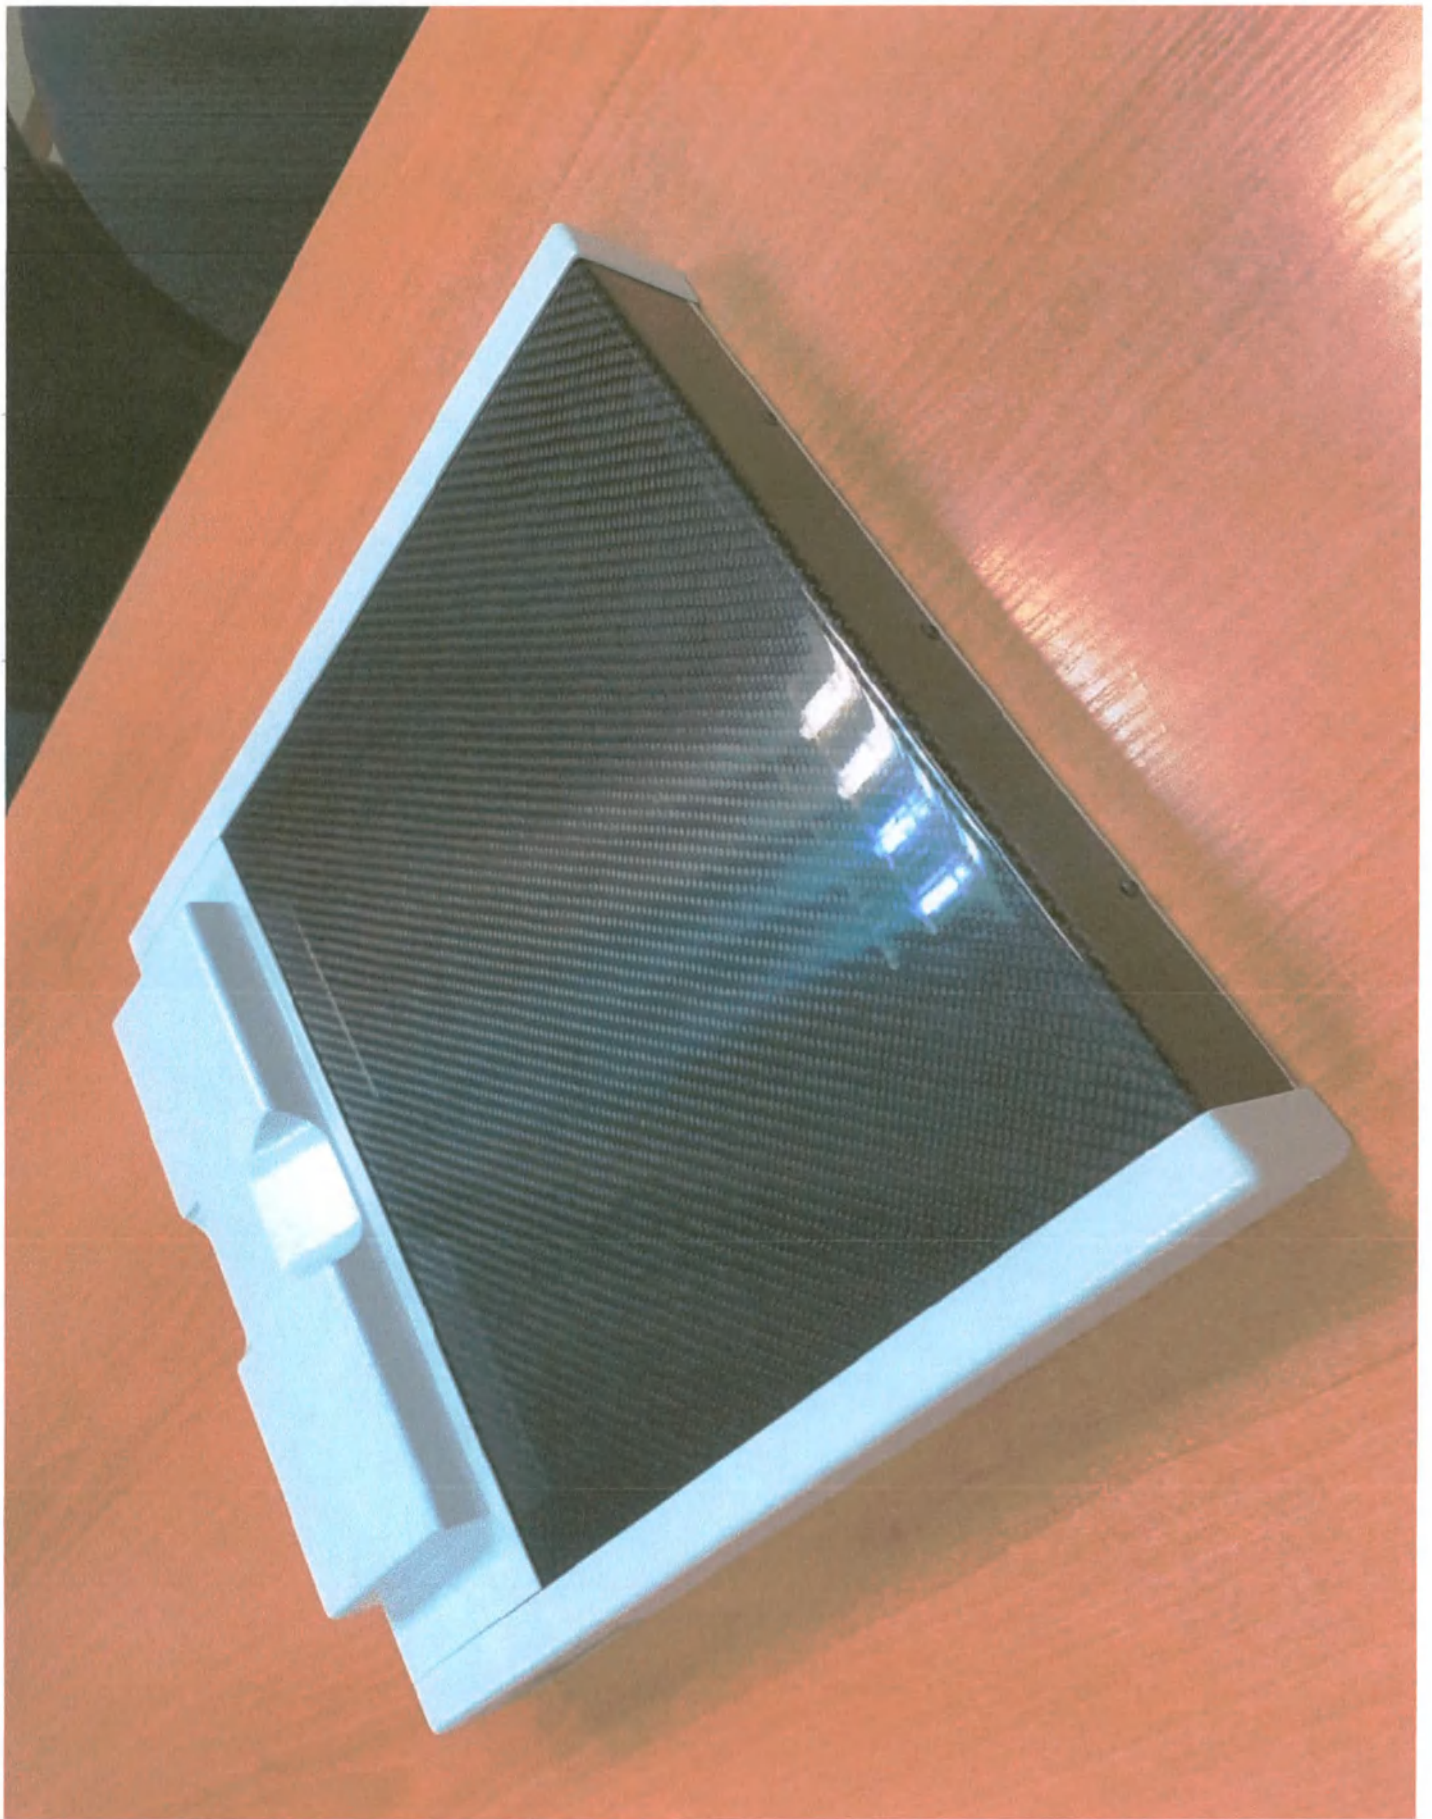

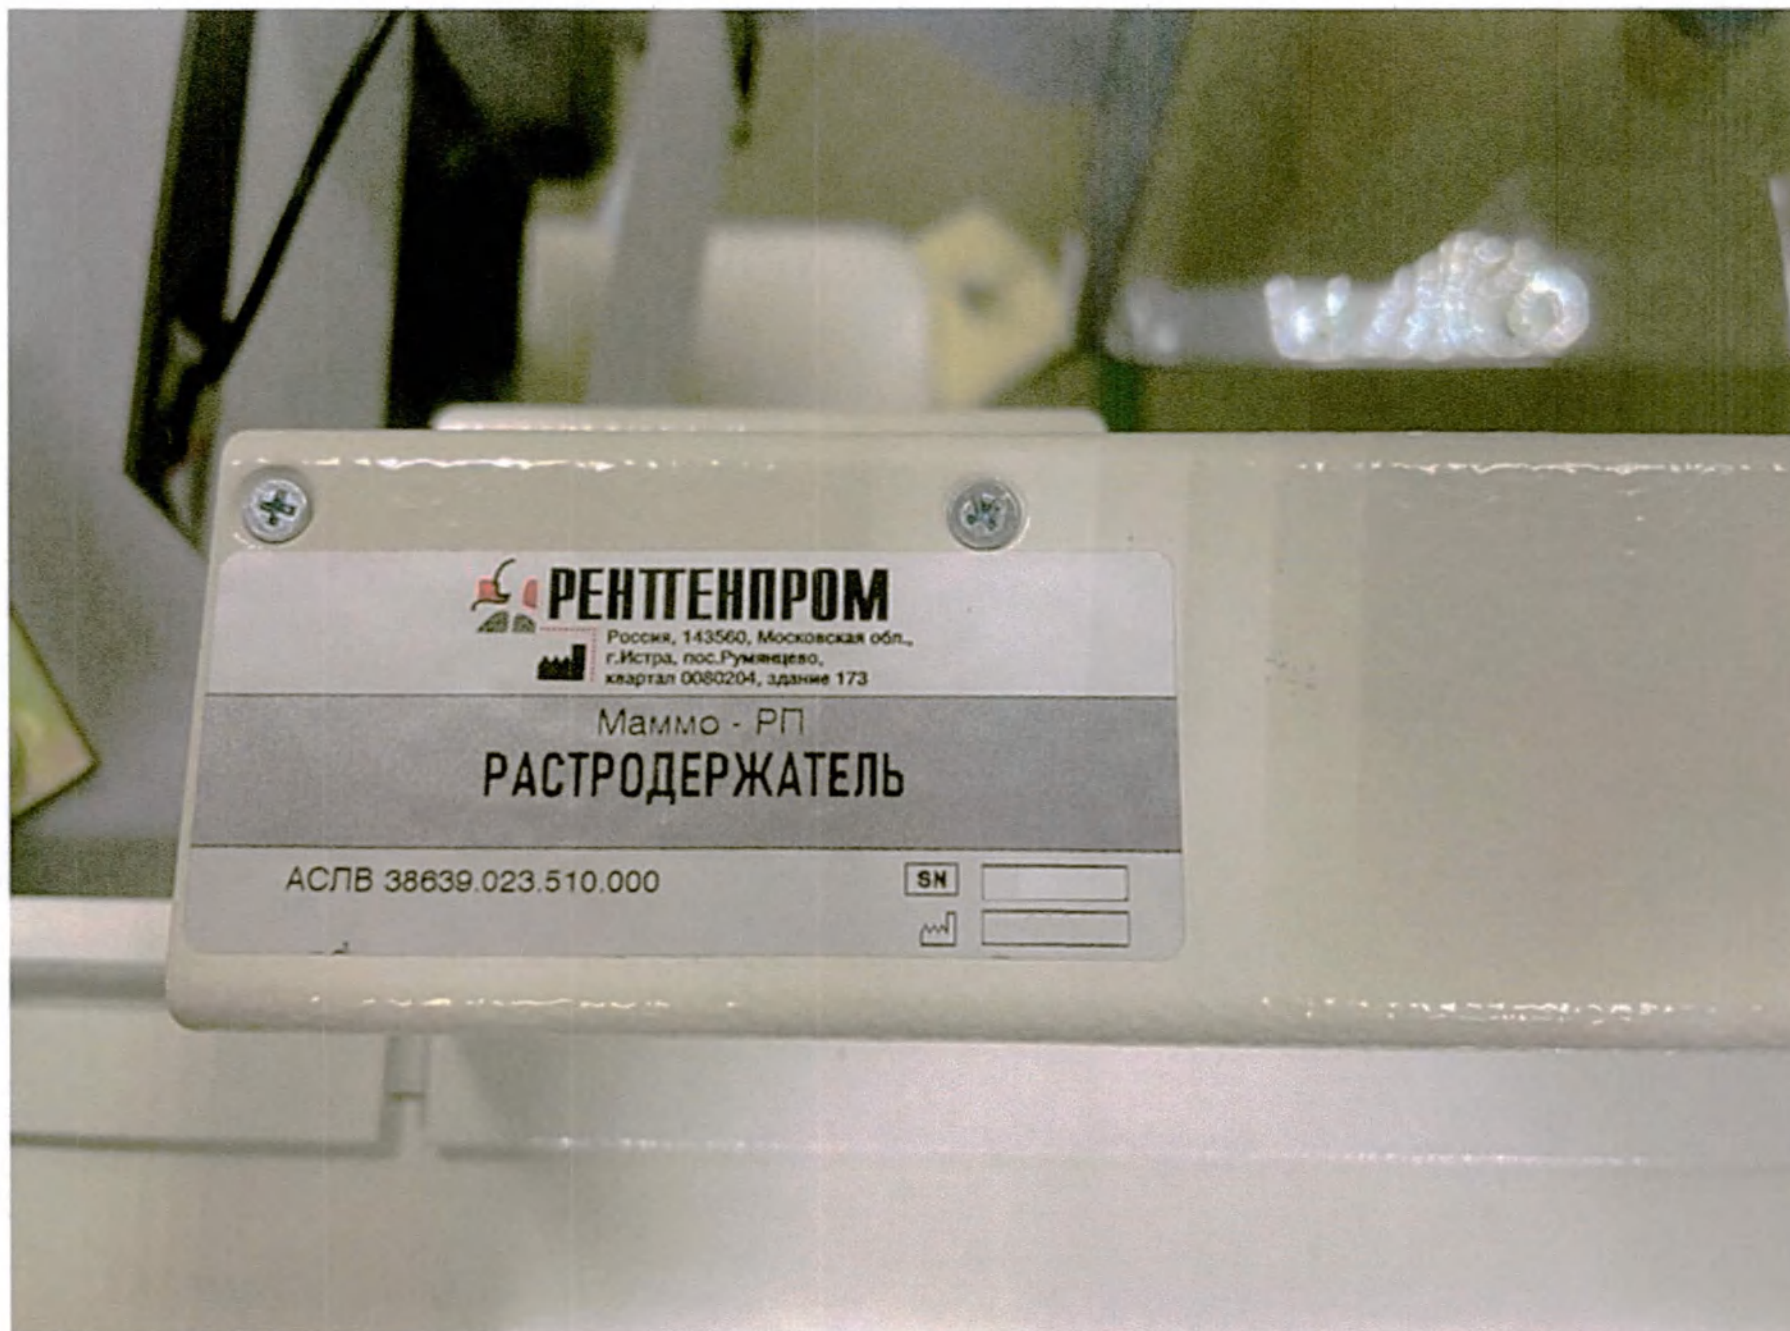





РЕНТГЕНПРОМ



Россия, 143560, Московская обл.,
г. Истра, пос. Румянцево,
квартал 0080204, здание 173


Маммо-РП

ШИРМА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ

АСЛВ 38639.030.310.000

SN




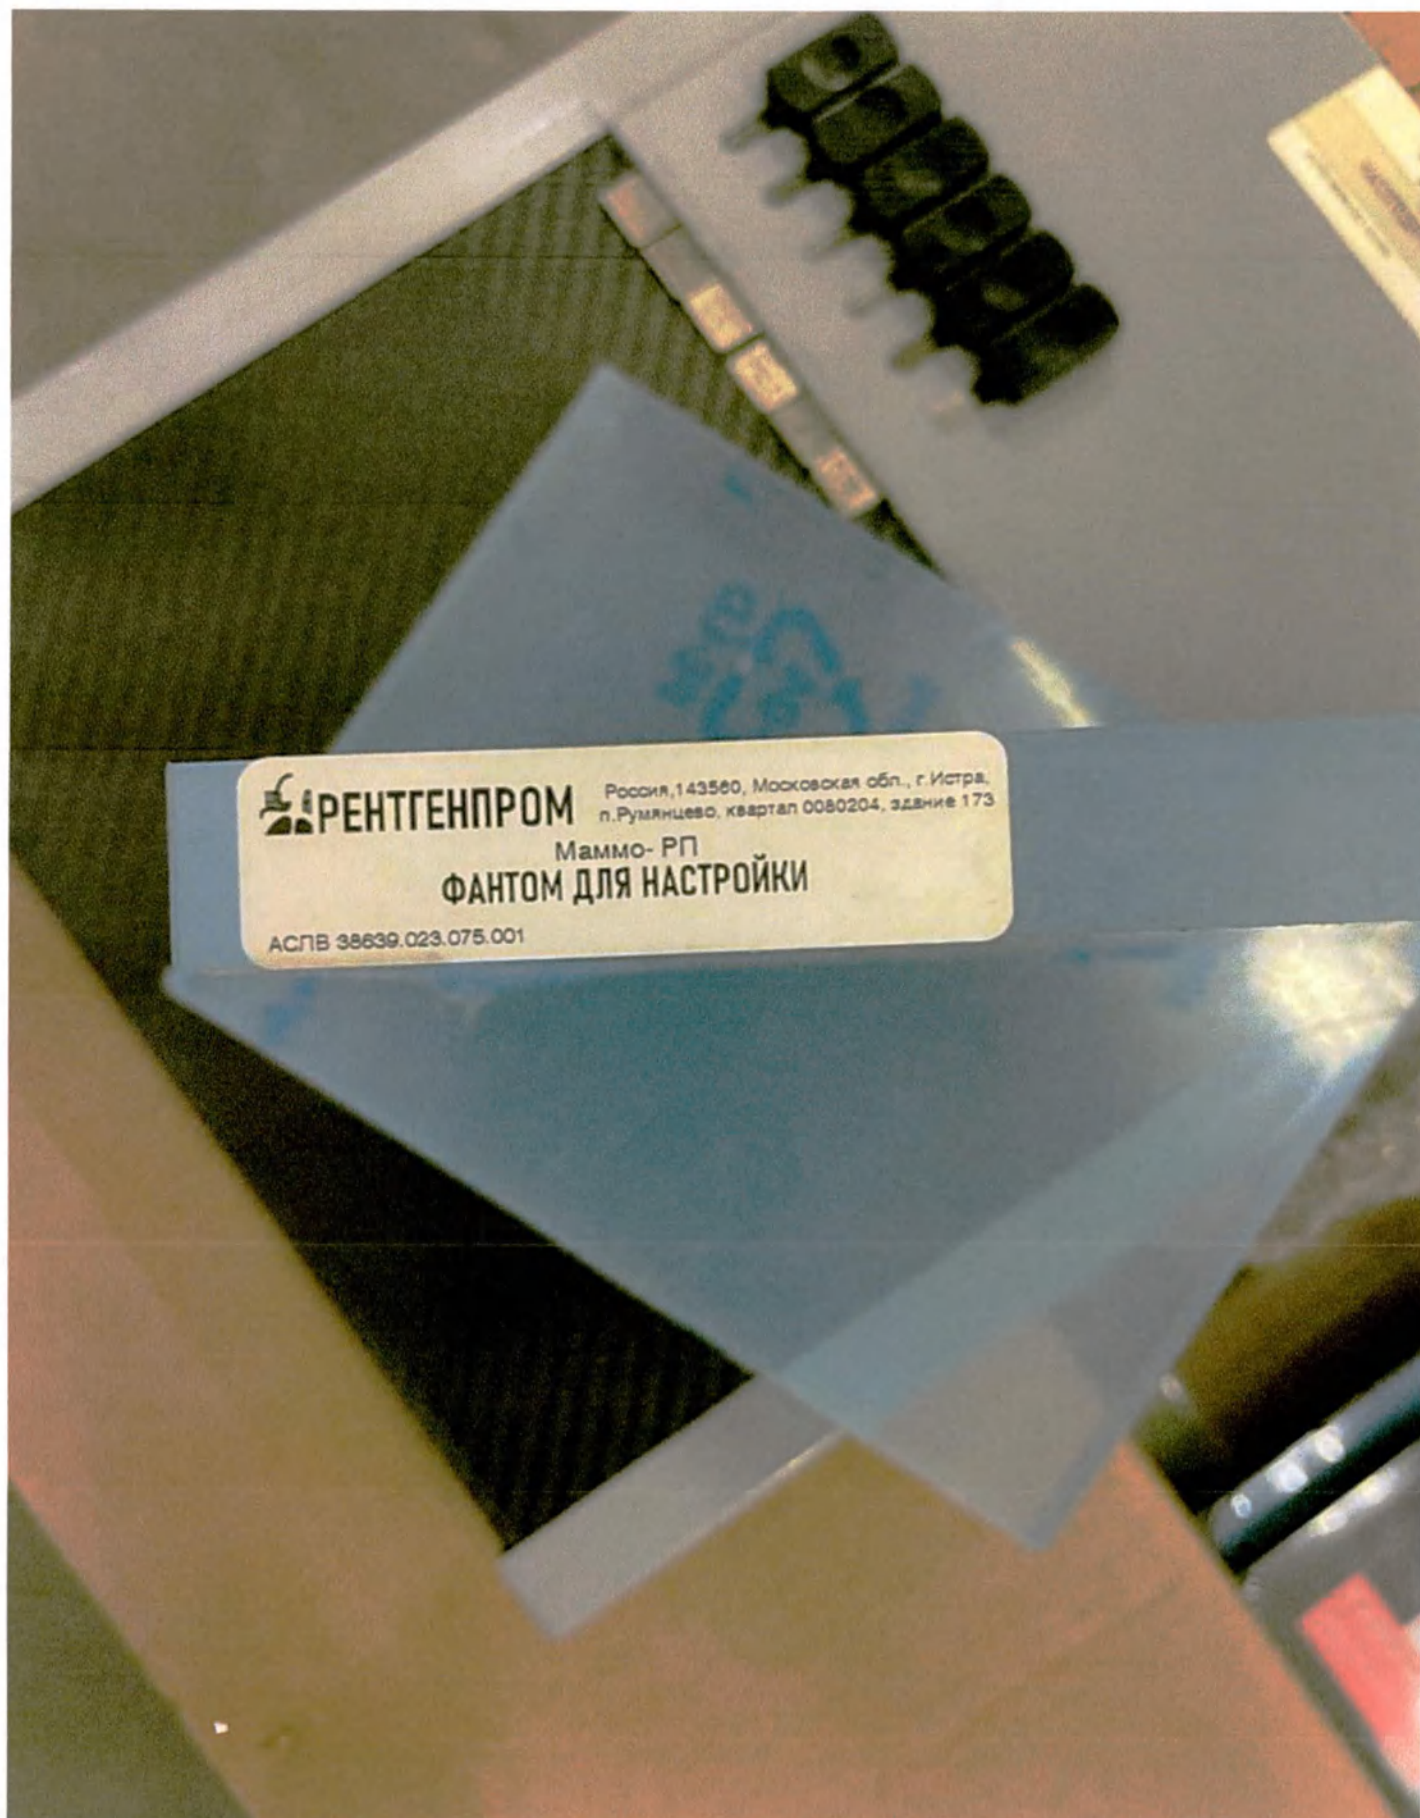

Комплекс средств управления маммографом на базе компьютера (АРМ 1)





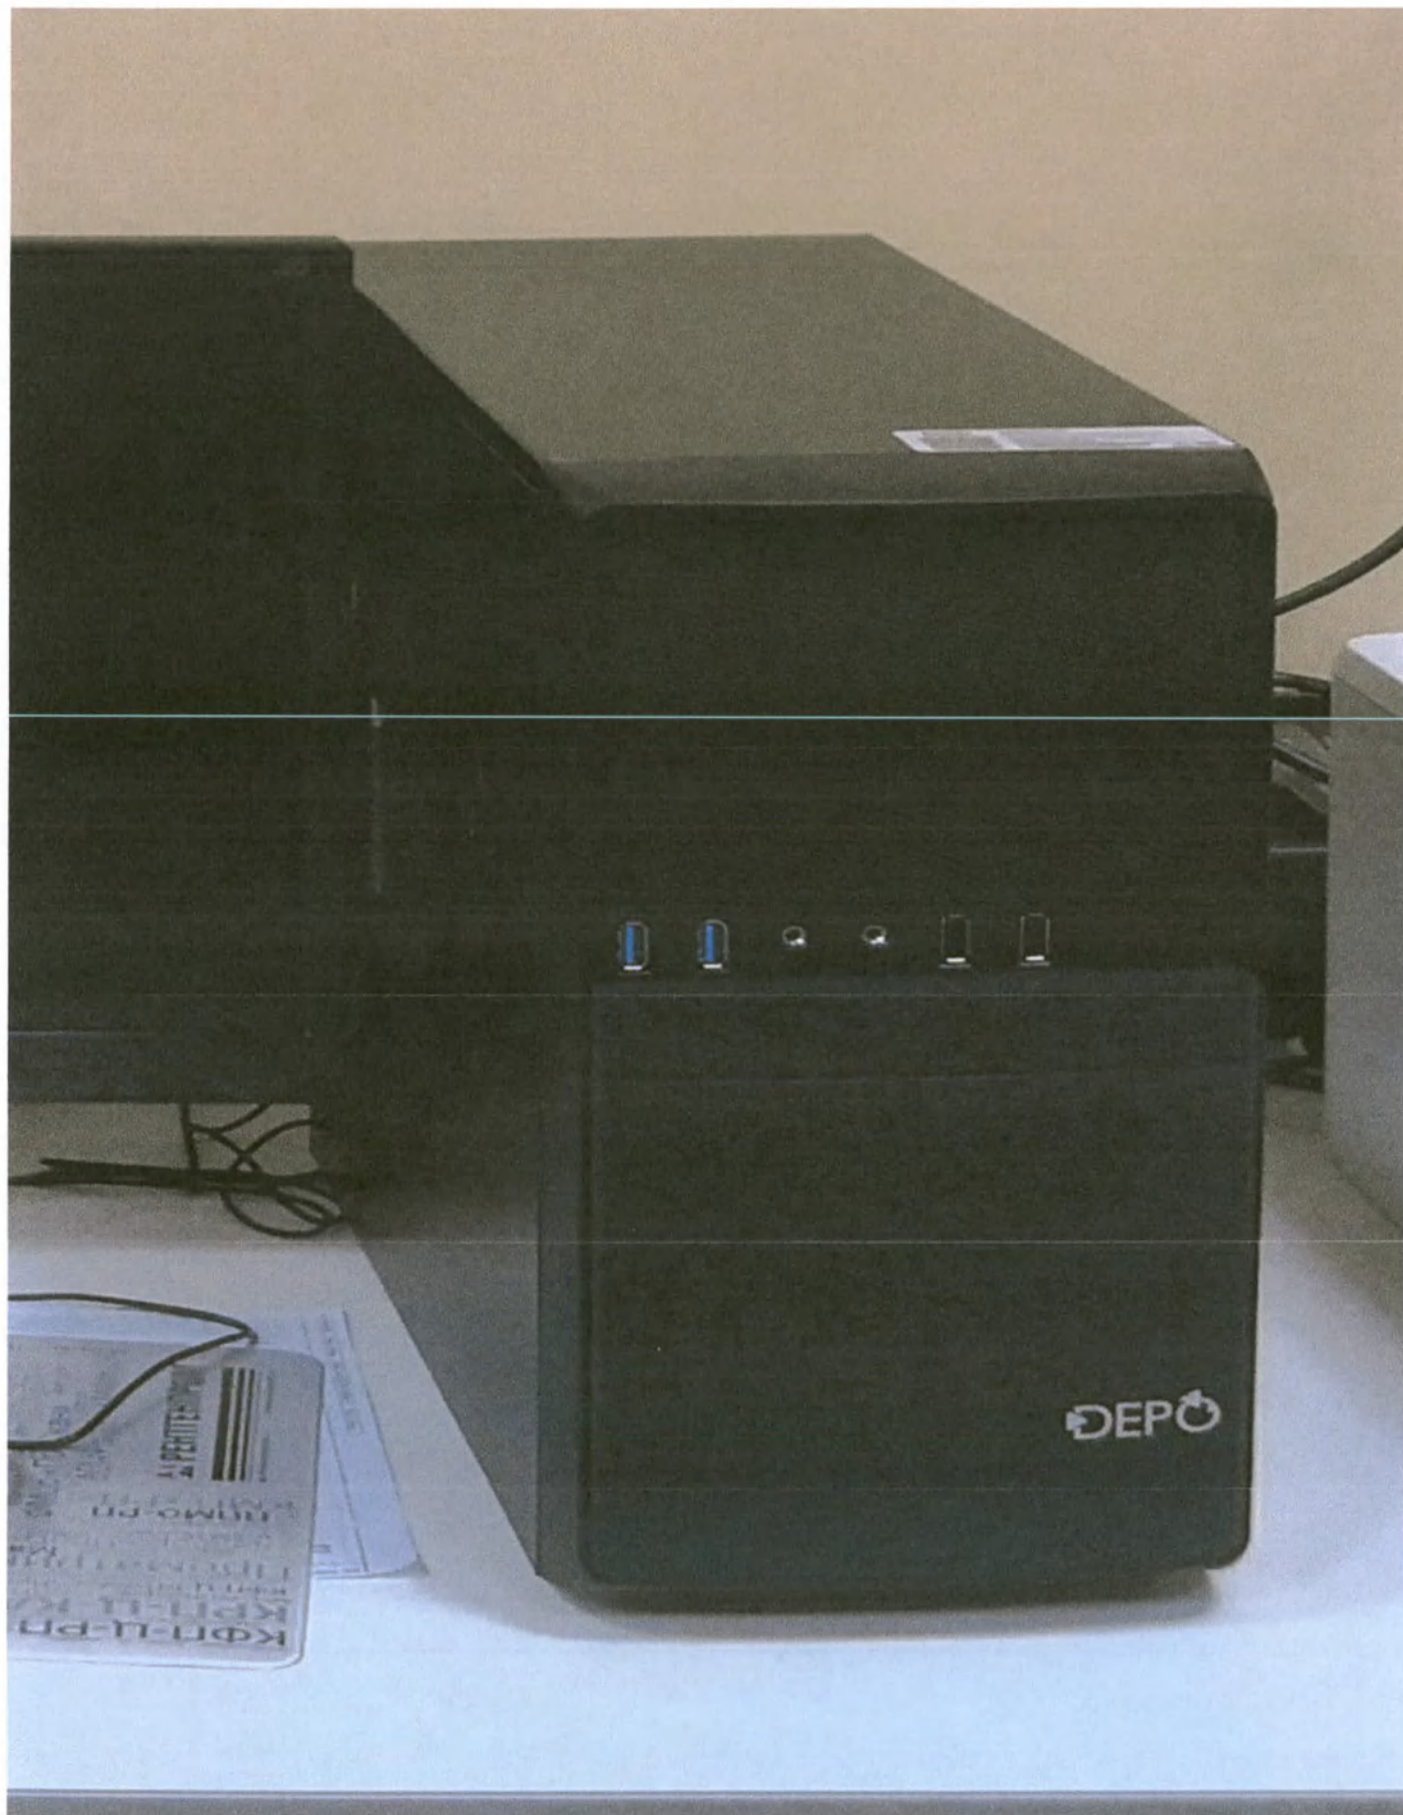



Системный блок: DEPO
Модель: Neos DH529
(1366385)
i3-10100/8GDDR4/T1Tb/T1Tb/DGLAN/KBu/Mu/400W/CAR3PCB

Сделано в России. ООО "ДЕПО Электроникс"
Питание: 220В 50Гц 3А ДАЦН.466219.020 TY
Дата производства: 09/2022
Гарантия: 36 мес. CAR3PCB

*Профессиональное оборудование,
не предназначено для домашнего использования.*



S/N:491204-058


















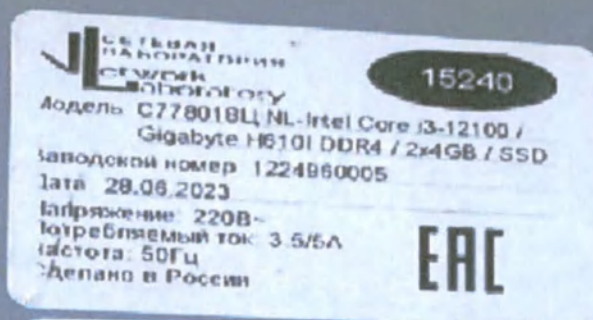

ВНИМАНИЕ!

Претензии по комплектации, начальной работоспособности, наличию внутренних повреждений и качеству предустановки системы рассматриваются только при опечатанном системном блоке.

Дополнительную информацию можно получить в сервисном центре продавца.







BenQ Product Name: **LCD Monitor**
Название продукта: ЖК-монитор

Model ID
Код модели: **PD2720U-T** Type/Тип: **PD2720U**

Rating/ Рейтинг: **100-240V~,50/60Hz, 2A**

Mfg. Date/Дата изг.: **April 2019**

R e v. : **00-006-AL**

P / N : **9H.LHKLA.TBE**

S / N : **ET64K01611019**



BenQ Corporation (16 Jihu Road, Neihsu, Taipei 114, Taiwan / Тайвань)
Importer: BenQ Europe B.V. Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Eindhoven, The Netherlands


Made in China /Сделано в Китае
Q40G032N-881-28A YHH



Ergonomie
Regelmäßige
Produktions-
überwachung
www.tuv.com
ID 0235004564



Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
Apparaten skall anslutas till jordat uttag







PHILIPS

LCD Monitor/液晶显示器
Дисплейный монитор с
интегрированным дисплеем
製品説明: 液晶ディスプレイ
Serial No.: Refer to barcode label

Model No./модель номер/型番

223V5L

Manufactured/製造日/Дата изготовления

Jun.2022



Philips Monitors & Displays, Nederland B.V.
www.dutchdisplay.com
© 2022 Philips. All rights reserved.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
MMD (Shanghai) Electronics Technology Co., Ltd.
警告: 使用過度恐傷害視力。

MODEL ID: 223V5LHSB/01




SERIAL NUMBER: UK0A2223001568



190732-24

WARNING/AVERTISSEMENT:

This apparatus must be earthed.
Cet appareil doit être relié à la terre.
Dieser Apparat muss geerdet sein.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laitte on liitettävä suojakoskettimilla
varustettuun pistorasiaan.
Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt





SAMSUNG

LED монитор/LED monitor

Typ № / Тип №: S24F350FH

Өнім / Модель: S24F350FH

Өнімнің коды/Код моделі/Код модели: LS24F350FHXC1

HDMI

Қуат көзі/Джерело живлення/Источник питания:

Тұрақты ток/Постійний струм/Постоянный ток 14V(B)  1.78A

IP 20 Дәрежелі құрал-жабдық III/Обладнання класу III/Оборудование класса III

Өндіру мерзімі/Дата виготовлення/Дата изготовления: 2018.05.

Қытайда жасалған. Өндіруші-зауыт: «ДонгГуан РИСАН

Электроник Ко., Лтд.» / Вироблено в КНР на потужностях.

«Дунгуань РИСАН Електронік Ко., Лтд.» / Произведено в КНР.

Завод-изготовитель: «ДонгГуан РИСАН Электроник Ко, Лтд.»



Сериялы нөмірі/Серійний номер/Серийный номер: ZZMTH4ZK502097T



Нұсқа №/Версія/Версия:


BB03


BN68-07103B-00








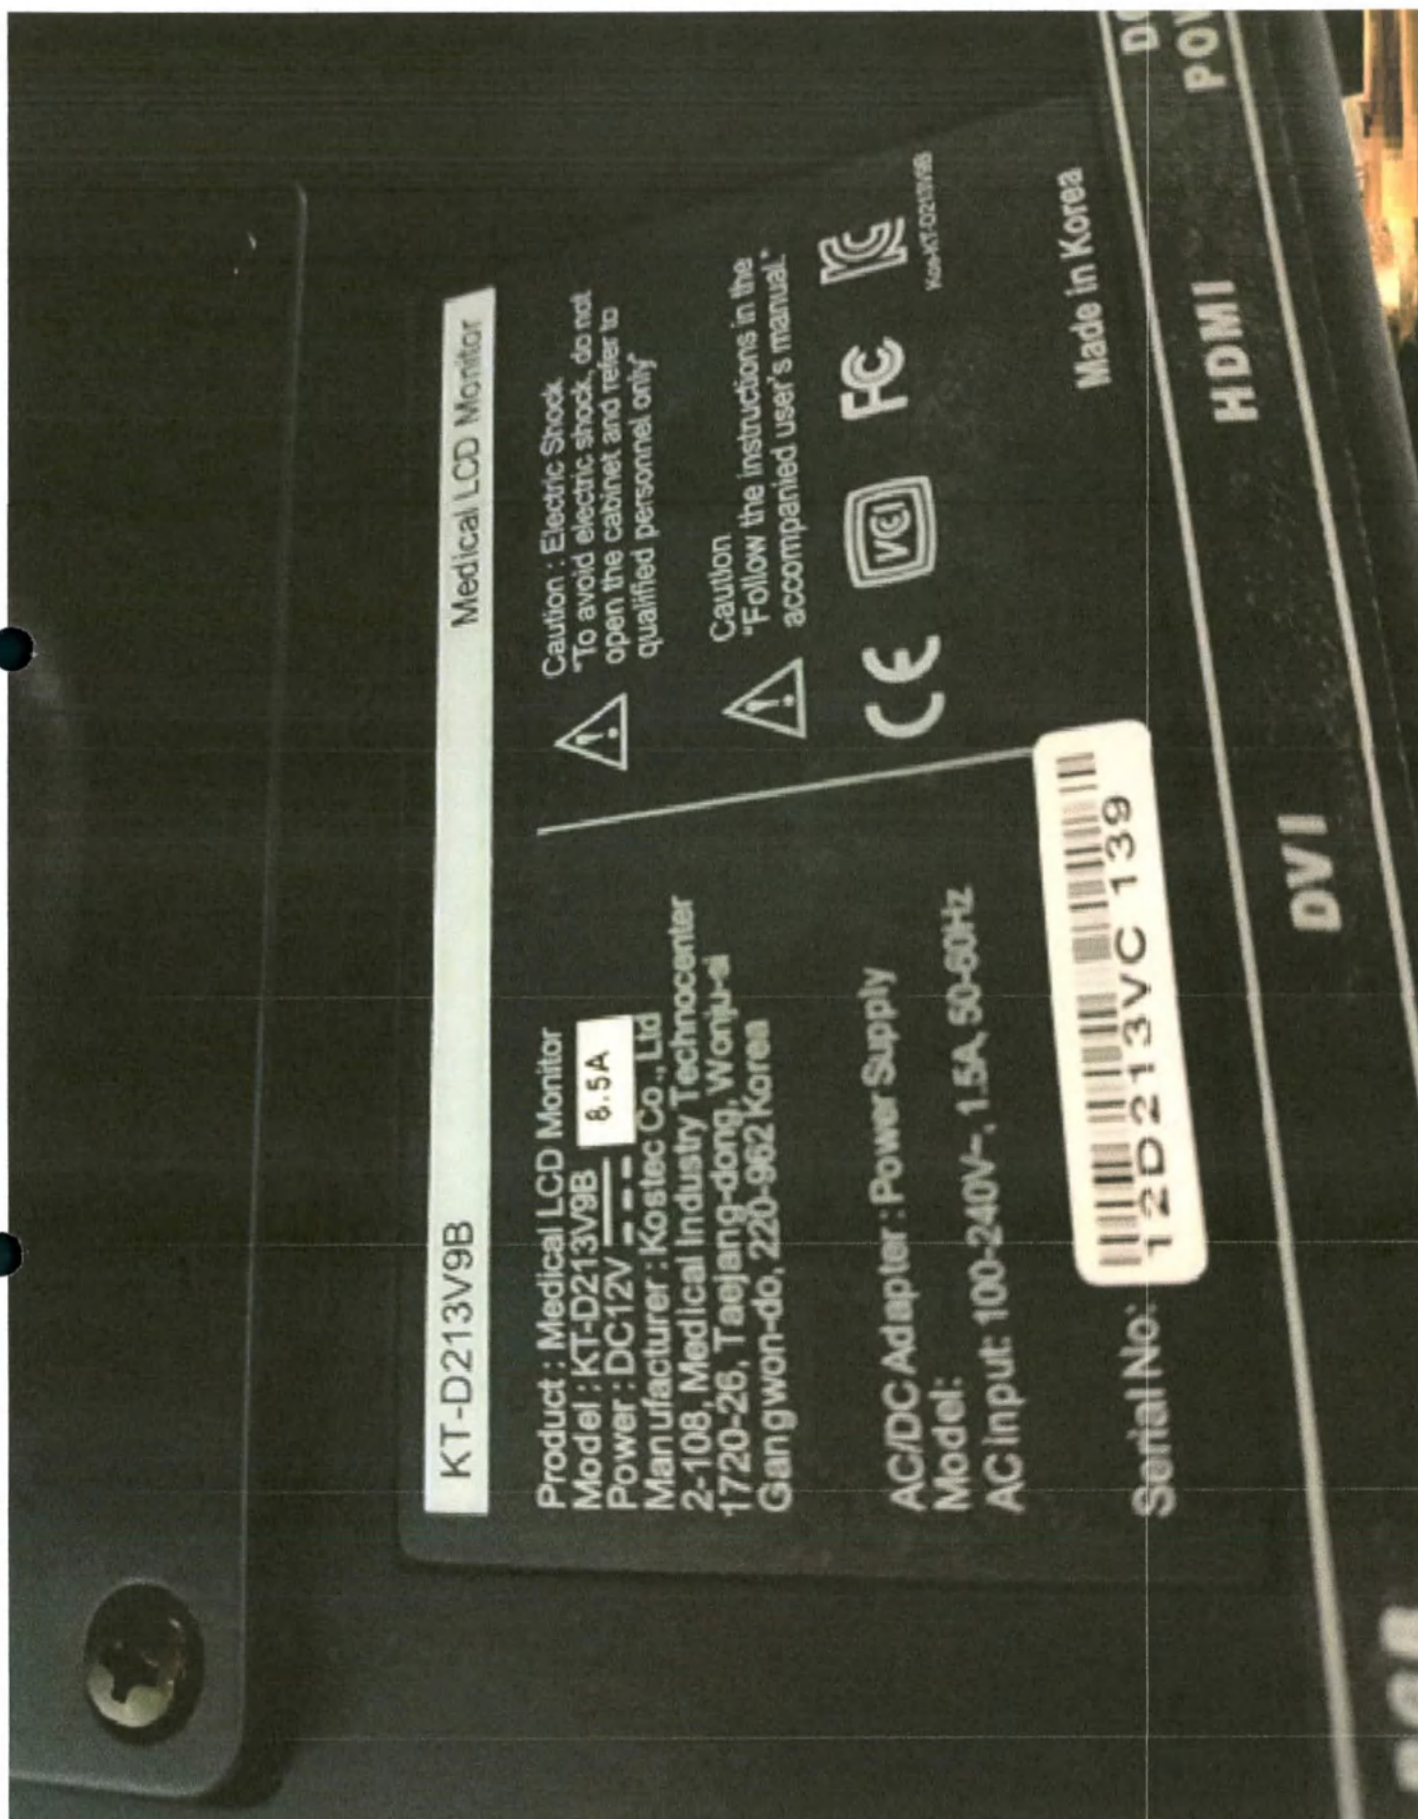

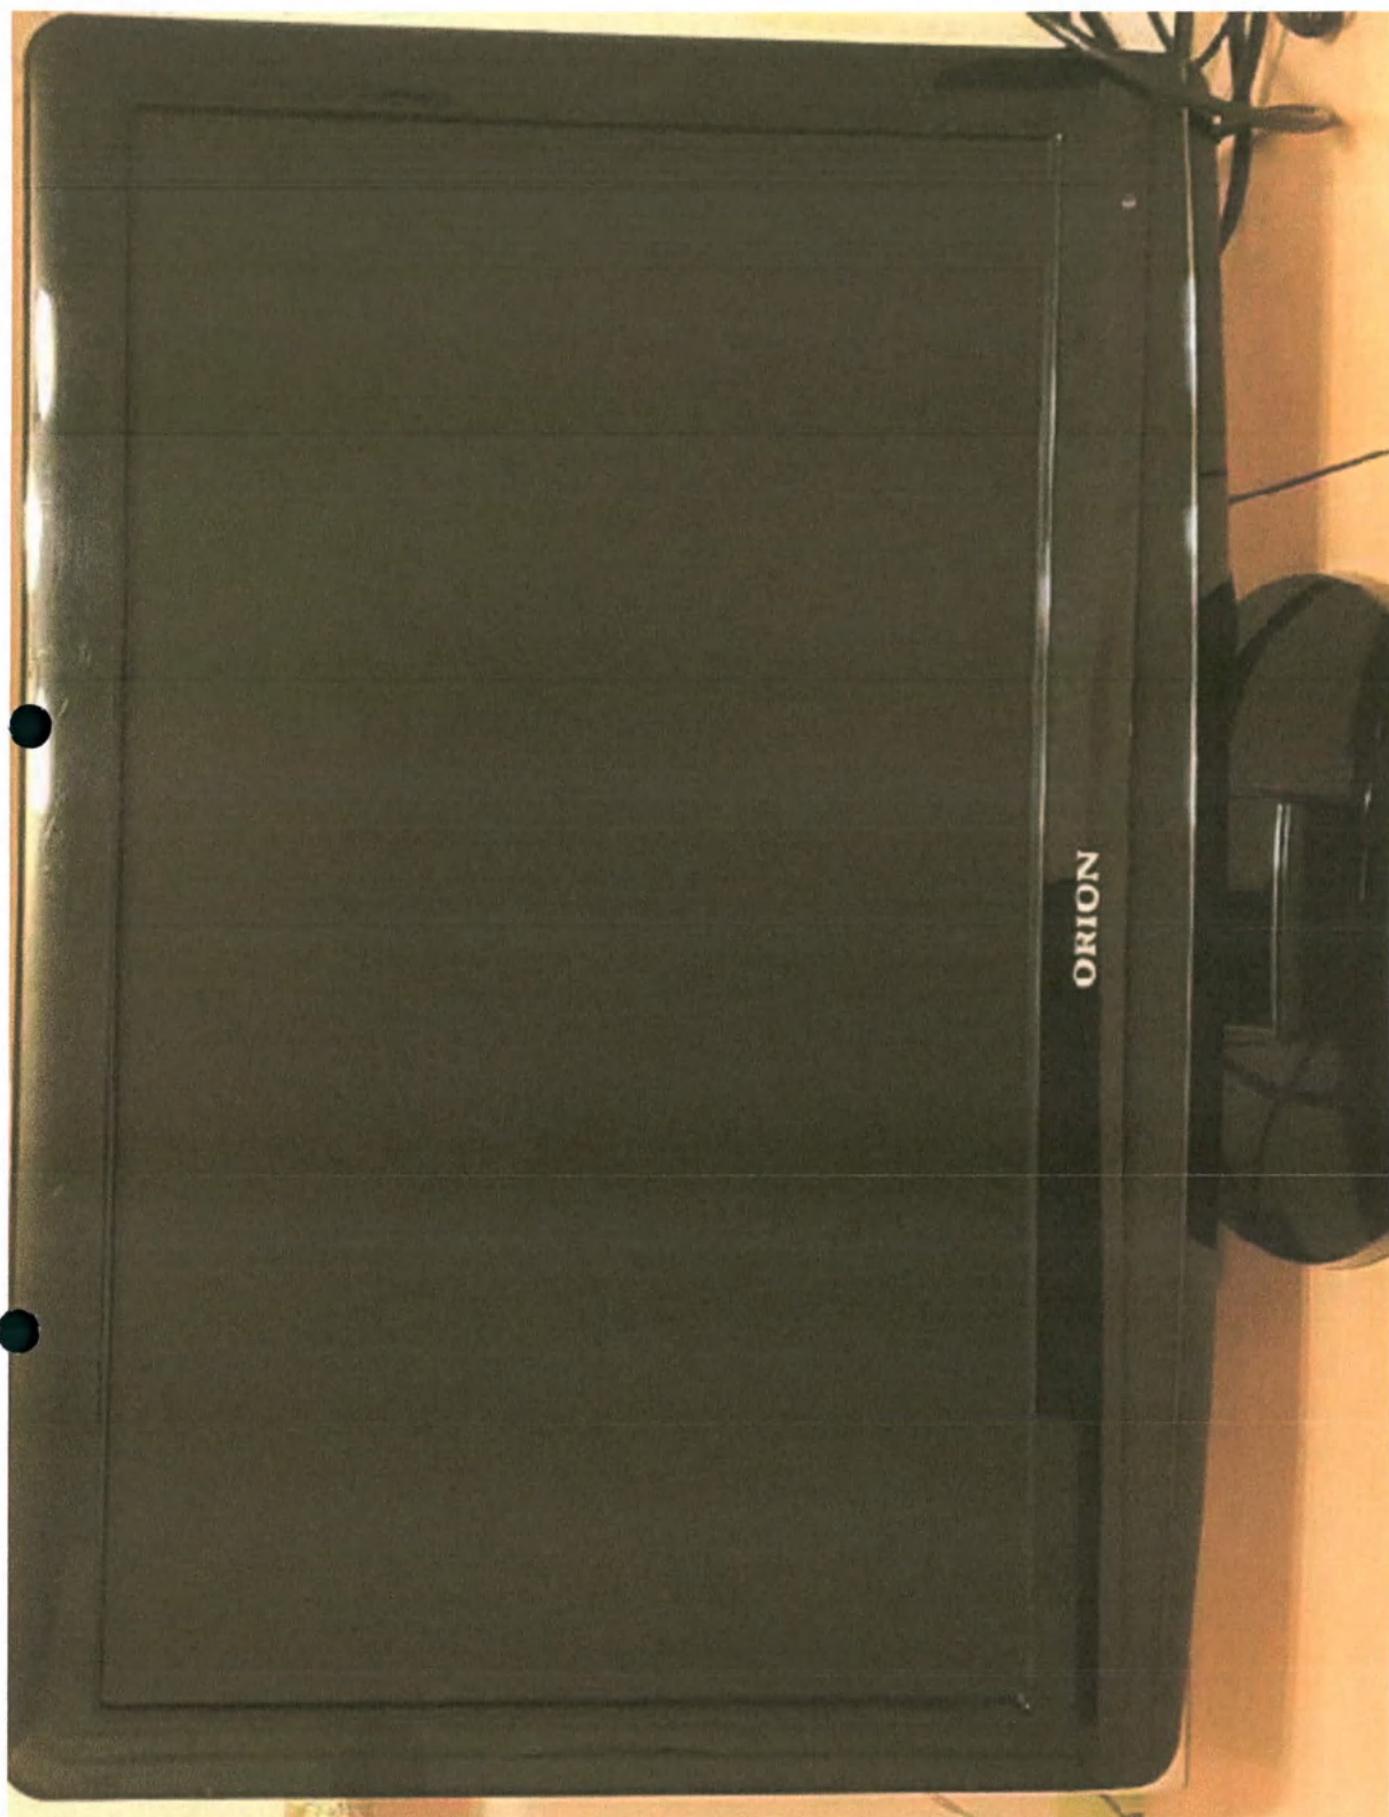



To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

FCC Verified : Class "A"

This device complies with the Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

警告使用者:

此為電腦資訊技術設備。於居住環境中使用時。可能會造成射頻擾動。在此種情況下。使用者會要求採取某些適當的對策。

MPDP


- Monitor/모니터/Плазменный цветной/Плазменный цветовой монитор
- Model Name/모델명/Модель: OPM-4260
- Voltage/전압/Напряжение : 100 - 240V~ / 100-240 B~
- Current/전류/текущий : 4A
- Frequency/주파수/Частота : 50/60Hz / 50/60 Гц
- Manufacture/제조사 : Orion Co., LTD (주)오리온
- Serial No./제조년월 :



S/N



KCC-1000A
OPC-OPM-4260A



UL LISTED
APPROVED
CLASS
K20

ORION CO., LTD.

韓國製造/Made in Korea / Сделано в Кореи /
Зроблено в Корі / Кореяда жасалган

사용상의 주의사항

- 감전사고 예방을 위하여 일체를 열지 마세요.
- 내부에는 소비자가 수리할 수 있는 부분이 없으므로 고장은 서비스센터로 연락 바랍니다. 서비스센터 : 054-460-5997

PC



IN



OUT

DVI-D



IN



OUT

RS-232C



IN



OUT







hp

Serial No. PHFMH39244

Número de Serie

Número de Producto

Product No. W1A53A

Made in Philippines
Hecho en Filipinas
Regulatory Model Number
SHNGC-1800-00

220-240V ~AC
50/60Hz, 3.4A

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated June 24, 2007.

For FDA: HP Inc., No. 2727 Jinke Road, Shanghai, China 201203

Laite on liitettävä suojakosketinilla varustettuun pistorasiaan.
 Apparaten må tilkoples jordnet stikkontakt.
 Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
 Apparätets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

UK
CA

HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

HP, HQ-TRE
71025 Boebingen
Germany

OND2

SITE:PH1 >PET<

CE

CS

EAC

RoHS

WEEE

REACH

ISO 14001

ISO 9001

ISO 13485

ISO 26262

ISO 27001

ISO 27002

ISO 27005

ISO 27017

ISO 27018

ISO 27019

ISO 27021

ISO 27022

ISO 27023

ISO 27024

ISO 27025

ISO 27026

ISO 27027

ISO 27028

ISO 27029

ISO 27030

ISO 27031

ISO 27032

ISO 27033

ISO 27034

ISO 27035

ISO 27036

ISO 27037

ISO 27038

ISO 27039

ISO 27040

ISO 27041

ISO 27042

ISO 27043

ISO 27044

ISO 27045

ISO 27046

ISO 27047

ISO 27048

ISO 27049

ISO 27050

ISO 27051

ISO 27052

ISO 27053

ISO 27054

ISO 27055

ISO 27056

ISO 27057

ISO 27058

ISO 27059

ISO 27060

ISO 27061

ISO 27062

ISO 27063

ISO 27064

ISO 27065

ISO 27066

ISO 27067

ISO 27068

ISO 27069

ISO 27070

ISO 27071

ISO 27072

ISO 27073

ISO 27074

ISO 27075

ISO 27076

ISO 27077

ISO 27078

ISO 27079

ISO 27080

ISO 27081

ISO 27082

ISO 27083

ISO 27084

ISO 27085

ISO 27086

ISO 27087

ISO 27088

ISO 27089

ISO 27090

ISO 27091

ISO 27092

ISO 27093

ISO 27094

ISO 27095

ISO 27096

ISO 27097

ISO 27098

ISO 27099

ISO 27100

ISO 27101

ISO 27102

ISO 27103

ISO 27104

ISO 27105

ISO 27106

ISO 27107

ISO 27108

ISO 27109

ISO 27110

ISO 27111

ISO 27112

ISO 27113

ISO 27114

ISO 27115

ISO 27116

ISO 27117

ISO 27118

ISO 27119

ISO 27120

ISO 27121

ISO 27122

ISO 27123

ISO 27124

ISO 27125

ISO 27126

ISO 27127

ISO 27128

ISO 27129

ISO 27130

ISO 27131

ISO 27132

ISO 27133

ISO 27134

ISO 27135

ISO 27136

ISO 27137

ISO 27138

ISO 27139

ISO 27140

ISO 27141

ISO 27142

ISO 27143

ISO 27144

ISO 27145

ISO 27146

ISO 27147

ISO 27148

ISO 27149

ISO 27150

ISO 27151

ISO 27152

ISO 27153

ISO 27154

ISO 27155

ISO 27156

ISO 27157

ISO 27158

ISO 27159

ISO 27160

ISO 27161

ISO 27162

ISO 27163

ISO 27164

ISO 27165

ISO 27166

ISO 27167

ISO 27168

ISO 27169

ISO 27170

ISO 27171

ISO 27172

ISO 27173

ISO 27174

ISO 27175

ISO 27176

ISO 27177

ISO 27178

ISO 27179

ISO 27180

ISO 27181

ISO 27182

ISO 27183

ISO 27184

ISO 27185

ISO 27186

ISO 27187

ISO 27188

ISO 27189

ISO 27190

ISO 27191

ISO 27192

ISO 27193

ISO 27194

ISO 27195

ISO 27196

ISO 27197

ISO 27198

ISO 27199

ISO 27200

ISO 27201

ISO 27202

ISO 27203

ISO 27204

ISO 27205

ISO 27206

ISO 27207

ISO 27208

ISO 27209

ISO 27210

ISO 27211

ISO 27212

ISO 27213

ISO 27214

ISO 27215

ISO 27216

ISO 27217

ISO 27218

ISO 27219

ISO 27220

ISO 27221

ISO 27222

ISO 27223

ISO 27224

ISO 27225

ISO 27226

ISO 27227

ISO 27228

ISO 27229

ISO 27230

ISO 27231

ISO 27232

ISO 27233

ISO 27234

ISO 27235

ISO 27236

ISO 27237

ISO 27238

ISO 27239

ISO 27240

ISO 27241

ISO 27242

ISO 27243

ISO 27244

ISO 27245

ISO 27246

ISO 27247

ISO 27248

ISO 27249

ISO 27250

ISO 27251

ISO 27252

ISO 27253

ISO 27254

ISO 27255

ISO 27256

ISO 27257

ISO 27258

ISO 27259

ISO 27260

ISO 27261

ISO 27262

ISO 27263

ISO 27264

ISO 27265

ISO 27266

ISO 27267

ISO 27268

ISO 27269

ISO 27270

ISO 27271

ISO 27272

ISO 27273

ISO 27274

ISO 27275

ISO 27276

ISO 27277

ISO 27278

ISO 27279

ISO 27280

ISO 27281

ISO 27282

ISO 27283

ISO 27284

ISO 27285

ISO 27286

ISO 27287

ISO 27288

ISO 27289

ISO 27290

ISO 27291

ISO 27292

ISO 27293

ISO 27294

ISO 27295

ISO 27296

ISO 27297

ISO 27298

ISO 27299

ISO 27300

ISO 27301

ISO 27302

ISO 27303

ISO 27304

ISO 27305

ISO 27306

ISO 27307

ISO 27308

ISO 27309

ISO 27310

ISO 27311

ISO 27312

ISO 27313

ISO 27314

ISO 27315

ISO 27316

ISO 27317

ISO 27318

ISO 27319

ISO 27320

ISO 27321

ISO 27322

ISO 27323

ISO 27324

ISO 27325

ISO 27326

ISO 27327

ISO 27328

ISO 27329

ISO 27330

ISO 27331

ISO 27332

ISO 27333

ISO 27334

ISO 27335

ISO 27336

ISO 27337

ISO 27338

ISO 27339

ISO 27340

ISO 27341

ISO 27342

ISO 27343

ISO 27344

ISO 27345

ISO 27346

ISO 27347

ISO 27348

ISO 27349

ISO 27350

ISO 27351

ISO 27352

ISO 27353

ISO 27354

ISO 27355

ISO 27356

ISO 27357

ISO 27358

ISO 27359

ISO 27360

ISO 27361

ISO 27362

ISO 27363

ISO 27364

ISO 27365

ISO 27366

ISO 27367

ISO 27368

ISO 27369

ISO 27370

ISO 27371

ISO 27372

ISO 27373

ISO 27374

ISO 27375

ISO 27376

ISO 27377

ISO 27378

ISO 27379

ISO 27380

ISO 27381

ISO 27382

ISO 27383

ISO 27384

ISO 27385

ISO 27386

ISO 27387

ISO 27388

ISO 27389

ISO 27390

ISO 27391

ISO 27392

ISO 27393

ISO 27394

ISO 27395

ISO 27396

ISO 27397

ISO 27398

ISO 27399

ISO 27400

ISO 27401

ISO 27402

ISO 27403

ISO 27404

ISO 27405

ISO 27406

ISO 27407

ISO 27408

ISO 27409

ISO 27410

ISO 27411

ISO 27412

ISO 27413

ISO 27414

ISO 27415

ISO 27416

ISO 27417

ISO 27418

ISO 27419

ISO 27420

ISO 27421

ISO 27422

ISO 27423

ISO 27424

ISO 27425

ISO 27426

ISO 27427

ISO 27428

ISO 27429

ISO 27430

ISO 27431

ISO 27432

ISO 27433

ISO 27434

ISO 27435

ISO 27436

ISO 27437

ISO 27438

ISO 27439

ISO 27440

ISO 27441

ISO 27442

ISO 27443

ISO 27444

ISO 27445

ISO 27446

ISO 27447

ISO 27448

ISO 27449

ISO 27450

ISO 27451

ISO 27452

ISO 27453

ISO 27454

ISO 27455

ISO 27456

ISO 27457

ISO 27458

ISO 27459

ISO 27460

ISO 27461

ISO 27462

ISO 27463

ISO 27464

ISO 27465

ISO 27466

ISO 27467

ISO 27468

ISO 27469

ISO 27470

ISO 27471

ISO 27472

ISO 27473

ISO 27474

ISO 27475

ISO 27476

ISO 27477

ISO 27478

ISO 27479

ISO 27480

ISO 27481

ISO 27482

ISO 27483

ISO 27484

ISO 27485

ISO 27486

ISO 27487

ISO 27488

ISO 27489

ISO 27490

ISO 27491

ISO 27492

ISO 27493

ISO 27494

ISO 27495

ISO 27496

ISO 27497

ISO 27498

ISO 27499

ISO 27500

ISO 27501

ISO 27502

ISO 27503

ISO 27504

ISO 27505

ISO 27506

ISO 27507

ISO 27508

ISO 27509

ISO 27510

ISO 27511

ISO 27512

ISO 27513

ISO 27514

ISO 27515

ISO 27516

ISO 27517

ISO 27518

ISO 27519

ISO 27520

ISO 27521

ISO 27522

ISO 27523

ISO 27524

ISO 27525

ISO 27526

ISO 27527

ISO 27528

ISO 27529

ISO 27530

ISO 27531

ISO 27532

ISO 27533

ISO 27534

ISO 27535

ISO 27536

ISO 27537

ISO 27538

ISO 27539

ISO 27540

ISO 27541

ISO 27542

ISO 27543

ISO 27544

ISO 27545

ISO 27546

ISO 27547

ISO 27548

ISO 27549

ISO 27550

ISO 27551

ISO 27552

ISO 27553

ISO 27554

ISO 27555

ISO 27556

ISO 27557

ISO 27558

ISO 27559

ISO 27560

ISO 27561

ISO 27562

ISO 27563

ISO 27564

ISO 27565

ISO 27566

ISO 27567

ISO 27568

ISO 27569

ISO 27570

ISO 27571

ISO 27572

ISO 27573

ISO 27574

ISO 27575

ISO 27576

ISO 27577

ISO 27578

ISO 27579

ISO 27580

ISO 27581

ISO 27582

ISO 27583

ISO 27584

ISO 27585

ISO 27586

ISO 27587

ISO 27588

ISO 27589

ISO 27590

ISO 27591

ISO 27592

ISO 27593

ISO 27594

ISO 27595

ISO 27596

ISO 27597

ISO 27598

ISO 27599

ISO 27600

ISO 27601

ISO 27602

ISO 27603

ISO 27604

ISO 27605

ISO 27606

ISO 27607

ISO 27608

ISO 27609

ISO 27610

ISO 27611

ISO 27612

ISO 27613

ISO 27614

ISO 27615

ISO 27616

ISO 27617

ISO 27618

ISO 27619

ISO 27620

ISO 27621

ISO 27622

ISO 27623

ISO 27624

ISO 27625

ISO 27626

ISO 27627

ISO 27628

ISO 27629

ISO 27630

ISO 27631

ISO 27632

ISO 27633

ISO 27634

ISO 27635

ISO 27636

ISO 27637

ISO 27638

ISO 27639

ISO 27640

ISO 27641

ISO 27642

ISO 27643

ISO 27644

ISO 27645

ISO 27646

ISO 27647

ISO 27648

ISO 27649

ISO 27650

ISO 27651

ISO 27652

ISO 27653

ISO 27654

ISO 27655

ISO 27656

ISO 27657

ISO 27658

ISO 27659

ISO 27660

ISO 27661

ISO 27662

ISO 27663

ISO 27664

ISO 27665

ISO 27666

ISO 27667

ISO 27668

ISO 27669

ISO 27670

ISO 27671

ISO 27672

ISO 27673

ISO 27674

ISO 27675

ISO 27676

ISO 27677

ISO 27678

ISO 27679

ISO 27680

ISO 27681

ISO 27682

ISO 27683

ISO 27684

ISO 27685

ISO 27686

ISO 27687

ISO 27688

ISO 27689

ISO 27690

ISO 27691

ISO 27692

ISO 27693


ISO 27694

ISO 27695

ISO 27696

ISO 27697





Xerox (UK)
Oxford Road
Uxbridge UB8 1HS

Complies with FDA performance
standards for laser products except for
deviations pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007



Serial No.: 3228156069

Phaser™ 3020

Volts: AC 220-240V
Hertz: 50/60Hz
Amps: 2.5 A
Manufactured: APRIL 2017



052



www.tuv.com
ID 1416037221



Made in China

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla
varustettuun pistorasiaan.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.







SAMSUNG

**Лазерный принтер
Лазерний принтер**

Модель : Xpress M2020

Напряжение/напруга: 220-240~ В

Частота/частота: 50/60 Гц

Ток/струм: 2.5 А

Произведено / Вироблено : 08.02.2017

Класс защиты / Клас захисту : I

М/С : SL-M2020/FEV



Серийный номер/Серійний номер: 07VFB8GJ2B007JL



CE EAC




CLASS 1 LASER PRODUCT

Сделано в Китае/Вироблено в Китаї
REV. 00 / Версія 00








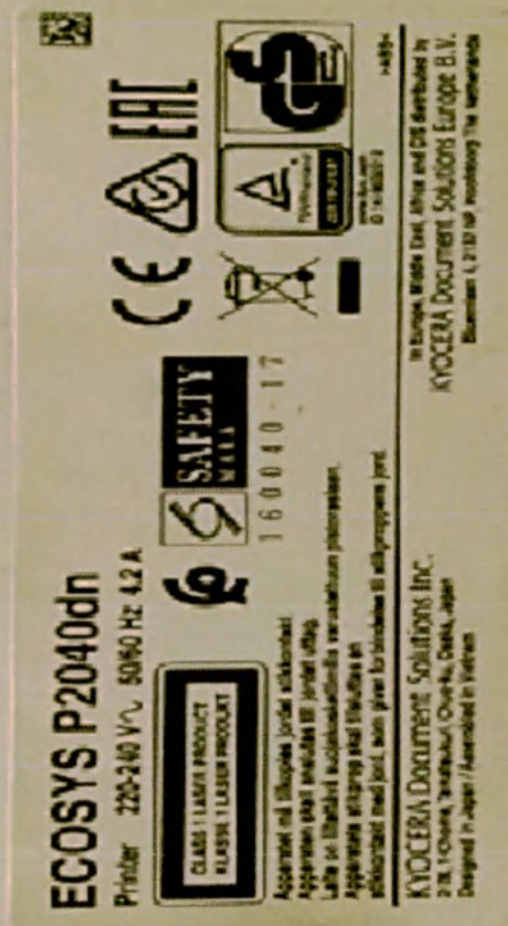



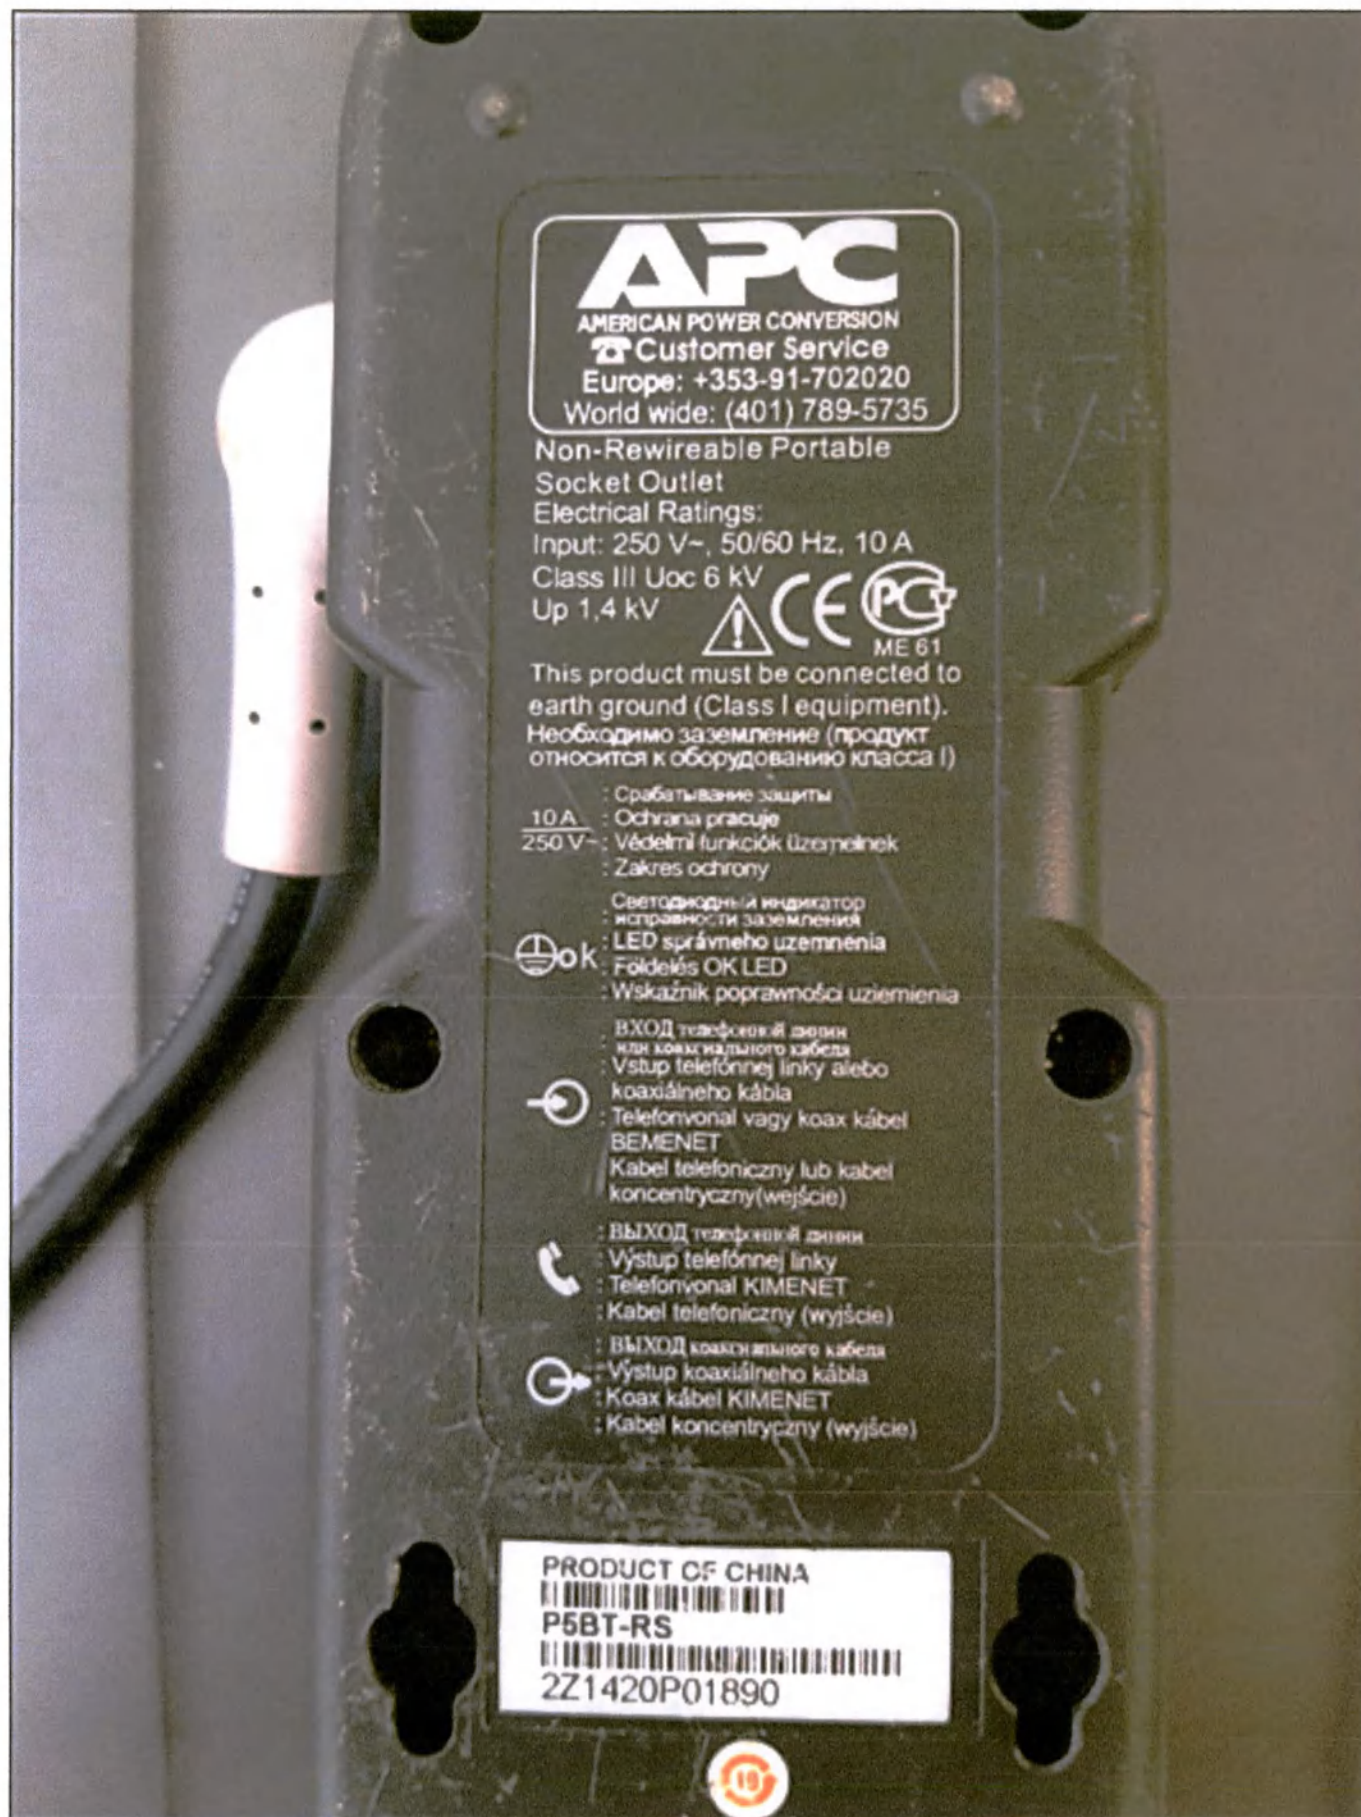













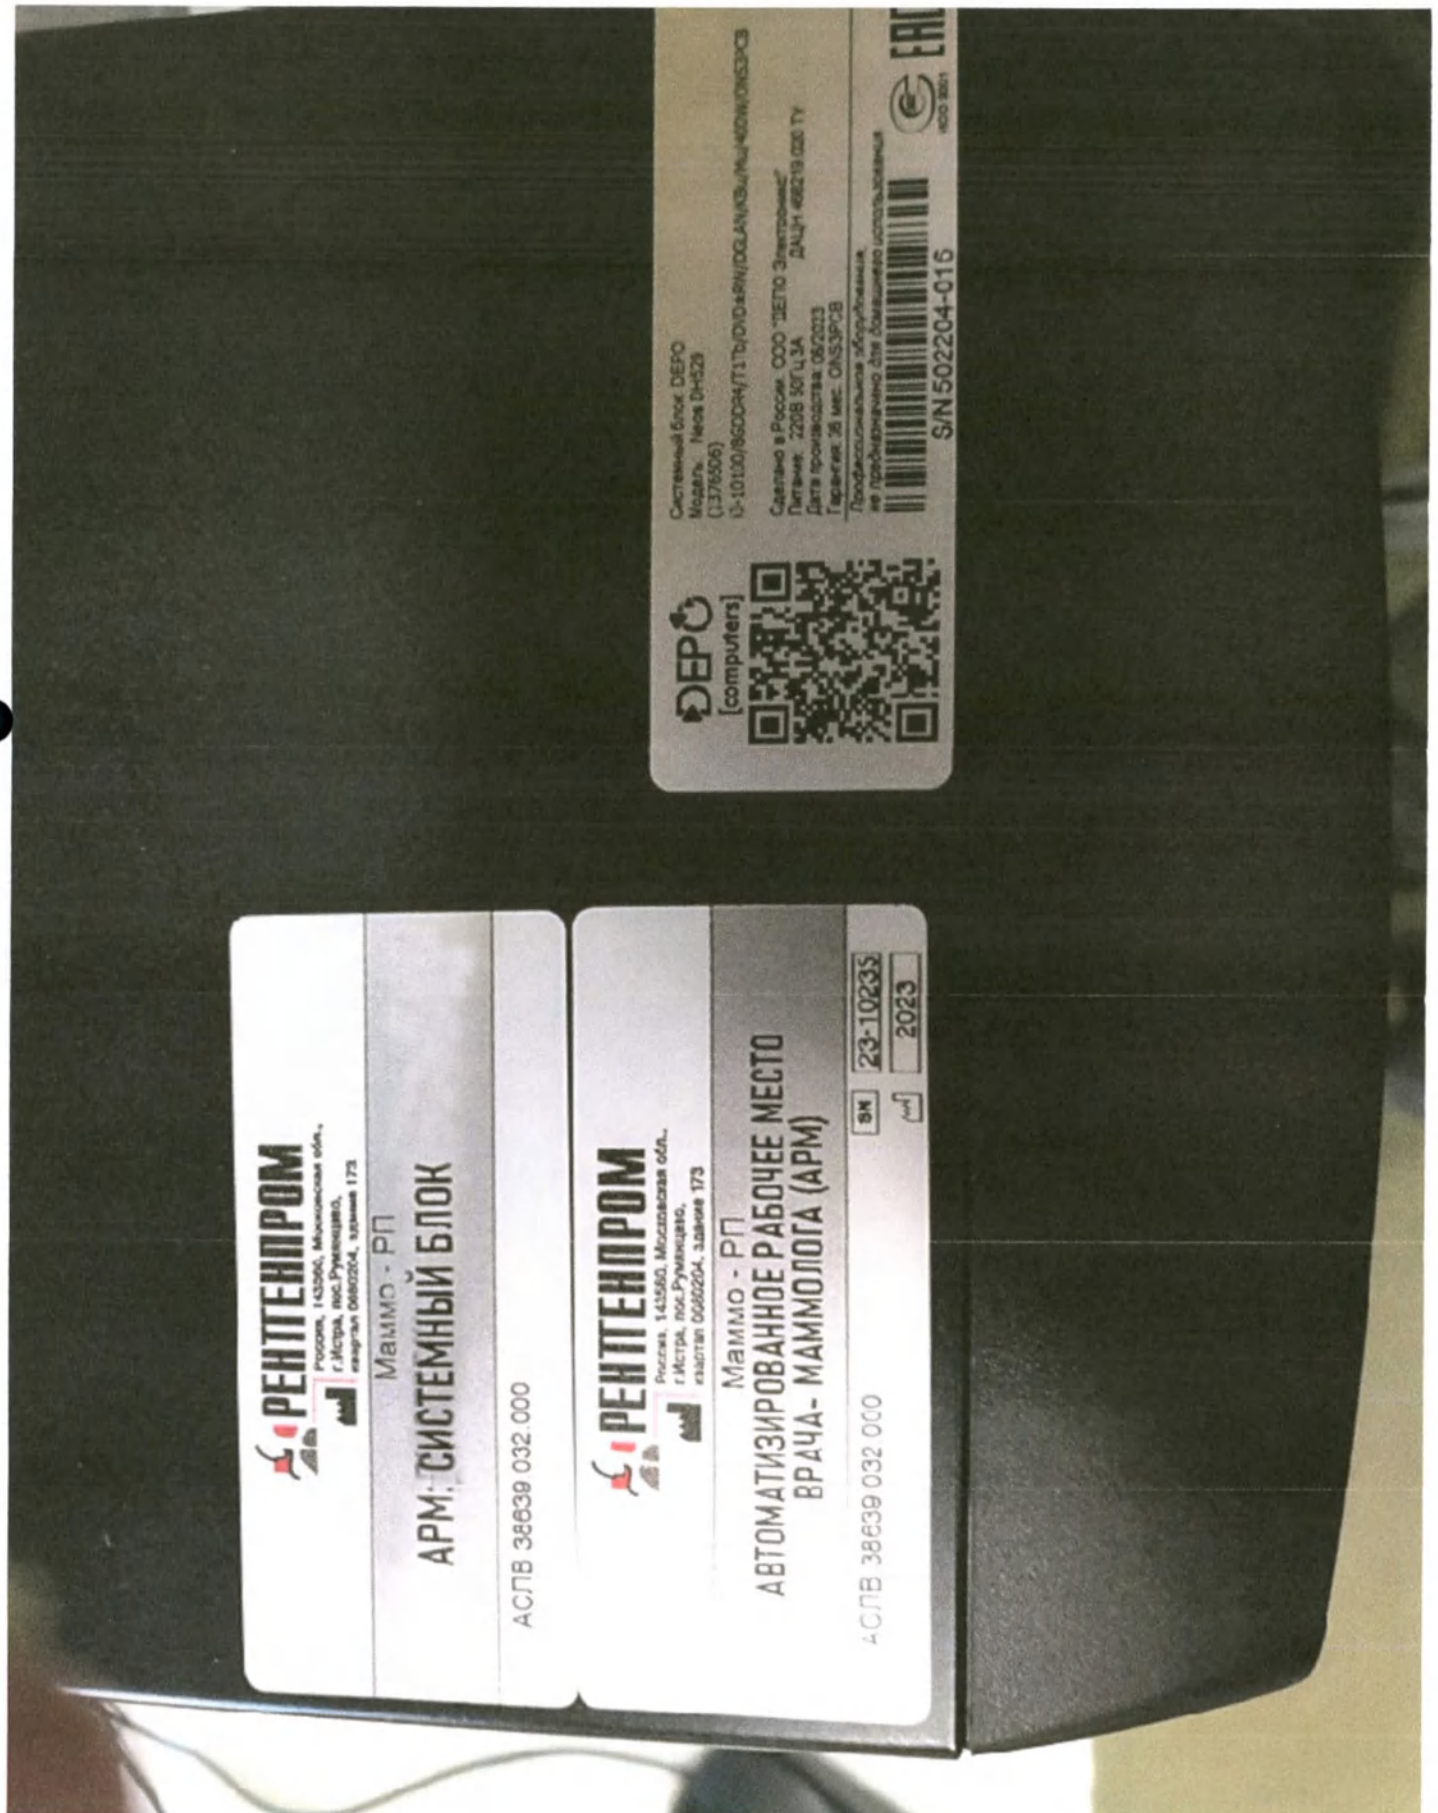

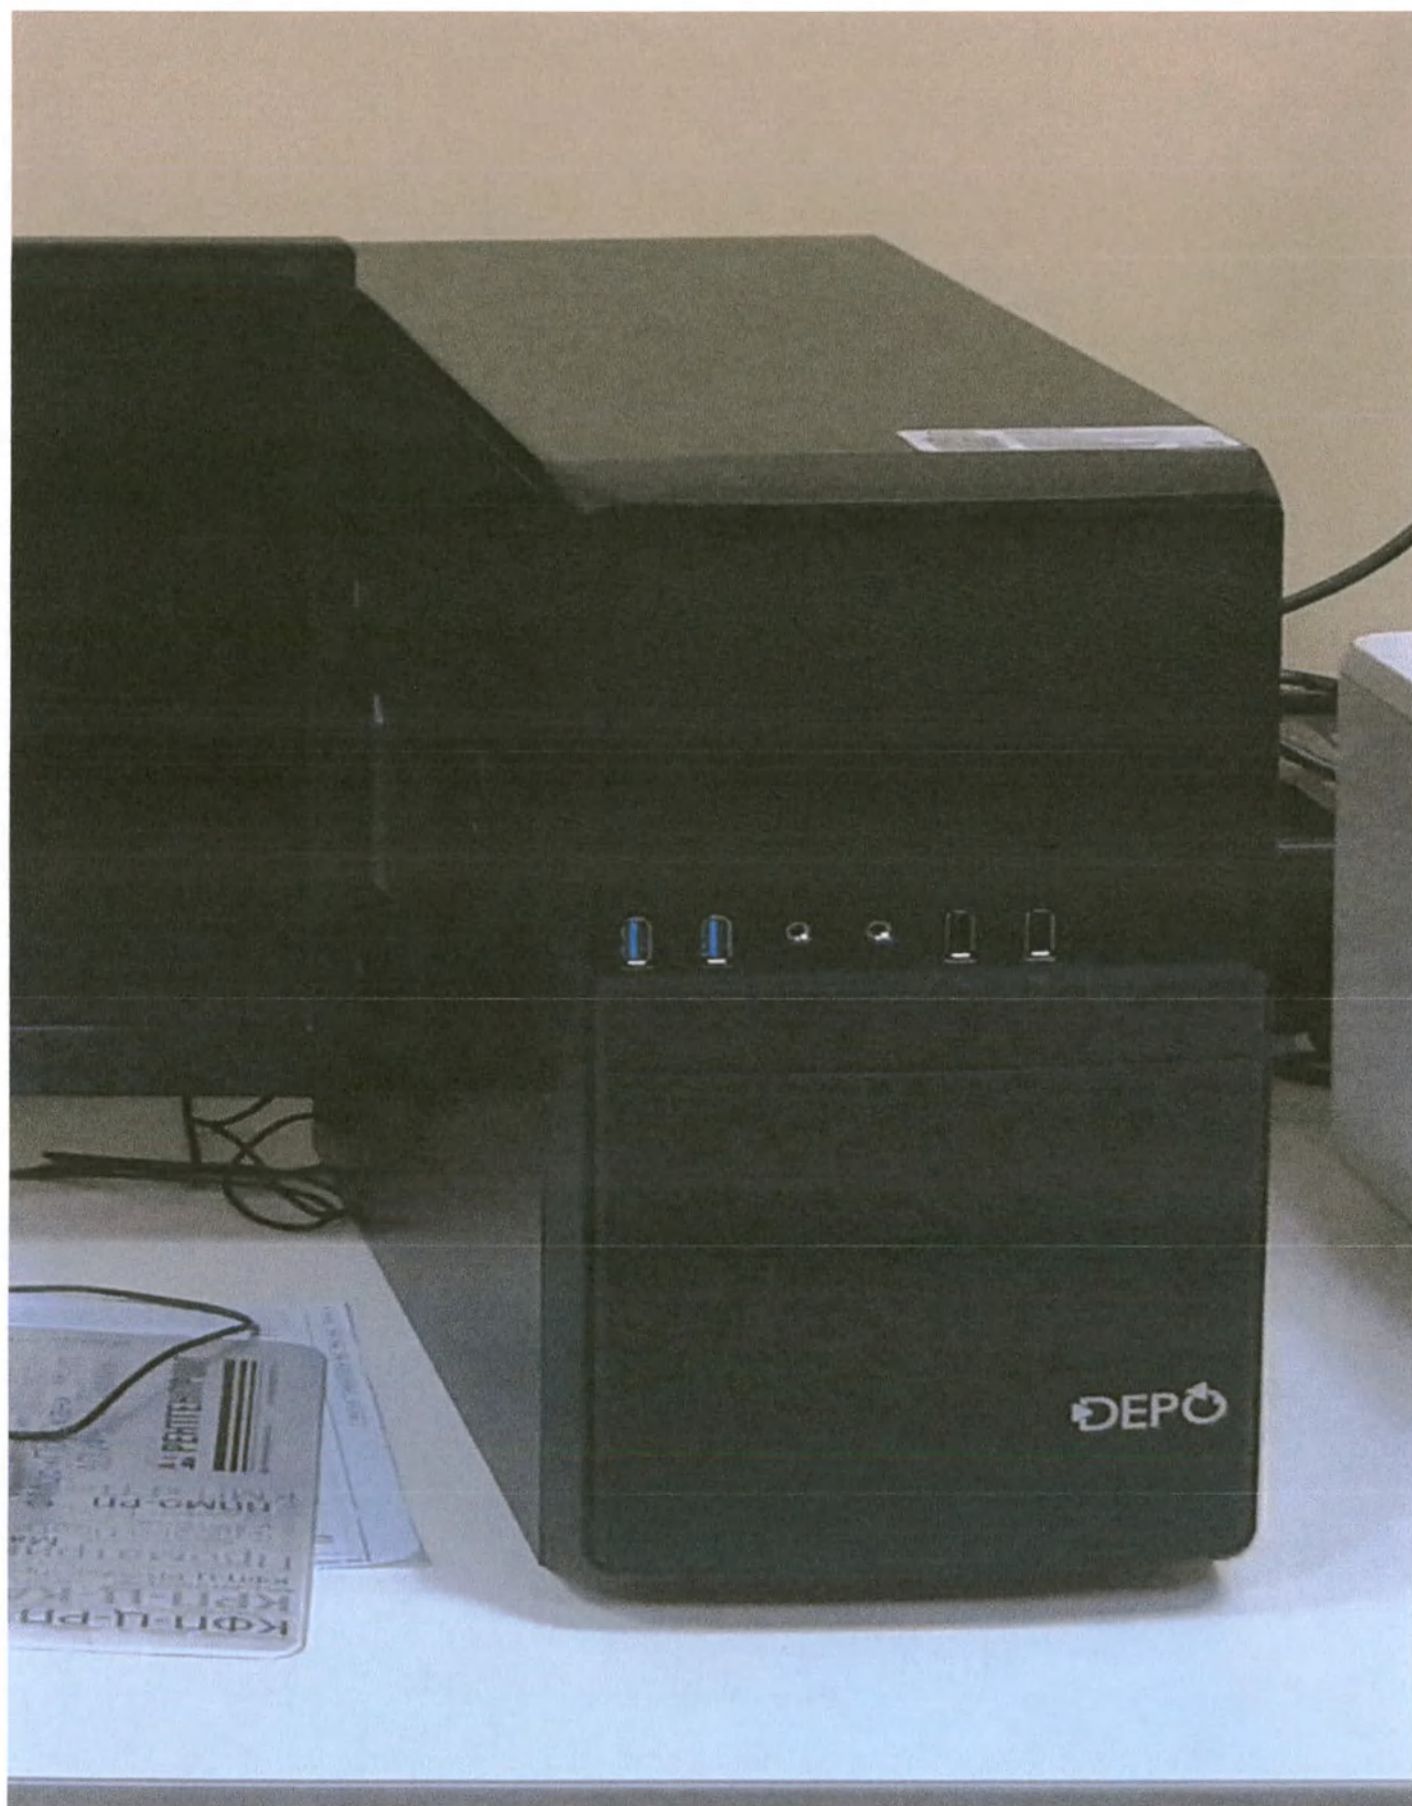



Системный блок: DEPO
Модель: Neos DH529
(1366385)
i3-10100/8GDDR4/T1Tb/T1Tb/DGLAN/KBu/Mu/400W/CAR3PCB

Сделано в России. ООО "ДЕПО Электроникс"
Питание: 220В 50Гц 3А ДАЦН.466219.020 ТУ
Дата производства: 09/2022
Гарантия: 36 мес. CAR3PCB

*Профессиональное оборудование,
не предназначено для домашнего использования.*



S/N:491204-058



















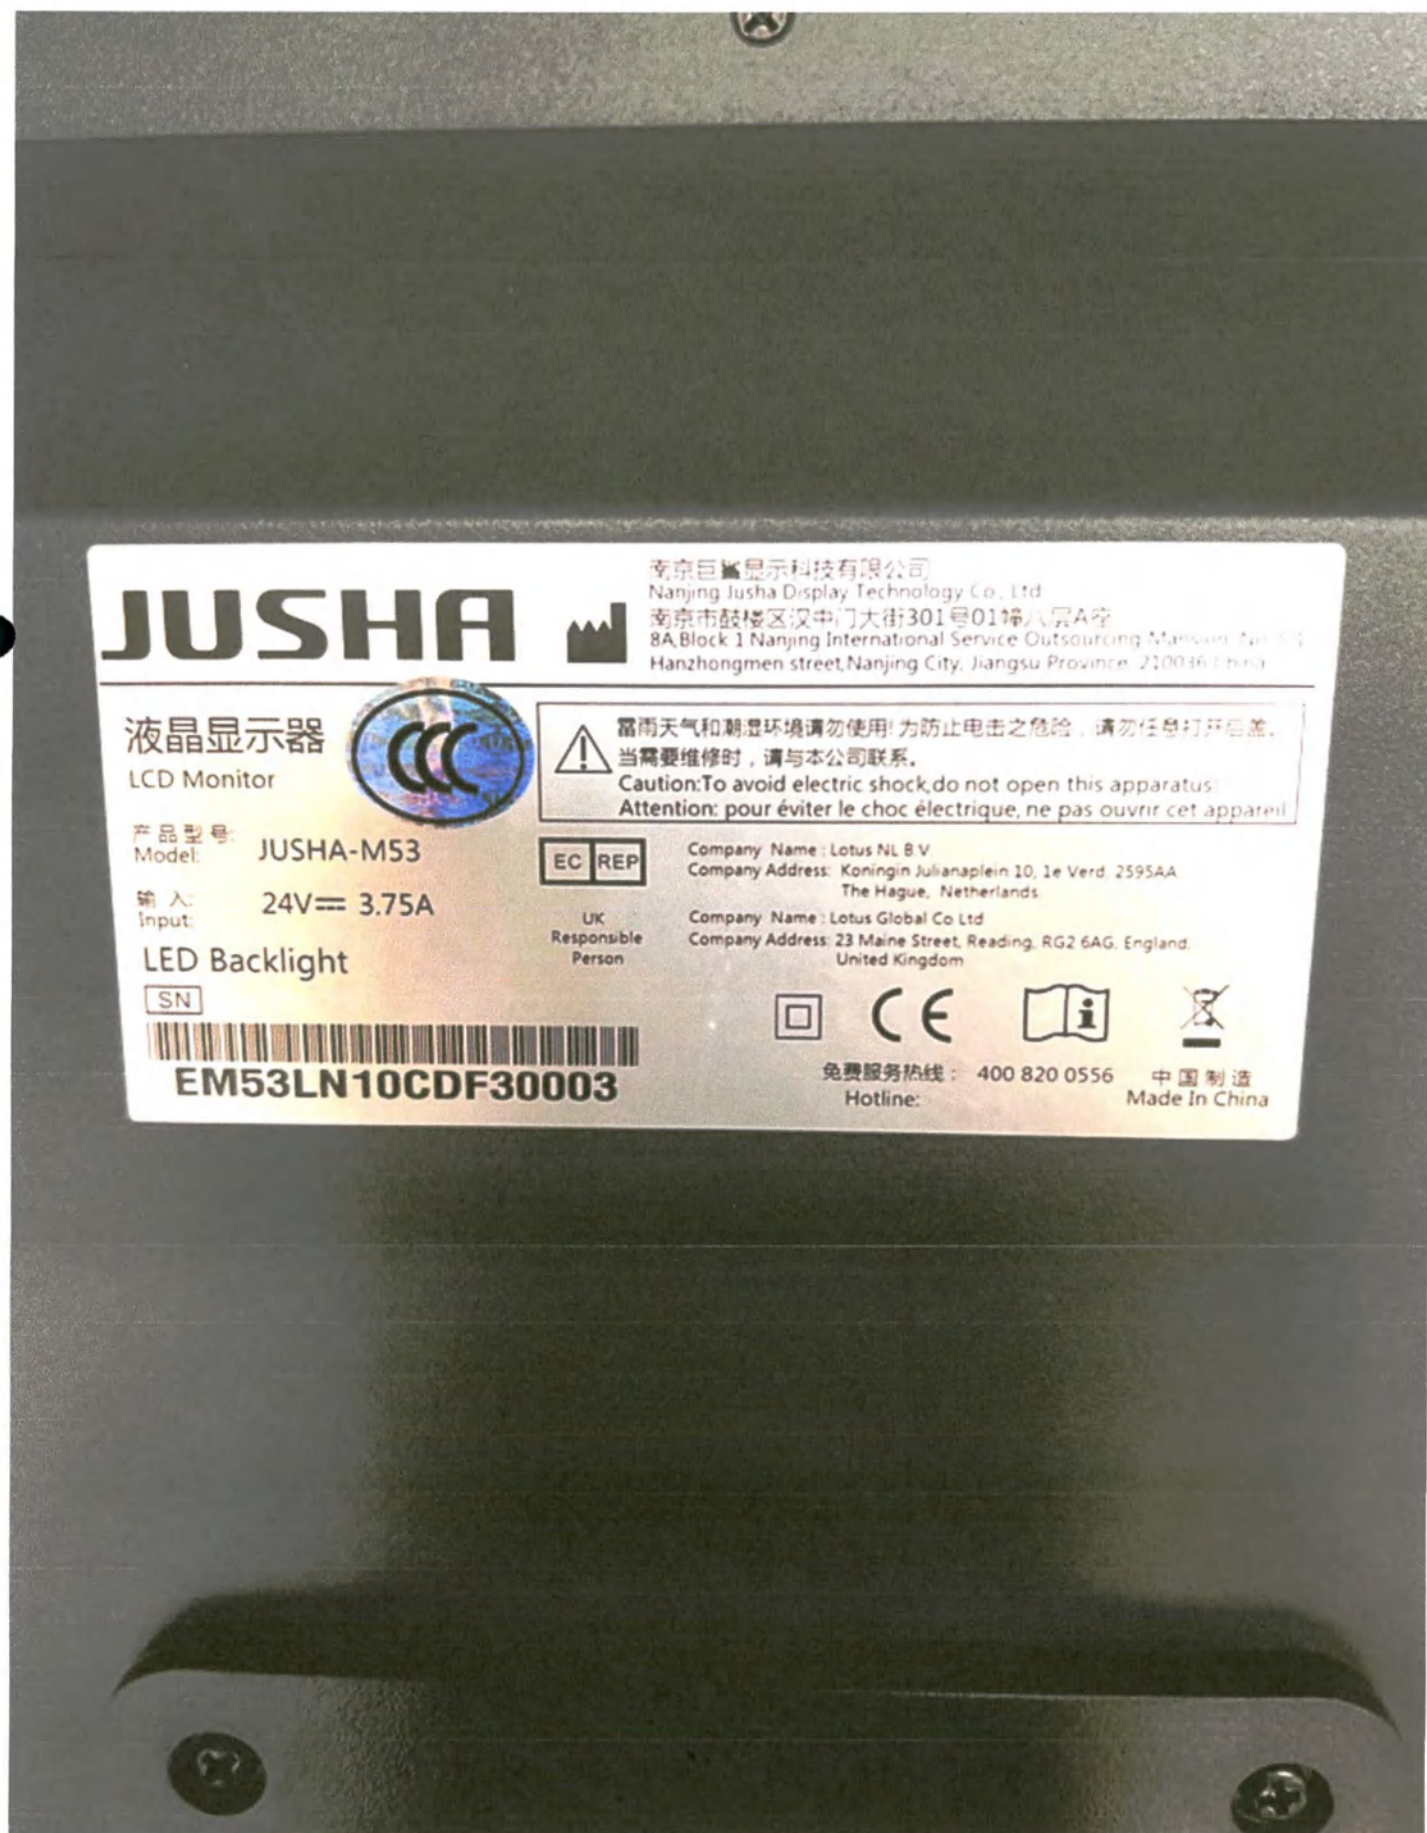

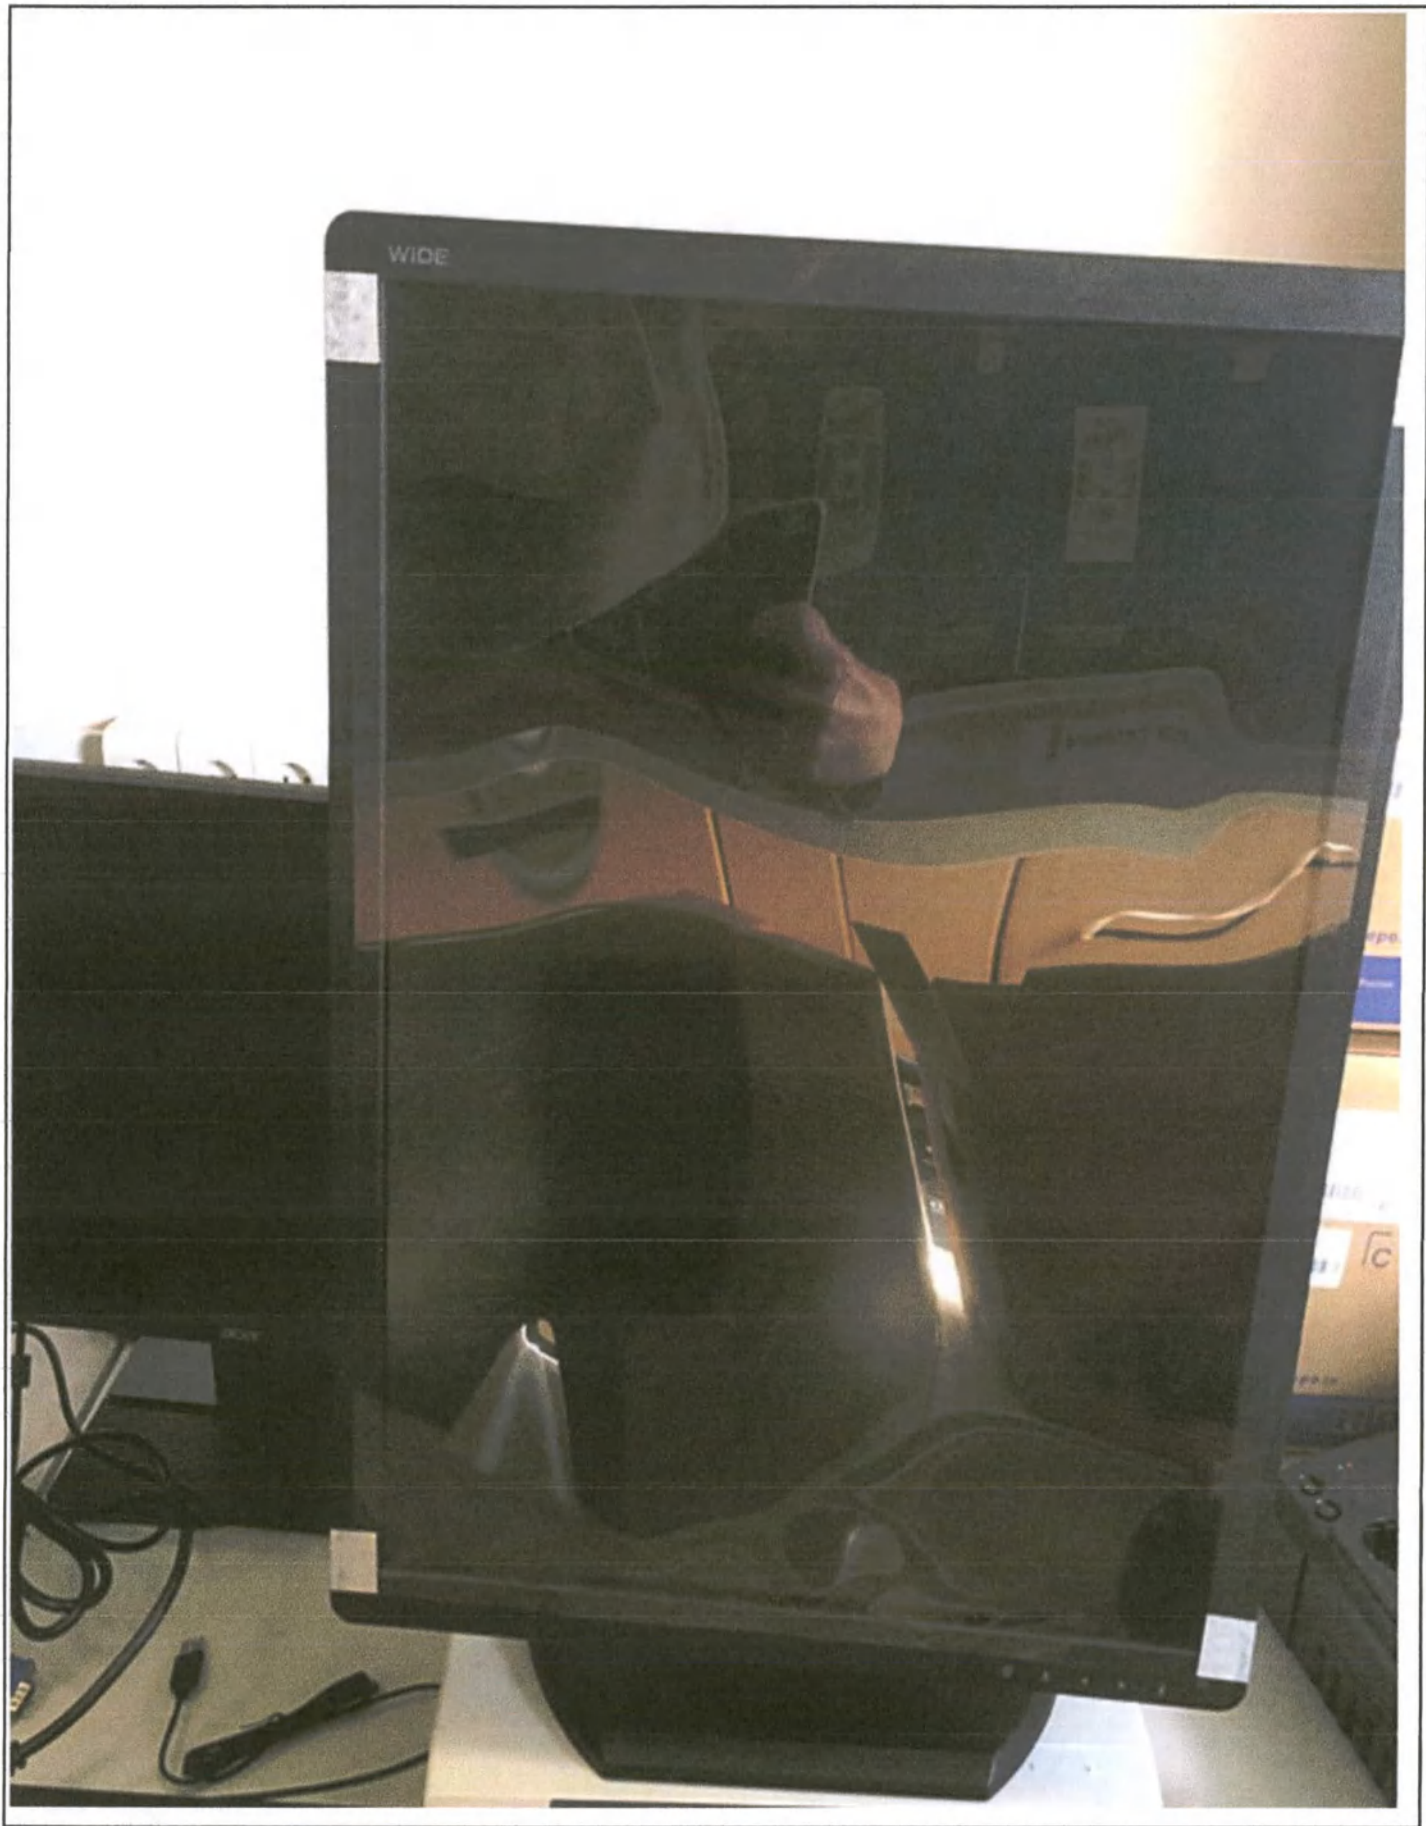





220-240V ~AC
50/60Hz, 3.4A

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Complies with FDA performance standards for laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No.50, dated June 24, 2007.

For FDA: HP Inc., No. 2727 Jinke Road, Shanghai, China 201203

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparatet skall anslutas till jordat uttag.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

HP Inc. UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT

HP HQ TRE 71025 Boeblingen Germany

OND2

SITE:PH1 >PET<

UK CA

CS

www.hp.com ID 0000081314

hp

Serial No. PHFMH39244

Número de Serie

Número de Producto

Product No. W1A53A

Made in Philippines

Hecho en Filipinas


Regulatory Model Number

SHNGC-1800-00

CE

HP





Xerox (UK)
Oxford Road
Uxbridge UB8 1HS

Complies with FDA performance
standards for laser products except for
deviations pursuant to Laser Notice No. 50,
dated June 24, 2007



Serial No.: 3228156069

Phaser™ 3020

Volts: AC 220-240V
Hertz: 50/60Hz
Amps: 2.5 A
Manufactured: APRIL 2017

Place: M098



052



www.tuv.com
ID: 1415017221



Made in China

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla
varustettuun pistorasiaan.
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.

Лазерный принтер «Brother Industries Ltd.», Вьетнам







SAMSUNG

**Лазерный принтер
Лазерний принтер**

Модель : Xpress M2020

Напряжение/напруга: 220-240~ В

Частота/частота: 50/60 Гц

Ток/струм: 2.5 А

Произведено / Вироблено : 08.02.2017

Класс защиты / Клас захисту : I

М/С : SL-M2020/FEV



Серийный номер/Серійний номер: 07VFB8GJ2B007JL



CE EAC



CLASS 1 LASER PRODUCT

Сделано в Китае/Вироблено в Китаї
REV. 00 / Версія 00






Canon 激光打印机 L11121E

220-240V

50/60Hz

3.3A



050972-11



MANUFACTURED: July 2008

CANON INC.
30-2, SHIMOMARUKO, 3-CHOME,
OHTA-KU, TOKYO, JAPAN

THIS PRODUCT CONFORMS WITH DHHS
RADIATION PERFORMANCE STANDARD,
21CFR CHAPTER 1 SUBCHAPTER J.

CANON INC. MADE IN
CHINA
RUS

制造商:佳能公司

日本国东京都大田区下丸子3-30-2


中国制造







Маркировка устройства для печати монохромных медицинских изображений
«Сони Корпорейшн» («SONY Corporation»), Япония

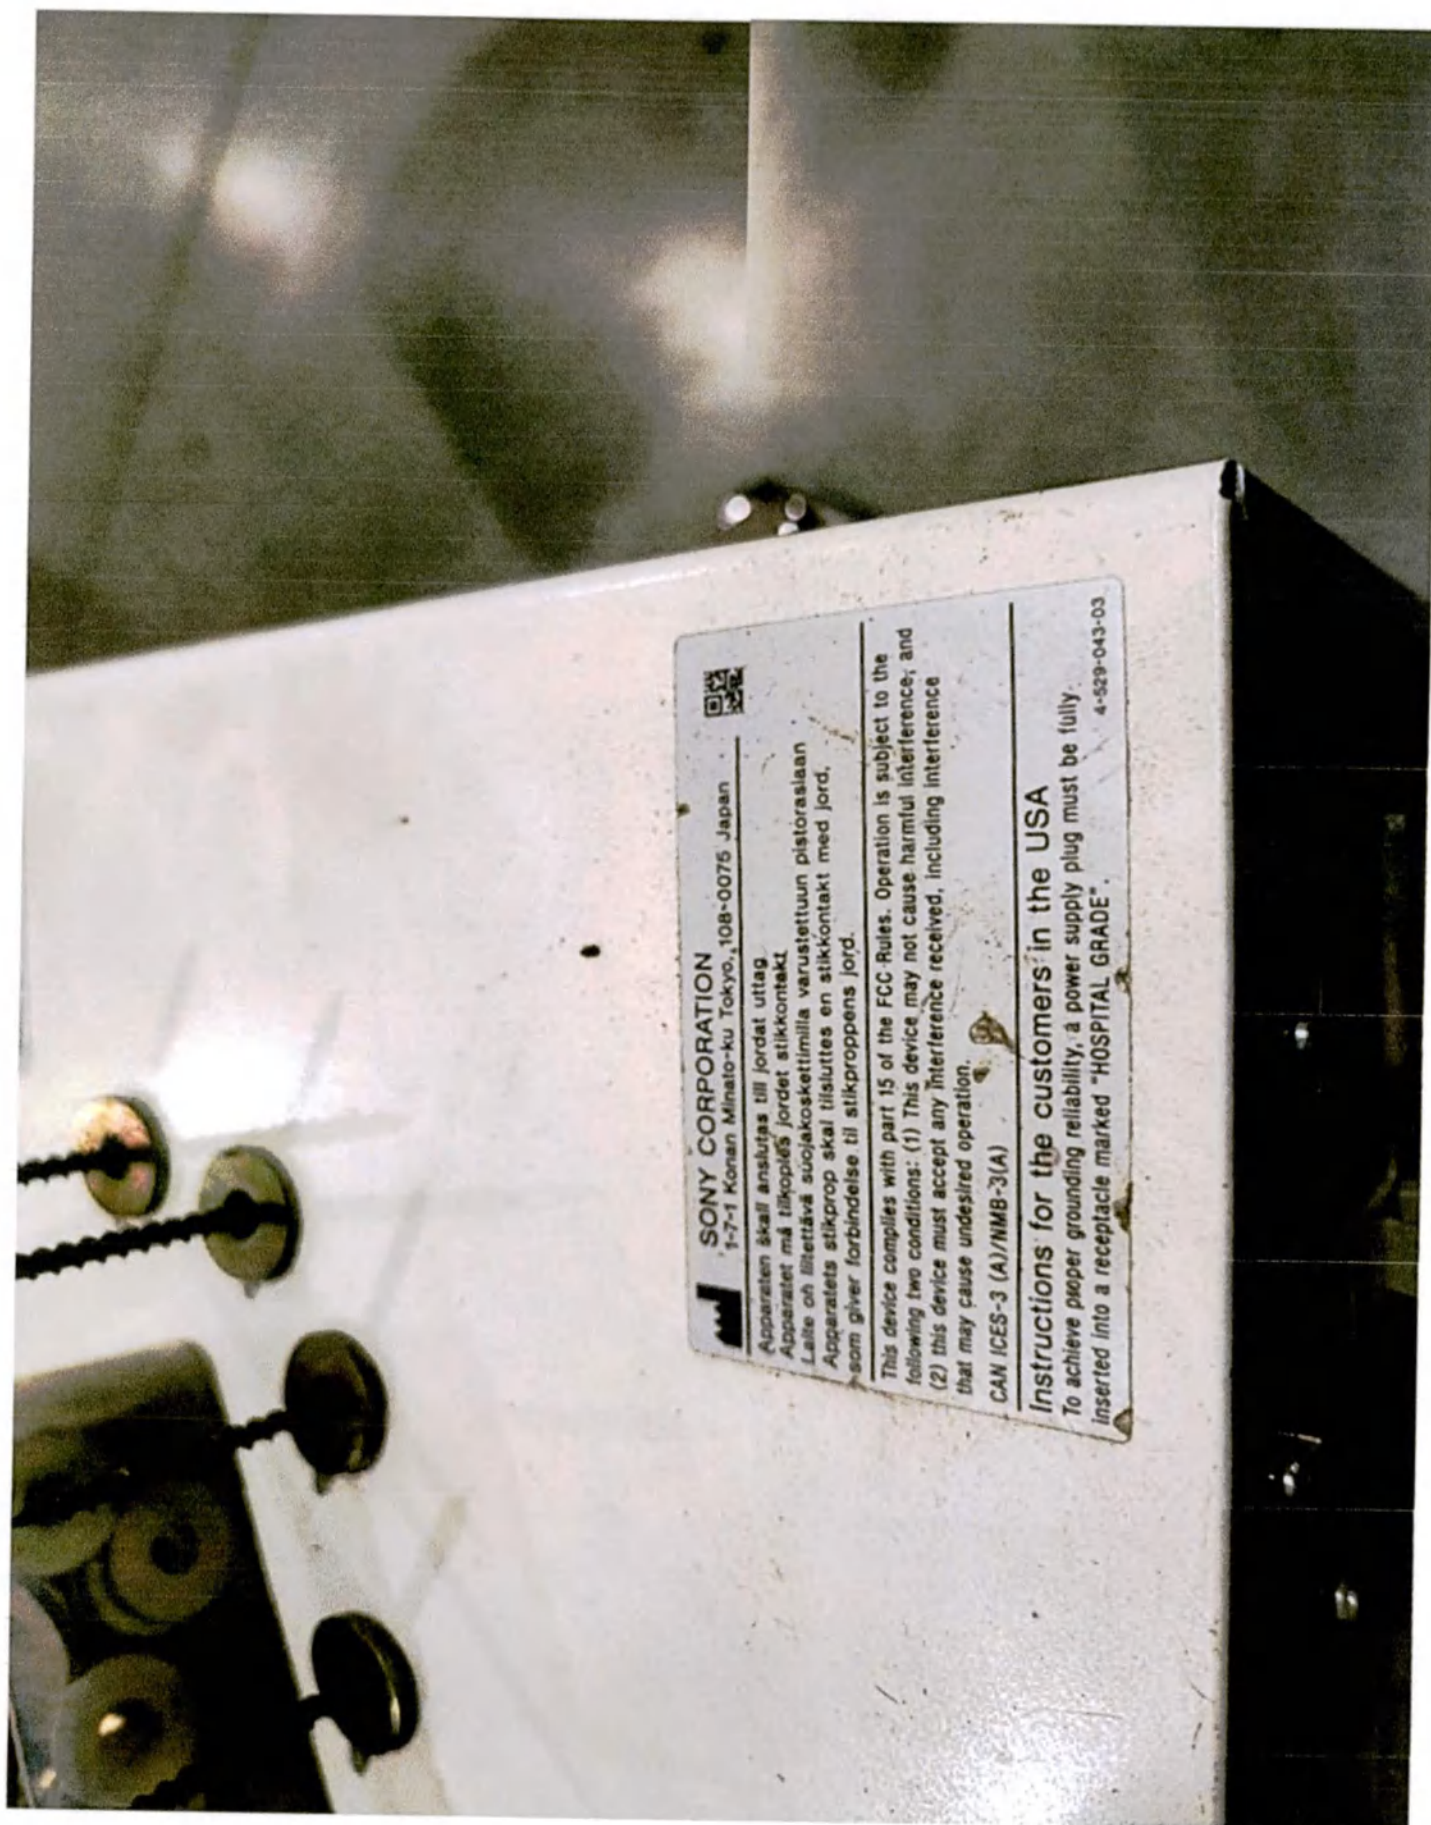

SONY CORPORATION
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Apparatet skal anslutas till jordat uttag.
Apparatet må tilkoples jorden stikkontakt.
Laitte oh liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord,
som giver forbindelse til stikproppens jord.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Instructions for the customers in the USA
To achieve proper grounding reliability, a power supply plug must be fully inserted into a receptacle marked "HOSPITAL GRADE".

4-529-043-03

Камера мультиформатная терморегулируемая Drystar AXYS с принадлежностями
«Альфа Н.В.» («Alpha N.V.»), Германия



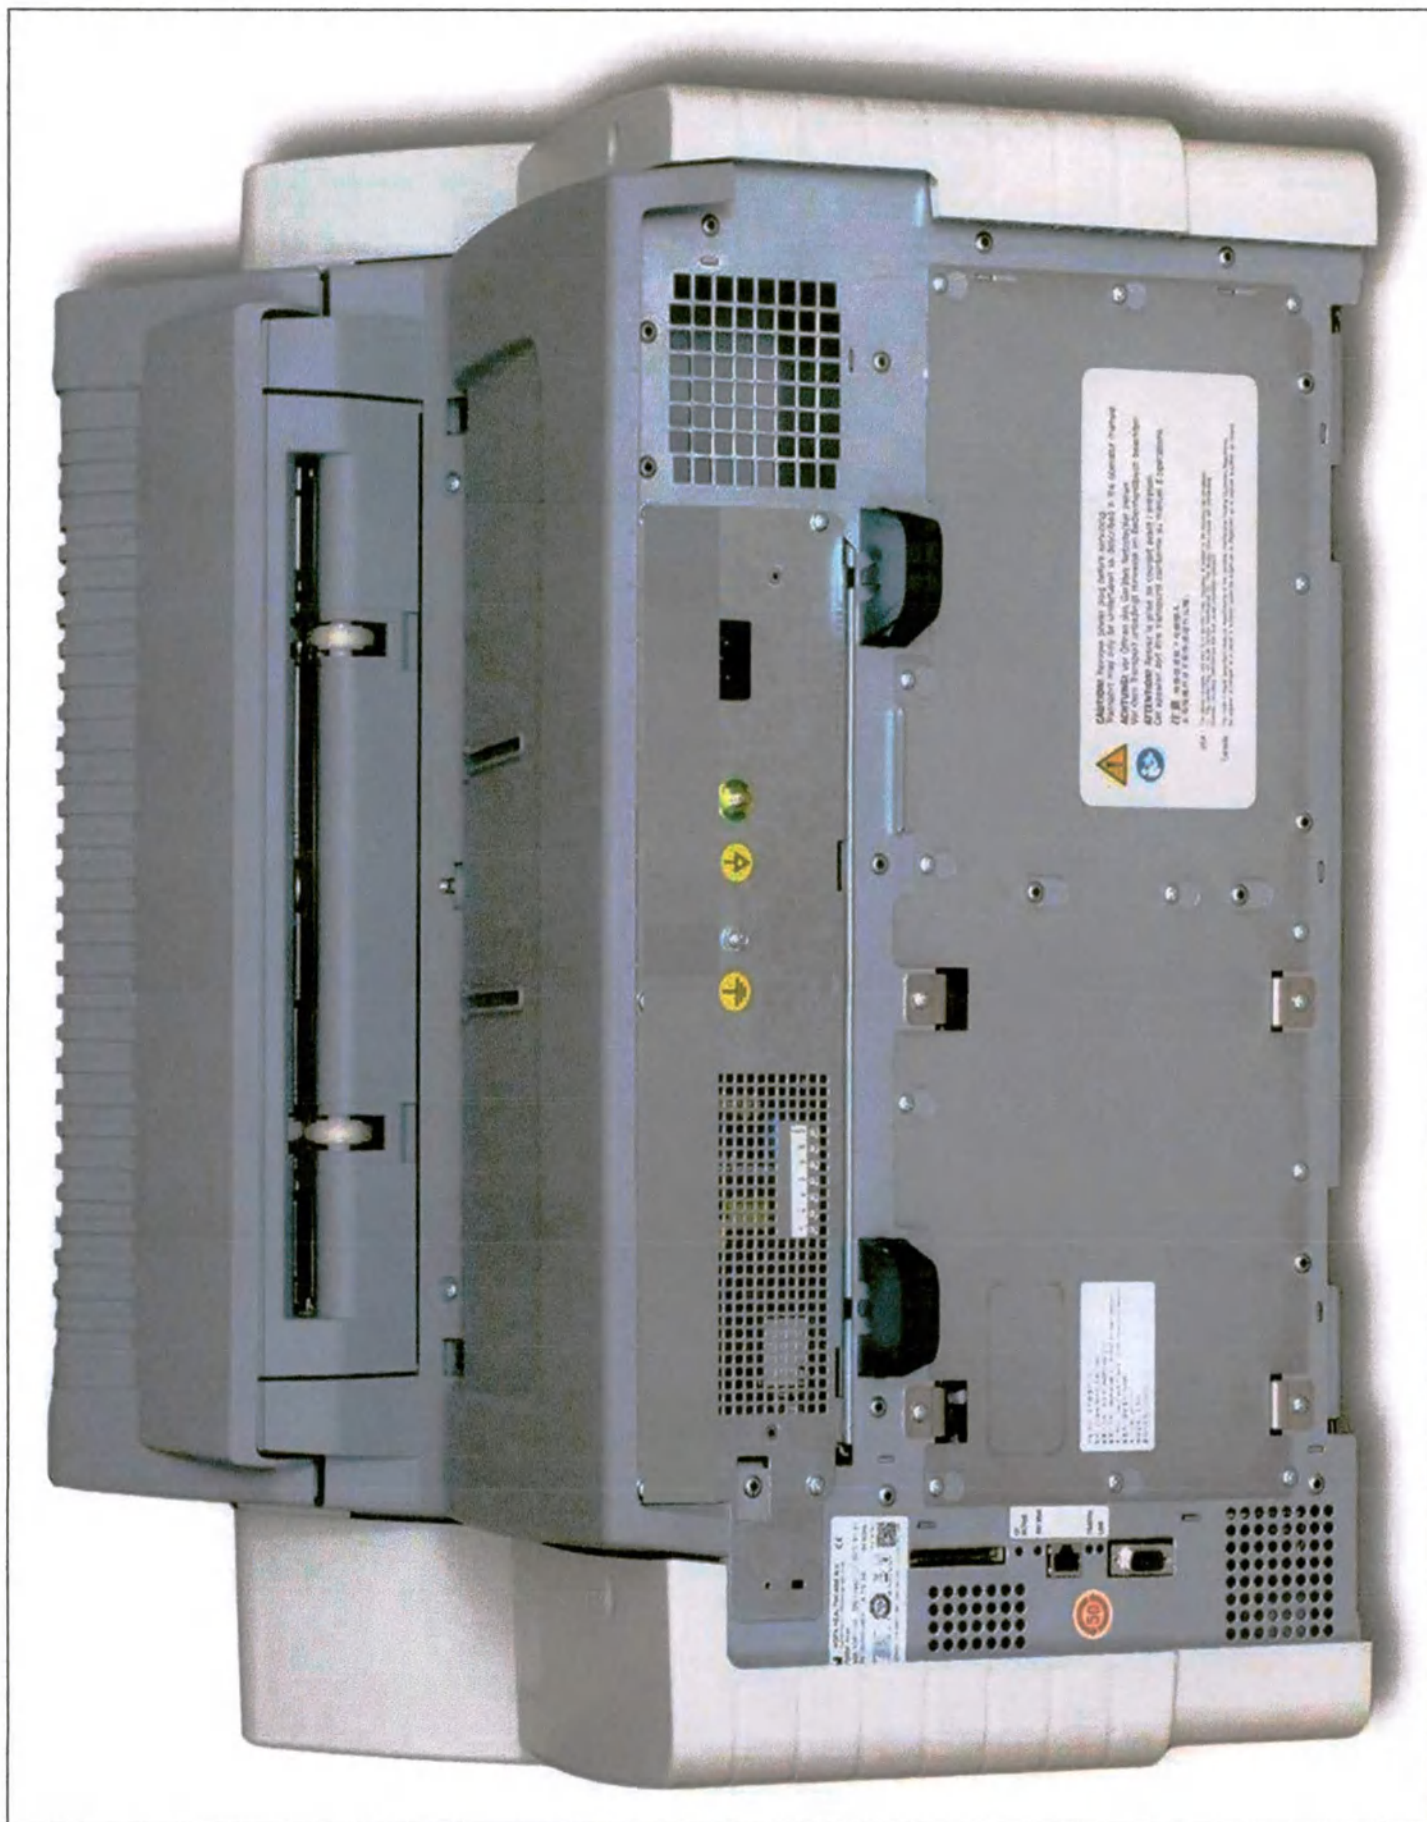



Камера лазерная мультиформатная DRYVIEW 5950 Laser Imaging System для печати медицинских изображений с принадлежностями «Кэарстрим Хэлс, Инк.» («Carestream Health, Inc.»), Китай



FCC ID: U729950

THIS CLASS A DIGITAL APPARATUS COMPLIES WITH CANADIAN ICES-003

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE A EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA

IC: 7027A-5950

COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11 EXCEPT FOR DEVIATIONS PURSUANT TO LASER NOTICE NO. 55, DATED JUNE 24, 2007

AE3345-B

Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5950 Laser Imaging System с принадлежностями

Рег. Удостоверение № РЗН 2015/2380 от 10.02.2015 г.

Произведено: «Кэарстрим Хэлс, Инк.»

Адрес: 150 Верона Стрит, Рочестер, Нью Йорк, 14608, США.

Место производства: Райко (Шанхай) Медикал Продактс Компани

Лимитед, биддинг 7, 1510 Чуанкиао Род, Джинкиао Экспорт Процессинг

Зон, Пудонг Нью Ареа, 201206 Шанхай, Китай.



Размеры, условия хранения и предупреждения указаны графическими символами на упаковке

Уполномоченный представитель: ООО «Кэарстрим Хэлс». Адрес: 123007, РФ, г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д.11, ком.7.

Тел. +7 (495) 660-5690, +7 (495) 660-5691

AE3345-B

DRYVIEW 5950 Laser Imaging System

干式激光成像仪

5950
SN 59550617
P/N 9J2001
REF 1033851

EC REP

Carestream Health Italia S.r.l.
Via al porto Antico, 6
16128 Genova
Italy

CH REP

Carestream Health SA
Centre « Les Tuilleries »
Route de Cîte-Ouest 2
1196 Gland
Switzerland

2022-12-03

200 - 240 V~

4 A


50/60Hz

TF3118 AS

Made in China by Rayco for
Carestream Health Inc.
150 Verona Street
Rochester, NY, USA 14608



WWW.CARESTREAM.COM
DOCUMENTATION



(01)60809971033857(21)59550617

干式激光成像仪

レーザーイメー
ジングプリンター

Laser Imaging Printer

Impresora laser de imágenes

Laser Imaging Drucker

Reprographie laser

Stampante per imaging laser

Laserbildeskriver

Laserkuvaustulostin

Laserbilledprinter

Laserprinter voor beeldverwerking

Laserbildbehandlungsskriver

Εκτυπωτής οπτικοποίησης Laser

Impressora de imagens a laser

Drukarka laserowa

레이저 이미징 프린터

Lazer Görüntüleme Yazıcısı

雷射影像印表機

Pencetak Pengimejan Laser


Принтер лазерного
формирования изображений



警告 1. 本製品はレーザー光を放射する装置であり、レーザー光を直接目や皮膚に照射すると、失明や火傷の原因となります。必ず安全対策を講じてください。

1. 本製品はレーザー光を放射する装置であり、レーザー光を直接目や皮膚に照射すると、失明や火傷の原因となります。必ず安全対策を講じてください。



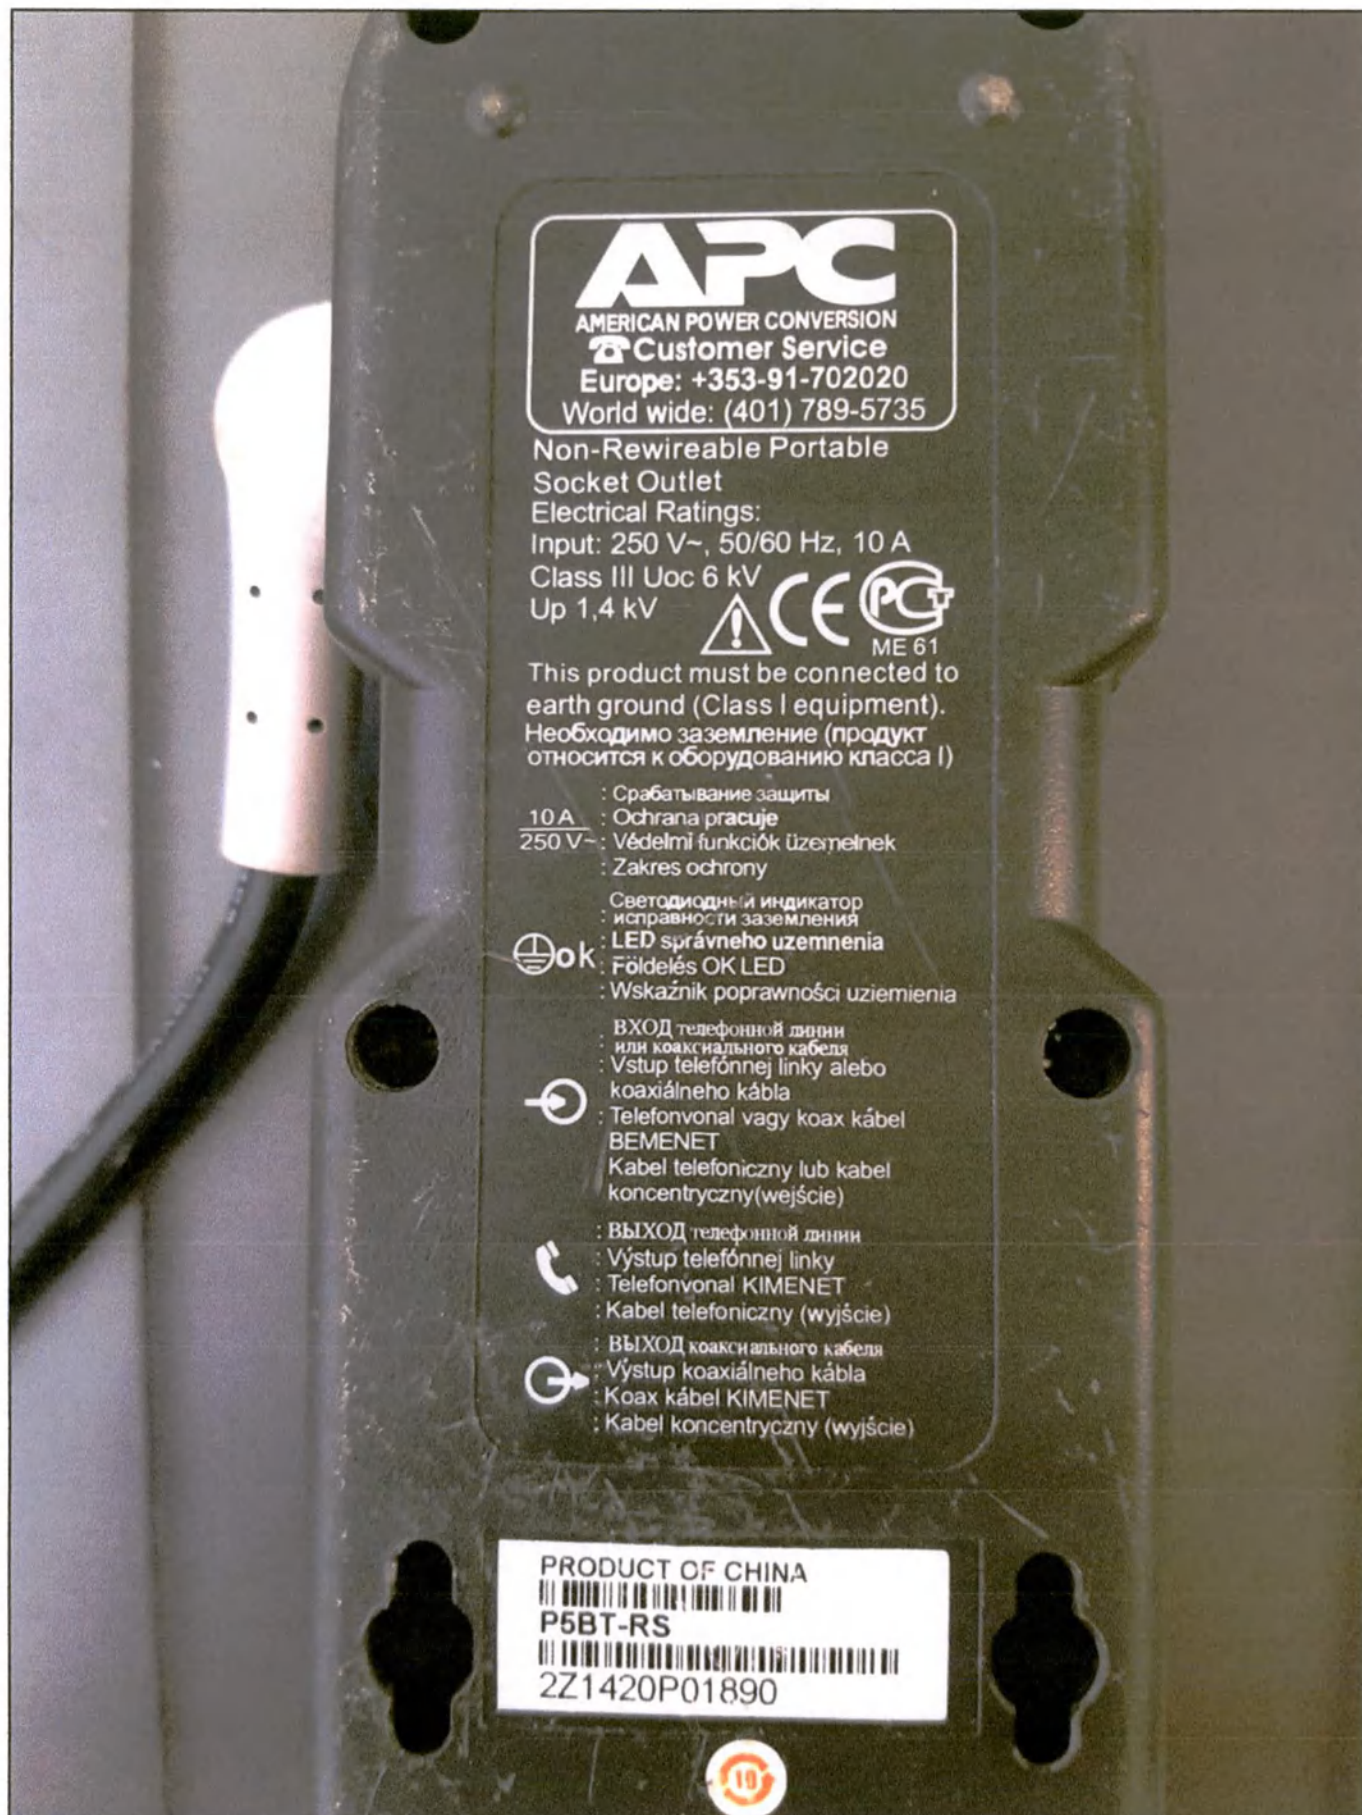

APC

AMERICAN POWER CONVERSION

Customer Service

Europe: +353-91-702020

World wide: (401) 789-5735

Non-Rewireable Portable
Socket Outlet

Electrical Ratings:

Input: 250 V~, 50/60 Hz, 10 A

Class III Uoc 6 kV

Up 1,4 kV



This product must be connected to
earth ground (Class I equipment).

Необходимо заземление (продукт
относится к оборудованию класса I)

10 A : Срабатывание защиты
250 V~ : Ochrana pracuje
: Védelmi funkciók üzemelnek
: Zakres ochrony



: Светодиодный индикатор
: исправности заземления
: LED správneho uzemnenia
: Földelés OK LED
: Wskaźnik poprawności uziemienia



: ВХОД телефонной линии
: или коаксиального кабеля
: Vstup telefónnej linky alebo
: koaxiálneho kábla
: Telefonvonal vagy koax kábel
: BEMENET
: Kabel telefoniczny lub kabel
: koncentryczny (wejście)



: ВЫХОД телефонной линии
: Výstup telefónnej linky
: Telefonvonal KIMENET
: Kabel telefoniczny (wyjście)



: ВЫХОД коаксиального кабеля
: Výstup koaxiálneho kábla
: Koax kábel KIMENET
: Kabel koncentryczny (wyjście)

PRODUCT OF CHINA

P5BT-RS

2Z1420P01890












UPS MONITORING FEATURES (Option)

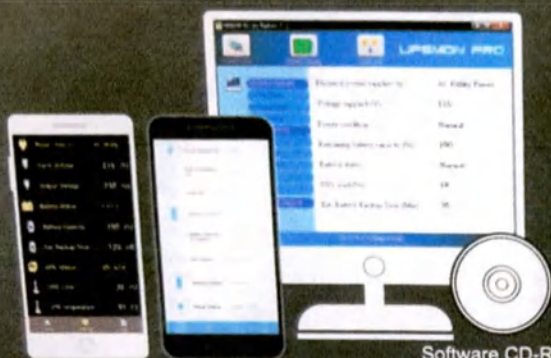

Software CD-ROM
(Option)

- UPS Communication Management
- Real Time Monitor
- Event Log
- UPS Status Scheduling
- VMware Compatible
- Instant Message Notification
- Multi Language Support



40192242212



Источник бесперебойного
питания SPD-850N, Powercom

Manufacturer/Производитель/Producent:
Powercom Co. Ltd, 9F, No.246, Lien Chen Road,
Chung Ho District, New Taipei City, 235, Taiwan;
886-2-2225-8552; info@pcm.ru
Made in China/Сделано в Китае/
Wyprodukowano w Chinach

ISO9001
CERTIFIED



RECEPTACLE



CAPACITY

SPD-450VA	E		SPD-650U	
	N			
SPD-650VA	E		SPD-850U	
	N			
SPD-850VA	E		SPD-1000U	
	N			
SPD-1000VA	E			
	N			

SERIAL NO.



5/5 40192242212



4 712505 035932



SPD-0850-6G0-2442



SPD-850N



Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при
рентгенодиагностических исследованиях:
Передник для защиты гонад ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», Россия







ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

Воротник защитный

ВРЗ-«Р-К»

№ 142 ноябрь 2020 г.

ТУ 9452-007-46782692-2001

Рв 0,35/100, размер

ГОСТ 31114.3-2012

РУ № ФСР 2010/08183

Набор мебели в составе:

Стол компьютерный ООО «Гранд», Россия или АСЛВ 38639.020.77.00



Маркировка стола компьютерного ООО «Гранд», Россия или АСЛБ 38639.020.77.00







Всего прошито и пронумеровано
125 (сто двадцать пять) листов
Исполнительный директор АО "РЕНТГЕНПРОМ"
Свябьянов Мансур Рафитович _____

