



Фотографические изображения медицинского изделия

**Система терапевтическая широкополосного пульсирующего света
SUPER VELOCE 4800**

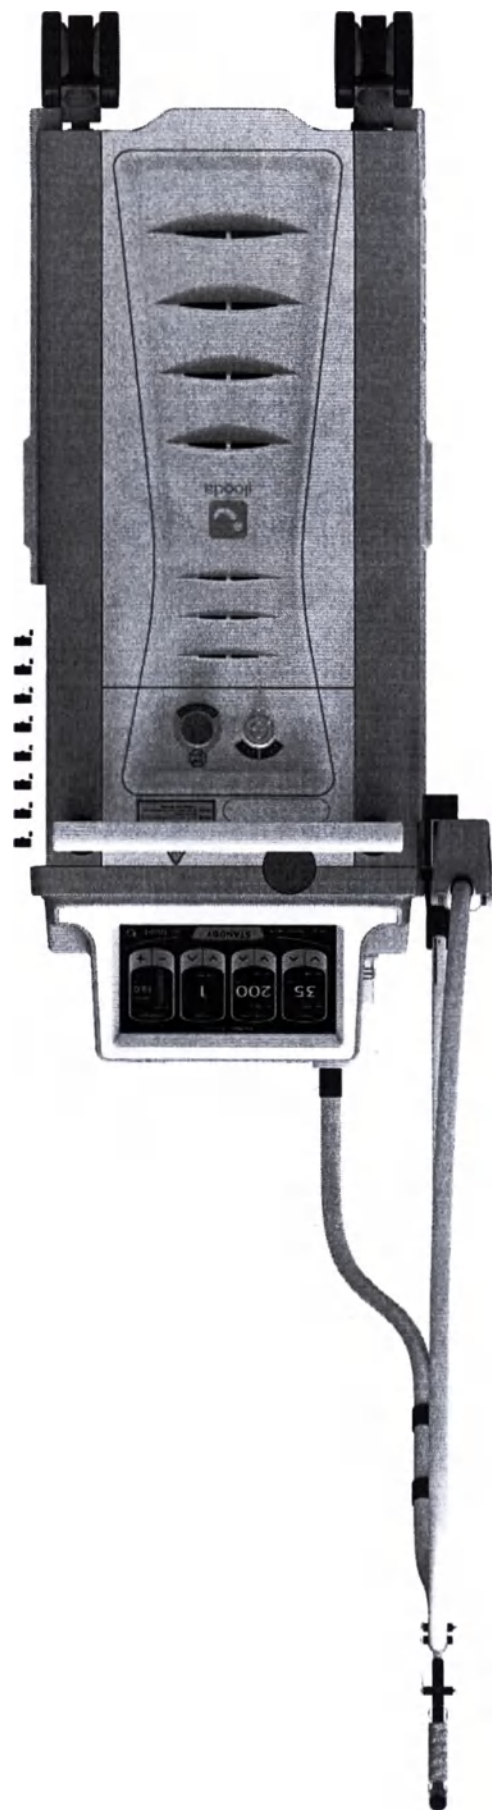

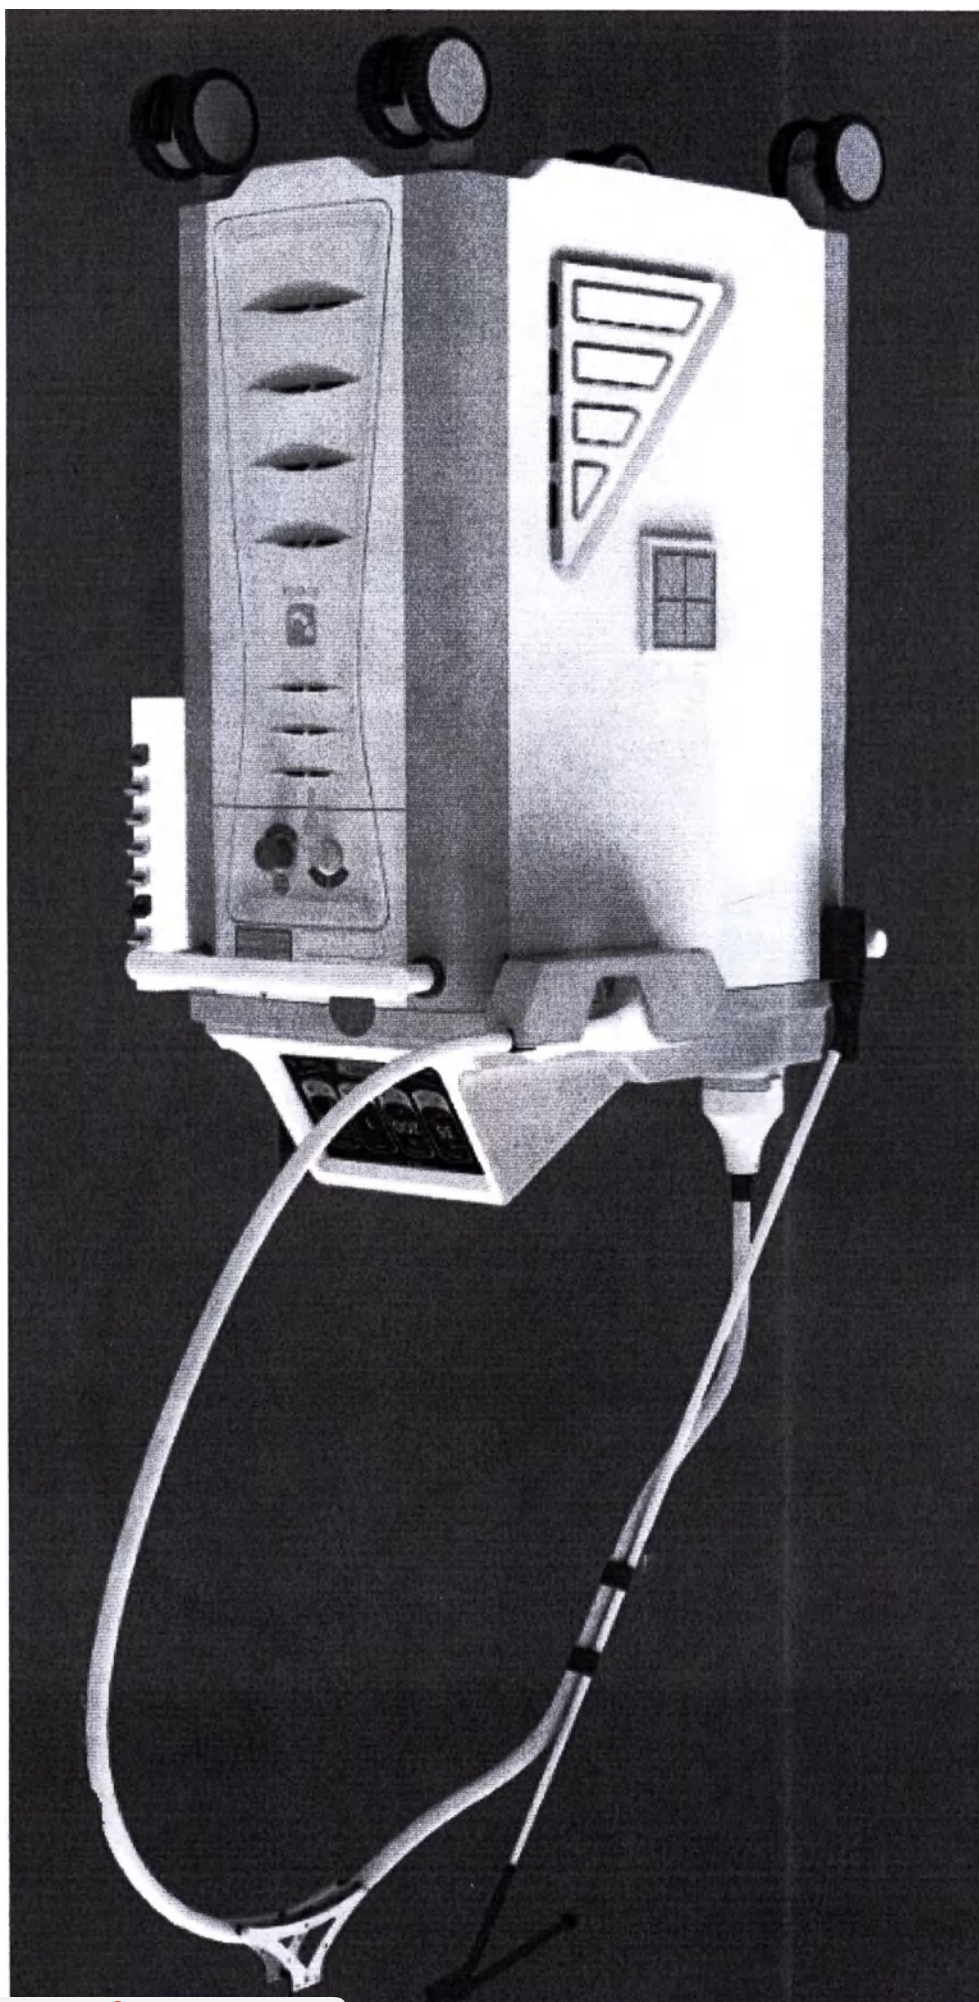


Насадка




Насадка дополнительная




Подставка насадки

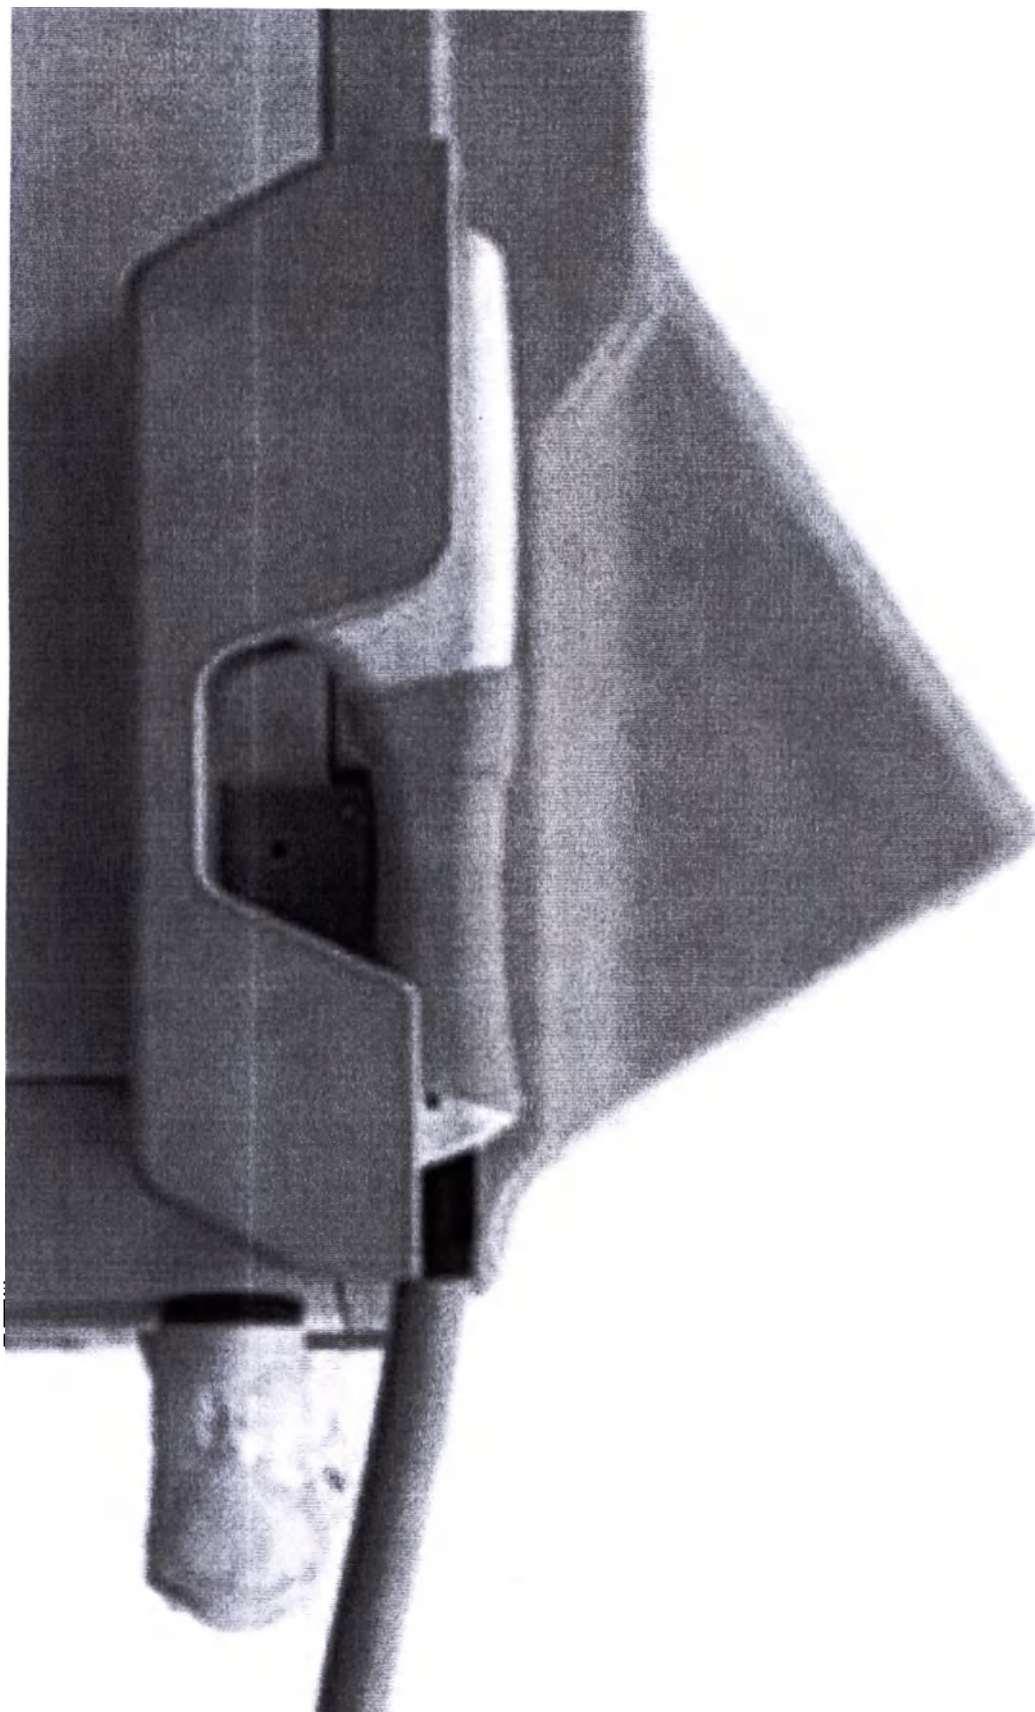

Держатель кабеля насадки

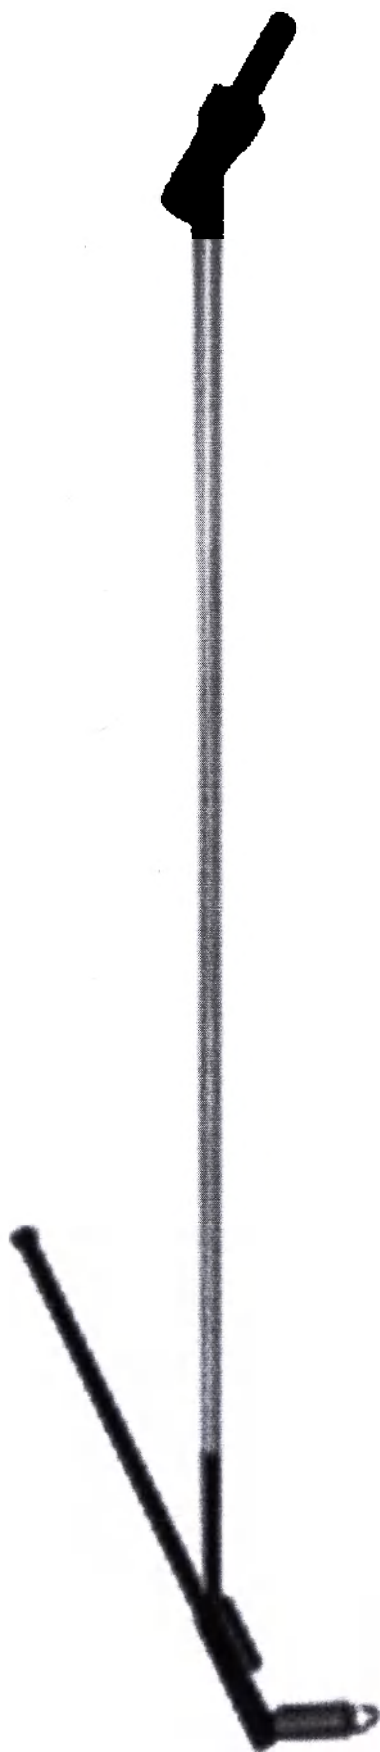


Пластиковый кейс для насадок и фильтров

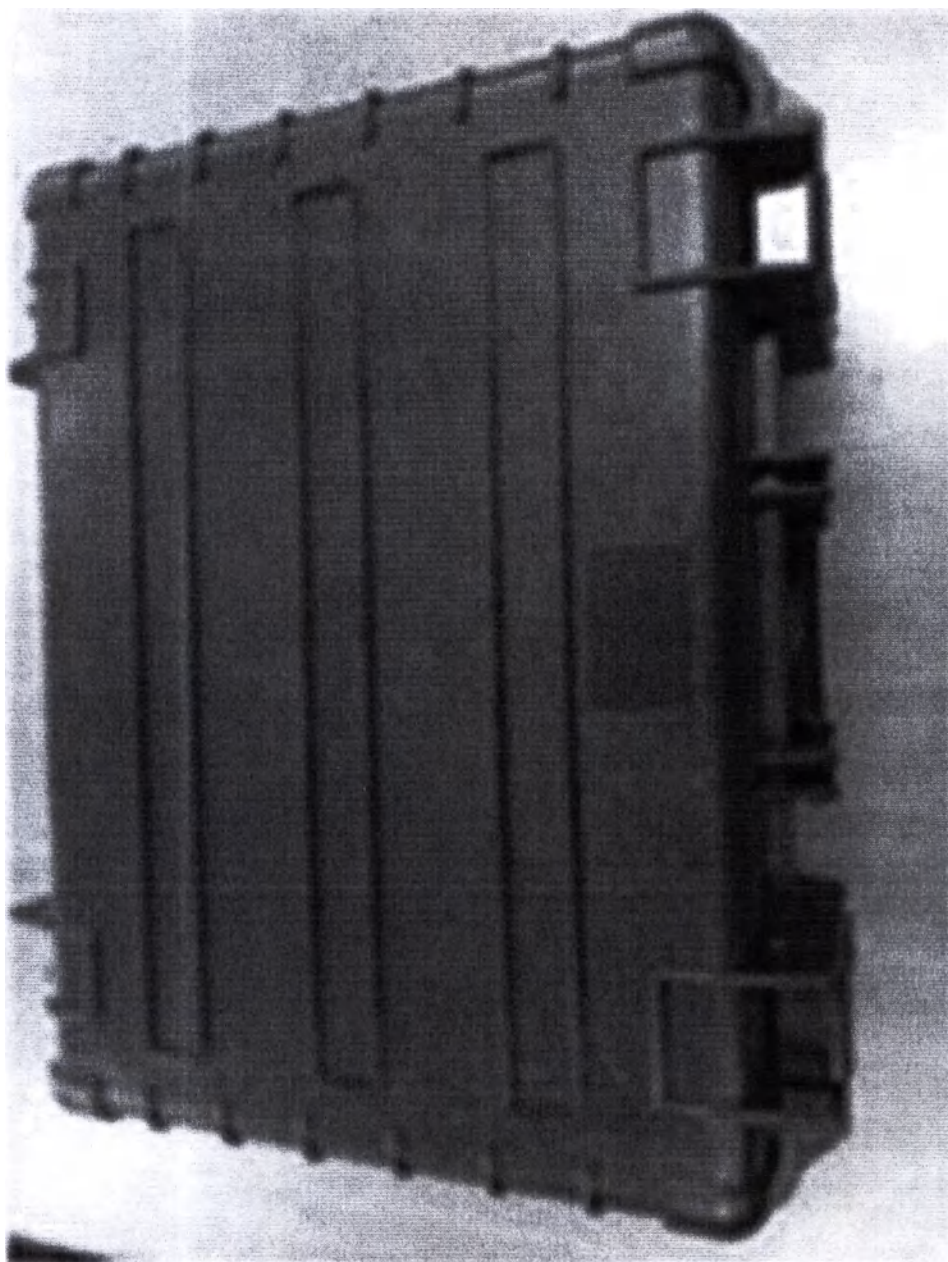




ФМБСТРМ

Наконечники для формирования пятна

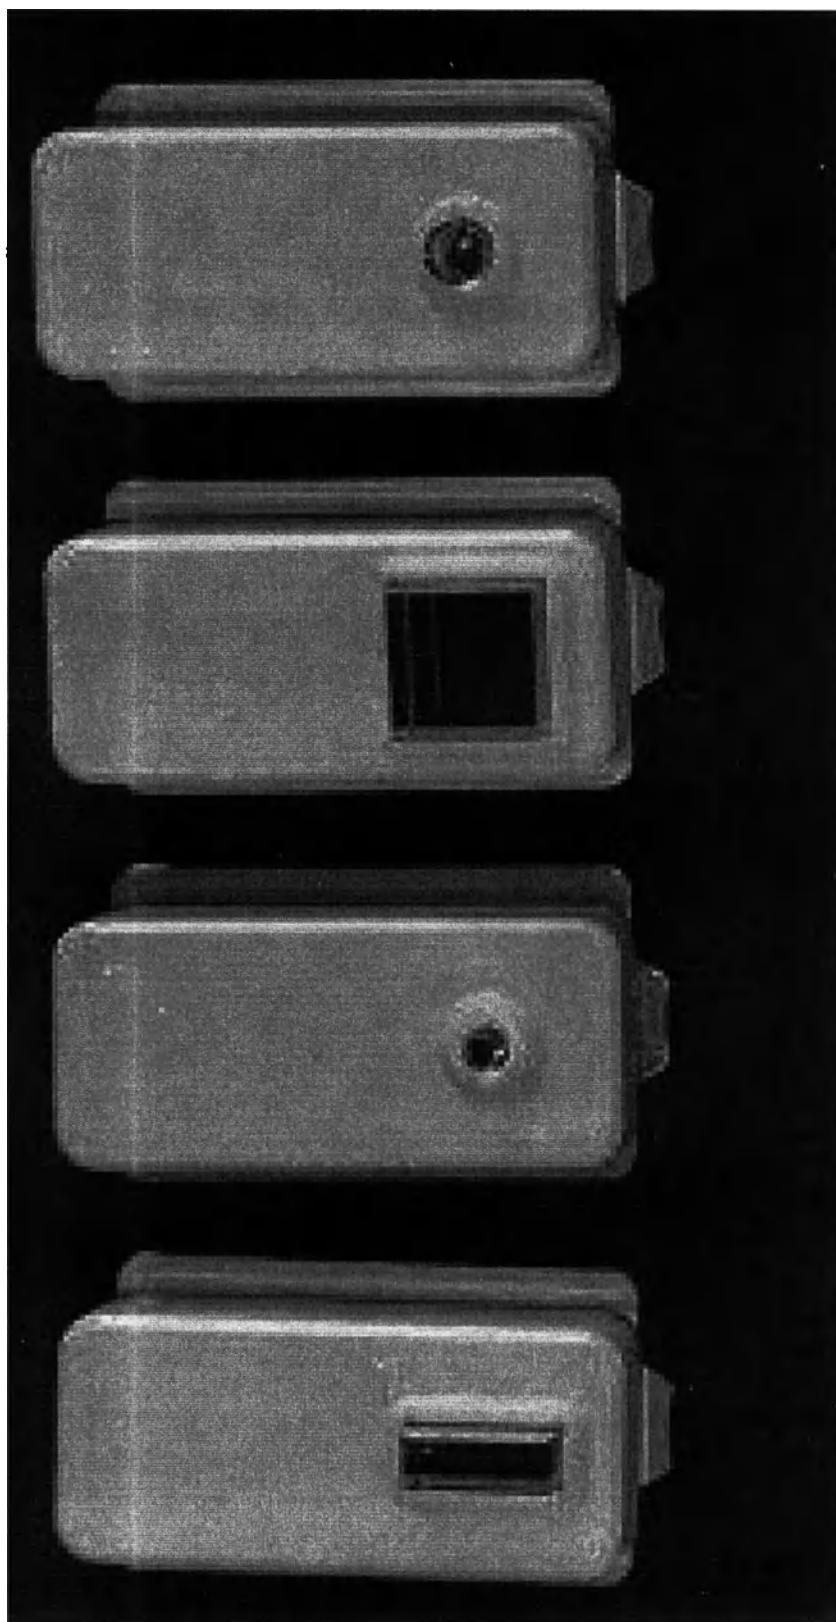


Направляющие (крышки контактных пластин)

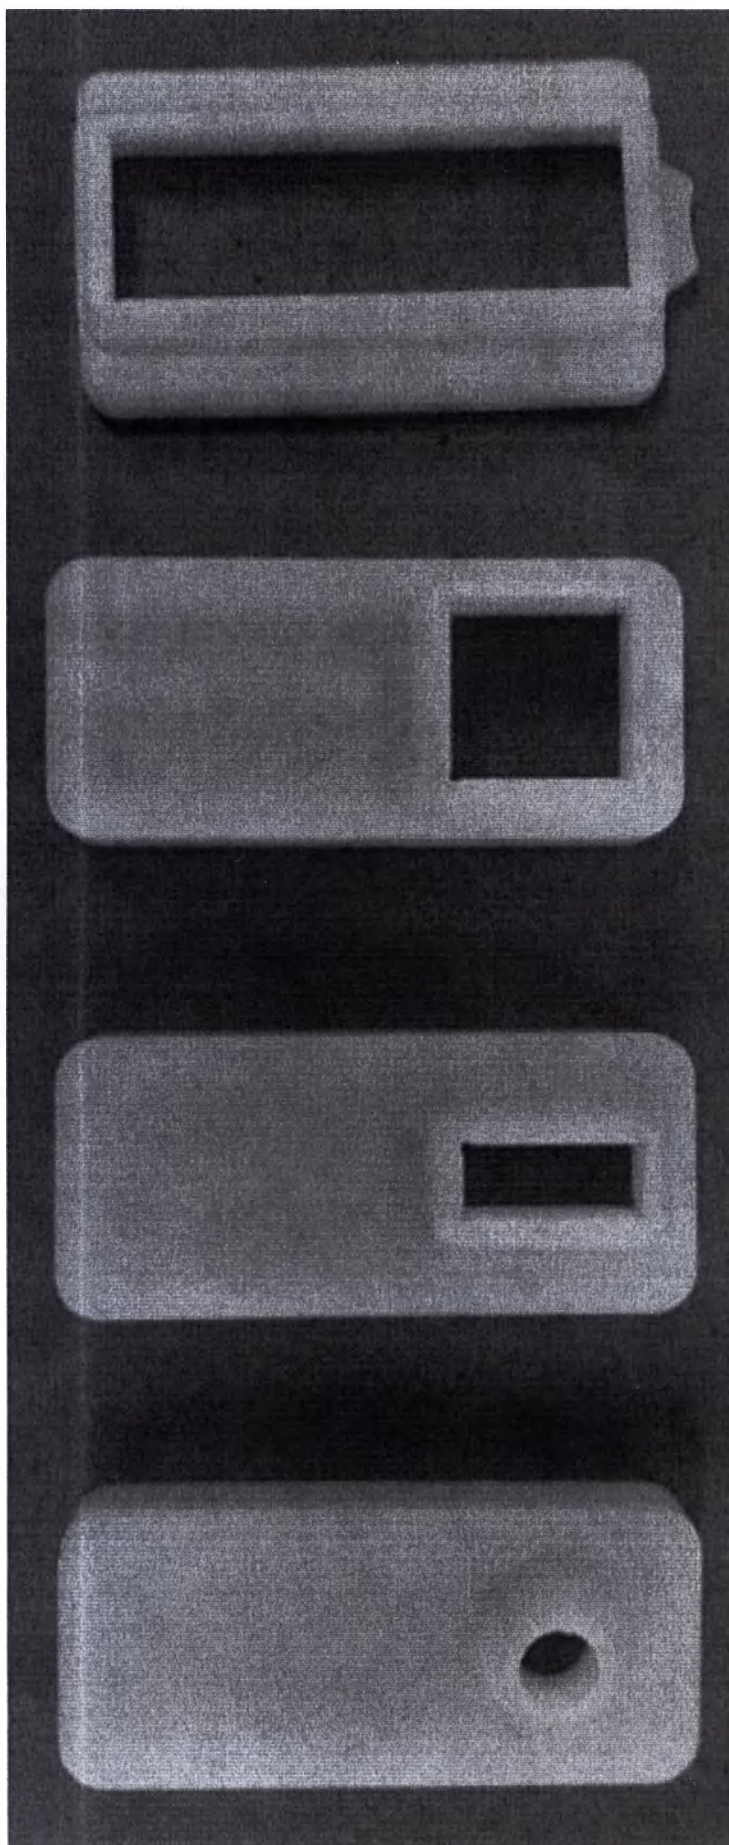



Ножная педаль

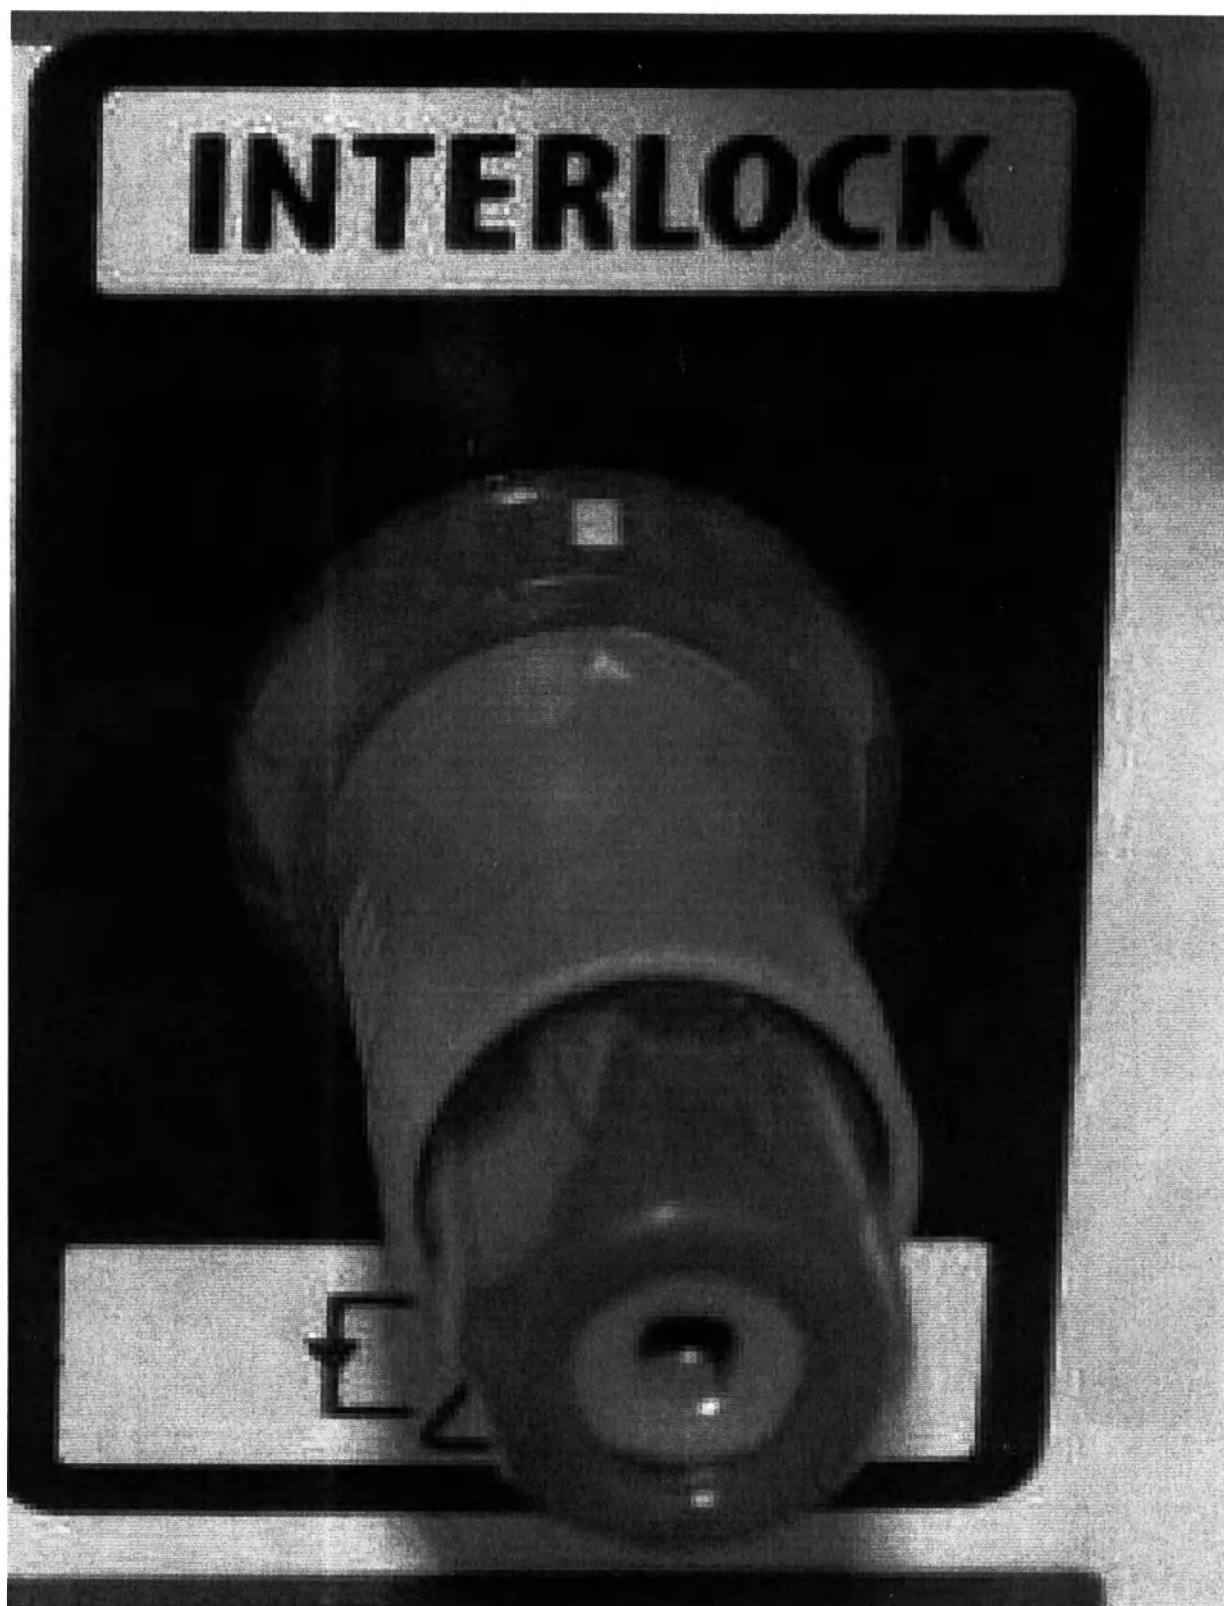


Выключатель блокировки



Защитные очки




Защитный экран для пациента

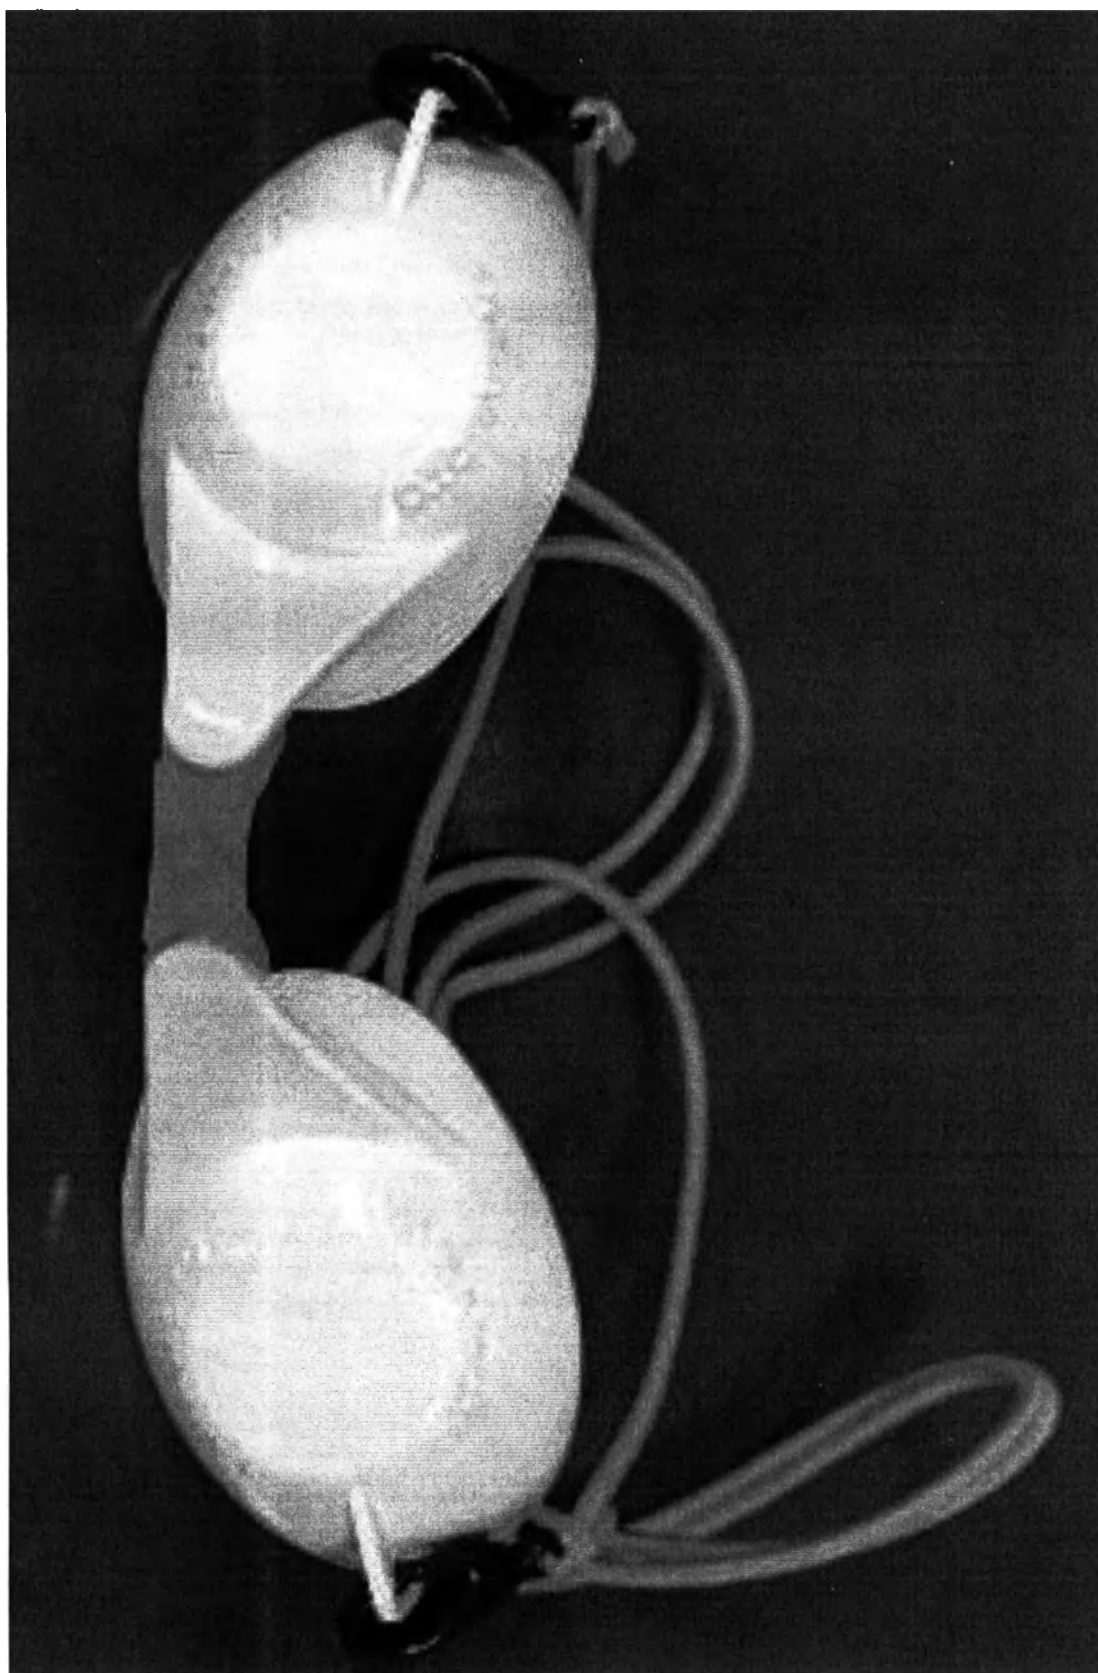

Маркировка


Intense Pulsed Light System(IPDL)		
REF SUPER VELOCE 4800		ilooda
MAINS CONFIGURATION 50Hz / 60Hz	DISCONTINUOUS USE 5 Min. / 15 Min. (at maximum power)	220VAC +/-10% - I max = 19.5A FUSE T 32A
 NSON Co., Ltd. 188-15, Damun-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Korea Tel: +82-53-857-5995 / Fax: +82-53-857-5998	 OBELIS S.A. Bd Général Wahis, 53 B-1030 Brussels, Belgium Tel: +32-2-732-59-54 / Fax: +32-2-732-60-03 E-MAIL: mail@obelis.net	
SN		
 Please read the user manual carefully before use.		Made in Korea    
ILOODA Co., Ltd. Distributor 120, Jangan-ro, 458 beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea Tel: +82-31-278-4660 / Fax: +82-31-278-4661		
 To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only		

Проект маркировки на русском языке

Система терапевтическая широкополосного пульсирующего света		
(REF) SUPER VELOCE 4800		ilooda
 NSON CO., Ltd. 188-15, Damun-ro, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Korea +82-53-857-5995 / факс +82-53-857-5998	 OBELIS S.A. Bd. General Wahis, 53 B -1030 Brussels, Бельгия Тел.: +32.2.732.59.54 Факс: +32.2.732.60.03 E-mail: mail@obelis.net	
SN		
 Пожалуйста внимательно прочтите руководство пользователь перед использованием	Сделано в Корее	   
Дистрибьютор ILOODA Co., LTD (ИЛУДА КО., ЛТД.) 120, Jangan-ro, 458beon-gil, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea (Корея)		
 Во избежание поражения электрическим током не вскрывать корпус аппарата. Доступ для обслуживания разрешен только квалифицированному персоналу		

Прошить, пронумеровано и заверено
печатью 17 листа (ов).

Генеральный директор
ООО «ИОНТО ТЕХНОЛОДЖИ»

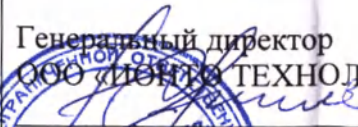 Сорокин П.Ю.

2021 г.

