

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РусАртро»

С.Ю. Козлова


26 декабря 2023 г.



Фотографические изображения медицинского изделия


Винт для фиксации связок «РусАртро», в вариантах исполнения
по ТУ 32.50.22-002-99322005-2022



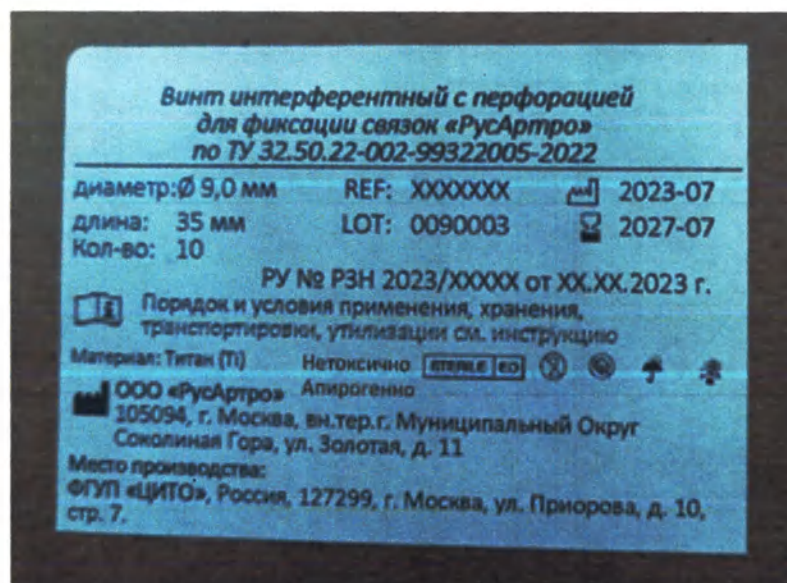

Фотографическое изображение 1

Фотографические изображения 1 Внешний вид и маркировка потребительской (транспортной) упаковки на примере «Винт интерферентный с перфорацией для фиксации связок «РусАртро» по ТУ 32.50.22-002-99322005»

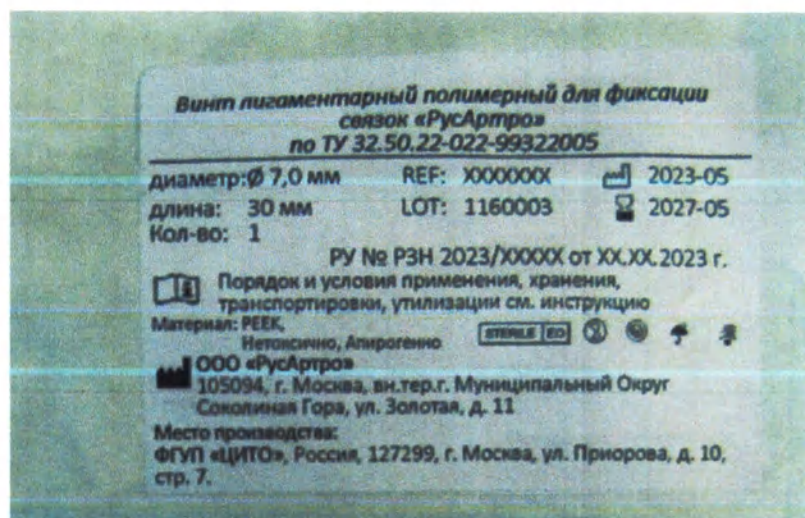


Фотографическое изображение 2



Фотографическое изображение 3

Фотографические изображения 3-4 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный полимерный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø7,0x30 мм.

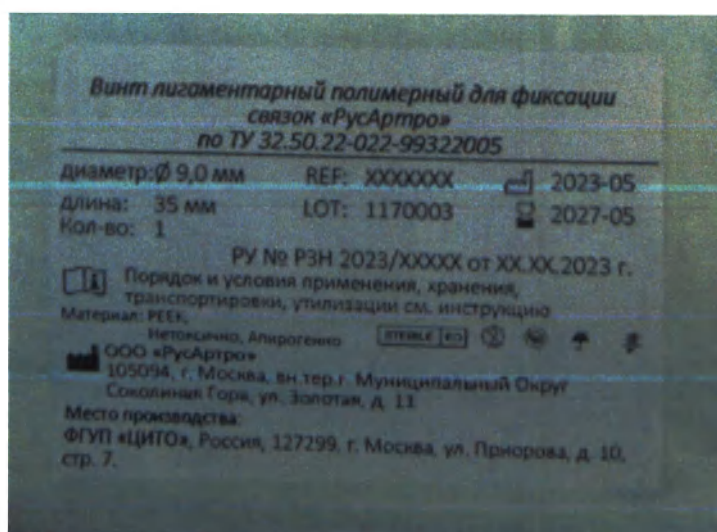


Фотографическое изображение 4



Фотографическое изображение 5

Фотографические изображения 5-6 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный полимерный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø9,0x35 мм.

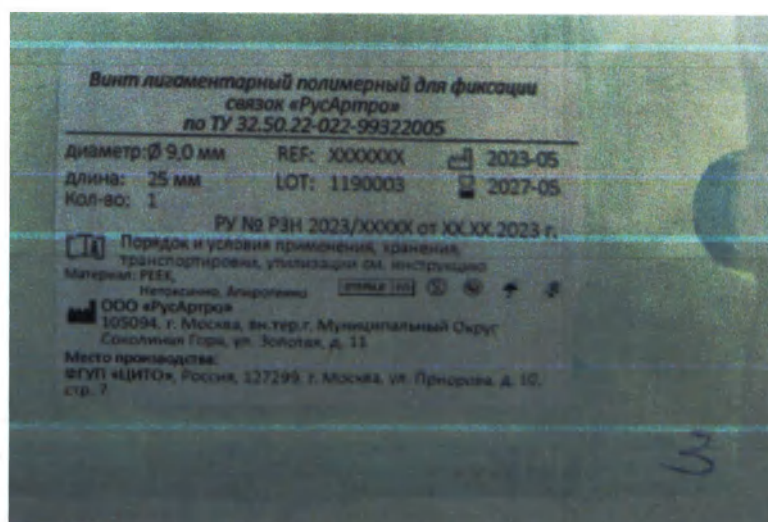


Фотографическое изображение 6



Фотографическое изображение 7

Фотографические изображения 7-8 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный полимерный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø9,0x25 мм.

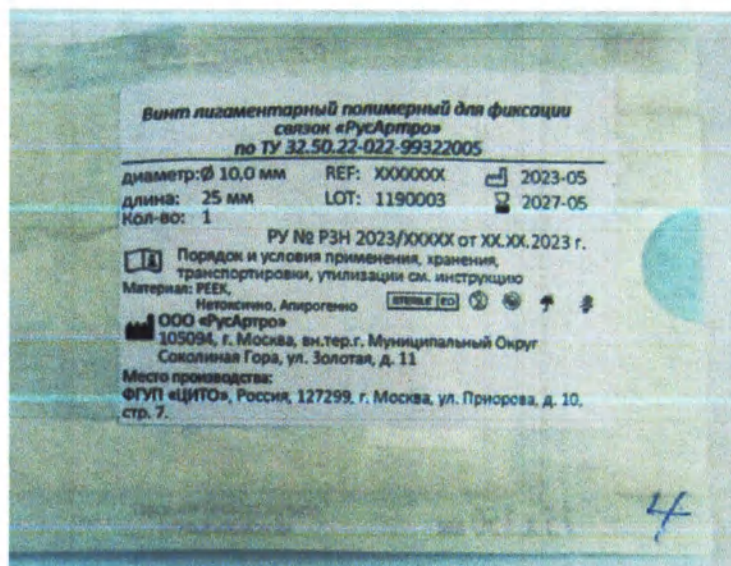


Фотографическое изображение 8



Фотографическое изображение 9

Фотографические изображения 9-10 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный полимерный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø10,0x25 мм.

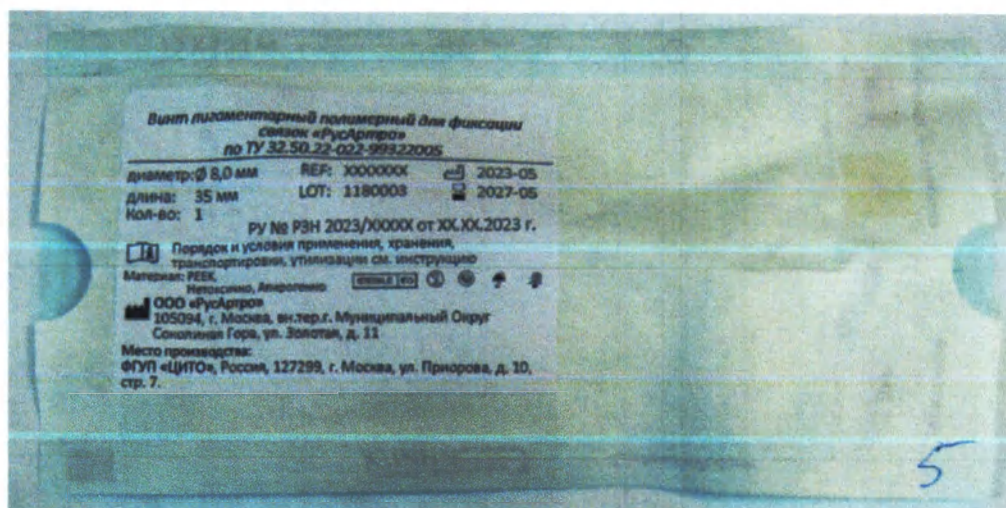


Фотографическое изображение 10




Фотографическое изображение 11

Фотографические изображения 11-12 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный полимерный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0x35 мм.

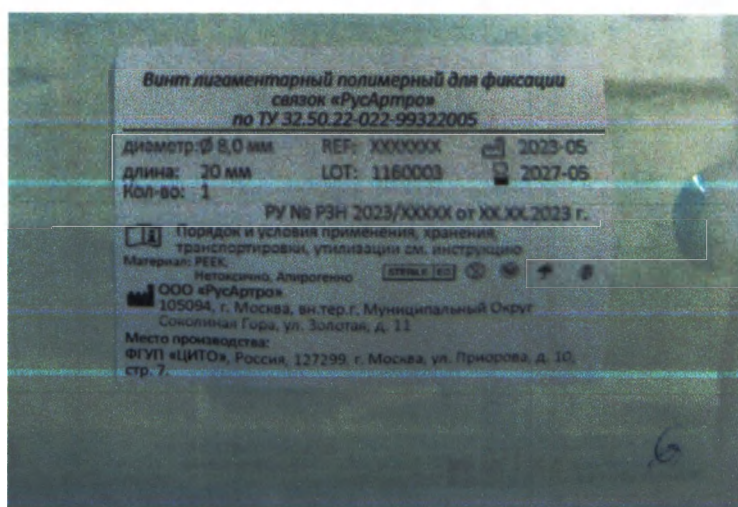


Фотографическое изображение 12

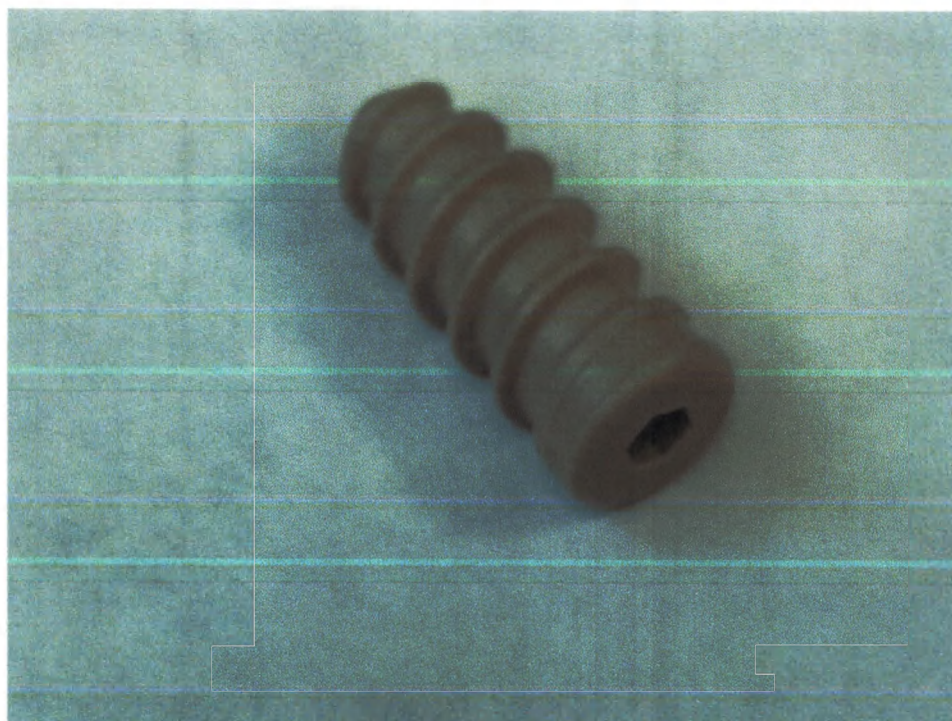

Фотографическое изображение 13

Фотографические изображения 13-14 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный полимерный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0x20 мм.

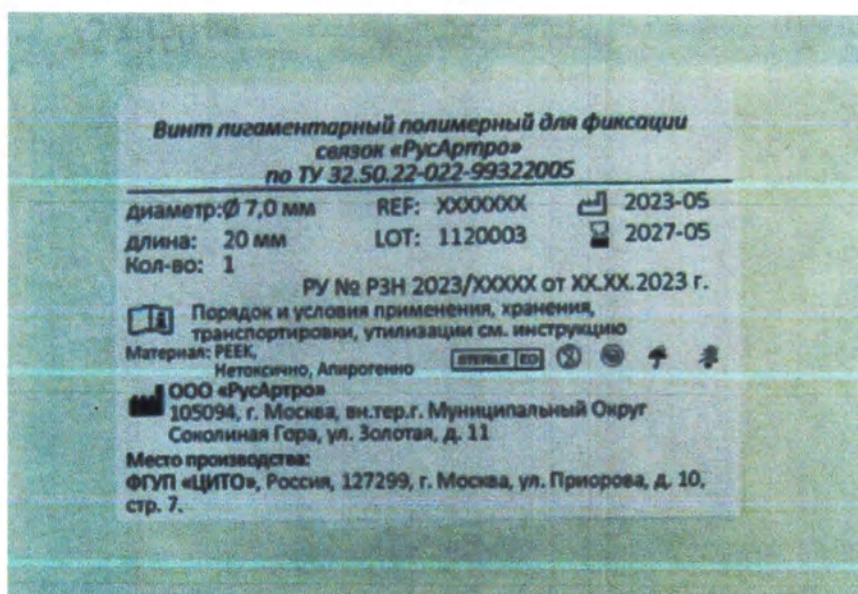


Фотографическое изображение 14



Фотографическое изображение 15

Фотографические изображения 15-16 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный полимерный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø7,0x20 мм.

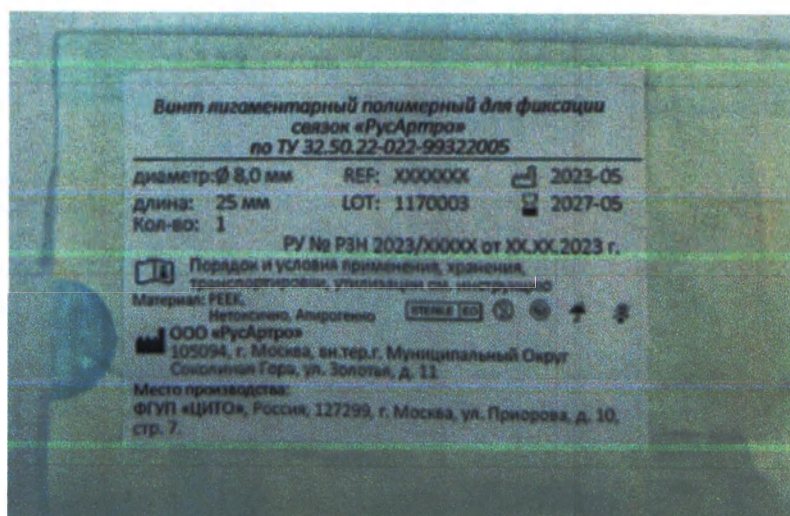


Фотографическое изображение 16



Фотографическое изображение 17

Фотографические изображения 17-18 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный полимерный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0x25 мм.

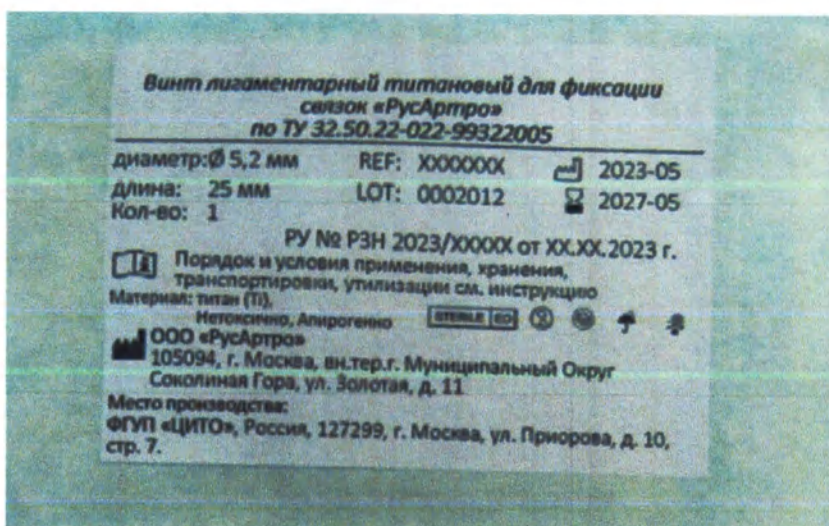


Фотографическое изображение 18



Фотографическое изображение 19

Фотографические изображения 19-20 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø5,2x25 мм.

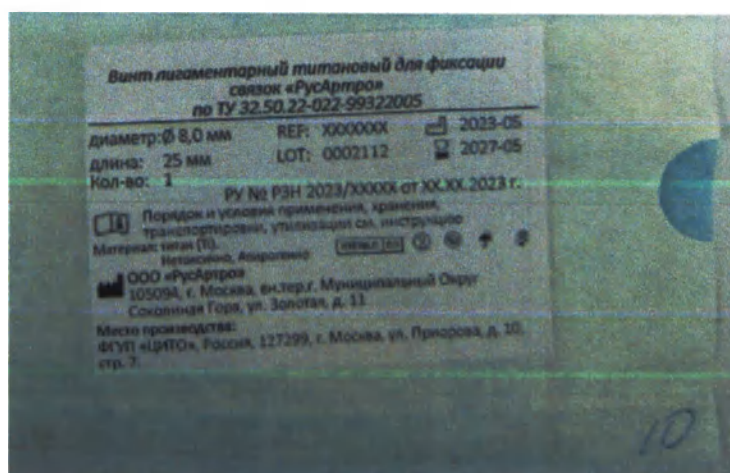


Фотографическое изображение 20




Фотографическое изображение 21

Фотографические изображения 21-22 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0х25 мм.

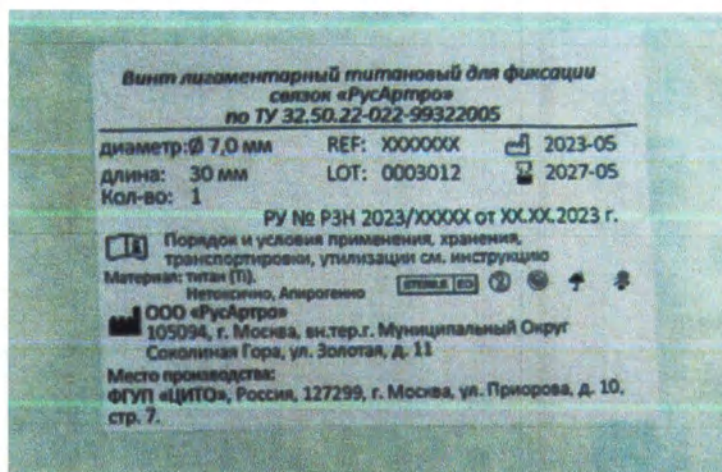


Фотографическое изображение 22

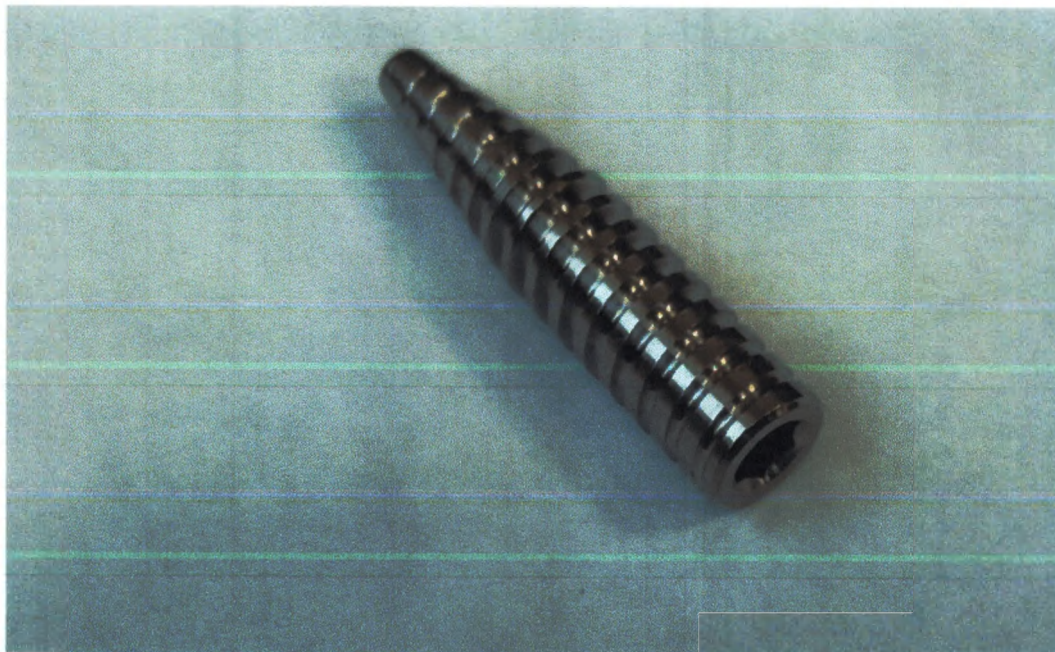

Фотографическое изображение 23

Фотографические изображения 23-24 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø7,0x30 мм.

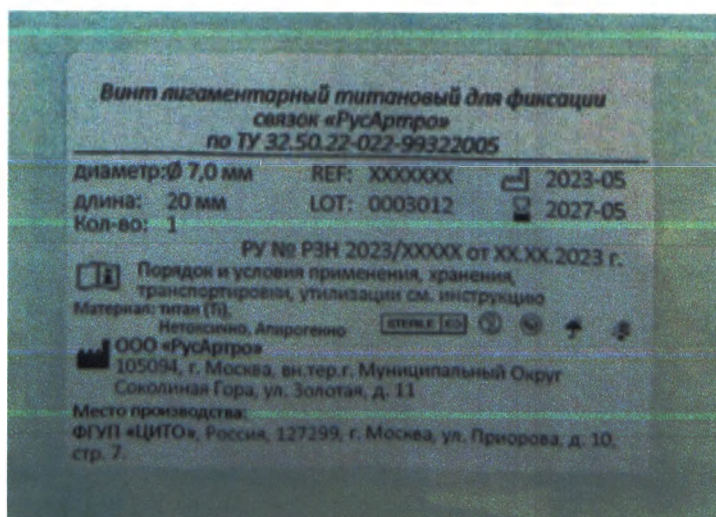


Фотографическое изображение 24



Фотографическое изображение 25

Фотографические изображения 25-26 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø7,0x20 мм.

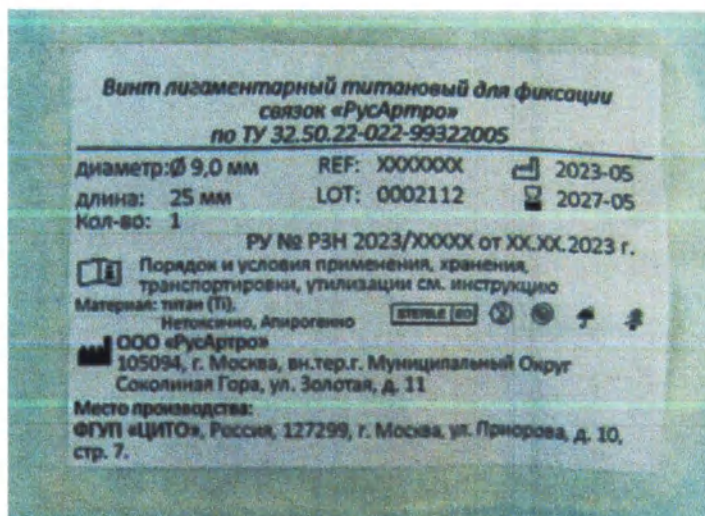


Фотографическое изображение 26



Фотографическое изображение 27

**Фотографические изображения 27-28 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø9,0x25 мм.**

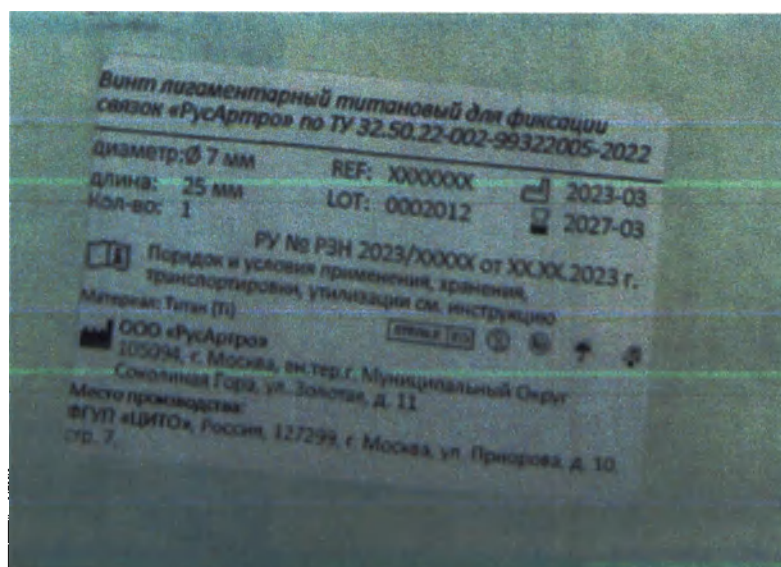


Фотографическое изображение 28



Фотографическое изображение 29

Фотографические изображения 29-30 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø7,0x25 мм.

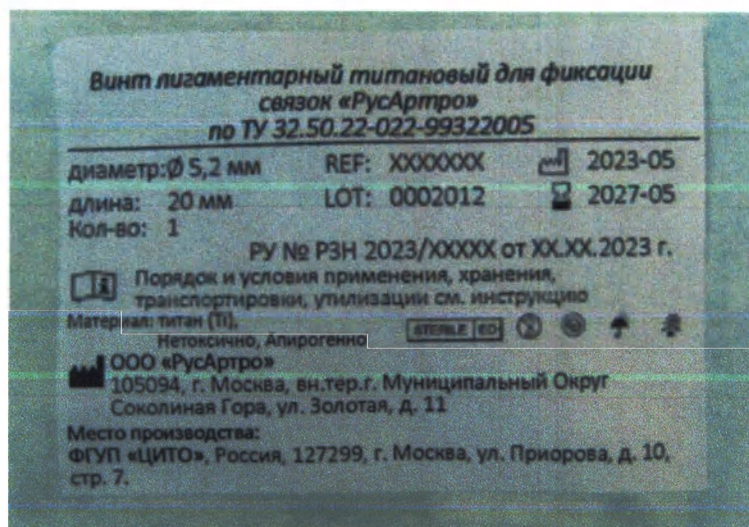


Фотографическое изображение 30



Фотографическое изображение 31

Фотографические изображения 31-32 Внешний вид и маркировка образца
«Винт лигаментарный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø5,2x20 мм.

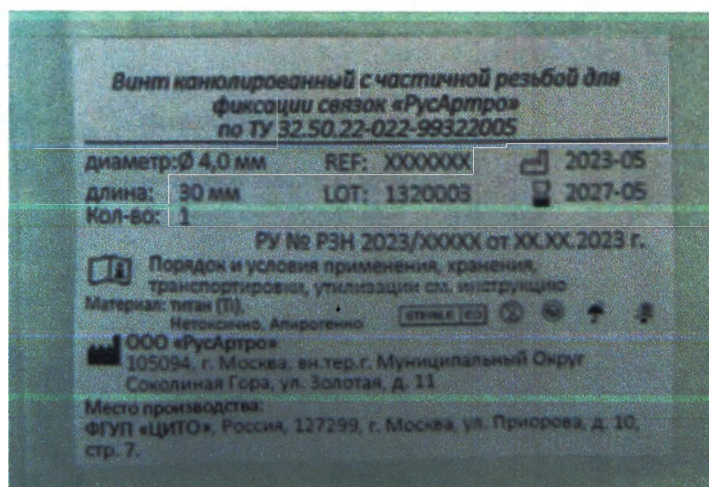

Фотографическое изображение 32



Фотографическое изображение 33

Фотографические изображения 33-34 Внешний вид и маркировка образца
«Винт канюлированный с частичной резьбой для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø4,0x30 мм.



Фотографическое изображение 34



Фотографическое изображение 35

Фотографические изображения 35-36 Внешний вид и маркировка образца
«Винт канюлированный с частичной резьбой для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø4,0x40 мм.




Фотографическое изображение 36




Фотографическое изображение 37

Фотографические изображения 37-38 Внешний вид и маркировка образца
«Винт канюлированный с частичной резьбой для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø4,0x32 мм.

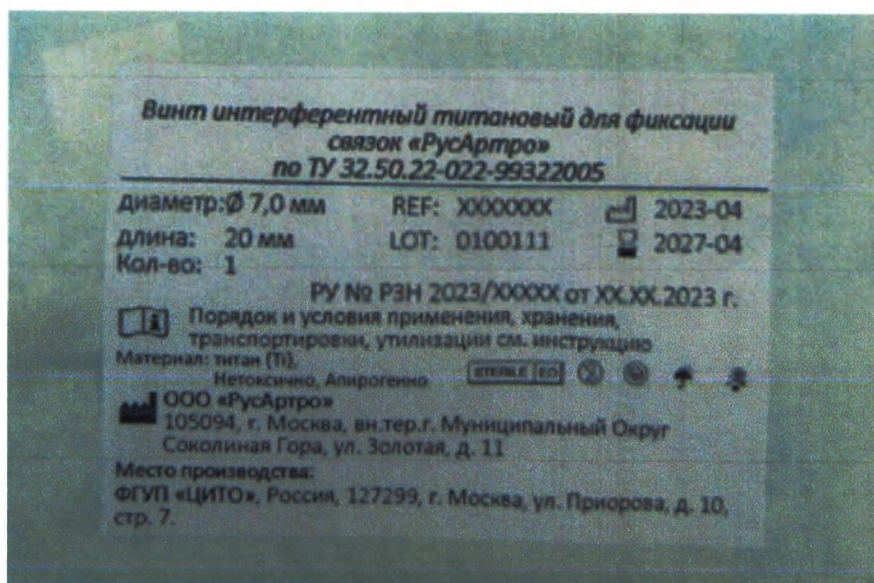


Фотографическое изображение 38

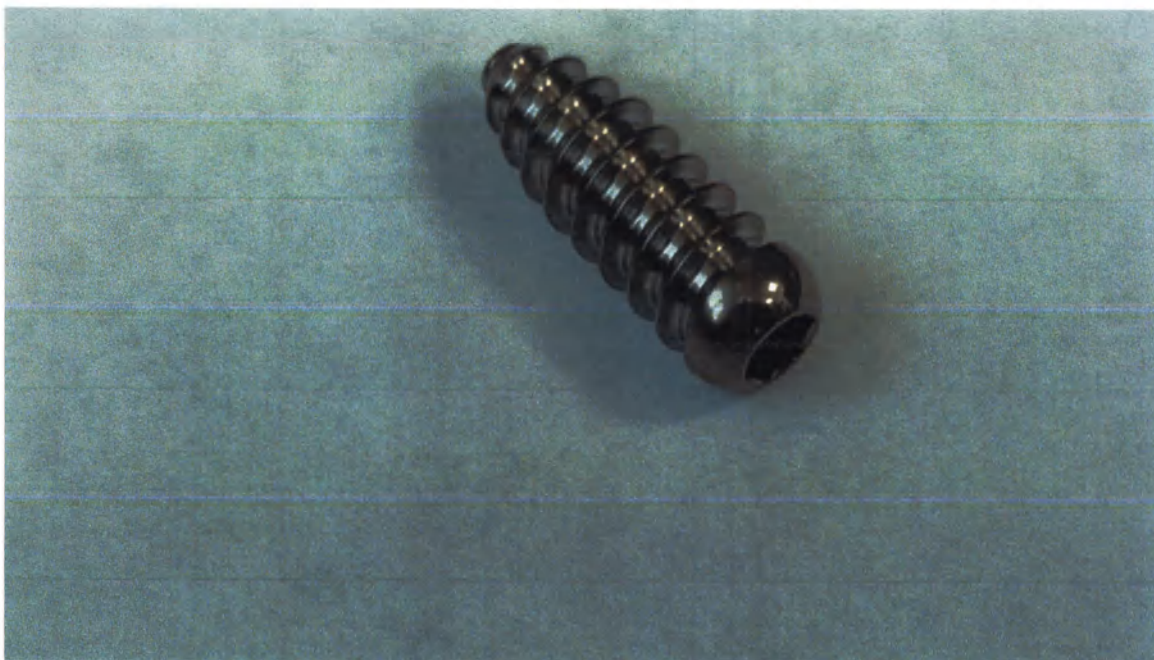


Фотографическое изображение 39

Фотографические изображения 39-40 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø7,0x20 мм.

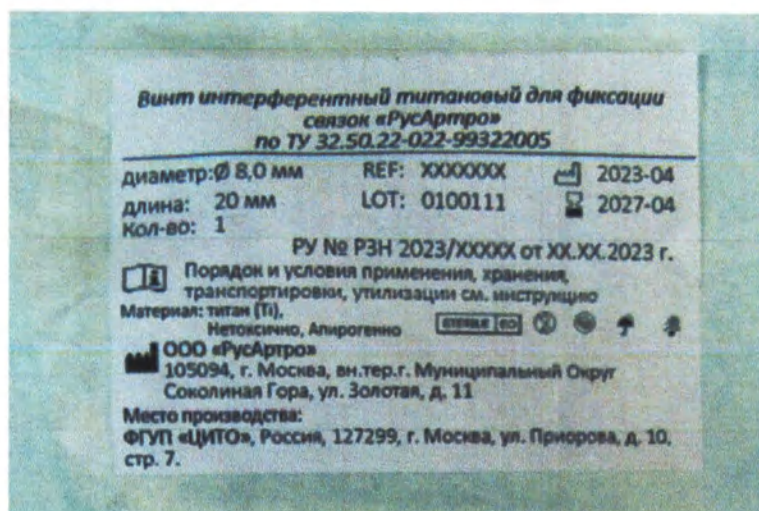


Фотографическое изображение 40

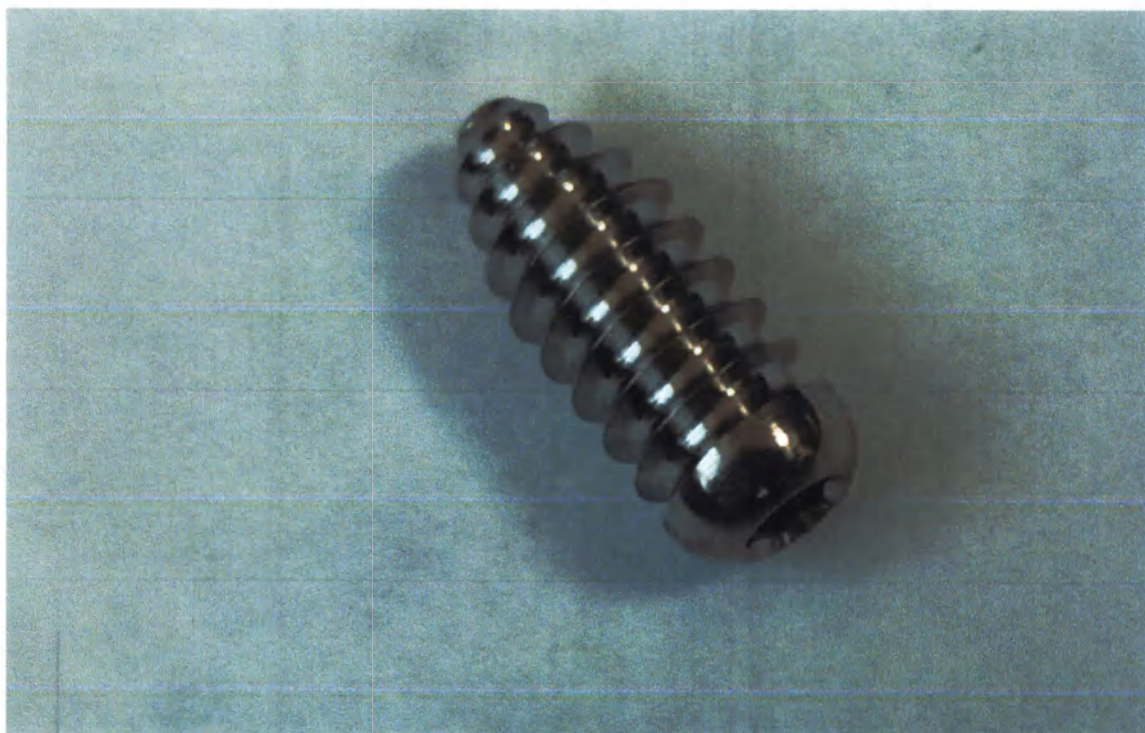


Фотографическое изображение 41

Фотографические изображения 41-42 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0x20 мм.

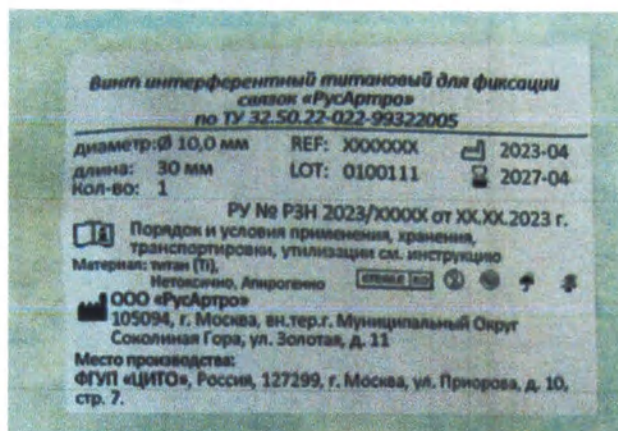

Фотографическое изображение 42

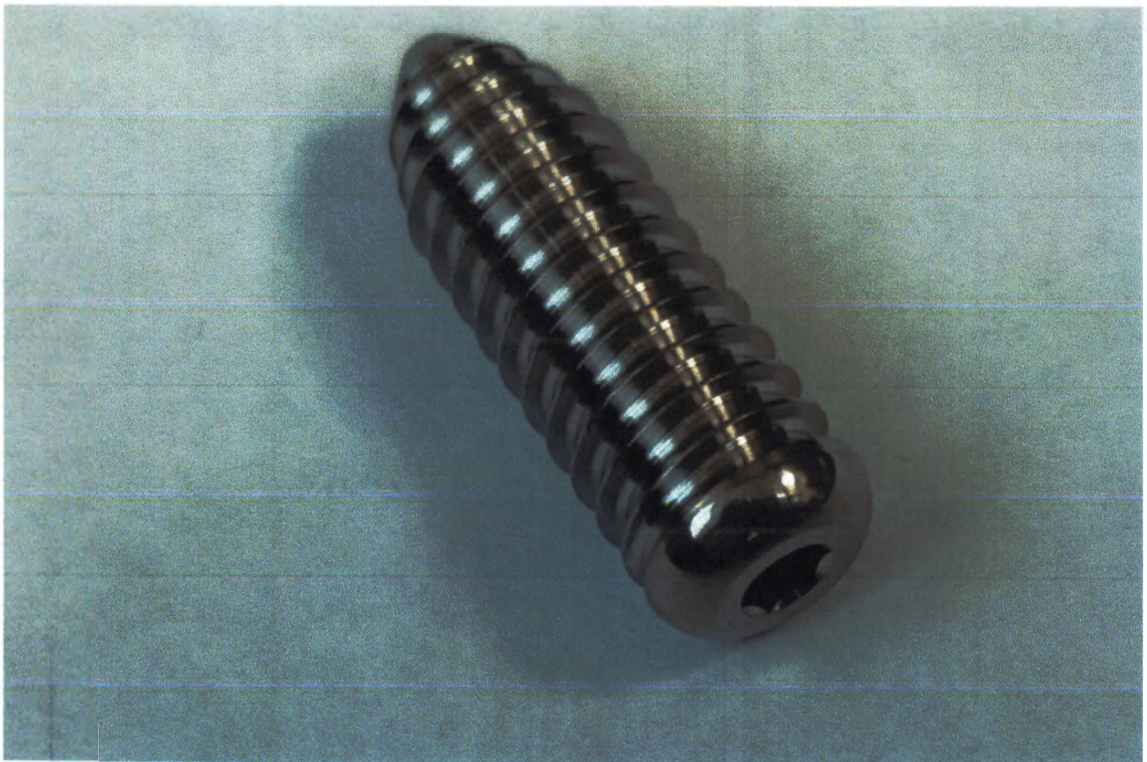


Фотографическое изображение 43

Фотографические изображения 43-44 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø10,0x30 мм.




Фотографическое изображение 44

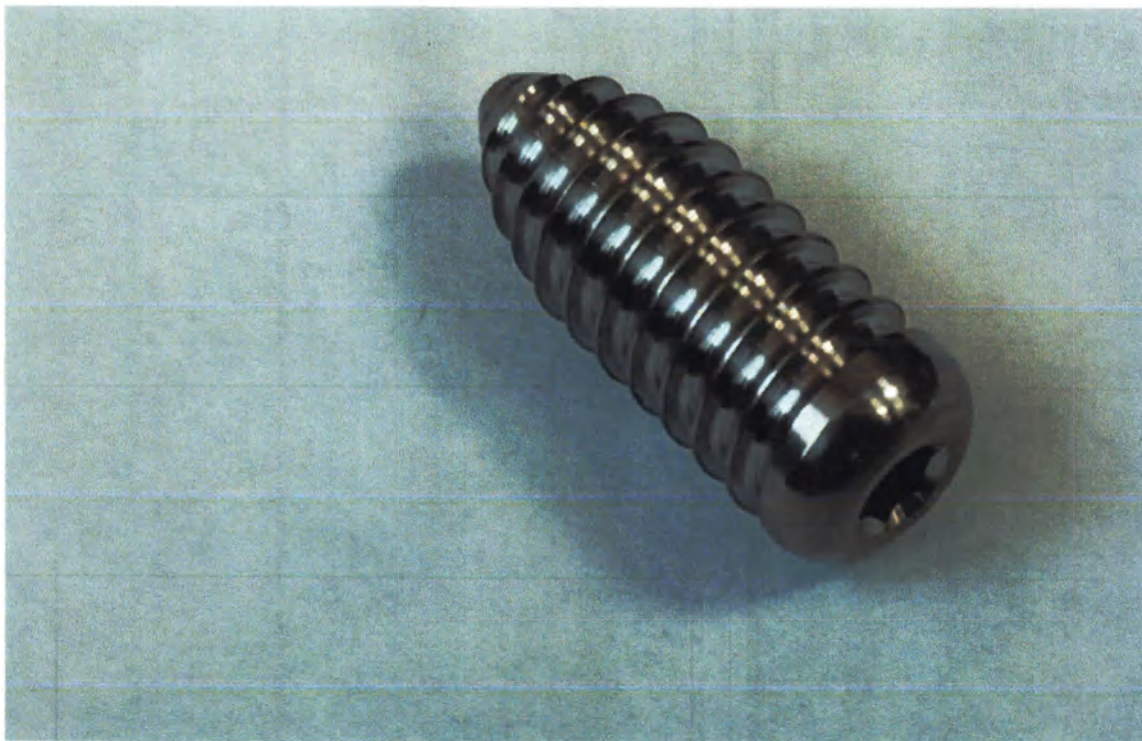


Фотографическое изображение 45

Фотографические изображения 45-46 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø10,0x25 мм.

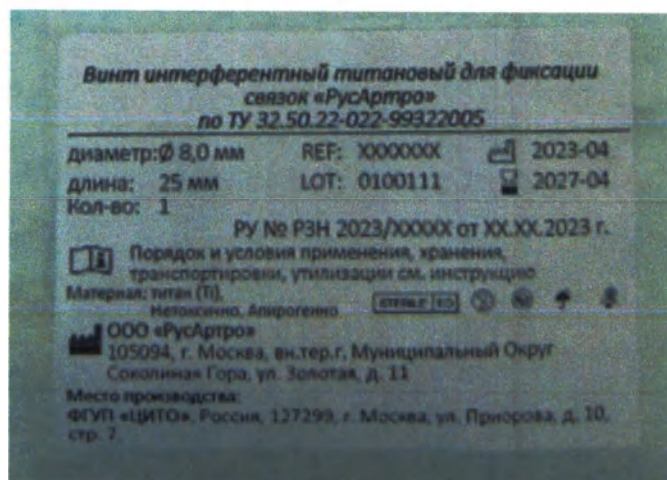


Фотографическое изображение 46

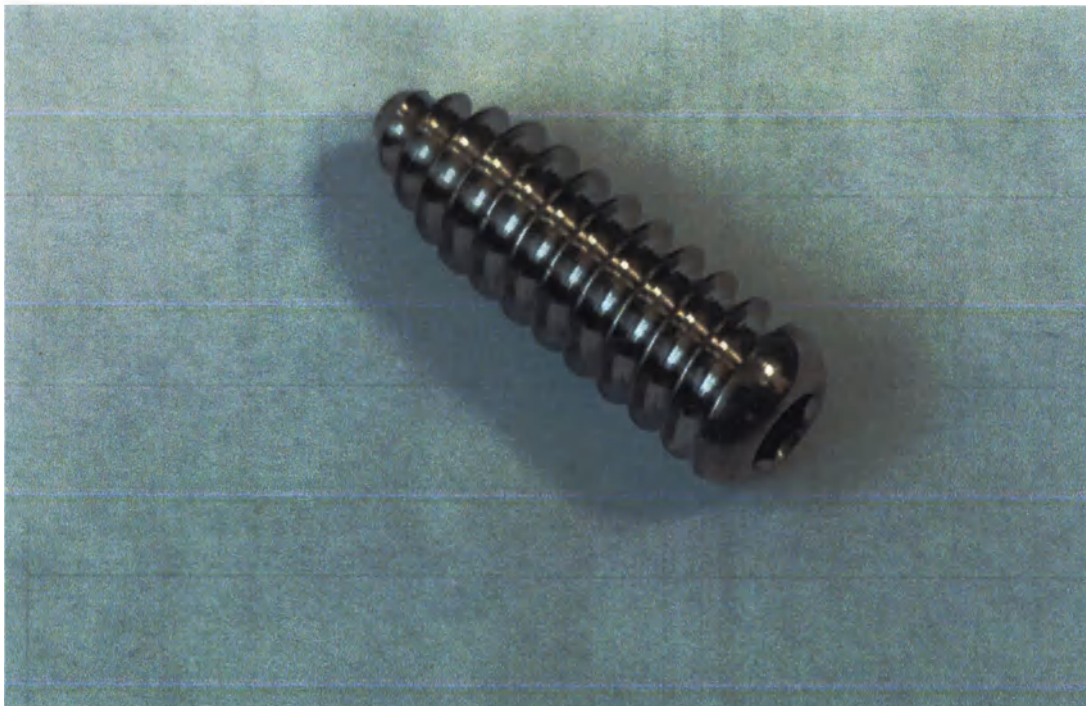


Фотографическое изображение 47

Фотографические изображения 47-48 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0x25 мм.

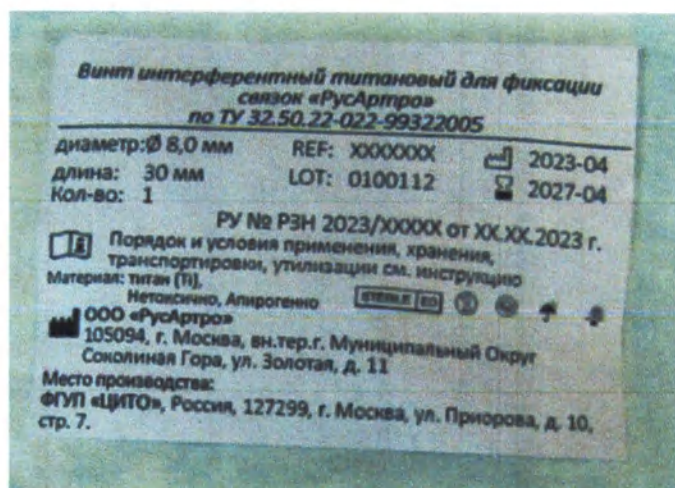

Фотографическое изображение 48

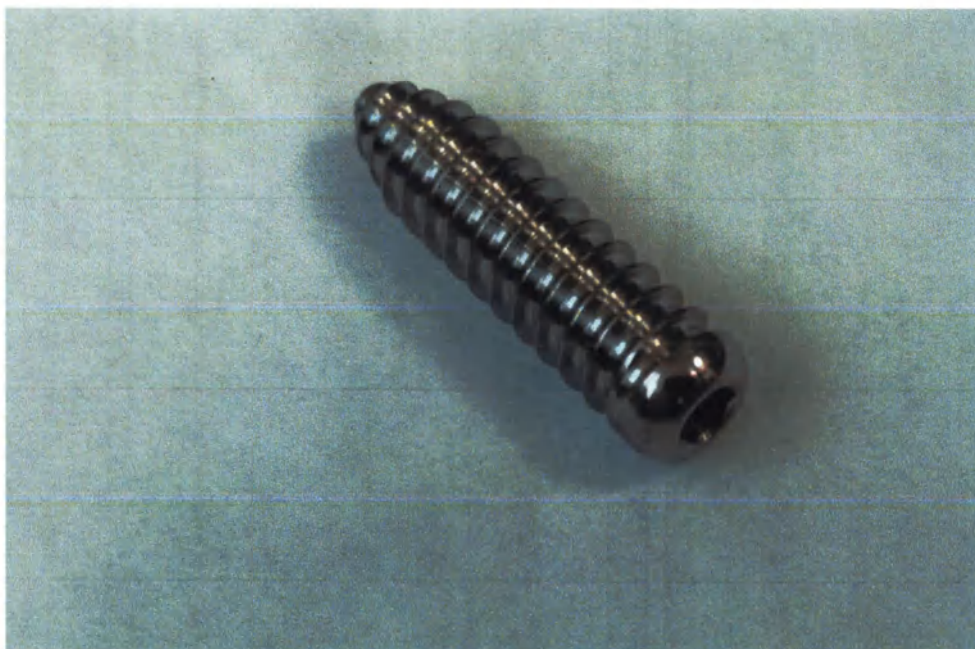


Фотографическое изображение 49

Фотографические изображения 49-50 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный титановый для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0x30 мм.



Фотографическое изображение 50

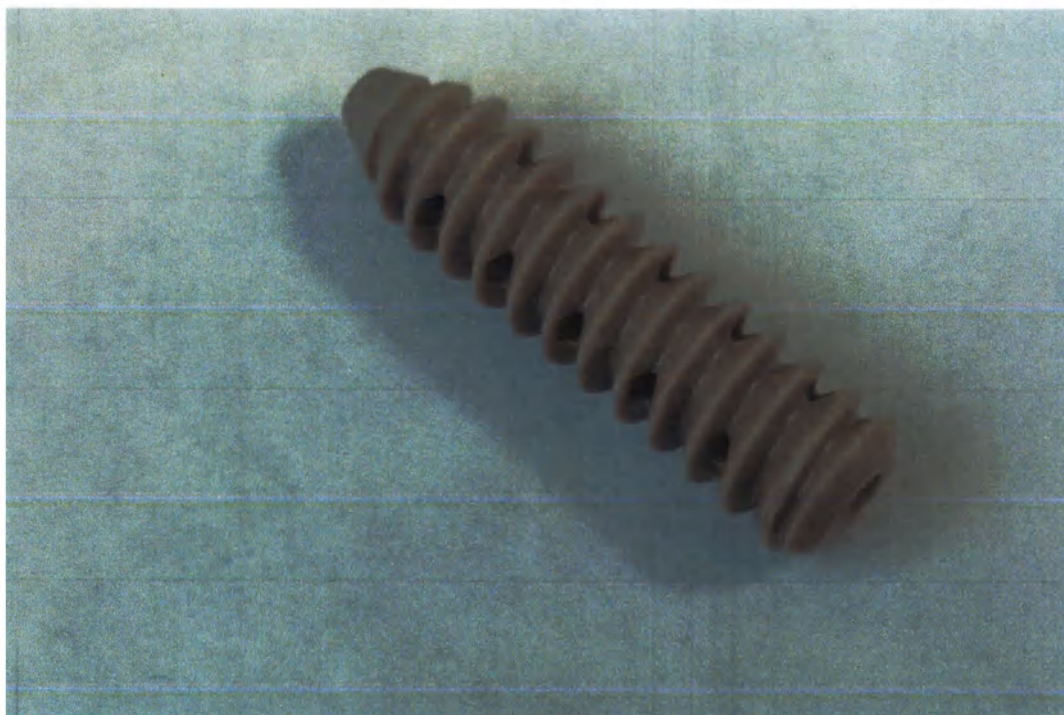

Фотографическое изображение 51

Фотографические изображения 51-52 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный с перфорацией для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø9,0x35 мм.




Фотографическое изображение 52



Фотографическое изображение 53

Фотографические изображения 53-54 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный с перфорацией для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø6,0x25 мм.

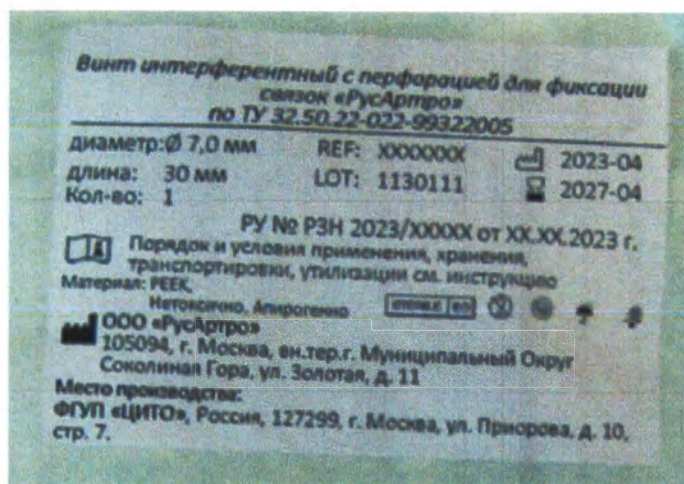

Фотографическое изображение 54



Фотографическое изображение 55

**Фотографические изображения 55-56 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный с перфорацией для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø7,0х30 мм.**



Фотографическое изображение 56



Фотографическое изображение 57

Фотографические изображения 57-58 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный с перфорацией для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø9,0x30 мм.




Фотографическое изображение 58



Фотографическое изображение 59

Фотографические изображения 59-60 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный с перфорацией для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø7,0x25 мм.

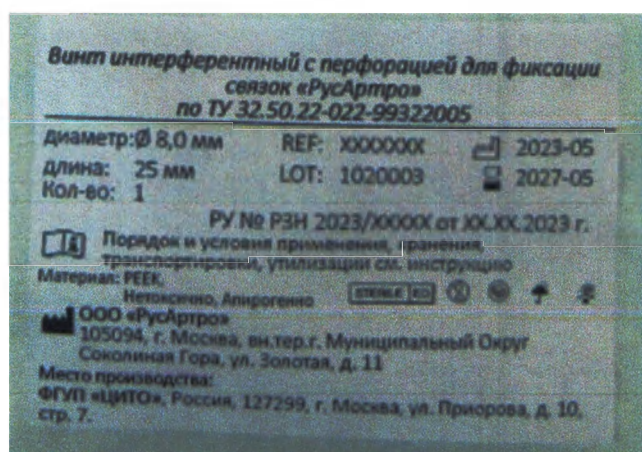

Фотографическое изображение 60



Фотографическое изображение 61

Фотографические изображения 61-62 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный с перфорацией для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0x25 мм.




Фотографическое изображение 62




Фотографическое изображение 63

**Фотографические изображения 63-64 Внешний вид и маркировка образца
«Винт интерферентный с перфорацией для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø8,0x30 мм.**

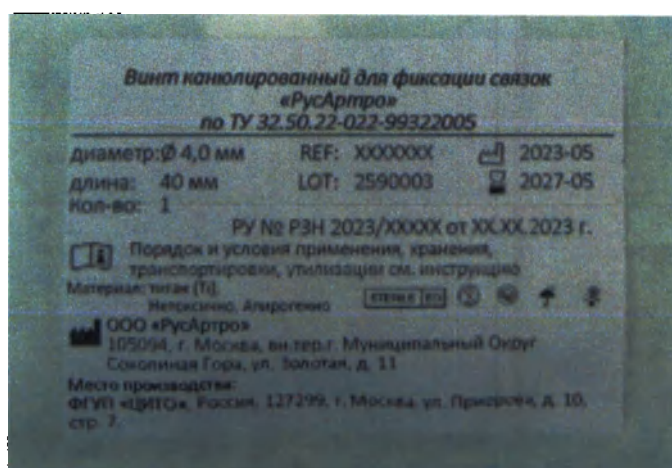


Фотографическое изображение 64

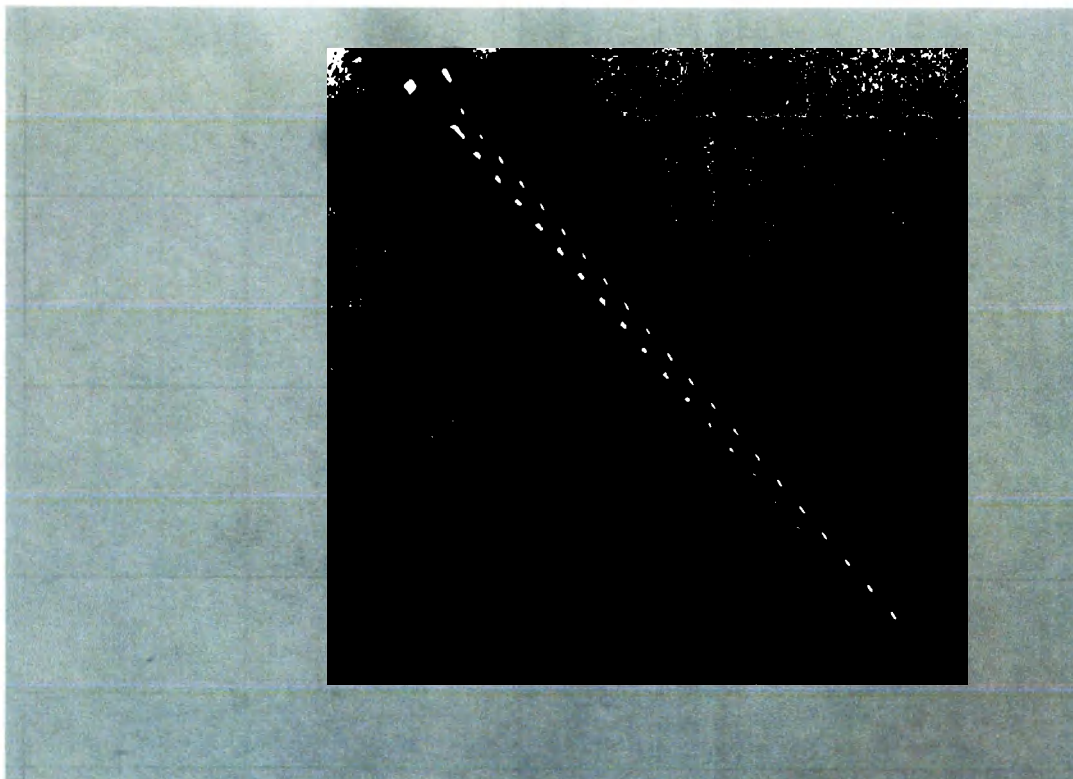

Фотографическое изображение 65

Фотографические изображения 65-66 Внешний вид и маркировка образца
«Винт канюлированный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø4,0x40 мм.

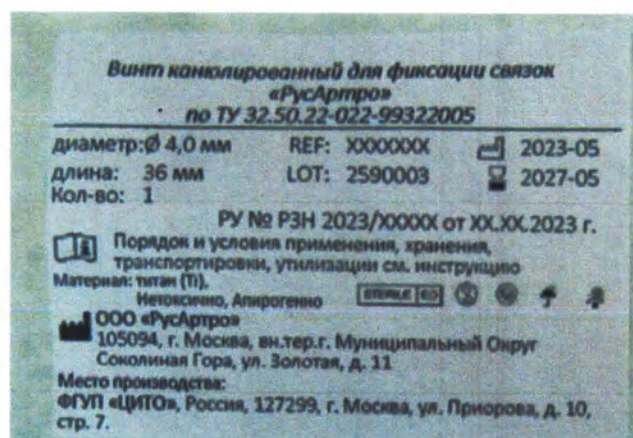


Фотографическое изображение 66



Фотографическое изображение 67

Фотографические изображения 67-68 Внешний вид и маркировка образца
«Винт канюлированный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø4,0x36 мм.

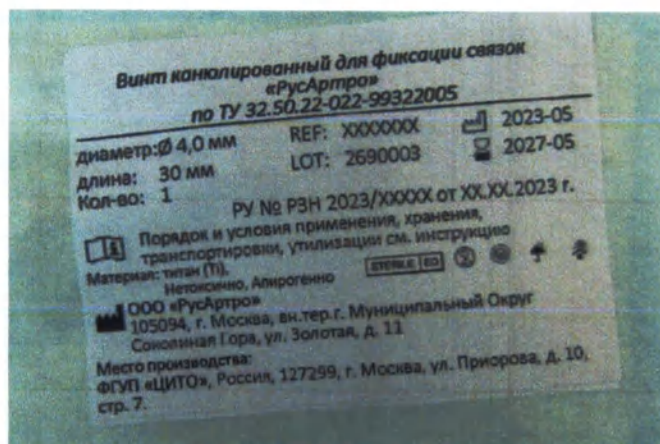

Фотографическое изображение 68



Фотографическое изображение 69

**Фотографические изображения 69 Внешний вид и маркировка образца
«Винт канюлированный для фиксации связок «РусАртро»
по ТУ 32.50.22-022-99322005» Ø4,0x30 мм.**

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

листах

