



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«31» мая 2023 г.

М.П.

Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Прогестерон» для количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23 – 235-65614693-2022»

I Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченого прогестерона (R2), 4,0 мл/уп.)



Пароизоляционные крышки



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон



Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон




Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон



Потребительская упаковка




Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)

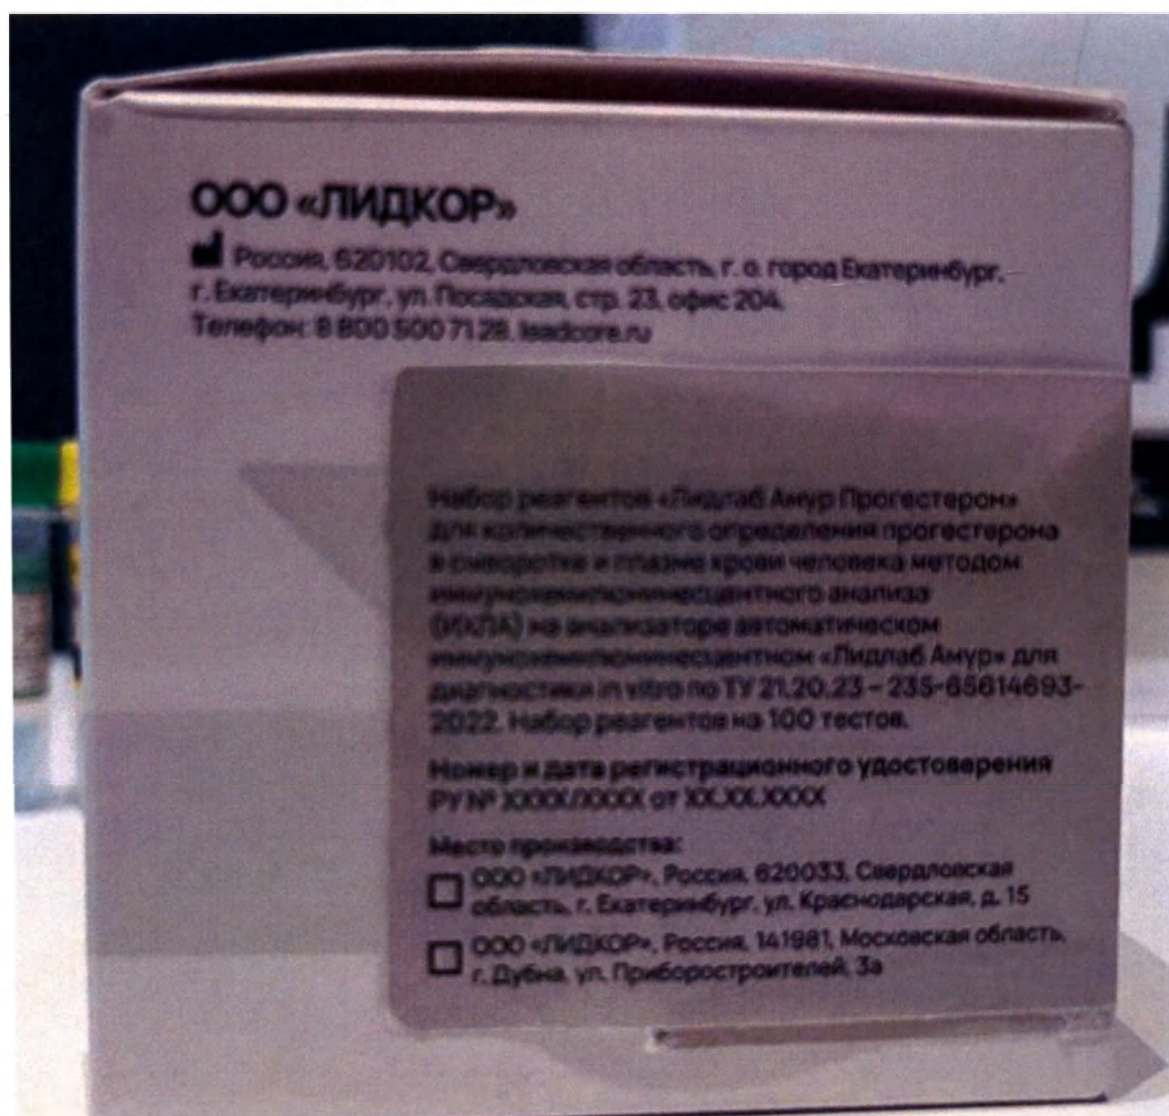


Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

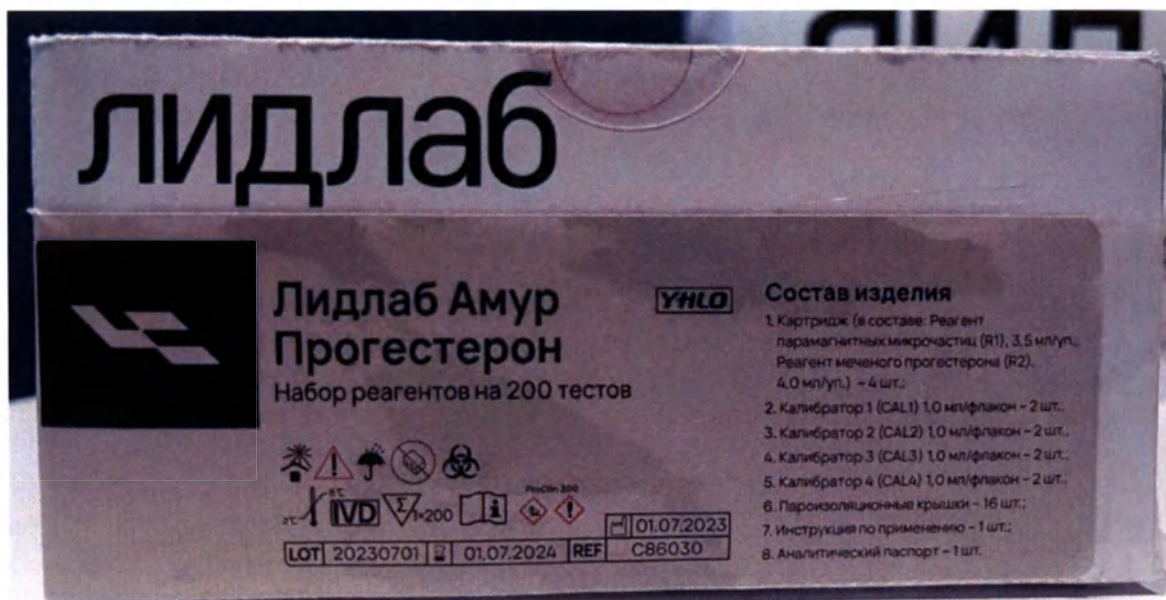


Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

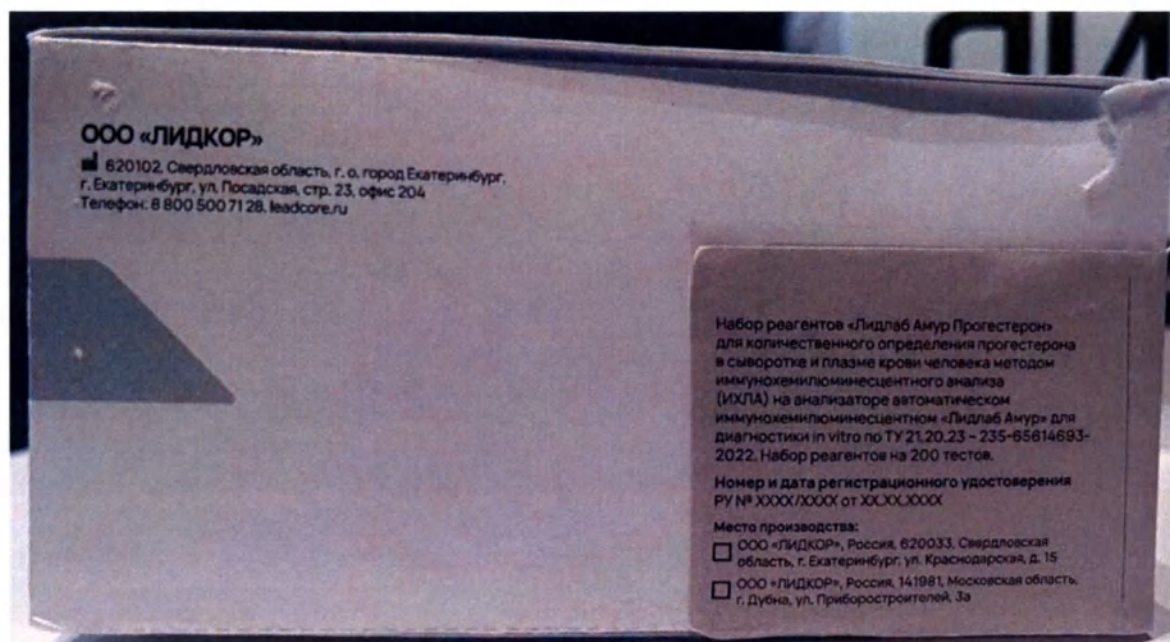


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)

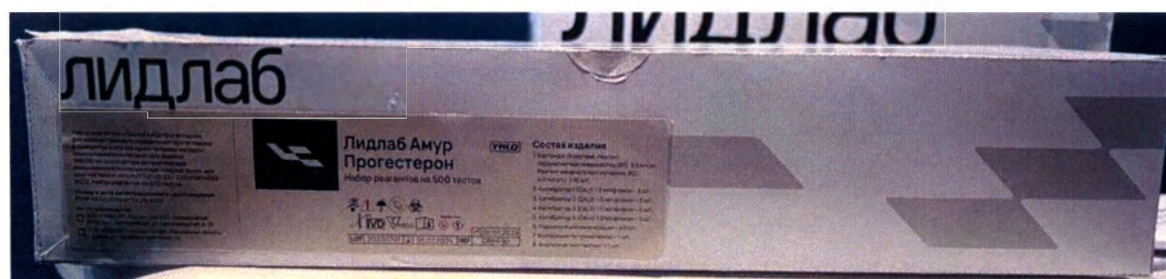

Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

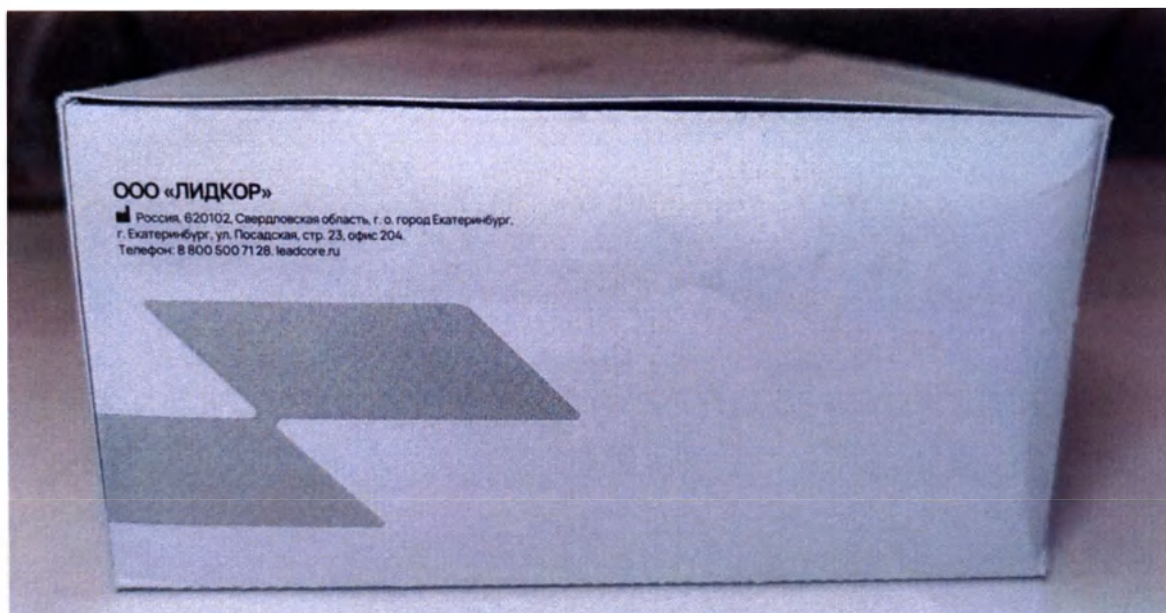

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)

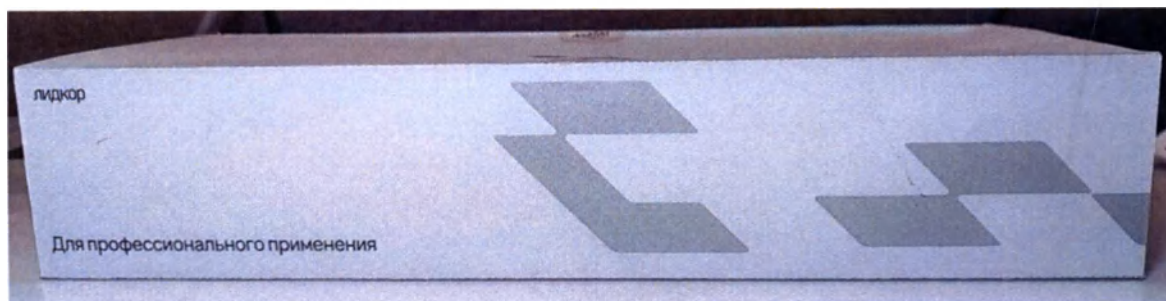

Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)



Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

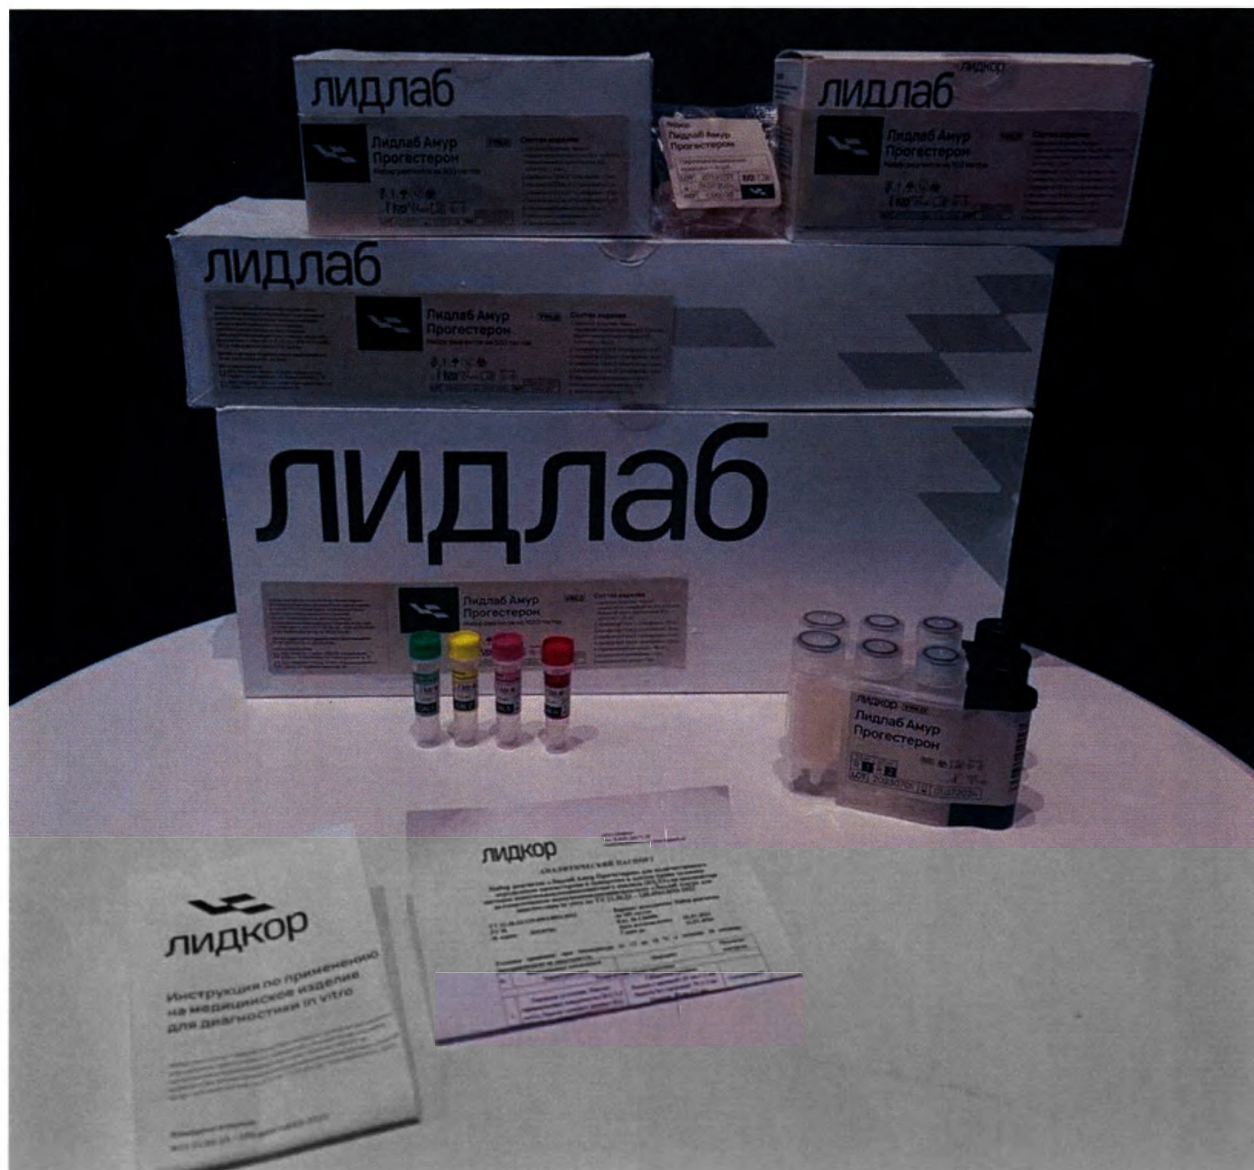

Групповое фото.

Транспортная упаковка






Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
19 (кричадышо) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»
/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"


Е.Ю. Гохгут


«31» мая 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Прогестерон» для количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 235-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.,
Реагент меченого прогестерона (R2), 4,0 мл/уп.)

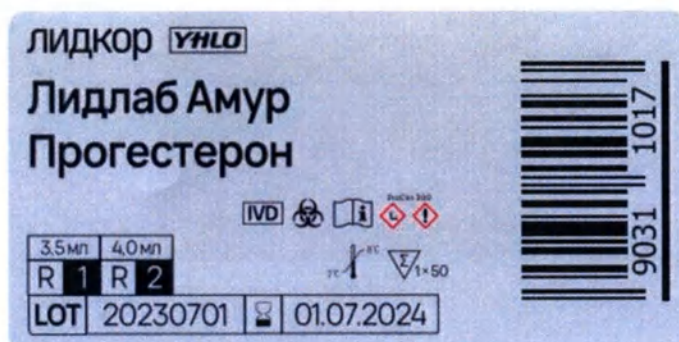

Калибратор 1 (CAL1)



Калибратор 2 (CAL2)



Калибратор 3 (CAL3)



Калибратор 4 (CAL4)



Пароизоляционные крышки




QR-code




Наклейка




Потребительская упаковка

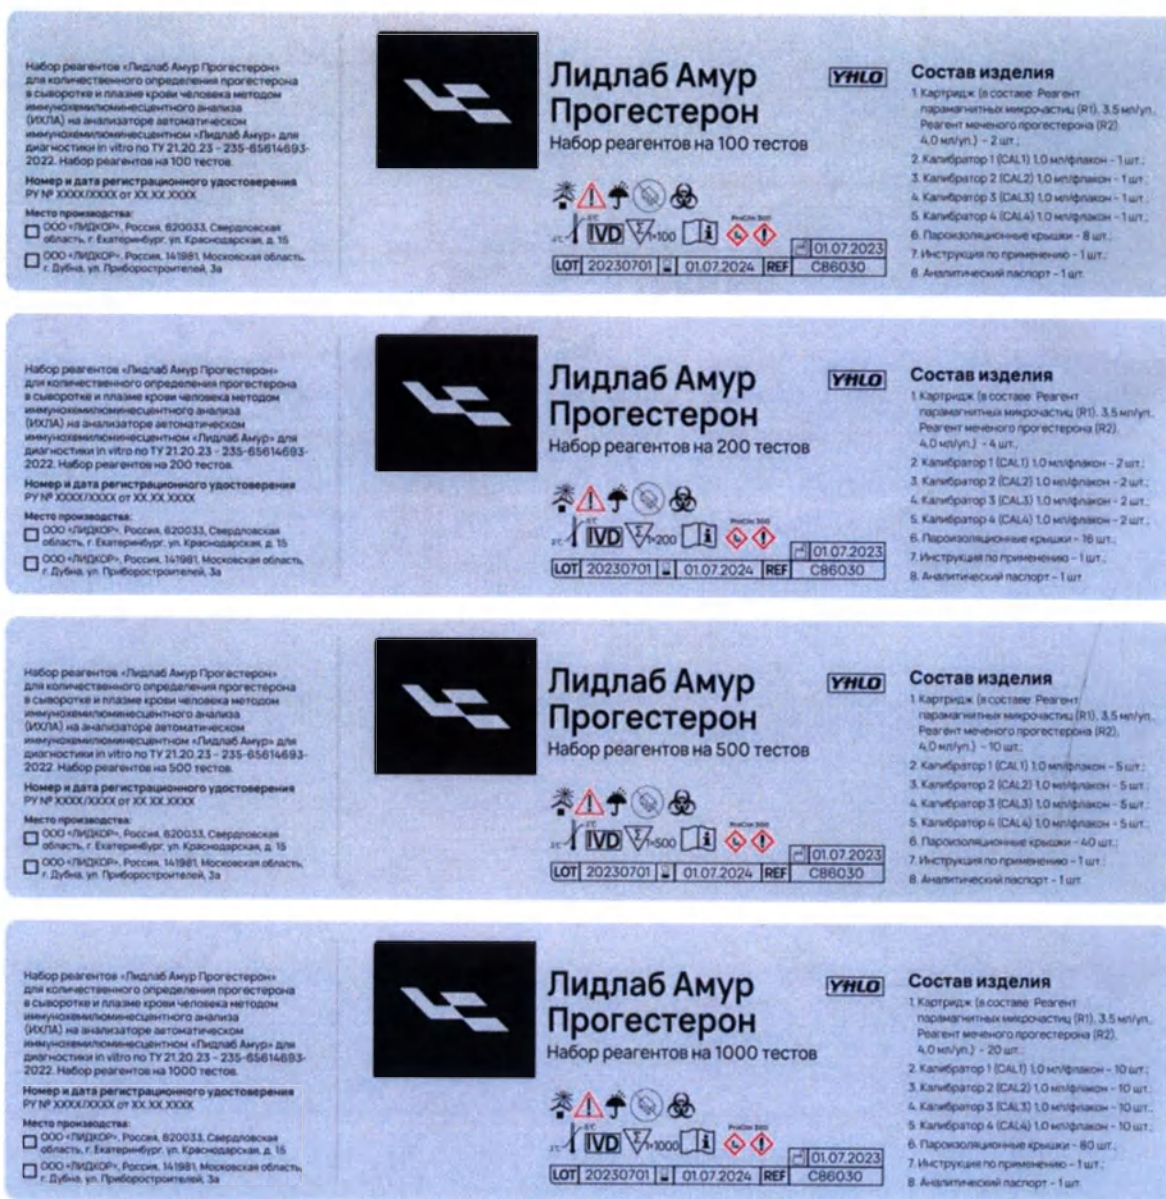

Потребительская коробка

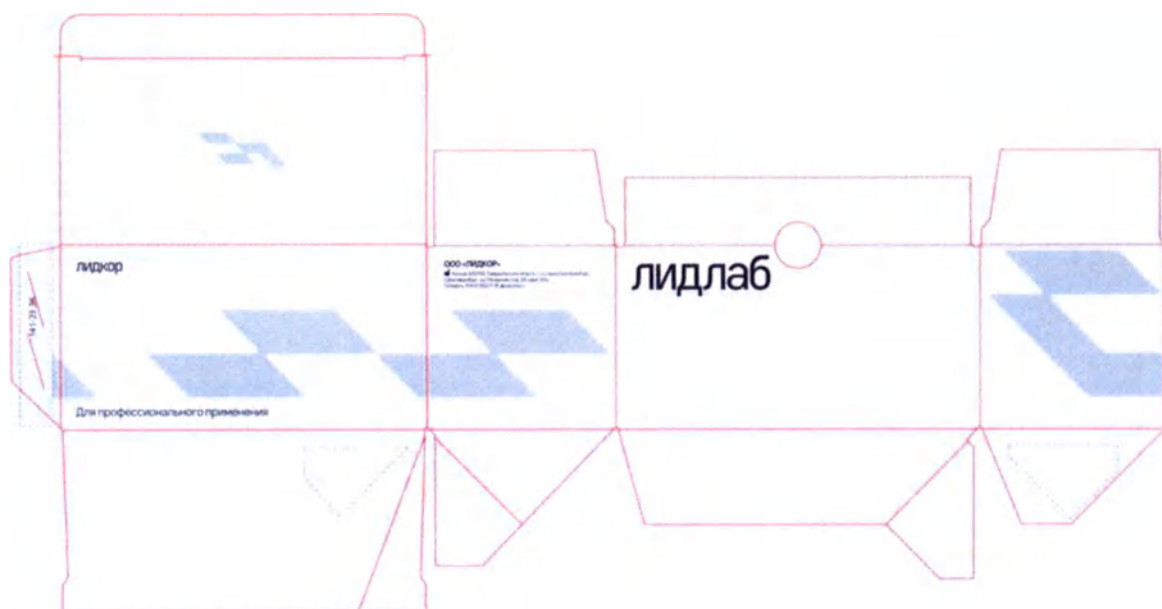

Транспортная упаковка

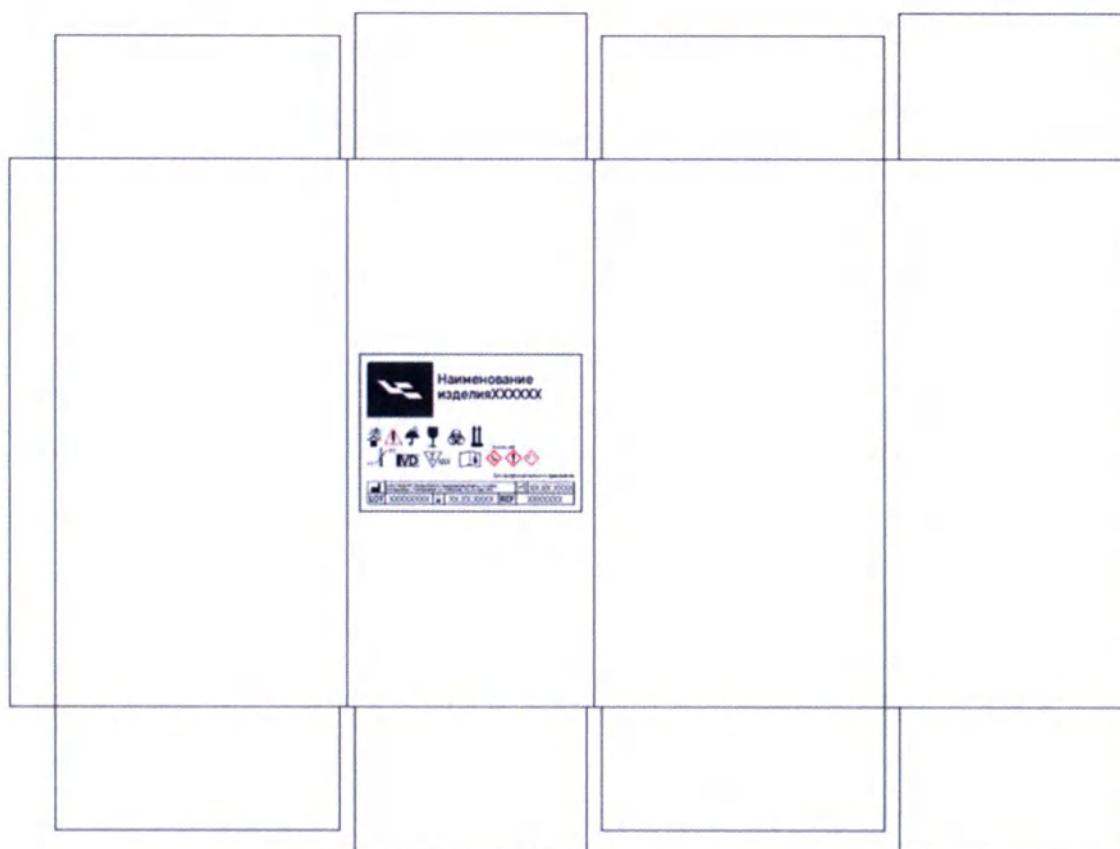

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ (Инициалы) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»
_____/Е. Ю. Гохгут/