

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Томограф рентгеновский компьютерный

(Neusoft Medical Systems Co., Ltd («Неусофт Медикал Системс Ко., Лтд»), Китай)

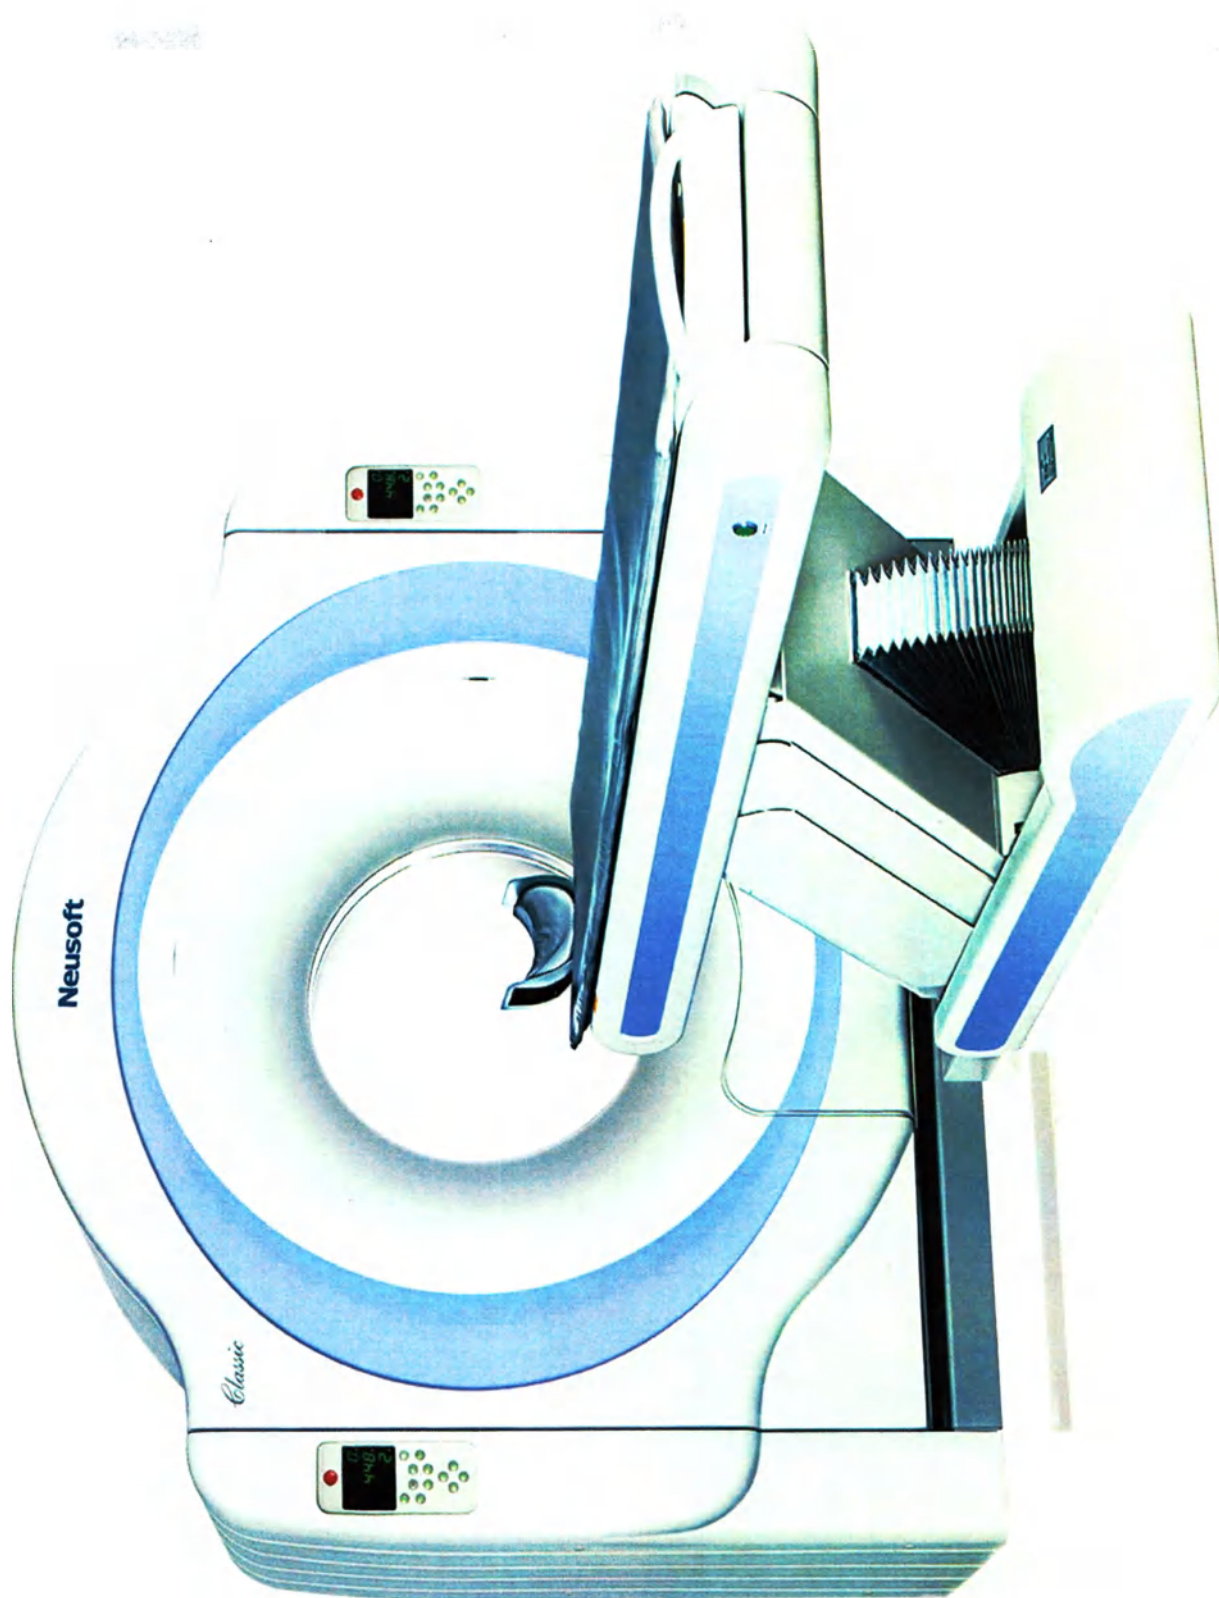


Рисунок 1 - Томограф рентгеновский компьютерный NeuViz 16 Classic. Общий вид гентри и стола пациента

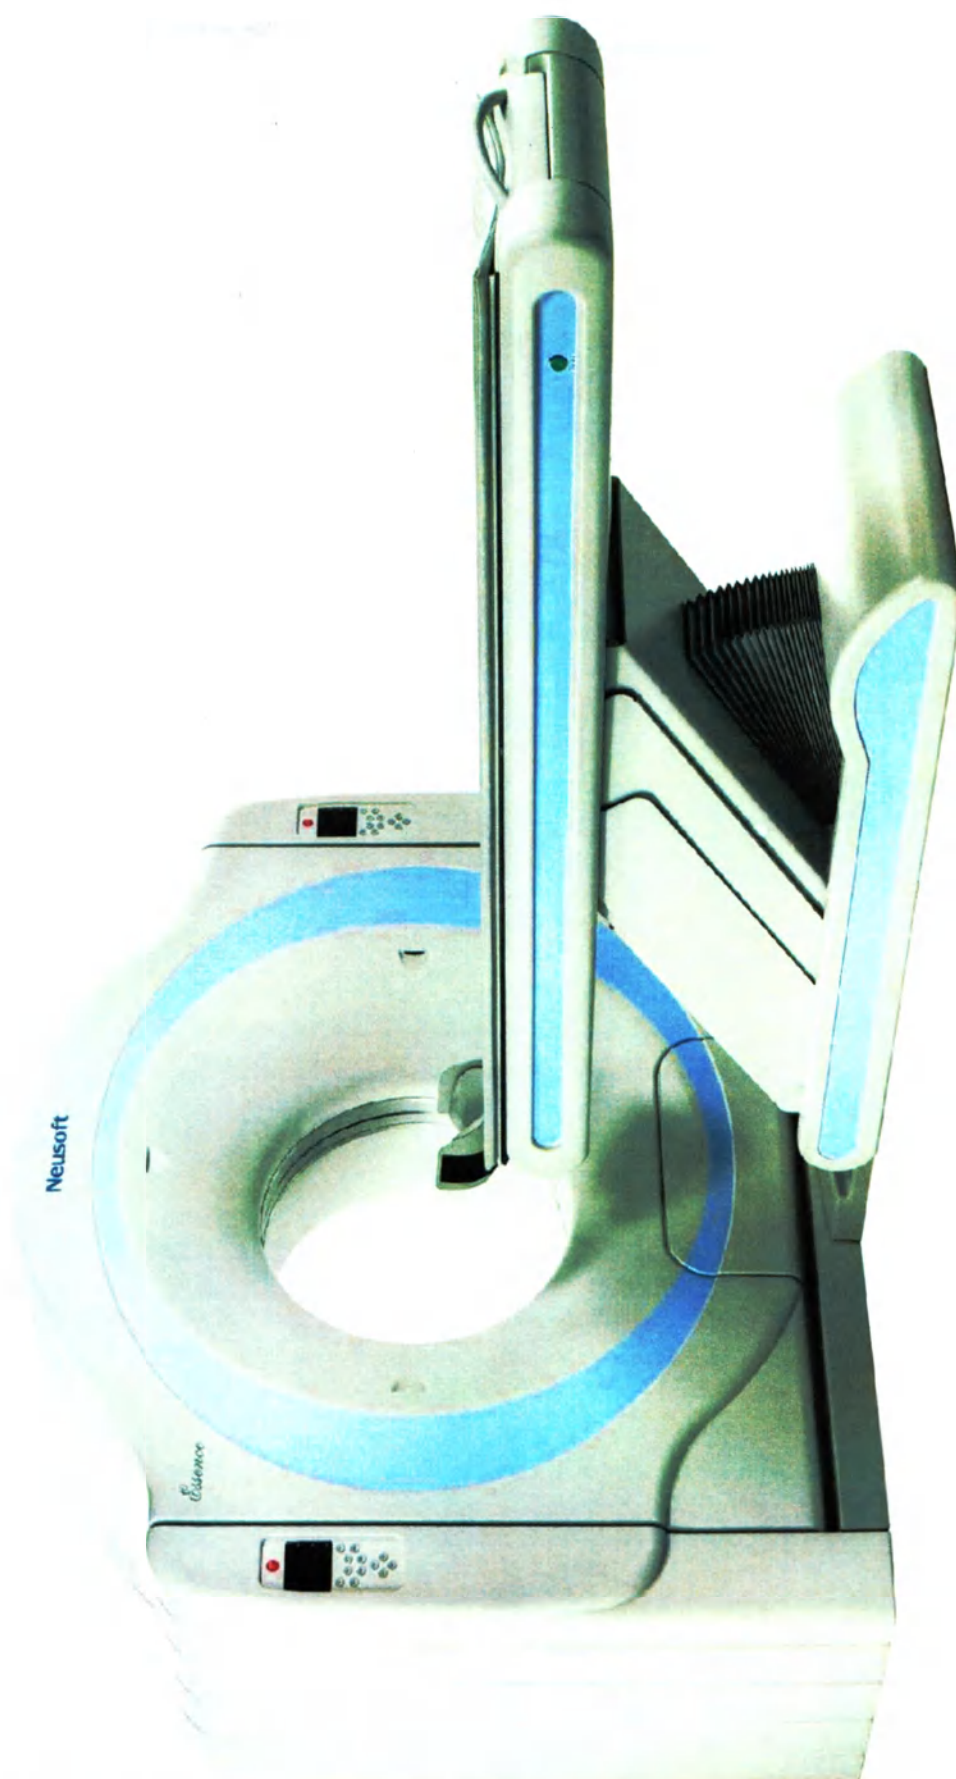


Рисунок 2 - Томограф рентгеновский компьютерный NeuViz 16 Essence с рентгеновским излучателем CTR2150CEPN и Томограф рентгеновский компьютерный NeuViz 16 Essence с рентгеновским излучателем GS-5179 (данные варианты исполнения не отличаются внешне). Общий вид гентри и стола пациента

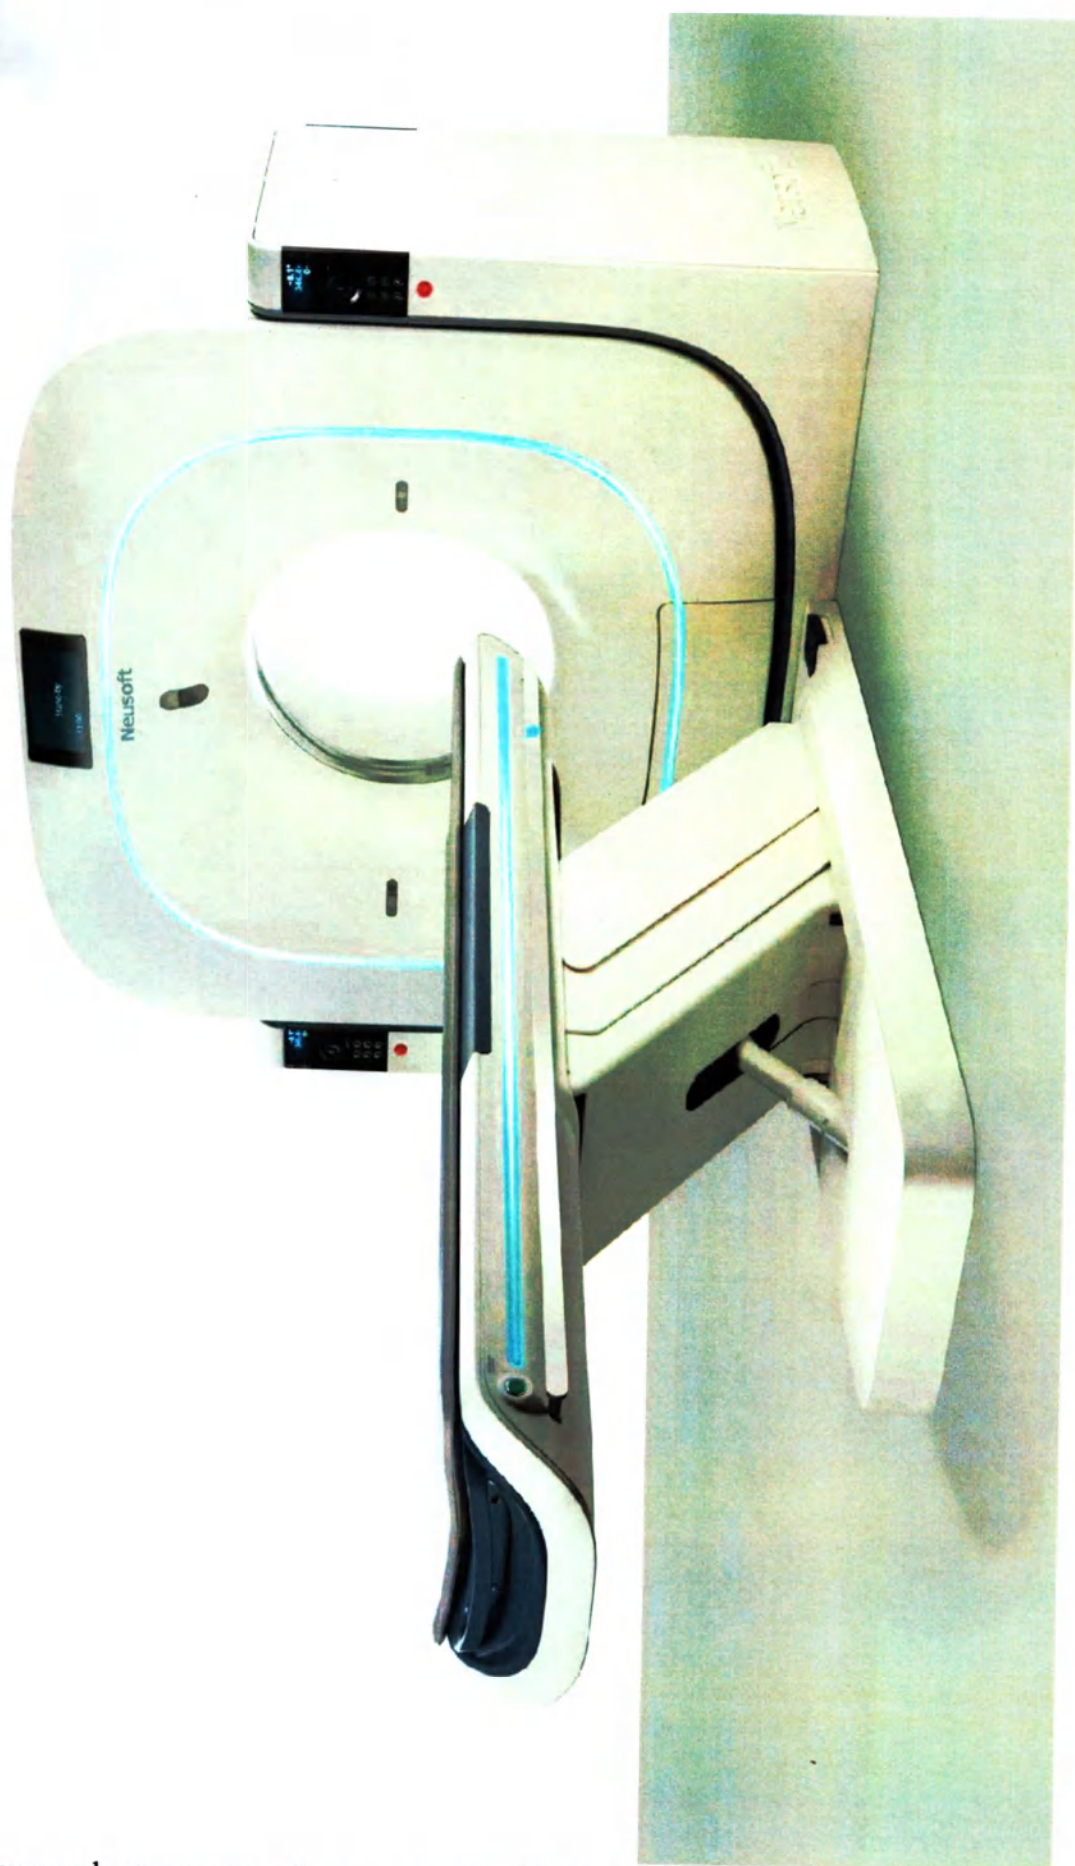


Рисунок 3 - Томограф рентгеновский компьютерный NeuViz Prime. Общий вид гентри и стола пациента.

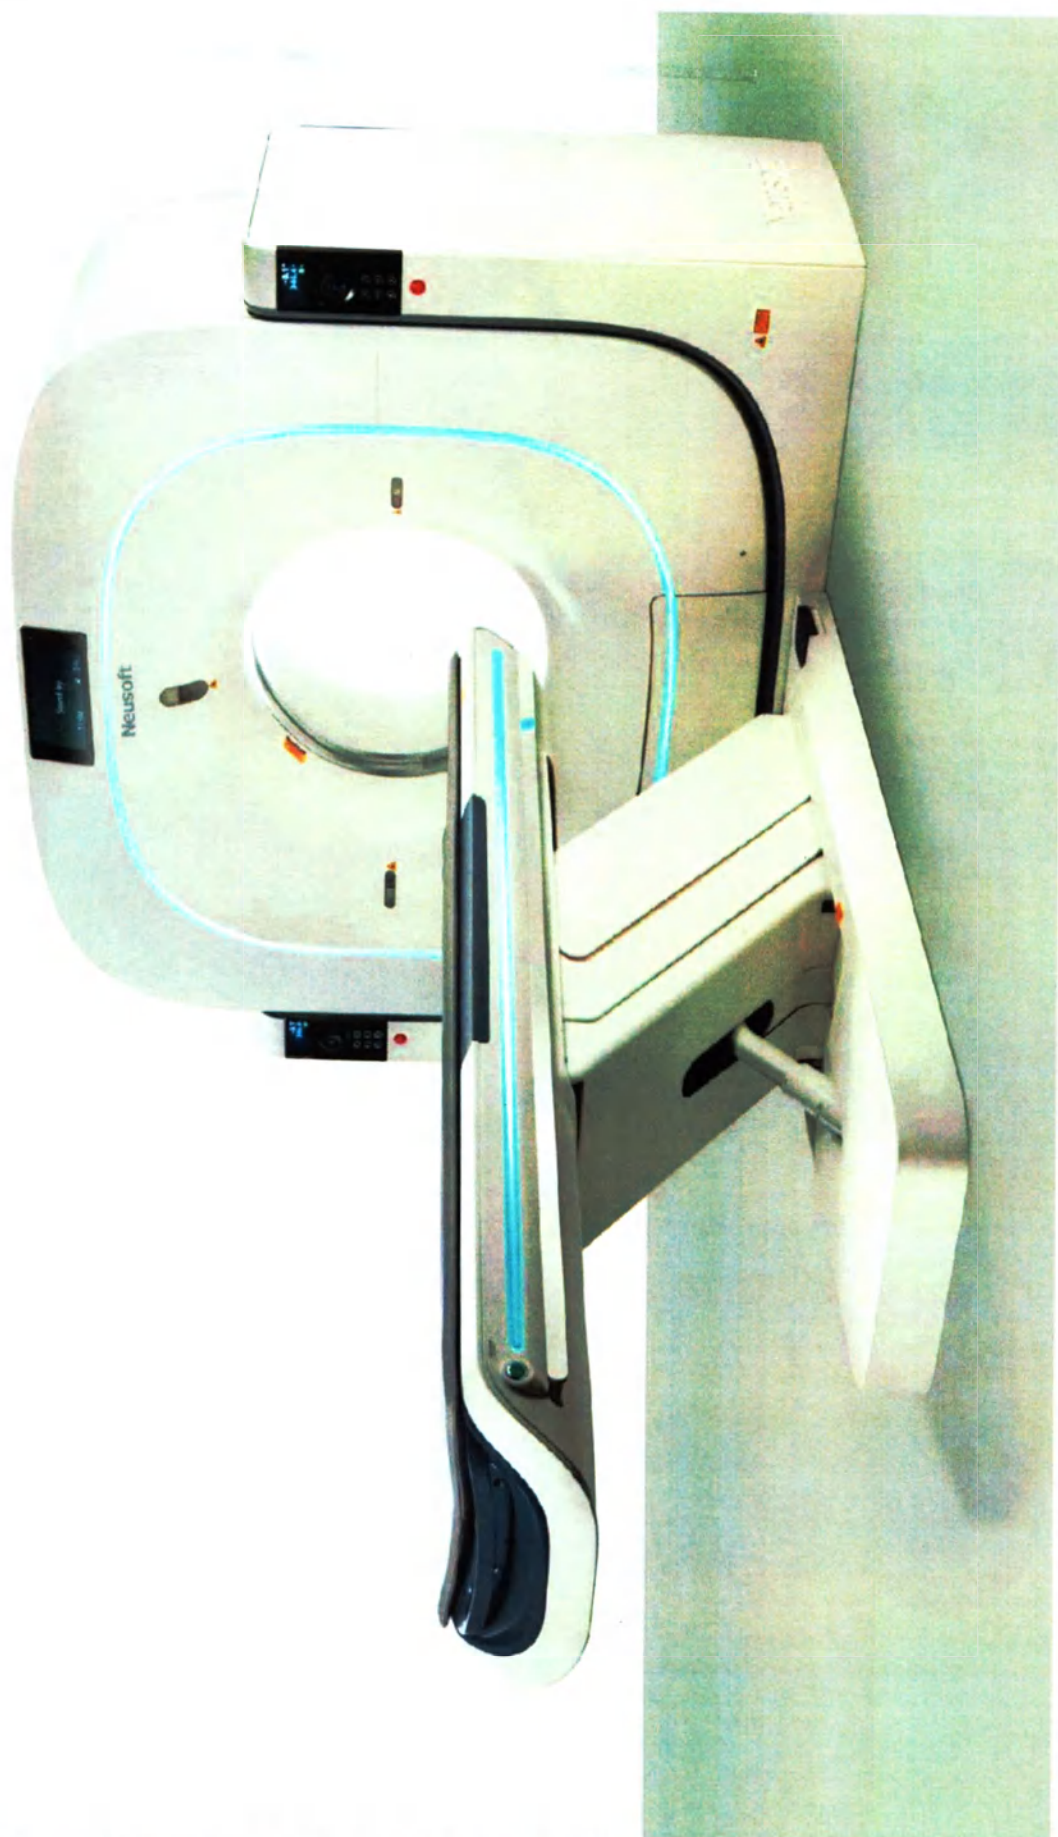


Рисунок 4 - Томограф рентгеновский компьютерный NeuViz 64 In. Общий вид гентри и стола пациента

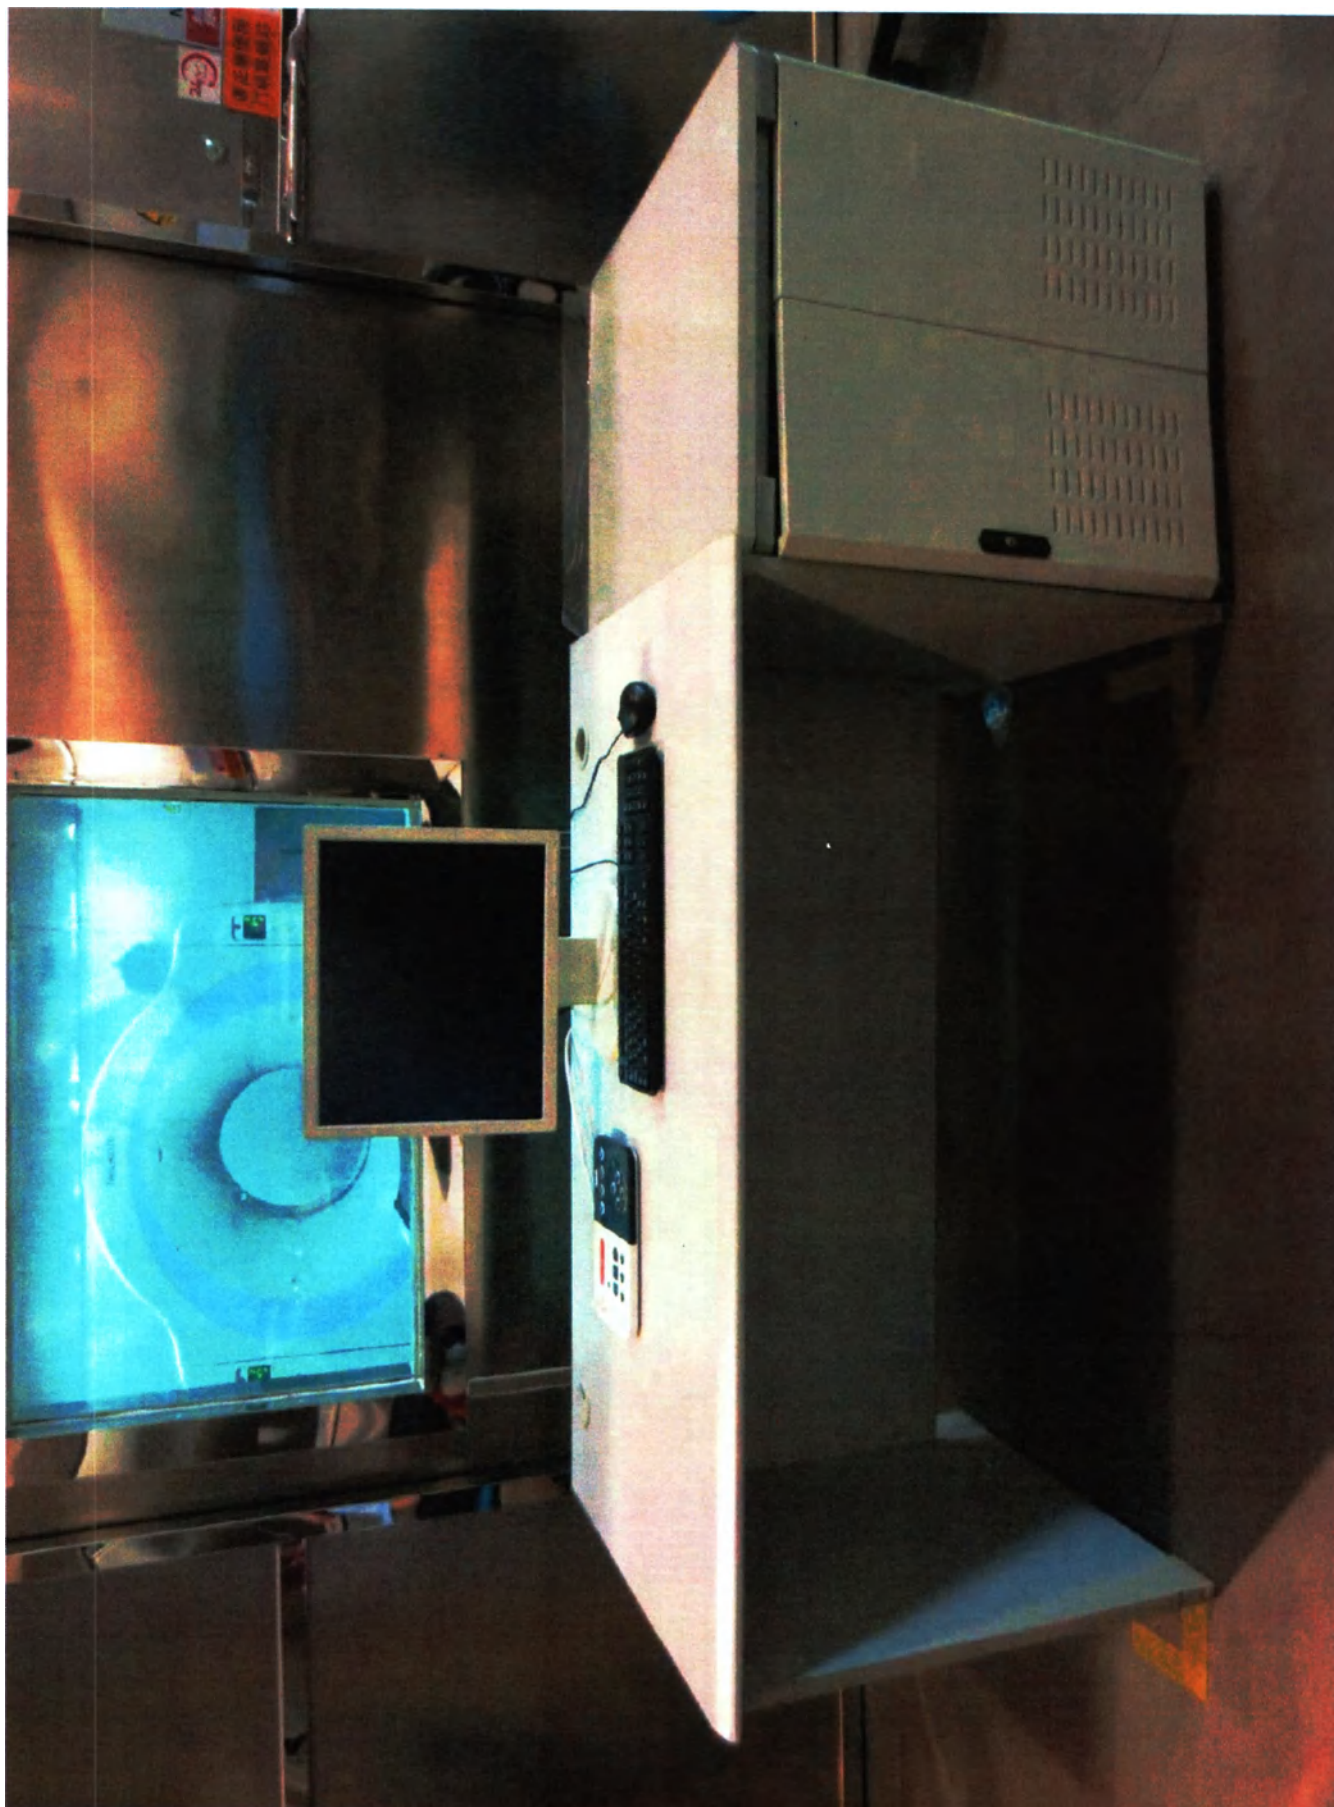


Рисунок 5 – Общий вид консоли оператора (Монитор, шкаф консольный с реконструкционным и консольным компьютерами, стол, клавиатура, мышь)



Рисунок 6 – Консоль оператора. СТ-BOX 1. Общий вид



Рисунок 7 – Консоль оператора. СТ-BOX 2. Общий вид



Рисунок 8 – Консоль оператора. Монитор. Общий вид

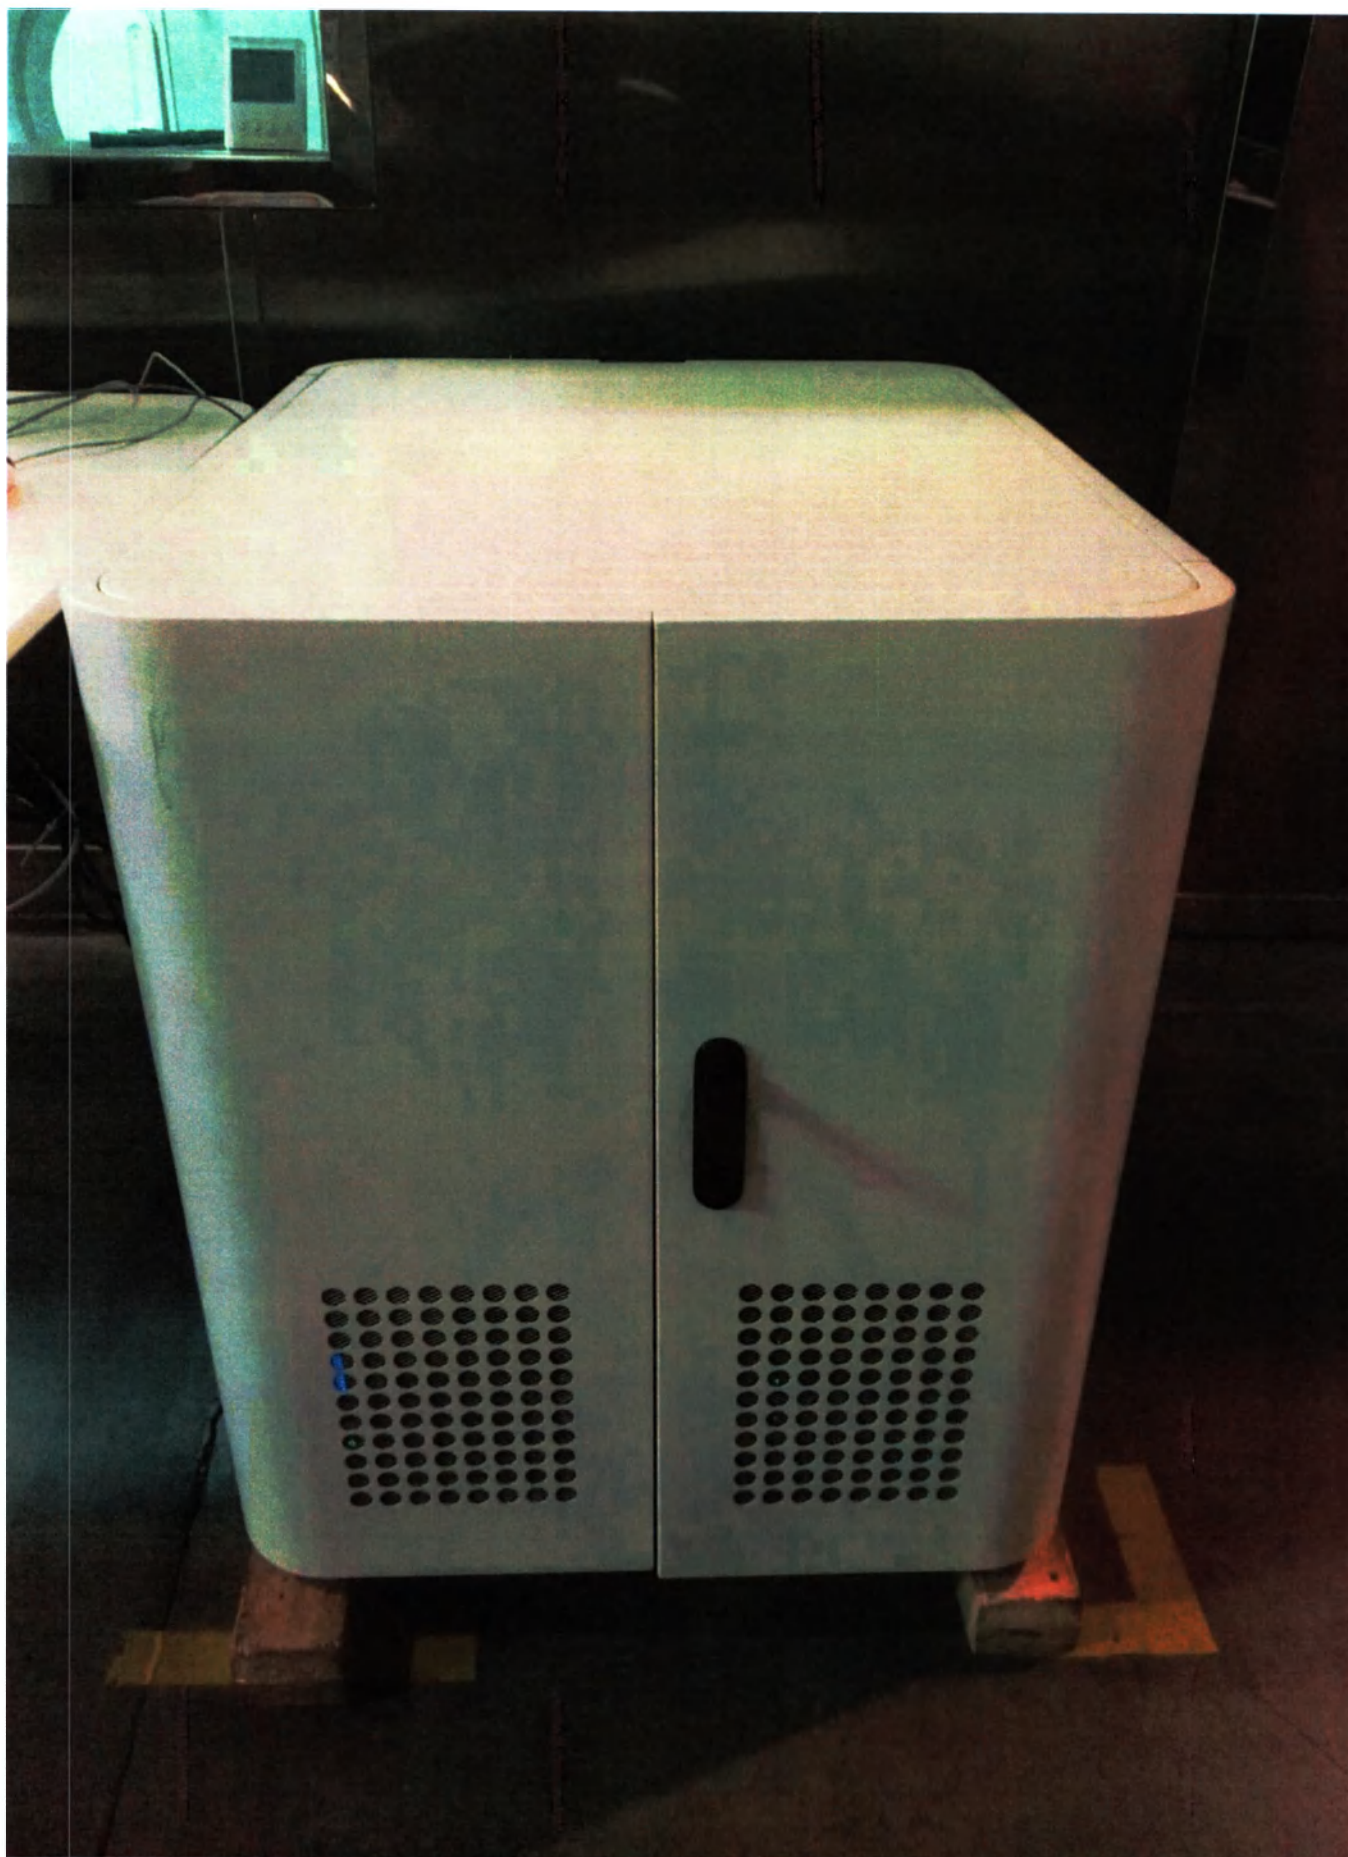


Рисунок 9 – Консоль оператора. Шкаф консольный 1 и 2. Общий вид



Рисунок 10 – Консоль оператора. Консольный шкаф 3. Общий вид

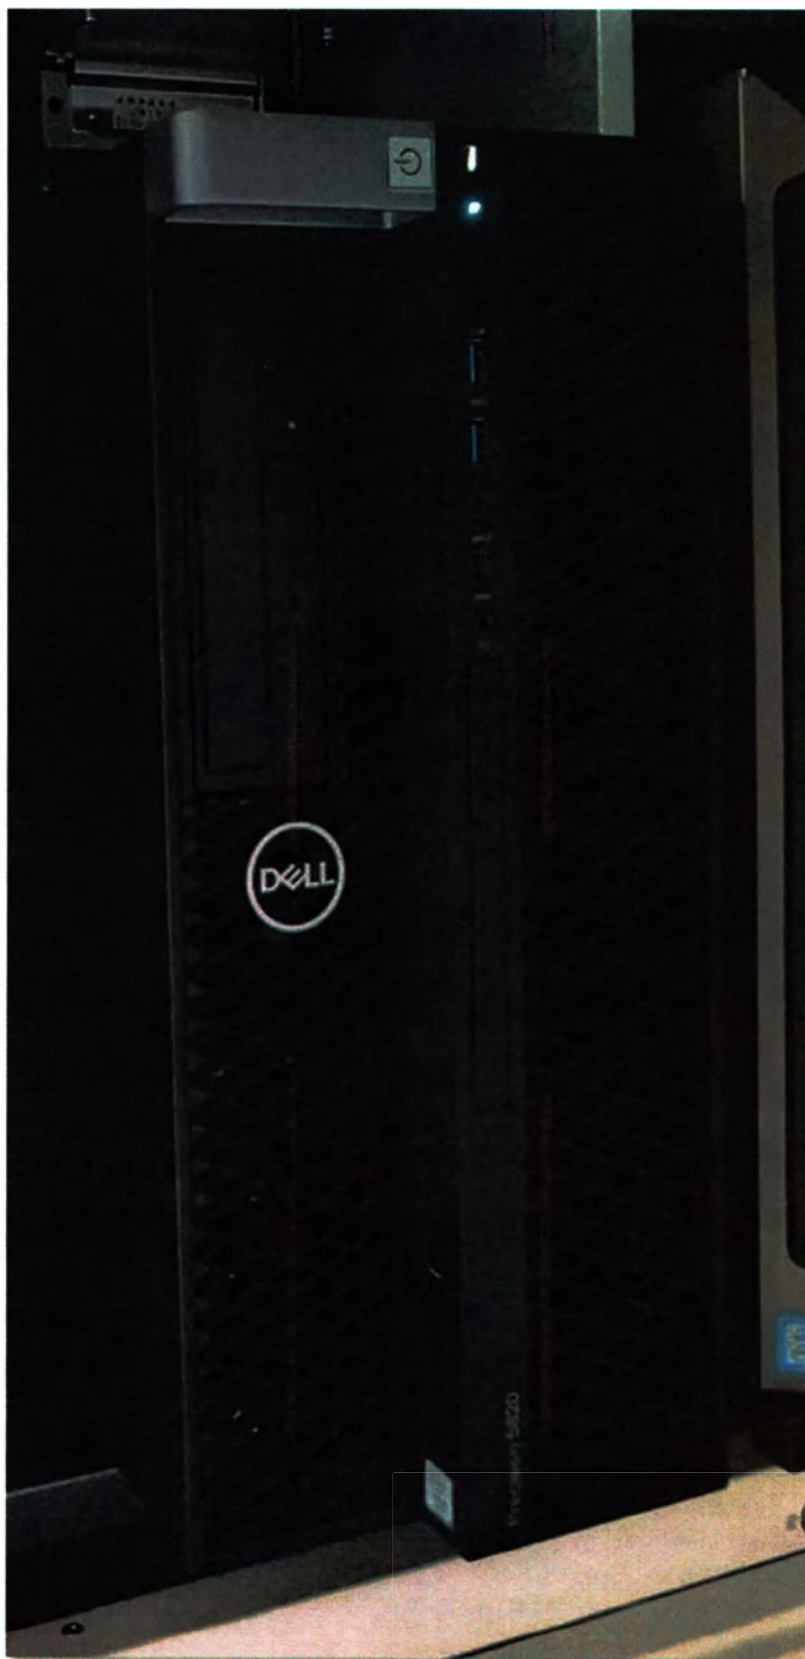


Рисунок 11 – Консоль оператора. Компьютер консольный. Общий вид



Рисунок 12 – Консоль оператора. Компьютер реконструкционный. Общий вид



Рисунок 13 – Консоль оператора. Клавиатура. Общий вид

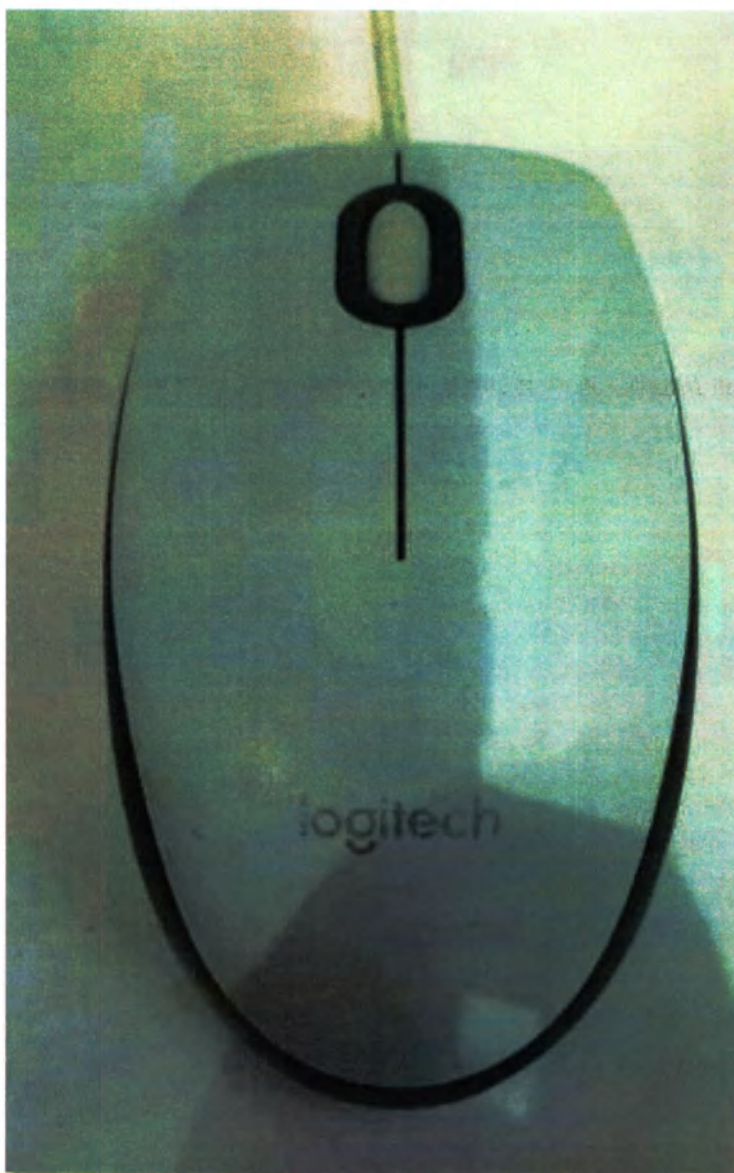


Рисунок 14 – Консоль оператора. Мышь. Общий вид



Рисунок 15 – Станция рабочая врача Advanced Visualization Workspace. Монитор врача. Общий вид

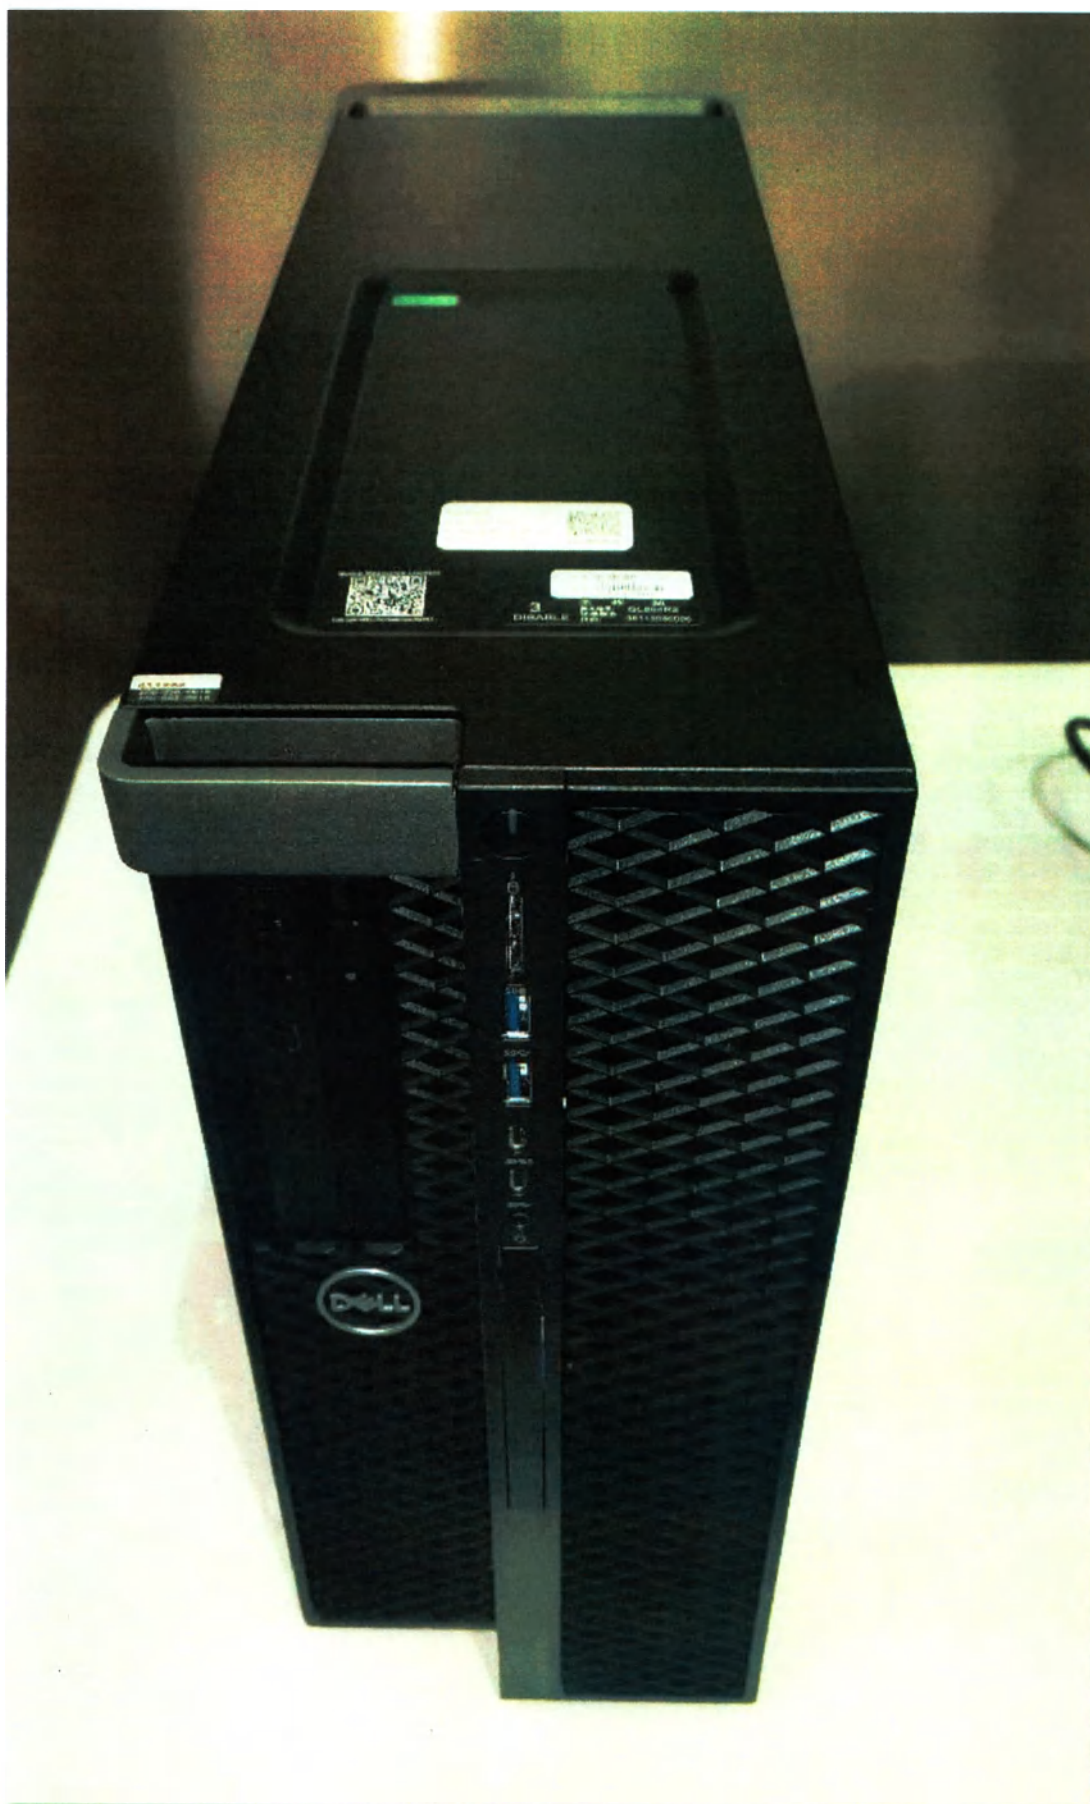


Рисунок 16 – Станция рабочая врача Advanced Visualization Workspace. Процессор. Общий вид



Рисунок 17 – Станция рабочая врача Advanced Visualization Workspace. Клавиатура. Общий вид



Рисунок 18 – Станция рабочая врача Advanced Visualization Workspace. Мышь. Общий вид

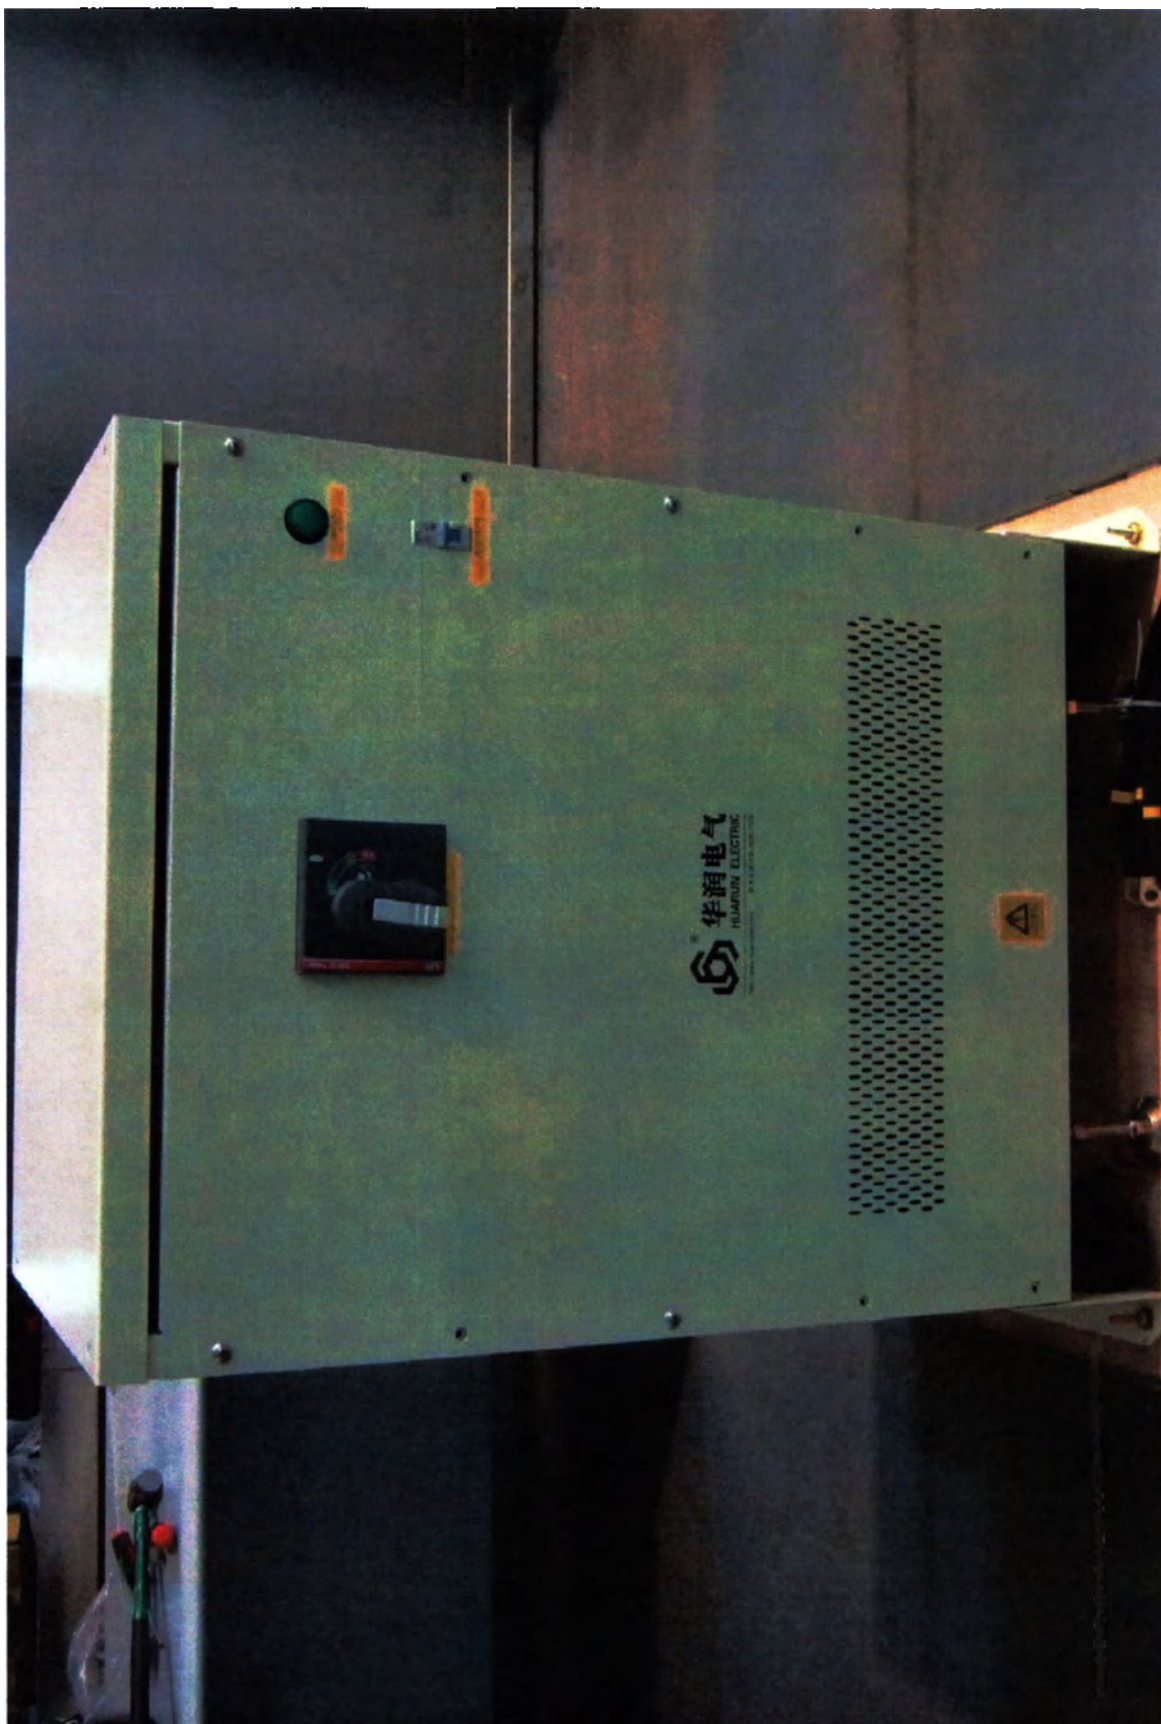


Рисунок 19 – Трансформатор разделительный 1 и 2. Общий вид



Рисунок 20 – Источник бесперебойного питания 1 для консоли оператора



Рисунок 21 – Источник бесперебойного питания 2 для консоли оператора (источник бесперебойного питания 3 для консоли оператора имеет аналогичный вид)



Рисунок 22 – Монитор передвижной. Общий вид

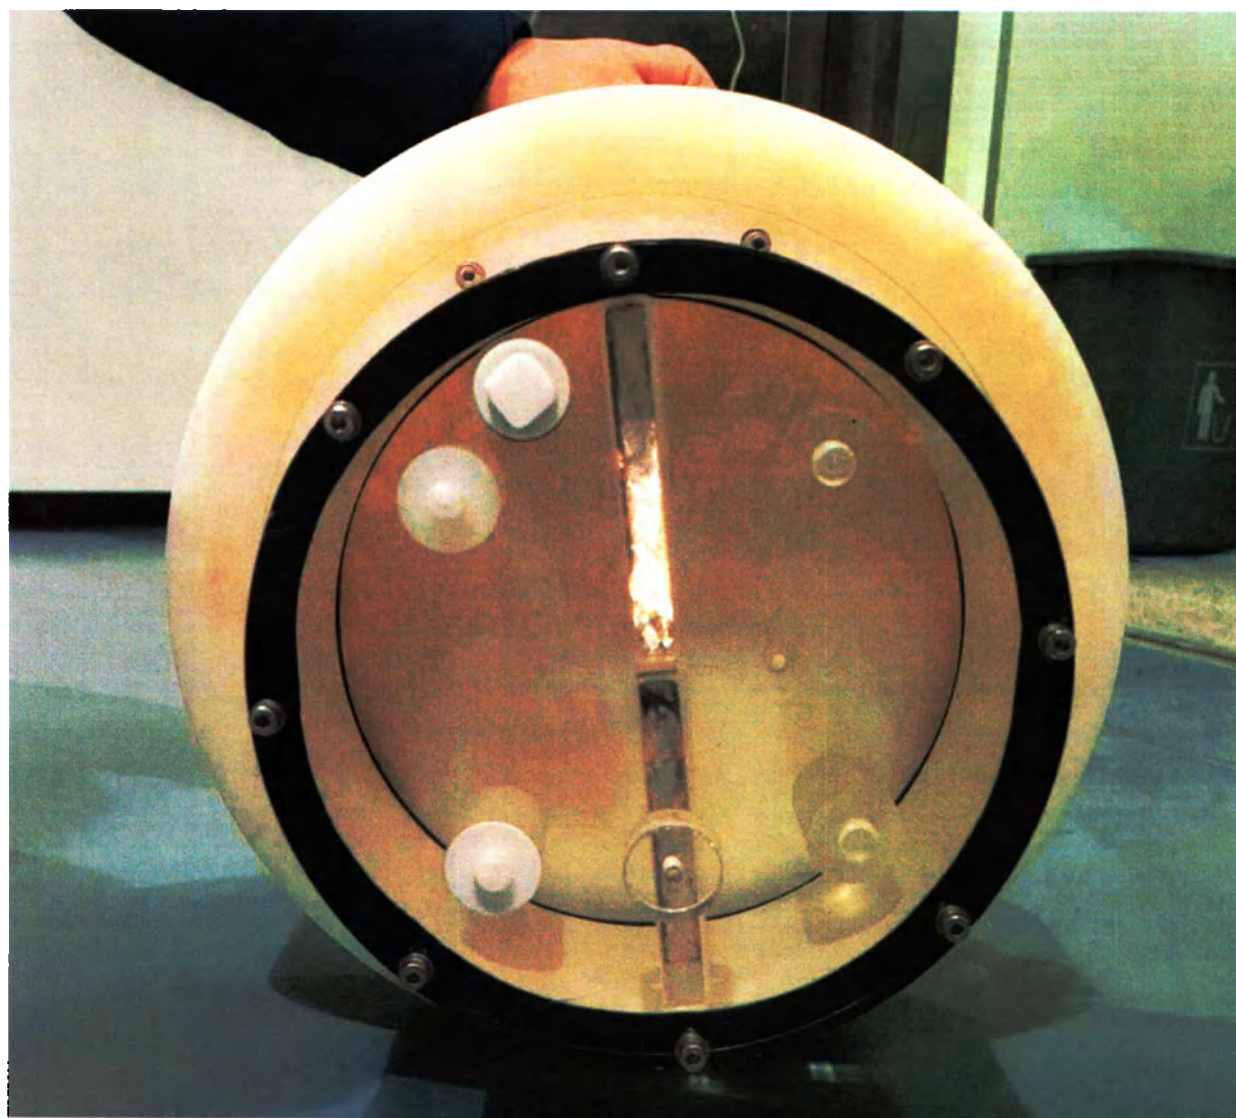


Рисунок 23 – Фантом QA. Общий вид



Рисунок 24 – Подставка коронарная для подбородка. Общий вид

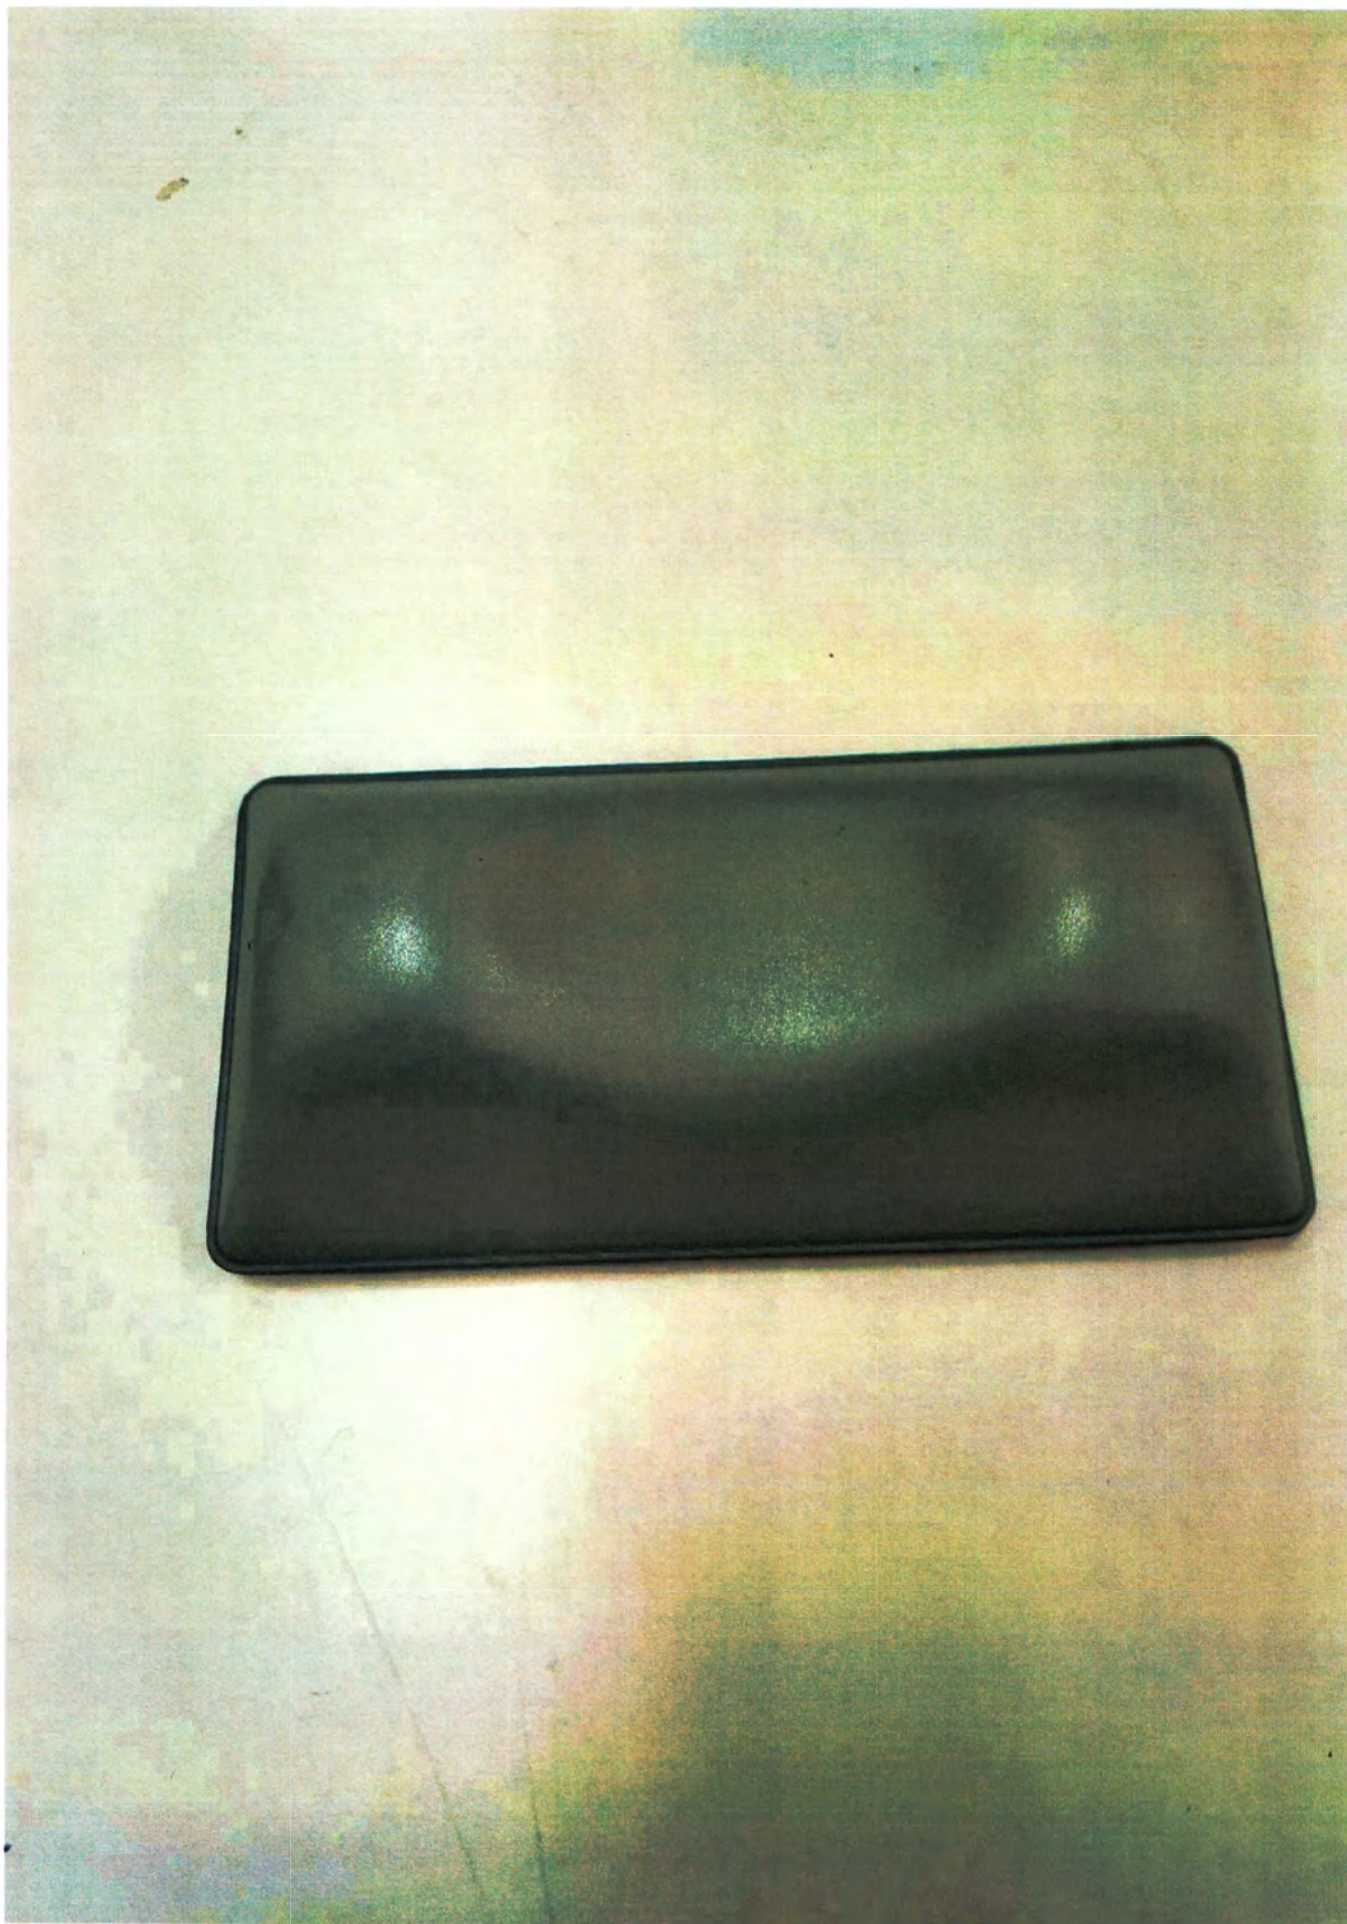
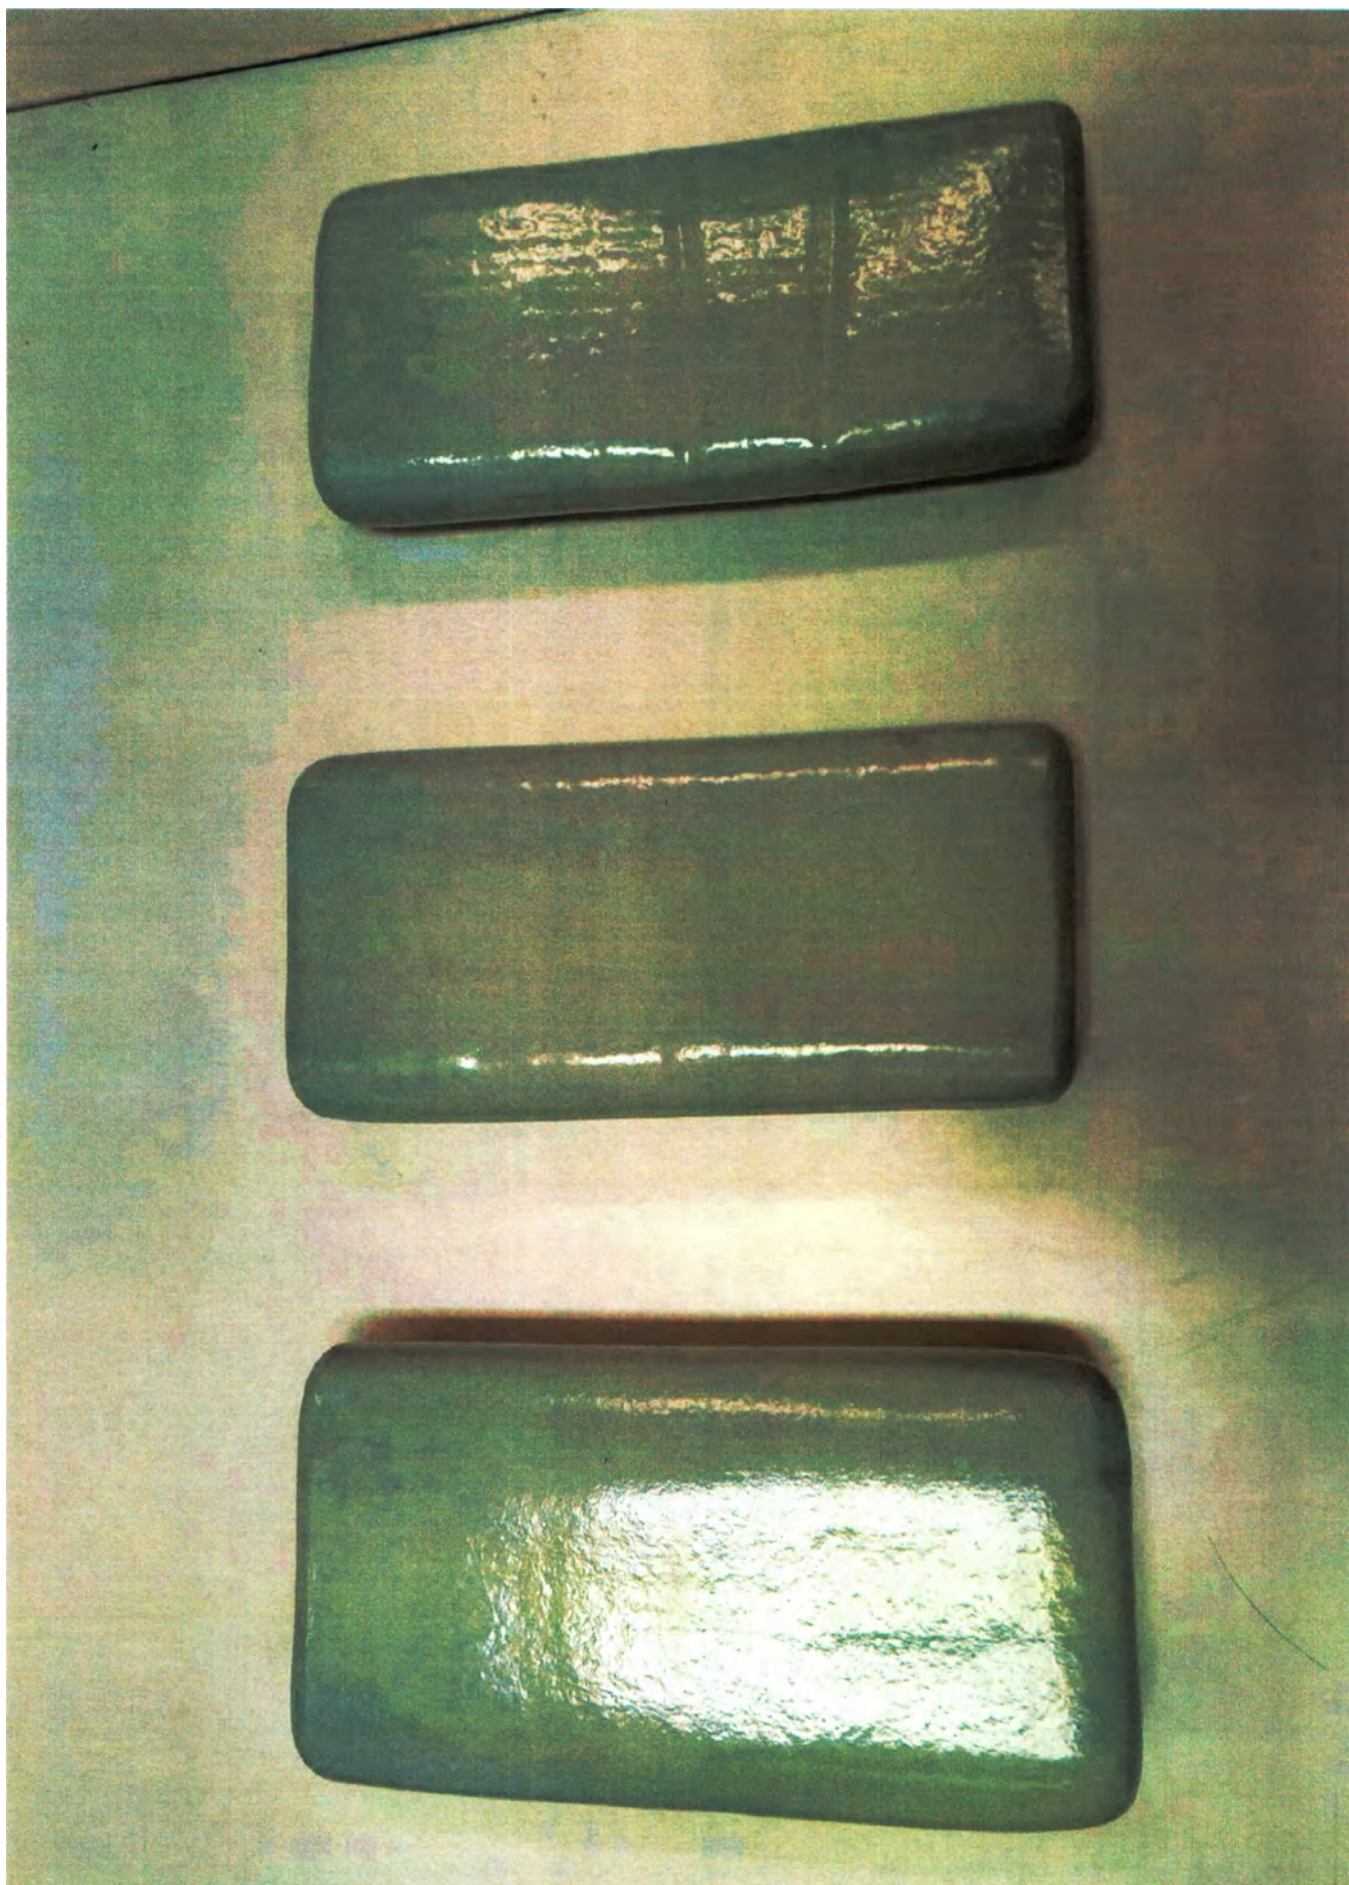


Рисунок 25 – Подушка под шею. Общий вид



**Рисунок 26 – Подушка боковая, снизу вверх: большой размер, средний размер и маленький размер.
Общий вид**



Рисунок 27 – Подушка для головы. Общий вид

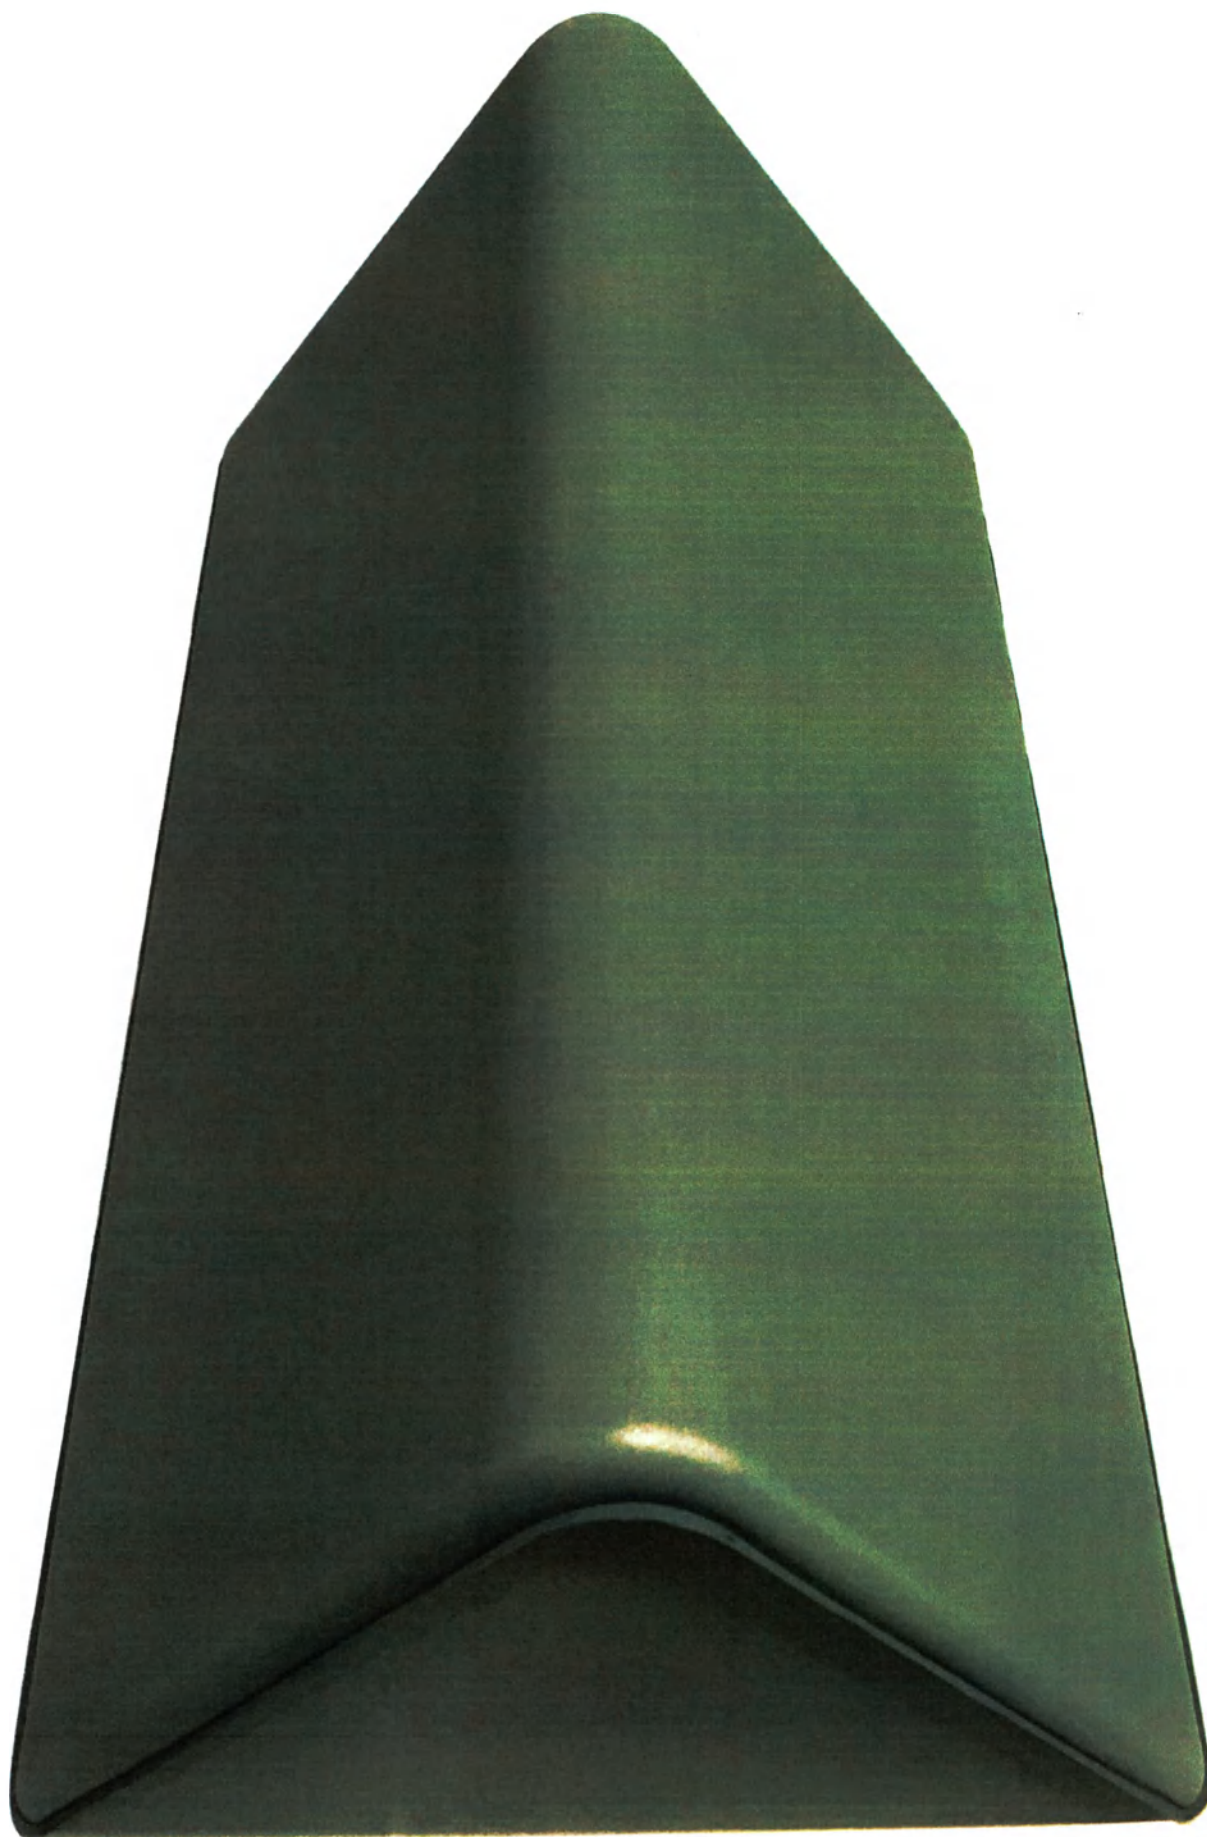


Рисунок 28 – Подушка для колен. Общий вид



Рисунок 29 – Подушка плоская для головы. Общий вид



Рисунок 30 – Подголовник. Общий вид



Рисунок 31 – Подголовник коронарный. Общий вид

стр. 32 из 47



Рисунок 32 – Подголовник плоский. Общий вид

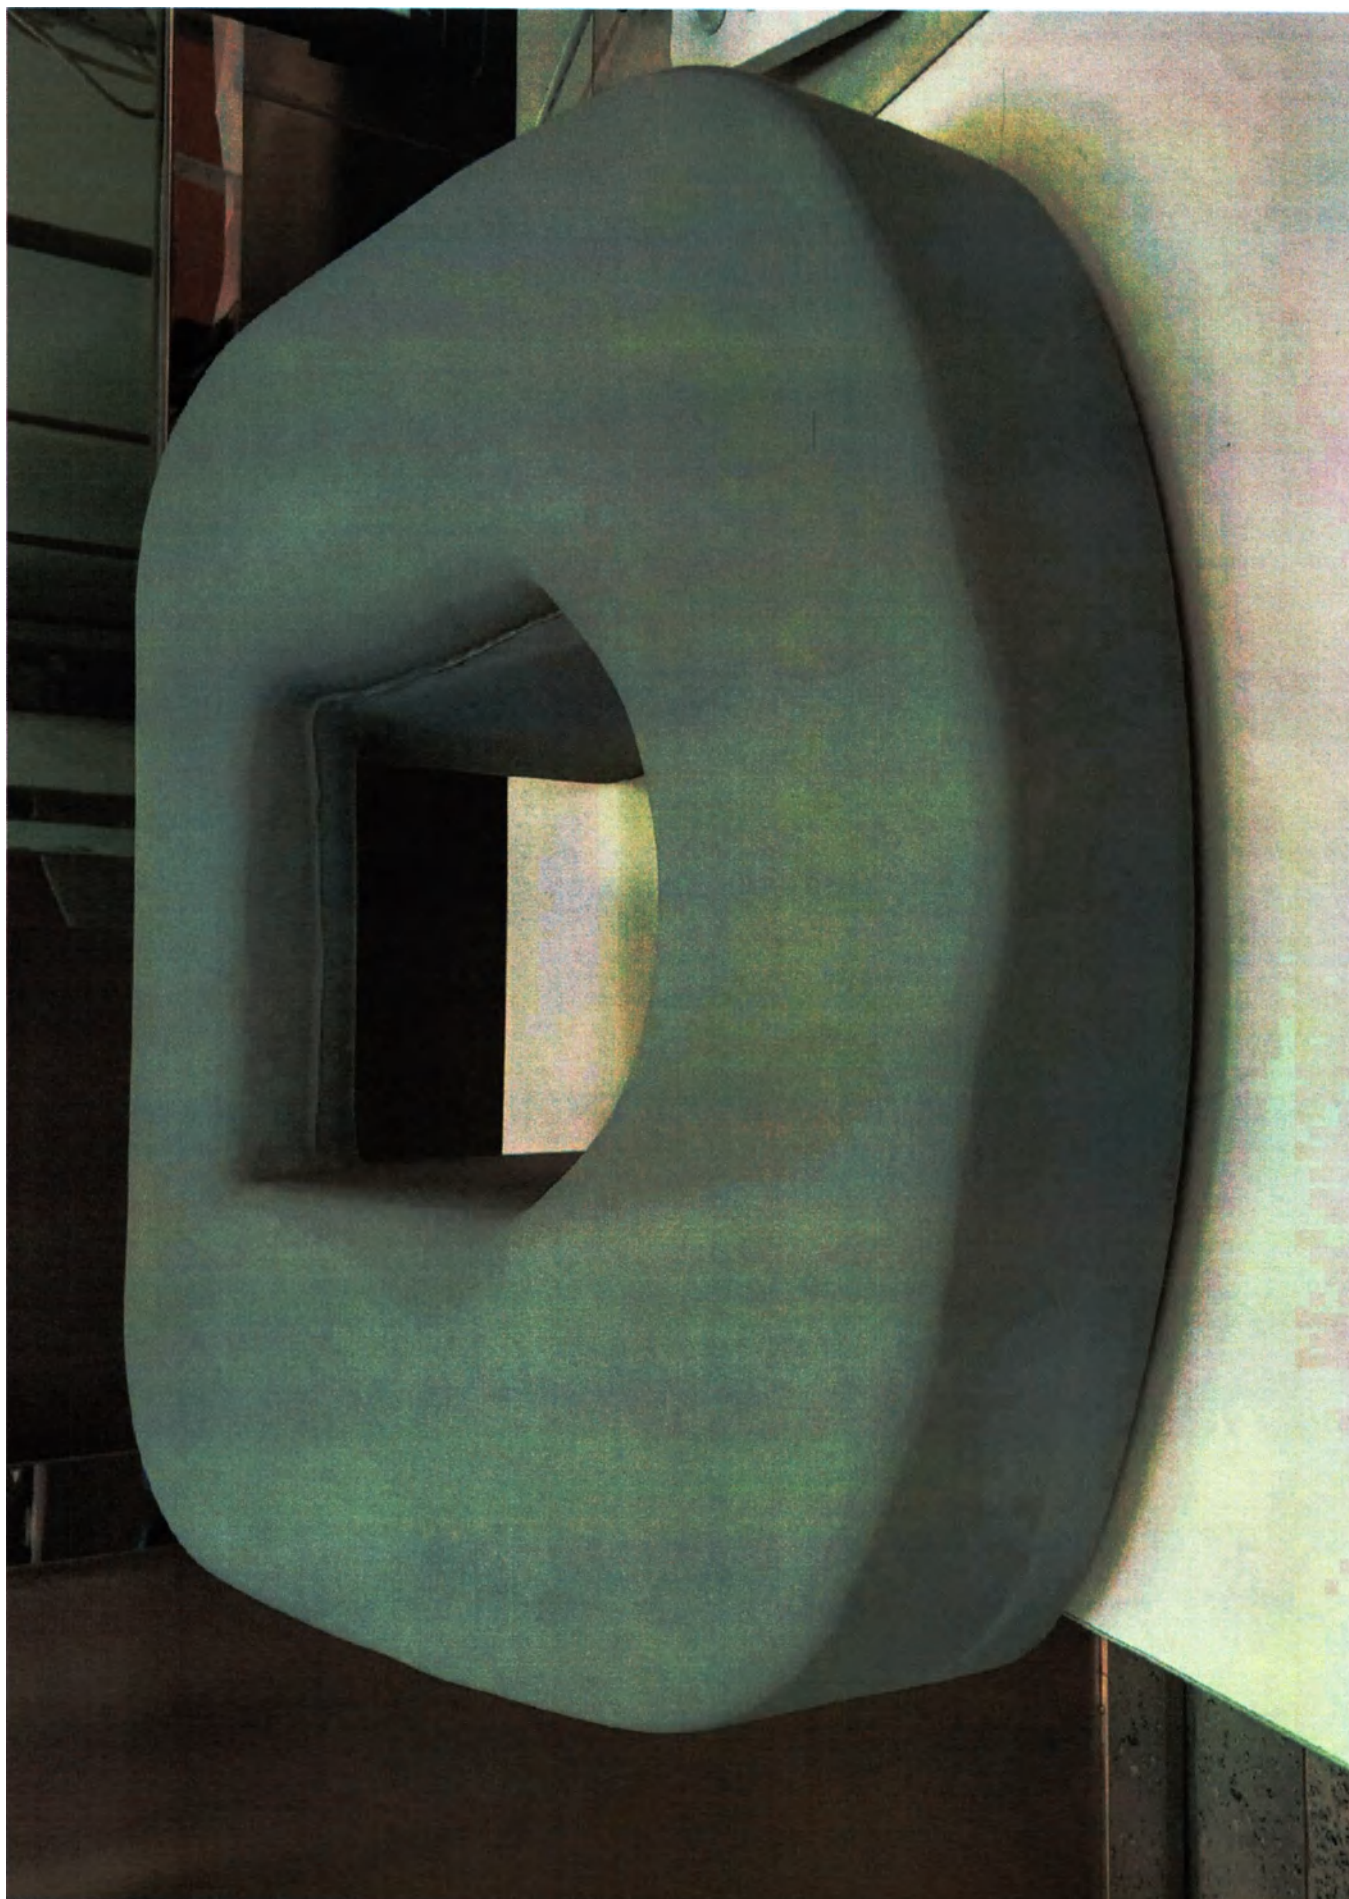


Рисунок 33 – Опора для головы и рук. Общий вид



**Рисунок 34 – Ремень для пациента всех вариантов исполнения (различаются только размером).
Общий вид**

стр. 35 из 47

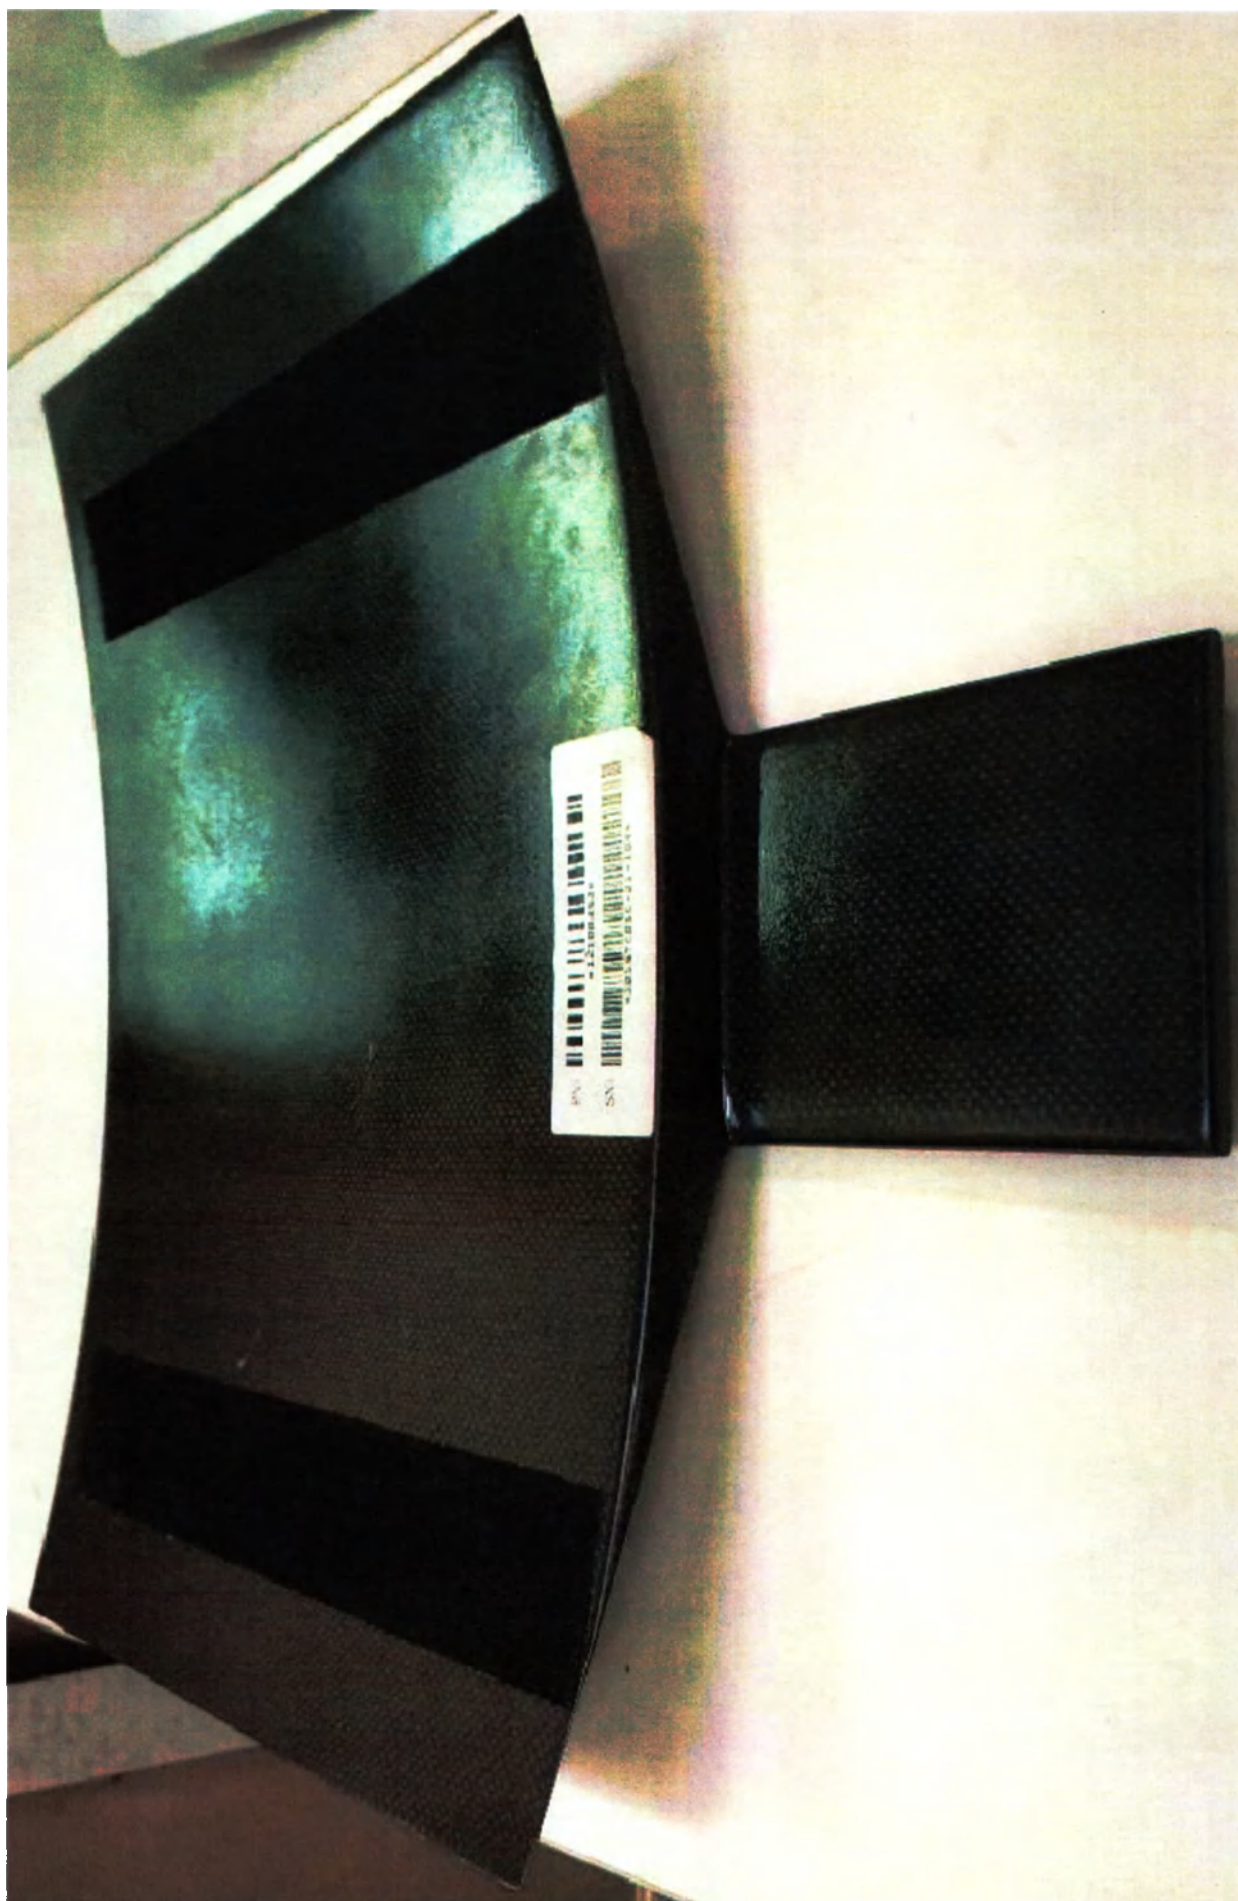


Рисунок 35 – Секция удлинительная для стола пациента. Общий вид

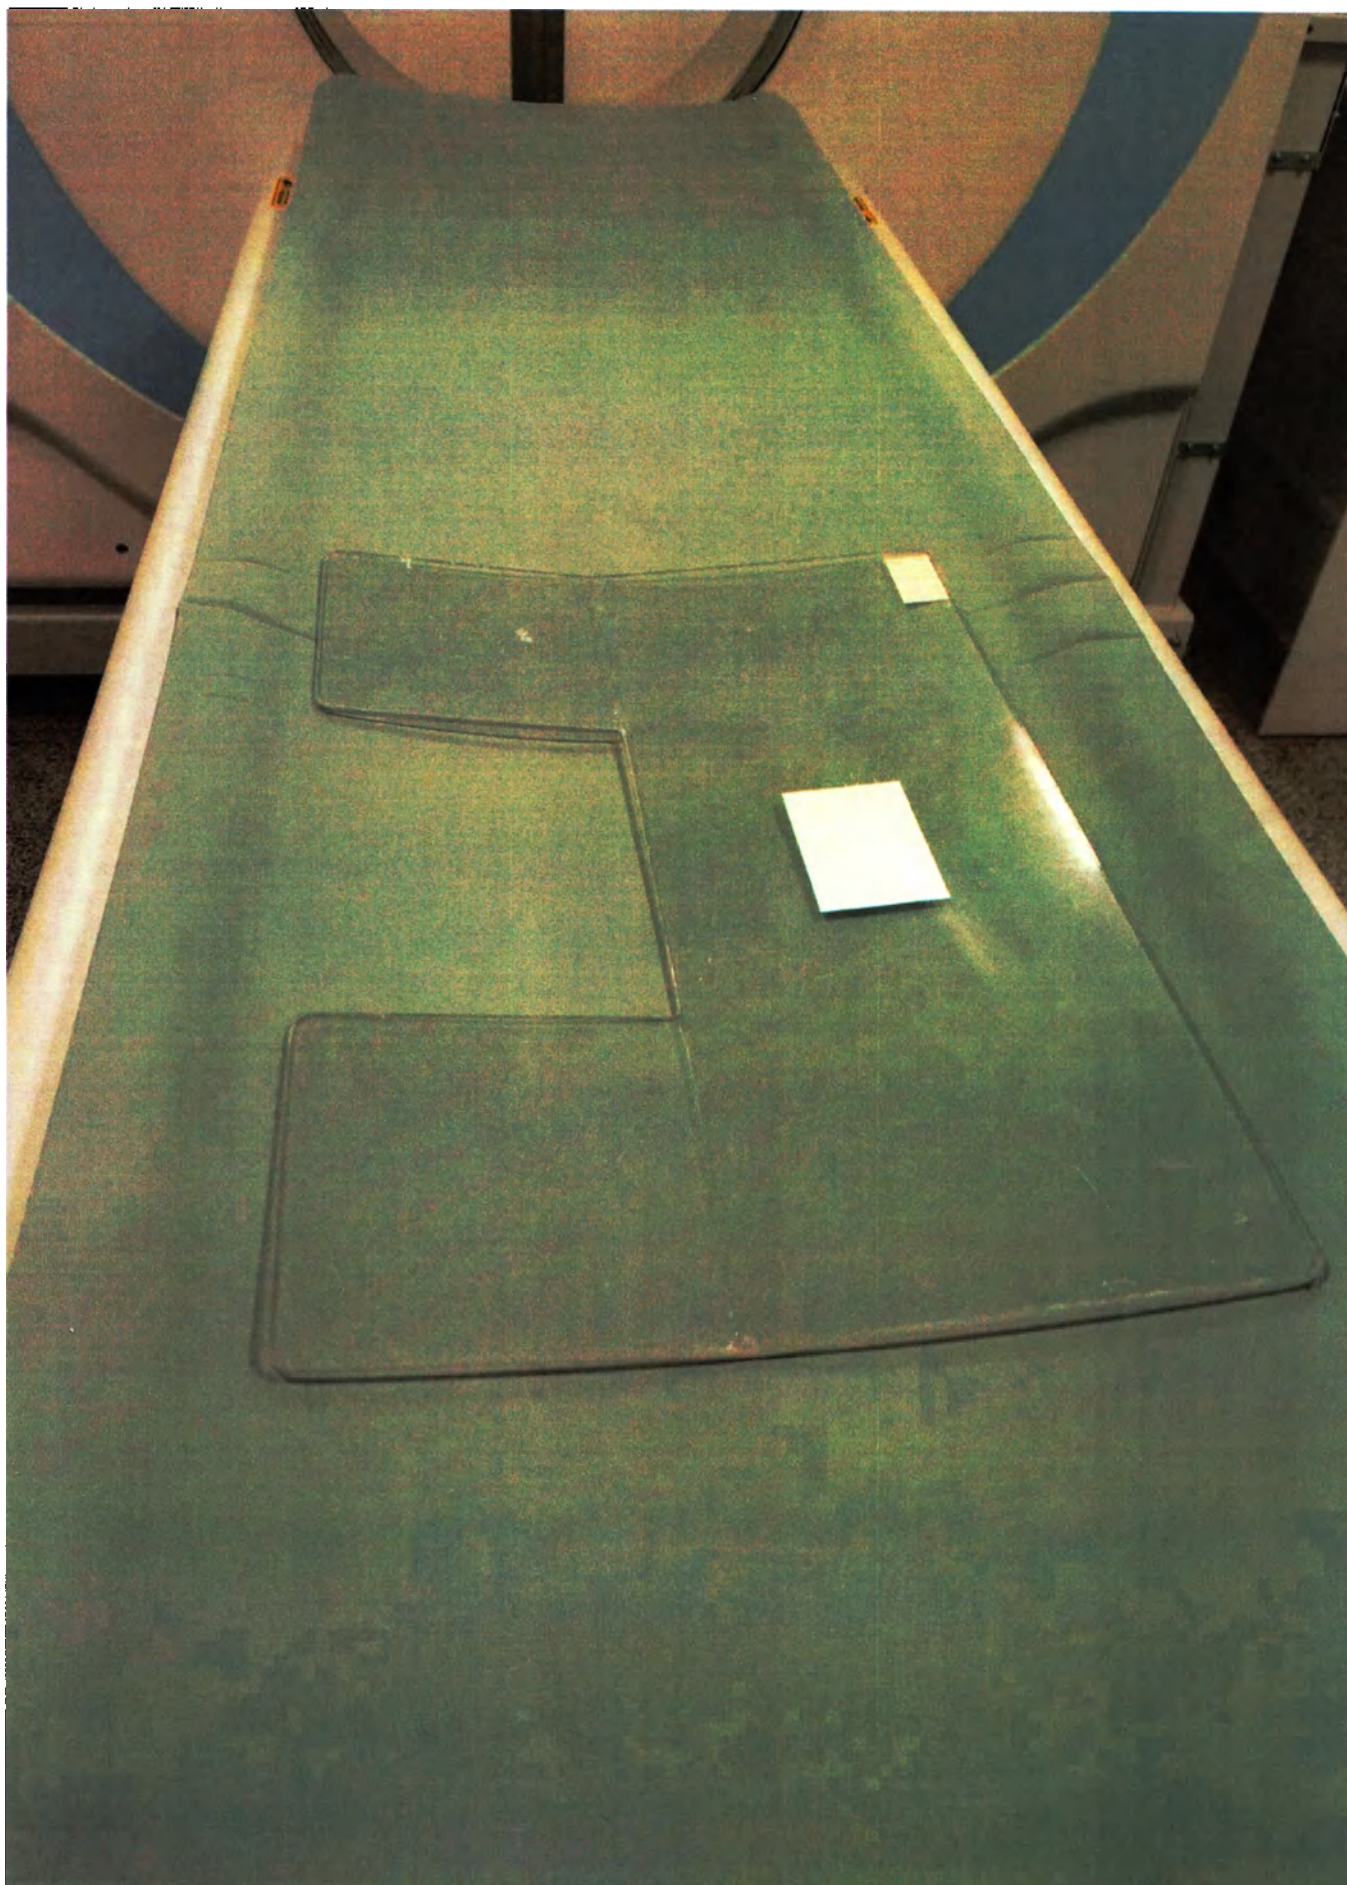


Рисунок 36 – Поддержка для руки при трансфузии. Общий вид



Рисунок 37 – Ручка деки стола пациента. Общий вид

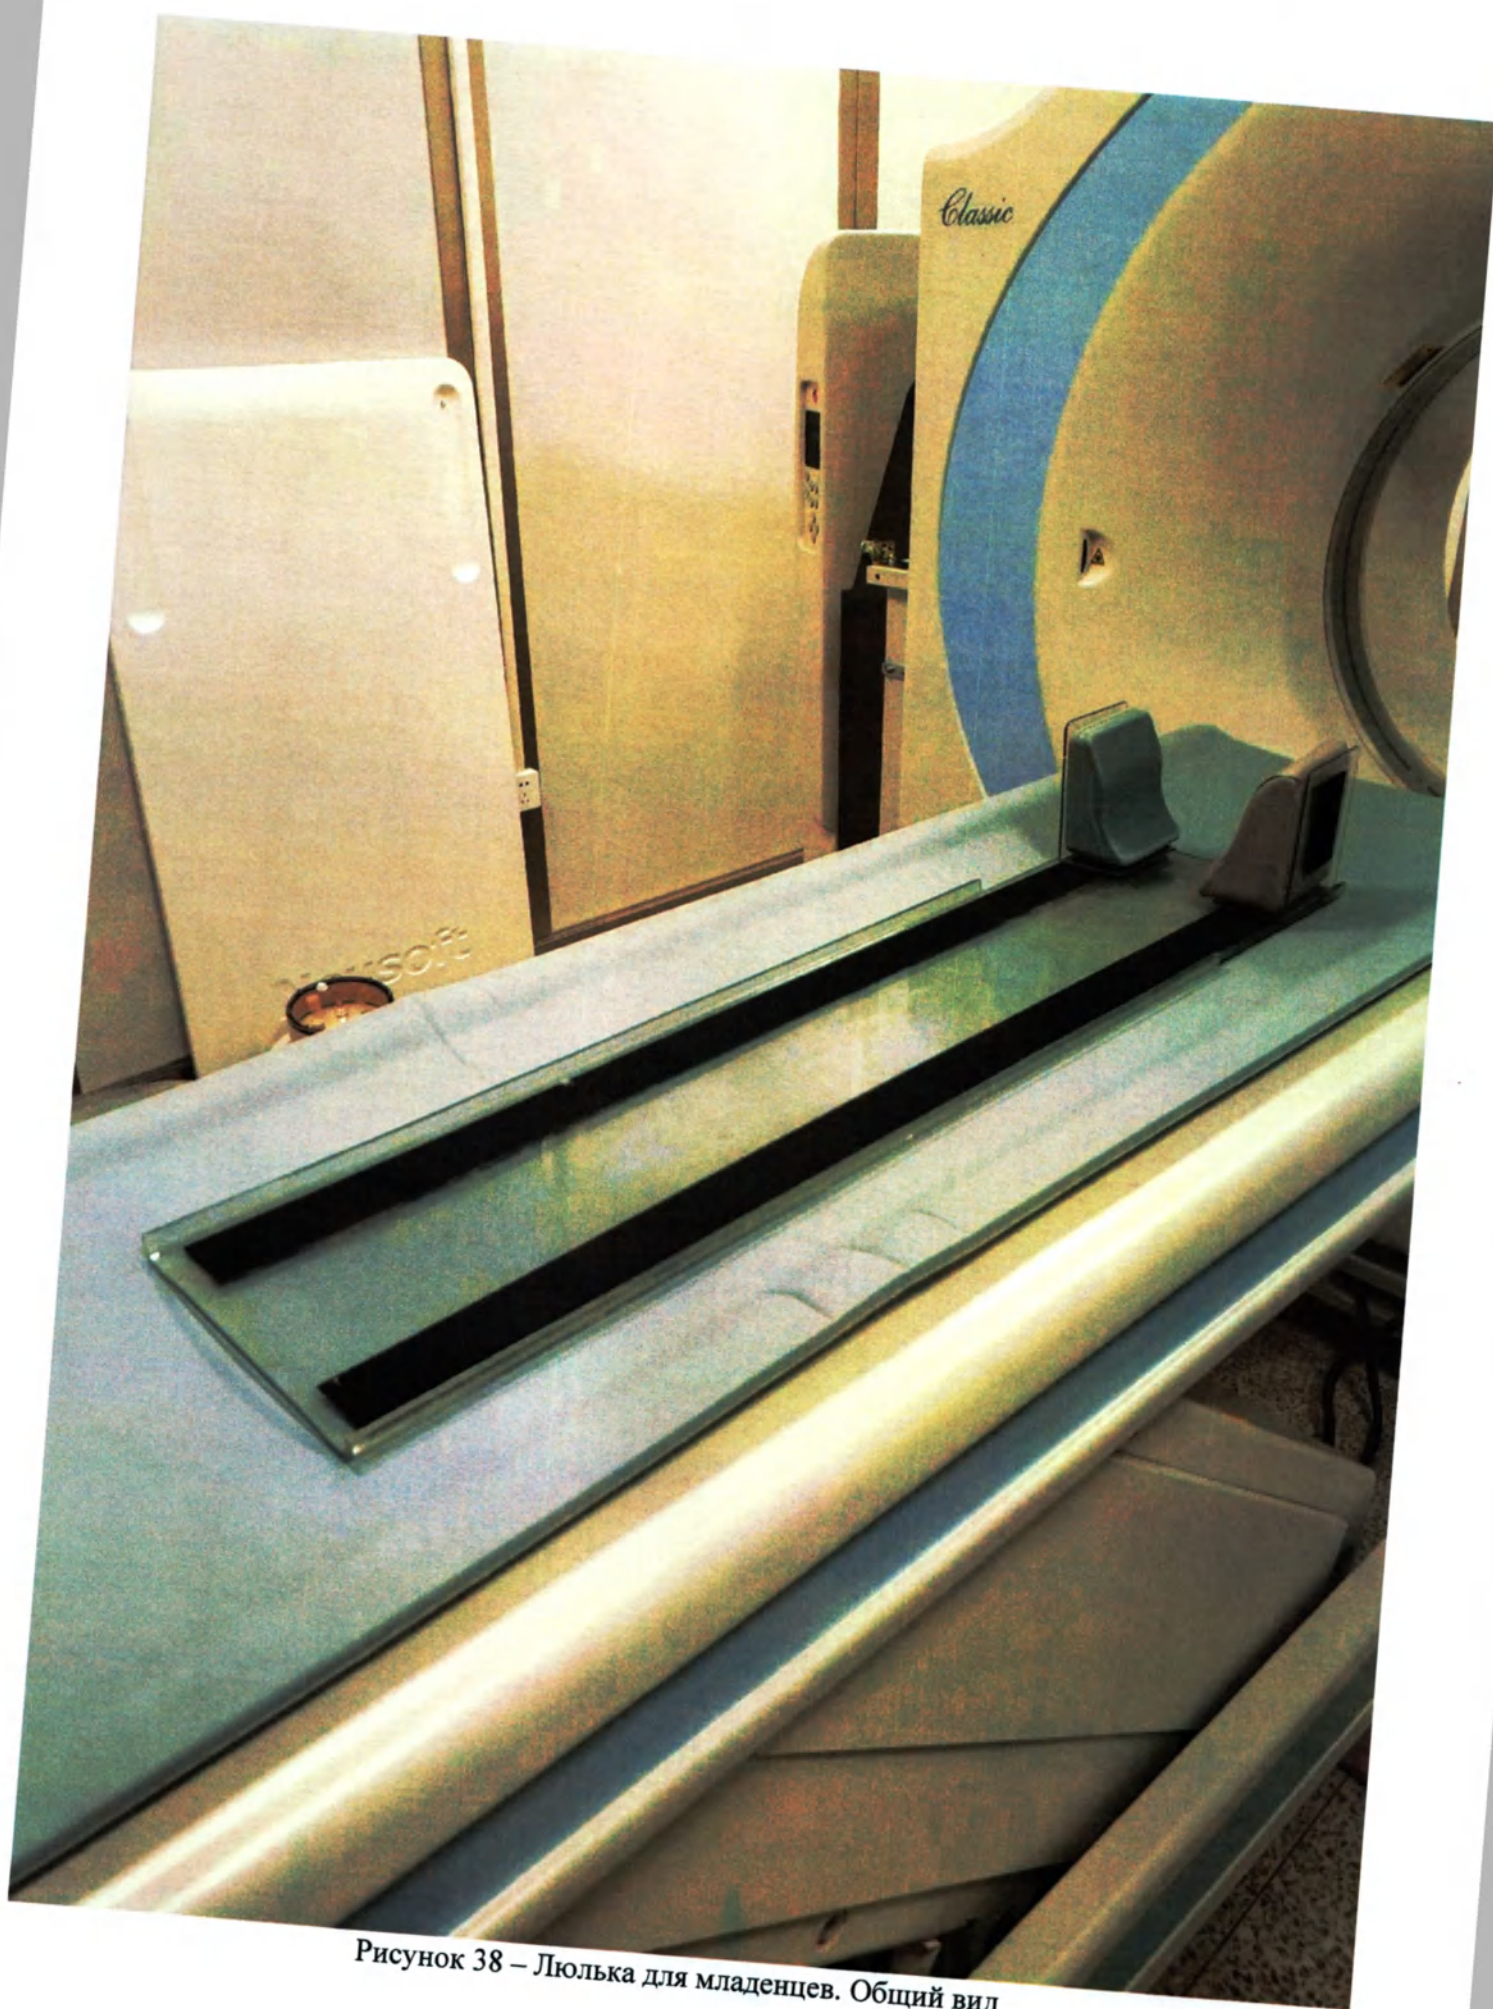


Рисунок 38 – Люлька для младенцев. Общий вид

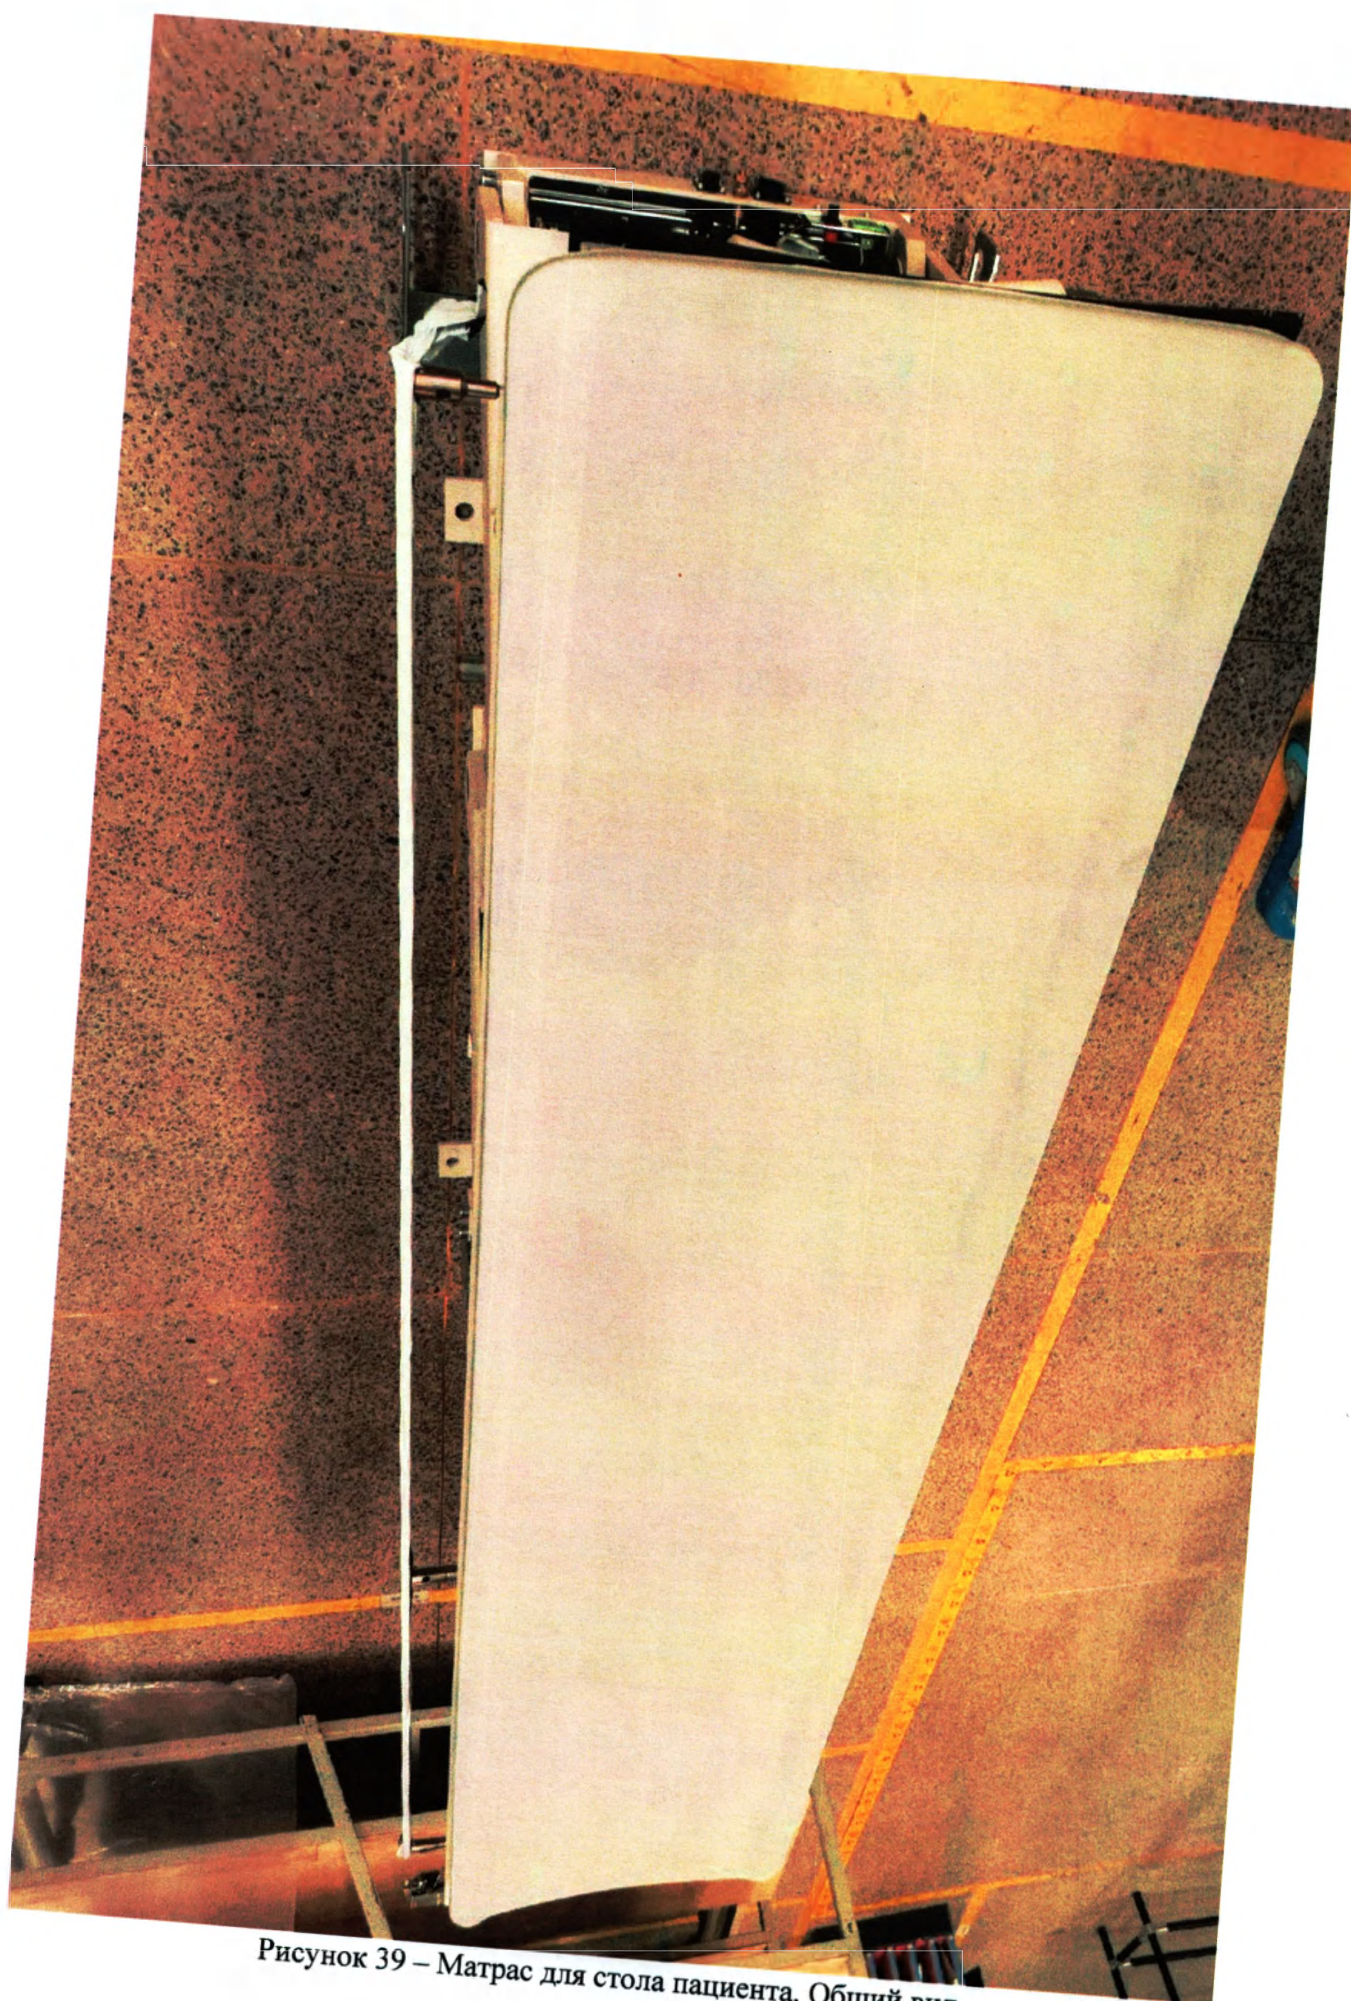


Рисунок 39 – Матрас для стола пациента. Общий вид

стр. 40 из 47

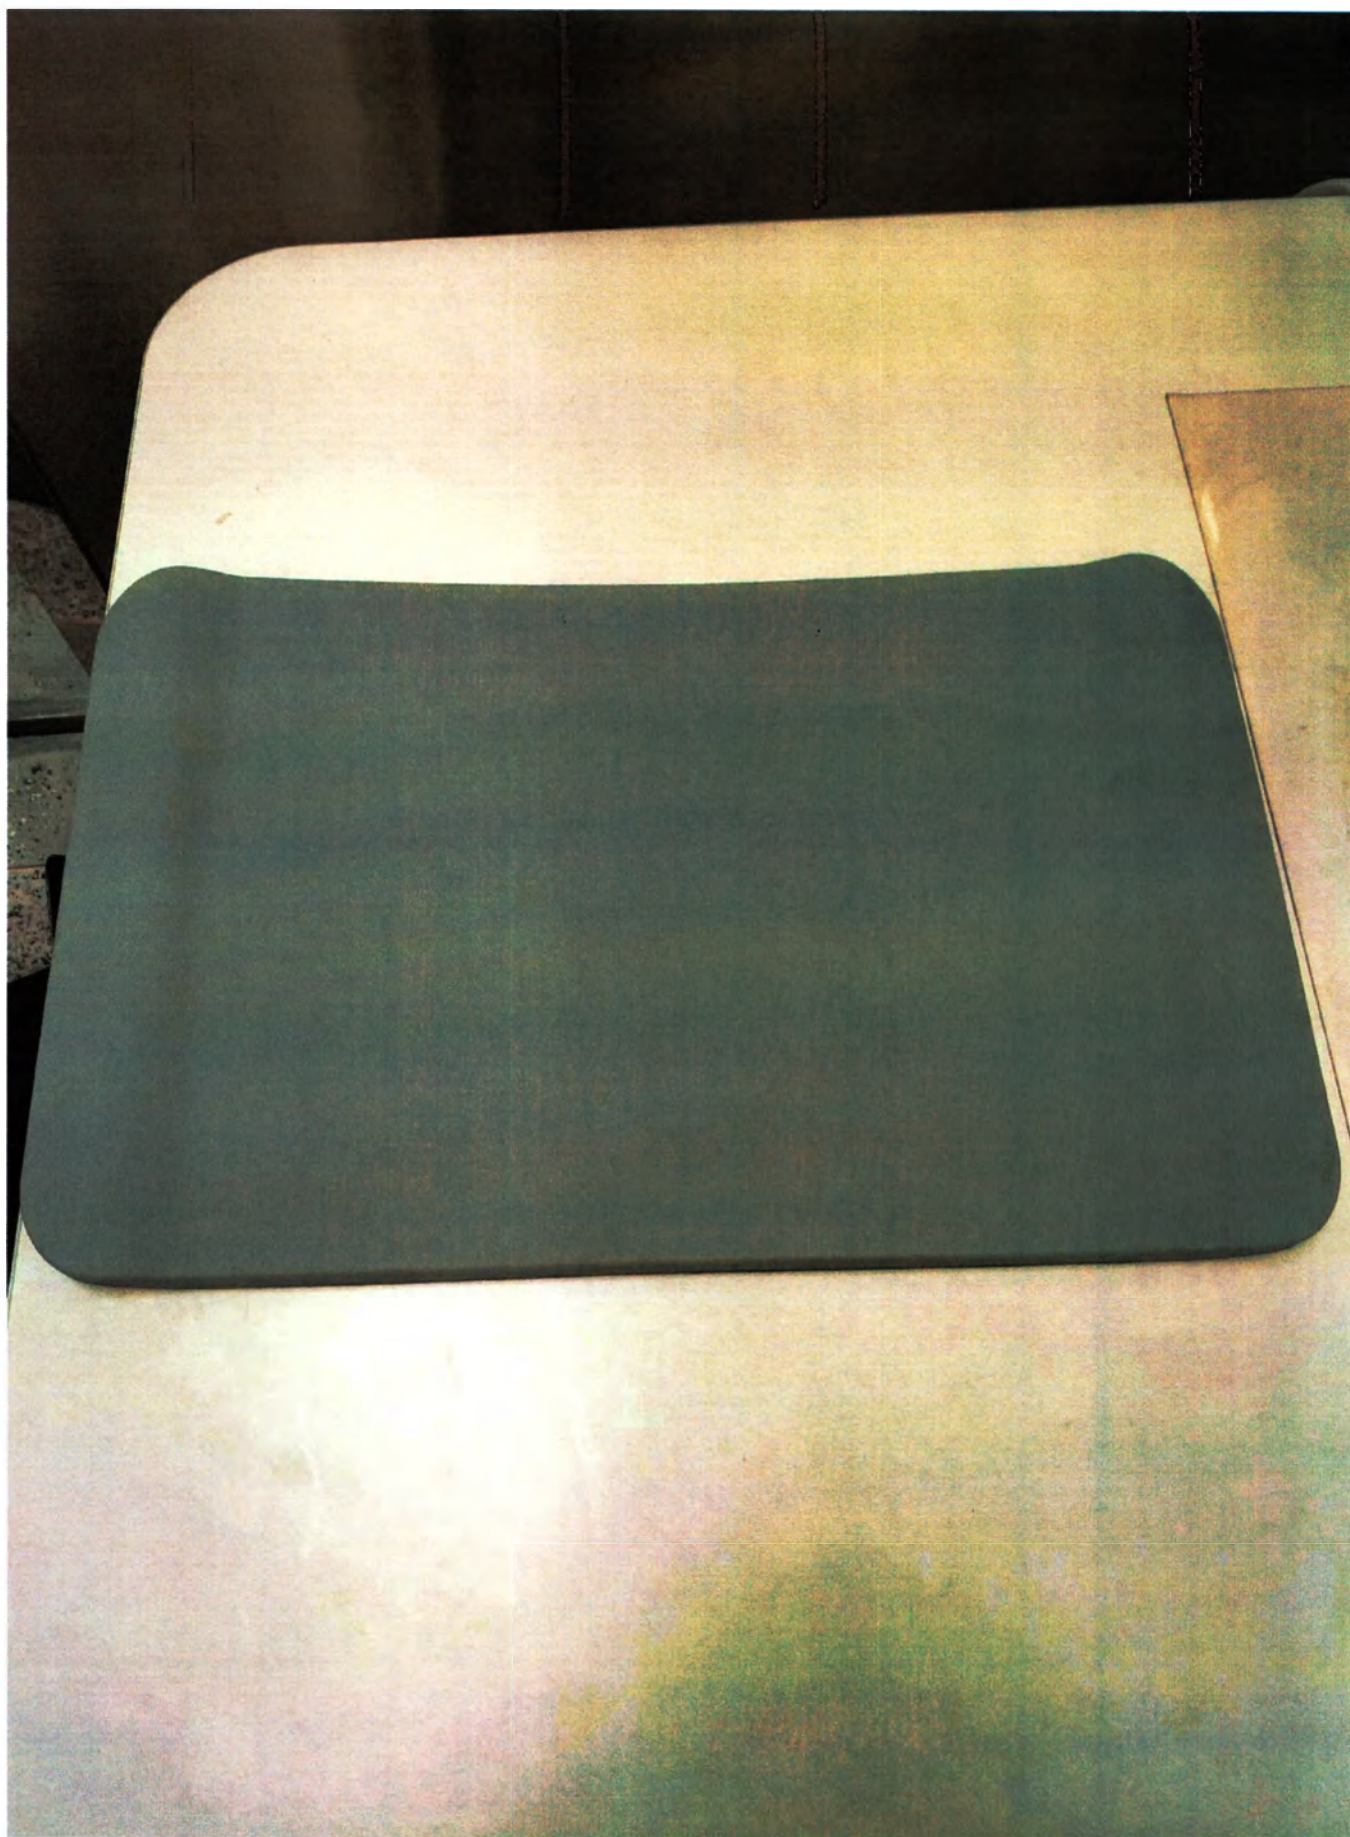


Рисунок 40 – Матрас для удлинительной секции стола пациента. Общий вид

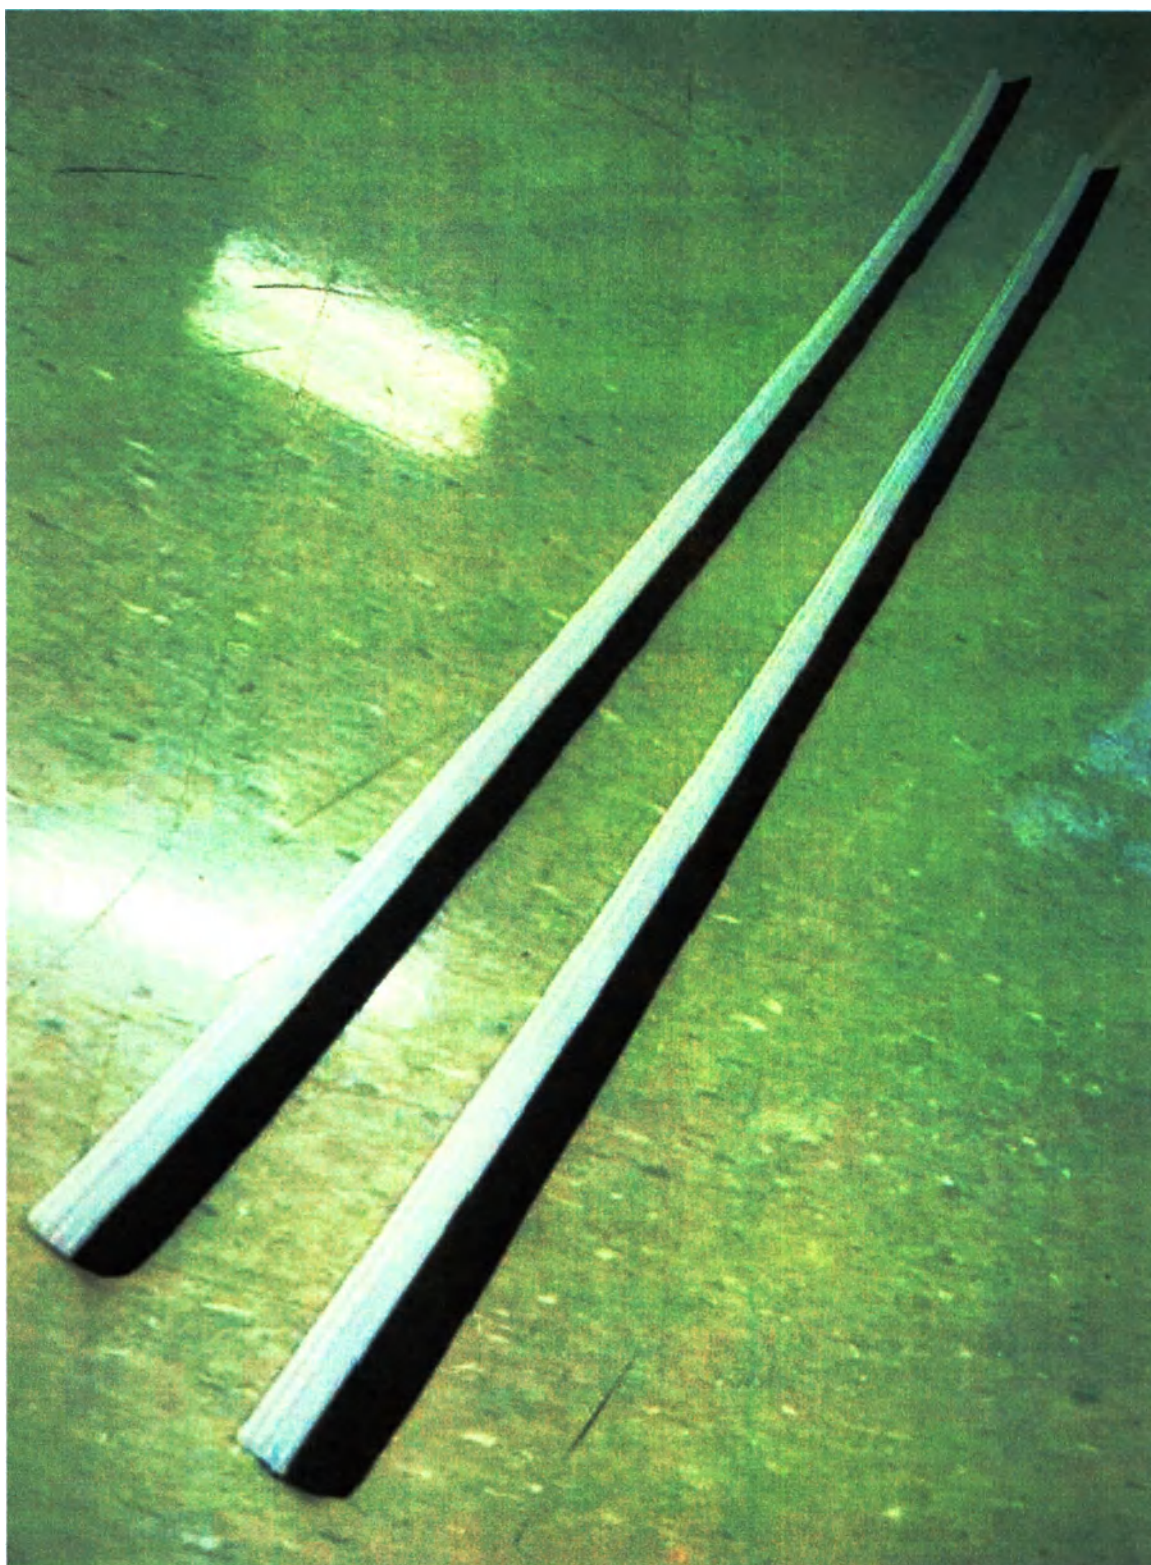


Рисунок 41 – Комплект направляющих всех вариантов исполнения. Общий вид



Рисунок 42 – Транспортная упаковка гентри. Общий вид



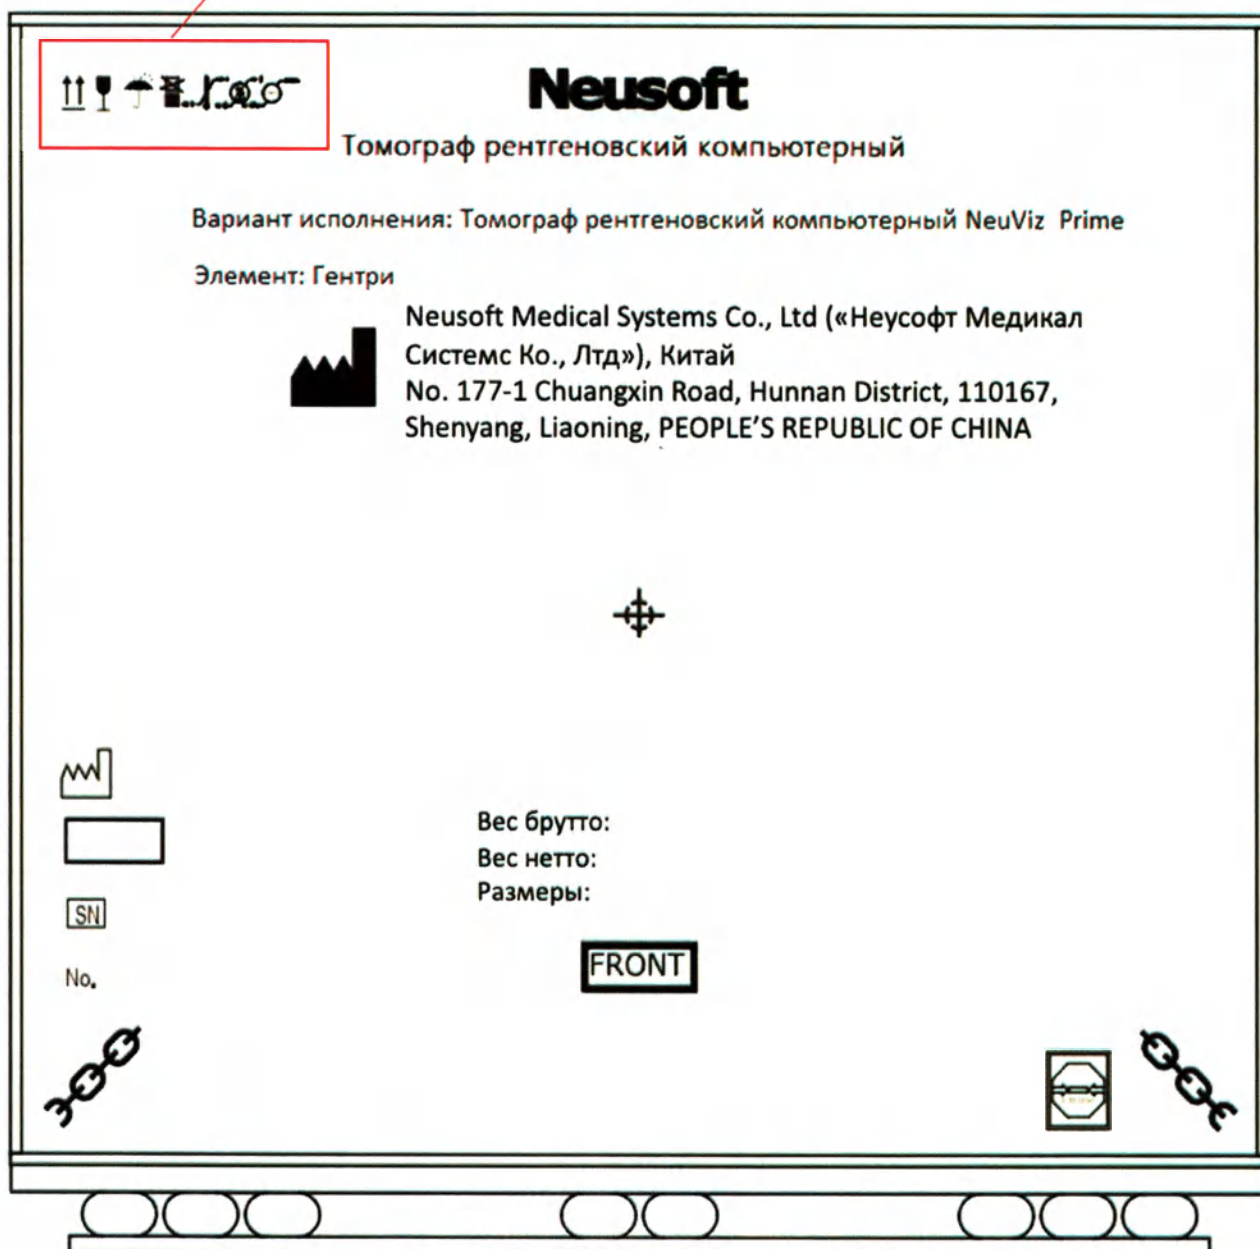


Рисунок 43 – Проект маркировки транспортной тары гентри на примере NeuViz Prime (для других вариантов исполнения аналогично)



Рисунок 44 – Транспортная упаковка стола пациента. Общий вид

Рисунок 45 – Проект маркировки транспортной тары стола пациента на примере NeuViz Prime (для других вариантов исполнения аналогично)

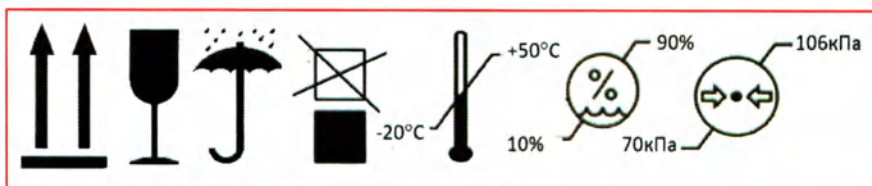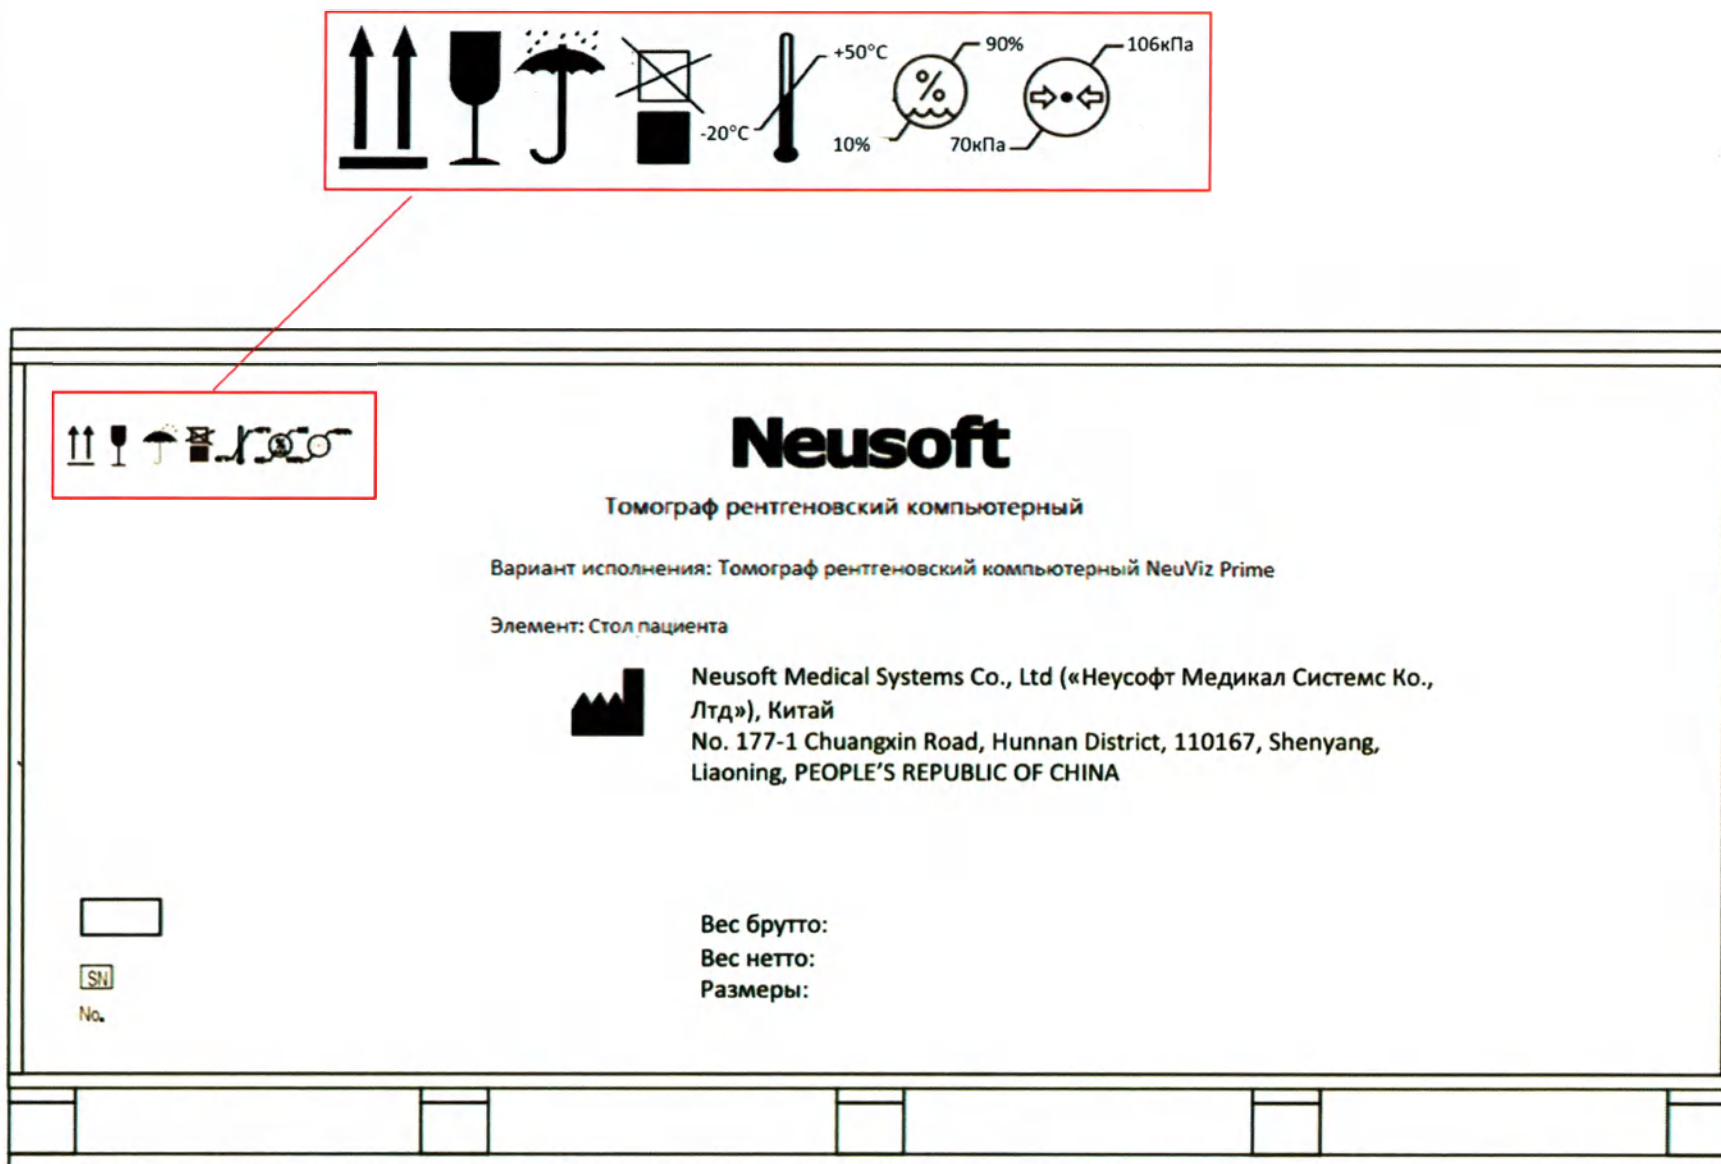

Neusoft

Томограф рентгеновский компьютерный

Вариант исполнения: Томограф рентгеновский компьютерный NeuViz Prime

Питание: 380/400 В, 3~ , 50/60 Гц, 125 кВА



0123

Класс электробезопасности: I класс

Электромагнитная совместимость: группа 1, класс A.



Neusoft Medical Systems Co., Ltd («Неусофт Медикал Системс Ко., Лтд»), Китай

No. 177-1 Chuangxin Road, Hunnan District, 110167, Shenyang, Liaoning, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Информация о уполномоченном представителе производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БиВи» (ООО «Компания «БиВи»)

129085, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, пр-кт Мира, д. 101 стр. 1, помещ. 1/1

+7 (499) 281-67-68 info@beawire.com

Номер регистрационного удостоверения:

от

Рисунок 46 – Проект основной маркировки изделия на примере NeuViz Prime (для других вариантов исполнения аналогично)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 47 листа (-ов)

Генеральный директор Т. А. Носова / Носова Т. А.
М.П.

