


Макет этикетки медицинского изделия


Устройство демпфирующее для скелетного вытяжения (шина Беллера) по ТУ
9452-155-01894927-98



 ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРТОПЕДИИ 					
ФГУП «ЦИТО» РОССИЯ, Москва					
REF 04.04.030	Устройство демпфирующее для скелетного вытяжения (шина Беллера) (большое) ТУ 9452-155-01894927-98 РУ ФСР 2008/02468 от 23.08.2017				
LOT 00000001					
					
 09.2019	<table border="1"><tr><td>Кол-во</td><td>1 компл</td></tr><tr><td colspan="2">Дата, подпись</td></tr></table>	Кол-во	1 компл	Дата, подпись	
Кол-во	1 компл				
Дата, подпись					

Штамп ОТК 1

09.09.19

Устройство демпфирующее для скелетного вытяжения (шина Беллера) по ТУ 9452-155-01894927-98

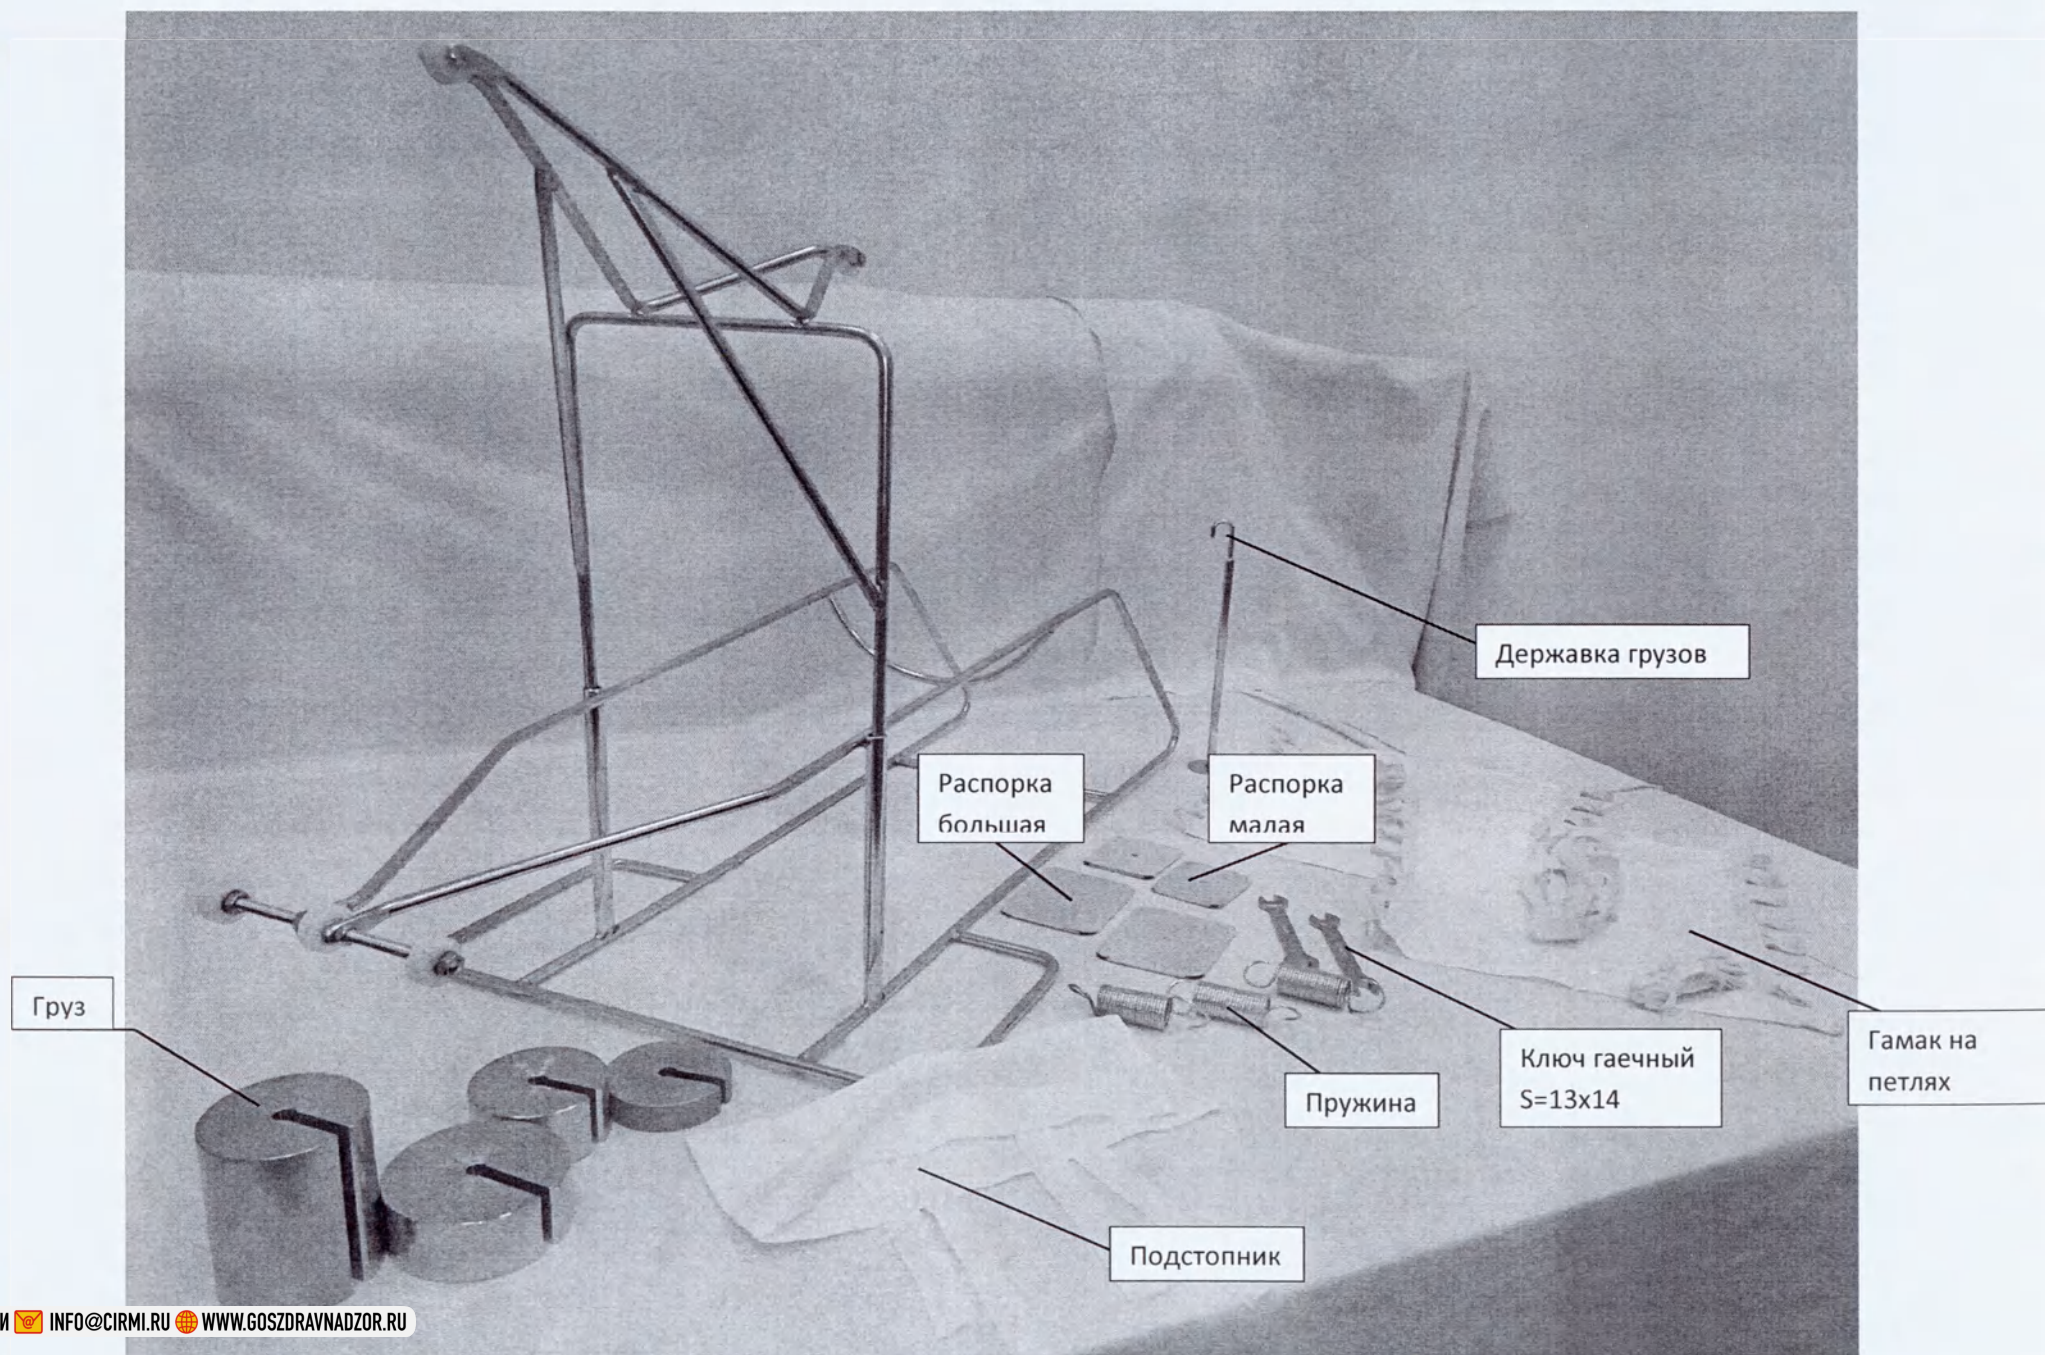

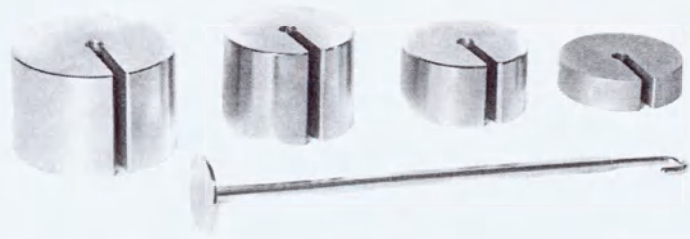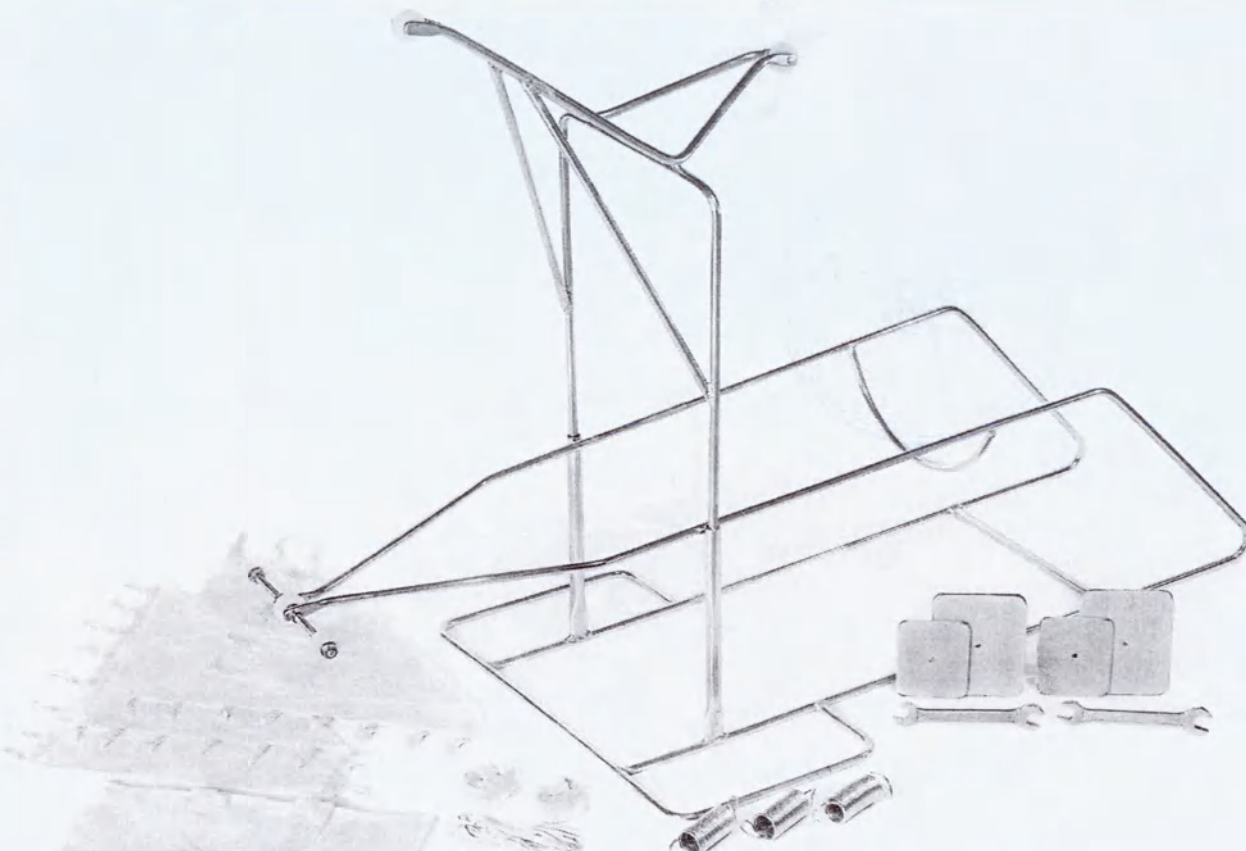

Комплектация

- рама горизонтальная – 1 шт.
- рама вертикальная – 1 шт.
- пружина – 3 шт.
- гамак на петлях – 2 шт.
- подstopник – 1 шт.
- распорка малая – 2 шт.
- распорка большая – 2 шт.
- шнур корсетный ОСТ 17-10-035 - 5 м
- грузы (весом 1, 2, 3, 5 кг) – 4 шт.
(поставляются отдельно)
- державка для грузов – 1 шт. (поставляется
отдельно)
- ключ гаечный $S=13 \times 14$ мм 7811-0027 Н.СІХ9
ГОСТ 2839 – 2 шт.
- паспорт – 1 экз.
- этикетка – 1 шт

Принадлежности:

1. Гамак на петлях.
2. Распорка большая.
3. Распорка малая.
4. Пружина $L=77,5$.
5. Пружина $L=107,5$.
6. Подstopник.
7. Шнур корсетный – 5 м.
8. Державка грузов (при необходимости).
9. Груз – весом 0,5 кг (при необходимости).
10. Груз – весом 1 кг (при необходимости).
11. Груз – весом 2 кг (при необходимости).
12. Груз – весом 3 кг (при необходимости).
13. Груз – весом 4 кг (при необходимости).
14. Груз – весом 5 кг (при необходимости).
15. Ключ гаечный $S=13 \times 14$.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

2 листа (ов)

Помощник ген. директора

О. В. Рождественская

