

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

«09» января 2024 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 230-65614693-2022»

2024

Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Фолат

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



PreClin 300

01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86020

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-конъюгат (R2), 6,5 мл/уп., Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп., Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Фолат

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



PreClin 300

01.07.2023

LOT 20230701 01.07.2024 REF C86020

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-конъюгат (R2), 6,5 мл/уп., Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп., Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Фолат

Набор реагентов на 500 тестов

YNLO

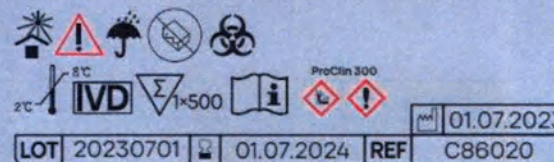

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-коъюгат (R2), 6,5 мл/уп., Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп., Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Фолат

Набор реагентов на 1000 тестов

YNLO

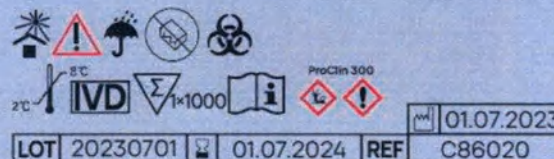

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-коъюгат (R2), 6,5 мл/уп., Реагент-1 для подготовки образцов (R3), 4,0 мл/уп., Реагент-2 для подготовки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

**Лидлаб Амур
Фолат**

3,5 мл	6,5 мл	4,0 мл	4,0 мл
R 1	R 2	R 3	R 4
LOT 20230701			
01.07.2024			

IVD     $\Sigma \times 50$

Barcode: 9031 1017 1301

лидкор
**Лидлаб Амур
Фолат**

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT	20230701	IVD 
REF	01.07.2024	
REF	C86020	

лидкор
Лидлаб Амур Фолат

1,0 мл

CAL 1

LOT	20230701
REF	01.07.2024
REF	C86020

IVD     $\Sigma \times 50$

лидкор
Лидлаб Амур Фолат

1,0 мл

CAL 2

LOT	20230701
REF	01.07.2024
REF	C86020

IVD     $\Sigma \times 50$

лидкор
Лидлаб Амур Фолат

1,0 мл

CAL 3

LOT	20230701
REF	01.07.2024
REF	C86020

IVD     $\Sigma \times 50$

лидкор
Лидлаб Амур Фолат

1,0 мл

CAL 4

LOT	20230701
REF	01.07.2024
REF	C86020


IVD     $\Sigma \times 50$


Лидлаб Амур Фолат



LOT 20230701 EXP 01.07.2024



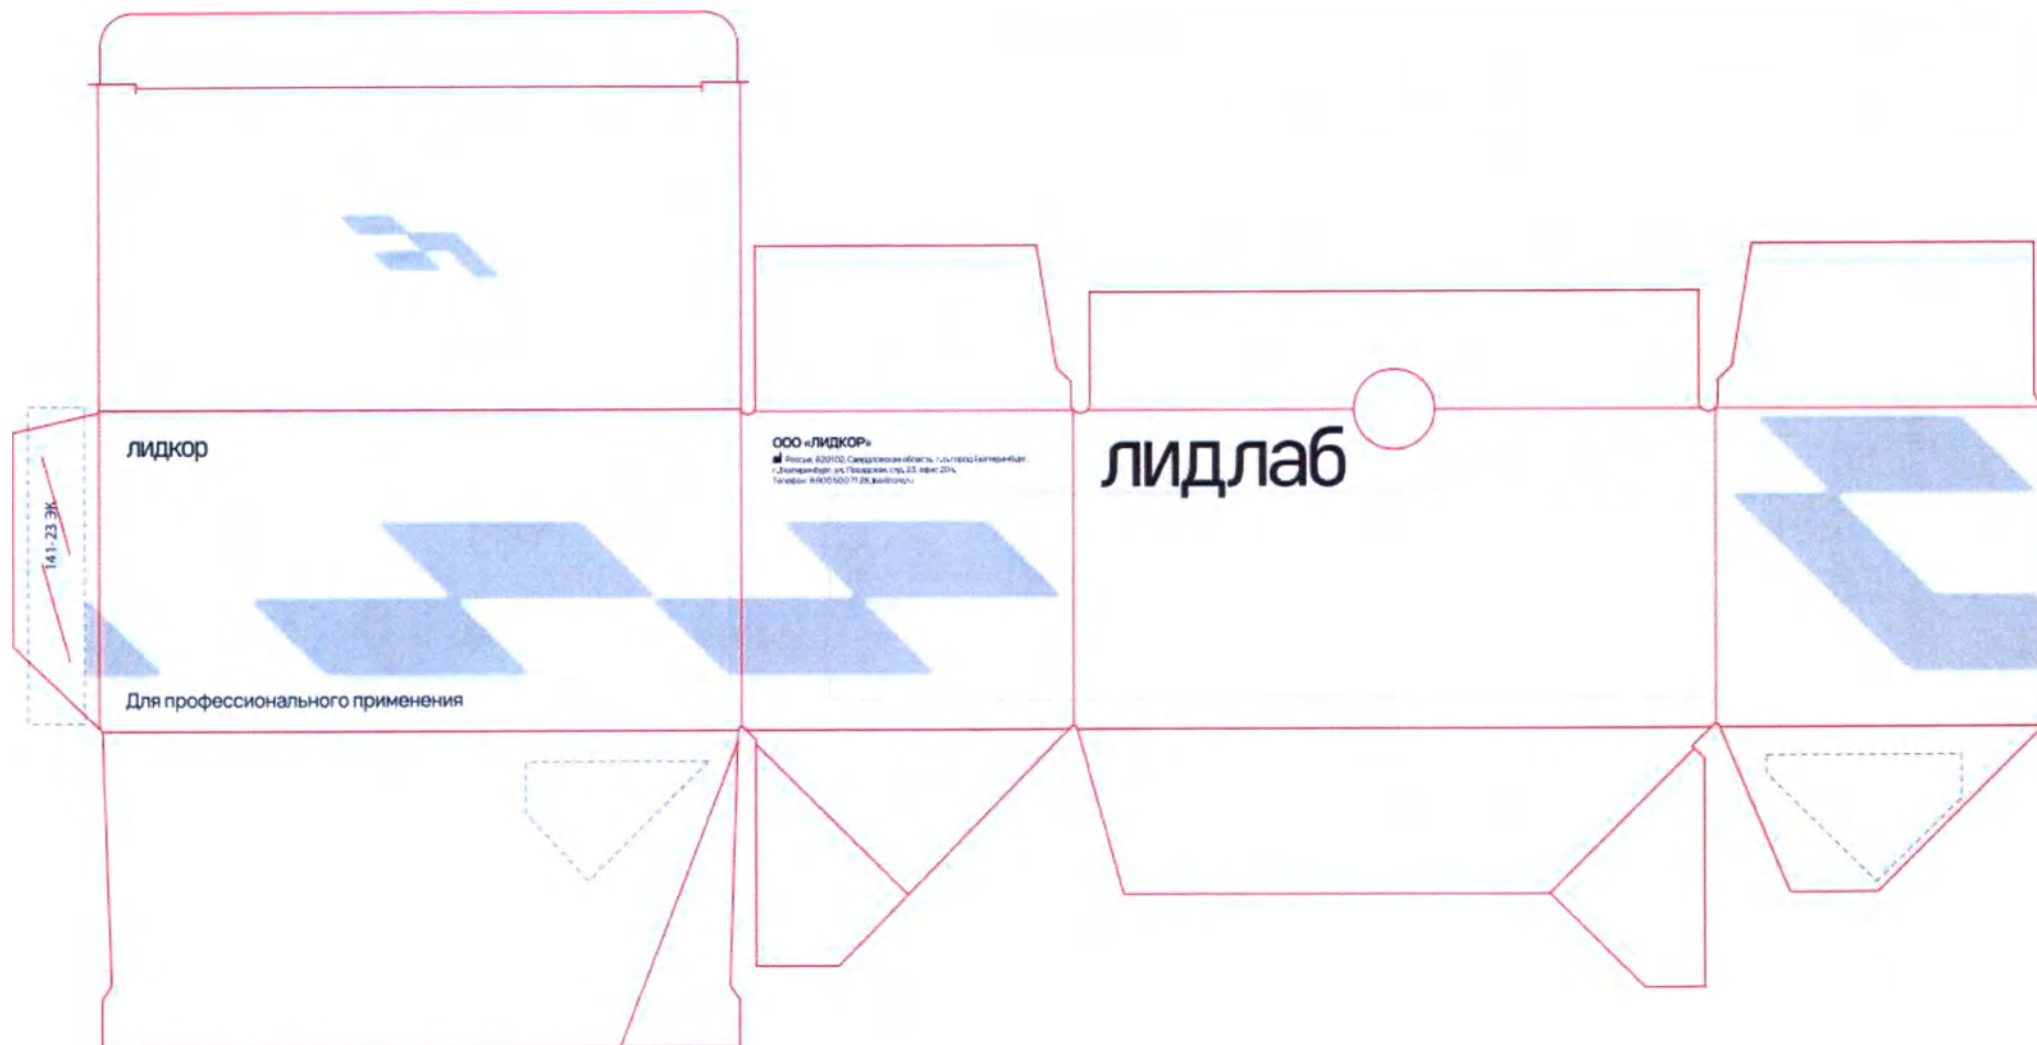

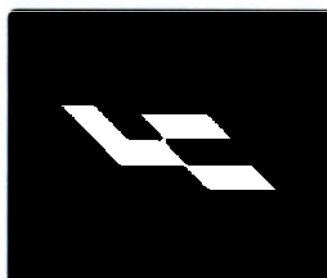


Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C86020		

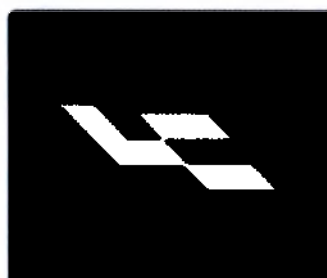


Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C86020		

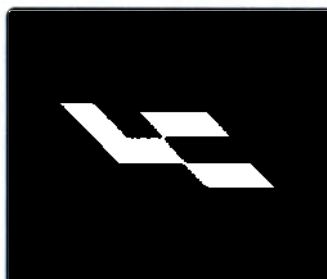


Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86020	

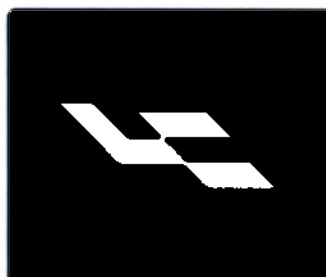


Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86020	

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.	 XXX
Наименование изделия	 MM.GGGT
 XXXXXX	
 XXXXXXXX	 Только для in vitro диагностики Для профессионального применения
	
	 8°C 2°C
	
	GHS07  

Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

восьмь

) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«09» января 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Набор реагентов «Лидлаб Амур Фолат» для количественного определения фолата (Витамин В9) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-230-65614693-2022»

2024


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)




Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

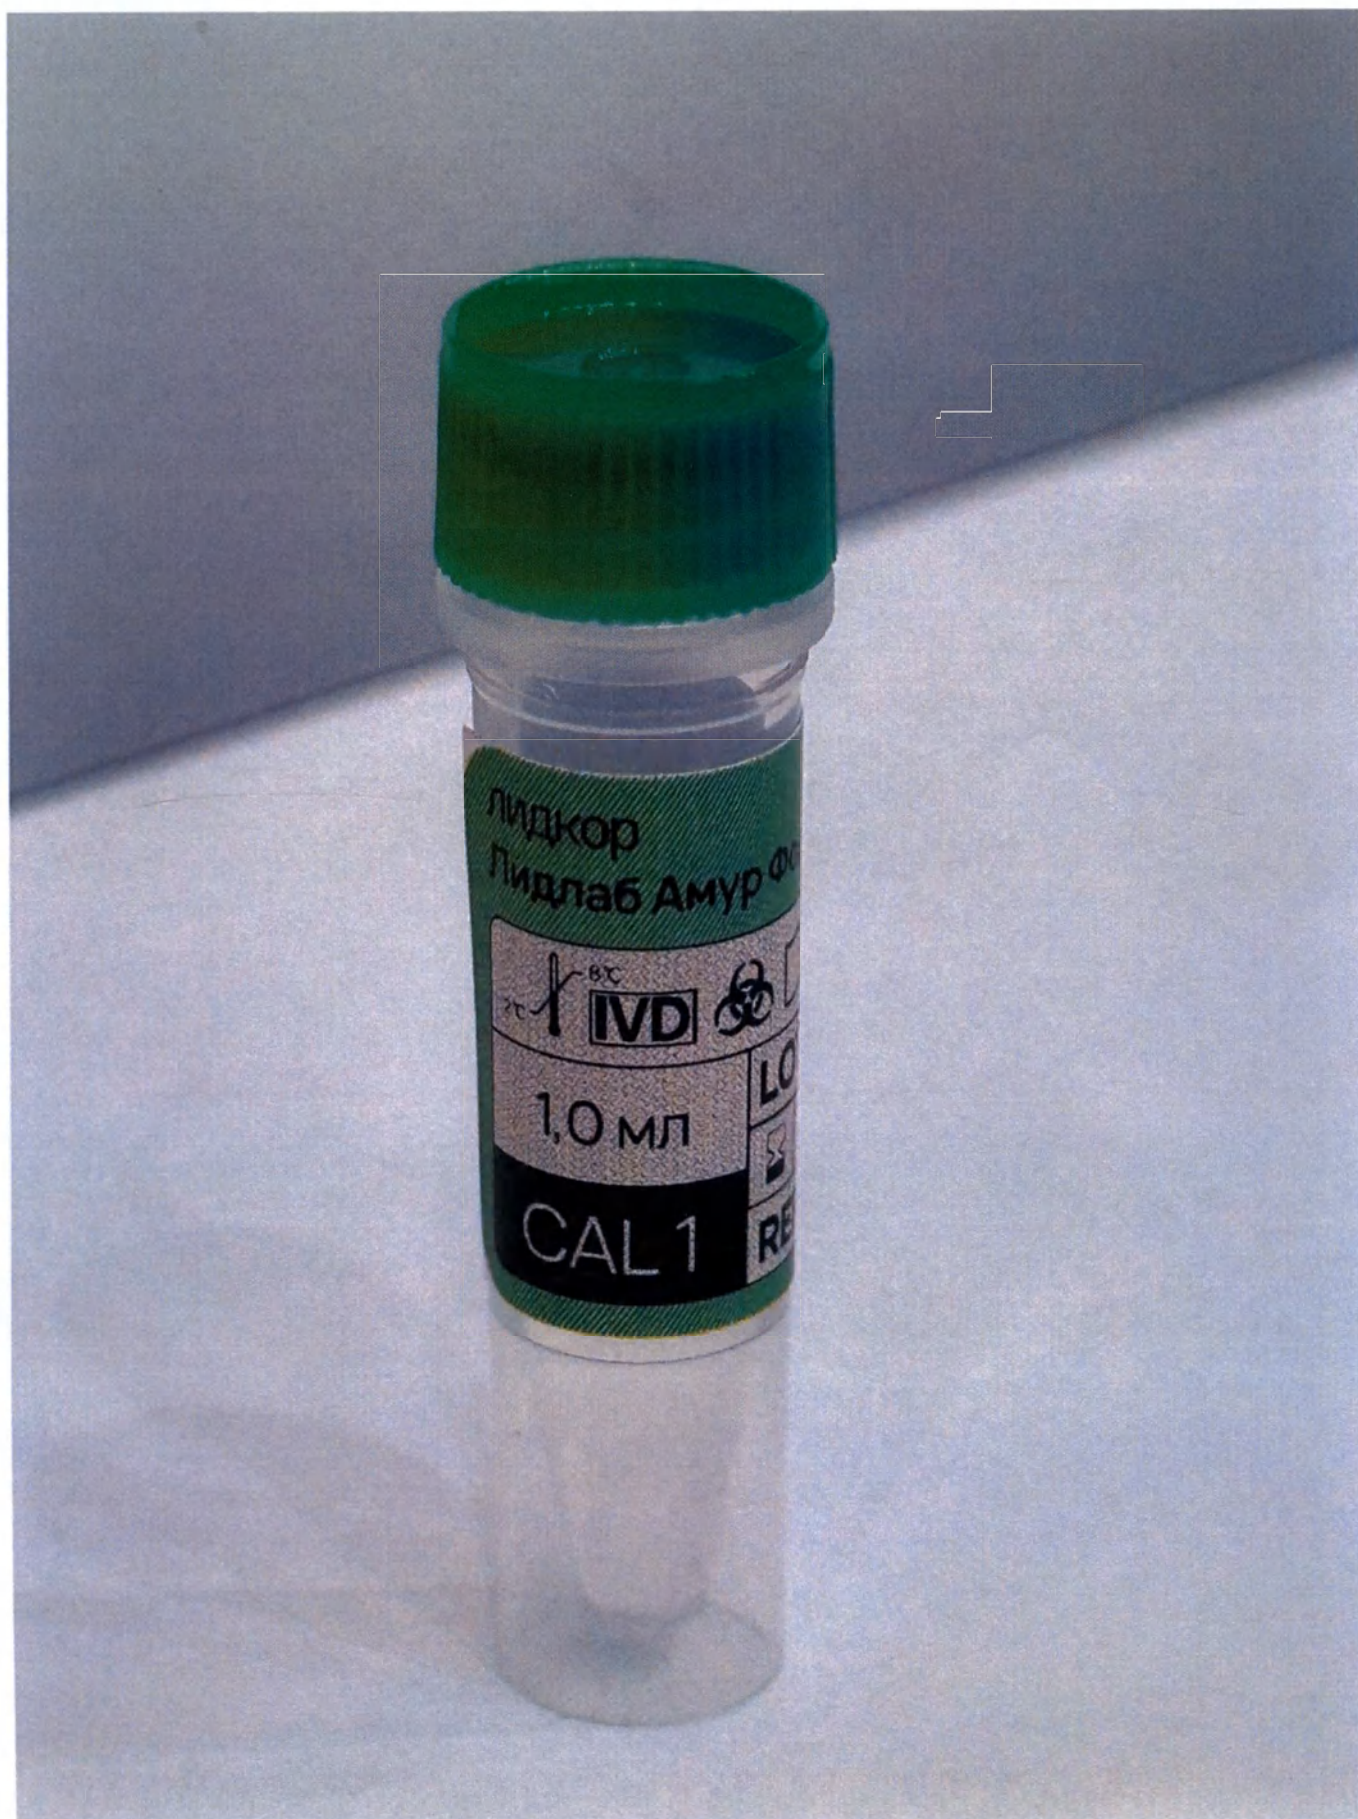


Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

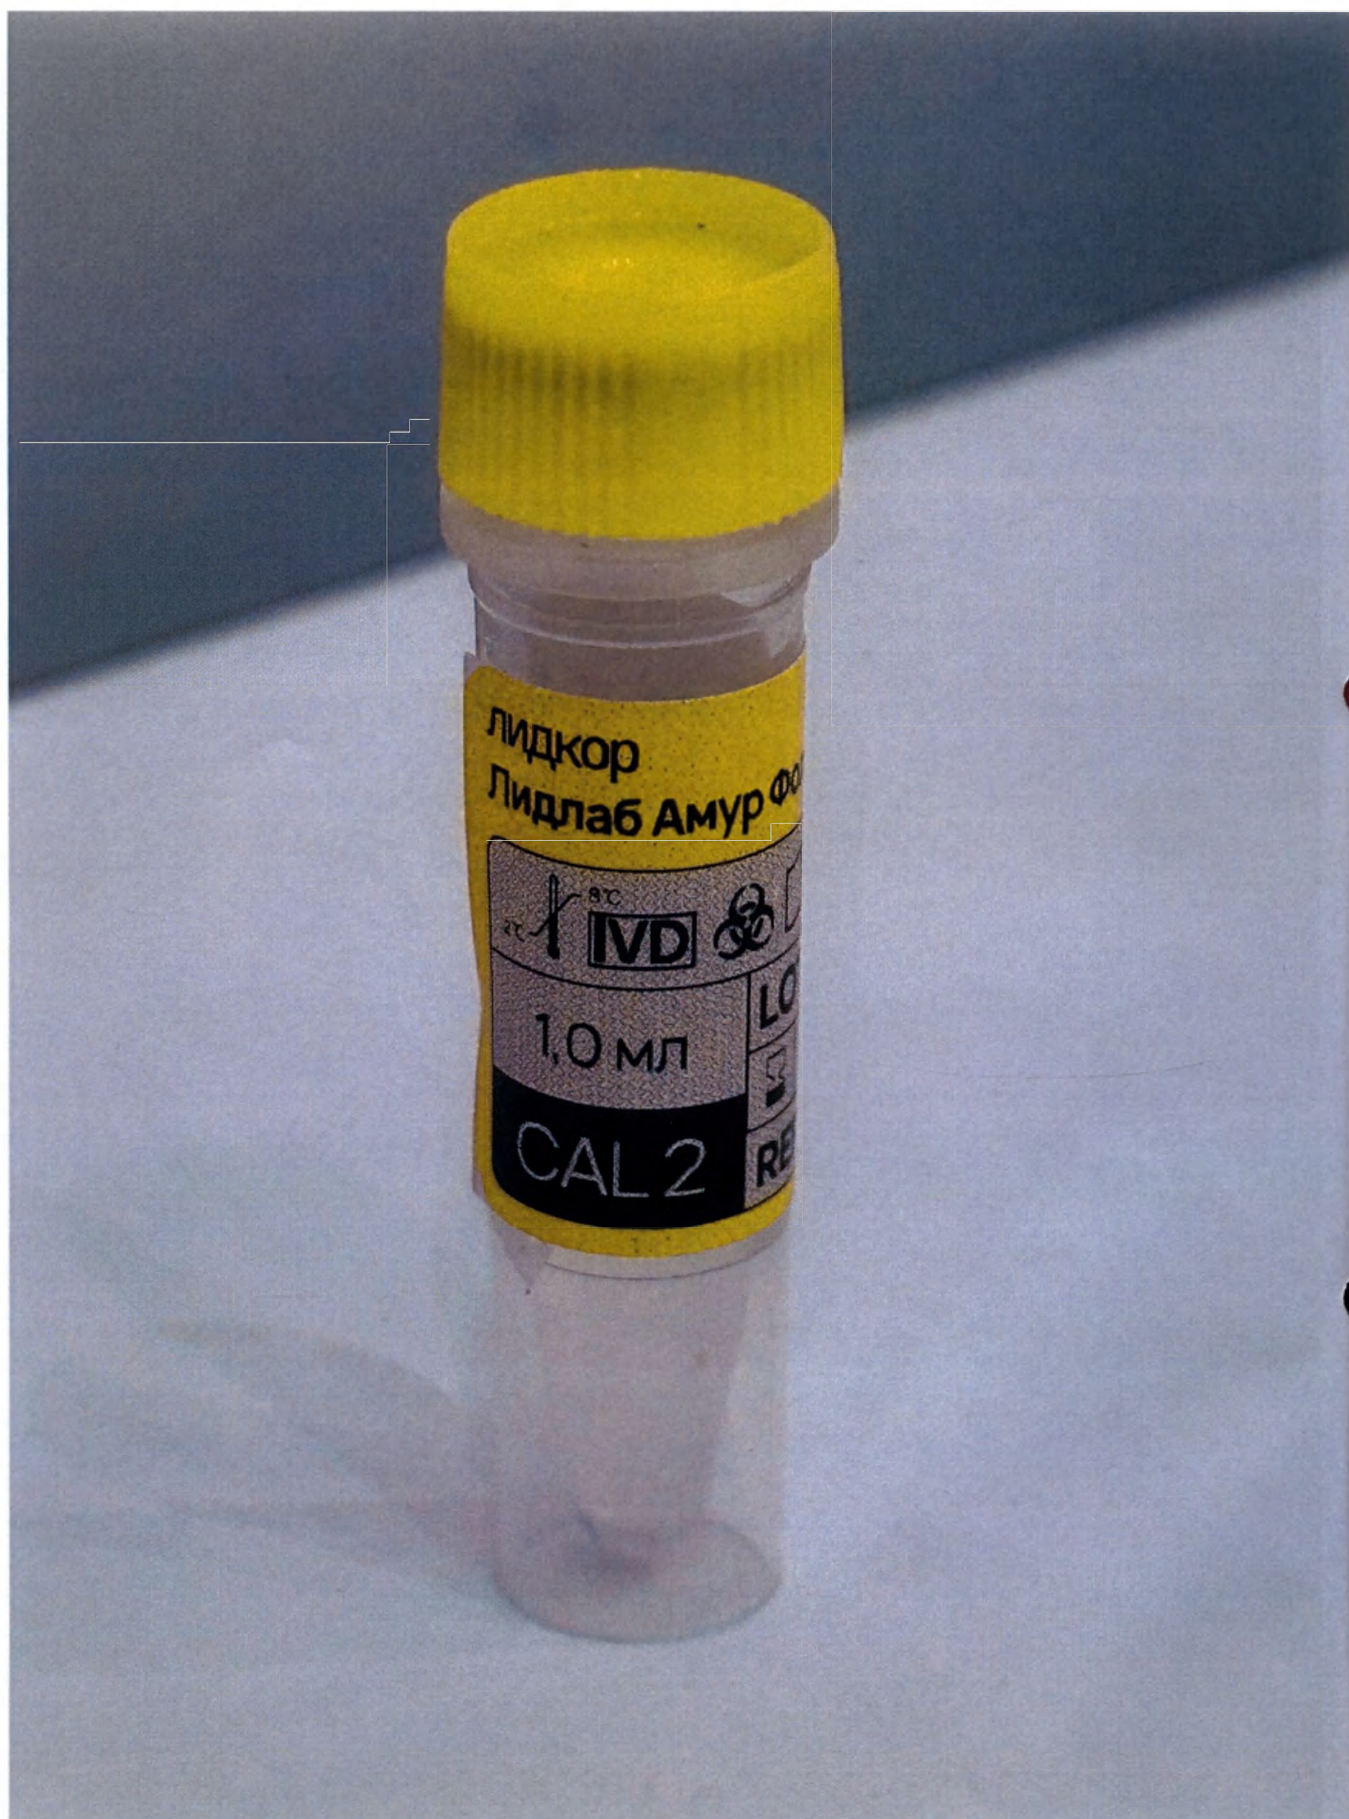

Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

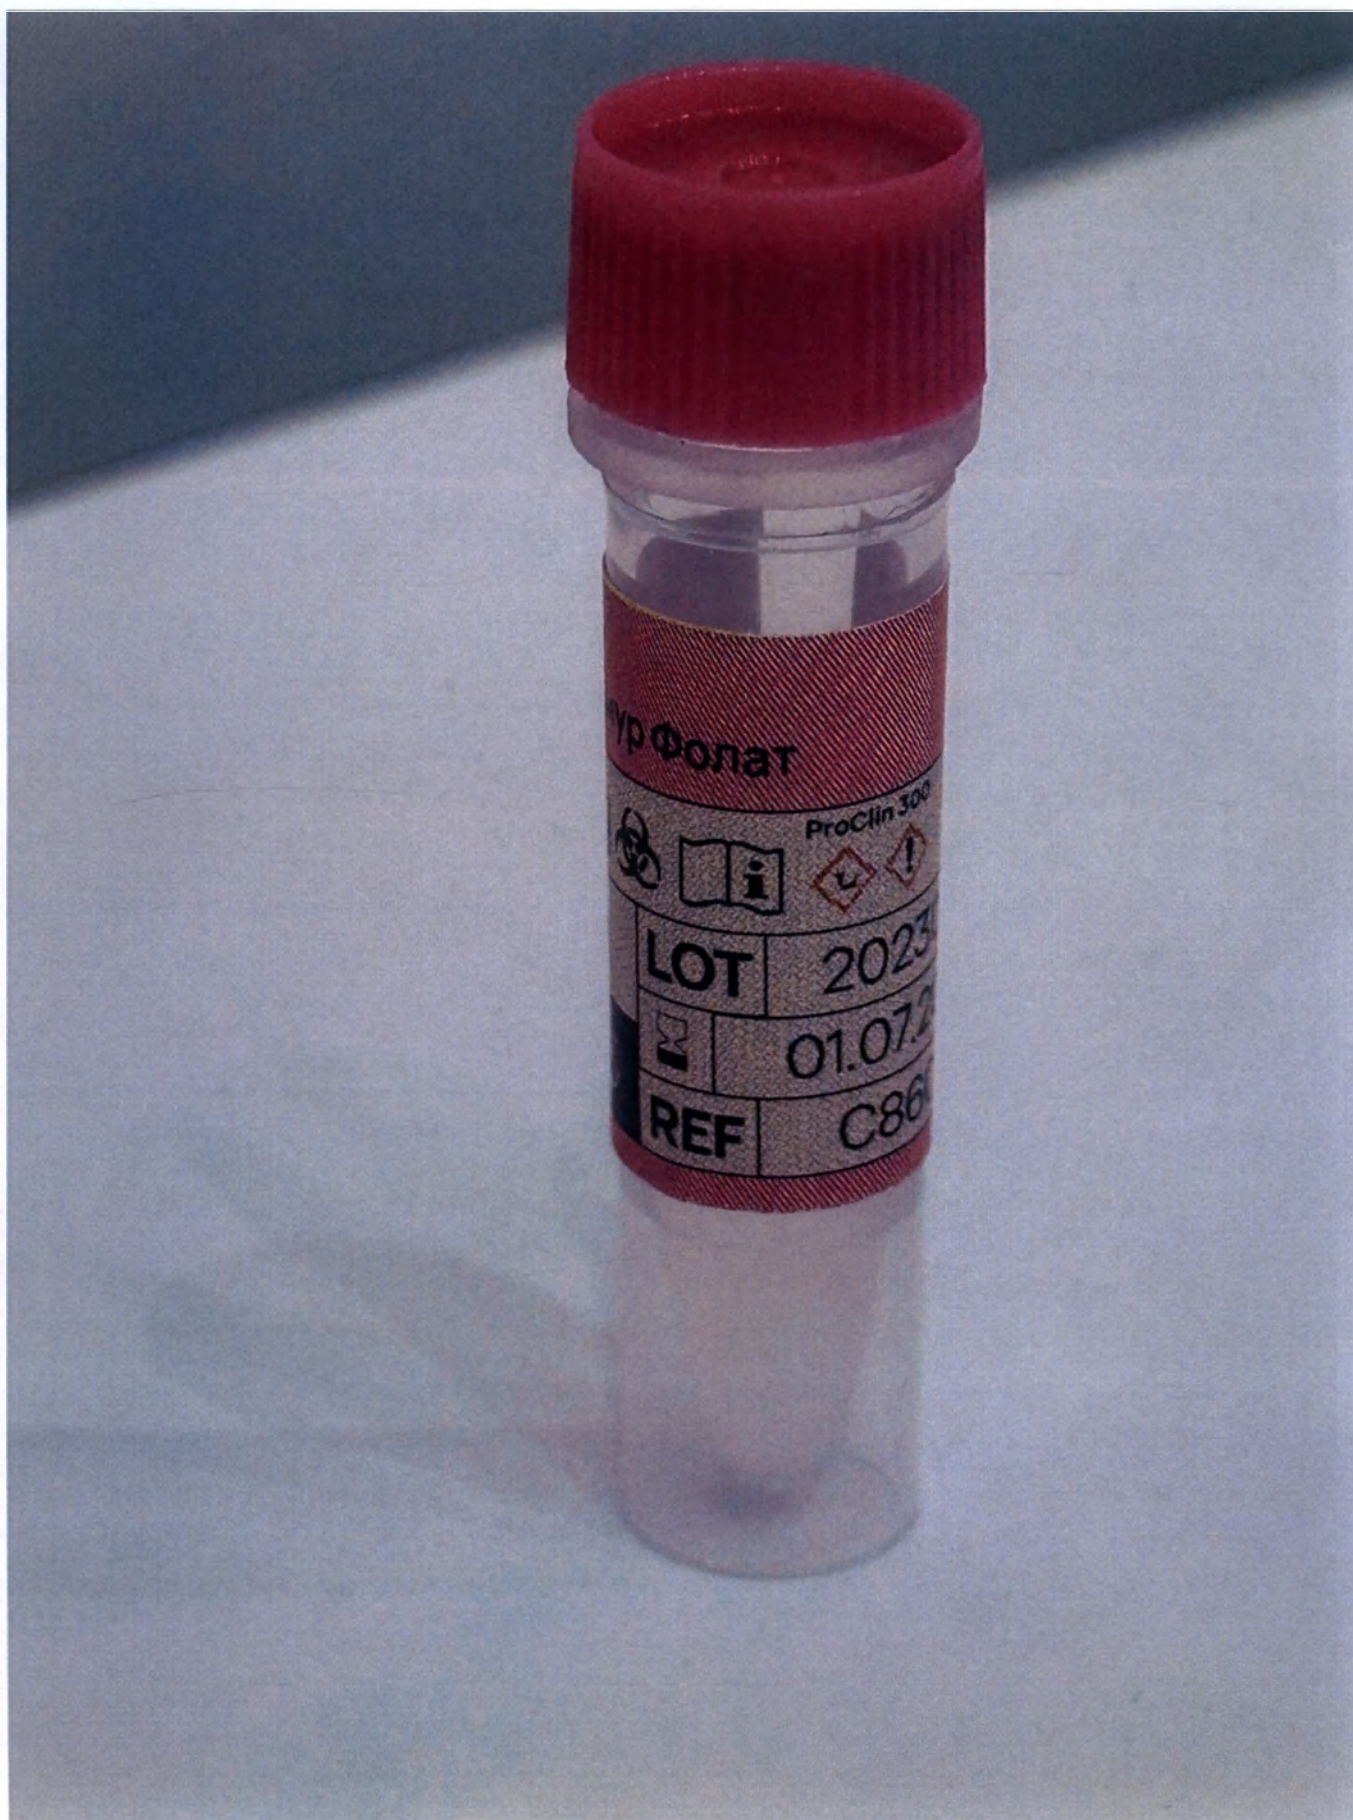

Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон

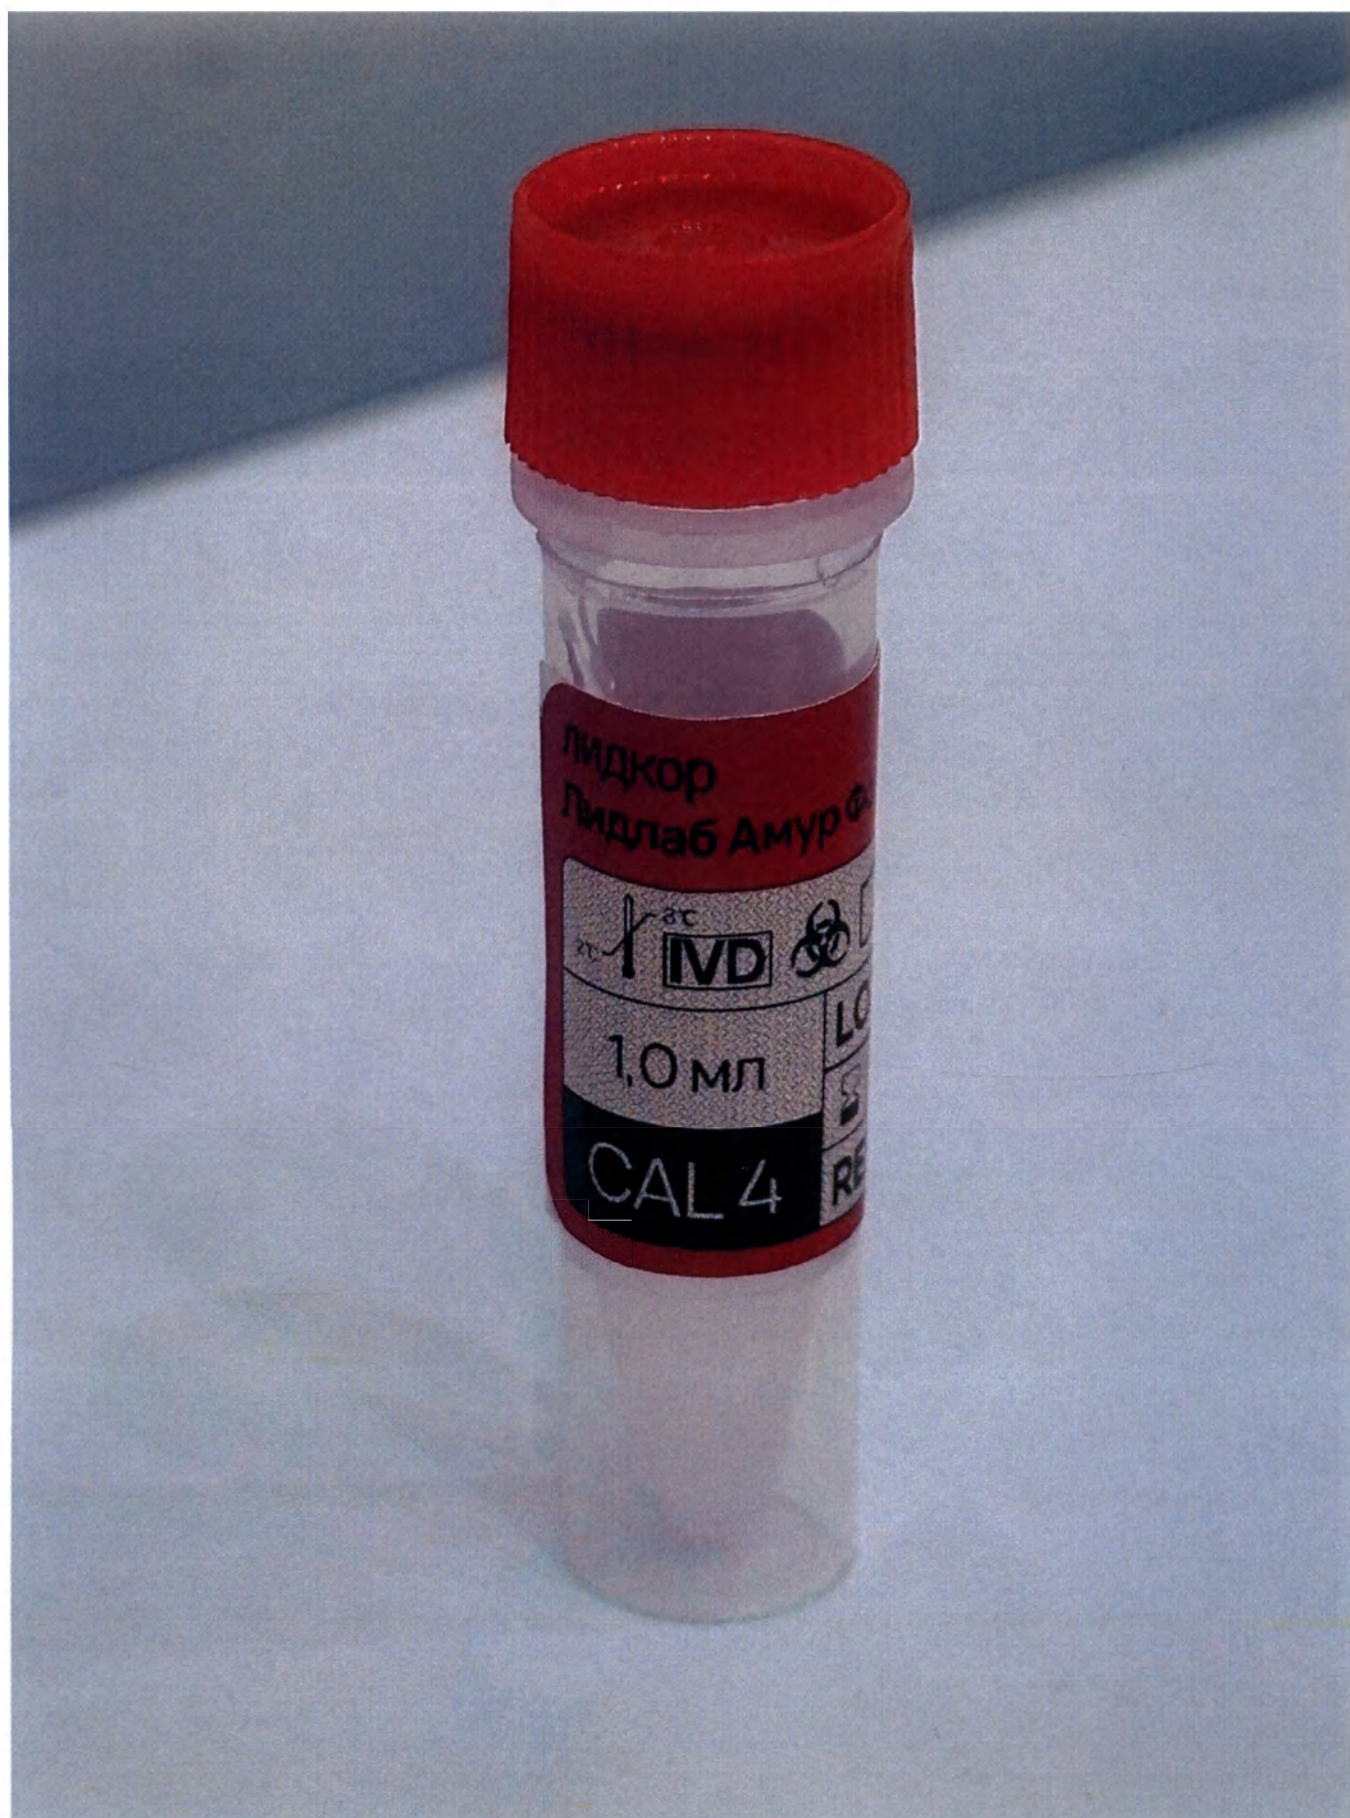

Набор реагентов на 100 тестов



лидкор
Лидлаб Амур
Фолат

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

 01.07.2024

REF C86020



лидкор
Лидлаб Амур
Фолат

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.


LOT 20230701


 01.07.2024

REF C86020



Набор реагентов на 100 тестов (вид сзади)

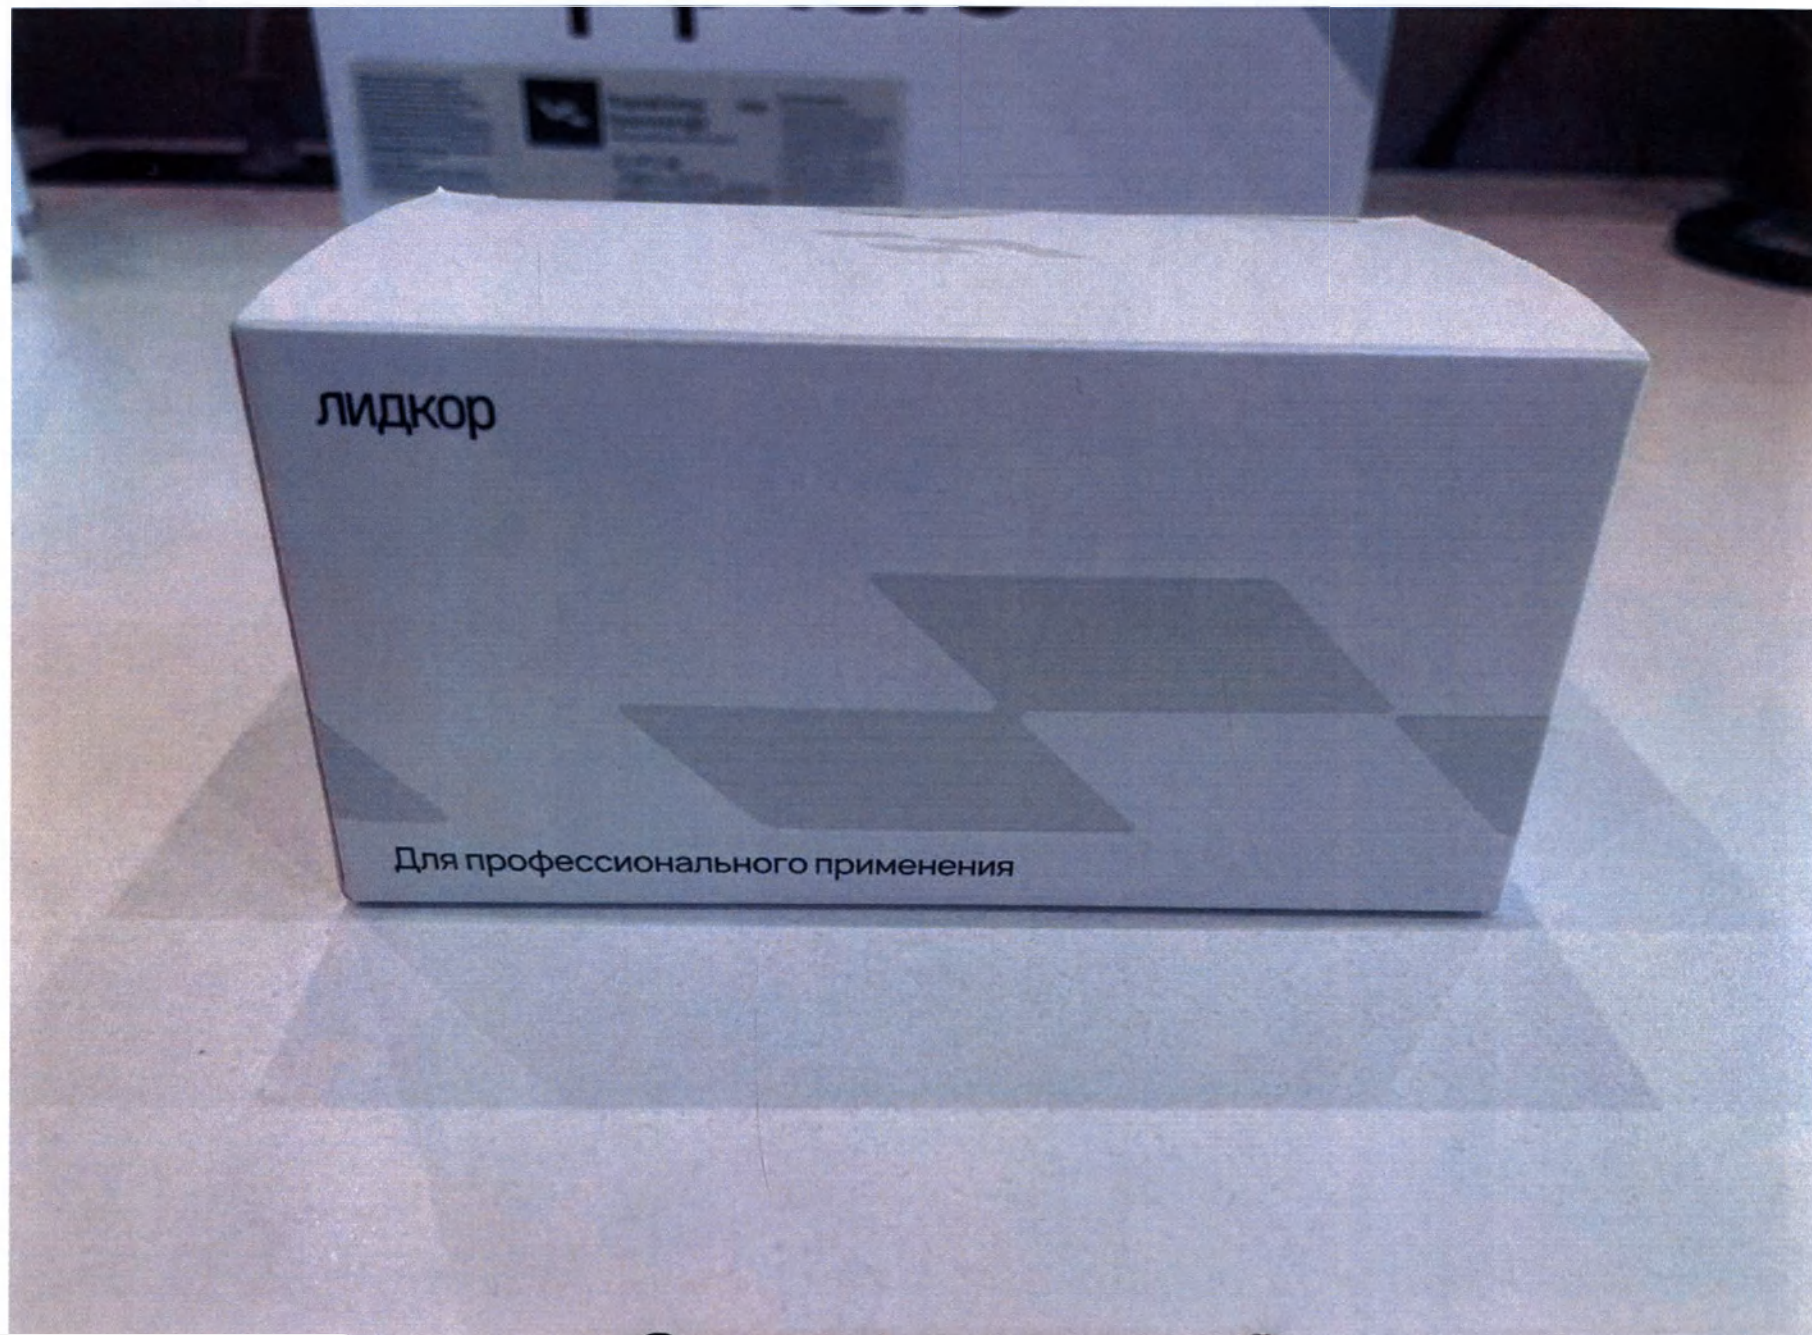


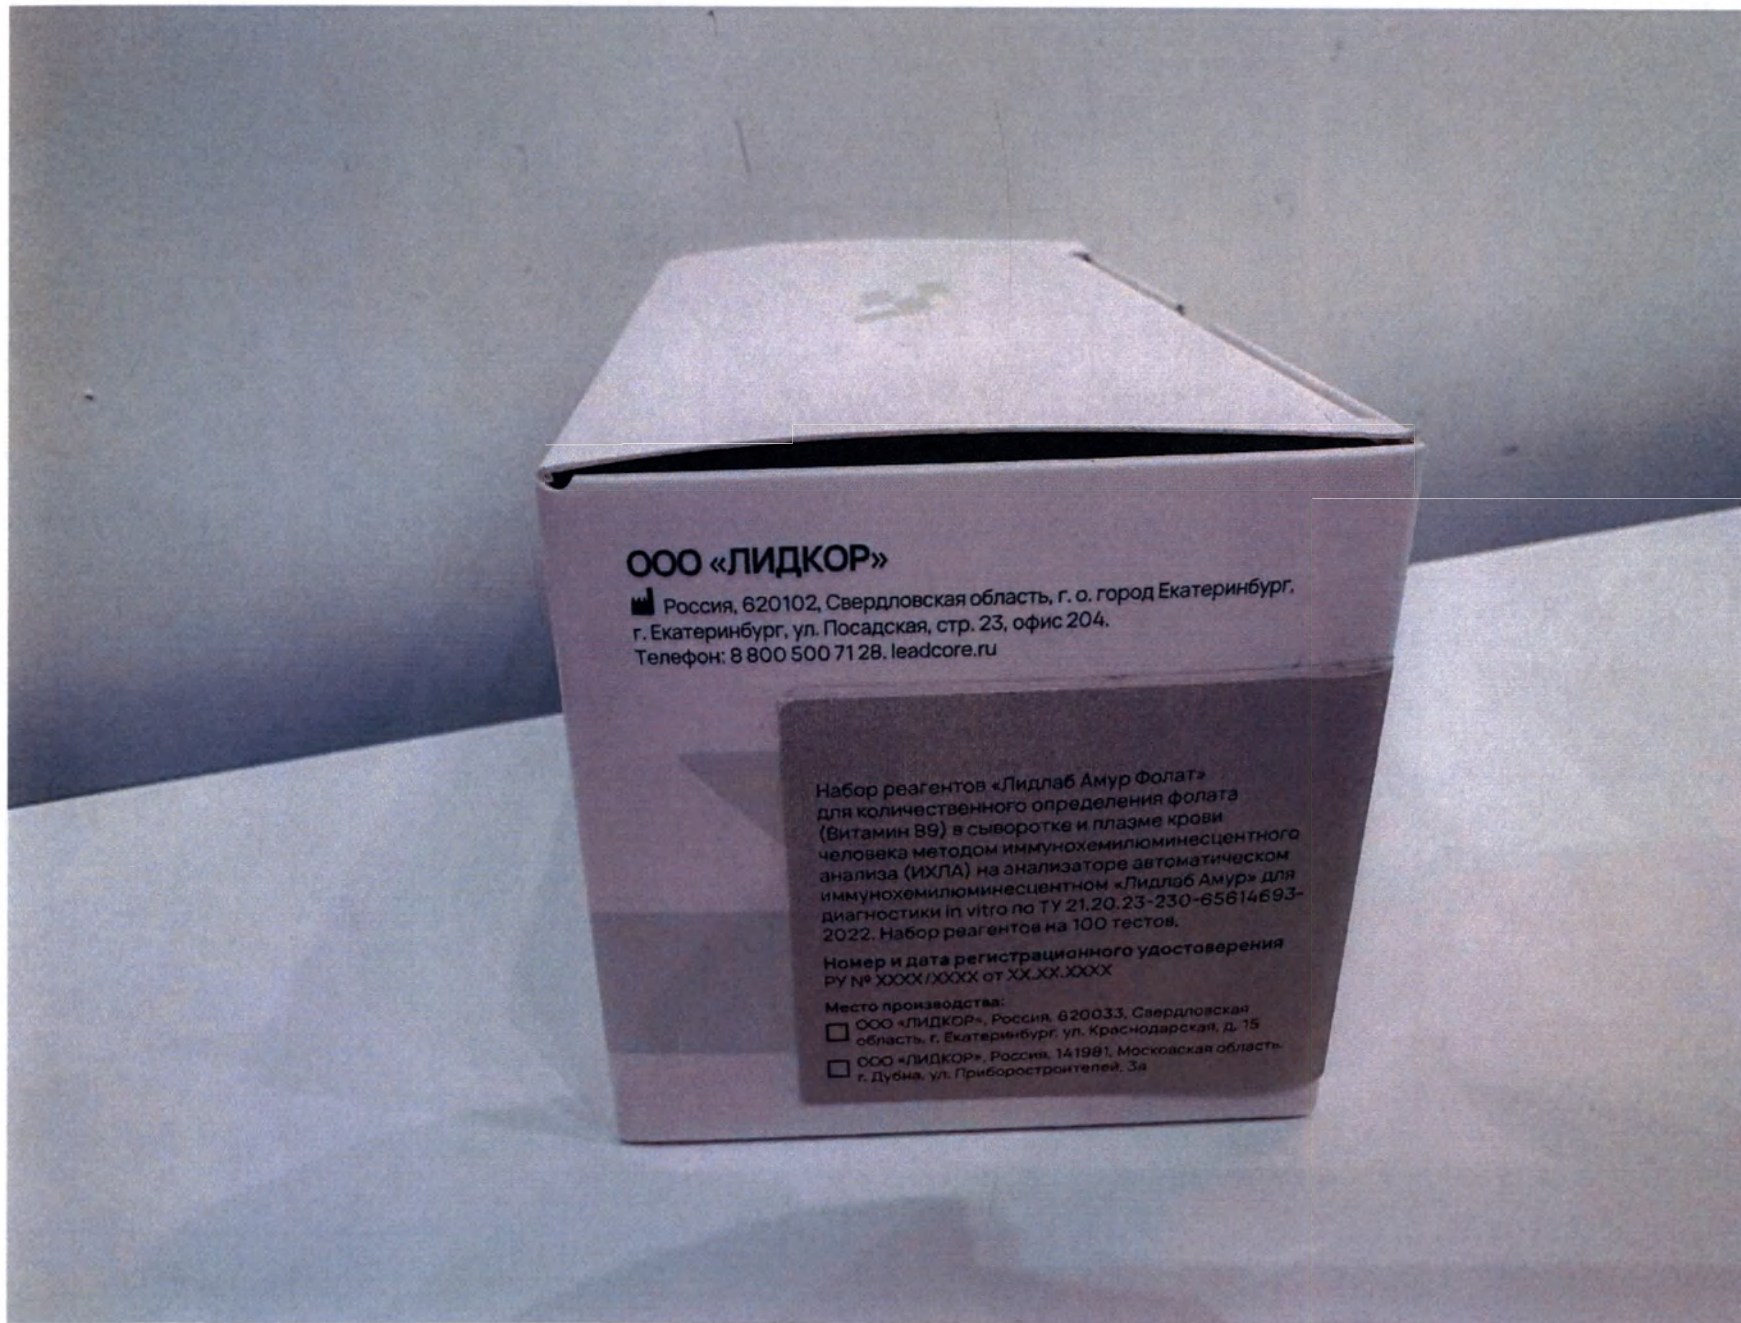

Набор реагентов на 200 тестов (вид сзади)



Набор реагентов на 200 тестов

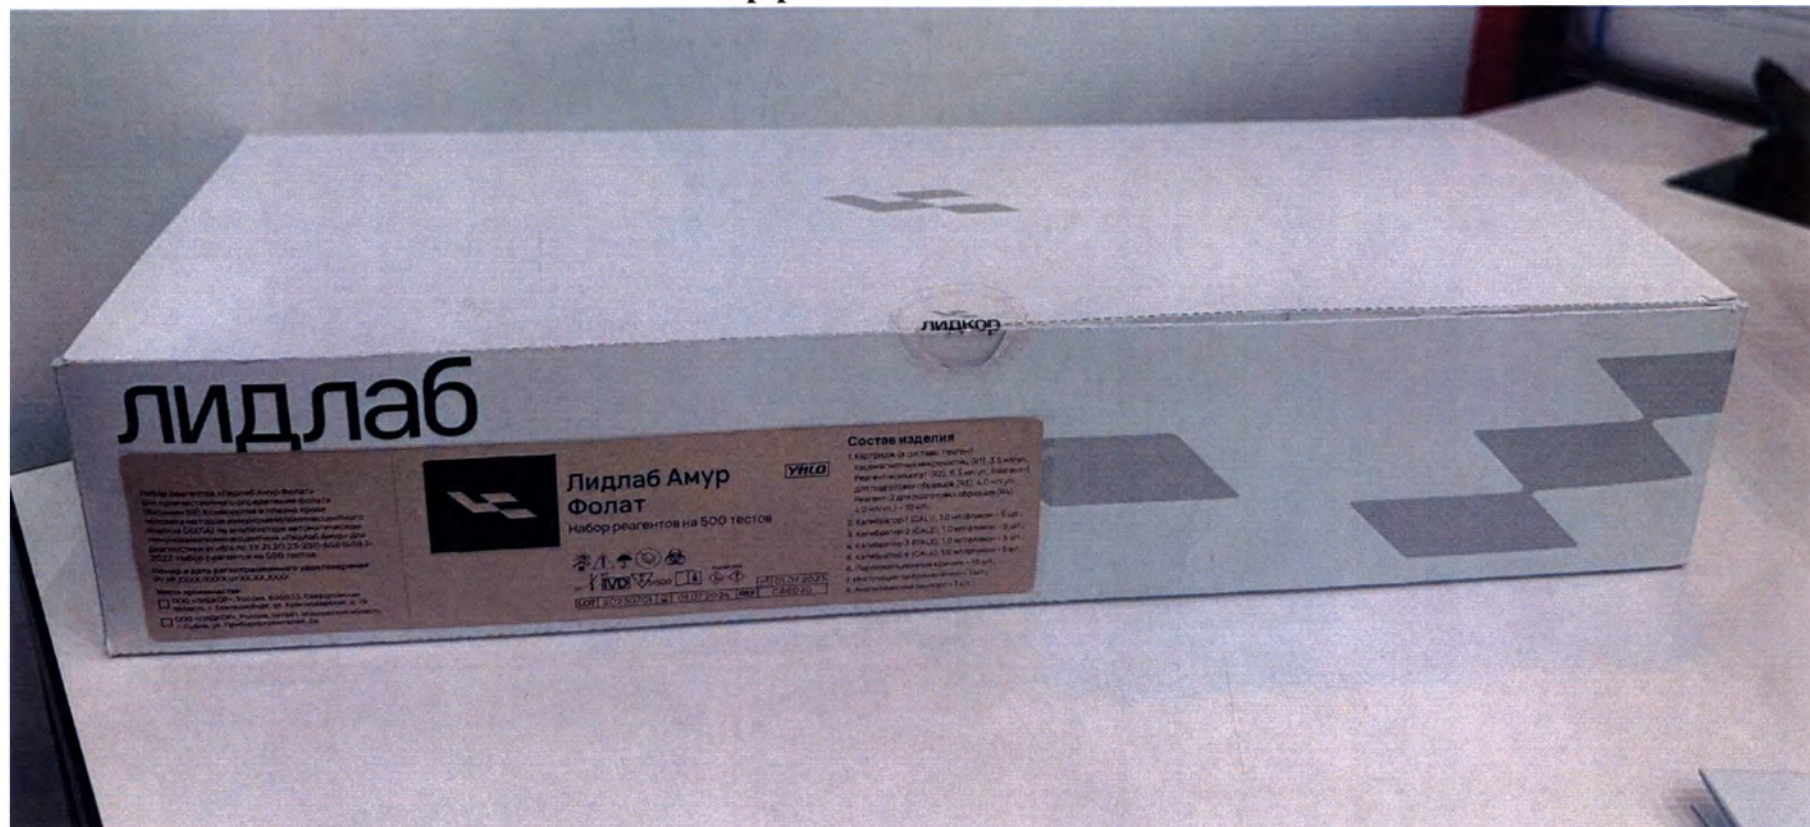

Набор реагентов на 200 тестов (вид сбоку)




Набор реагентов на 500 тестов (вид сбоку)




ООО «ЛИДКОР»


🏠 Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.
Телефон:88005007128.leadcore.ru

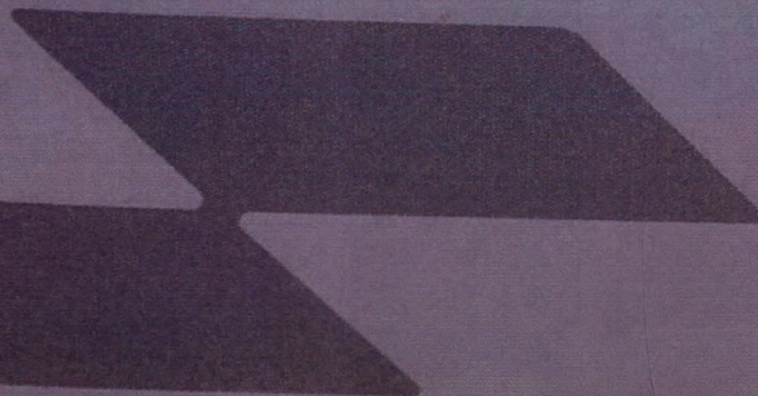

Набор реагентов на 500 тестов (вид сзади)

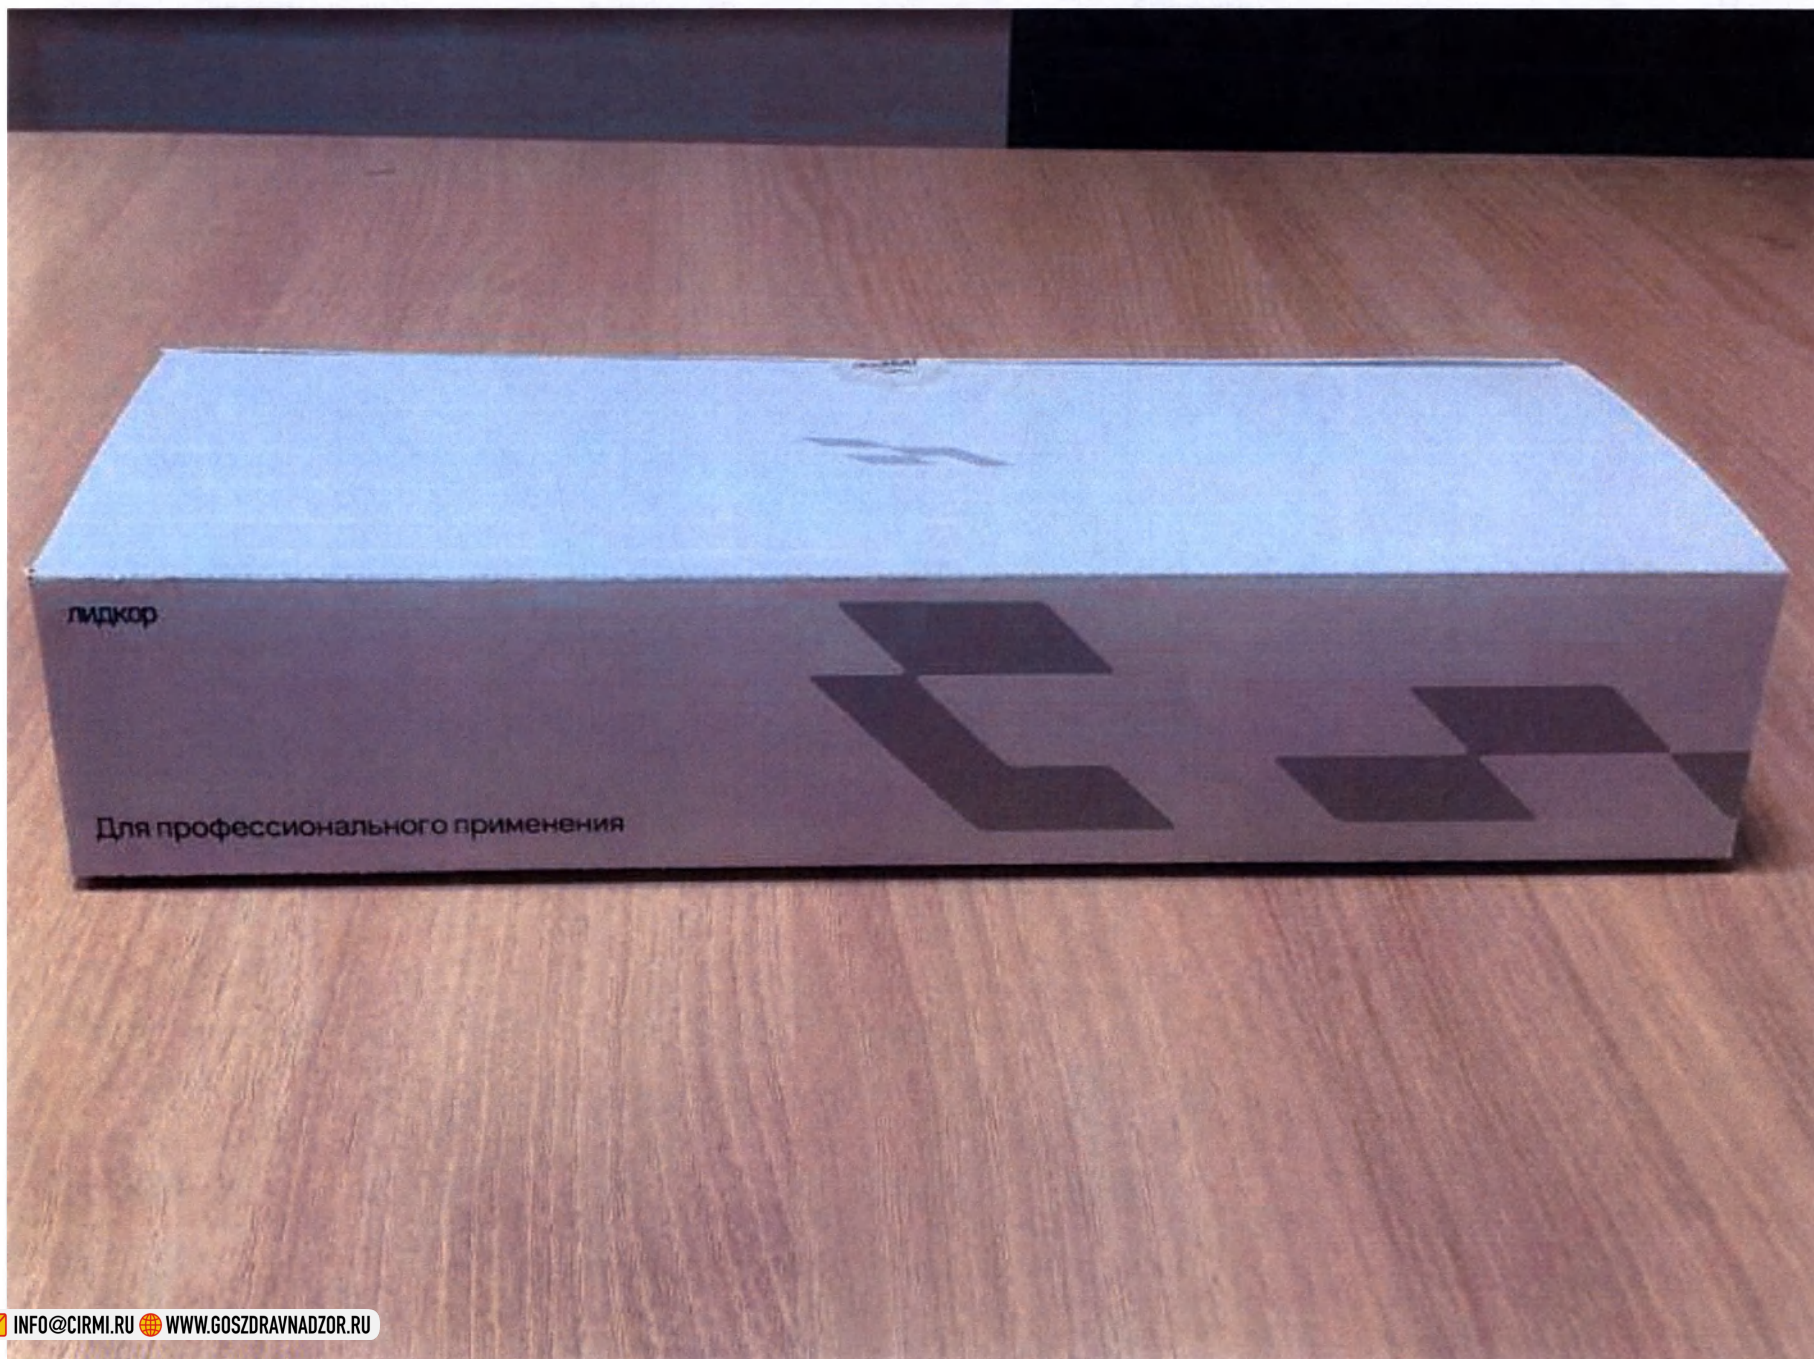

Набор реагентов на 1000 (вид сзади)

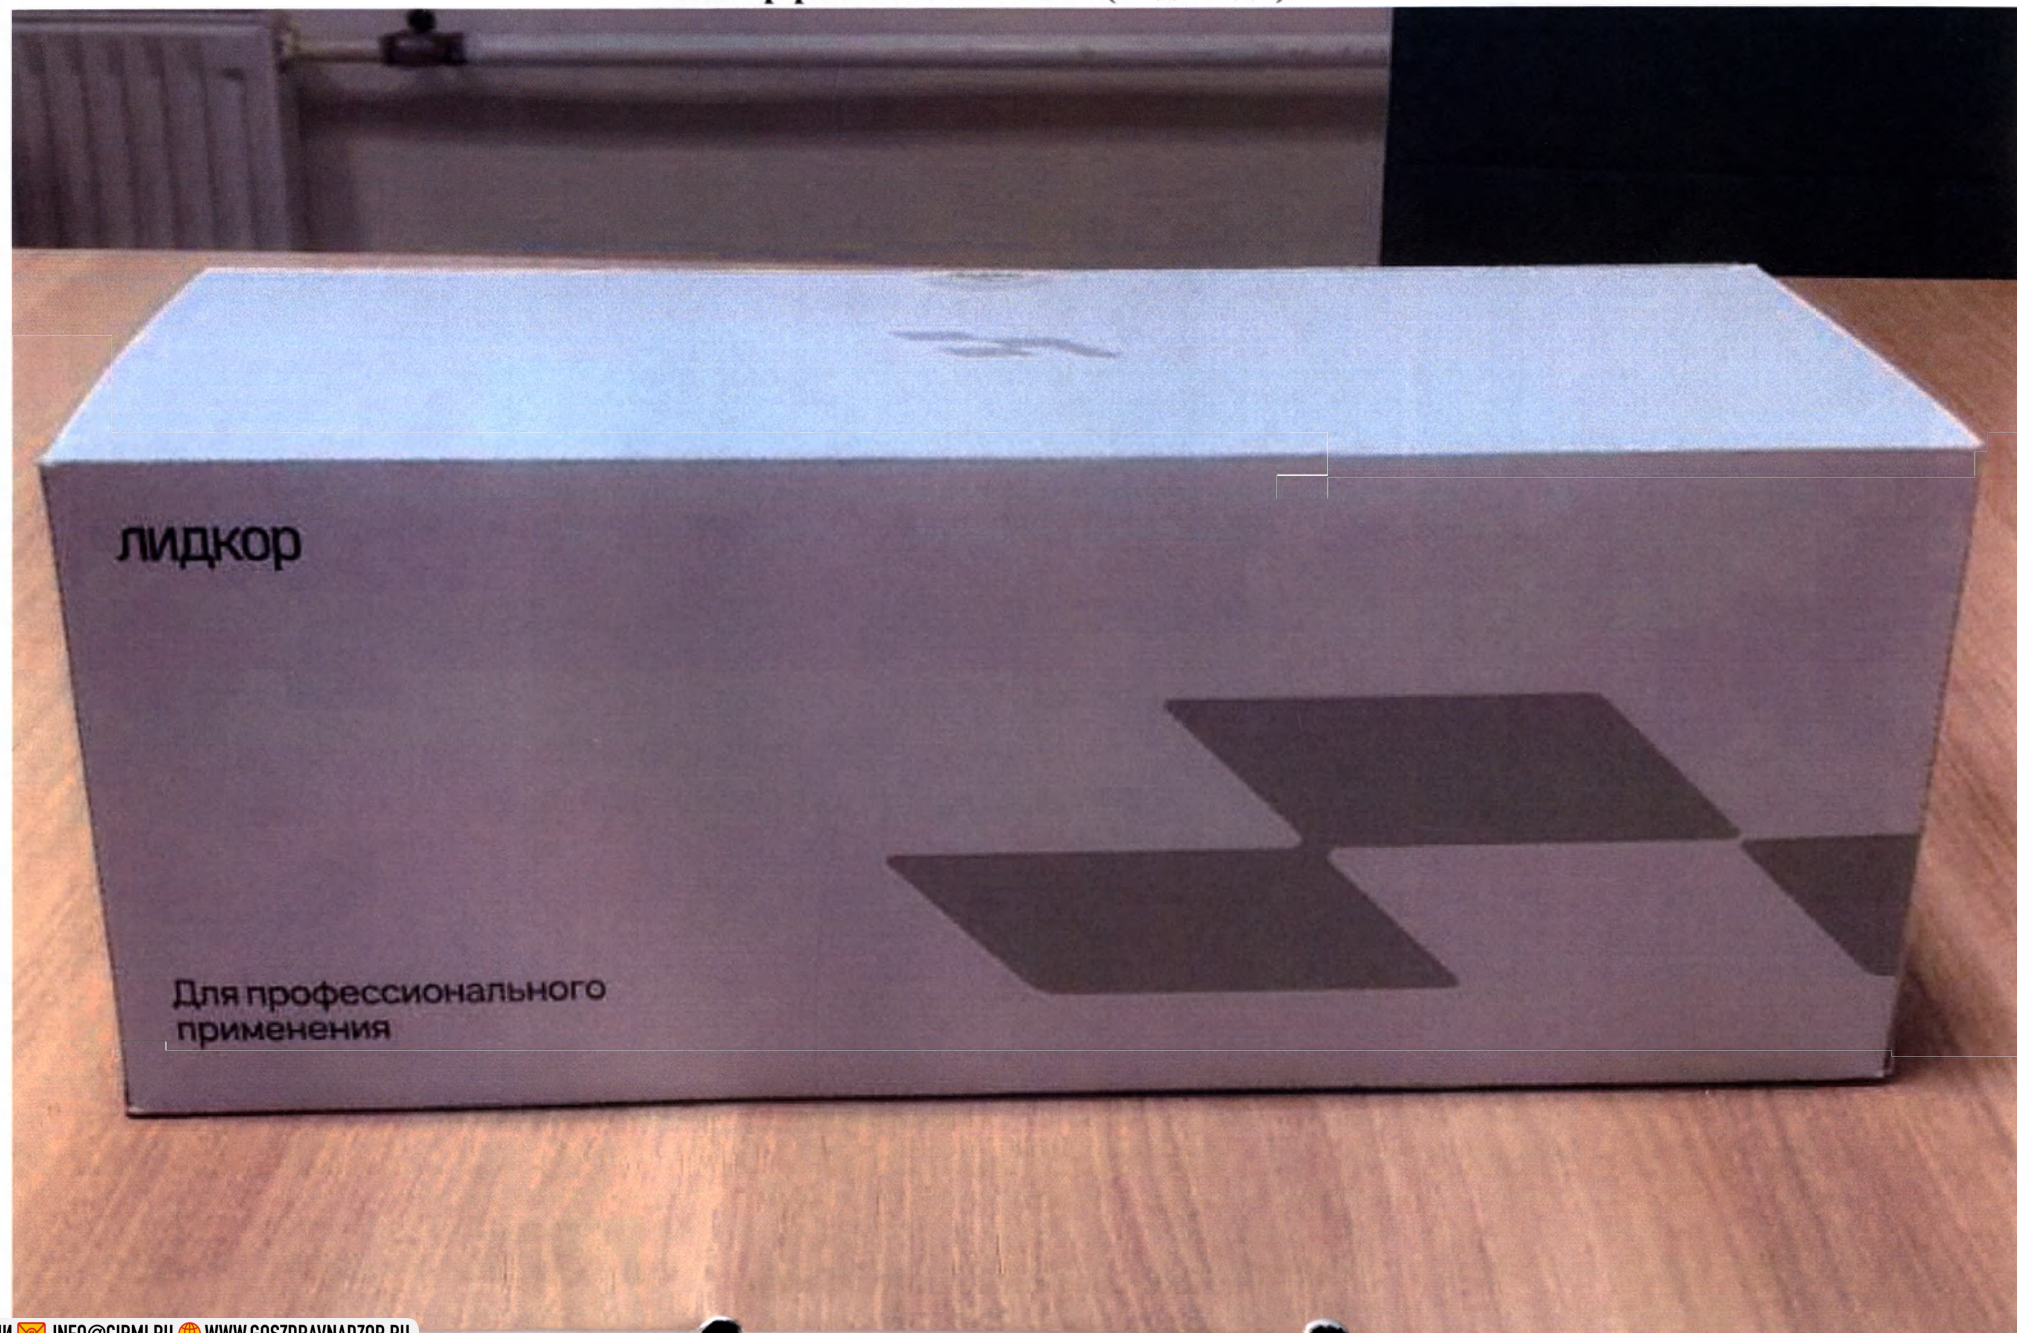

лидкор

Для профессионального
применения

Набор реагентов на 1000 тестов






Набор реагентов на 1000 тестов (вид сбоку)

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.
Телефон:88005007128.leadcore.ru

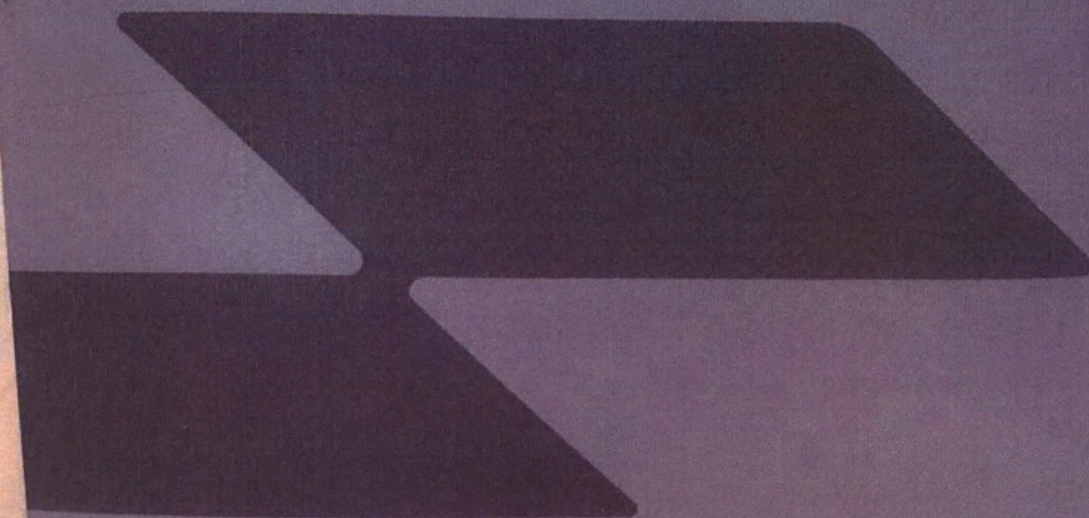

Транспортная упаковка



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
12 двенадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
Е. Ю. Гохгут /Е. Ю. Гохгут/