


Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015


Комплектация 1

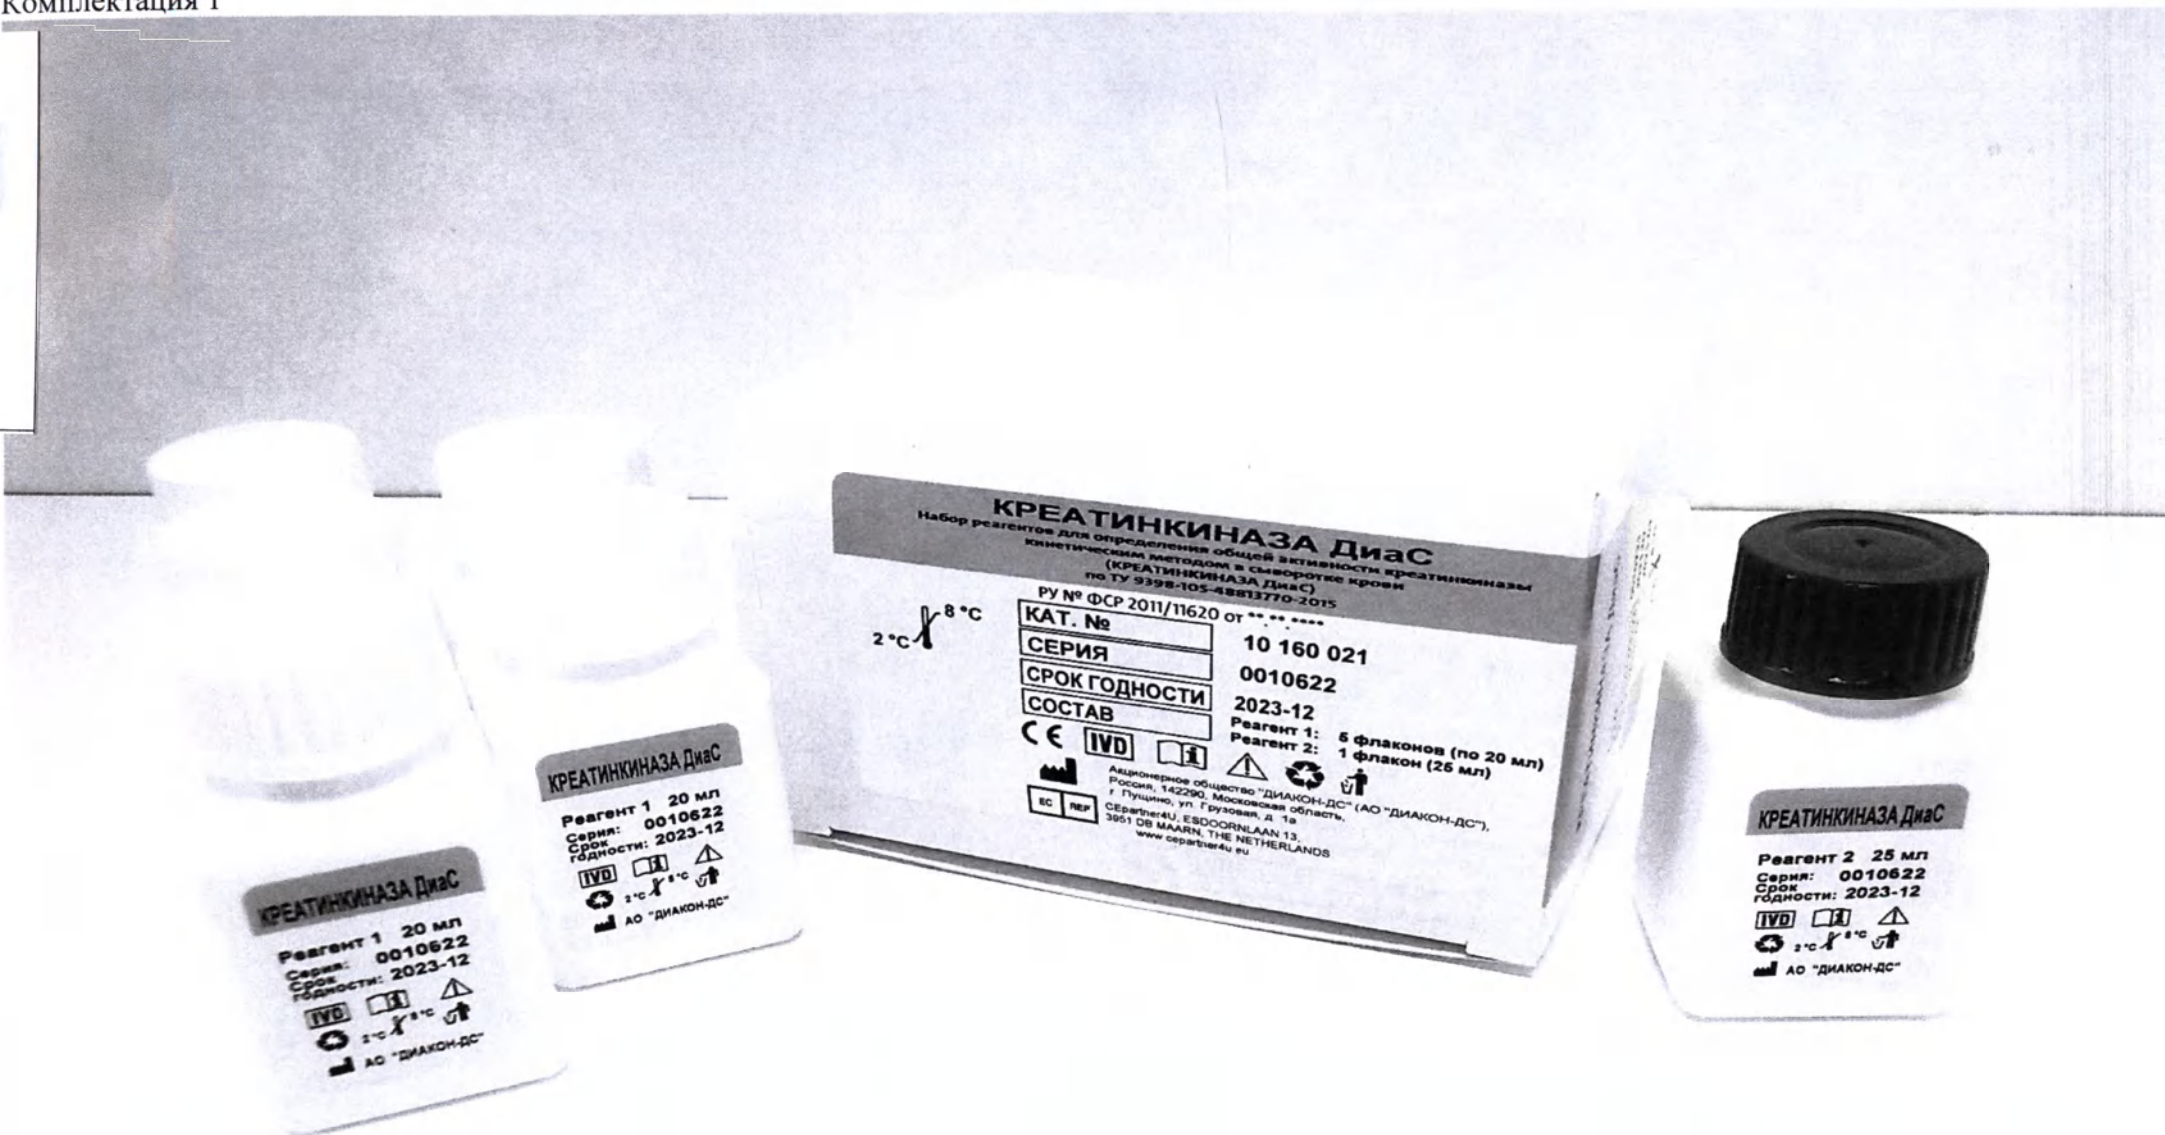

Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 2

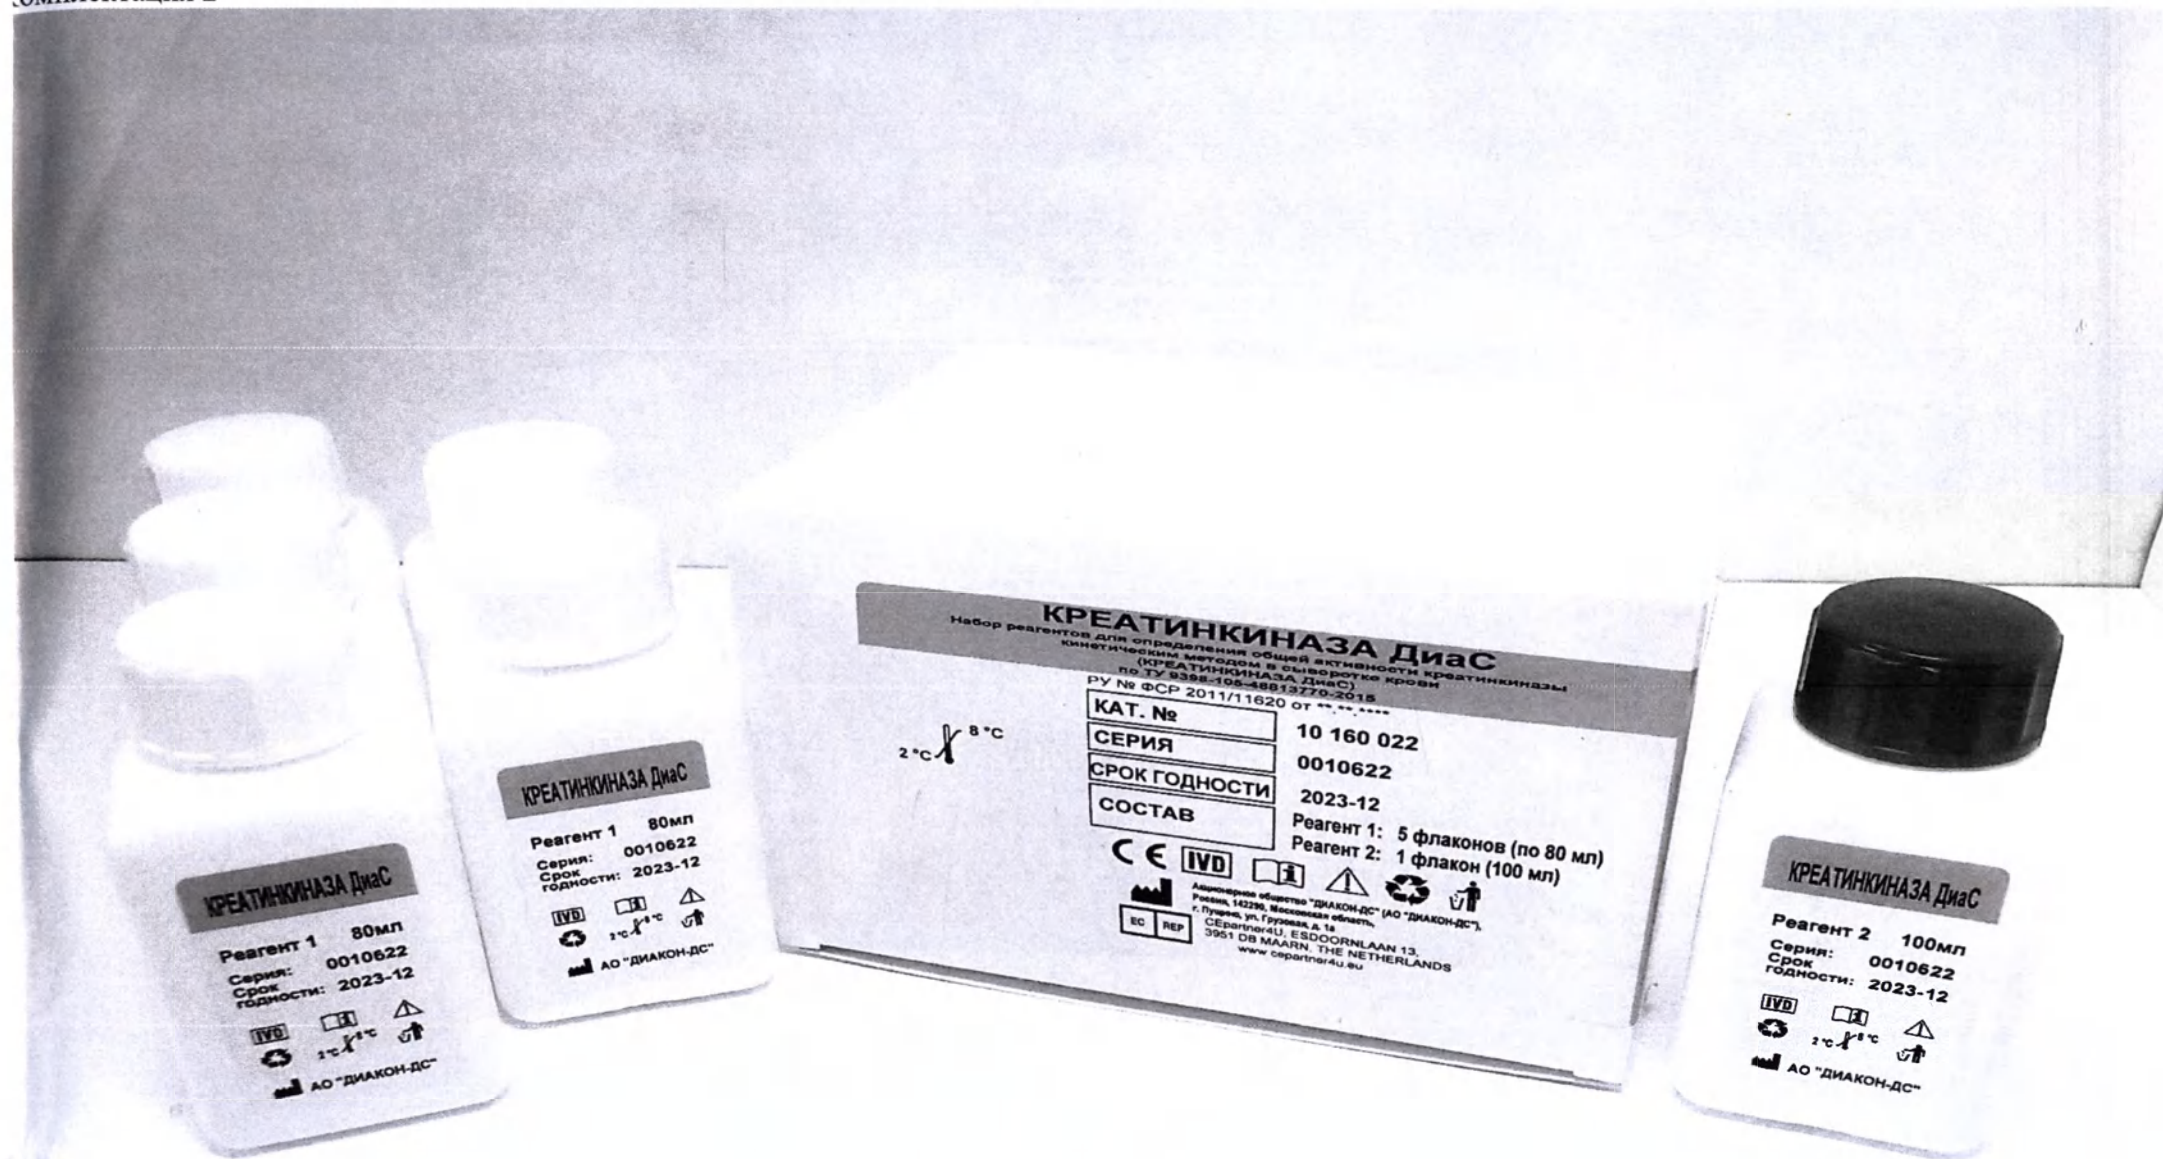


Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови (КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Омплектация 3




Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Омуплектация 4

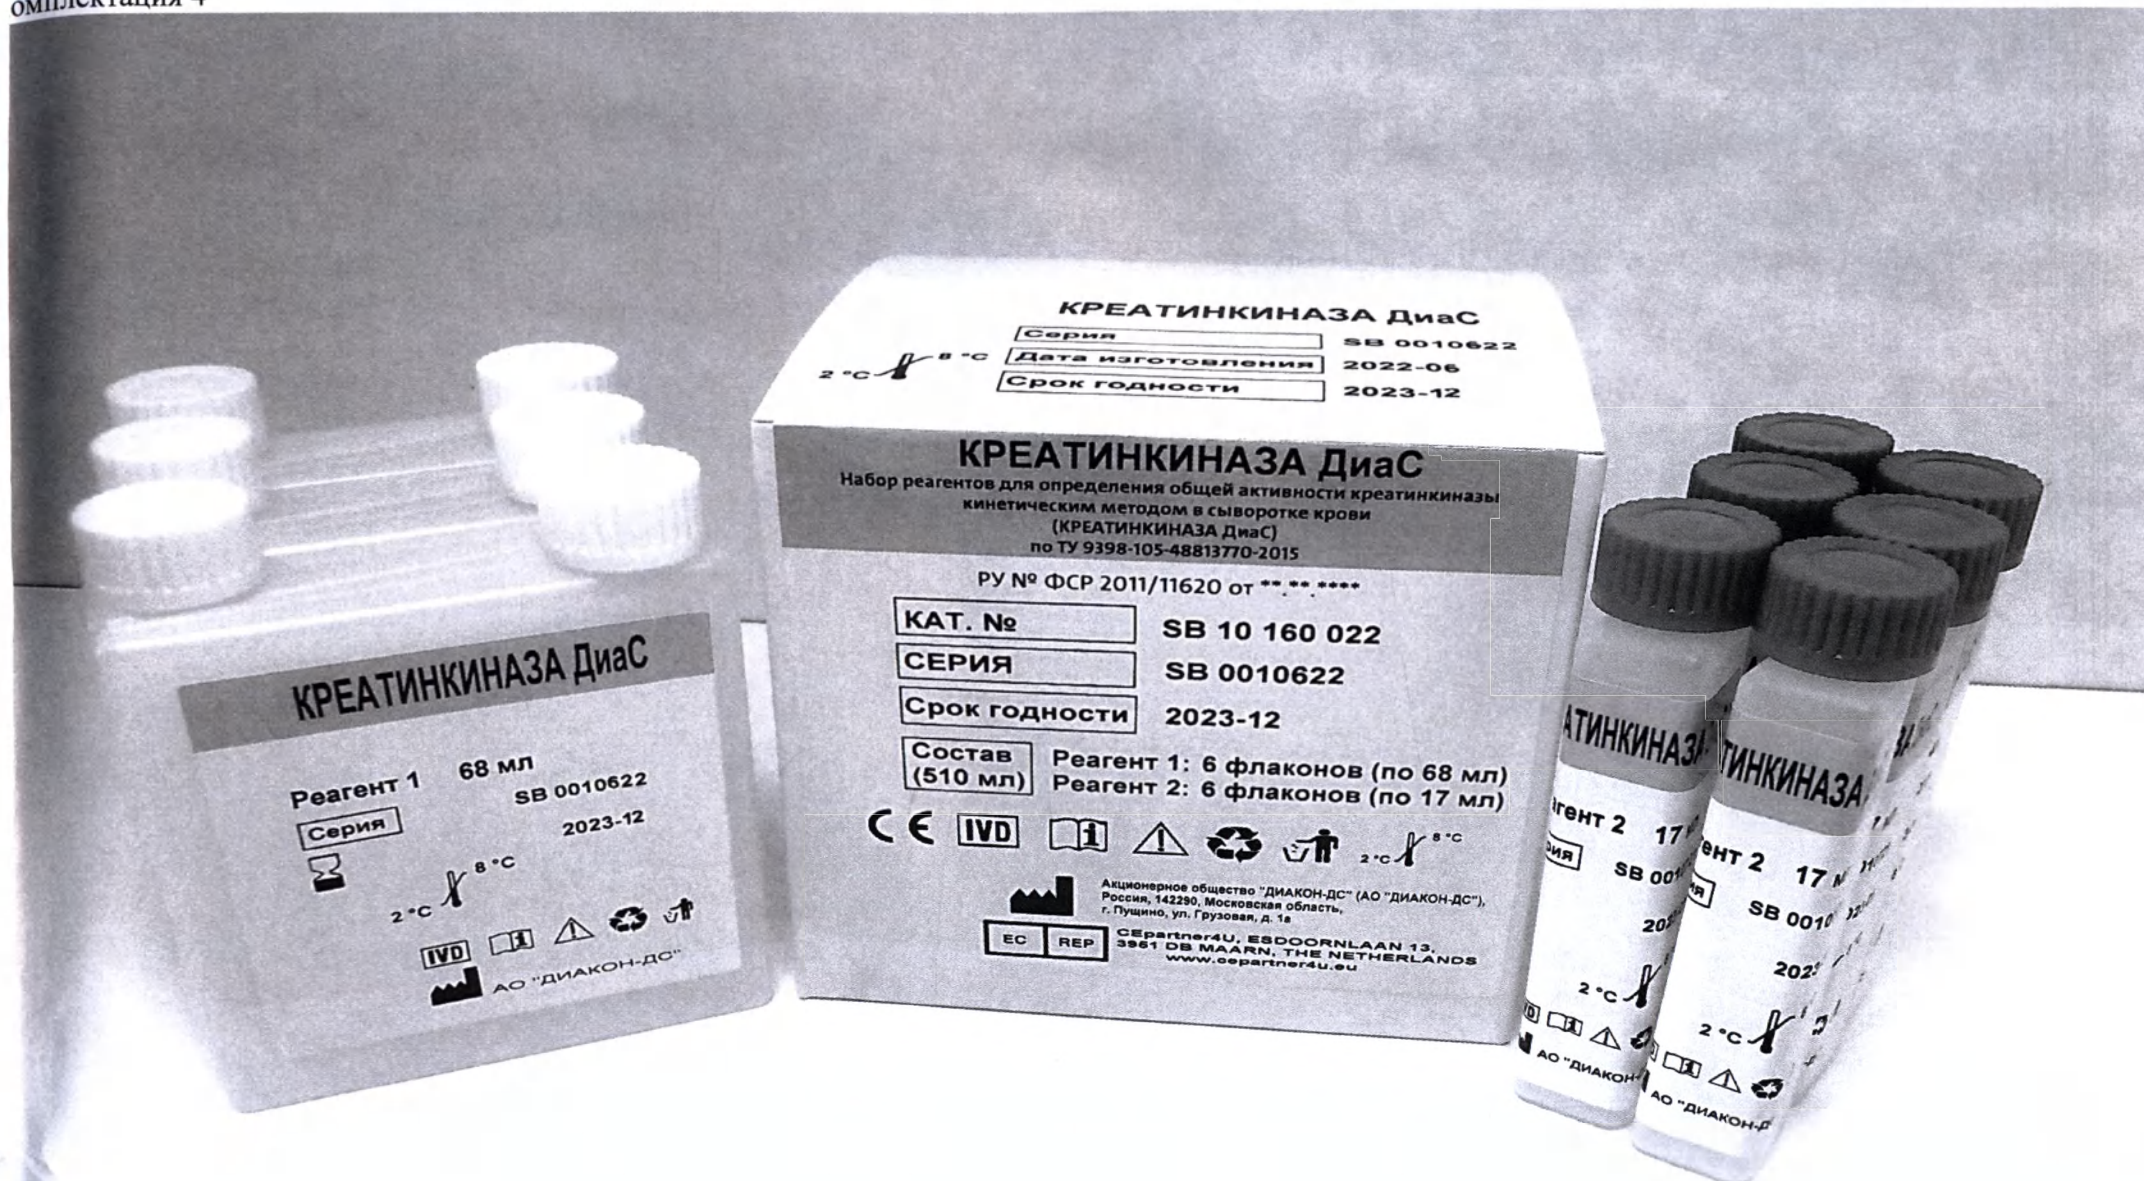

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015


Комплектация 5

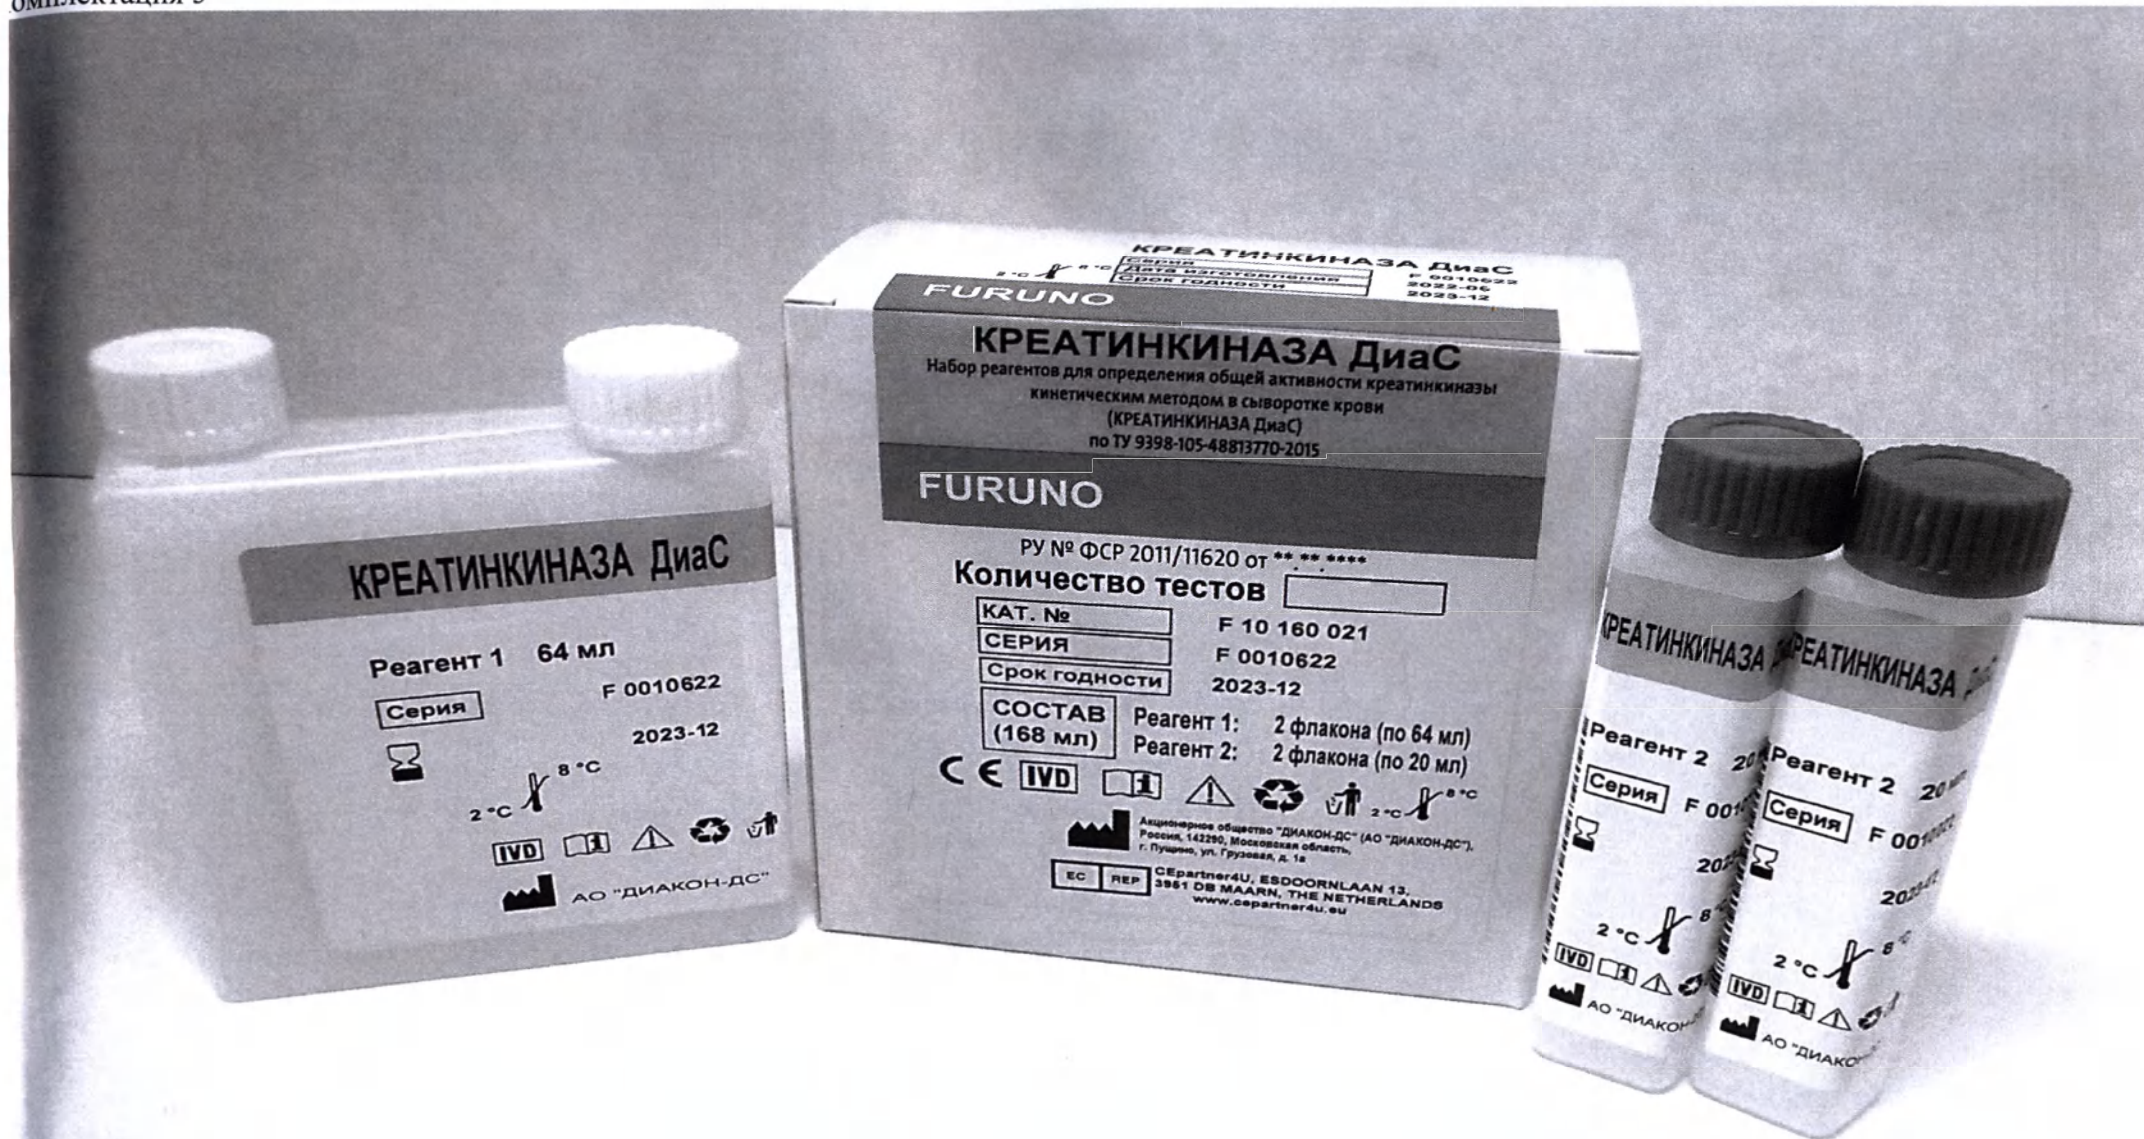

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Омплектация 6



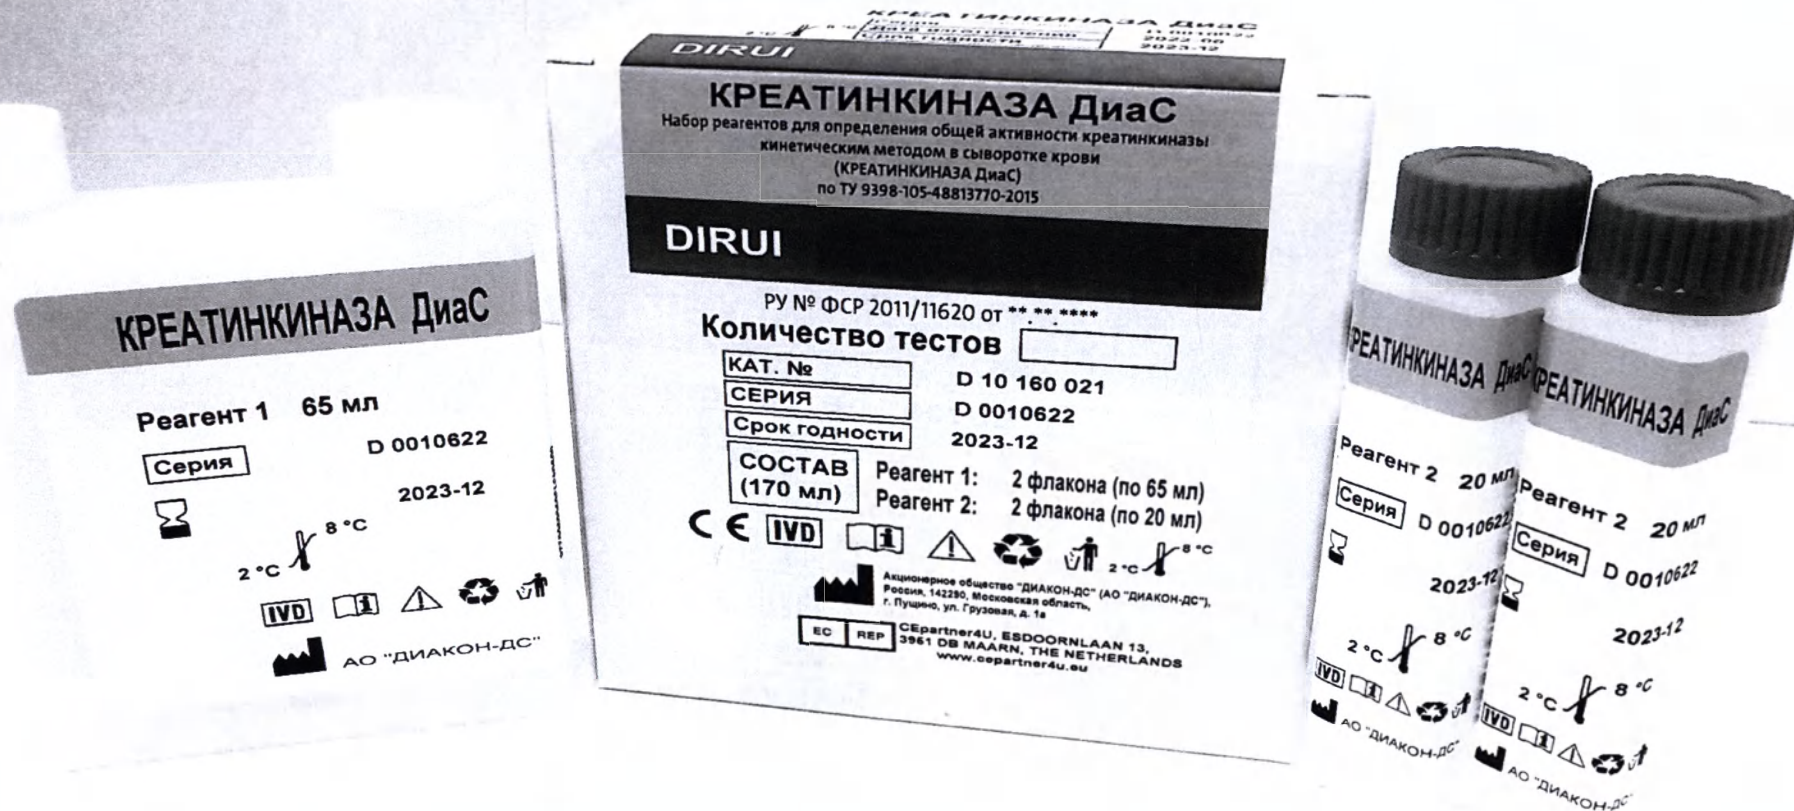

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015


Комплектация 8



Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 9

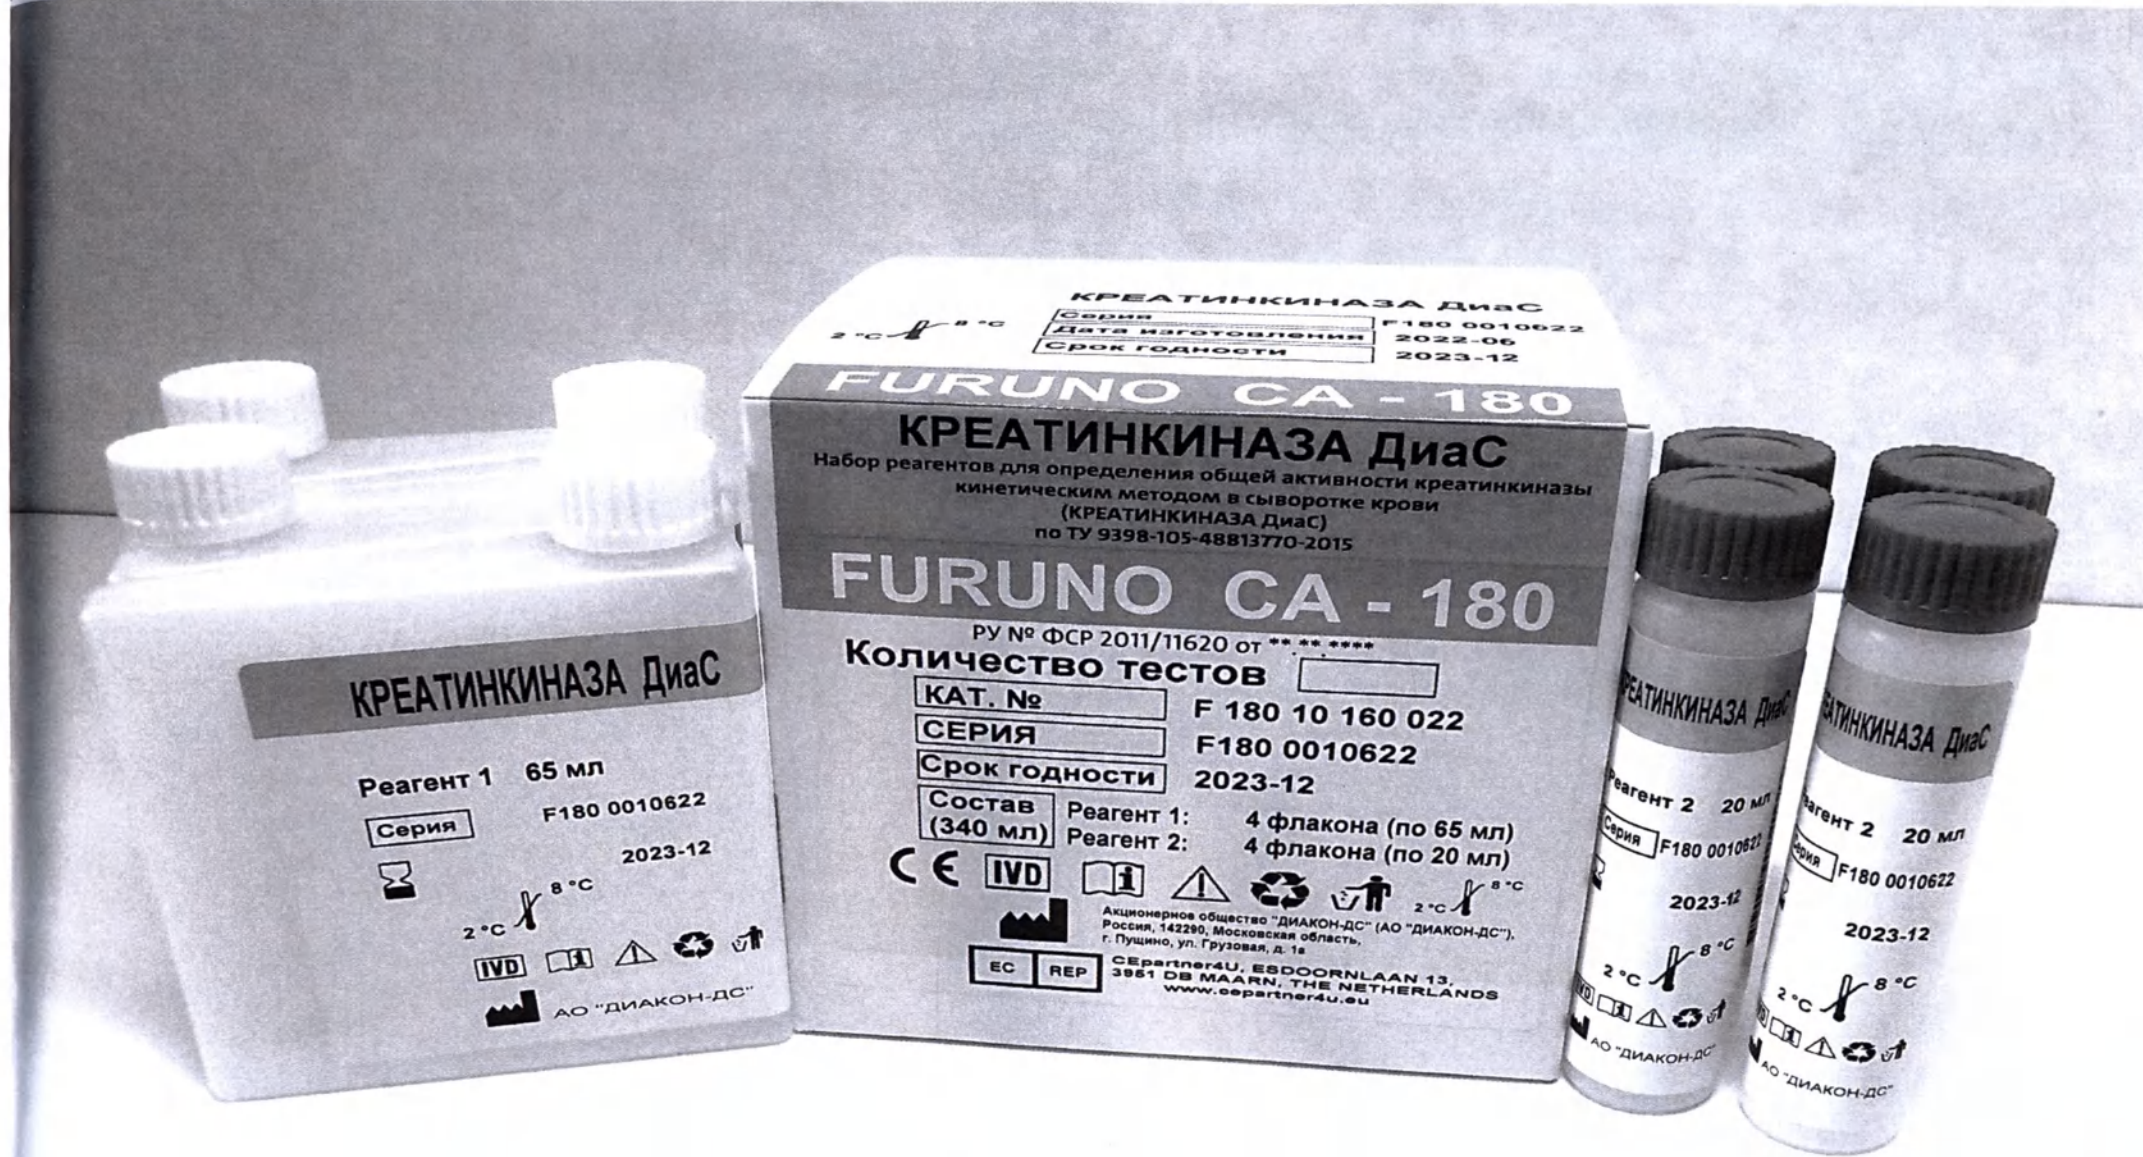

Внешний вид
Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015


Комплектация 10



Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015


Комплектация 11 (1)

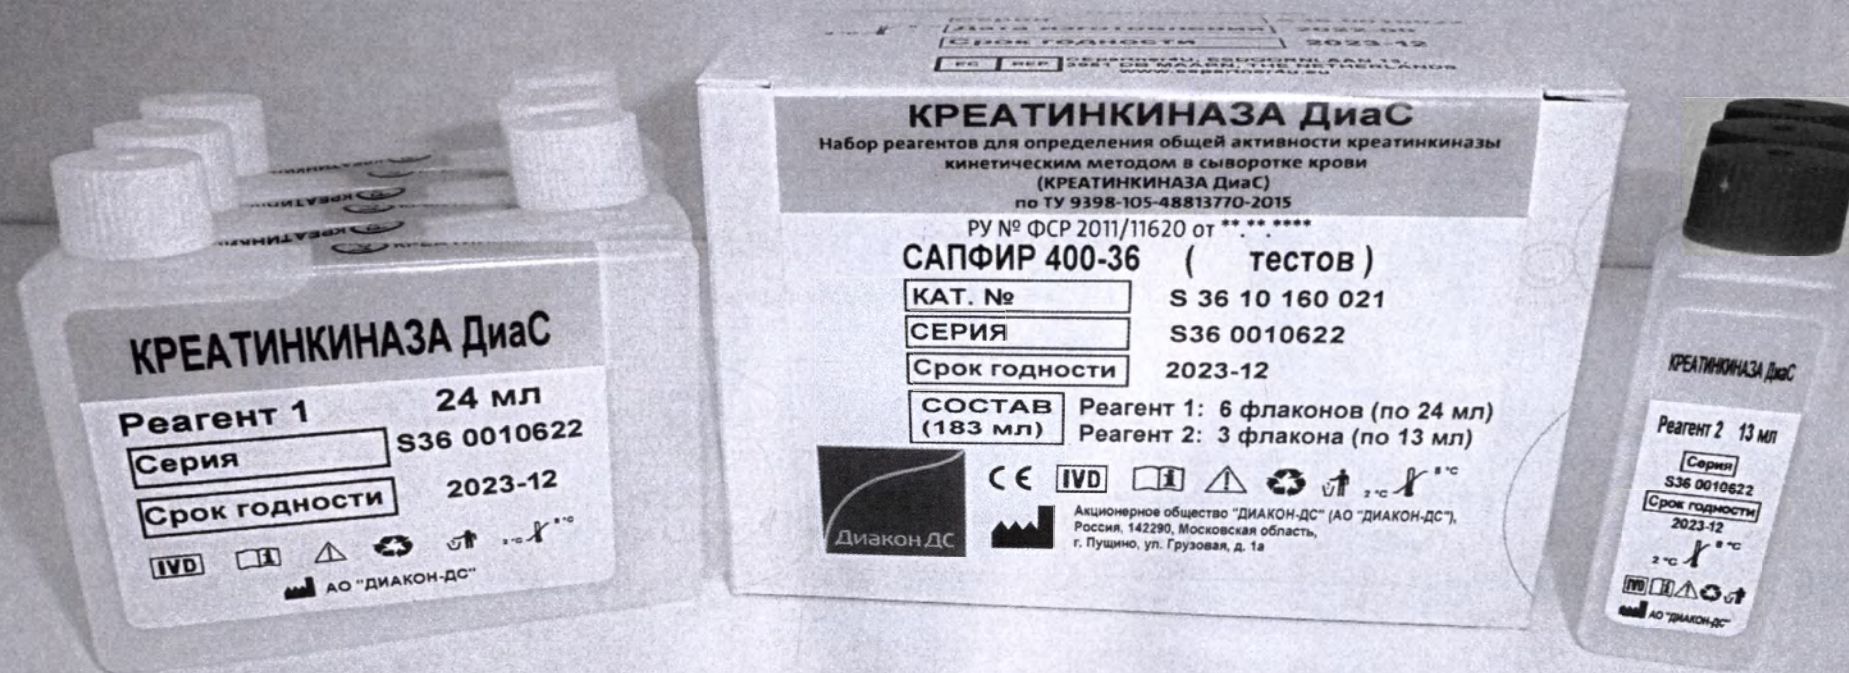

Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015


Комплектация 11 (2)

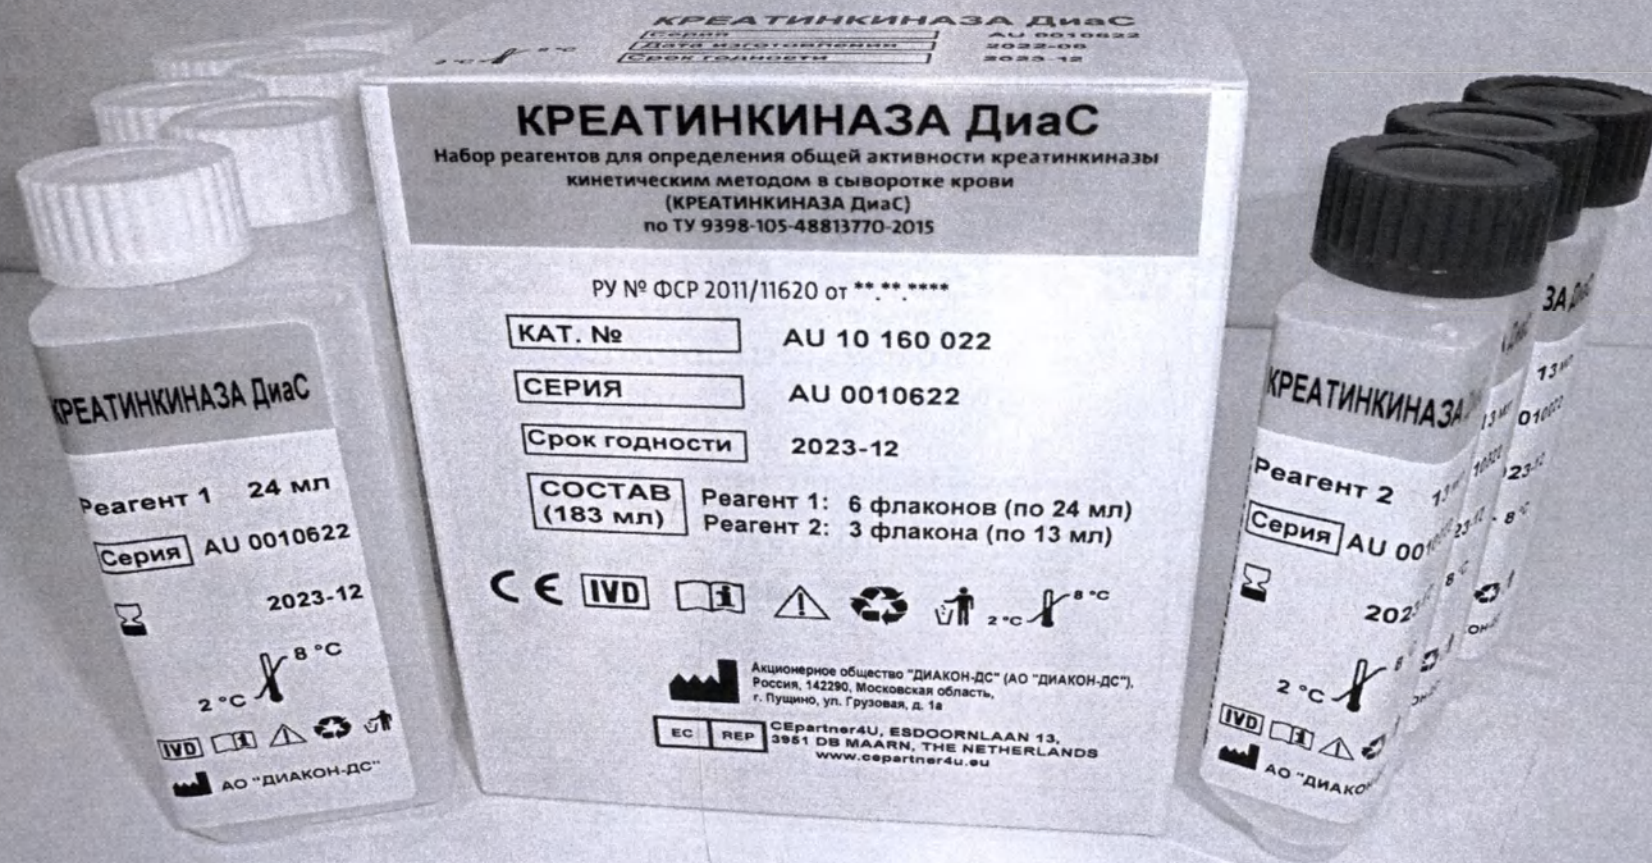


Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 12

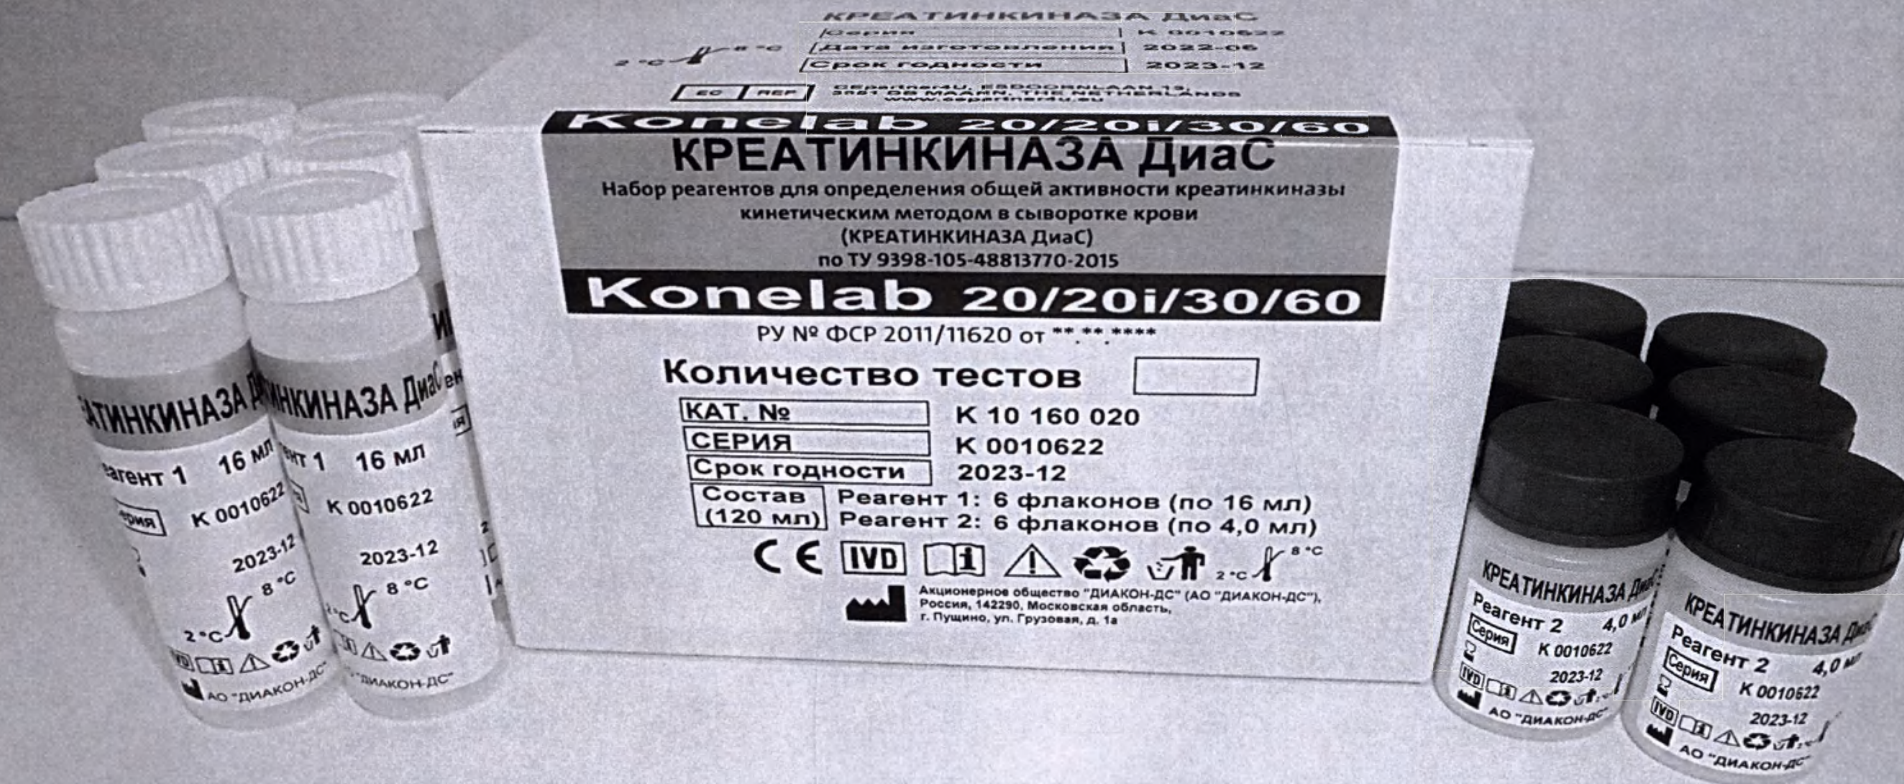

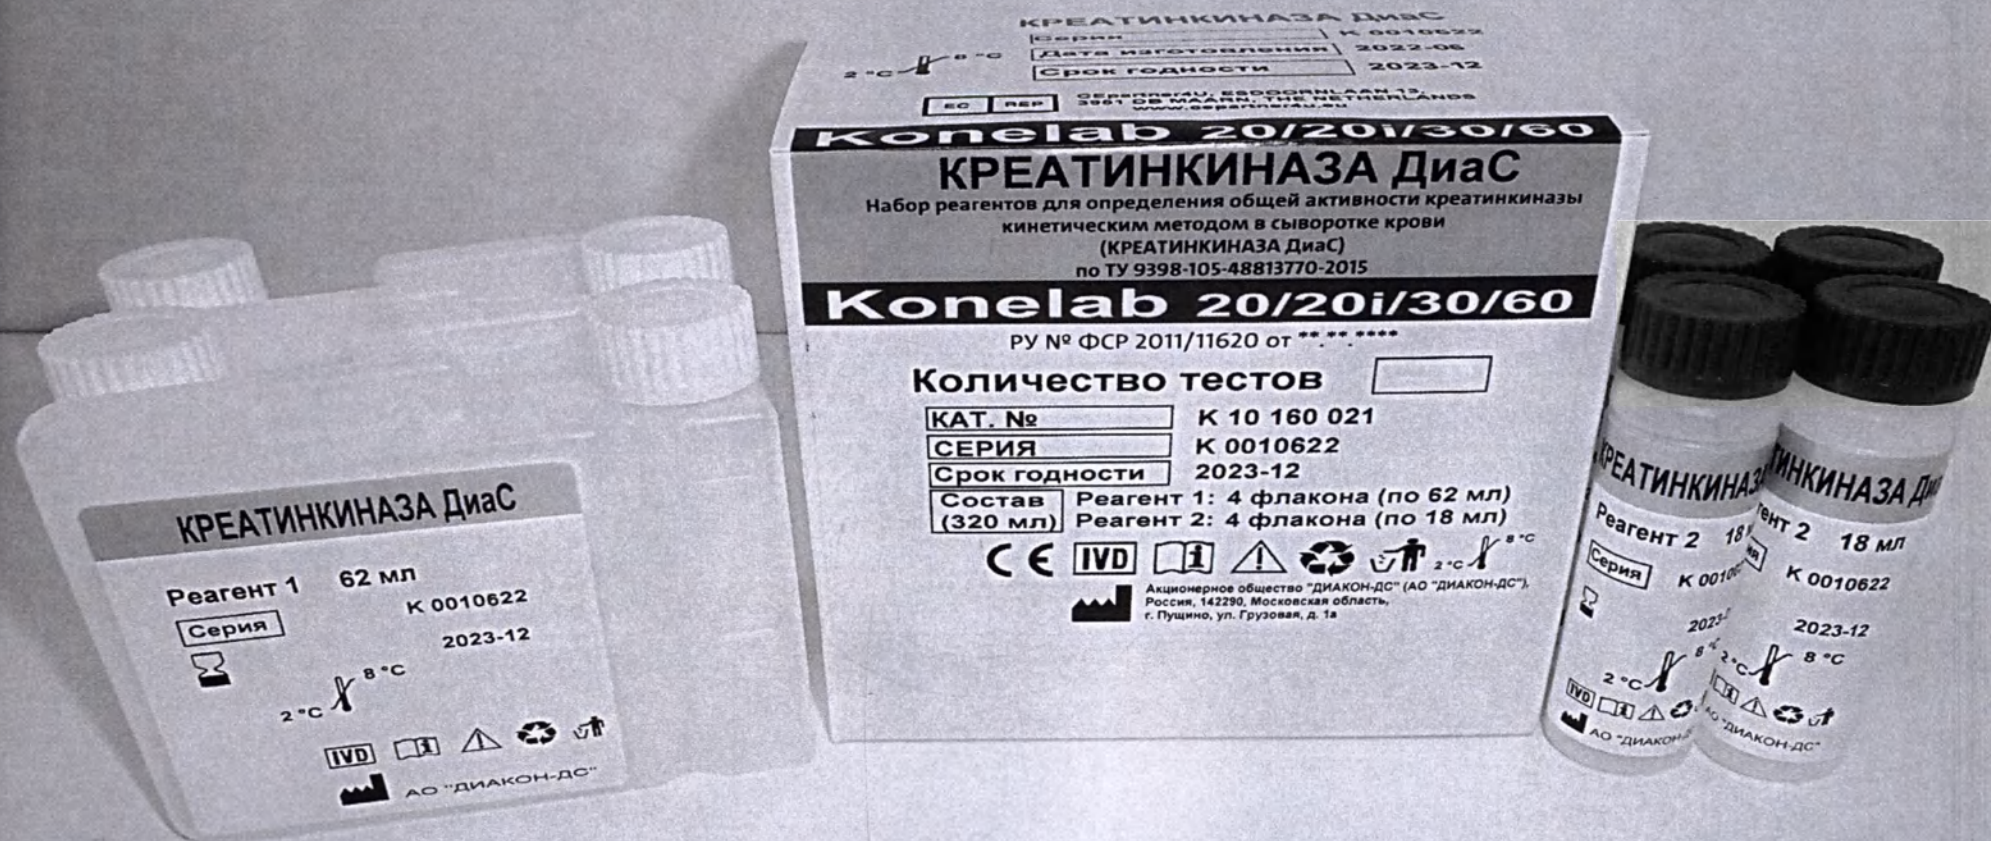


Внешний вид

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015




Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015


Комплектация 15

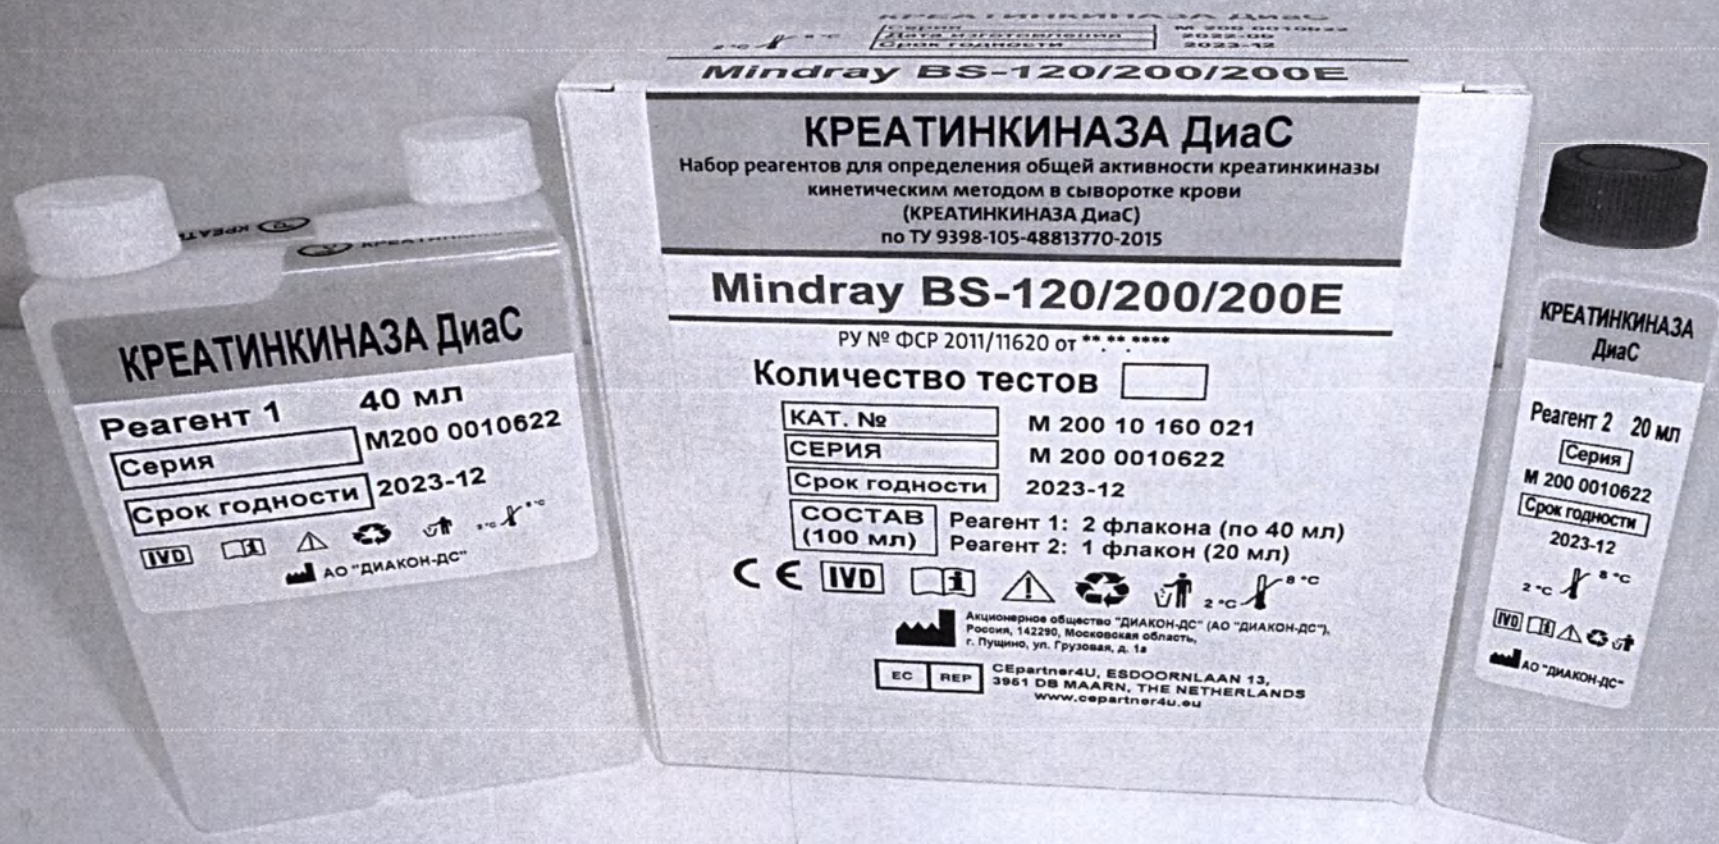


Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 16

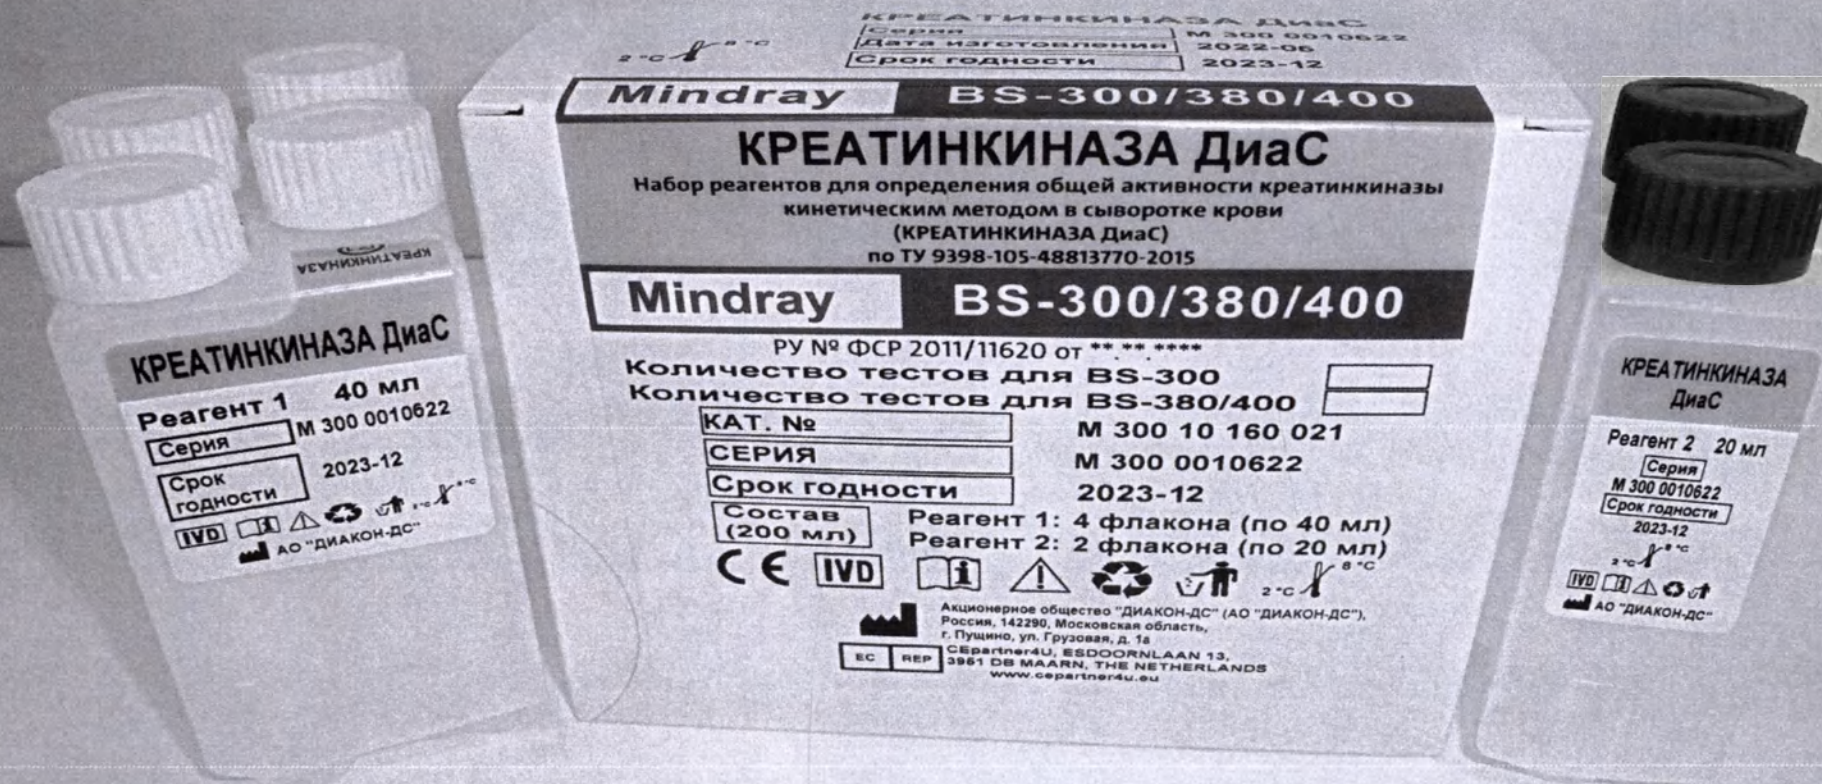

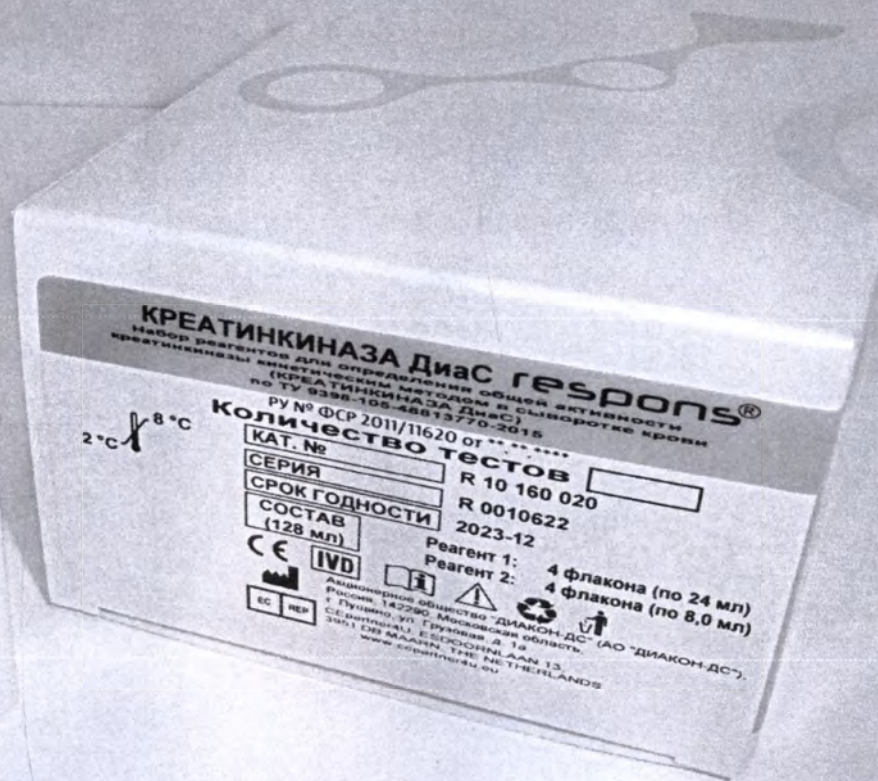

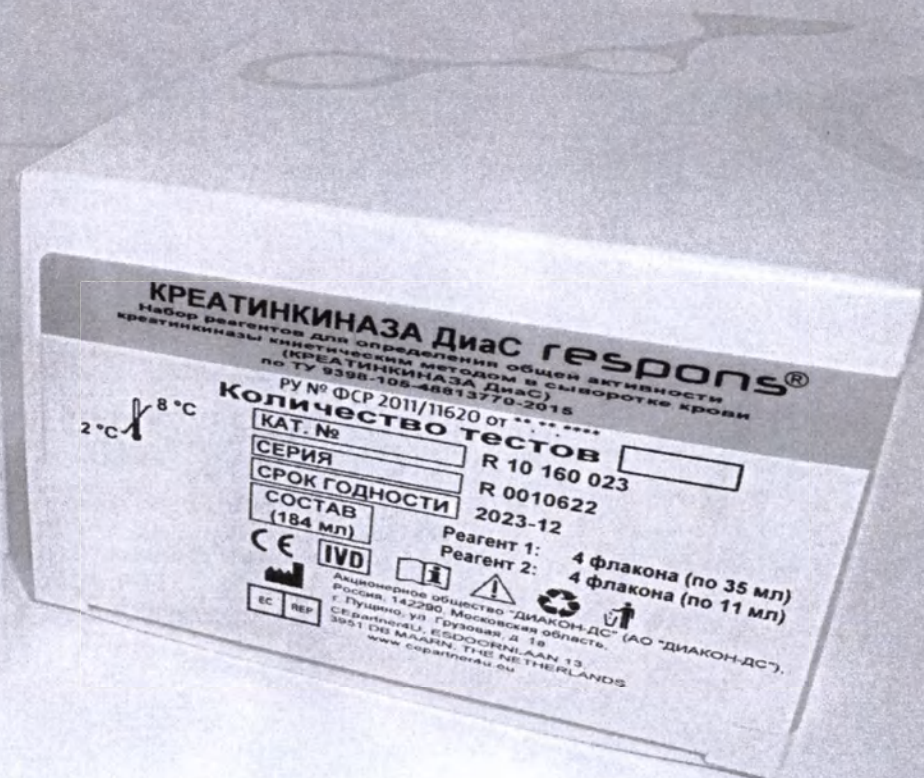




Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 20



Внешний вид
Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 21

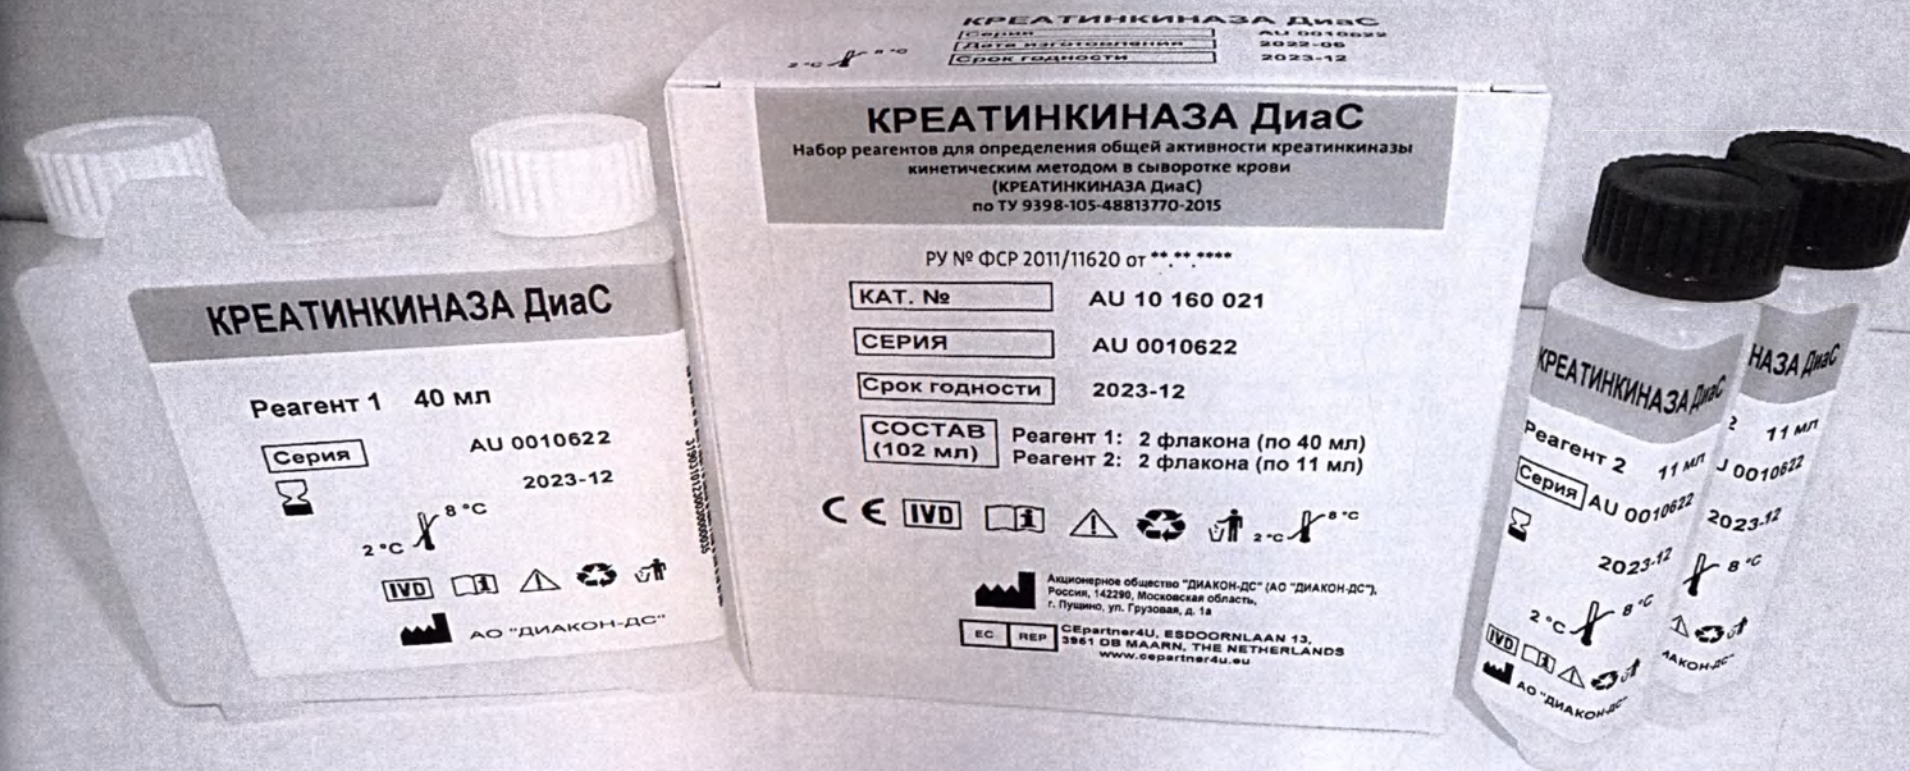

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови (КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 22

КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС

Серия	AU 0010622
Дата изготовления	2023-06
Срок годности	2023-12


КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови (КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

РУ № ФСР 2011/11620 от *** **



КАТ. №	*** **
СЕРИЯ	AU 0010622
Срок годности	2023-12

Состав	Реагент 1: 10 флаконов (по 39 мл) (520 мл) Реагент 2: 10 флаконов (по 13 мл)
--------	---




Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

CE partner4U, ESDOORNLAAN 13,
3551 DB MAAK, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.eu

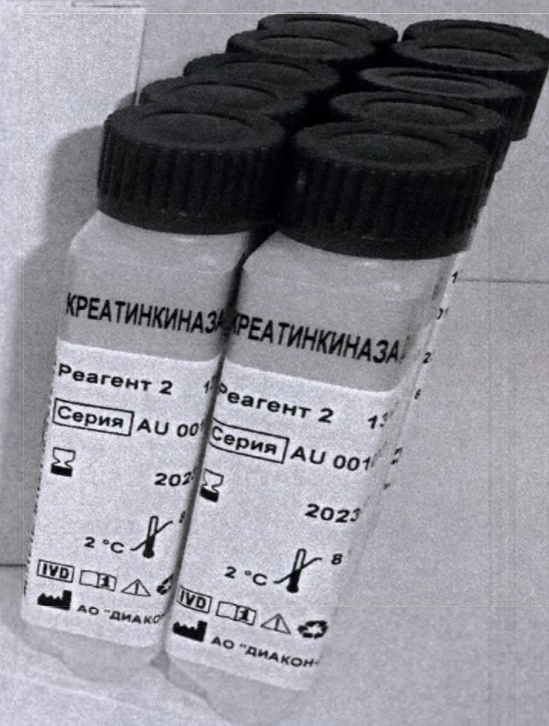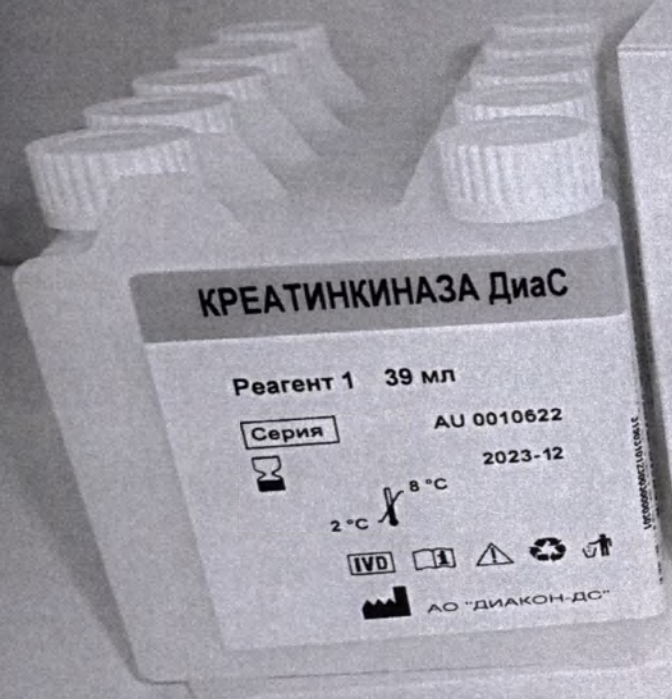

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови (КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 23

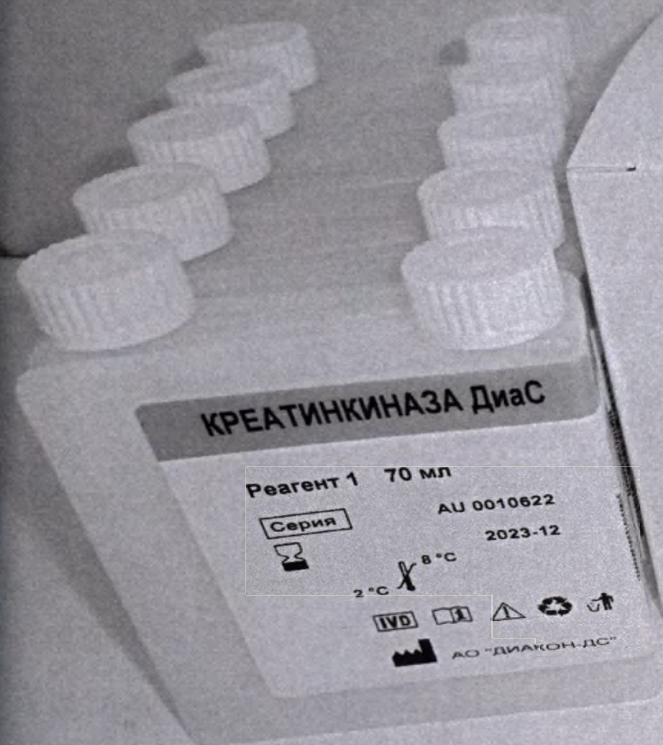

КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС	
Серия	AU 0010622
Дата изготовления	2022-06
Срок годности	2023-12

КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС
Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови (КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

ПУ № ФСР 2011/11620 от ** ** *

КАТ. №	** ** *
СЕРИЯ	AU 0010622
Срок годности	2023-12
Состав	Реагент 1: 10 флаконов (по 70 мл) Реагент 2: 10 флаконов (по 21 мл)




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС"),
Россия, 142290, Московская область,
г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а
ООО "ДИПЛАМАТ" ES DOORNLAAN 13,
3961 DB MAAK, THE NETHERLANDS
www.espartner.ru



Внешний вид
Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови
(КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Омплектация 24

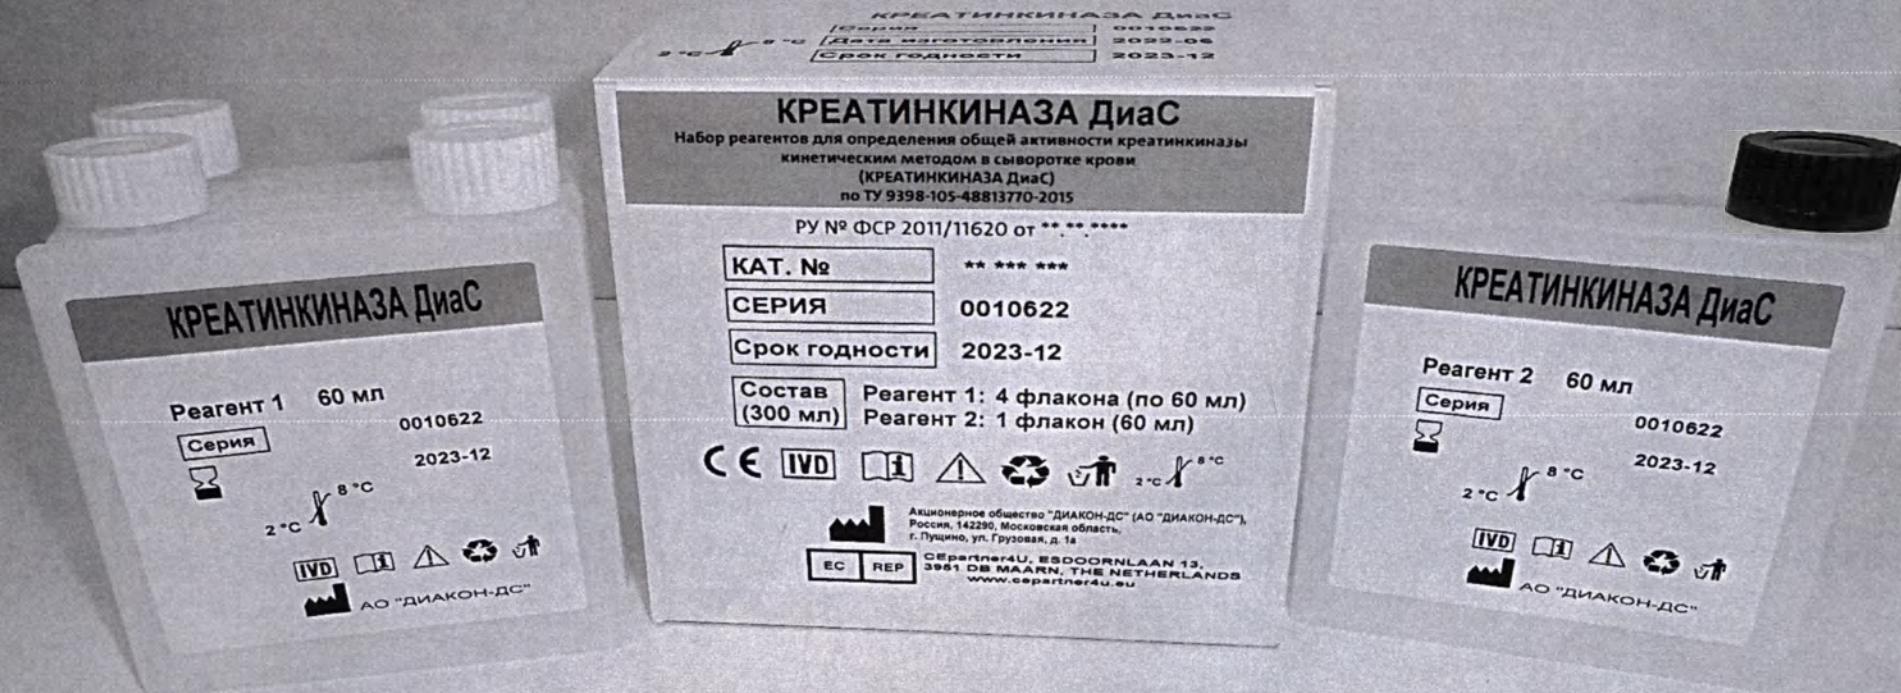

Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы кинетическим методом в сыворотке крови (КРЕАТИНКИНАЗА ДиаС) по ТУ 9398-105-48813770-2015

Комплектация 25





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 26
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»

Т.Ю. Корзун