

Фотографические изображения медицинского изделия

Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель по нормативному регулированию

ООО «ФИЛИПС»

"ФИЛИПС"


Д.В.Горкуша

« 29 » нояб 2022 г.

I. Базовый состав: 1. Совместимое устройство с операционной системой Android или iOS—представлен пример совместимого устройства



2. Программное обеспечение на виртуальном носителе.

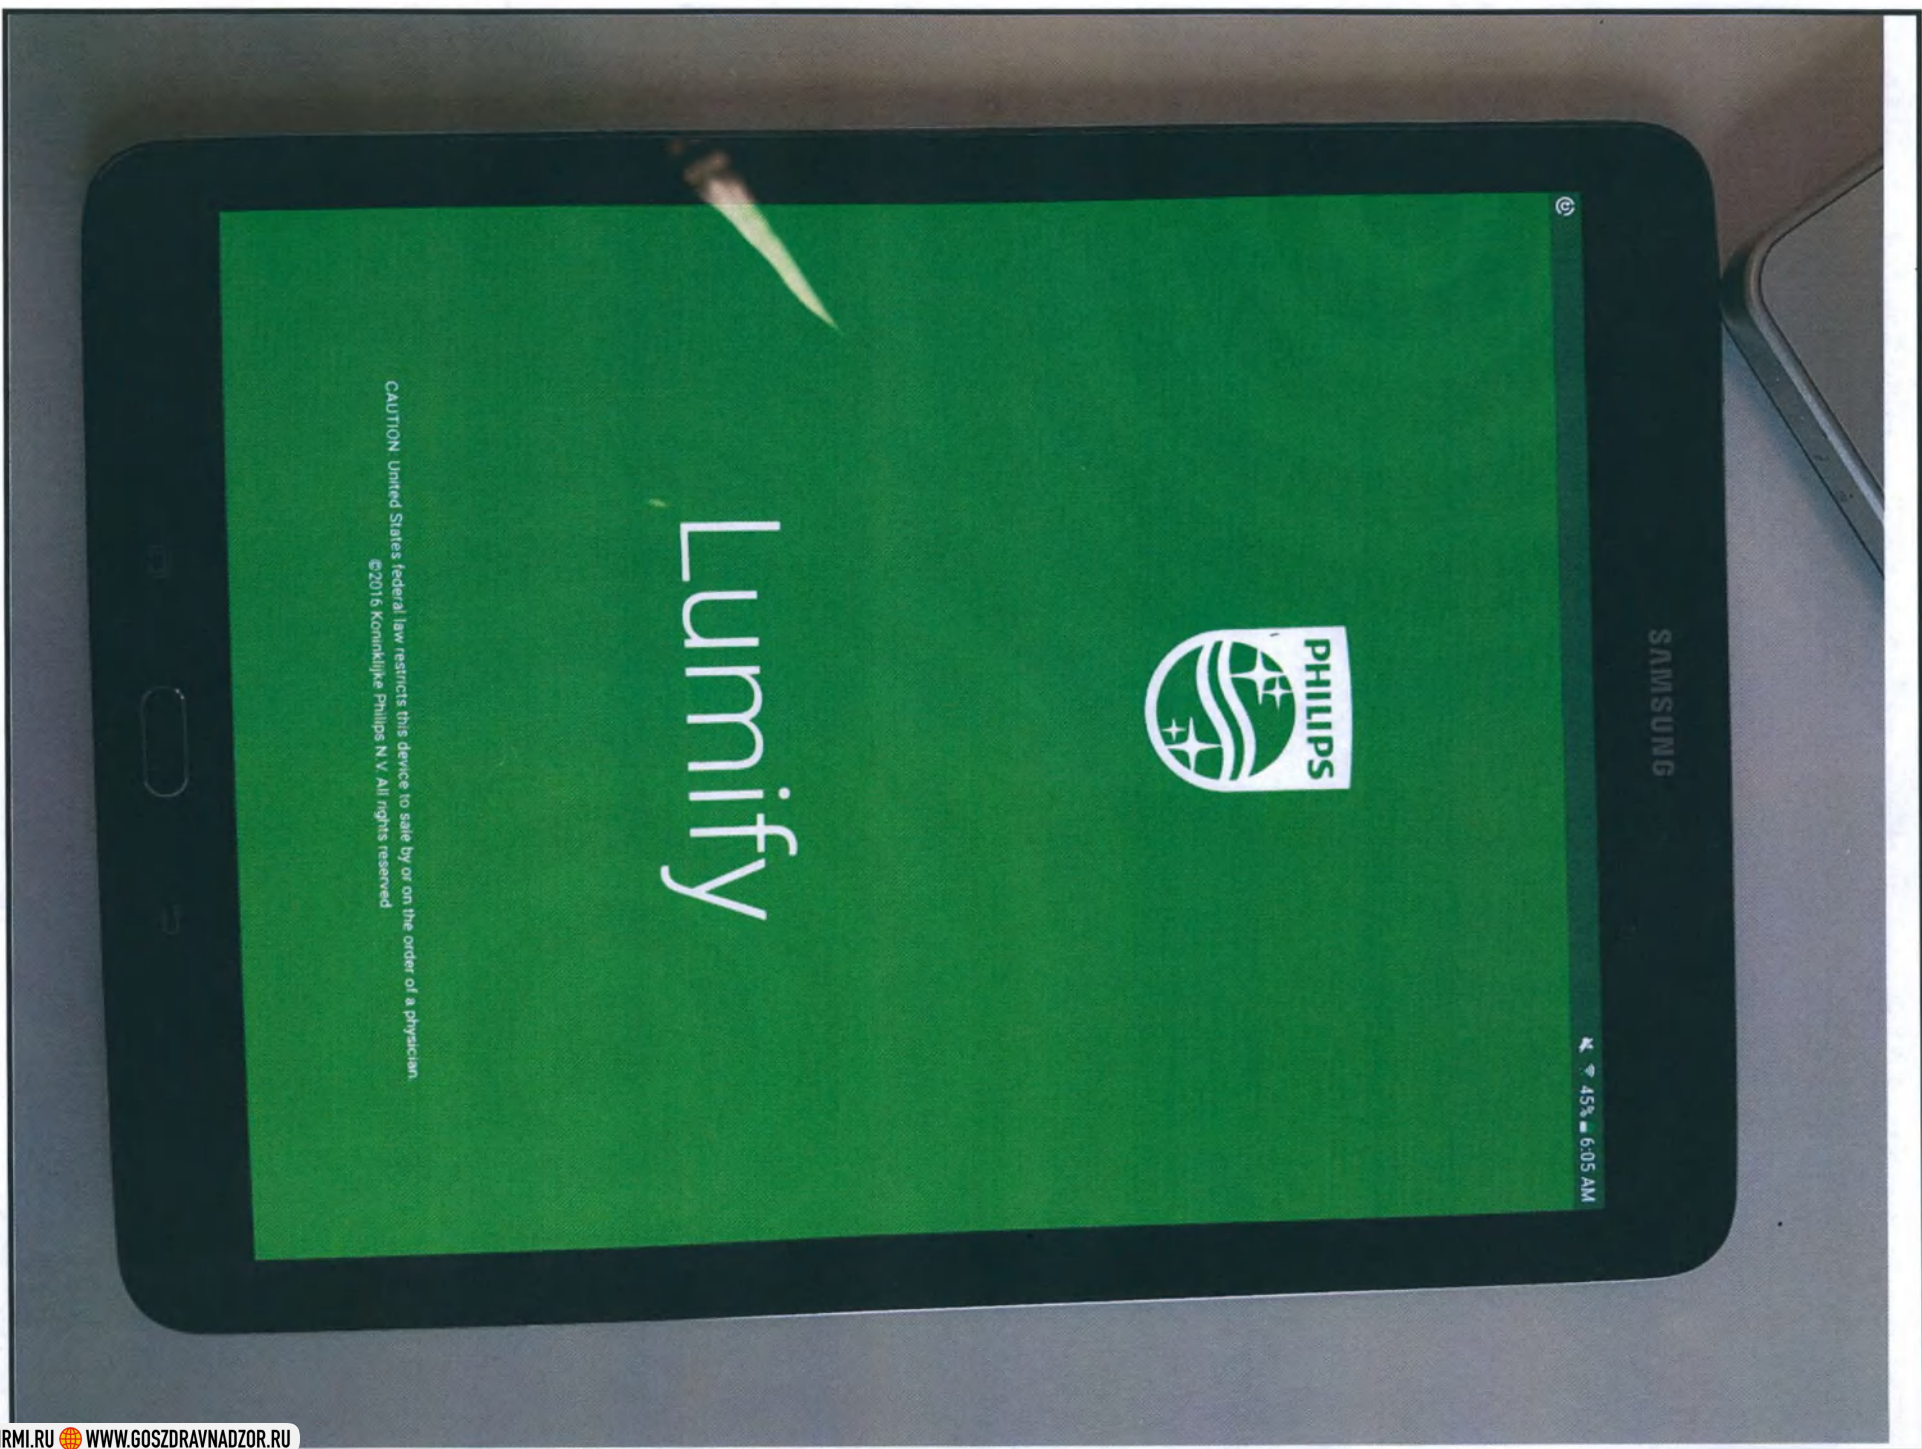

3. Датчик конвексный C5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик C5-2)




3. Датчик конвексный C5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик C5-2)



3. Датчик конвексный C5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик C5-2)



3. Датчик конвексный С5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик L12-4)

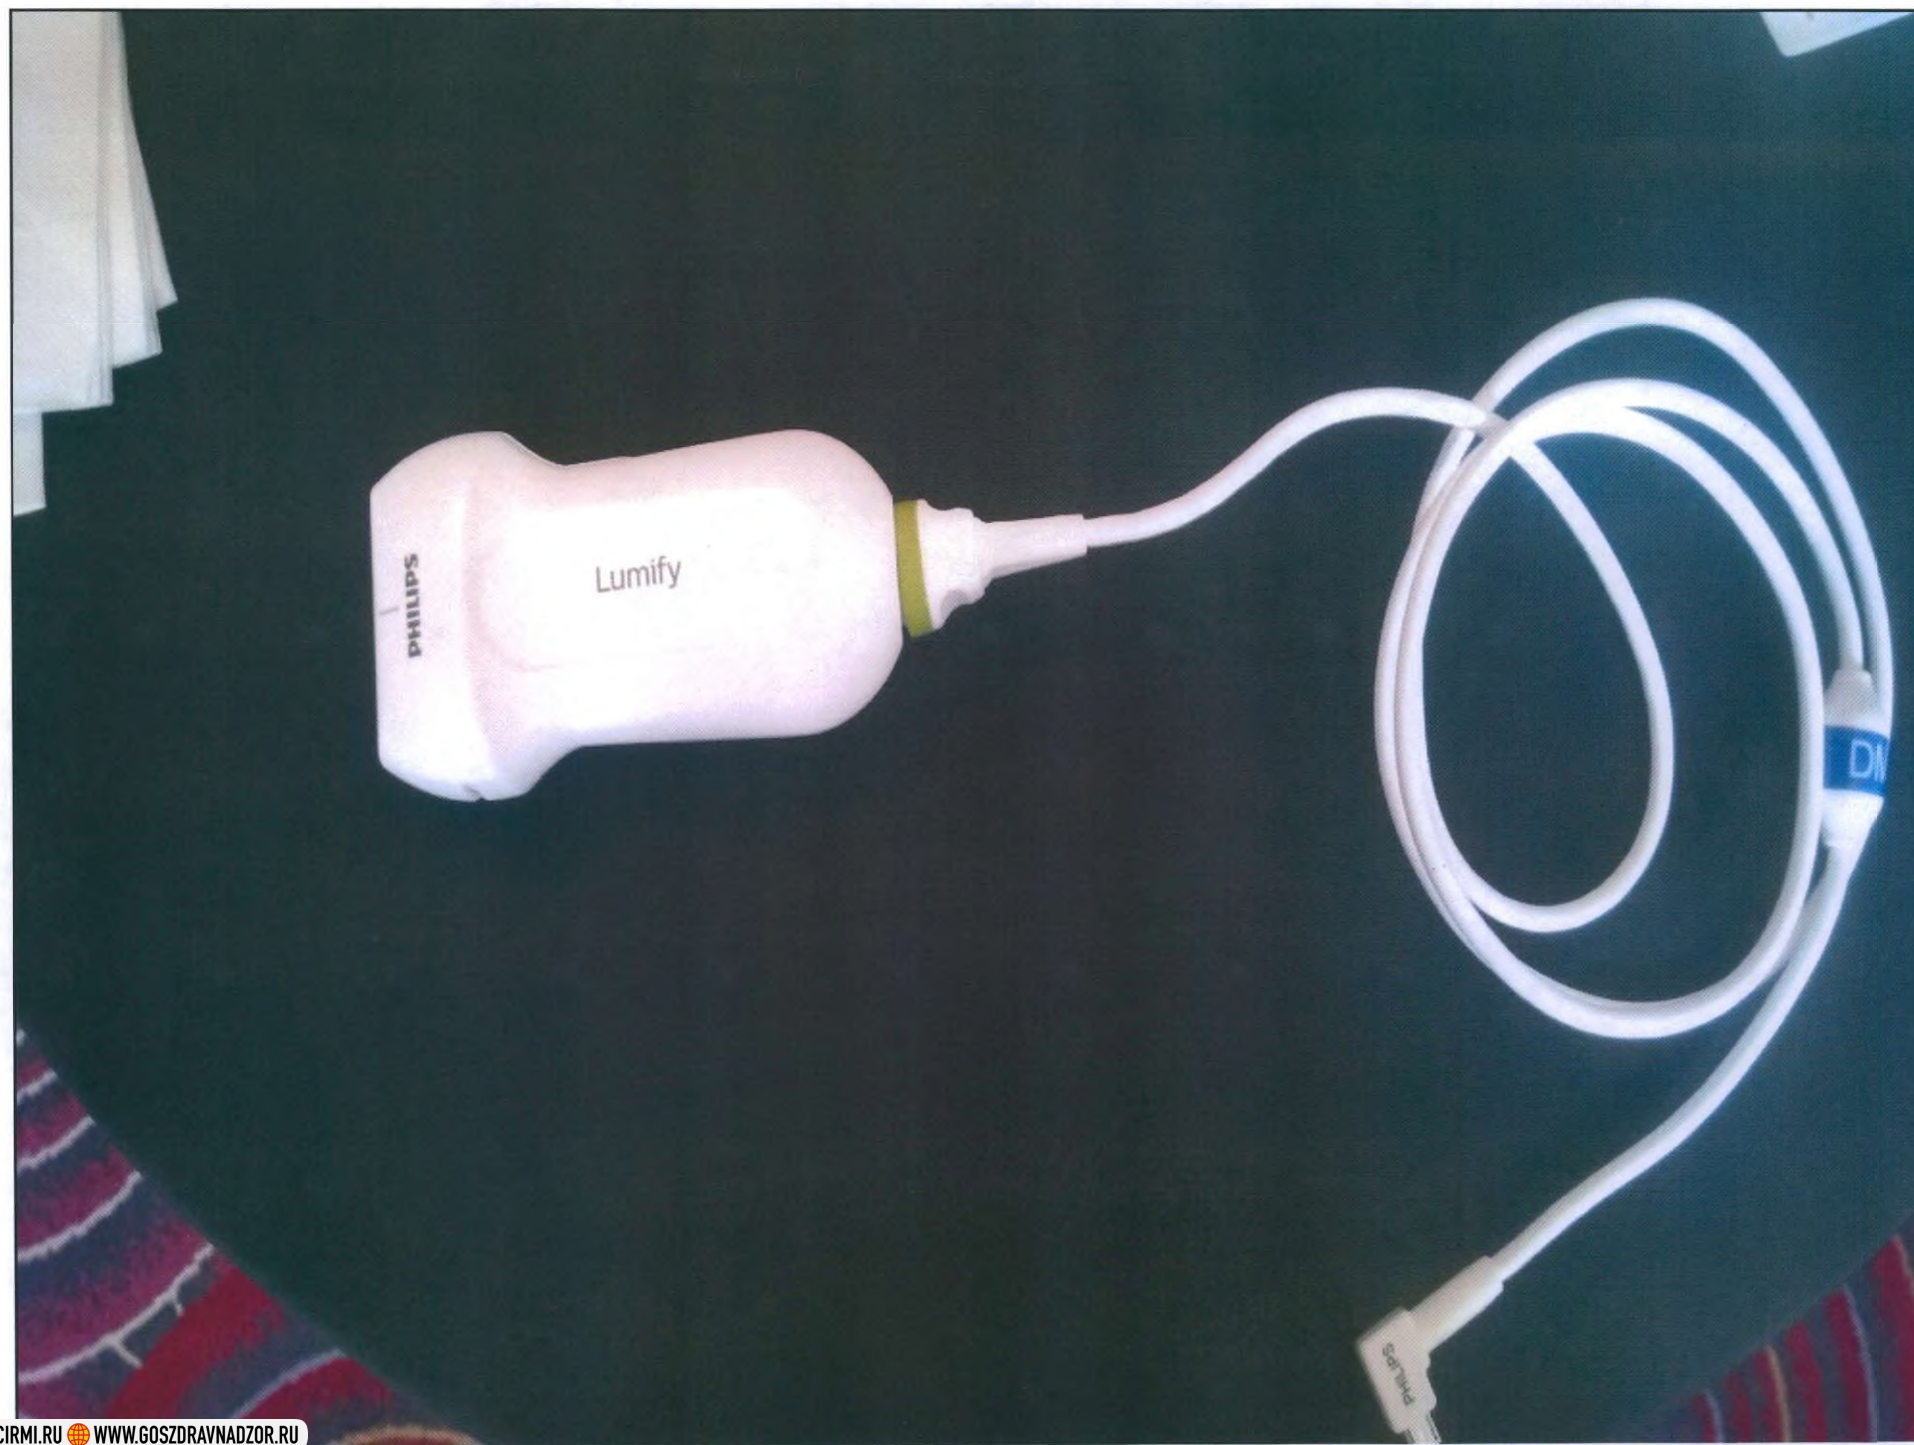

3. Датчик конвексный C5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик L12-4)



3. Датчик конвексный С5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик L12-4)



3. Датчик конвексный C5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик S4-1)




3. Датчик конвексный C5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик S4-1)



3. Датчик конвексный C5-2 и/или датчик линейный L12-4 и/или датчик фазированный S4-1. (Датчик S4-1)



4. Кабель датчика, не более 9 шт.

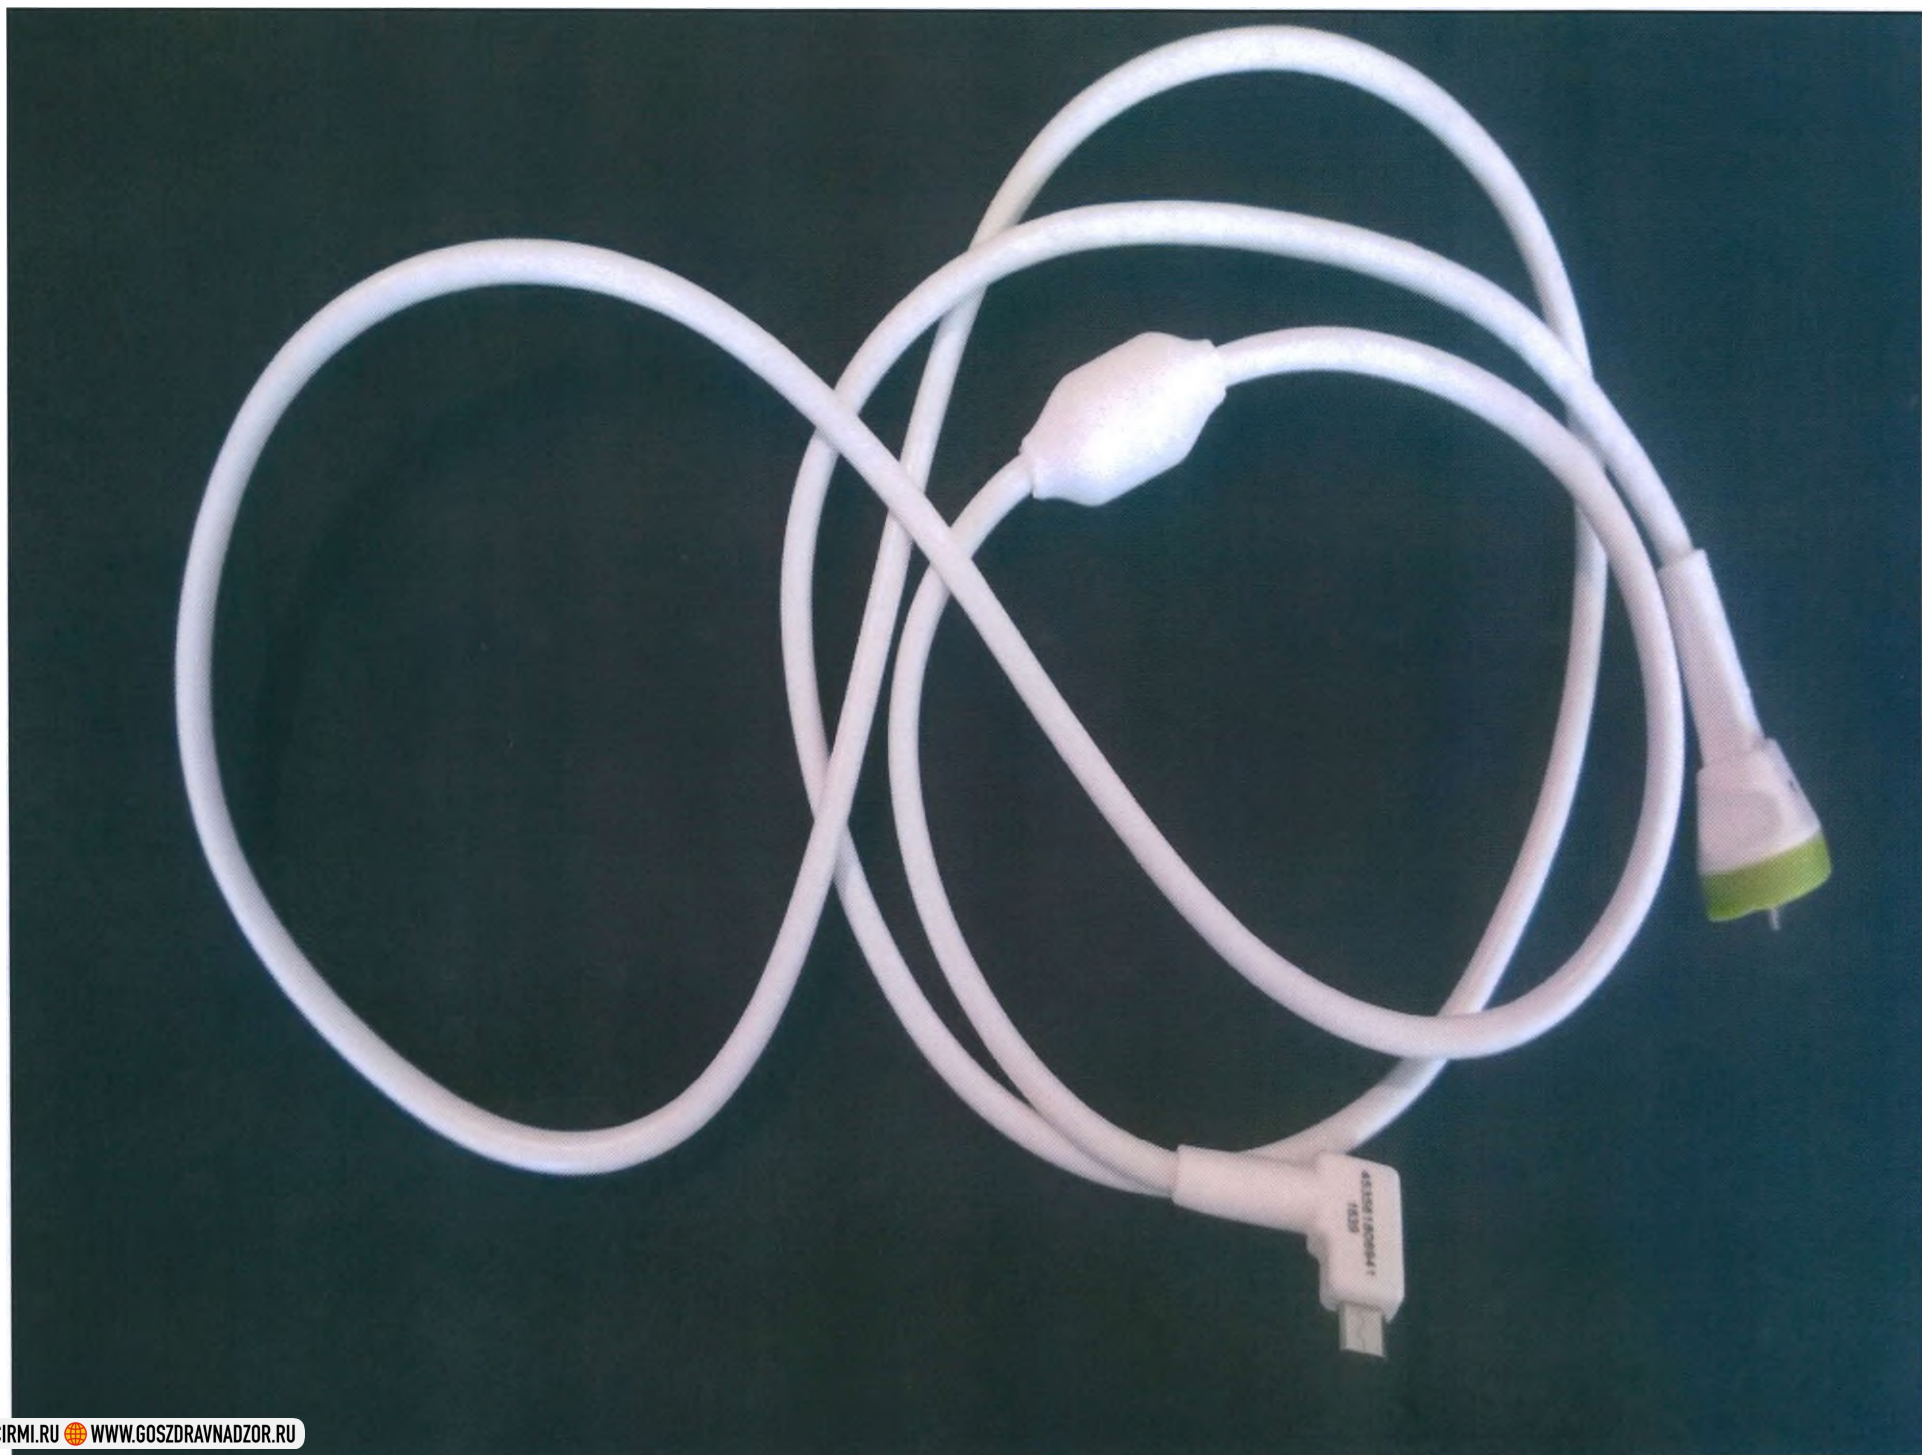

5. Компакт-диск с информацией для пользователей.






Руководство
пользователя

Русский

Диагностическая ультразвуковая система Lumify

PHILIPS

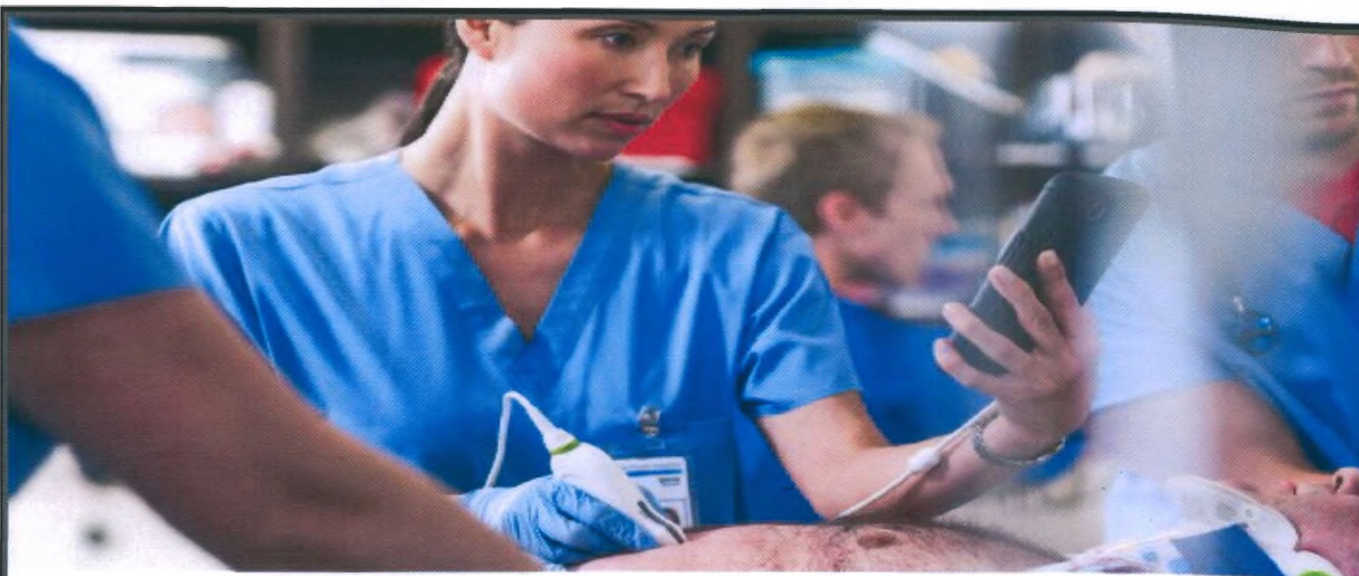


Обновление
информации для
пользователя

Русский

Аппаратное обеспечение диагностической ультразвуковой системы Lumify для устройств iOS

PHILIPS

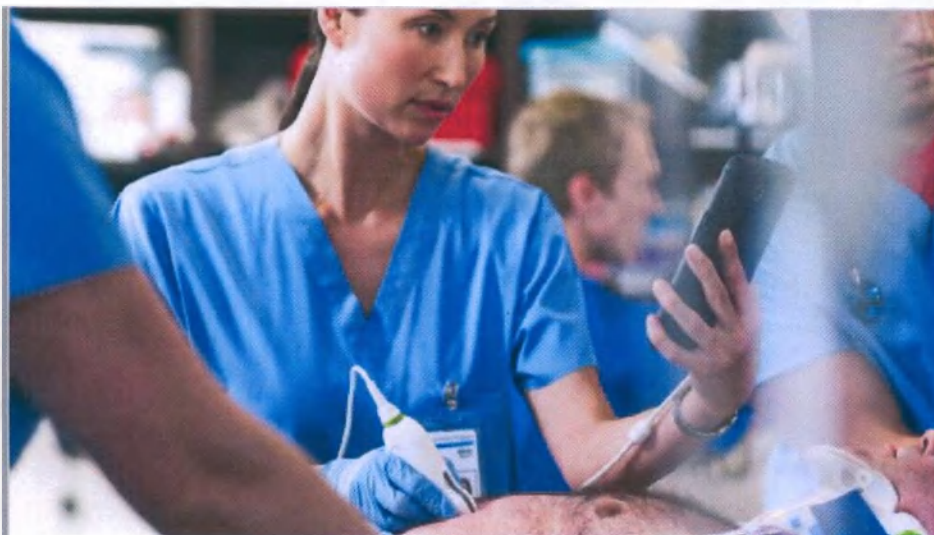

Всестороннее
обеспечение
безопасности системы
и данных

Русский

Диагностическая ультразвуковая система Lumify


PHILIPS

Руководство
пользователя

Русский

Уход за ультразвуковыми системами и датчиками и очистка

PHILIPS

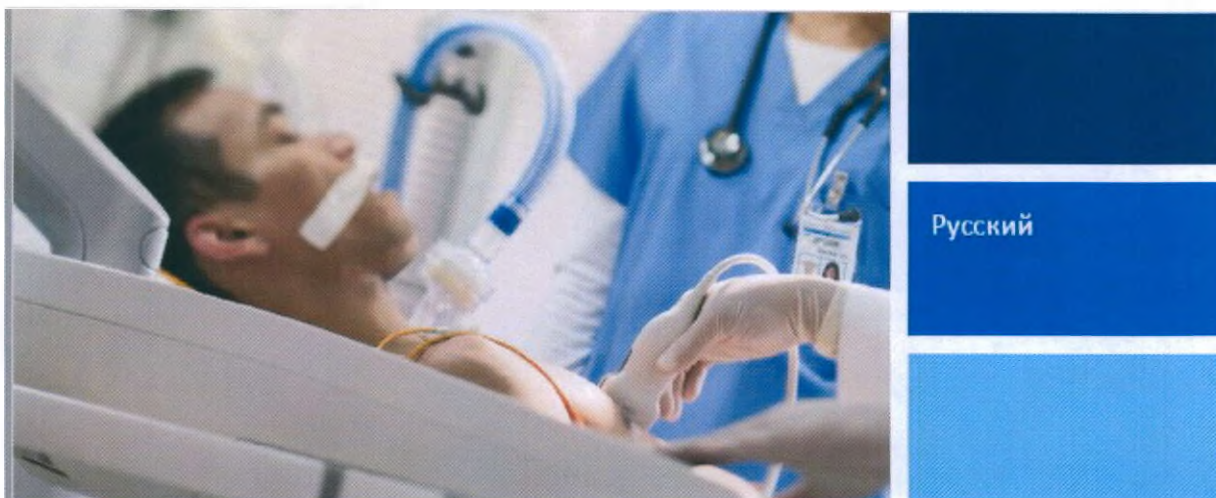

Использование ультразвука для лечения осложнений на легкие и сердце, вызванных вирусом COVID-19

PHILIPS

Руководство
пользователя

Русский

Дезинфицирующие средства и чистящие растворы для ультразвуковых систем и датчиков

PHILIPS



Справочная картотека

Диагностическая ультразвуковая система Lumify


Русский

PHILIPS


II. Принадлежности: 1. Сумка для переноски.




II. Принадлежности: 2.Комплект для подключения устройства с операционной системой iOS, в составе: Корпус для 9,7-дюймового устройства iPad

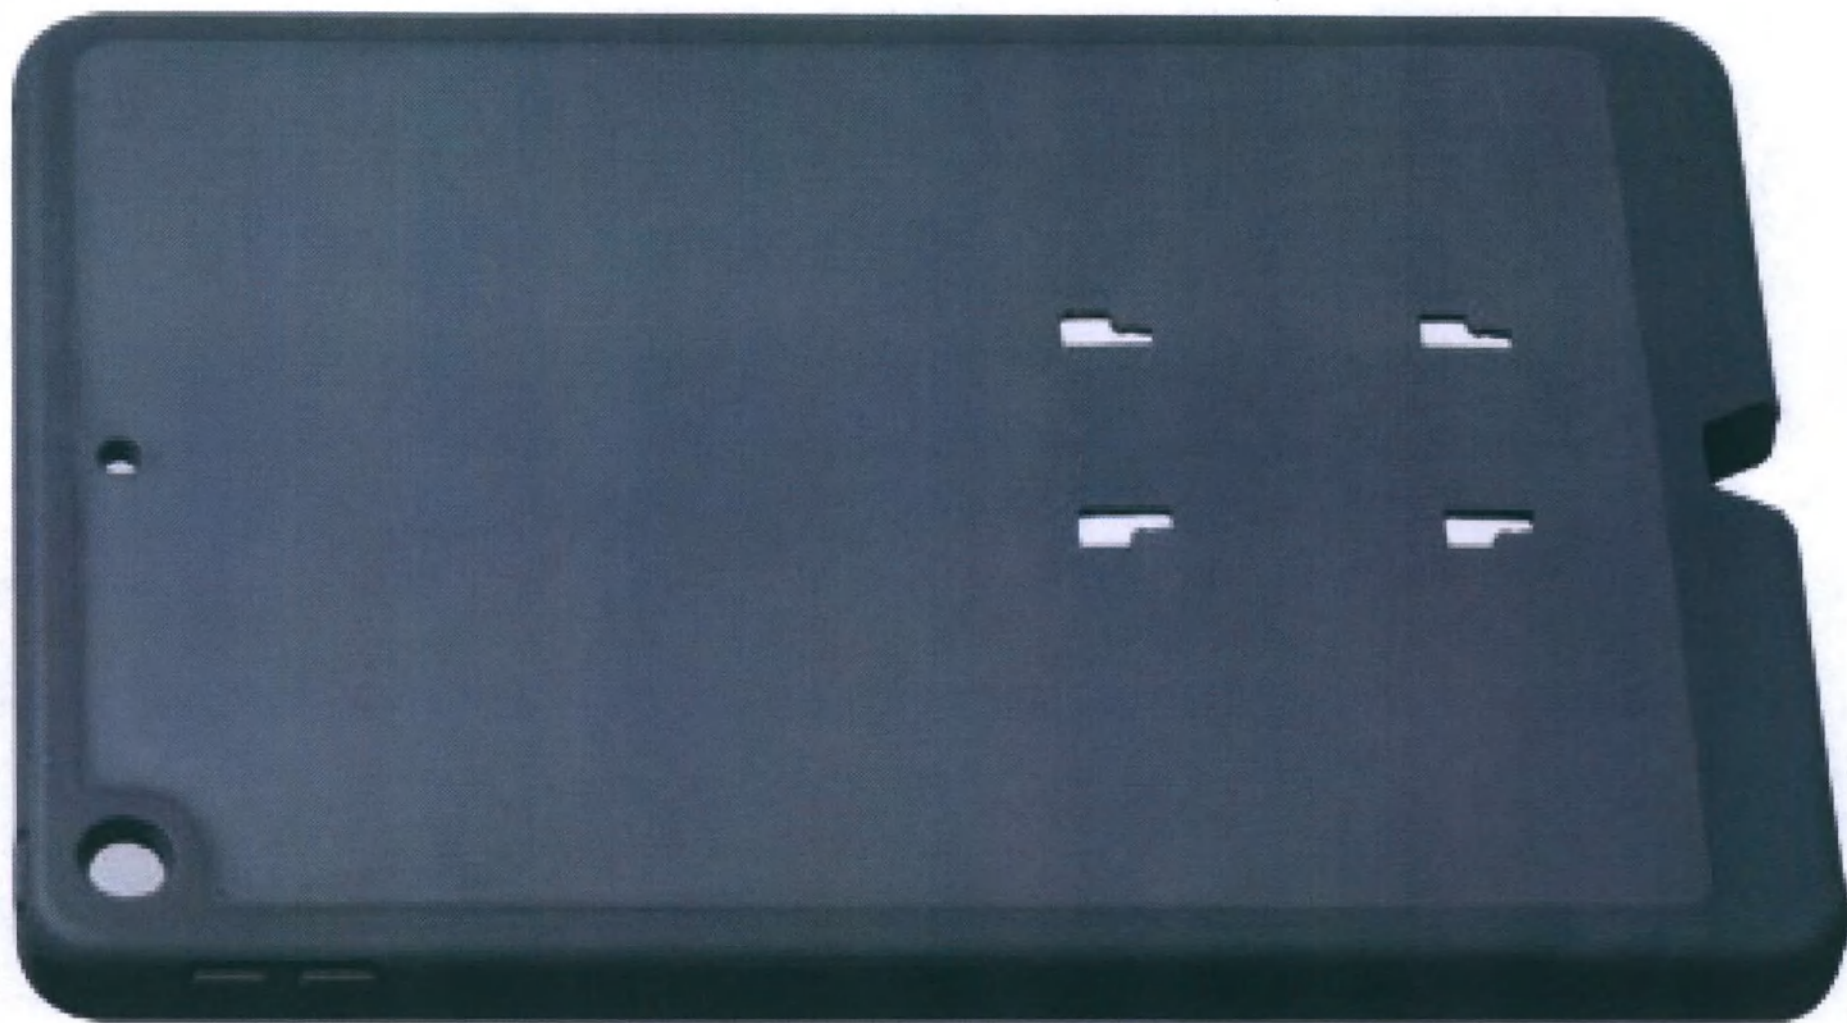



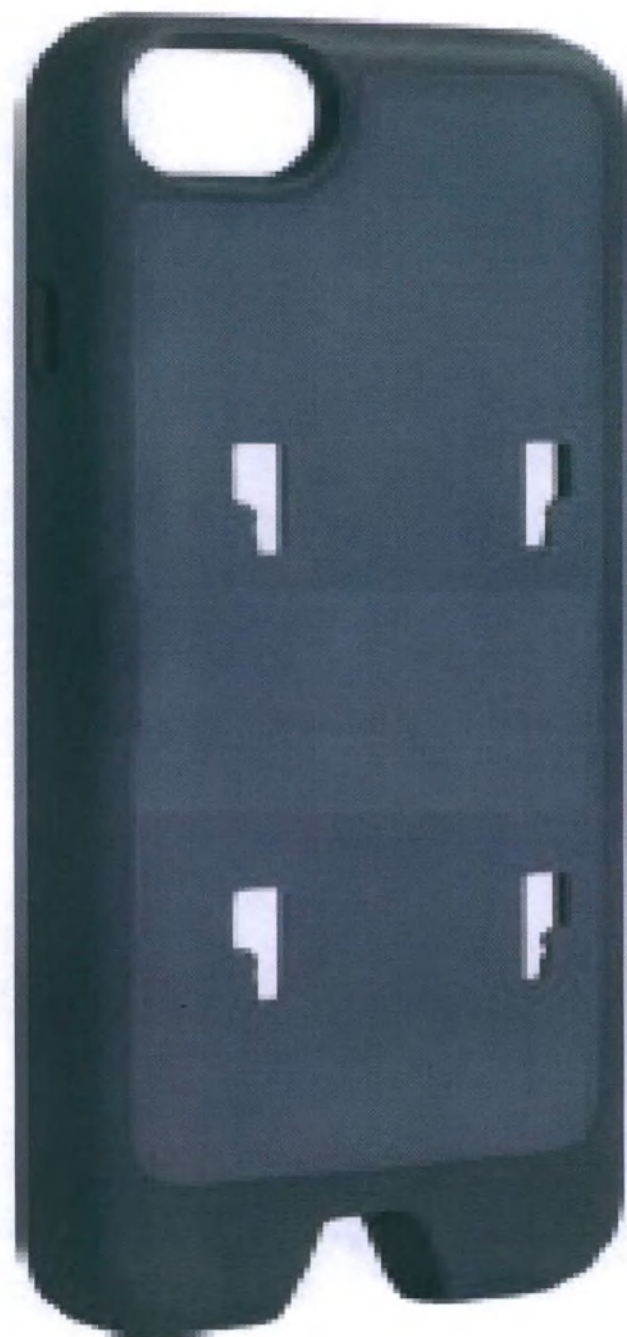

Пластина монтажная клейкая.

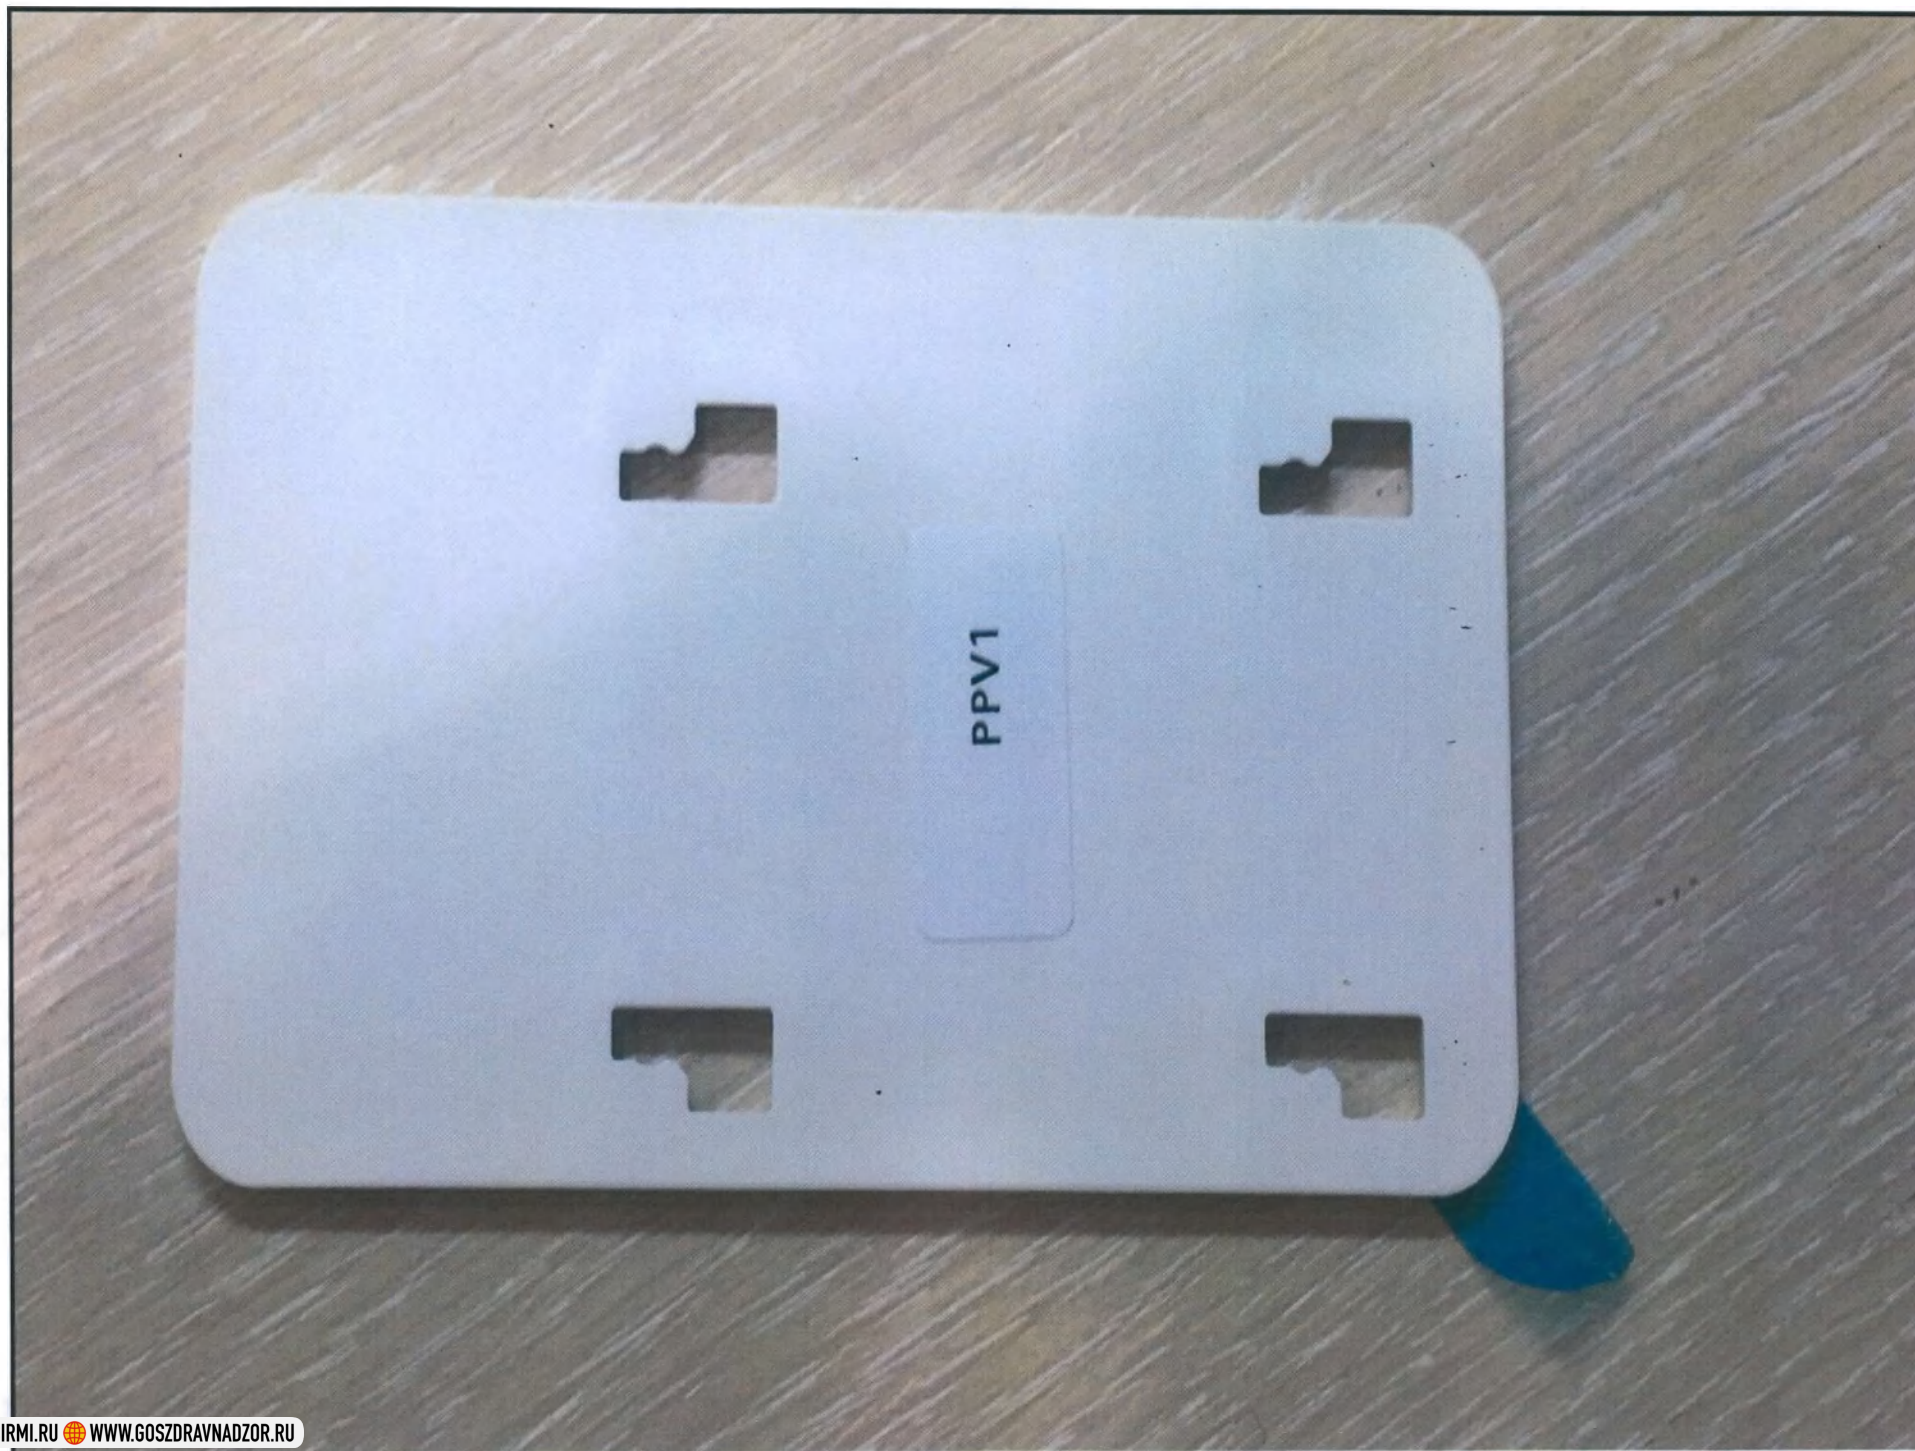

II. Принадлежности: 2.Комплект для подключения устройства с операционной системой iOS, в составе: Модуль питания Lumify (LPM).




II. Принадлежности: 2.Комплект для подключения устройства с операционной системой iOS, в составе: Кабель зарядный.



II. Принадлежности: 2.Комплект для подключения устройства с операционной системой iOS, в составе: Разъем жесткий.



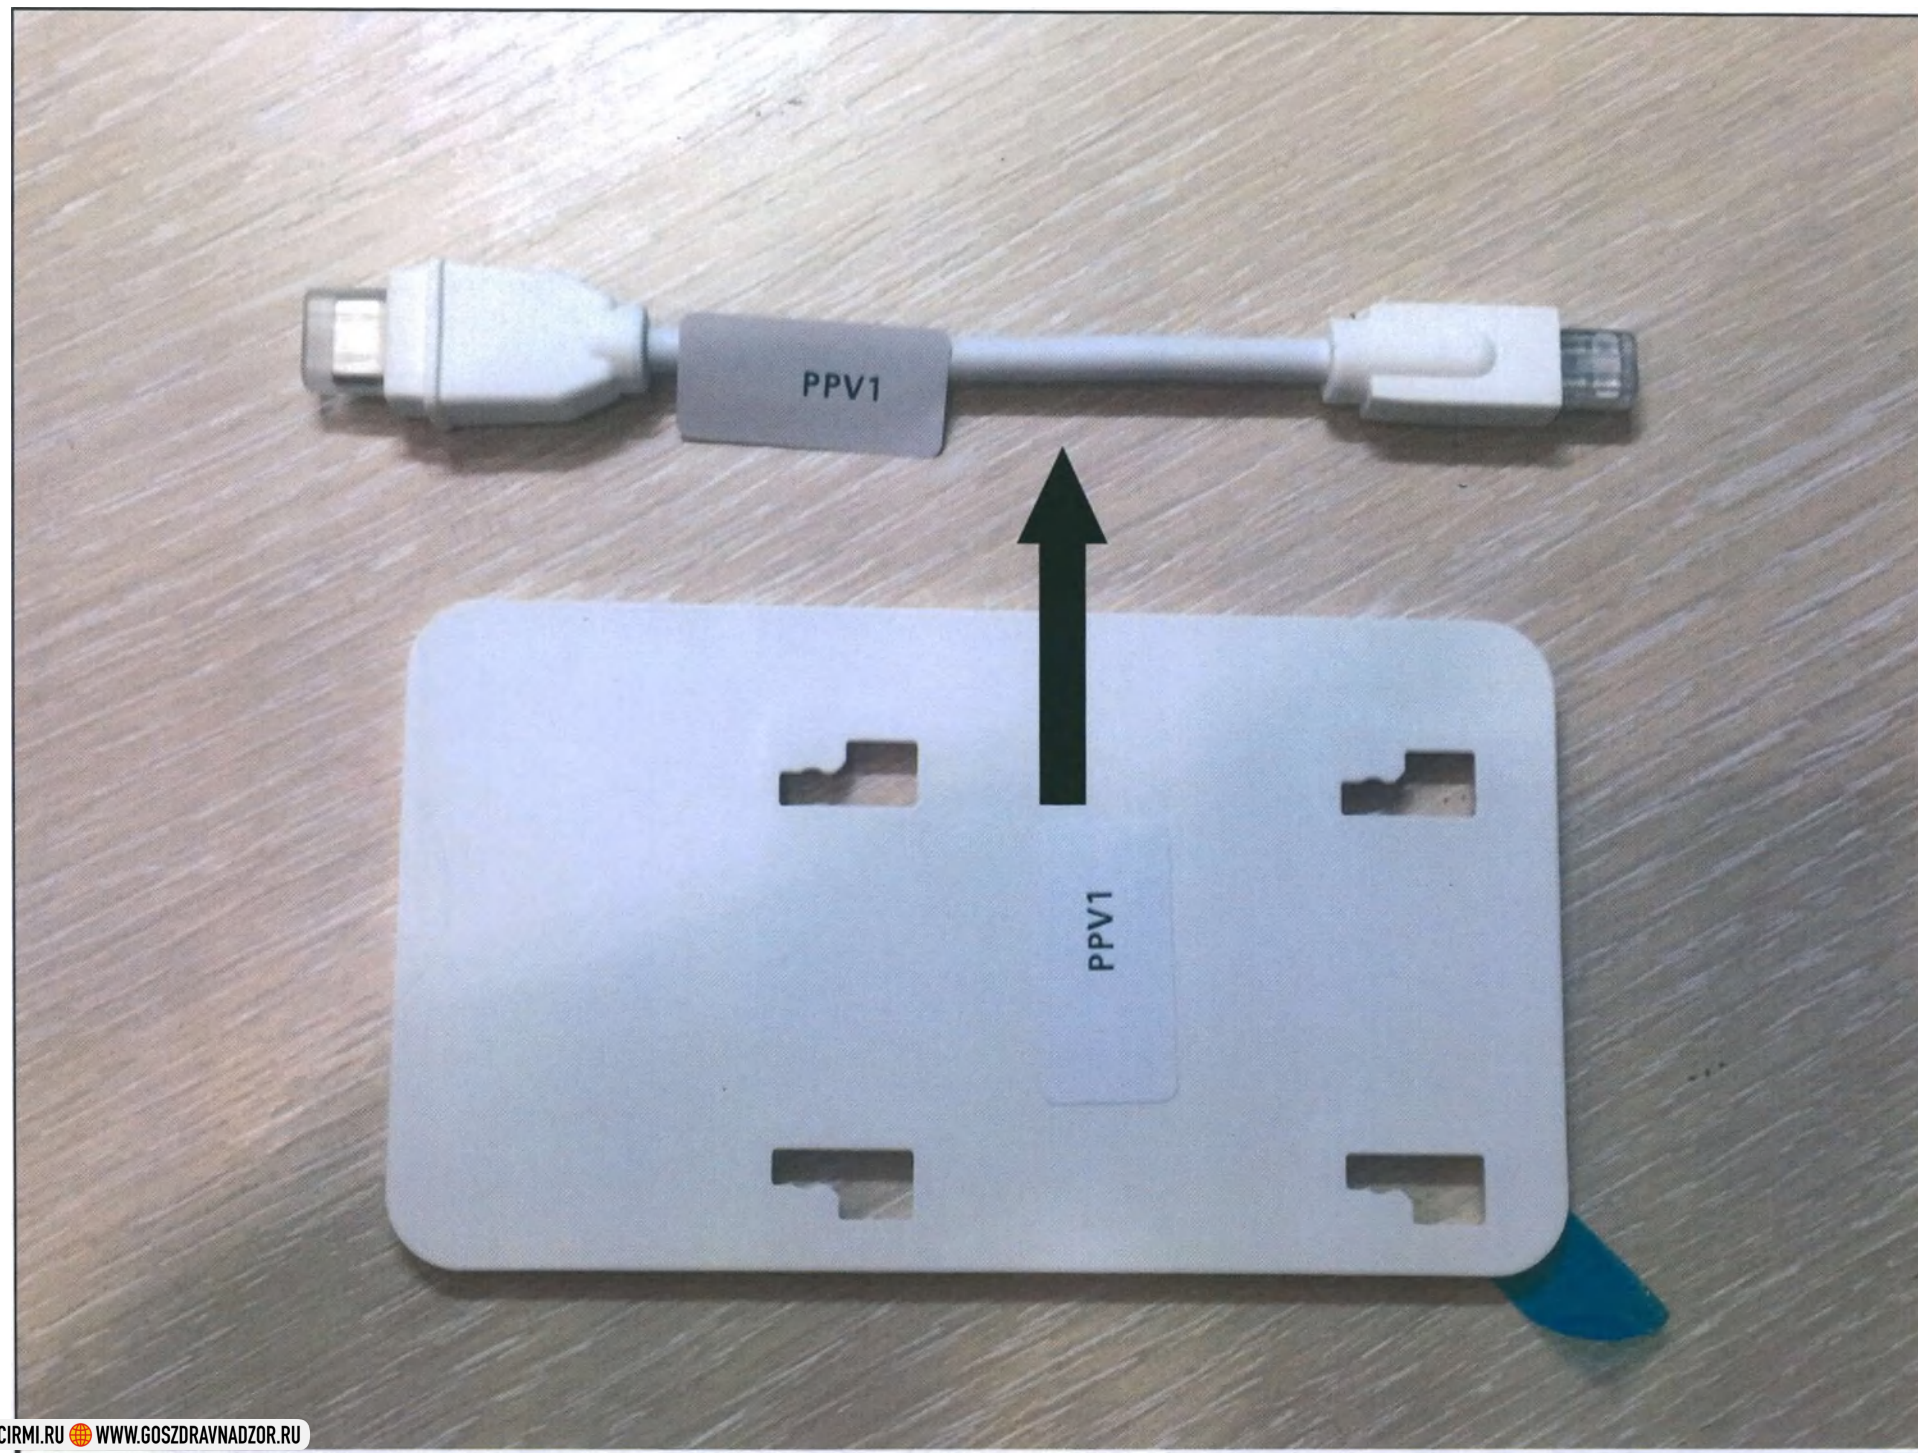



ПРОШУ
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЮ 30 л.

