

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

ИНН 7720828231/ОГРН 5147746211267/КПП 771501001  
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 27521, Г. МОСКВА, 17-Й ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ, Д. 9А  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ОРЛОВСКИЙ ДМИТРИЙ РУСЛАНОВИЧ  
ТЕЛЕФОН: +7-916-181-12-44 ©  
EMAIL: ORTHODONT@INBOX.RU

ООО "ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Генеральный директор  
Орловский Д. Р.



(Подпись)

2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Брекет ортодонтический самолигирующий Andrews ASL Momentum

2024г.

орекет ортодонтический самолигирующий Andrews ASL Momentum, в вариантах исполнения:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orthodontic self-ligating bracket Andrews ASL Momentum, in the following versions:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|  <b>Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd.</b><br>No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District<br>310015 Hangzhou City, Zhejiang<br>Province, P.R. China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Authorized representative in the Russian Federation:<br><b>ORTHODONTIC LABORATORY IN MOSCOW LLC</b><br>Russia, 127521, Moscow, 17th proezd Maryina<br>Roshchi, 9A, +7 (916) 181-12-44<br>orthodont@inbox.ru |
| Self-ligating braces - standard design, without hook, groove 0.022in: ■ UR1, ■ UL1, ■ UR2, ■ UL2, ■ LR1, ■ LL1, ■ LR2, ■ LL2<br>Self-ligating braces - standard design, with hook, groove 0.022in: ■ UR3HK, ■ UL3HK, ■ UR4HK, ■ UL4HK, ■ UR5HK, ■ UL5HK, ■ LR3HK, ■ LL3HK, ■ LR4HK, ■ LL4HK, ■ LR5HK, ■ UL5HK, ■ UR3HK, ■ UL3HK, ■ UR4HK, ■ UL4HK, ■ UR5HK, ■ UL5HK, ■ LR3HK, ■ LL3HK, ■ LR4HK, ■ LL4HK, ■ LR5HK, ■ UL5HK<br>Buccal tubes for first molars - standard design, convertible, groove 0.022in, UR<br>Buccal tubes for first molars - standard prescription, convertible, 0.022in slot, UL<br>Buccal tubes for first molars - standard design, convertible, groove 0.022in, LR<br>Buccal tubes for first molars - standard design, convertible, groove 0.022in, LL<br>Buccal tubes for the first molars - translational copy, convertible, groove 0.022in, UR<br>Buccal tubes for first molars - translational prescription, convertible, groove 0.022in, UL<br>Buccal tubes for the first molars - translational copy, convertible, groove 0.022in, LR<br>Buccal tubes for the first molars - translational copy, convertible, groove 0.022in, LL<br>Buccal tubes for second molars - standard design, non-convertible, groove 0.022in, UR<br>Second molar buccal tubes - standard design, non-convertible, 0.022in slot, UL<br>Buccal tubes for second molars - standard design, non-convertible, 0.022in groove, LR<br>Buccal tubes for second molars - standard design, non-convertible, 0.022in slot, LL<br>Buccal tubes for second molars - translational copy, non-convertible, groove 0.022in, UR<br>Buccal tubes for second molars - translational writing, non-convertible, 0.022in groove, UL<br>Buccal tubes for second molars - translational copy, non-convertible, groove 0.022in, LR<br>Buccal tubes for second molars - translational copy, non-convertible, groove 0.022in, LL<br>■ Instructions for use |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Transportation and storage conditions:</b><br>Ambient temperature: from -20°C to +85°C<br>Relative humidity up to 80%, no condensation<br>Ambient pressure: 700-1060 hPa                                 |

Our metal product contains nickel and chromium. Patients known to be allergic to these metals should not be treated with these products.

**EC REP**

Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd.  
 No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District  
 Hangzhou City, Zhejiang Province, China  
 TEL: +86-571-58102870 FAX: +86-571-58102890  
 E-mail: export@shinye-ortho.com

Our metal product contains nickel and chromium. Patients known to be allergic to these metals should not be treated with these products.

**EC REP**

Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd.  
 No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District  
 Hangzhou City, Zhejiang Province, China  
 TEL: +86-571-58102870 FAX: +86-571-58102890  
 E-mail: export@shinye-ortho.com

CE 0197 FDA

Our metal product contains nickel and chromium. Patients known to be allergic to these metals should not be treated with these products.

**EC REP**

Lotus NL B.V.  
 Koningin Julianaplein 10, 1e, Venlo, 3591AA  
 The Hague, Netherlands

Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd.  
 No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015  
 Hangzhou City, Zhejiang Province, China  
 TEL: +86-571-58102870 FAX: +86-571-58102890  
 E-mail: export@shinye-ortho.com

орекет ортодонтический самолигирующий Andrews ASL Momentum, в вариантах исполнения:

**Orthodontic self-ligating bracket Andrews ASL Momentum, in the following versions:**



Zhejiang Shinye Medical  
Technology Corp., Ltd.  
No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District  
310015 Hangzhou City, Zhejiang  
Province, P.R. China

Authorized representative in the Russian  
Federation:  
ORTHODONTIC LABORATORY IN MOSCOW  
LLC  
Russia, 127521, Moscow, 17th proezd Maryina  
Roshchi, 9A, + 7 (916) 181-12-44  
orthodont@inbox.ru


Self-ligating braces - standard design, without hook, groove 0.022in: ■ UR1, ■ UL1, ■ UR2, ■ UL2, ■ LR1, ■ LL1, ■ LR2, ■ LL2

Self-ligating braces - standard design, with hook, groove 0.022in: ■ UR3HK, ■ UL3HK, ■ UR4HK, ■ UL4HK, ■ UR5HK, ■ UL5HK, ■ LR3HK, ■ LL3HK, ■ LR4HK, ■ LL4HK, ■ LR5HK, ■ LL5HK, ■ UR3HK, ■ UL3HK, ■ UR4HK, ■ UL4HK, ■ UR5HK, ■ UL5HK, ■ LR3HK, ■ LL3HK, ■ LR4HK, ■ LL4HK, ■ LR5HK, ■ LL5HK

■ Buccal tubes for first molars - standard design, convertible, groove 0.022in, UR  
■ Buccal tubes for first molars - standard prescription, convertible, 0.022in slot, UL  
■ Buccal tubes for first molars - standard design, convertible, groove 0.022in, LR  
■ Buccal tubes for first molars - standard design, convertible, groove 0.022in, LL  
■ Buccal tubes for the first molars - translational copy, convertible, groove 0.022in, UR  
■ Buccal tubes for first molars - translational prescription, convertible, groove 0.022in, UL  
■ Buccal tubes for the first molars - translational copy, convertible, groove 0.022in, LR  
■ Buccal tubes for the first molars - translational copy, convertible, groove 0.022in, LL  
■ Buccal tubes for second molars - standard design, non-convertible, groove 0.022in, UR  
■ Second molar buccal tubes - standard design, non-convertible, 0.022in slot, UL  
■ Buccal tubes for second molars - standard design, non-convertible, 0.022in groove, LR  
■ Buccal tubes for second molars - standard design, non-convertible, 0.022in slot, LL  
■ Buccal tubes for second molars - translational copy, non-convertible, groove 0.022in, UR  
■ Buccal tubes for second molars - translational writing, non-convertible, 0.022in groove, UL  
■ Buccal tubes for second molars - translational copy, non-convertible, groove 0.022in, LR  
■ Buccal tubes for second molars - translational copy, non-convertible, groove 0.022in, LL  
■ Instructions for use



Transportation and storage conditions:  
Ambient temperature: from -20°C to +85°C  
Relative humidity up to 80%, no  
condensation  
Ambient pressure: 700-1060 hPa

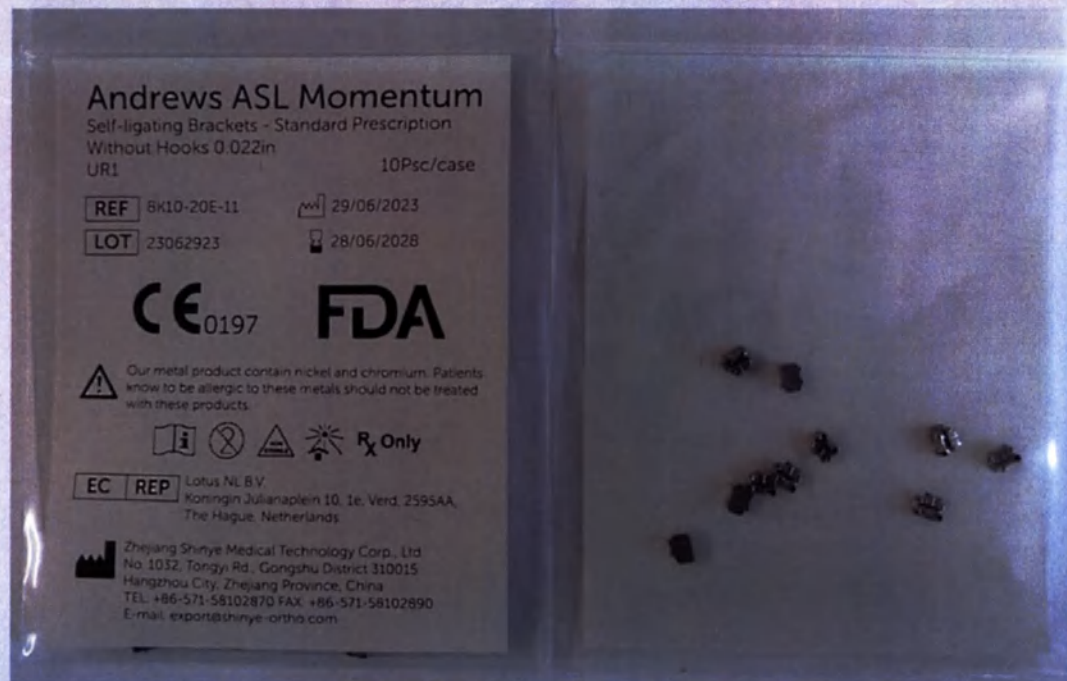

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самоблокирующиеся -  
стандартная пропись, без крючка, паз  
0.022in. UR1, 10 шт. в упаковке;

REF



LOT




Материал изделия содержат  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

2. Брекеты самолигирующие - стандартная пропись, без крючка, паз 0.022in, UL1, 10 шт. в упаковке.

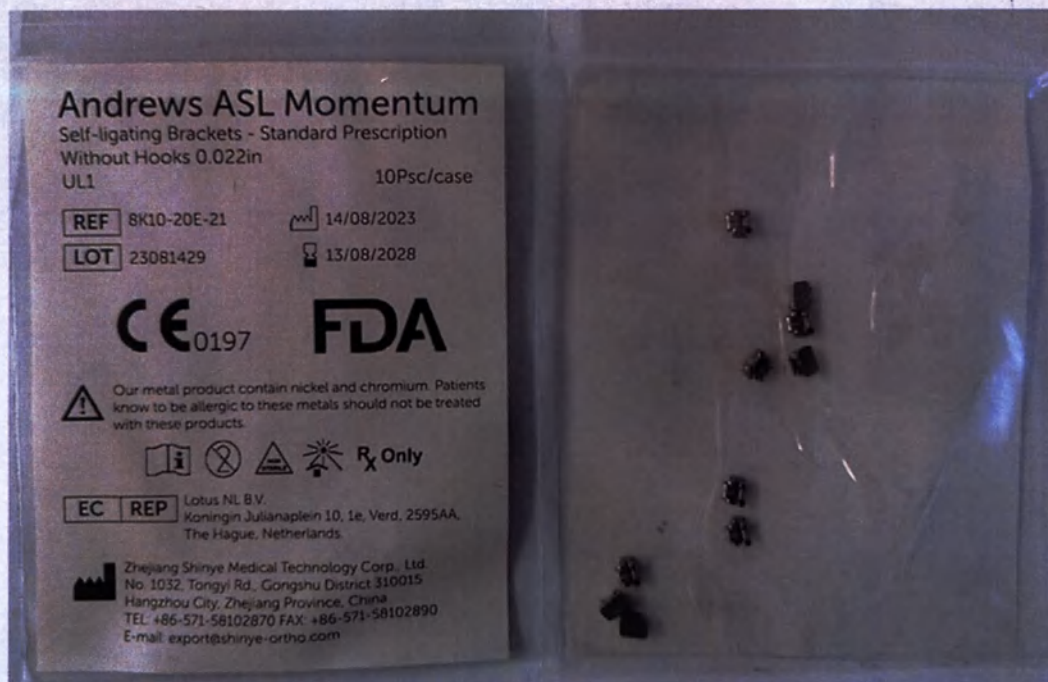

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие - стандартная  
пропись, без крючка, паз 0.022in, UL1,  
10 шт. в упаковке;

REF





LOT




Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологии Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

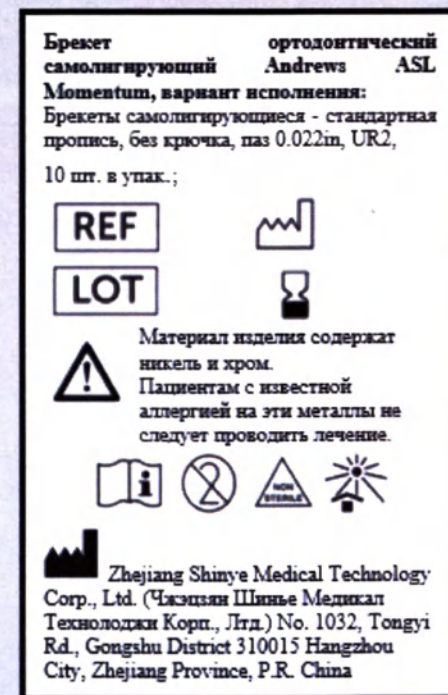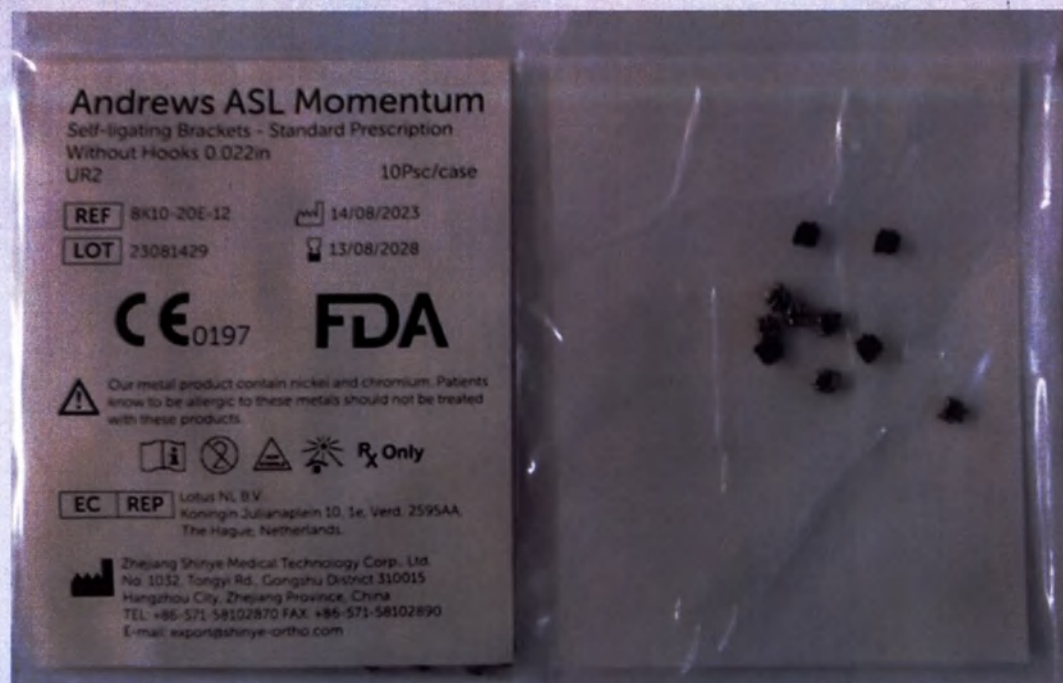

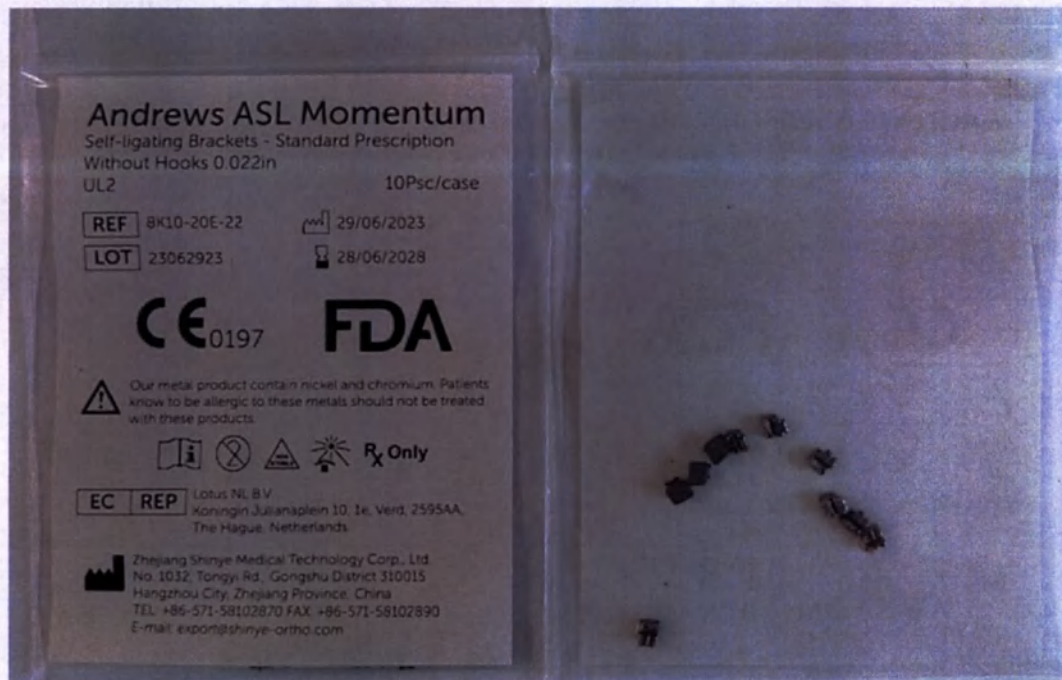

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие - стандартная  
пропись, без крючка, паз 0.022in, UL2,  
10 шт. в упаковке;

REF




LOT





Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.




Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологиз Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

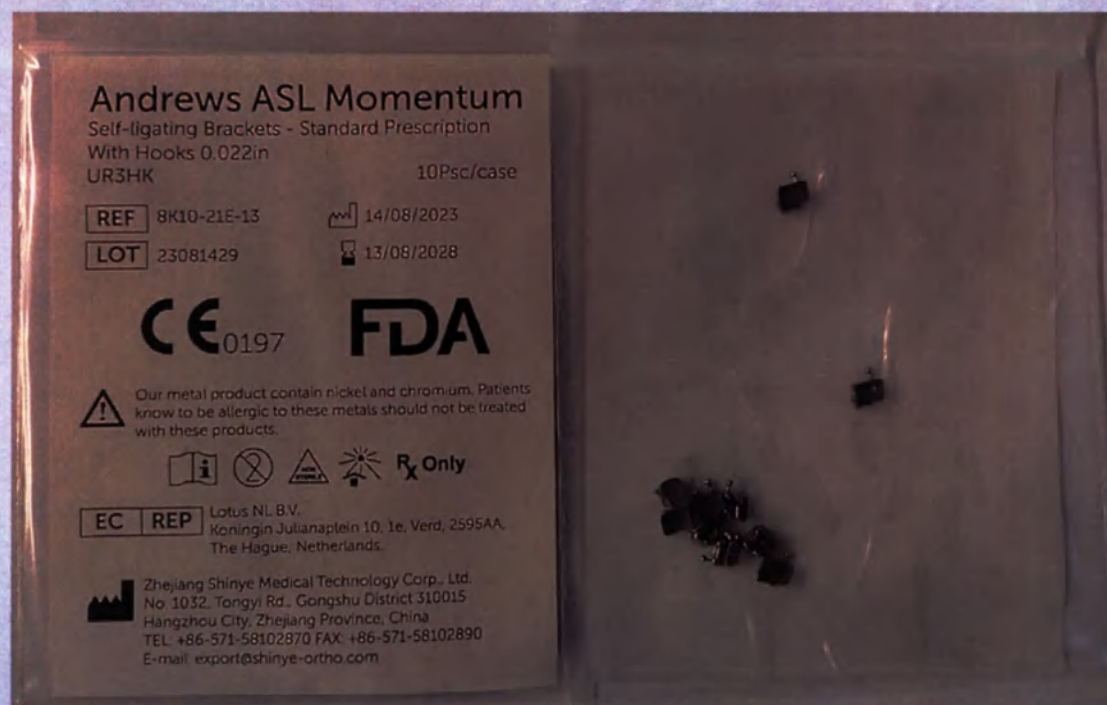

6. Брекеты самолигирующие - стандартная пропись, с крючком, паз 0.022in, UL3HK, 10 шт. в упак.,

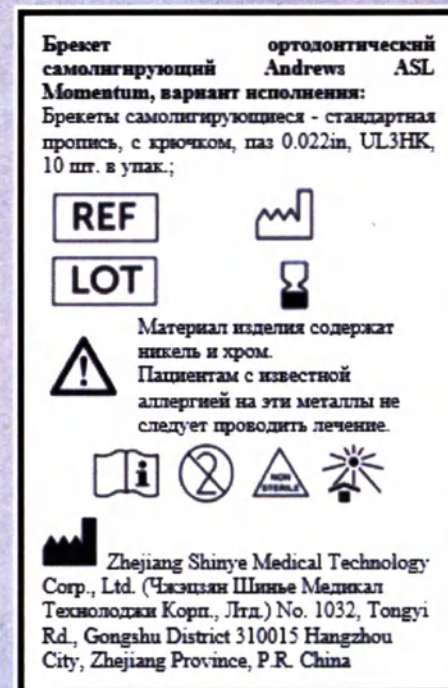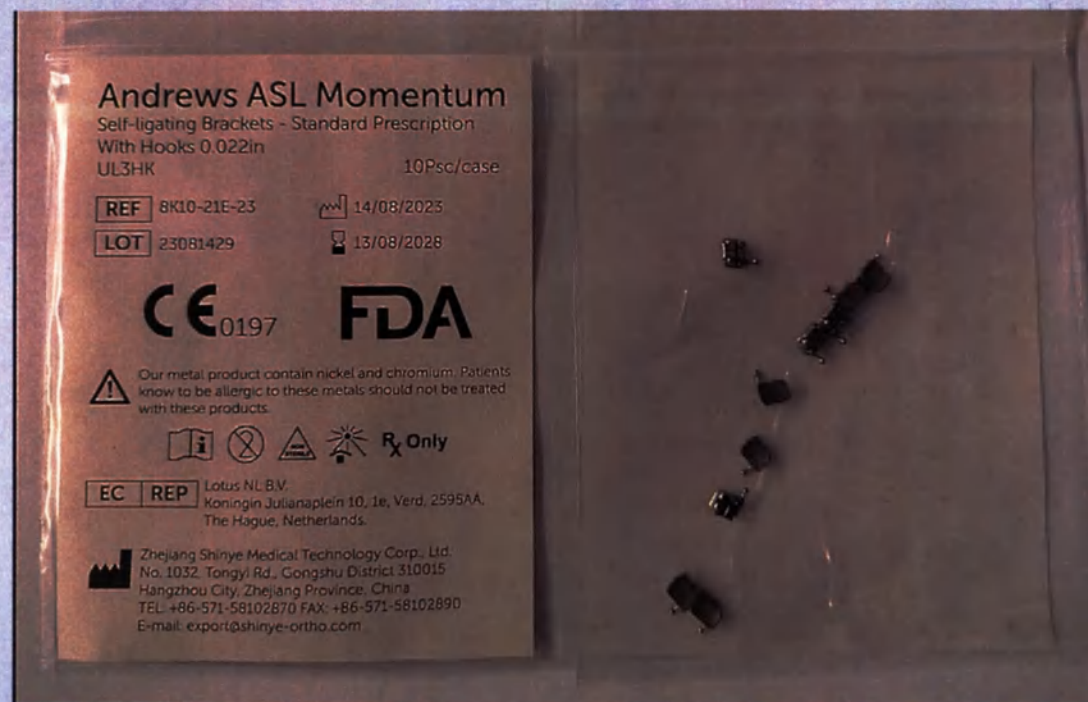

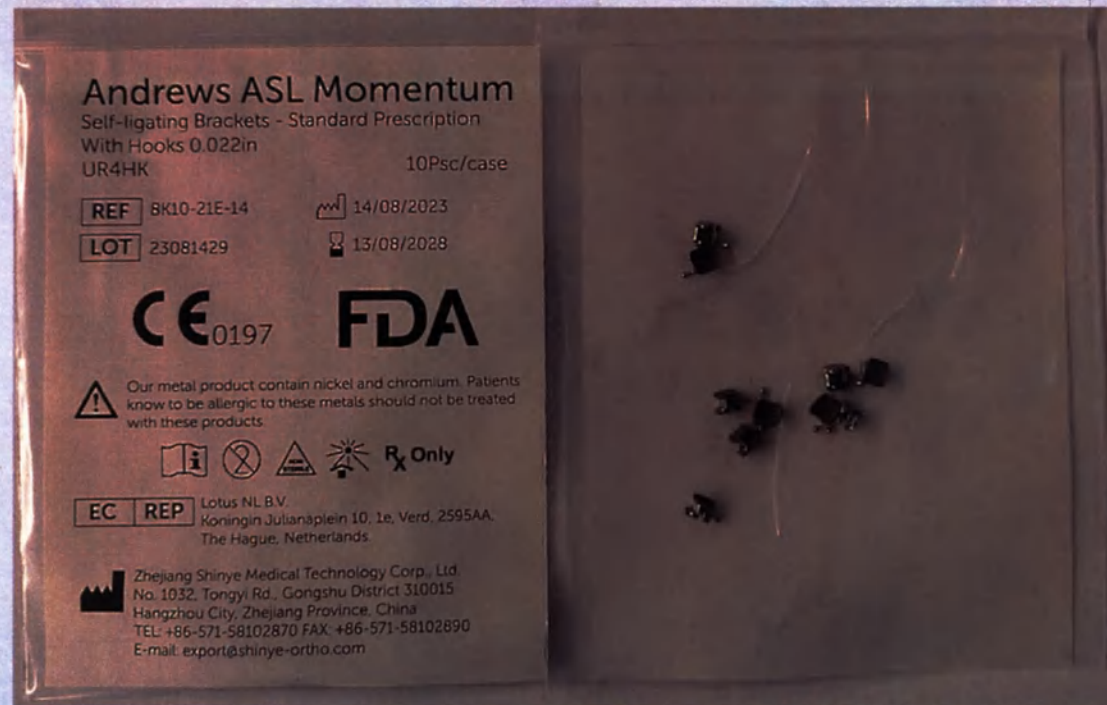

**Andrews ASL Momentum**  
Self-ligating Brackets - Standard Prescription  
With Hooks 0.022in  
UR4HK 10Psc/case

REF 8K10-21E-14 14/08/2023  
LOT 23081429 13/08/2028

CE 0197 FDA

⚠ Our metal product contain nickel and chromium. Patients know to be allergic to these metals should not be treated with these products.

ⓘ ⓘ ⓘ ⓘ Rx Only

EC REP Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, 1e, Verd, 2595AA,  
The Hague, Netherlands.

⚙ Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd  
No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015  
Hangzhou City, Zhejiang Province, China  
TEL: +86-571-58102870 FAX: +86-571-58102890  
E-mail: export@shinye-ortho.com

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие - стандартная  
пропись, с крючком, паз 0.022in, UR4HK,  
10 шт. в упак.;

REF



LOT






Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.




Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

8. Брекеты самолигирующие – стандартная пропись, с крючком, паз 0.022in, UL4HK, 10 шт. в упаковке.

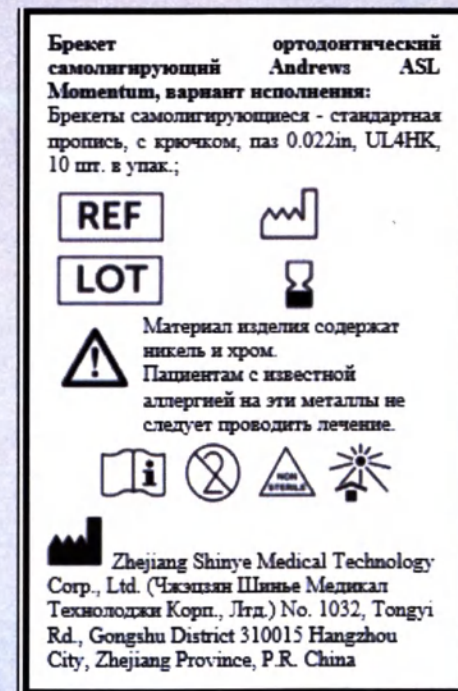

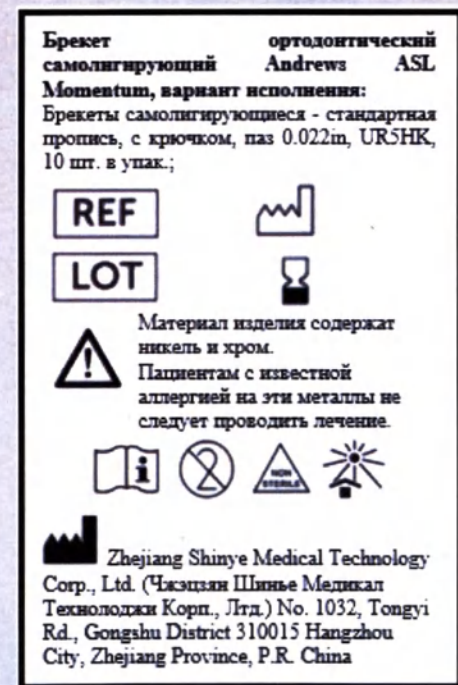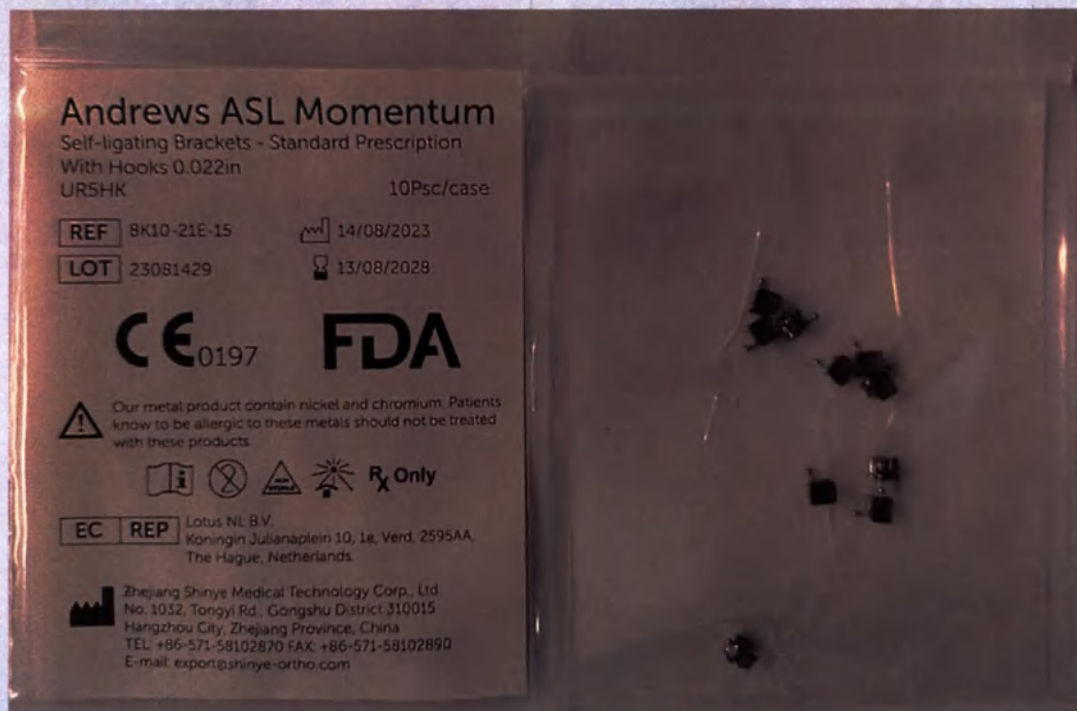

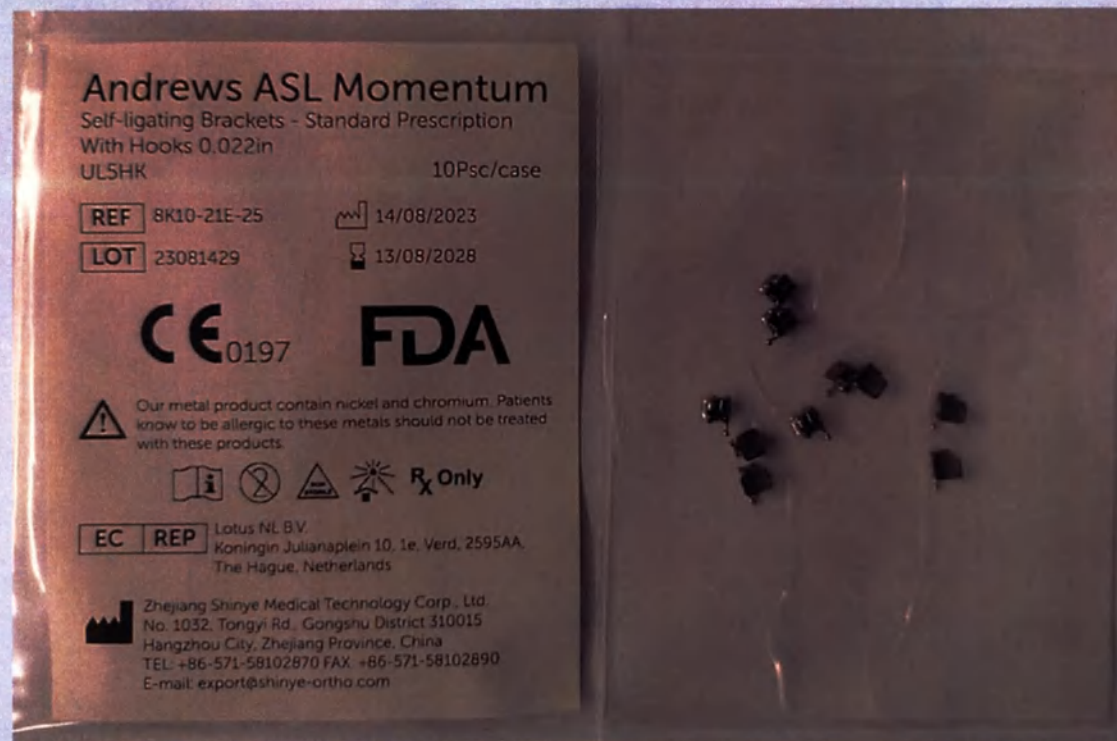


**Брекет самолигирующий** **ортодонтический**  
**Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Брекеты самолигирующие - стандартная пропись, с крючком, паз 0.022in, UL5HK, 10 шт. в упак.;

**REF**   
**LOT** 

 **Материал изделия содержит никель и хром. Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.**

 **Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China**

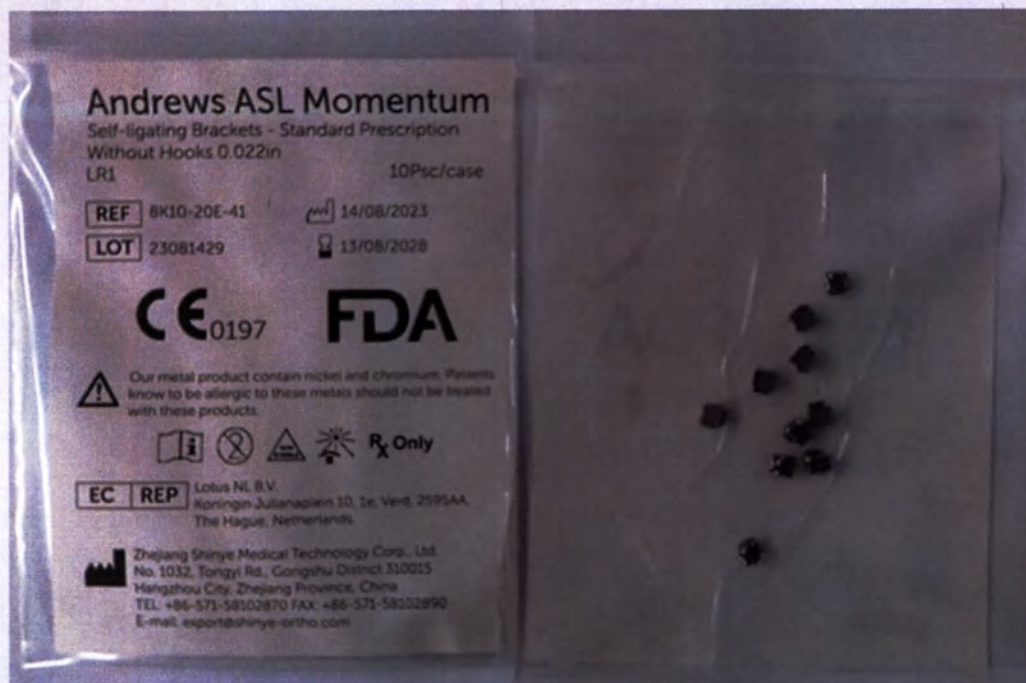

**Брекет ортодонтический самолигирующий Andrews ASL Momentum, вариант исполнения:**  
Брекеты самолигирующие - стандартная пропись, без крючка, паз 0.022in, LR1, 10 шт. в упак.;

REF




LOT



Материал изделия содержит никель и хром. Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

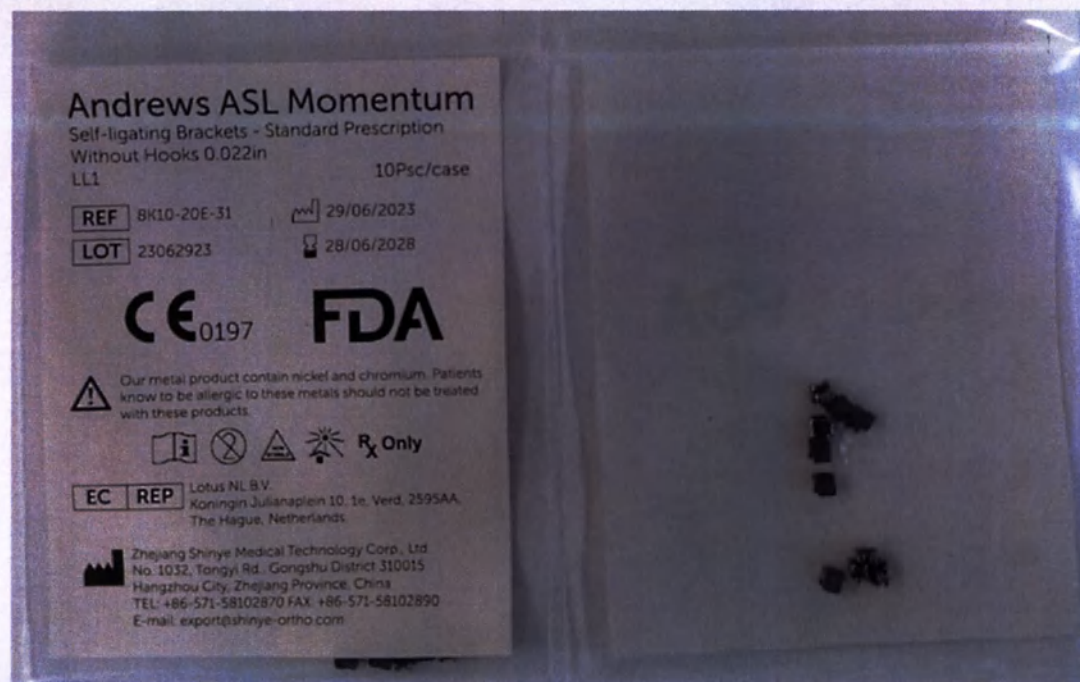

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующиеся - стандартная  
пропись, без крючка, паз 0.022in, LL1,  
10 шт. в упак.;

REF




LOT



Материал изделия содержат  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технология Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

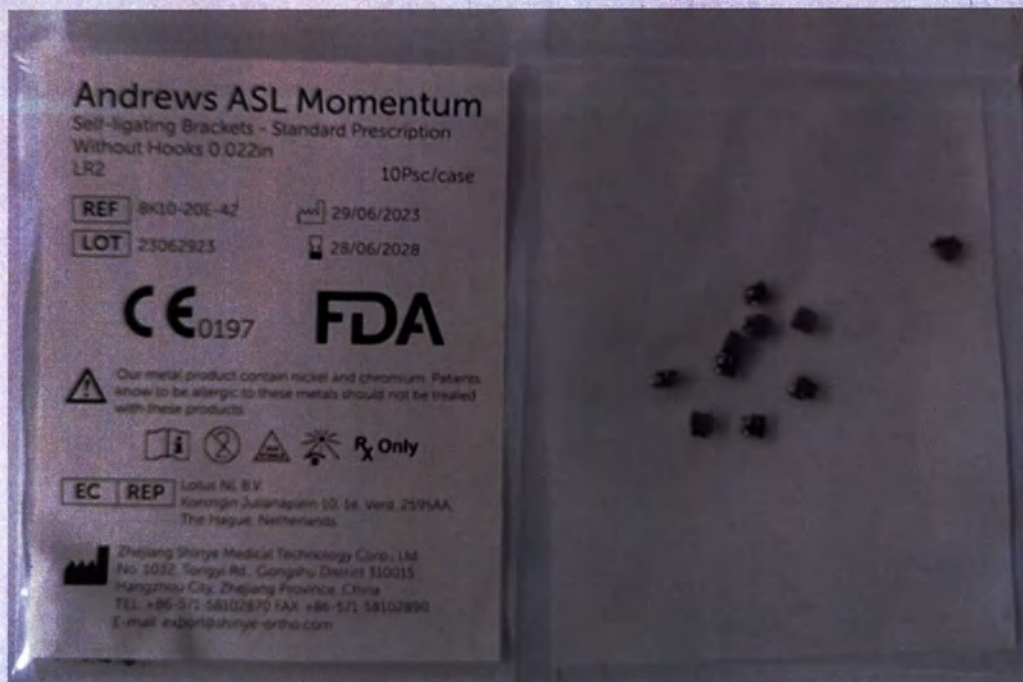

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие - стандартная  
пропись, без крючка, паз 0.022in, LR2,  
10 шт. в упак.;

REF




LOT



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

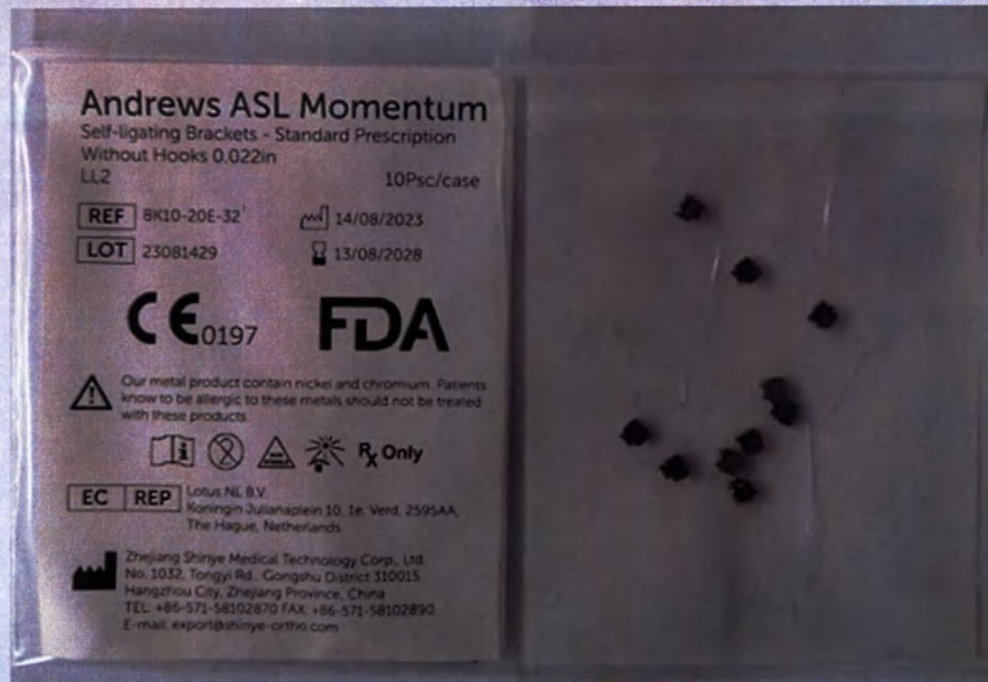

**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Брекеты самолигирующие - стандартная пропись, без крючка, паз 0.022in, LL2, 10 шт. в упак.;

REF




LOT



Материал изделия содержат никель и хром.  
Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

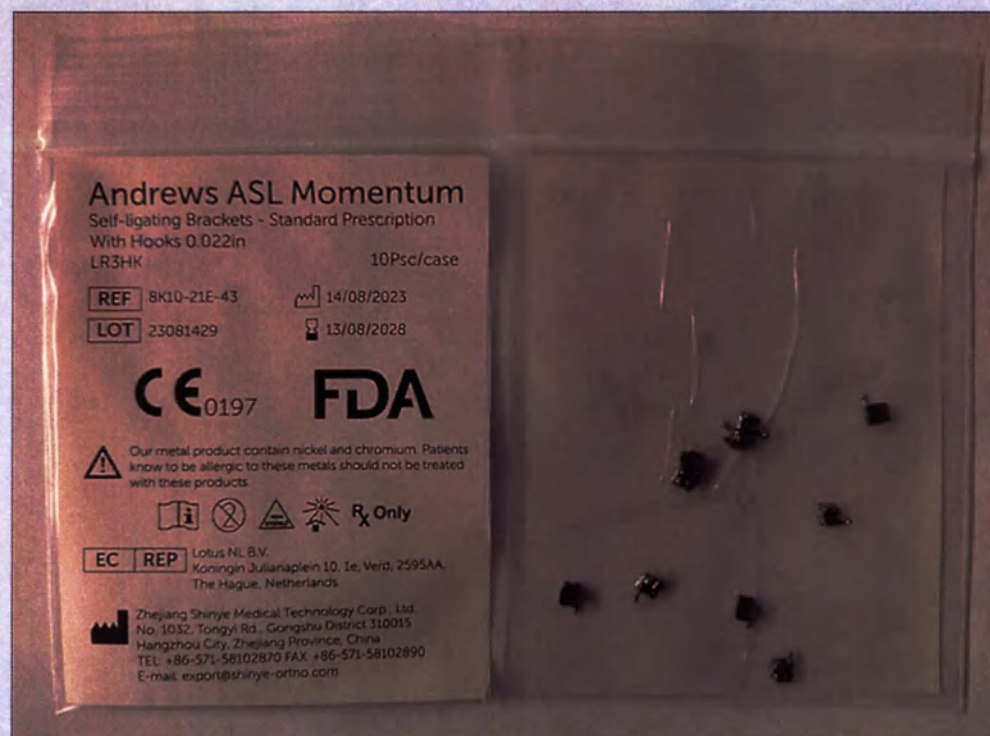

### Andrews ASL Momentum

Self-ligating Brackets - Standard Prescription  
With Hooks 0.022in  
LR3HK 10Psc/case

REF 8K10-21E-43 14/08/2023

LOT 23081429 13/08/2028

CE 0197

FDA

Our metal product contains nickel and chromium. Patients know to be allergic to these metals should not be treated with these products.



EC REP Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, 1e, Verd, 2595AA  
The Hague, Netherlands

Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd.  
No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015  
Hangzhou City, Zhejiang Province, China  
TEL: +86-571-58102870 FAX: +86-571-58102890  
E-mail: export@shinye-ortho.com

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие - стандартная  
пропись, с крючком, паз 0.022in, LR3HK,  
10 шт. в упаковке;

REF



LOT




Материал изделия содержит  
никель и хром.

Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологии Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

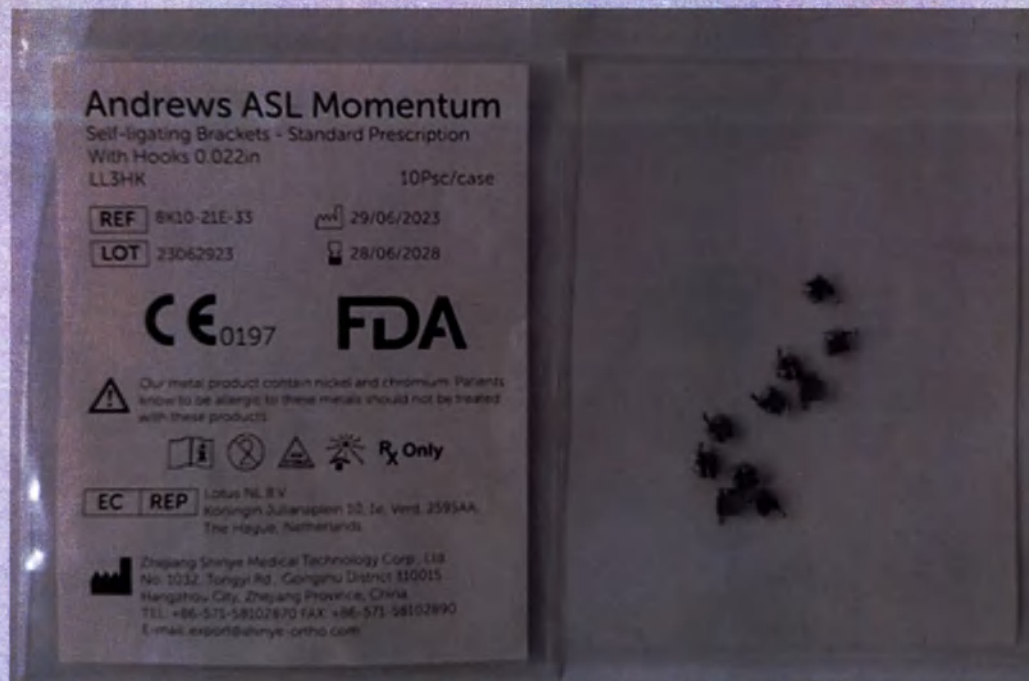

**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Брекеты самолигирующие - стандартная  
пропись, с крючком, паз 0.022in, LL3HK,  
10 шт. в упак.;

**REF**




**LOT**



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

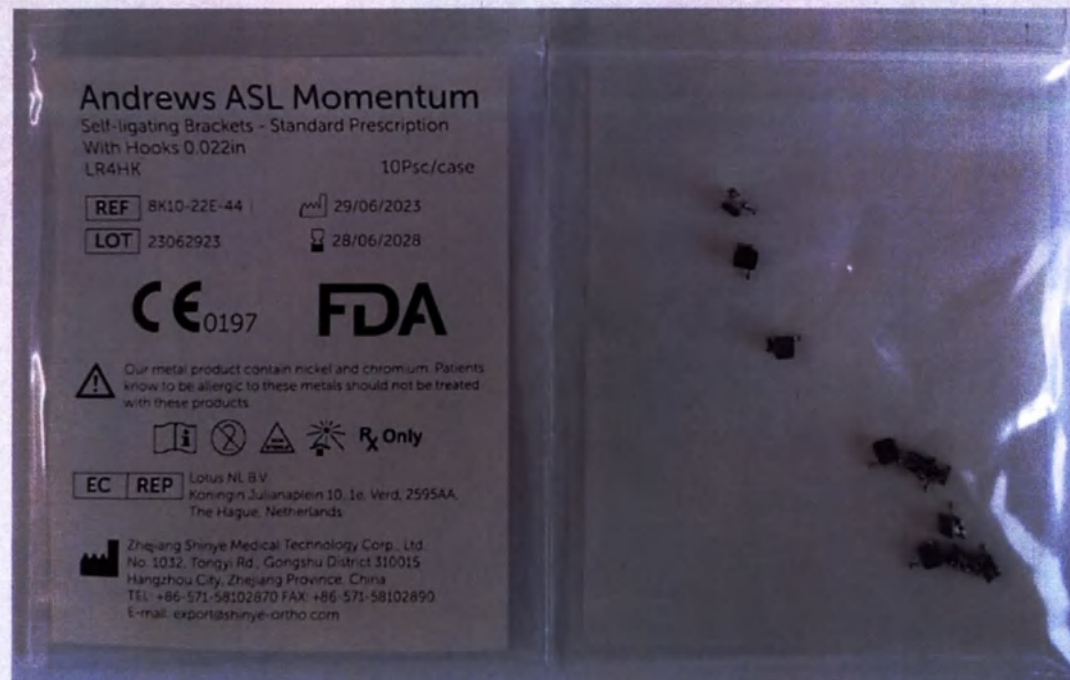

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие - стандартная  
пропись, с крючком, паз 0.022in, LR4HK,  
10 шт. в упаковке:

REF




LOT



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологии Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

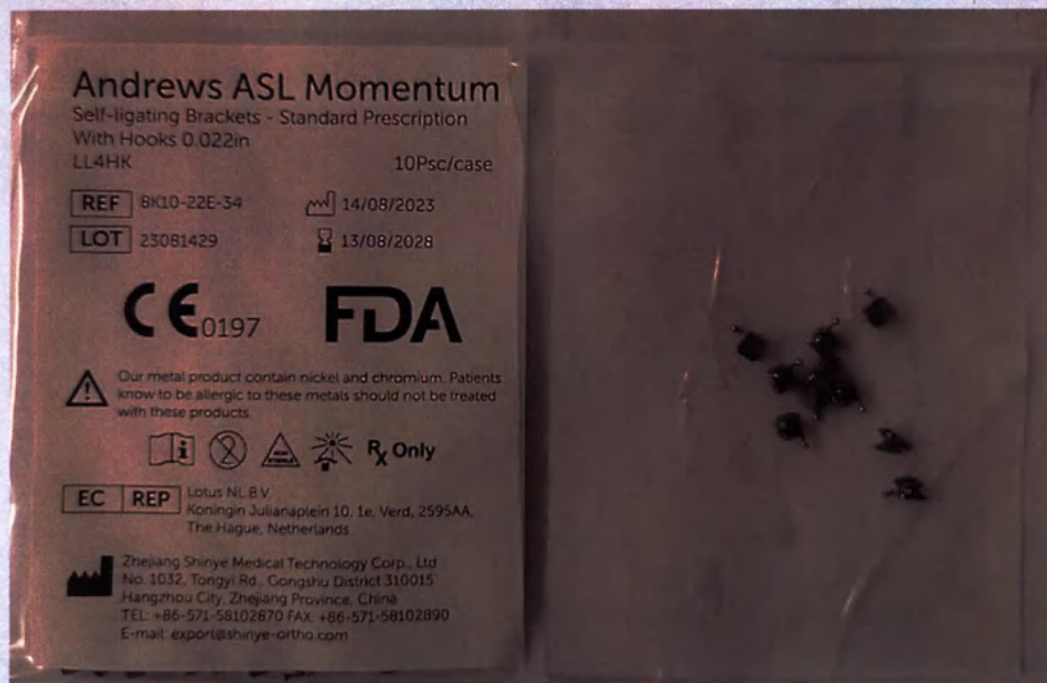

**Брекет ортодонтический самолигирующий Andrews ASL Momentum, вариант исполнения:**

Брекеты самолигирующие - стандартная пропись, с крючком, паз 0.022in, LL4HK, 10 шт. в упак.;

REF




LOT




Материал изделия содержит никель и хром. Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

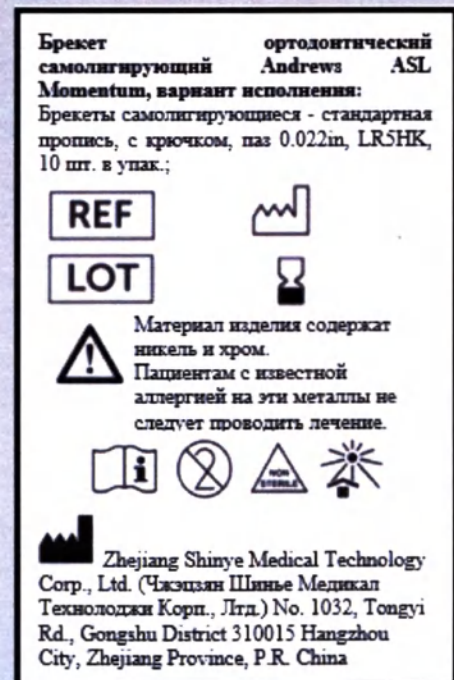

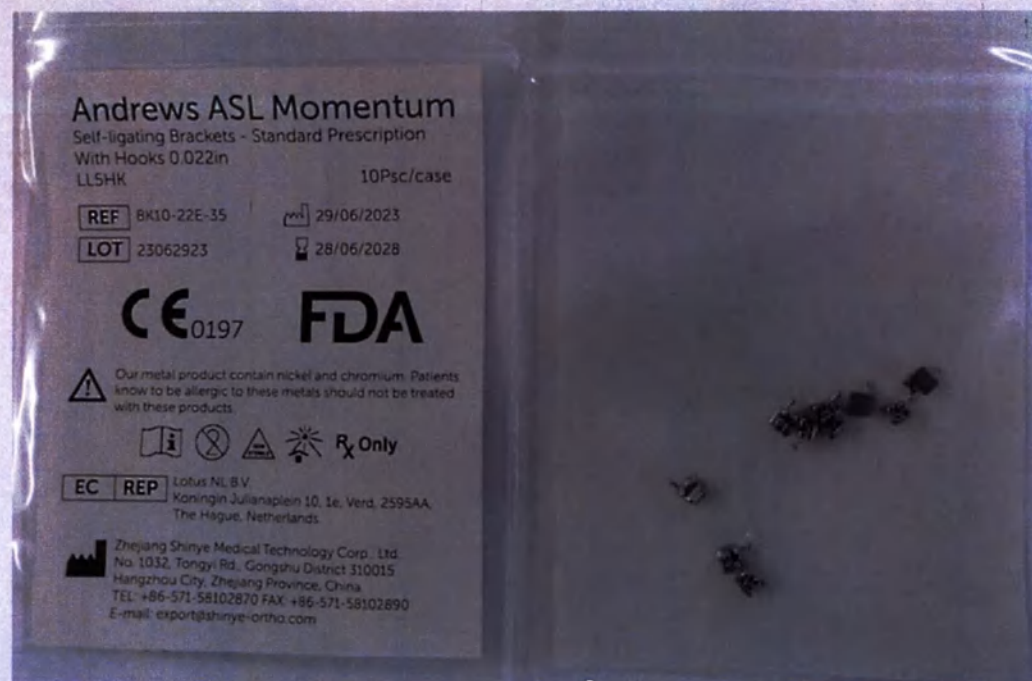

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие - стандартная  
пропись, с крючком, паз 0.022in, LL5HK,  
10 шт. в упак.;

REF



LOT




Материал изделия содержит  
никель и хром.

Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

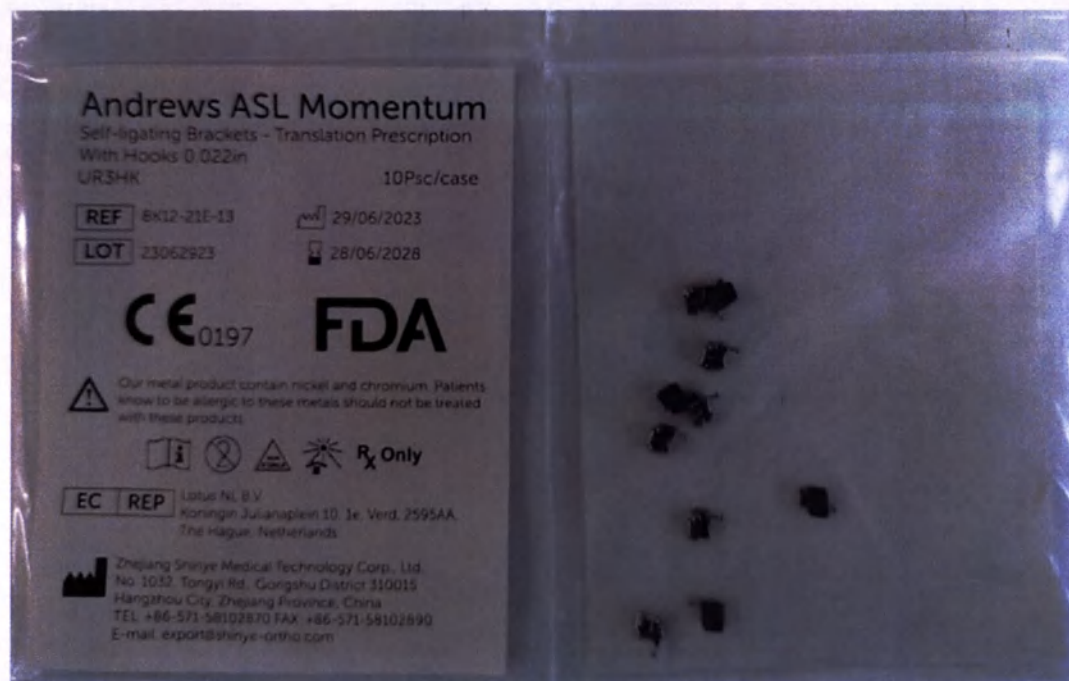

**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Брекеты самолигирующиеся -  
трансляционная пропись, с крючком, паз  
0.022in, UR3HK, 10 шт. в упаковке;


**REF** 

**LOT** 

**⚠** Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.

 **Zhejiang Shinye Medical Technology**  
**Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал**  
**Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi**  
**Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou**  
**City, Zhejiang Province, P.R. China**

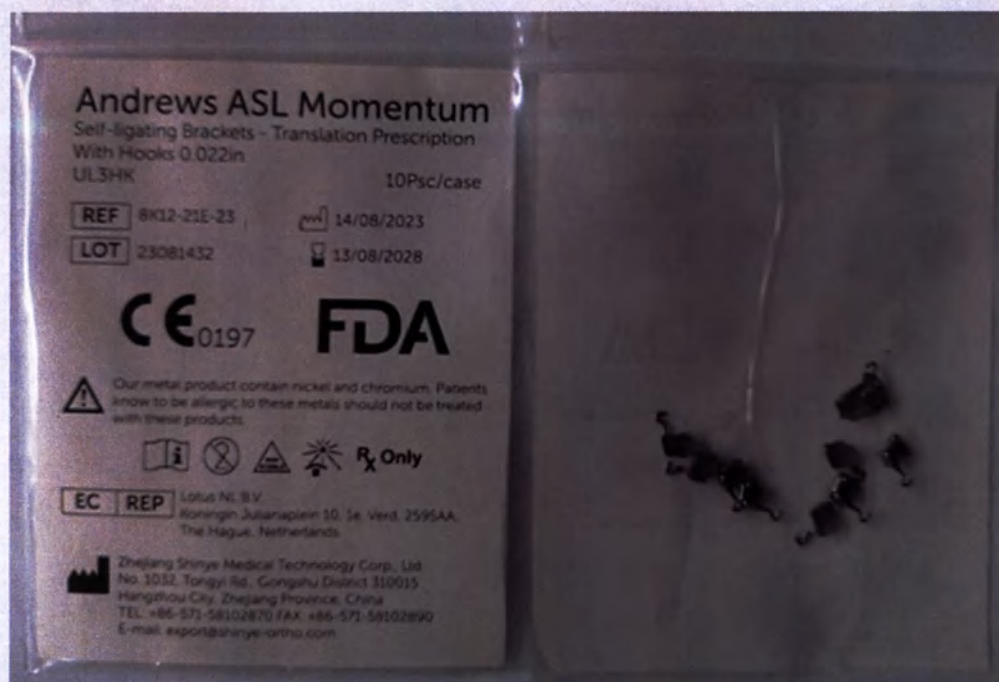

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие с  
транзиторной прописью, с крючком, паз  
0.022in, UL3HK, 10 шт. в упаковке;

REF




LOT



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

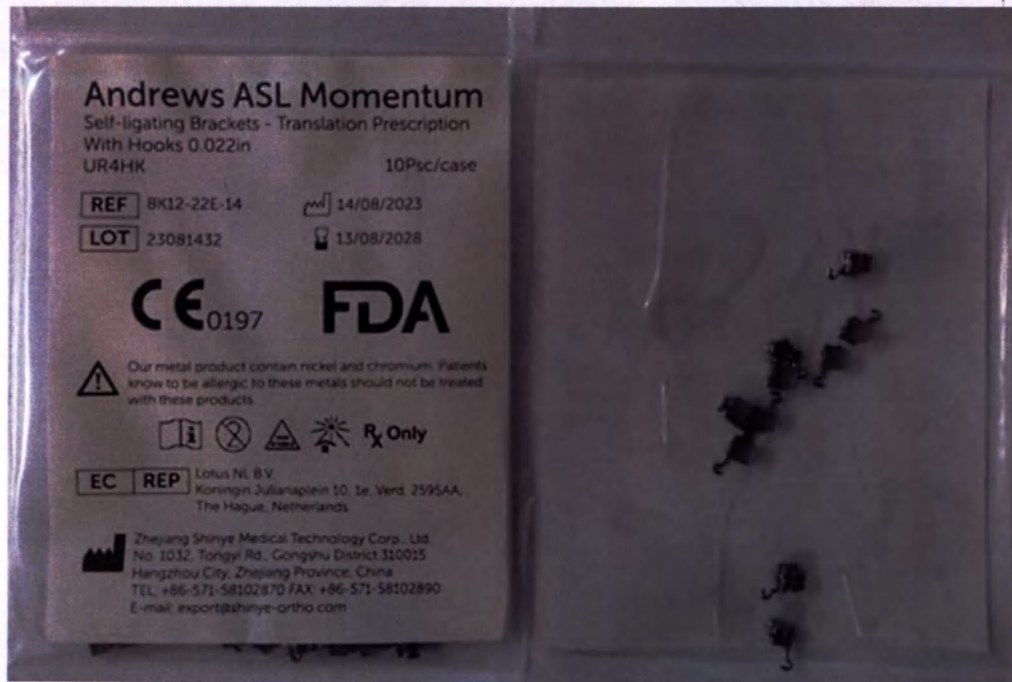

**Andrews ASL Momentum**  
Self-ligating Brackets - Translation Prescription  
With Hooks 0.022in  
UR4HK 10Psc/case

REF 8K12-22E-14 14/08/2023  
LOT 23081432 13/08/2028

**CE** 0197 **FDA**

⚠ Our metal product contain nickel and chromium. Patients know to be allergic to these metals should not be treated with these products.

ⓘ ⓧ ⚠ ⚡ Rx Only

EC REP Lotus NL B.V.  
Koningin Julianaplein 10, 1e. Verd. 2595AA,  
The Hague, Netherlands.

Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd.  
No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015  
Hangzhou City, Zhejiang Province, China  
TEL: +86-571-58102870 FAX: +86-571-58102890  
E-mail: export@shinye-ortho.com

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующиеся -  
трансляционная пропись, с крючком, паз  
0.022in, UR4HK, 10 шт. в упак.;


REF


LOT



⚠ Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.


ⓘ ⓧ ⚠ ⚡


Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

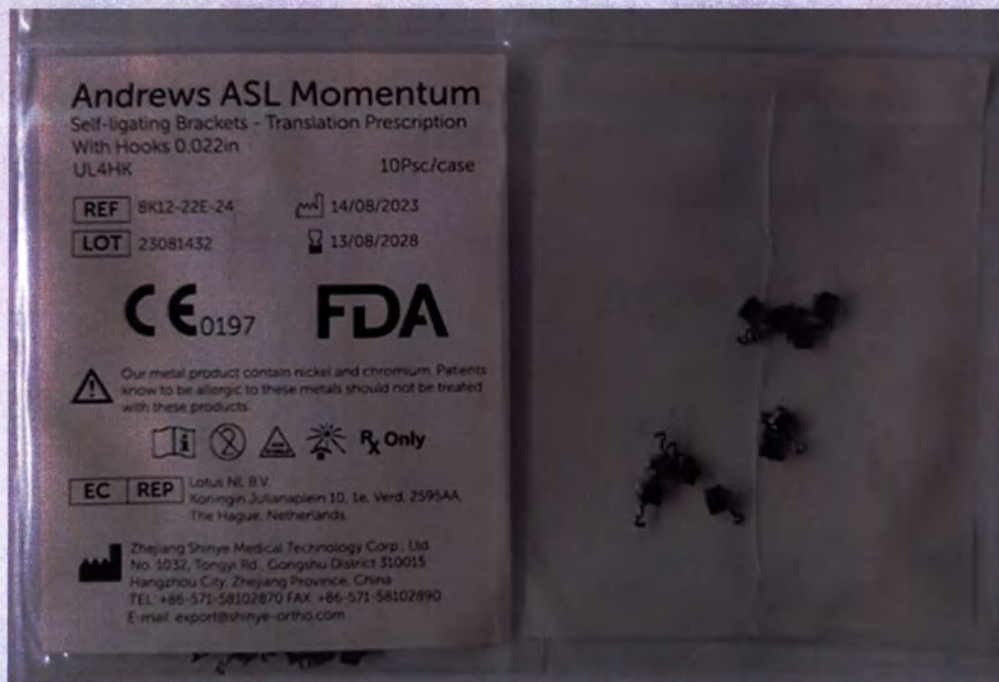

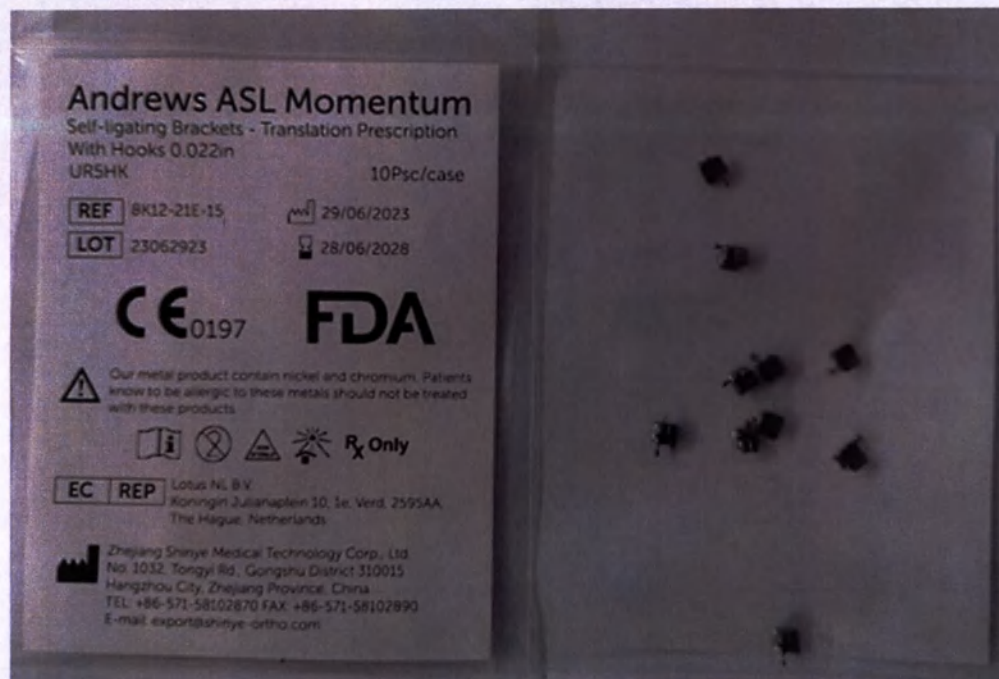

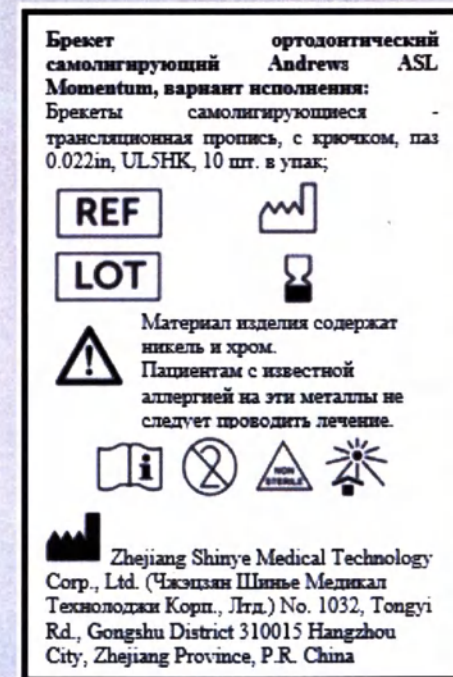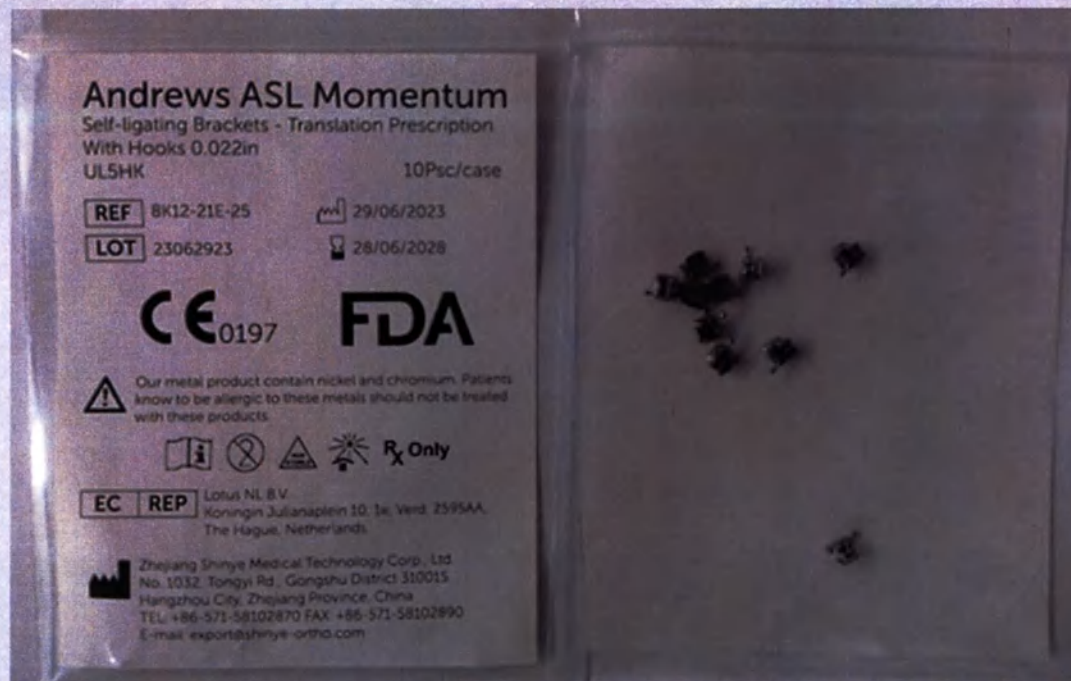

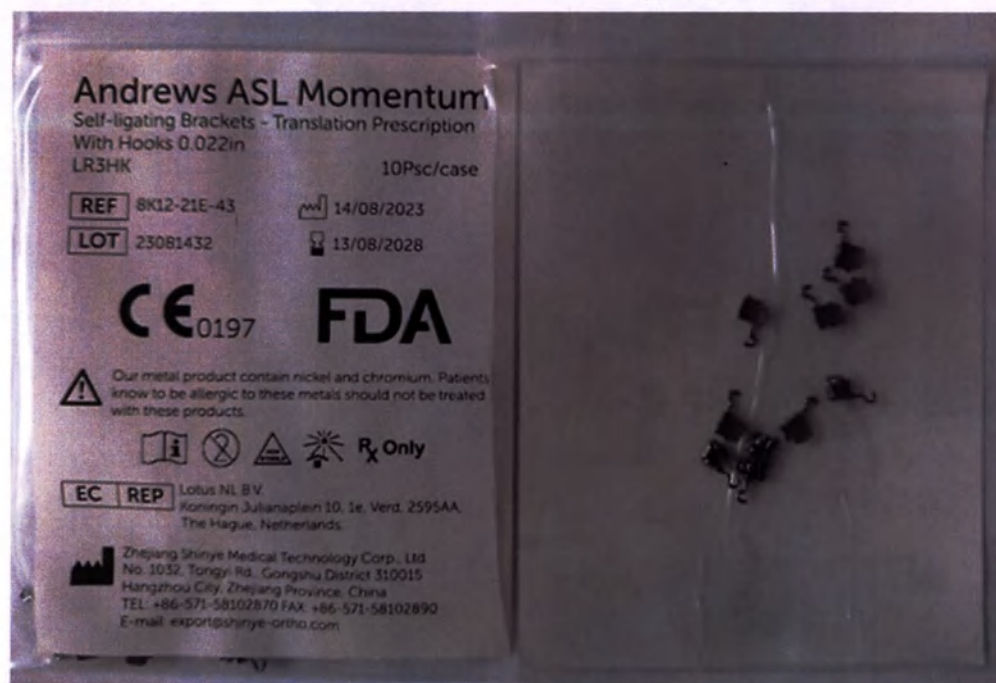

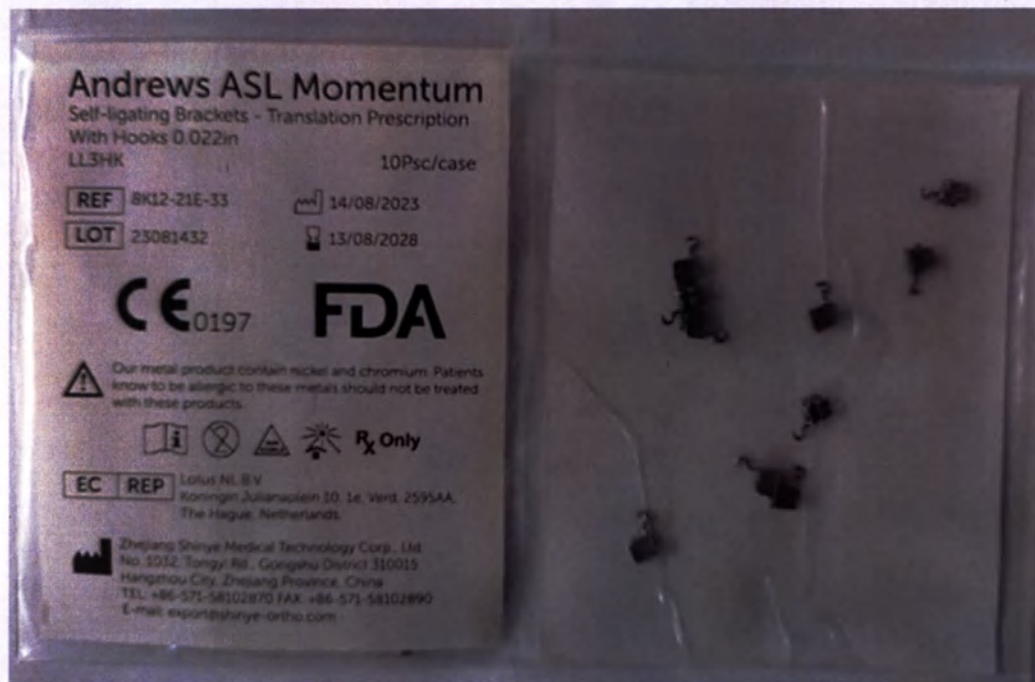

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующиеся  
трансляционная пропись, с крючком, паз  
0.022in, LL3HK, 10 шт. в упак.;

REF



LOT



Материал изделия содержат  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China



**Брекет самолигирующий ортодонтический**  
**Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Брекеты самолигирующие -  
трансляционная пропись, с крючком, паз  
0.022in, LR4HK, 10 шт. в упаковке;


**REF**

**LOT**

⚠ Материал изделия содержит никель и хром.  
Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.

ⓘ ⚡ ⚠ ⚡

Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

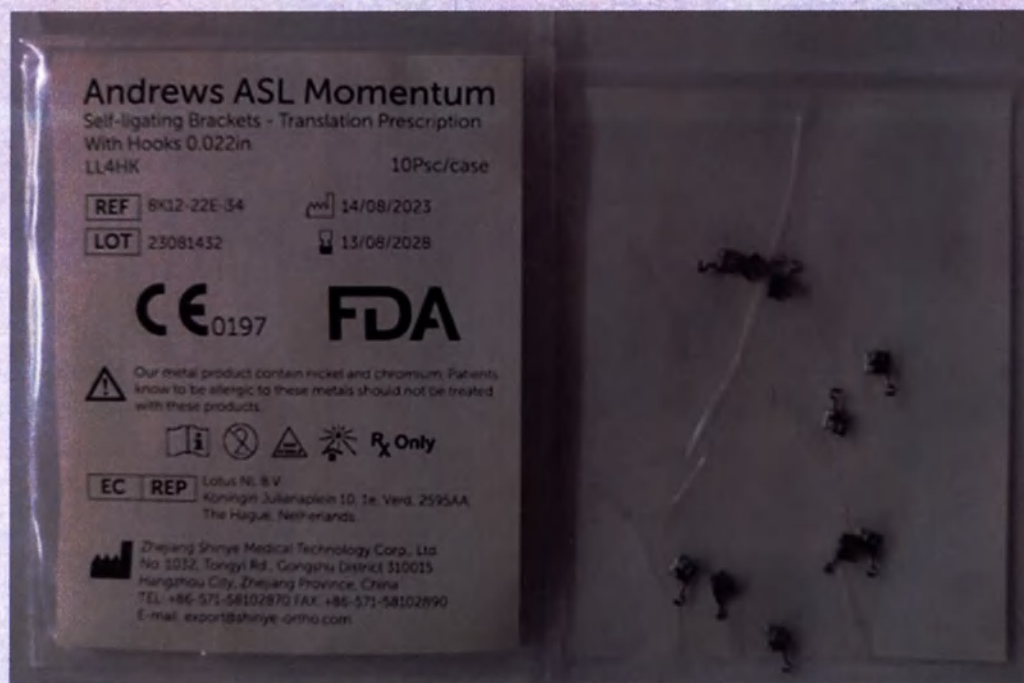


**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Брекеты самолигирующие -  
трансляционная пропись, с крючком, паз  
0.022in, LL4HK, 10 шт. в упаковке;

REF LOT

Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.

Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

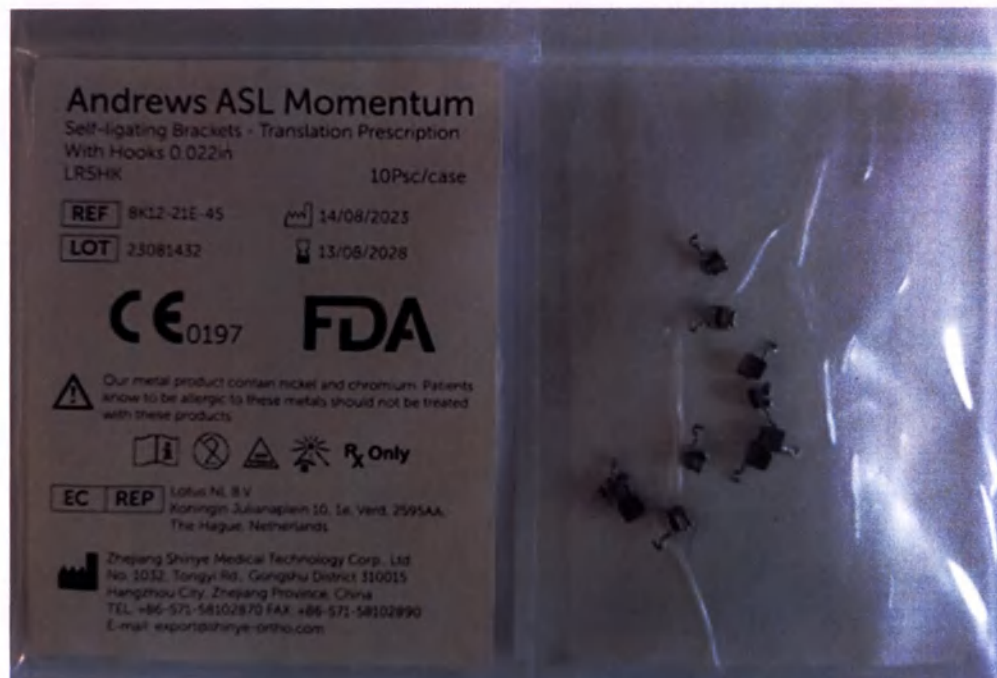

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующиеся  
транслационная пропись, с крючком, паз  
0.022in, LR5HK, 10 шт. в упаковке;

REF




LOT



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

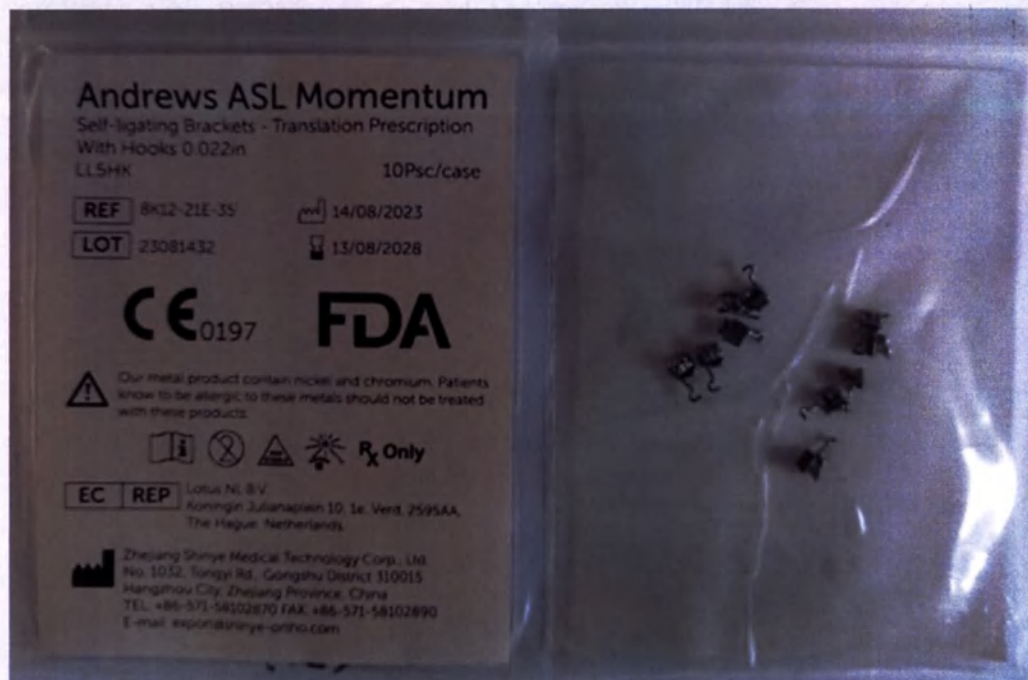

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Брекеты самолигирующие -  
трансляционная пропись, с крючком, паз  
0.022in, LL5HK, 10 шт. в упаковке;

REF




LOT



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

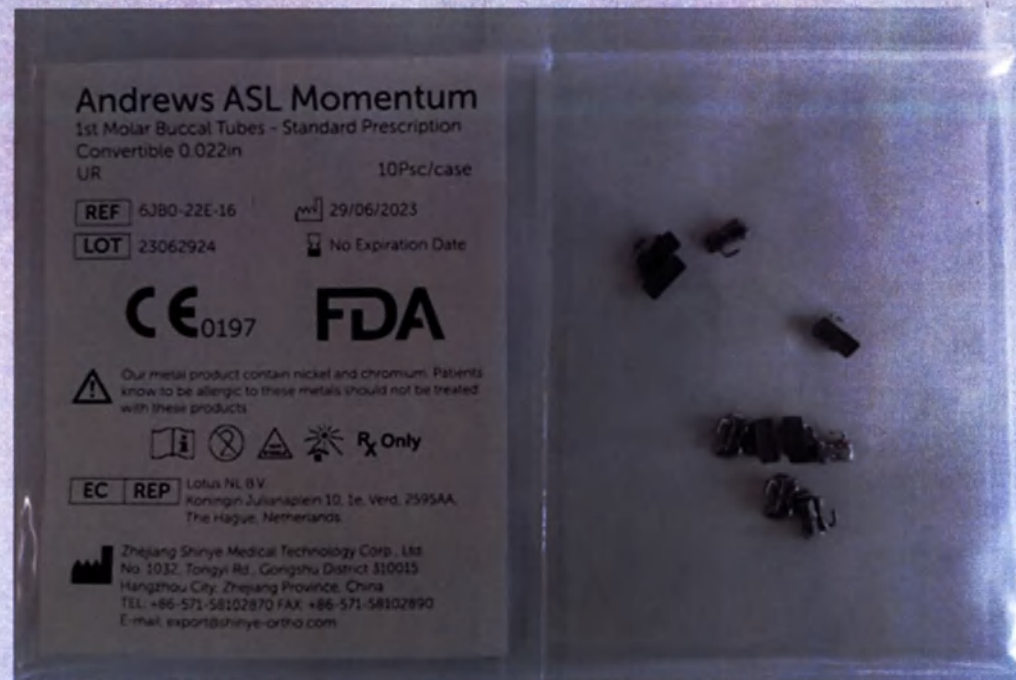

Брекет ортодонтический  
самолитирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:

Трубки щечные на первые моляры -  
стандартная пропись, конвертируемые, паз  
0.022in, UR, 10 шт. в упак.

REF



LOT




Материал изделия содержат  
никель и хром.

Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

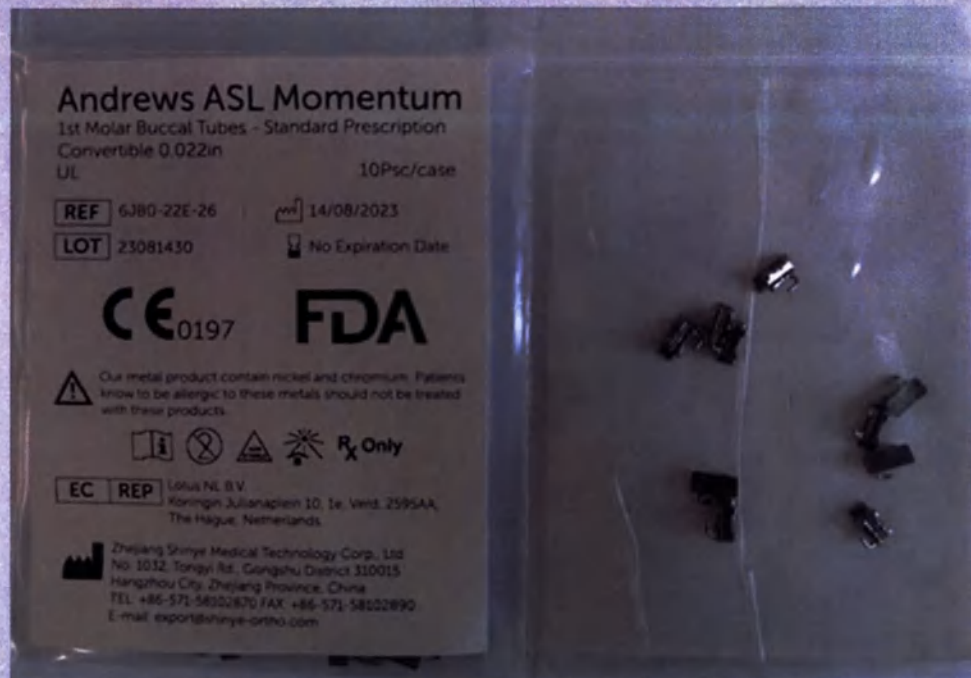

**Брекет самолигирующий ортодонтический Andrews ASL Momentum, вариант исполнения:**  
Трубки щечные на первые моляры - стандартная пропись, конвертируемые, паз 0.022in, UL, 10 шт. в упак;

**REF**




**LOT**



Материал изделия содержит никель и хром. Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технологии Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

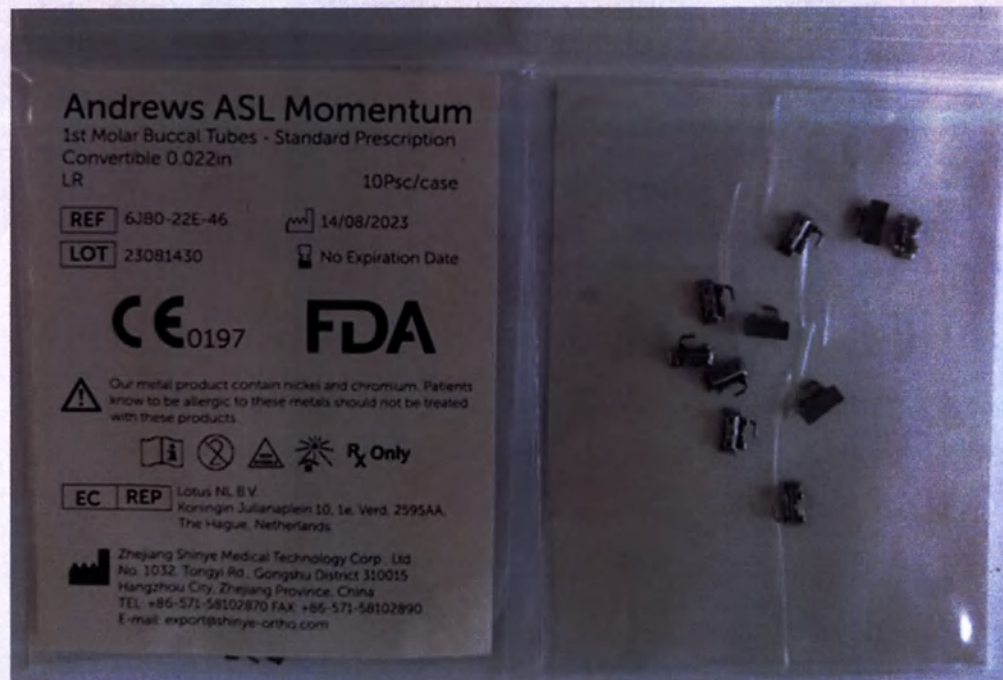

**Брекет** ортодонтический  
**самолигирующий** **Andrews ASL**  
**Momentum**, вариант исполнения:  
Трубки щечные на первые моляры -  
стандартная пропись, конвертируемые, паз  
0.022in, LR, 10 шт. в упак;

**REF**



**LOT**



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China



**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Трубки щечные на первые моляры -  
стандартная пропись, конвертируемые, паз  
0.022in, LL, 10 шт. в упак.

**REF**



**LOT**



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологии Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China



**Брекет самолигирующий ортодонтический**  
**Momentum, вариант исполнения: Andrews ASL**  
Трубки щечные на первые моляры - транслационная пропись, конвертируемые, паз 0.022in, UR, 10 шт. в упаковке;

REF




LOT



Материал изделия содержит никель и хром.  
Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

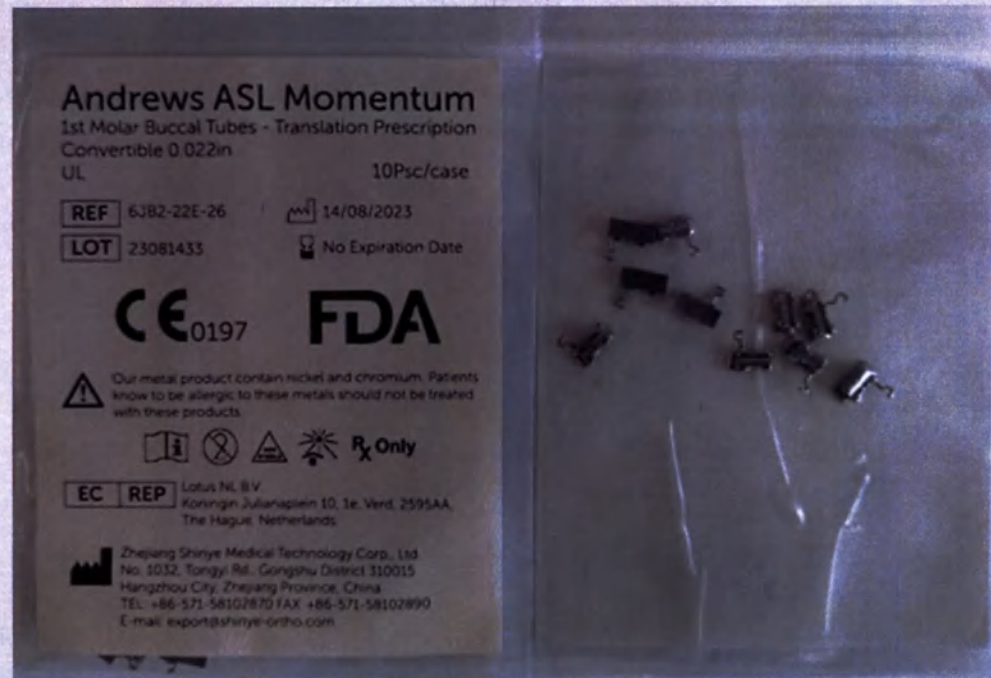

**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Трубки щечные на первые моляры -  
транслиционная пропись, конвертируемые,  
паз 0.022in, UL, 10 шт. в упак.;

**REF**

**LOT**

**Материал изделия содержит никель и хром. Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.**

**Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технологии Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China**





**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Трубки щечные на первые моляры -  
трансляционная пропись, конвертируемые,  
паз 0.022in, LL, 10 шт. в упаковке;


**REF** 

**LOT** 

⚠ Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.

ⓘ ⚠ ⚡

 Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

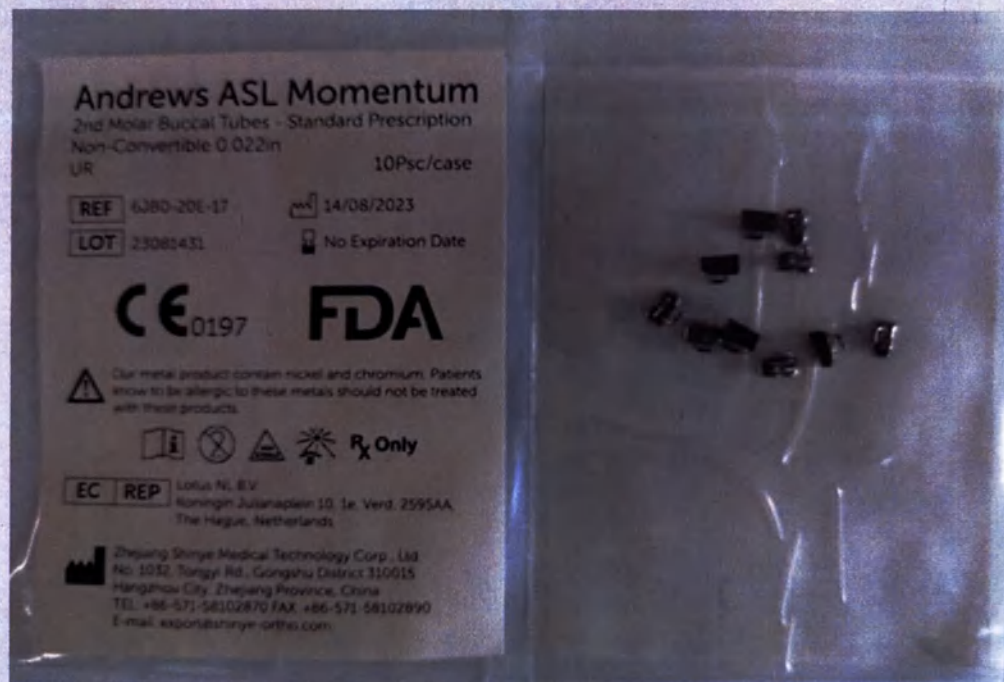

Брекет самолигирующий ортодонтический  
Andrews ASL Momentum, вариант исполнения:

Трубки щечные на вторые моляры - стандартная пропись, неконвертируемые, паз 0.022in, UR, 10 шт. в упак;

REF



LOT




Материал изделия содержит никель и хром.

Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

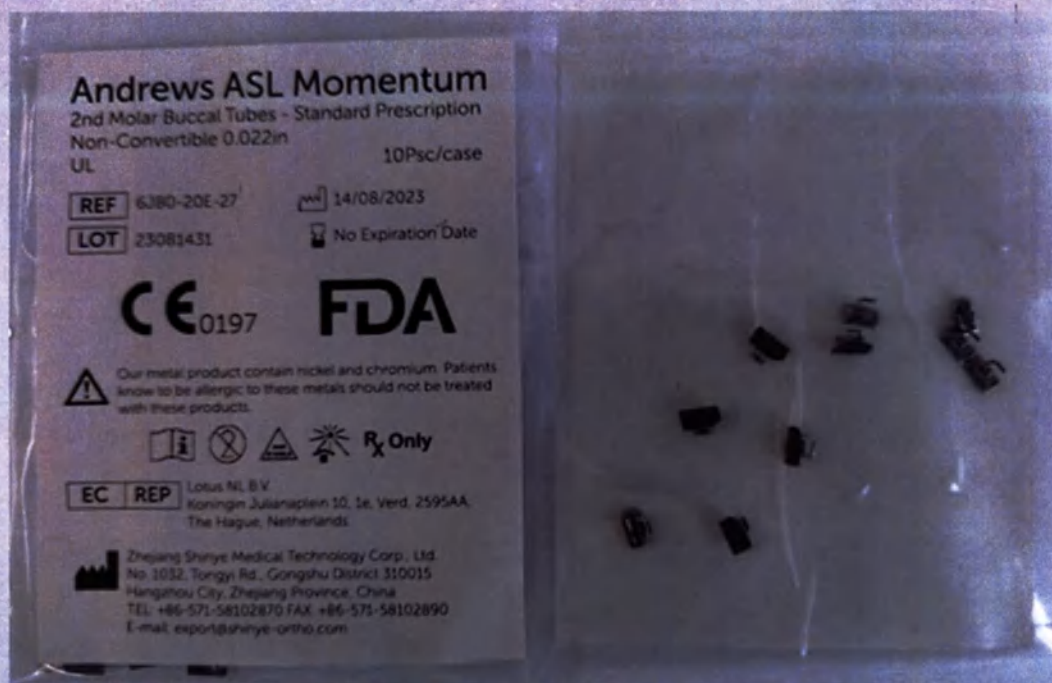

**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
 Трубки щечные на вторые моляры -  
 стандартная пропись, неконвертируемые,  
 паз 0.022in. UL, 10 шт. в упаковке;

**REF**

**LOT**

**Материал изделия содержит**  
**никель и хром.**  
**Пациентам с известной**  
**аллергией на эти металлы не**  
**следует проводить лечение.**

**Zhejiang Shinye Medical Technology**  
**Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал**  
**Технологиз Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi**  
**Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou**  
**City, Zhejiang Province, P.R. China**



Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Трубки щечные на вторые моляры -  
стандартная пропись, неконвертируемые,  
паз 0.022in, LR, 10 шт. в упак.;

REF





LOT




Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологии Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi  
Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou  
City, Zhejiang Province, P.R. China

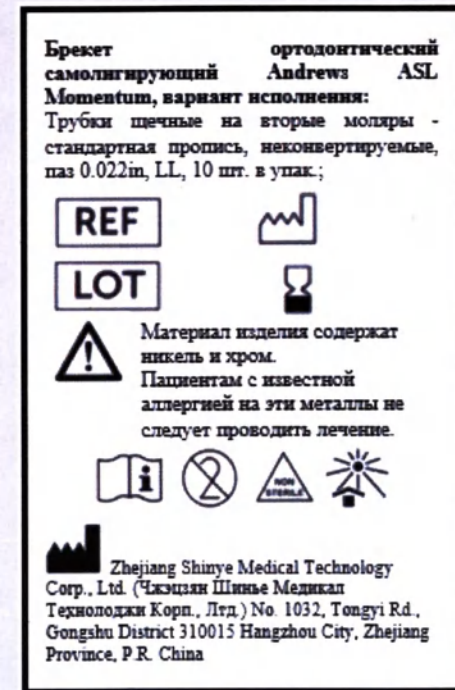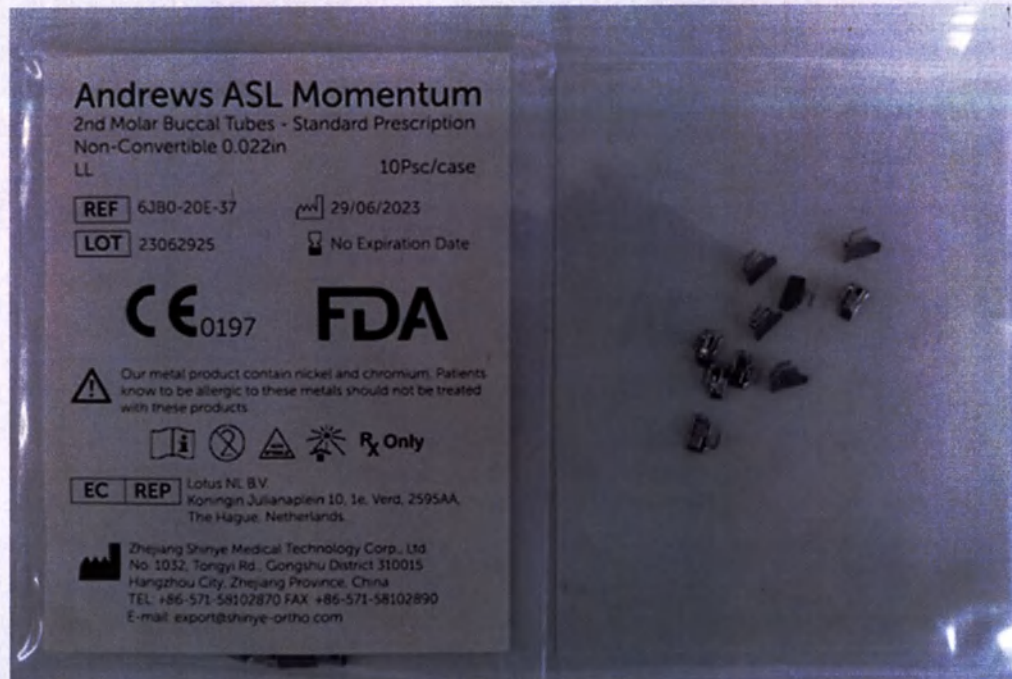

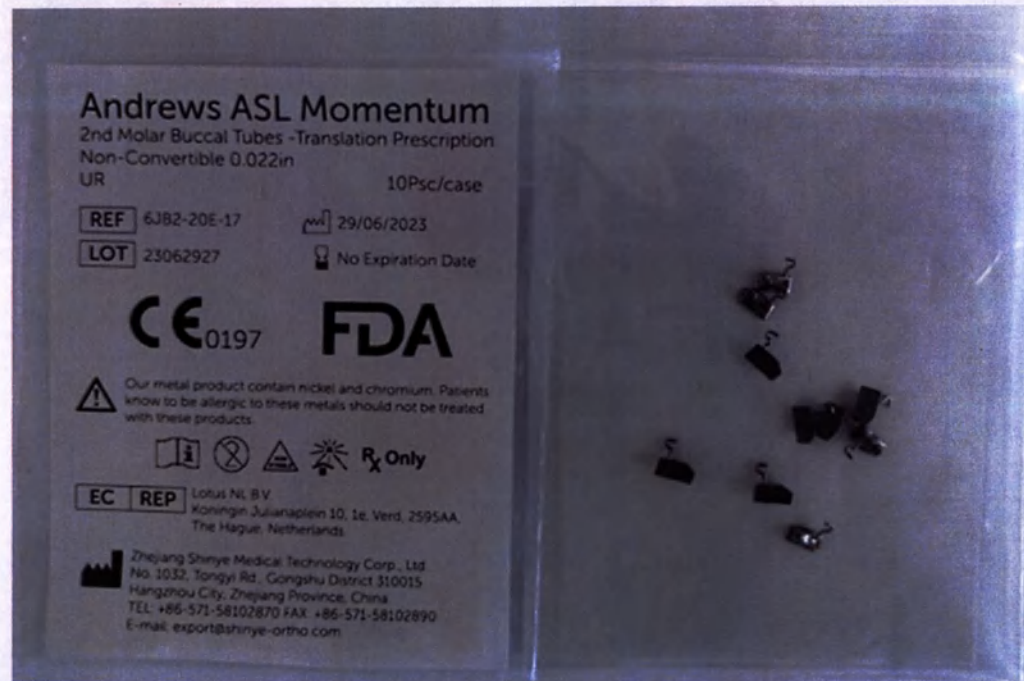

Брекет ортодонтический  
самолигирующий Andrews ASL  
Momentum, вариант исполнения:  
Трубки щечные на вторые моляры -  
трансляционная пропись,  
неконвертируемые, паз 0.022in, UR, 10 шт.  
в упаковке;

REF




LOT



Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технолоджи Корп., Лтд) No. 1032, Tongyi Rd.,  
Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang  
Province, P.R. China

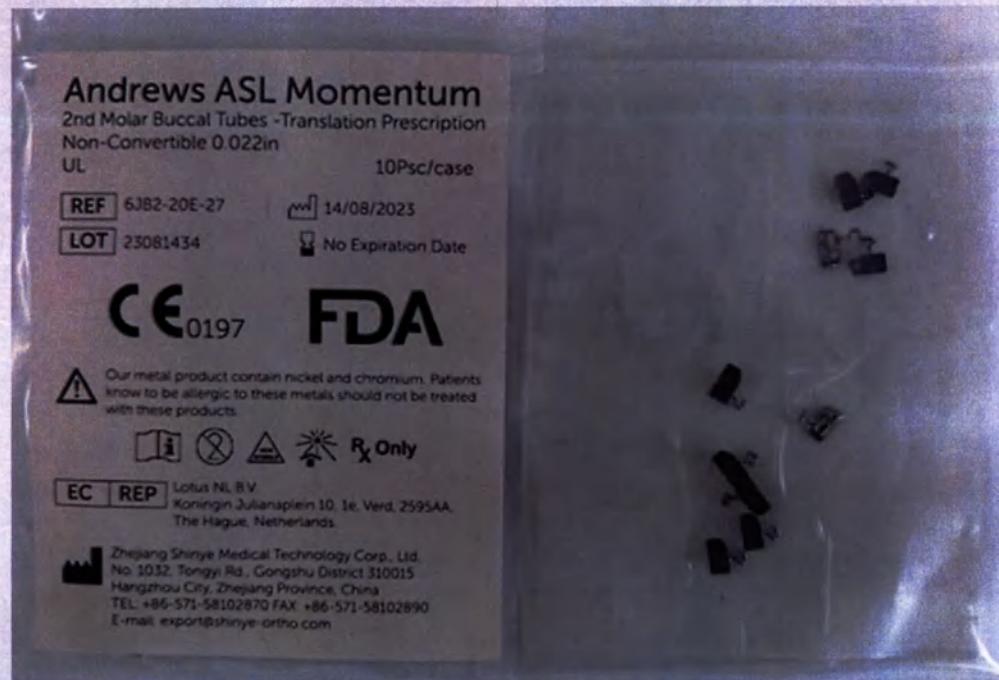

**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Трубки щечные на вторые моляры -  
трансляционная пропись,  
неконвертируемые, паз 0.022in, UL, 10 шт.  
в упак;

REF



LOT



Материал изделия содержит  
никель и хром.

Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.



Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd.,  
Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang  
Province, P.R. China




**Брекет самолигирующий ортодонтический Andrews ASL Momentum, вариант исполнения:**  
Трубки щечные на вторые моляры - транслационная пропись, неконвертируемые, паз 0.022in, LR, 10 шт. в упак.;

**REF**

**LOT**

Материал изделия содержит никель и хром. Пациентам с известной аллергией на эти металлы не следует проводить лечение.

Zhejiang Shinye Medical Technology Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал Технолоджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd., Gongshu District 310015 Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China

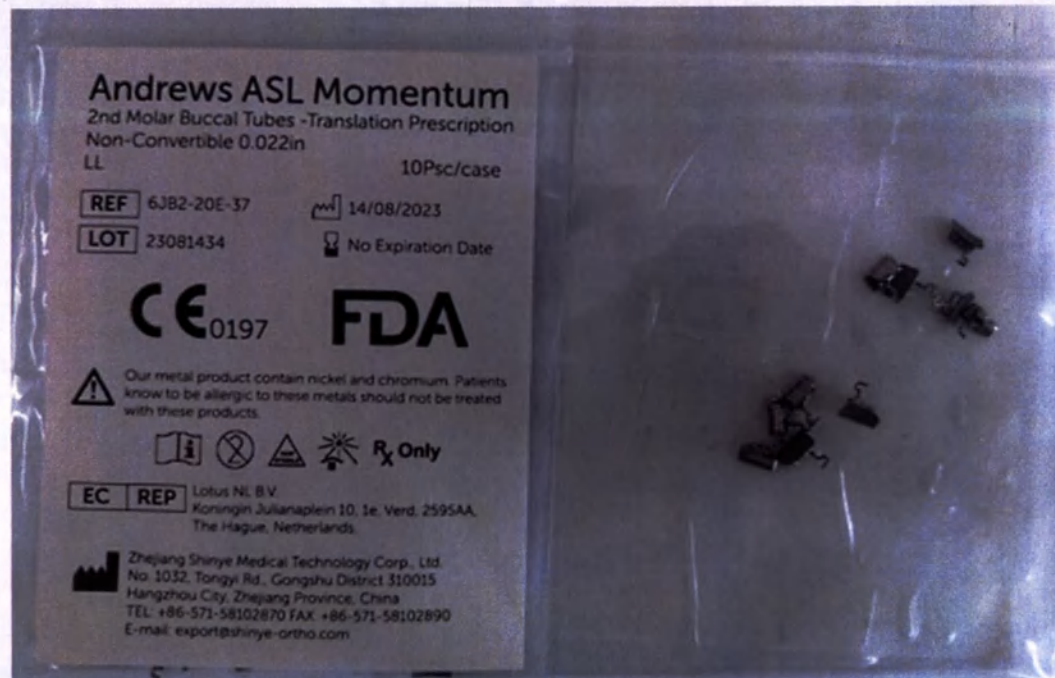

**Брекет ортодонтический**  
**самолигирующий Andrews ASL**  
**Momentum, вариант исполнения:**  
Трубки щечные на вторые моляры -  
трансляционная пропись,  
неконвертируемые, паз 0.022in, LL, 10 шт.  
в упак.

REF LOT

! Материал изделия содержит  
никель и хром.  
Пациентам с известной  
аллергией на эти металлы не  
следует проводить лечение.

i X A R<sub>x</sub> Only

Zhejiang Shinye Medical Technology  
Corp., Ltd. (Чжэцзян Шинье Медикал  
Технологджи Корп., Лтд.) No. 1032, Tongyi Rd.,  
Gongshu District 310015 Hanzhou City, Zhejiang

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Брекет ортодонтический самолигирующий Andrews ASL  
Momentum**

(для применения на территории Российской Федерации)

Прошито, пронумеровано 52 листов  
и скреплено печатью

Генеральный директор  
"ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
В ГОРОДЕ МОСКВЕ"



Орловский Д. Р.