



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE
в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин»,
по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 300-51-01

На коробку:

АллергоБлот-Скрин

Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022

LOT E003



2023-03-14

REF 300-51-01



2024-09-14

IVD



20



2°C



Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Пищевая панель №1 | 2 уп. (по 10 кассет) |
| 2. Конъюгат Е | 1 фл. (23 мл) |
| 3. Буфер Д | 1 фл. (20 мл) |
| 4. Буфер Р (20X) | 1 фл. (14 мл) |
| 5. Раствор ТМБ-М | 1 фл. (10 мл) |
| 6. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 2 шт. |
| 7. Инструкция по применению | 1 шт. |
| 8. Паспорт | 1 шт. |
| 9. Шкала для оценки результатов | 1 шт. |



1 234567 890128

АллергоБлот-Скрин

2024-09-14



E003

LOT

ТУ 21.20.23-645-98539446-2022

ПУ №

Для профессионального применения

F1

V002

На пакеты / флаконы:

Пищевая панель №1

АллергоБлот-Скрин

серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готова к использованию
только для диагностики in vitro



V001

-2 шт.

Конъюгат Е

АллергоБлот-Скрин

объем 23 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001

Буфер Д

АллергоБлот-Скрин

объем 20 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001

Буфер Р (20X)

объем 14 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

V001

Раствор ТМБ-М

объем 10 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»

Макет этикеток


ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 300-51-02

На коробку:

АллергоБлот-Скрин

Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022

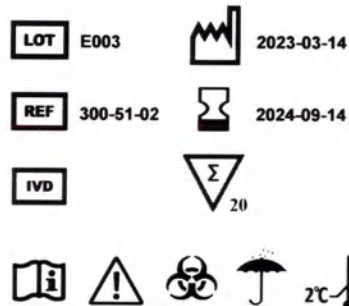


Комплект поставки:


- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Пищевая панель №2 | 2 уп. (по 10 кассет) |
| 2. Конъюгат Е | 1 фл. (23 мл) |
| 3. Буфер Д | 1 фл. (20 мл) |
| 4. Буфер Р (20Х) | 1 фл. (14 мл) |
| 5. Раствор ТМБ-М | 1 фл. (10 мл) |
| 6. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 2 шт. |
| 7. Инструкция по применению | 1 шт. |
| 8. Паспорт | 1 шт. |
| 9. Шкала для оценки результатов | 1 шт. |







АллергоБлот-Скрин

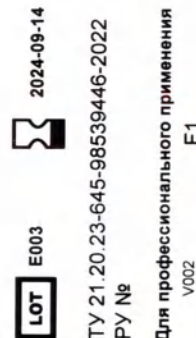

На пакеты / флаконы:

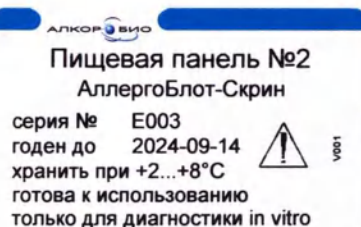

-2 шт.

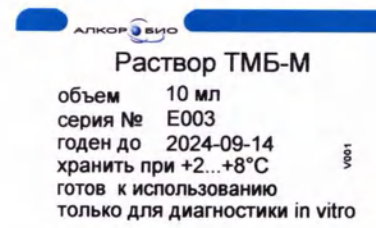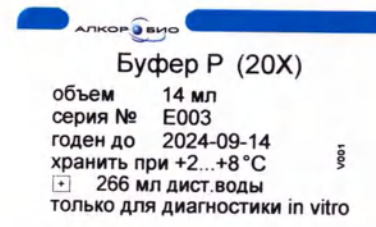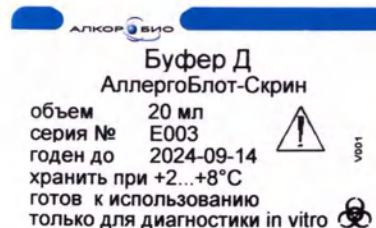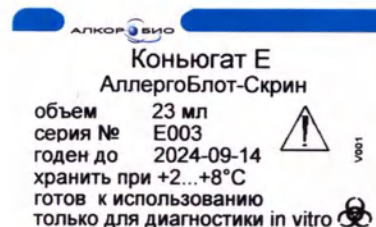

«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»

Макет этикеток



Кат. № 300-51-03

На коробку:

АллергоБлот-Скрин
Набор реагентов для качественного определения специфических IgE
в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин»,
по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022

LOT E003	 2023-03-14	Комплект поставки: 1. Ингаляционная панель №1 2 уп. (по 10 кассет) 2. Конъюгат Е 1 фл. (23 мл) 3. Буфер Д 1 фл. (20 мл) 4. Буфер Р (20Х) 1 фл. (14 мл) 5. Раствор ТМБ-М 1 фл. (10 мл) 6. Пакет закрывающийся полиэтиленовый 2 шт. 7. Инструкция по применению 1 шт. 8. Паспорт 1 шт. 9. Шкала для оценки результатов 1 шт.
REF 300-51-03	 2024-09-14	
IVD	 20	
     2°C -8°C		

АллергоБлот-Скрин

1 234567 890128

 2024-09-14

LOT E003

ТУ 21.20.23-645-98539446-2022
РУ №

Для профессионального применения
V002 F1

На пакеты / флаконы:

Ингаляционная панель №1
АллергоБлот-Скрин
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

-2 шт.

Конъюгат Е
АллергоБлот-Скрин
объем 23 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер Д
АллергоБлот-Скрин
объем 20 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

Буфер Р (20Х)
объем 14 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

Раствор ТМБ-М
объем 10 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 300-51-04

На коробку:

АллергоБлот-Скрин

Набор реагентов для качественного определения специфических IgE
в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин»,
по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022

LOT E003  2023-03-14

REF 300-51-04  2024-09-14

IVD  20



Комплект поставки:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ингаляционная панель №2 | 2 уп. (по 10 кассет) |
| 2. Конъюгат Е | 1 фл. (23 мл) |
| 3. Буфер Д | 1 фл. (20 мл) |
| 4. Буфер Р (20X) | 1 фл. (14 мл) |
| 5. Раствор ТМБ-М | 1 фл. (10 мл) |
| 6. Пакет закрывающийся
полиэтиленовый | 2 шт. |
| 7. Инструкция по применению | 1 шт. |
| 8. Паспорт | 1 шт. |
| 9. Шкала для оценки результатов | 1 шт. |



1 234567 890128

АллергоБлот-Скрин

LOT E003  2024-09-14
ТУ 21.20.23-645-98539446-2022
РУ №
Для профессионального применения
V002 F1

На пакеты / флаконы:

АЛКОР БИО
Ингаляционная панель №2
АллергоБлот-Скрин

серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готова к использованию
только для диагностики in vitro



V001

-2 шт.

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
АллергоБлот-Скрин

объем 23 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001

АЛКОР БИО
Буфер Д
АллергоБлот-Скрин

объем 20 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001

АЛКОР БИО
Буфер Р (20X)

объем 14 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

V001

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ-М

объем 10 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»

Макет этикеток


ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 300-51-05

На коробку:

АллергоБлот-Скрин

Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022

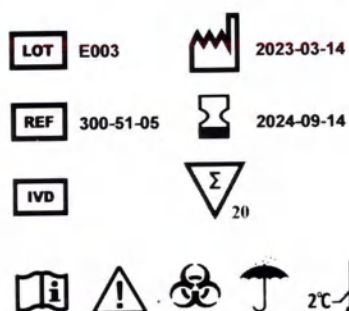


Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Педиатрическая панель | 2 уп. (по 10 кассет) |
| 2. Конъюгат Е | 1 фл. (23 мл) |
| 3. Буфер Д | 1 фл. (20 мл) |
| 4. Буфер Р (20X) | 1 фл. (14 мл) |
| 5. Раствор ТМБ-М | 1 фл. (10 мл) |
| 6. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 2 шт. |
| 7. Инструкция по применению | 1 шт. |
| 8. Паспорт | 1 шт. |
| 9. Шкала для оценки результатов | 1 шт. |



АллергоБлот-Скрин

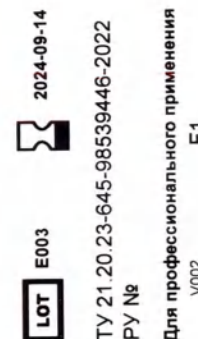

На пакеты / флаконы:

АЛКОР БИО
Педиатрическая панель
АллергоБлот-Скрин
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

-2шт.

АЛКОР БИО
Конъюгат Е
АллергоБлот-Скрин
объем 23 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Буфер Д
АллергоБлот-Скрин
объем 20 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Буфер Р (20X)
объем 14 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

АЛКОР БИО
Раствор ТМБ-М
объем 10 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 300-51-06

На коробку:

АллергоБлот-Скрин

Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022

LOT E003  2023-03-14

REF 300-51-06  2024-09-14

IVD  20



Комплект поставки:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Атопическая панель | 2 уп. (по 10 кассет) |
| 2. Конъюгат Е | 1 фл. (23 мл) |
| 3. Буфер Д | 1 фл. (20 мл) |
| 4. Буфер Р (20X) | 1 фл. (14 мл) |
| 5. Раствор ТМБ-М | 1 фл. (10 мл) |
| 6. Пакет закрывающийся полиэтиленовый | 2 шт. |
| 7. Инструкция по применению | 1 шт. |
| 8. Паспорт | 1 шт. |
| 9. Шкала для оценки результатов | 1 шт. |



1 234567 890128

АллергоБлот-Скрин

LOT E003  2024-09-14
ТУ 21.20.23-645-98539446-2022
РУ №
для профессионального применения
V002 F1

На пакеты / флаконы:

Атопическая панель
АллергоБлот-Скрин
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готова к использованию
только для диагностики in vitro



V001

-2 шт.

Конъюгат Е
АллергоБлот-Скрин
объем 23 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001

Буфер Р (20X)
объем 14 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

V001

Буфер Д
АллергоБлот-Скрин
объем 20 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro



V001

Раствор ТМБ-М
объем 10 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин», по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Кат. № 300-51-07

На коробку:

АллергоБлот-Скрин
Набор реагентов для качественного определения специфических IgE
в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин»,
по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022

LOT E003	 2023-03-14
REF 300-51-07	 2024-09-14
IVD	 20

     8°C

Комплект поставки:

1. Панель смесей аллергенов	2 уп. (по 10 кассет)
2. Конъюгат Е	1 фл. (23 мл)
3. Буфер Д	1 фл. (20 мл)
4. Буфер Р (20X)	1 фл. (14 мл)
5. Раствор ТМБ-М	1 фл. (10 мл)
6. Пакет закрывающийся полиэтиленовый	2 шт.
7. Инструкция по применению	1 шт.
8. Паспорт	1 шт.
9. Шкала для оценки результатов	1 шт.

АллергоБлот-Скрин



1 234567 890128

 2024-09-14

LOT E003

ТУ 21.20.23-645-98539446-2022
РУ №

Для профессионального применения
V002 F1

На пакеты / флаконы:

Панель смесей аллергенов
АллергоБлот-Скрин
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

 V001

-2 шт.

Конъюгат Е
АллергоБлот-Скрин
объем 23 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

  V001

Буфер Д
АллергоБлот-Скрин
объем 20 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

  V001

Буфер Р (20X)
объем 14 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
266 мл дист. воды
только для диагностики in vitro

V001

Раствор ТМБ-М
объем 10 мл
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готов к использованию
только для диагностики in vitro

V001

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
8 () лист 8

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Алкор Био" ДТ. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

"Компания Алкор Био" Полинцев Д.Г.

«А» 2024 г.

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для качественного определения специфических IgE
в сыворотке и плазме крови человека «АллергоБлот-Скрин»,
по ТУ 21.20.23-645-98539446-2022»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

АллергоБлот-Скрин




E003



2024-09-14

ТУ 21.20.23-645-98539446-2022
РУ №

Для профессионального применения
V002 F1

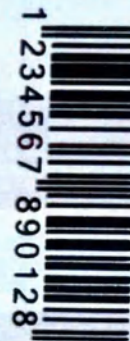

1 234567 890128

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО


**ШКАЛА
ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ**

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21

КРУПНО СЧИСЛАЕ
АЛКОР БИО

Панель смесей аллергенов
АллергоБлот-Скрин
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

Панель смесей аллергенов
АллергоБлот-Скрин
серия № E003
годен до 2024-09-14
хранить при +2...+8°C
готова к использованию
только для диагностики in vitro

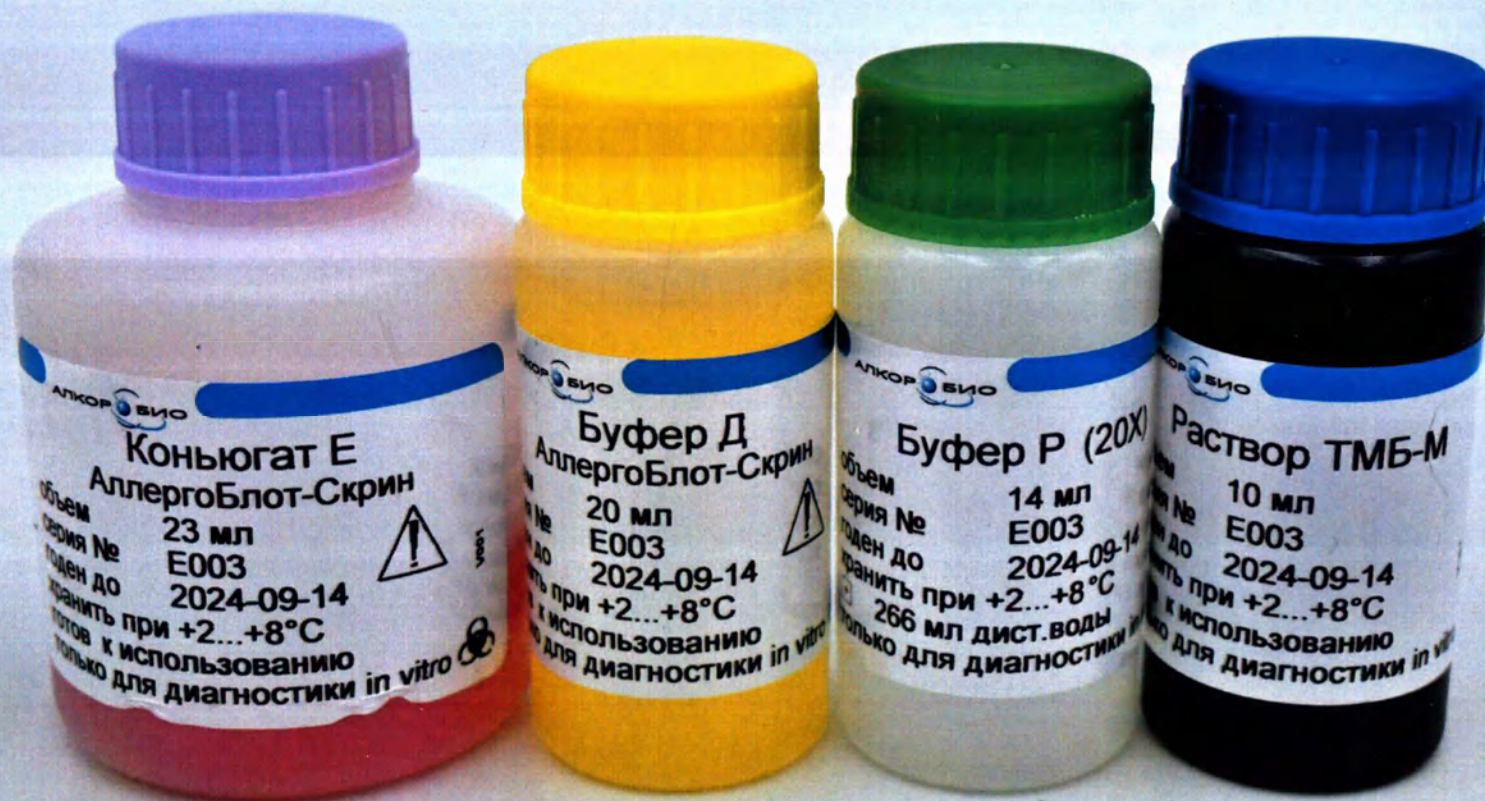

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

1 (схема) лист 80

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

