

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«09» января 2024 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022»

2024

Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ДГЭА-С

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT 20230701 01.01.2025 REF C86033 01.07.2023

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ДГЭА-С

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT 20230701 01.01.2025 REF C86033 01.07.2023

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ДГЭА-С

Набор реагентов на 500 тестов

YNLO



LOT	20230701	01.01.2025	REF	C86033
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ДГЭА-С

Набор реагентов на 1000 тестов

YNLO



LOT	20230701	01.01.2025	REF	C86033
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YHLO**

**Лидлаб Амур
ДГЭА-С**

3,5 мл 4,0 мл

R 1 R 2

LOT 20230701 01.01.2025

IVD

Биологическая опасность

Информация

Результат

37°C

1x50

9031 1017

лидкор

**Лидлаб Амур
ДГЭА-С**

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

01.01.2025

REF C86033

IVD

лидкор

Лидлаб Амур ДГЭА-С

1,0 мл

CAL 1

LOT 20230701

01.01.2025

REF C86033

IVD

лидкор

Лидлаб Амур ДГЭА-С

1,0 мл

CAL 2

LOT 20230701

01.01.2025

REF C86033

IVD

лидкор

Лидлаб Амур ДГЭА-С

1,0 мл

CAL 3

LOT 20230701

01.01.2025

REF C86033

IVD

лидкор

Лидлаб Амур ДГЭА-С

1,0 мл

CAL 4

LOT 20230701

01.01.2025

REF C86033


IVD


Лидлаб Амур ДГЭА-С



LOT 20230701 EXP 01.01.2025



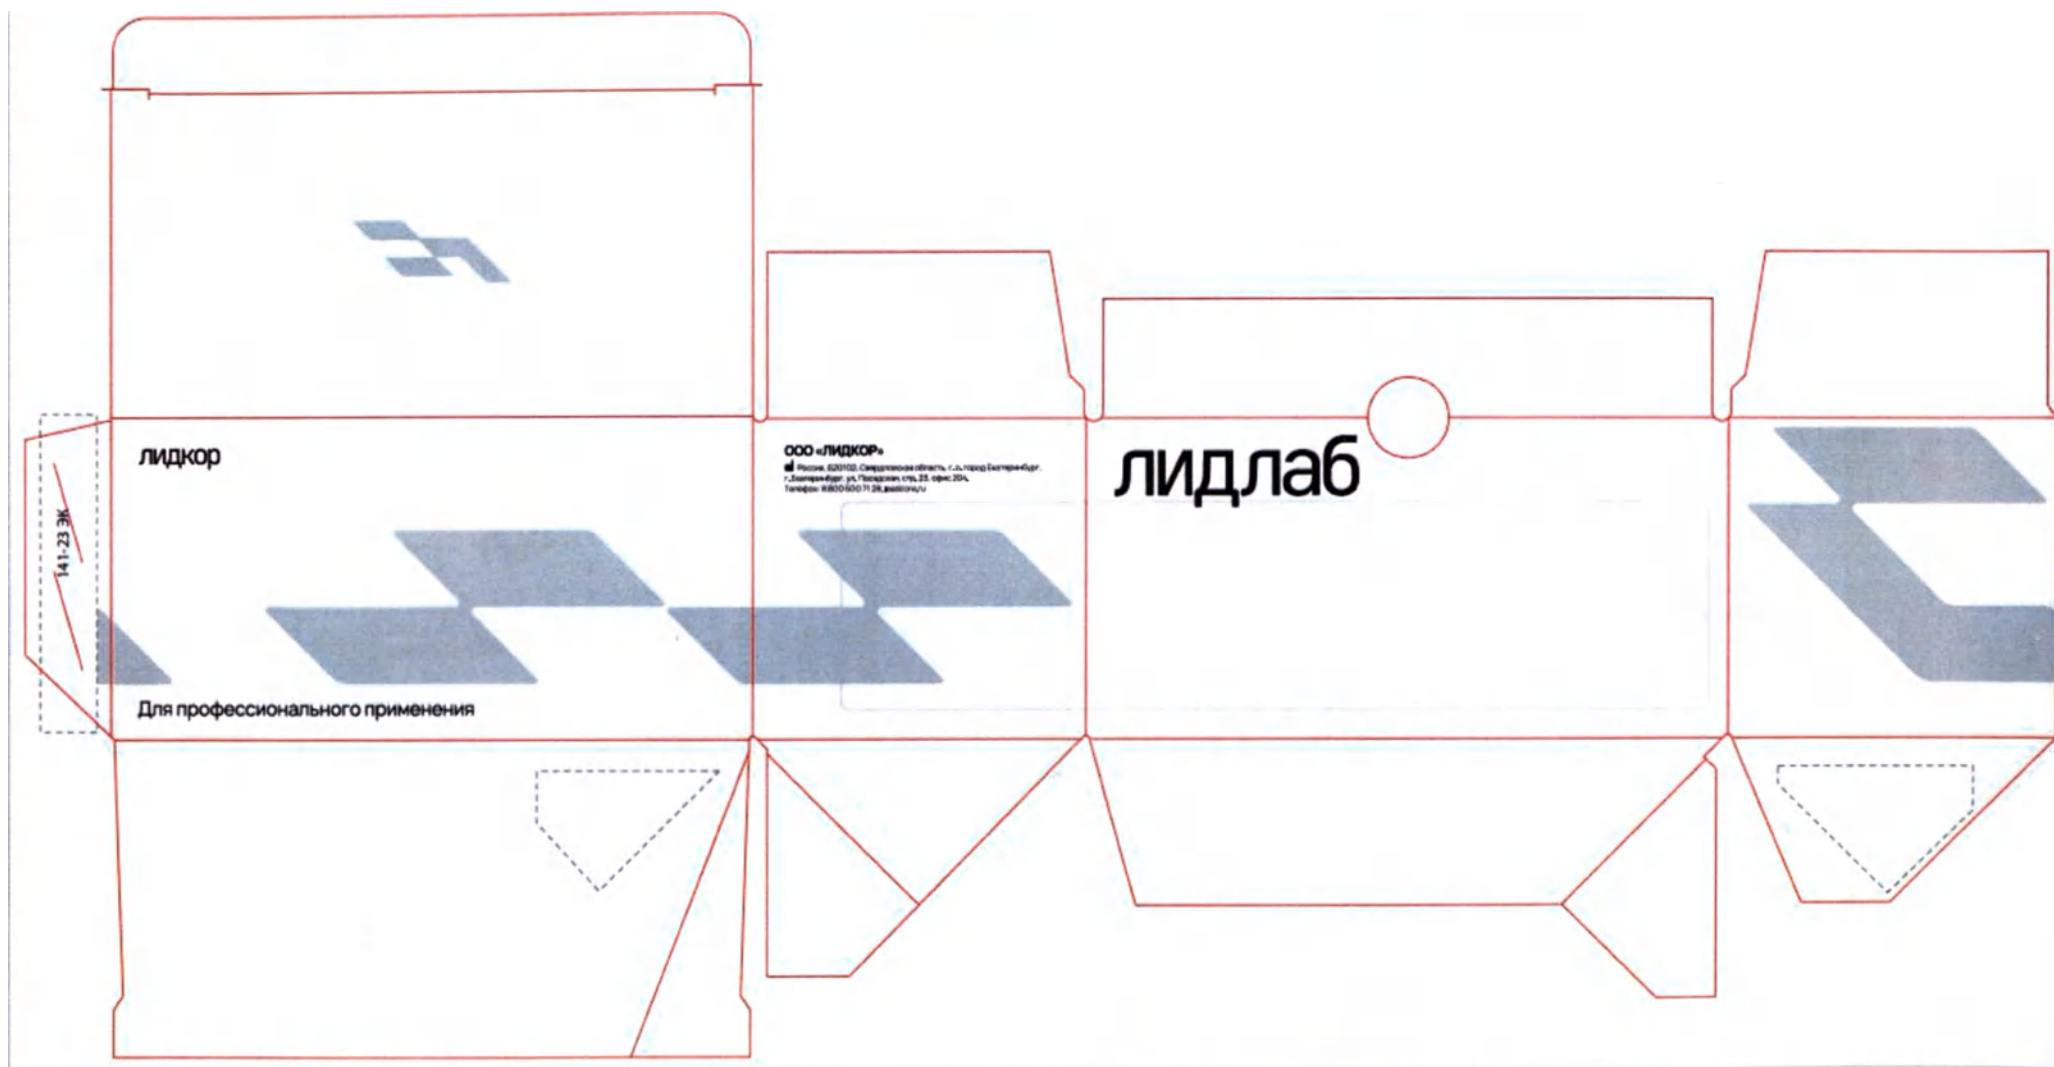

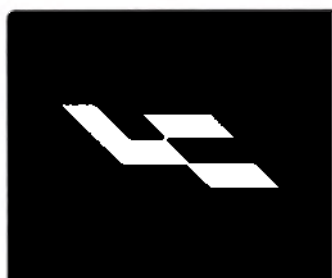

Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025
REF	C86033		



Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025
REF	C86033		




Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022

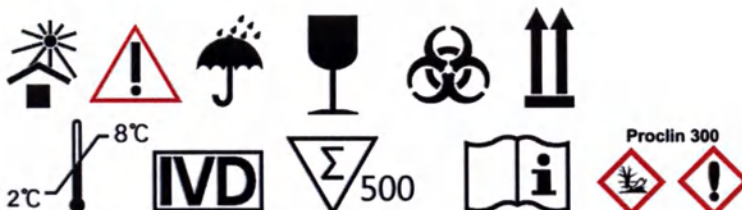

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025
REF	C86033		

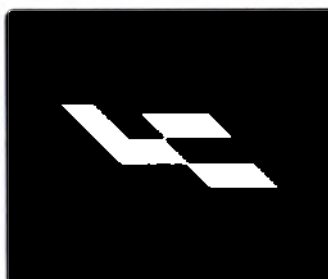

Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025
REF	C86033		

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.	 XXX
Наименование изделия	 ММ.ГГГГ
 XXXXXX	
 XXXXXXXX	 Только для in vitro диагностики Для профессионального применения
	
	
	
	GHS07  

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (восемь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«09» января 2024 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


«Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022»

2024


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

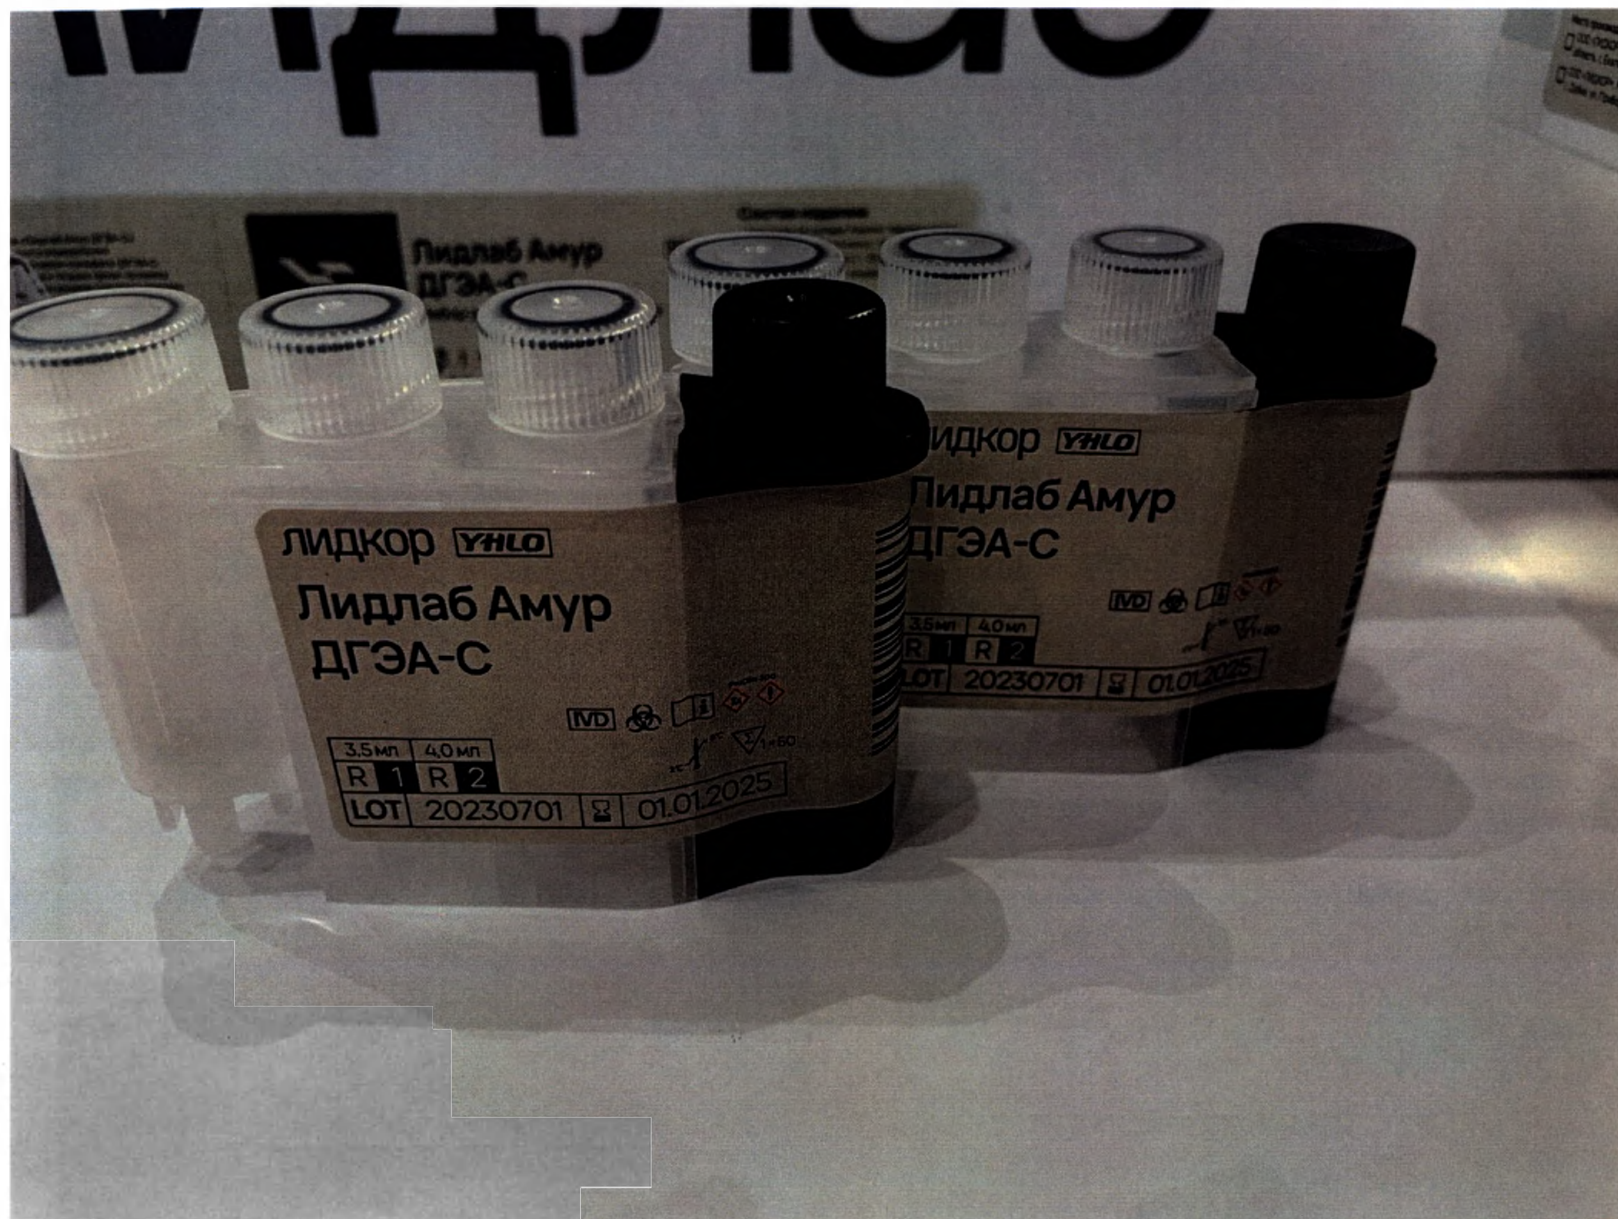


Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

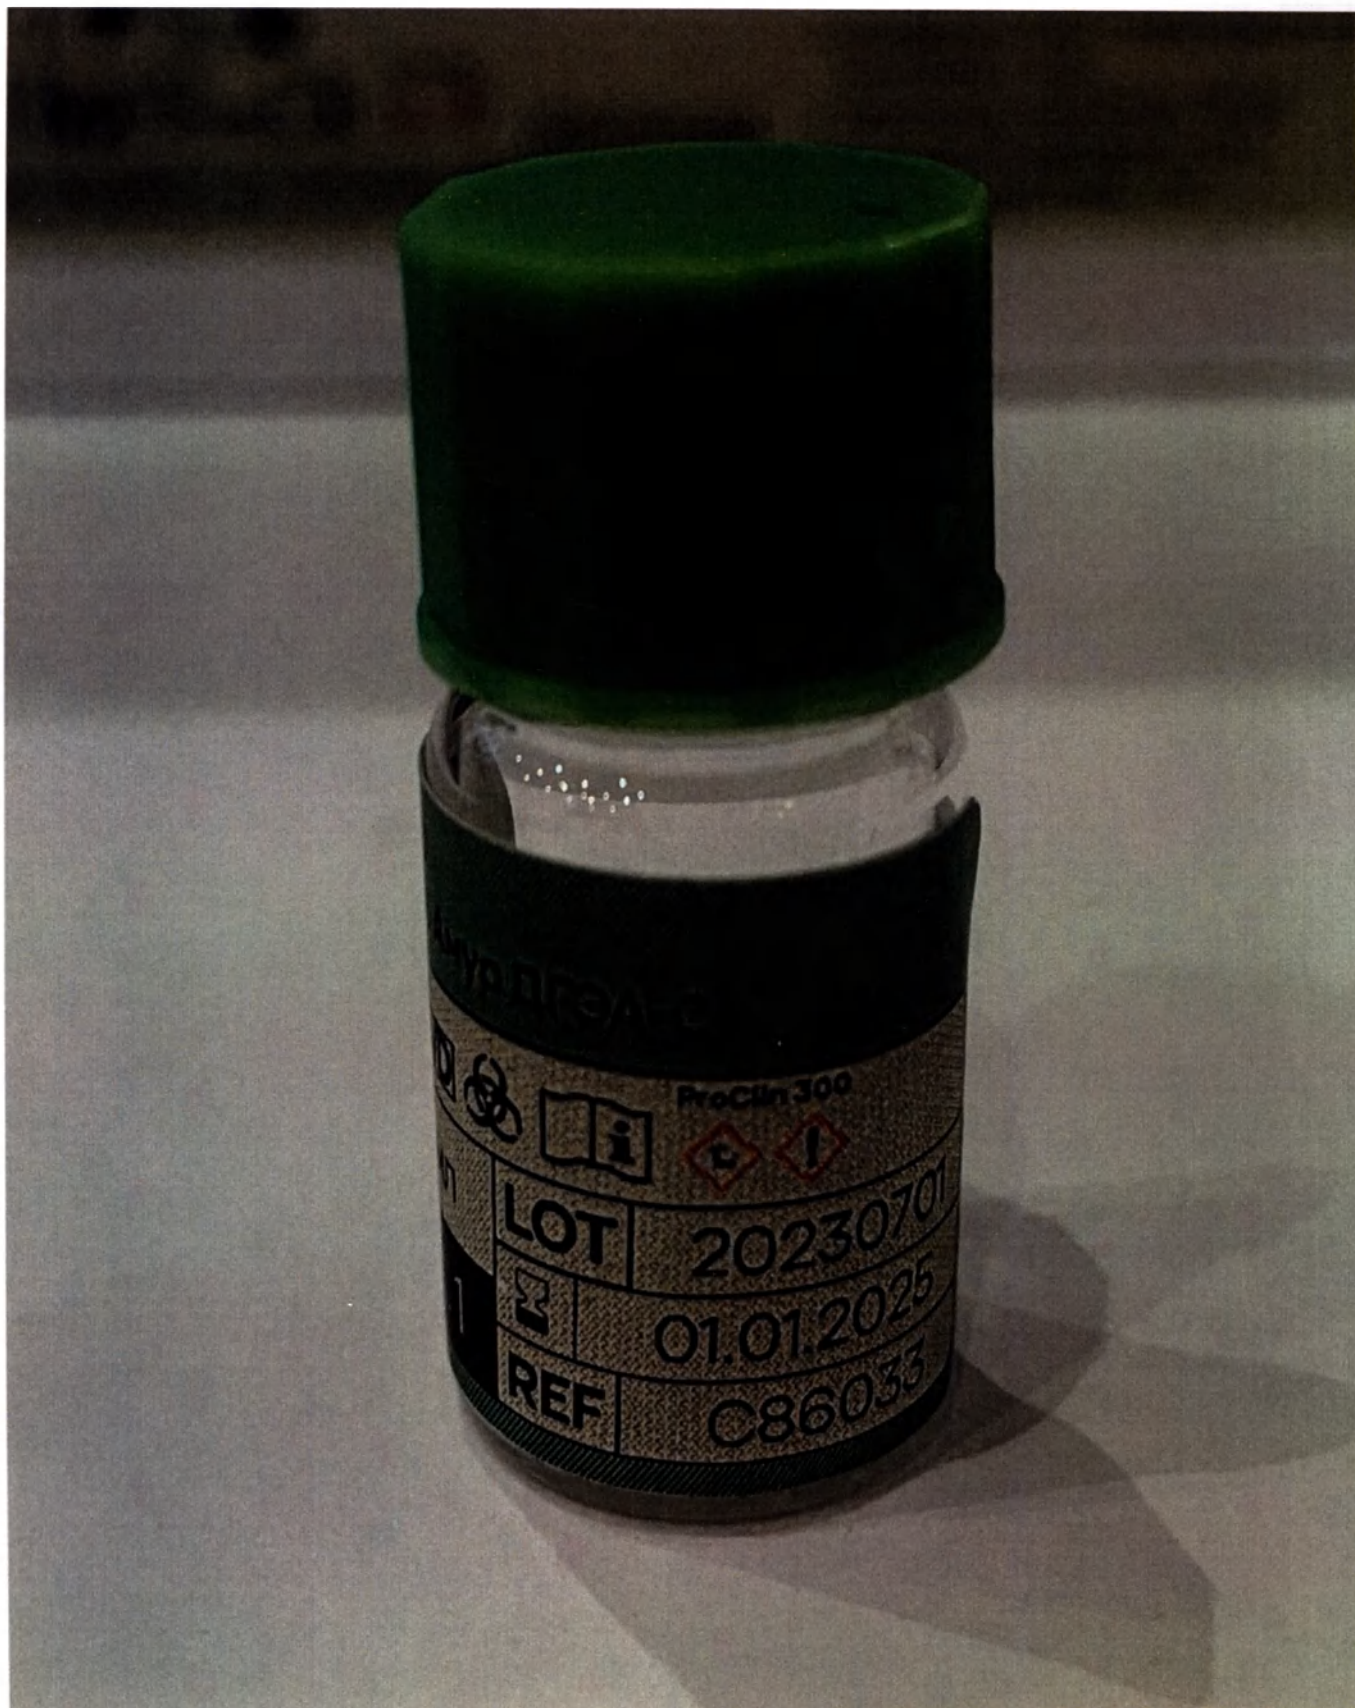


Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

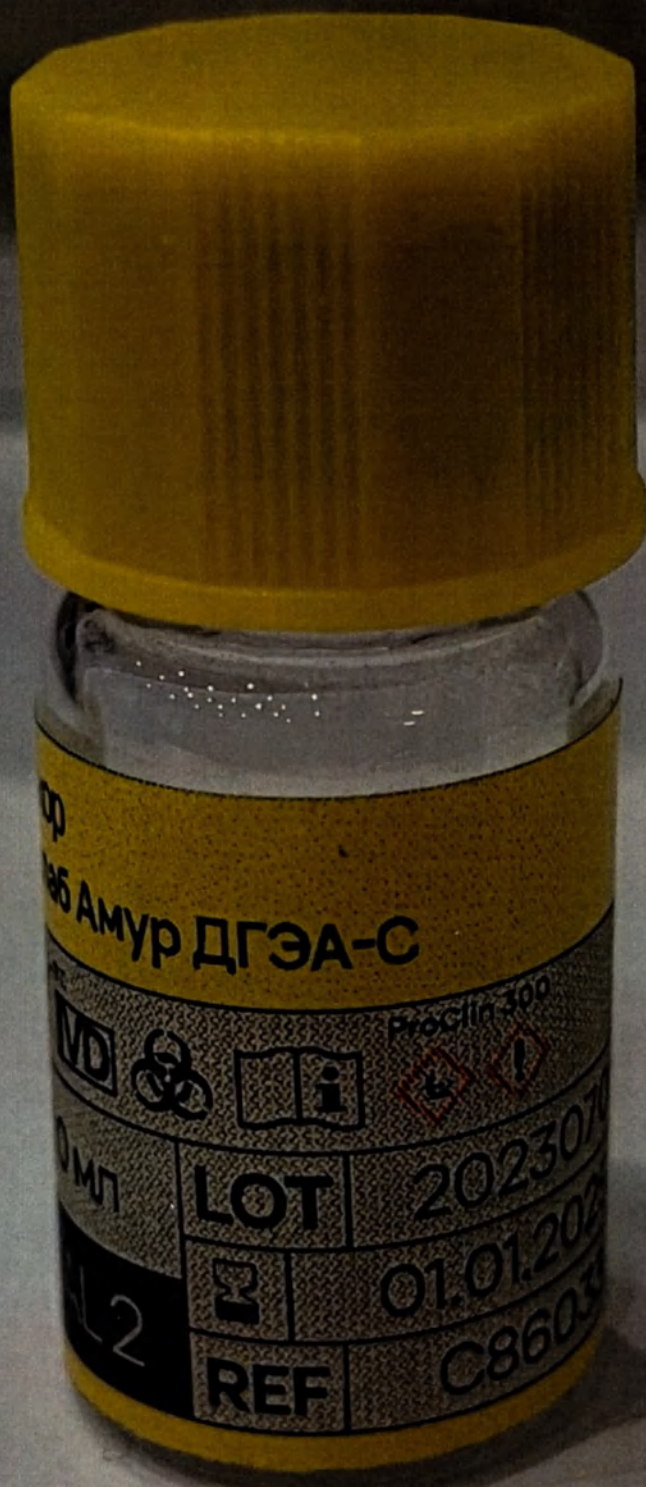

Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

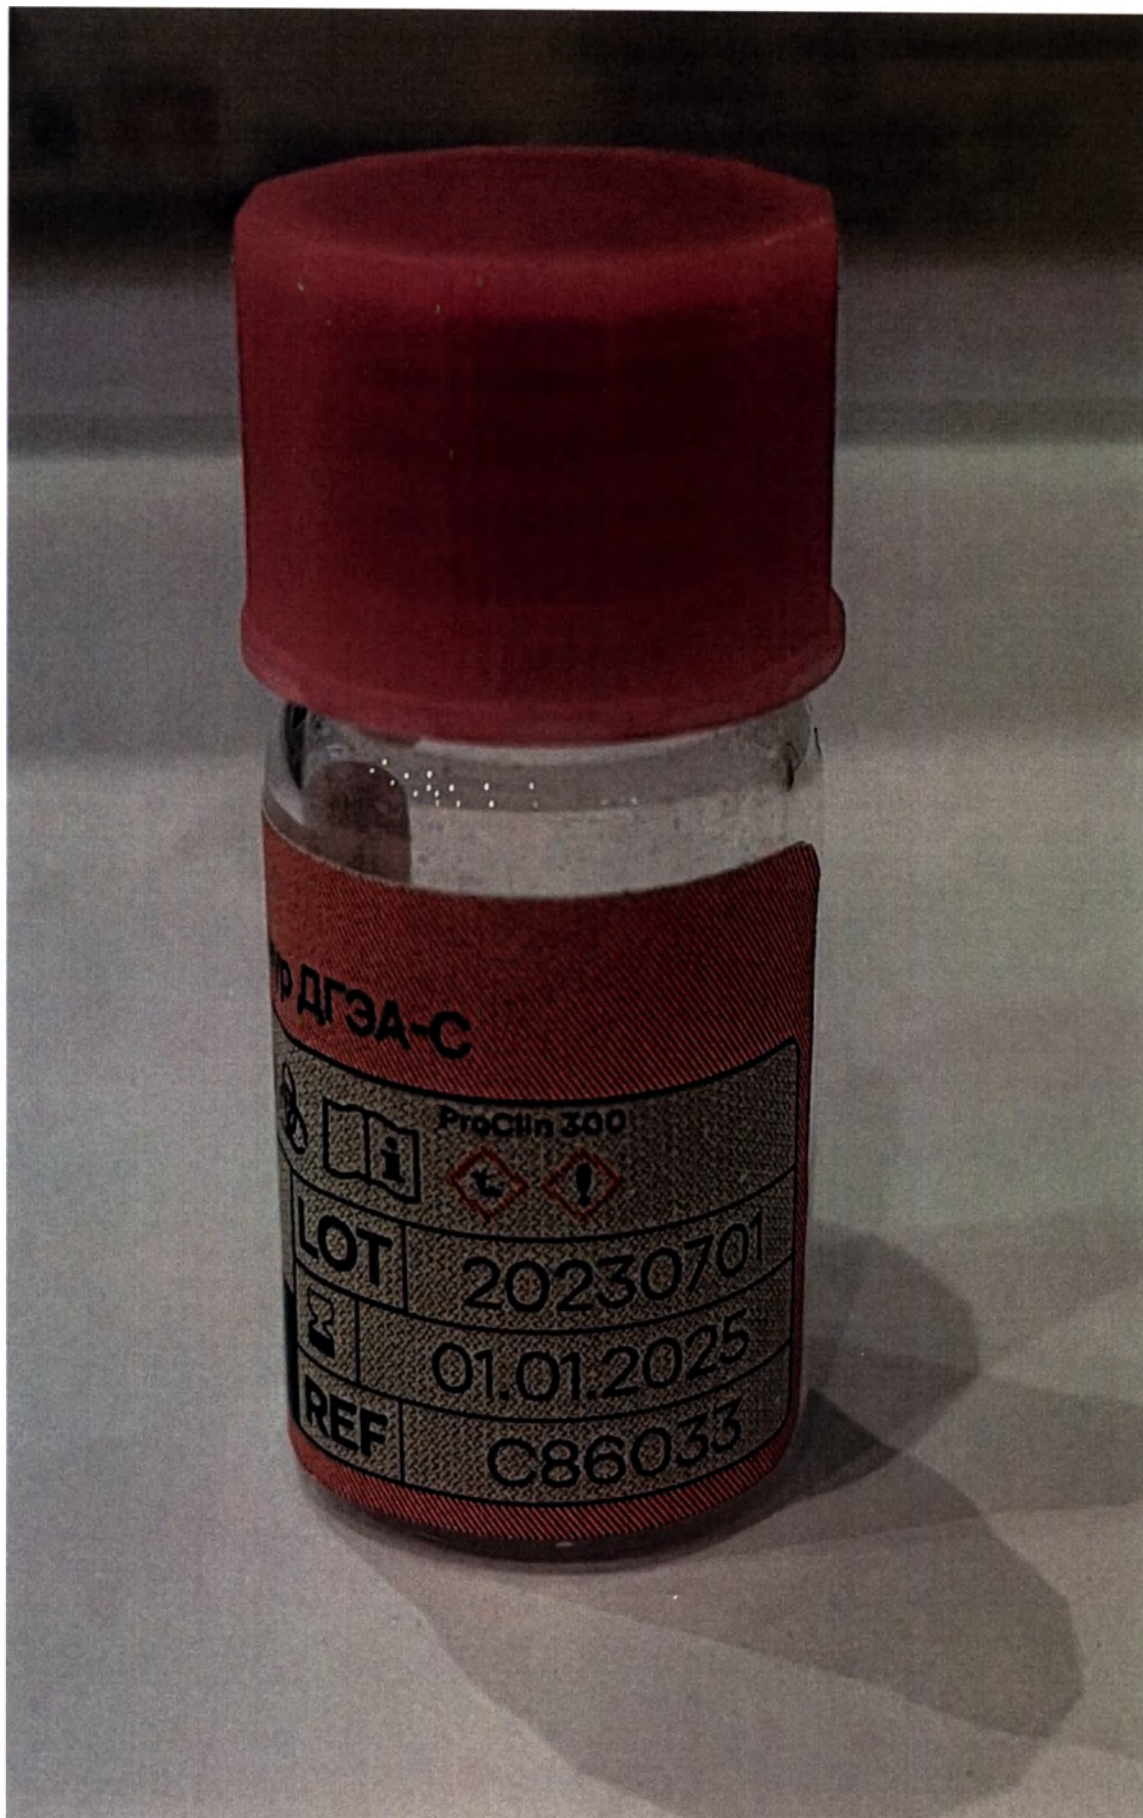

Калибратор 4 (CAL4), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон

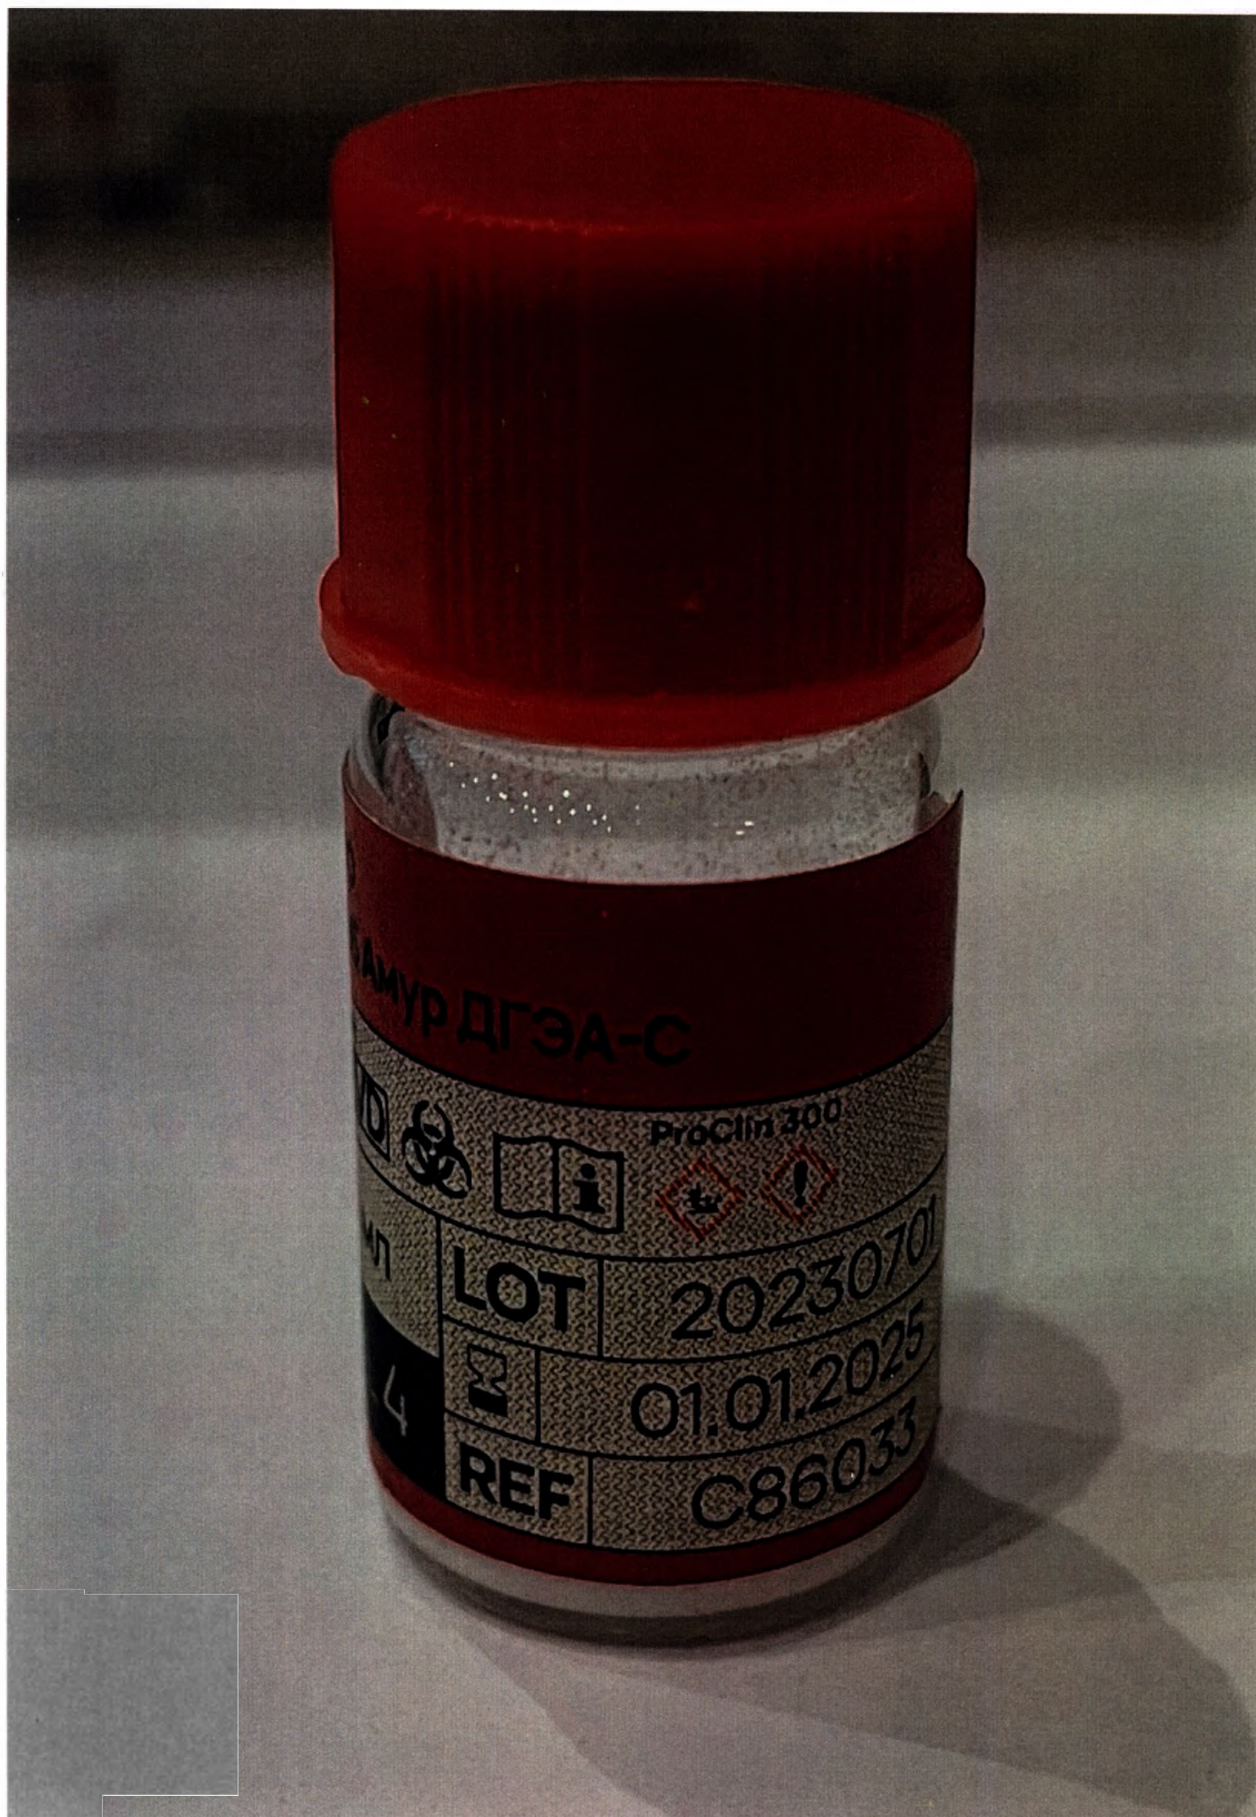

лидкор
Лидлаб Амур
ДГЭА-С

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

01.01.2025

REF C86033

IVD







лидлаб



**Лидлаб Амур
ДГЭА-С**

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO



IVD

1-200

ProCin 200

01.07.2023

LOT 20230701 01.01.2025 REF C86033


Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2) 4,0 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Калибратор 4 (CAL4), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт.
8. Аналитический паспорт – 1 шт.


ЛИДКОР

Для профессионального применения


Набор реагентов на 200 тестов (вид сбоку)

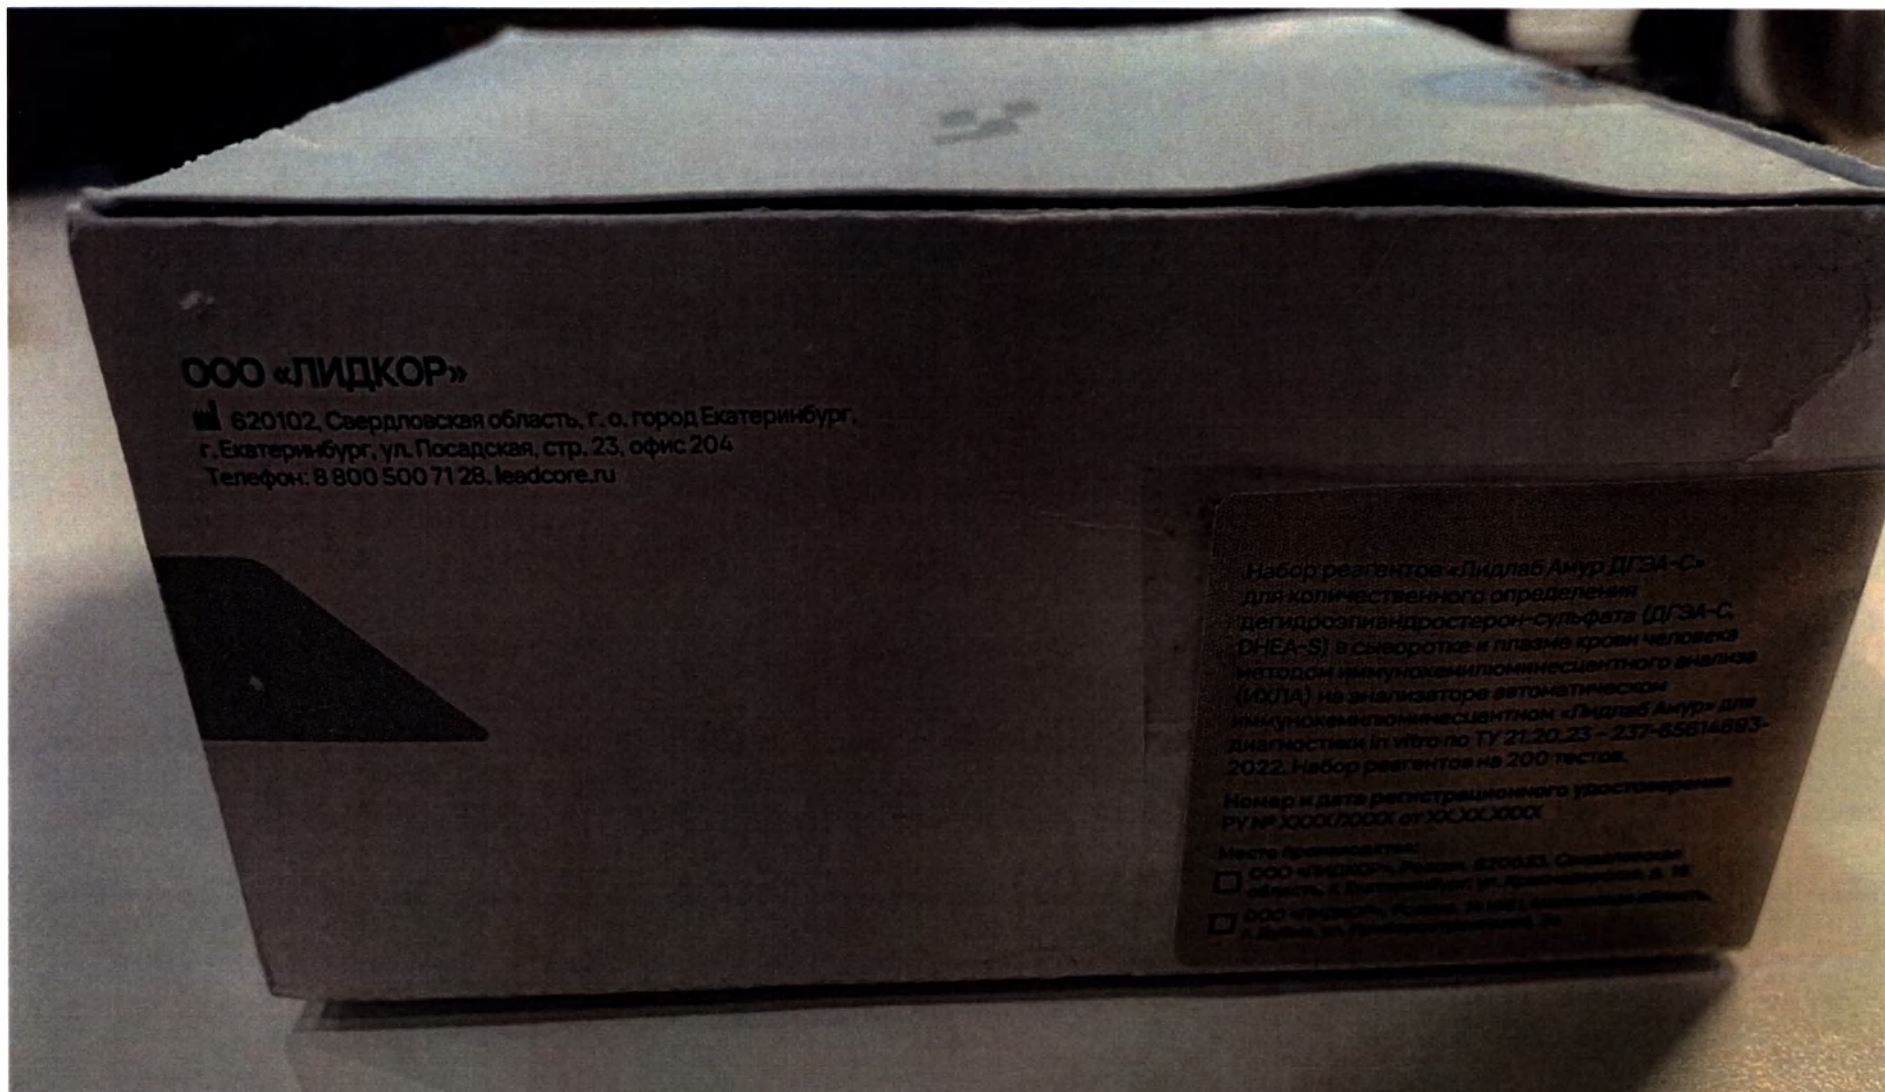

Набор реагентов на 500 тестов

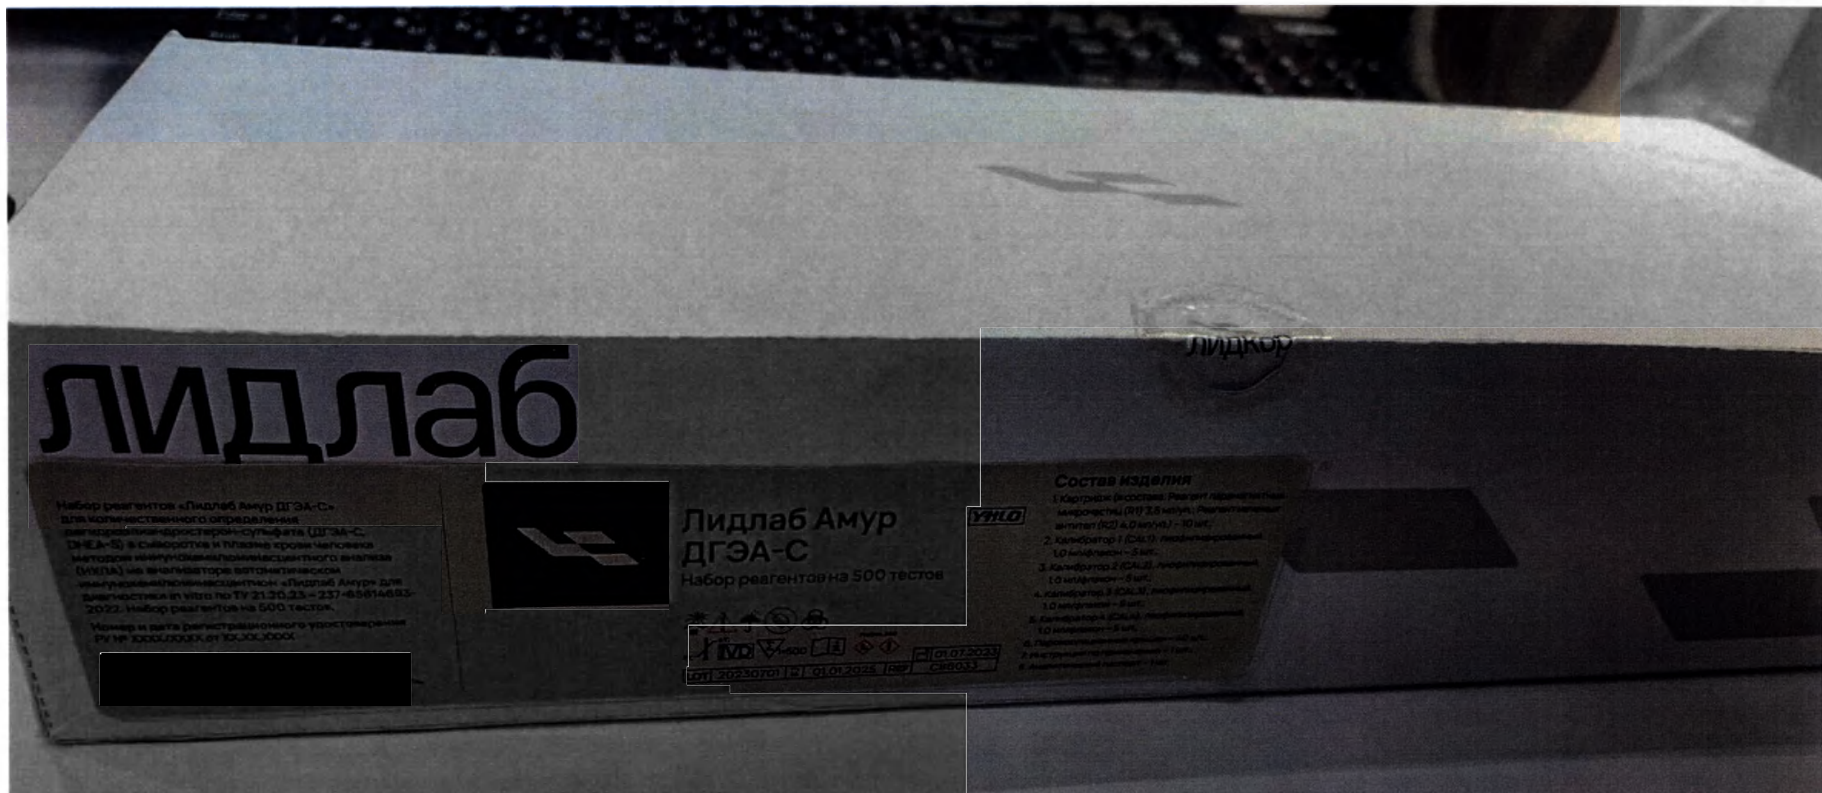


Набор реагентов на 500 тестов (вид сзади)

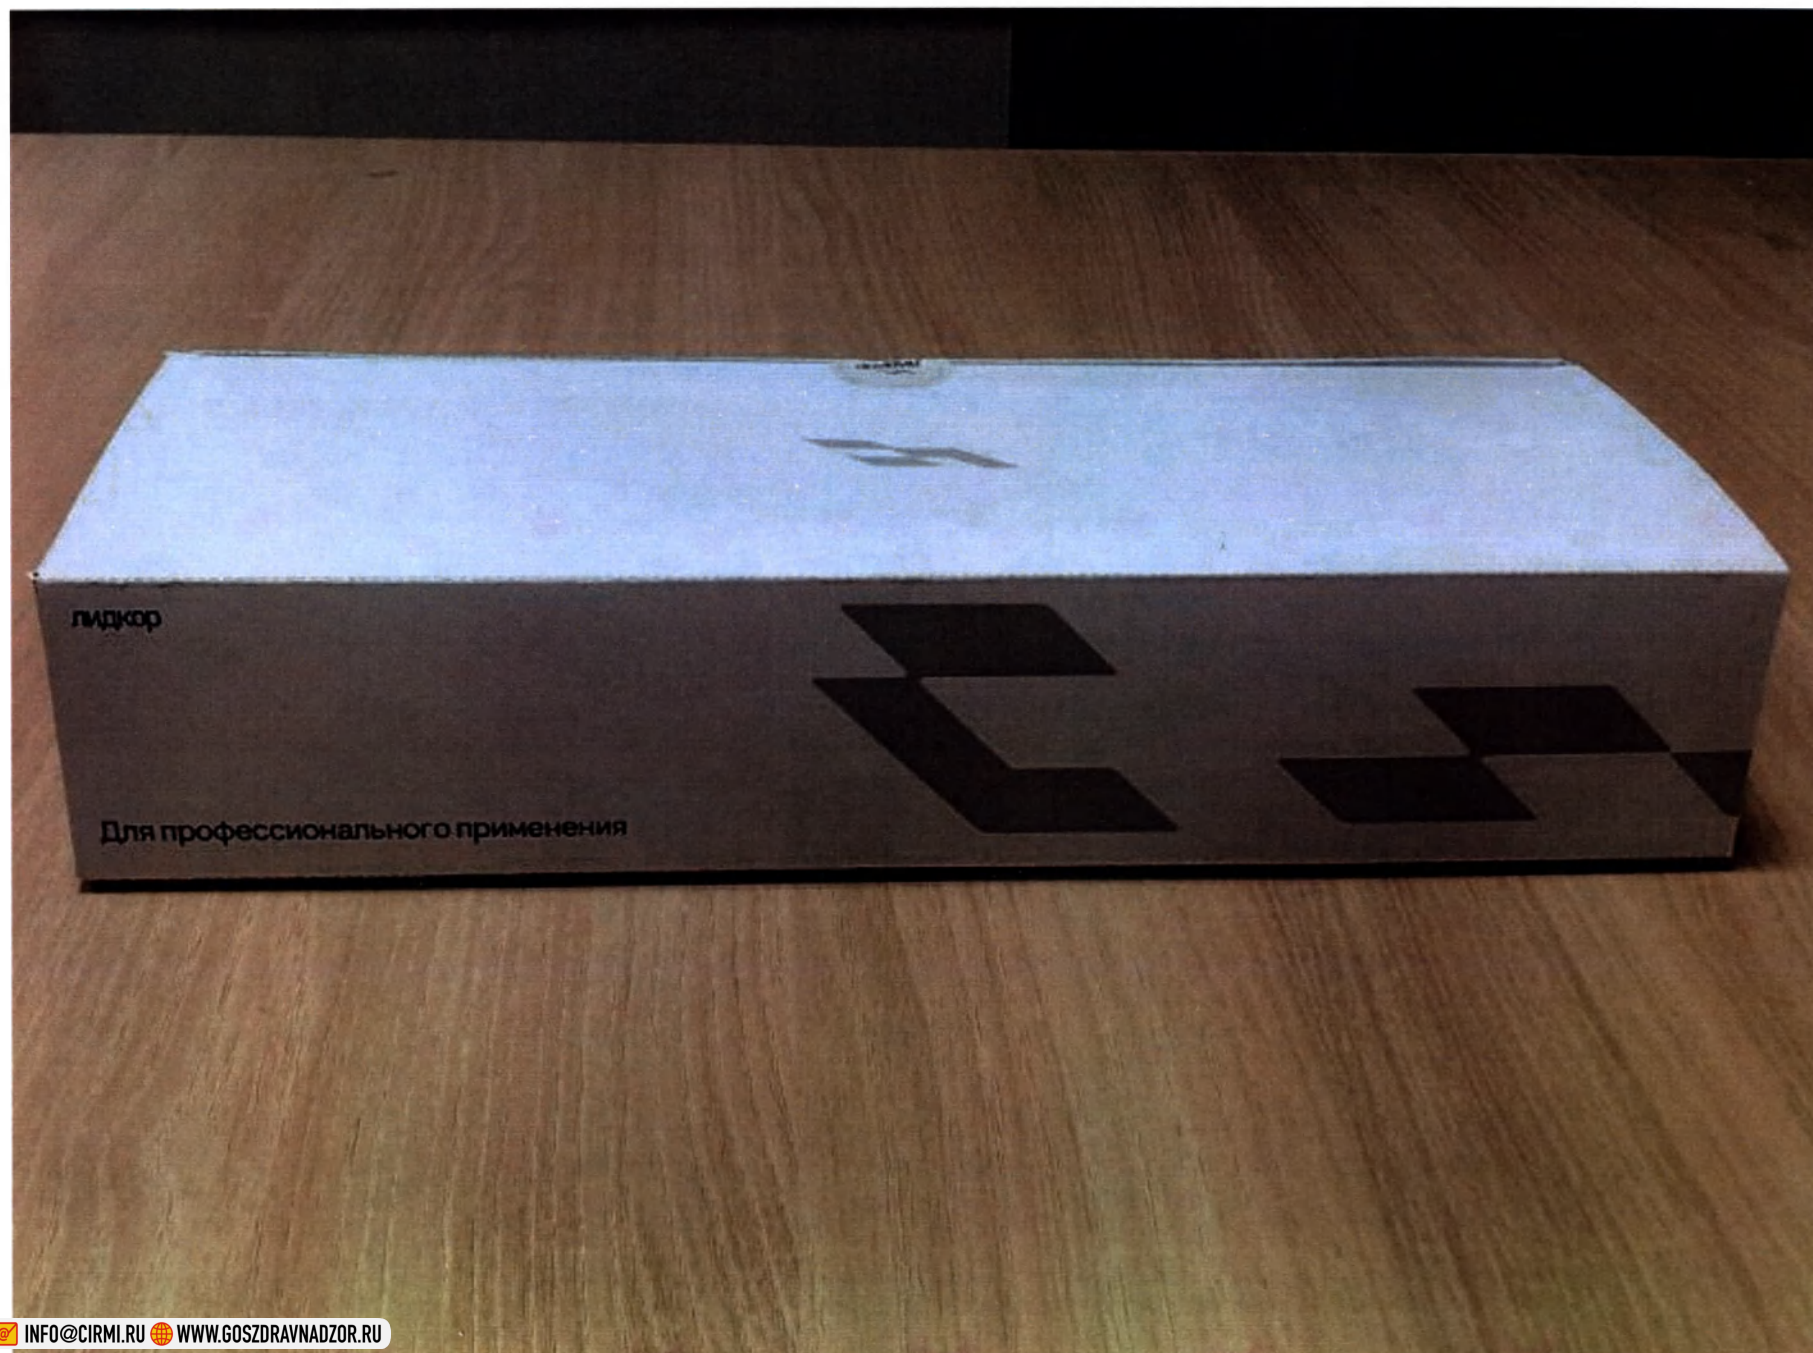

гидкор


Для профессионального применения

Набор реагентов на 500 тестов (вид сбоку)

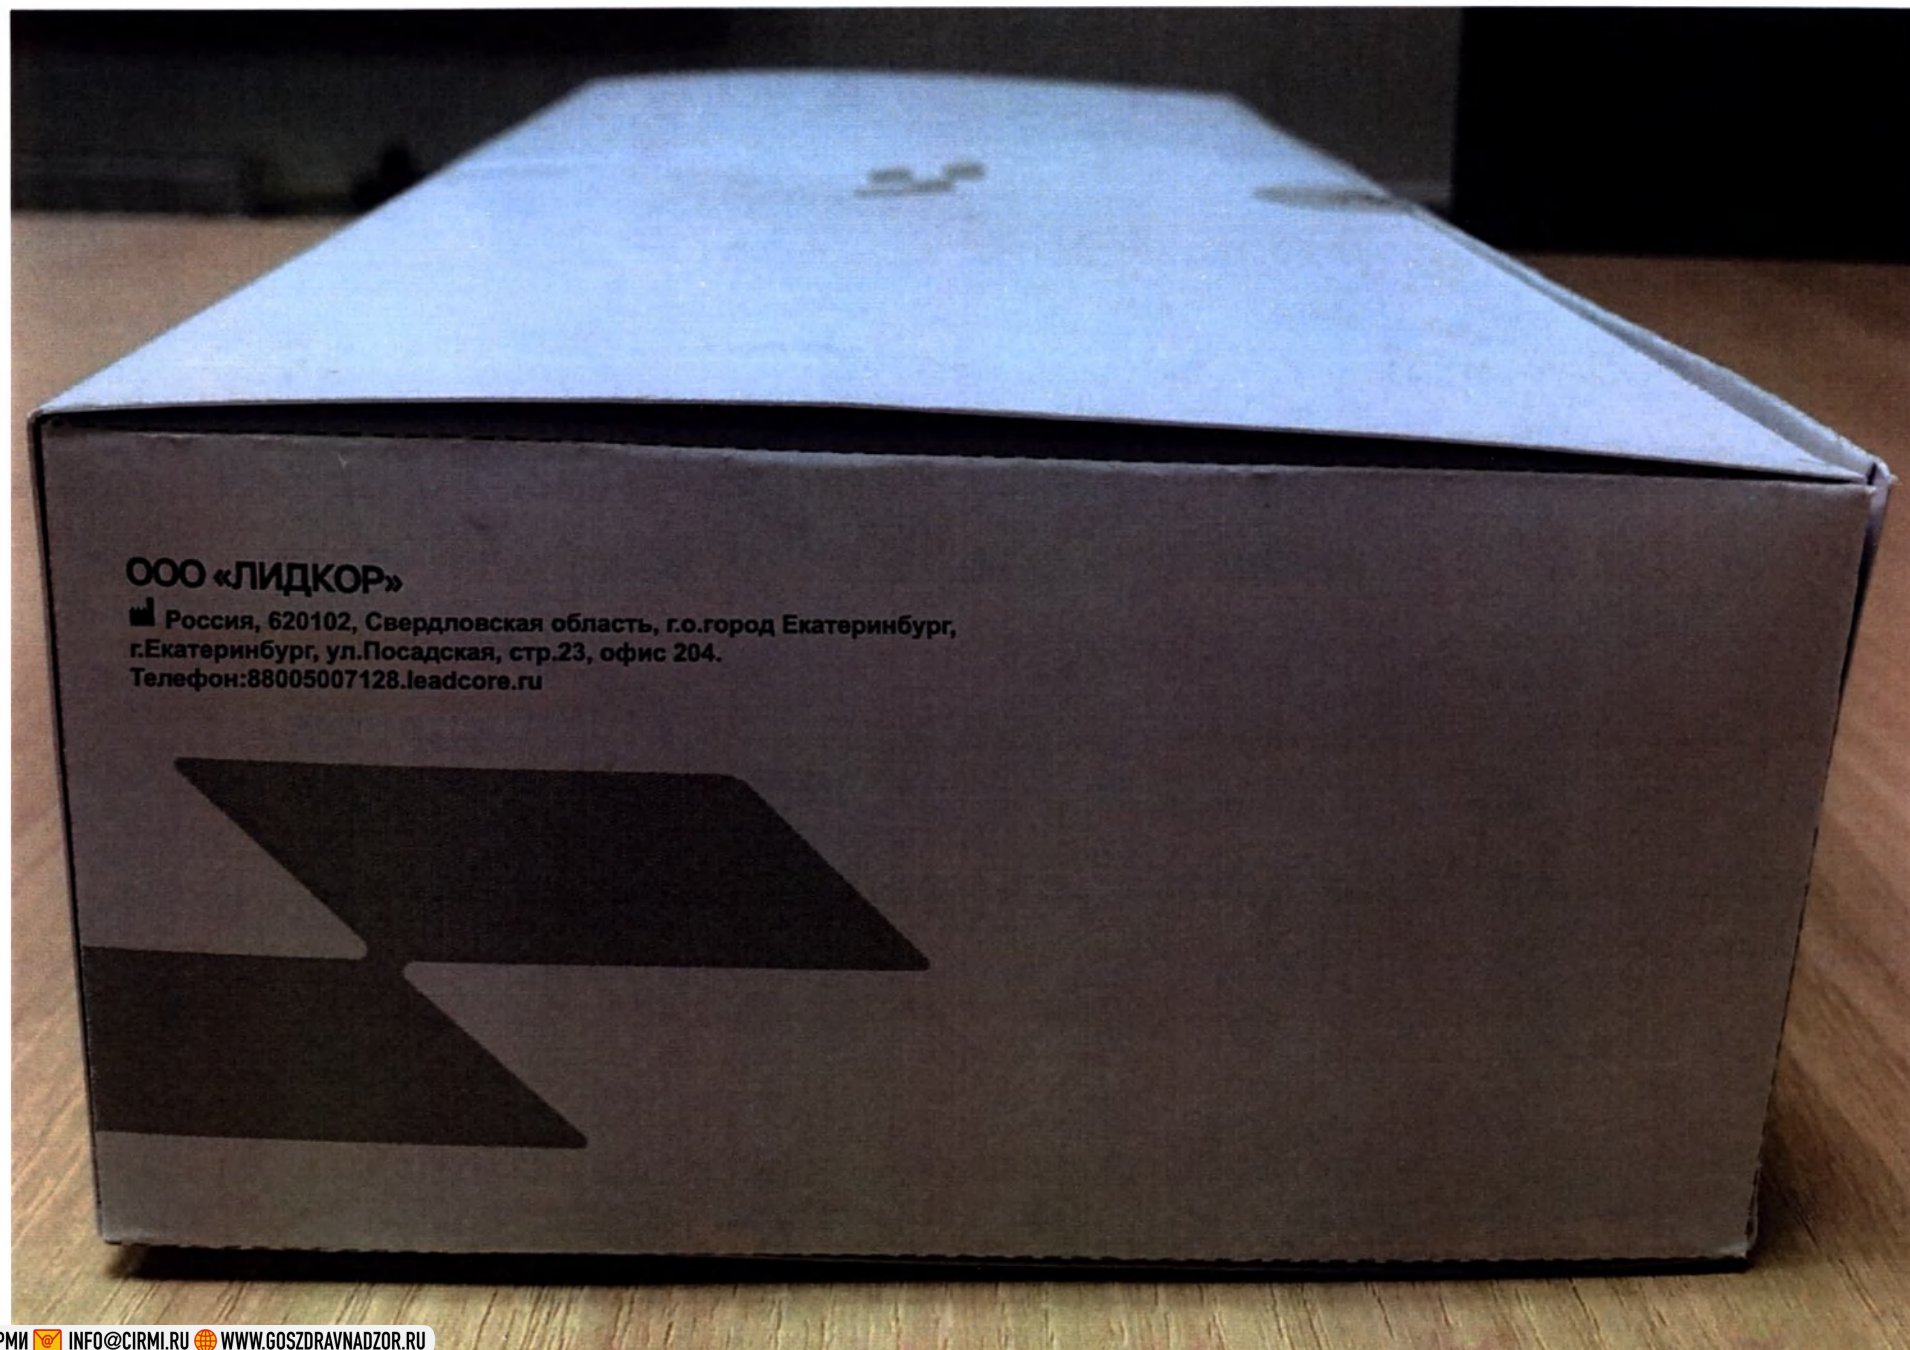

ООО «ЛИДКОР»


Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.
Телефон:88005007128.leadcore.ru

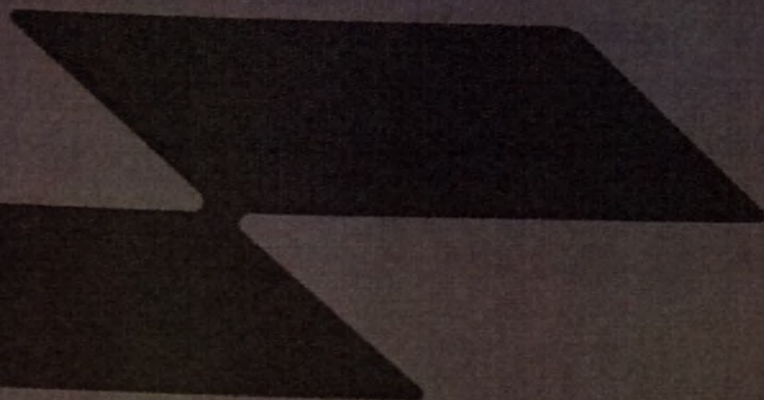

Набор реагентов на 1000 тестов



Набор реагентов на 1000 (вид сзади)

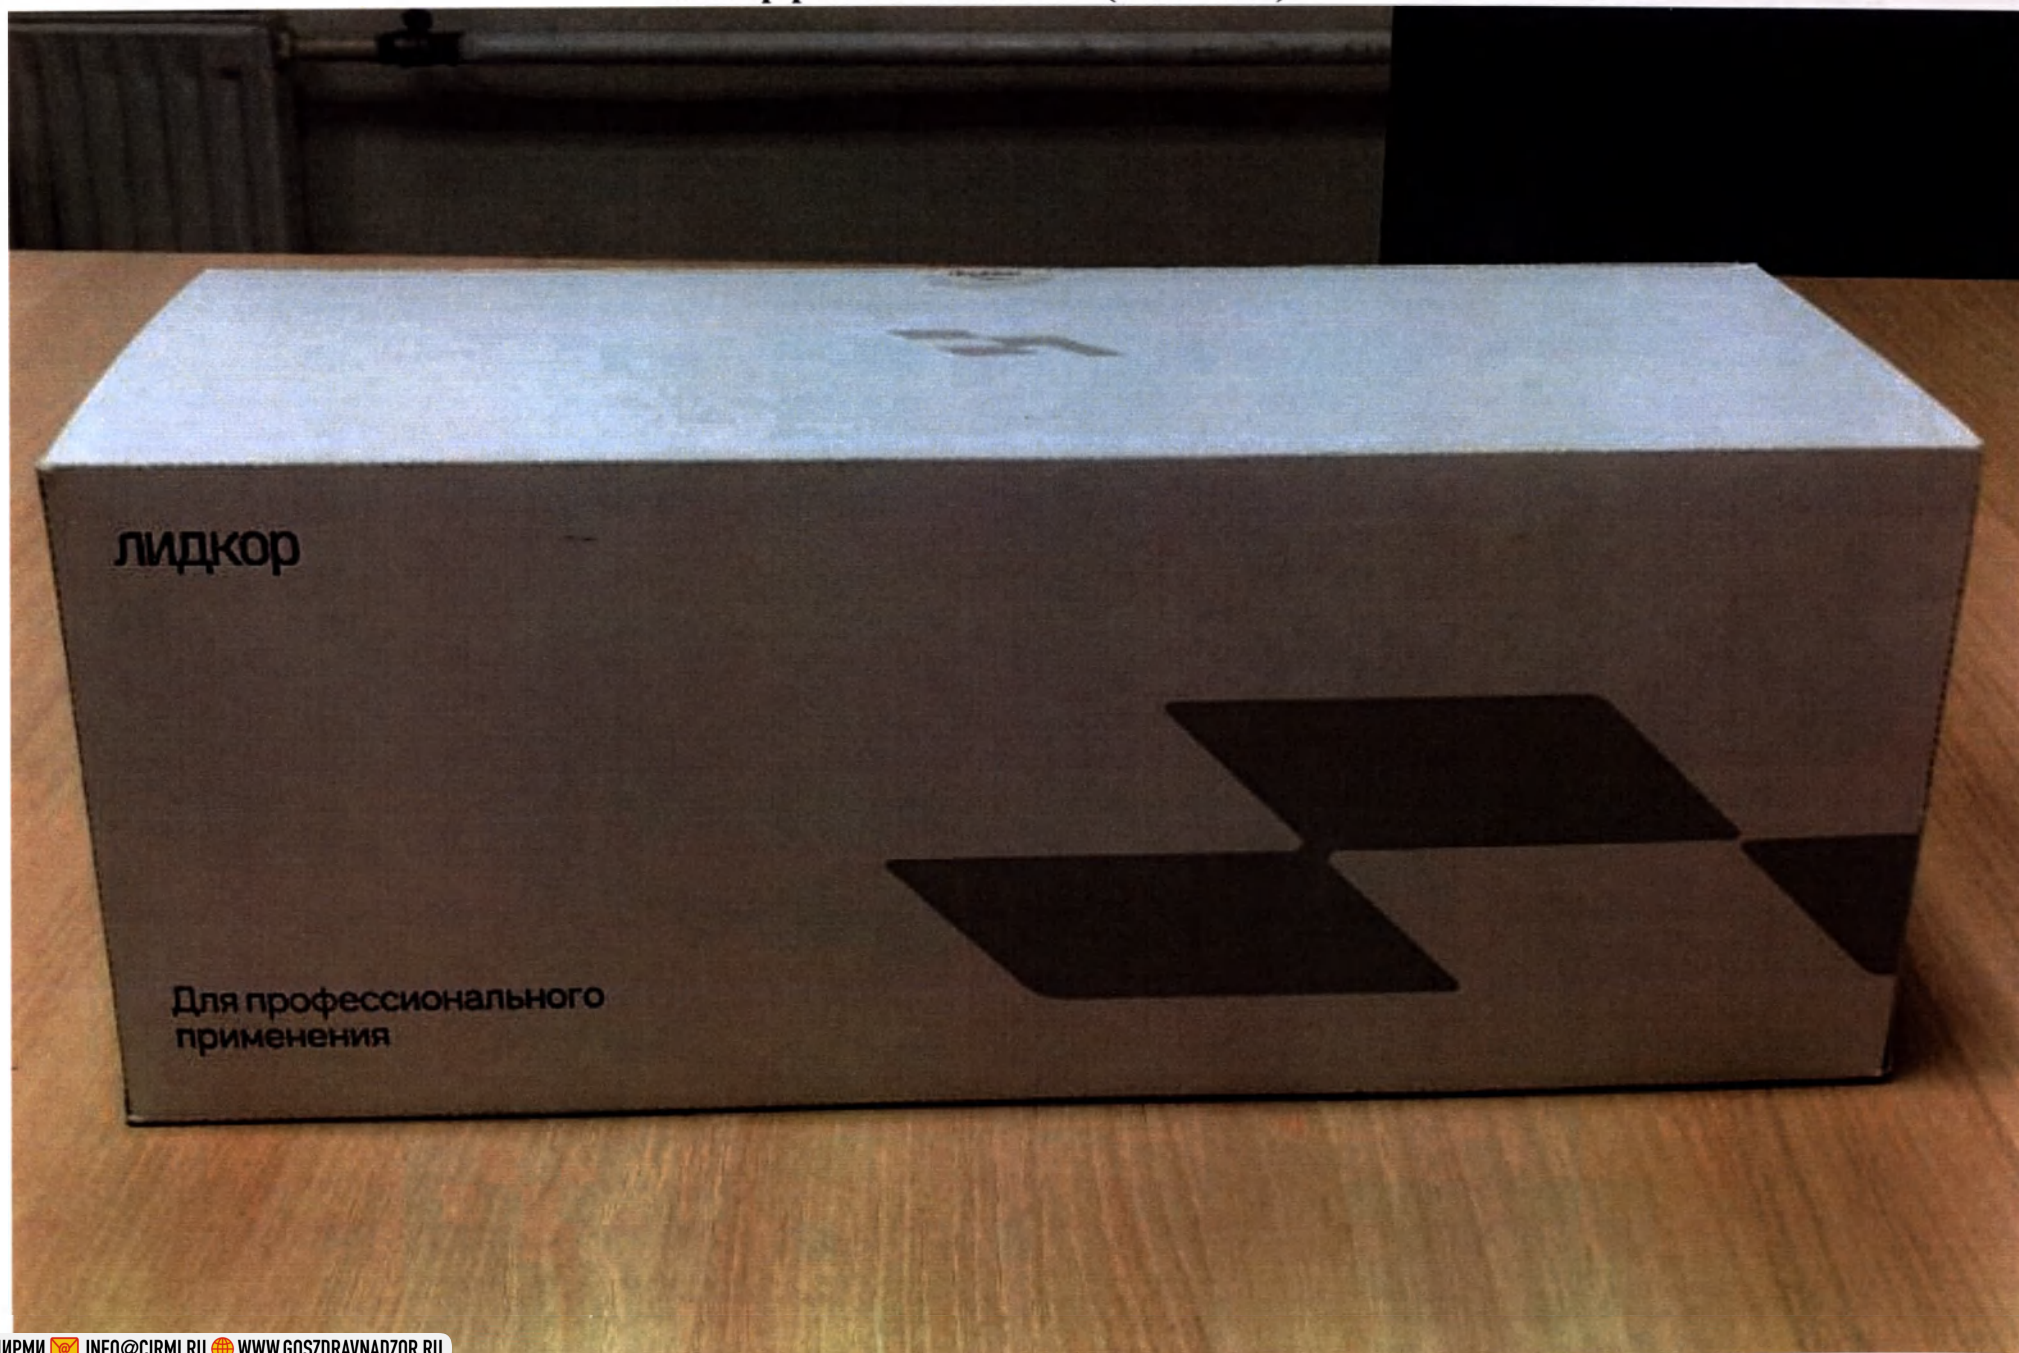

Набор реагентов на 1000 тестов (вид сбоку)

ООО «ЛИДКОР»


■ Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.
Телефон:88005007128.leadcore.ru







Набор реагентов «Лидлаб Амур ДГЭА-С» для количественного определения дегидроэпандростерон-сульфата (ДГЭА-С, DHEA-S) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 237-65614693-2022

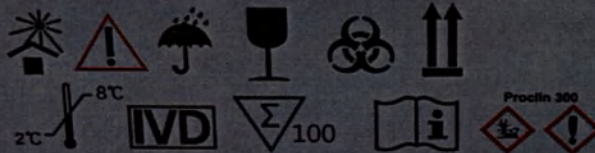

Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.			01.07.2023
LOT	20230701	01.01.2025	REF C86033

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
20 (двадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»
[подпись] /Е. Ю. Гохгут/

