

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«09» января 2024 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 236-65614693-2022»


2024

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 236-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:




- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тестостерон

Набор реагентов на 100 тестов

YNLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C86031
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченого тестостерона (R2) 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/уп – 1 флакон;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/уп – 1 флакон;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/уп – 1 флакон;
5. Калибратор 4 (CAL4) 1,0 мл/уп – 1 флакон;
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 236-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:





- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тестостерон

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C86031
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченого тестостерона (R2) 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/уп – 2 флакона;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/уп – 2 флакона;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/уп – 2 флакона;
5. Калибратор 4 (CAL4) 1,0 мл/уп – 2 флакона;
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 236-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тестостерон

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86031

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченого тестостерона (R2) 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/уп – 5 флаконов;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/уп – 5 флаконов;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/уп – 5 флаконов;
5. Калибратор 4 (CAL4) 1,0 мл/уп – 5 флаконов;
6. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 236-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тестостерон

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86031

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченого тестостерона (R2) 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/уп – 10 флаконов;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/уп – 10 флаконов;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/уп – 10 флаконов;
5. Калибратор 4 (CAL4) 1,0 мл/уп – 10 флаконов;
6. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YHLO**

**Лидлаб Амур
Тестостерон**

3,5 мл 4,0 мл
R 1 R 2

LOT 20230701 01.07.2024

IVD     

2°C 1x50

9031 1017

лидкор
**Лидлаб Амур
Тестостерон**

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701
01.07.2024
REF C86031

IVD 

лидкор
Лидлаб Амур Тестостерон

1,0 мл
CAL 1

LOT 20230701
01.07.2024
REF C86031

IVD     

лидкор
Лидлаб Амур Тестостерон

1,0 мл
CAL 2

LOT 20230701
01.07.2024
REF C86031

IVD     

лидкор
Лидлаб Амур Тестостерон

1,0 мл
CAL 3

LOT 20230701
01.07.2024
REF C86031

IVD     

лидкор
Лидлаб Амур Тестостерон

1,0 мл
CAL 4

LOT 20230701
01.07.2024
REF C86031


IVD     

Лидлаб Амур Тестостерон



LOT 20230701 EXP 01.07.2024



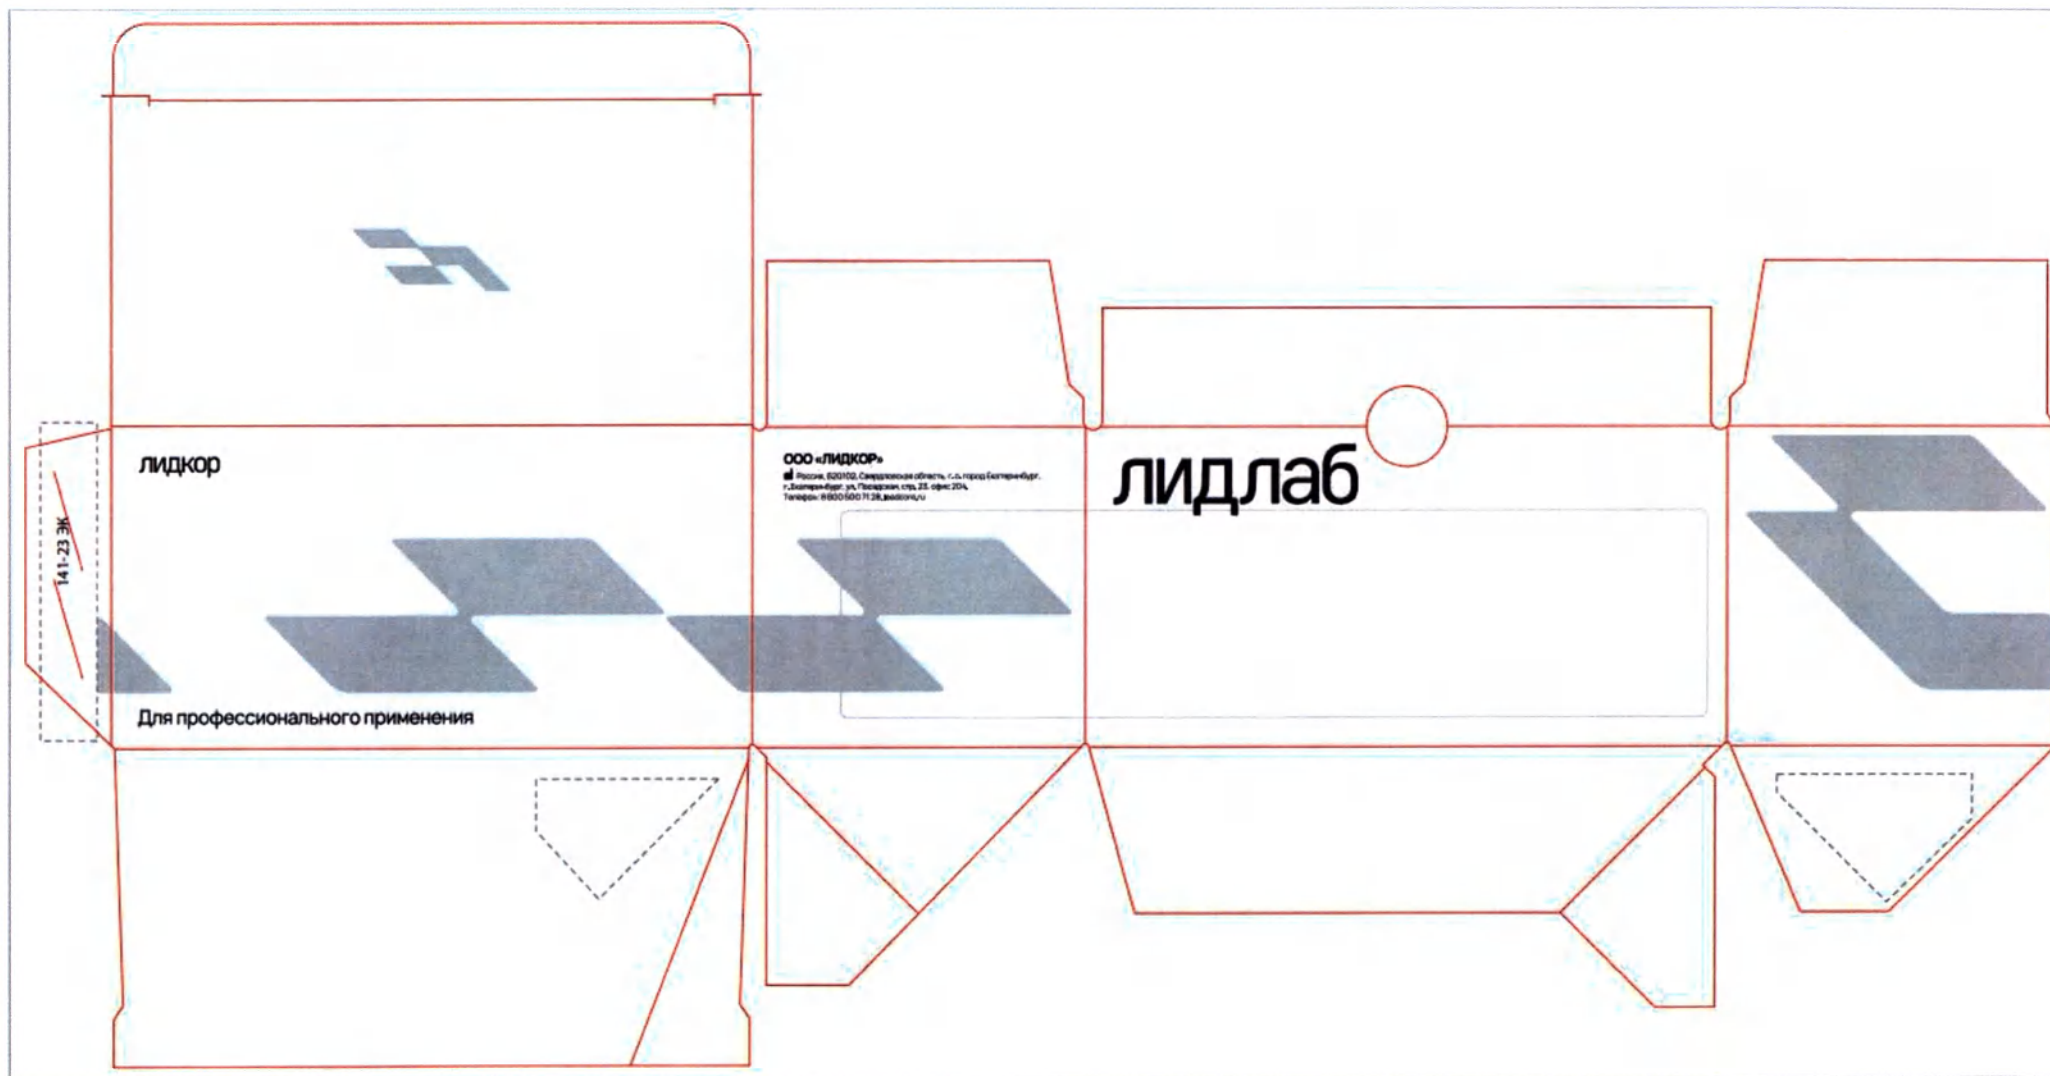

Макет транспортной маркировки



Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-236-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C86031		



Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-236-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C86031		



Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-236-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C86031		



Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-236-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024
REF	C86031		

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.	 XXX
Наименование изделия	 MM.GTTT
 XXXXXX	
 XXXXXXXX	 Только для in vitro диагностики Для профессионального применения
	
	
	
	GHS07  

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (восемь) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



Е.Ю. Гохгут

«09» января 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


«Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23 – 236-65614693-2022»

2024


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченого тестостерона (R2), 4,0 мл/уп.)




Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

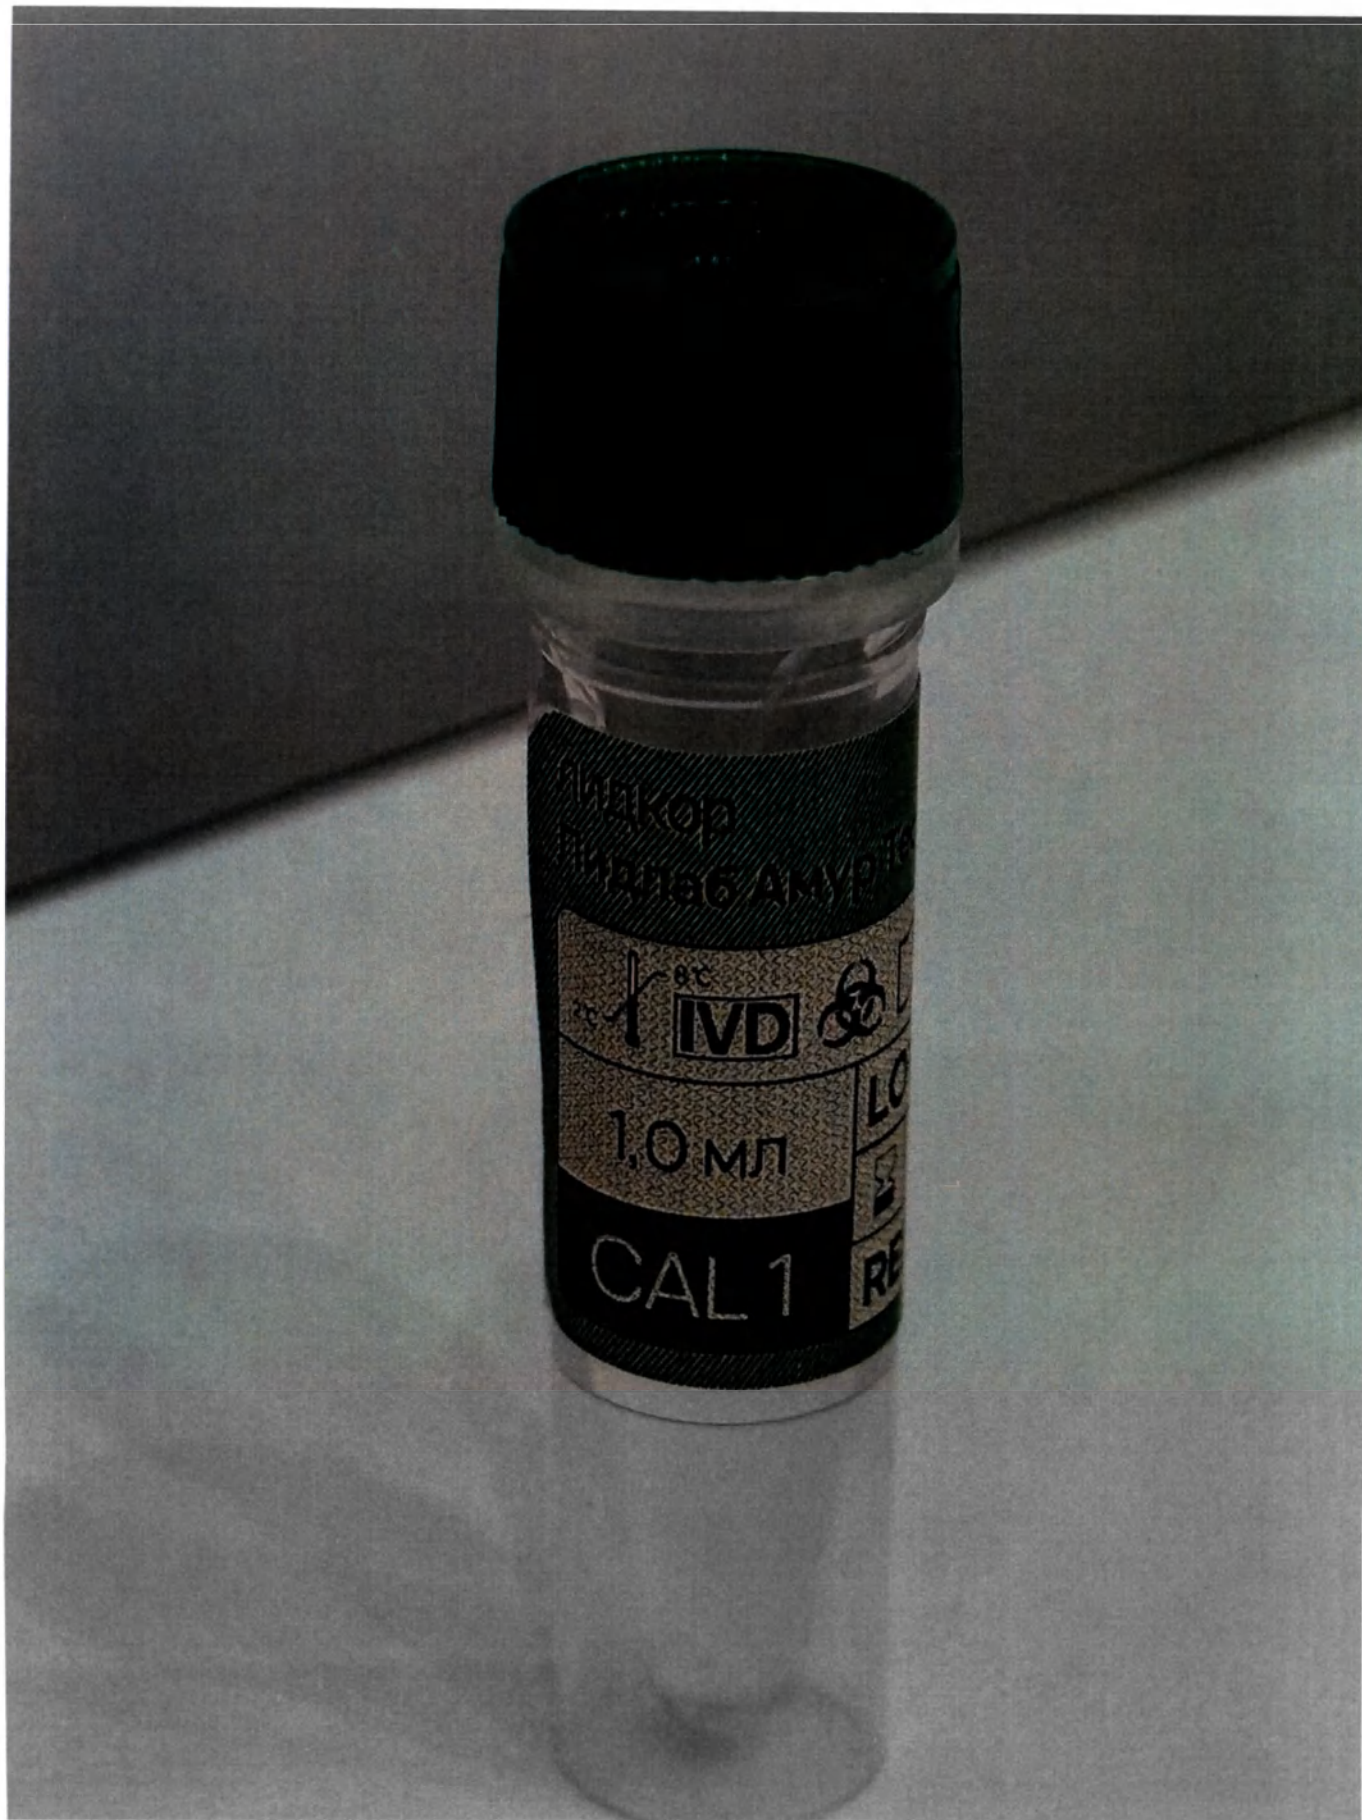


Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

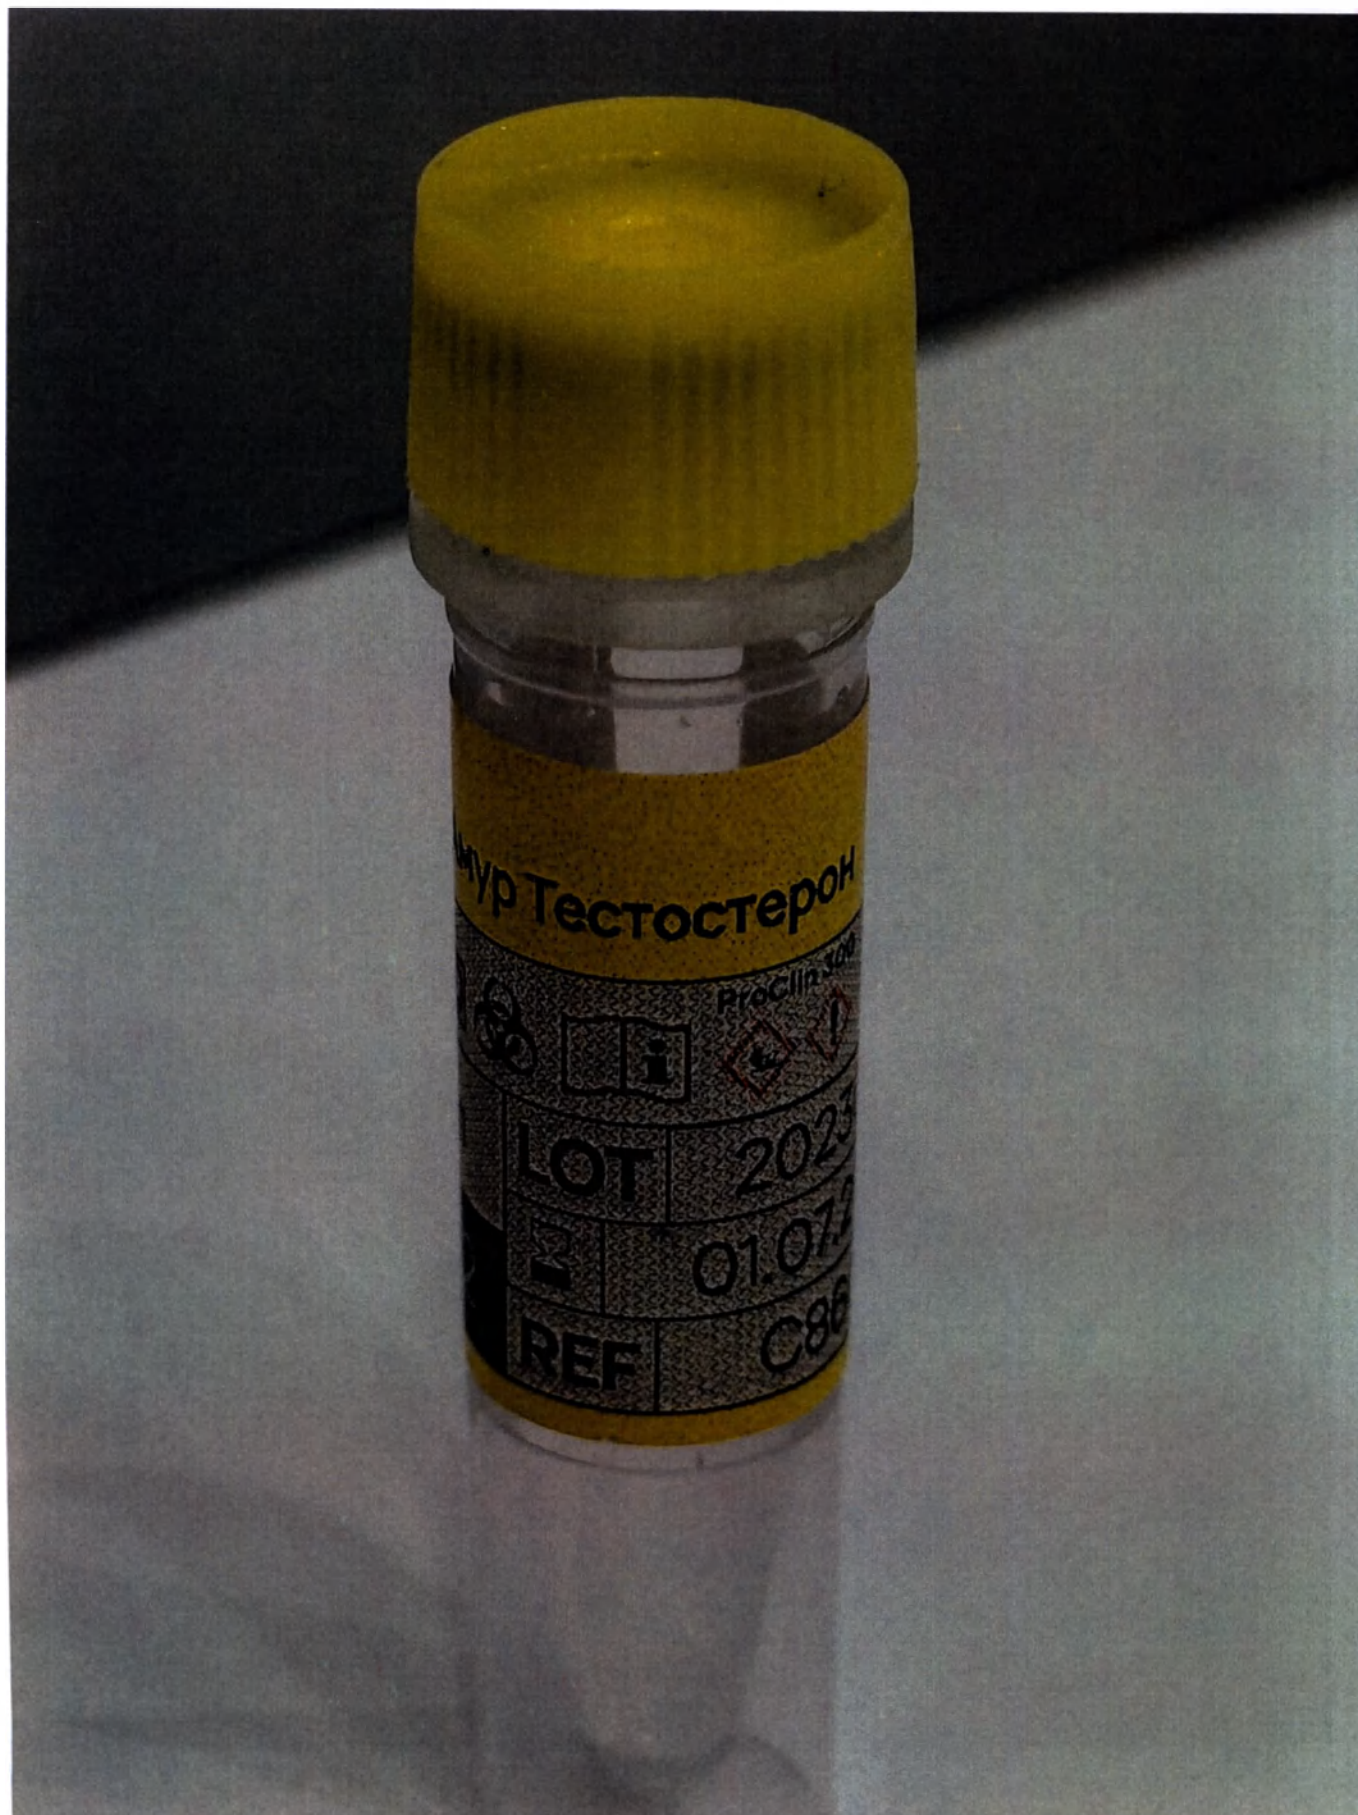


Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

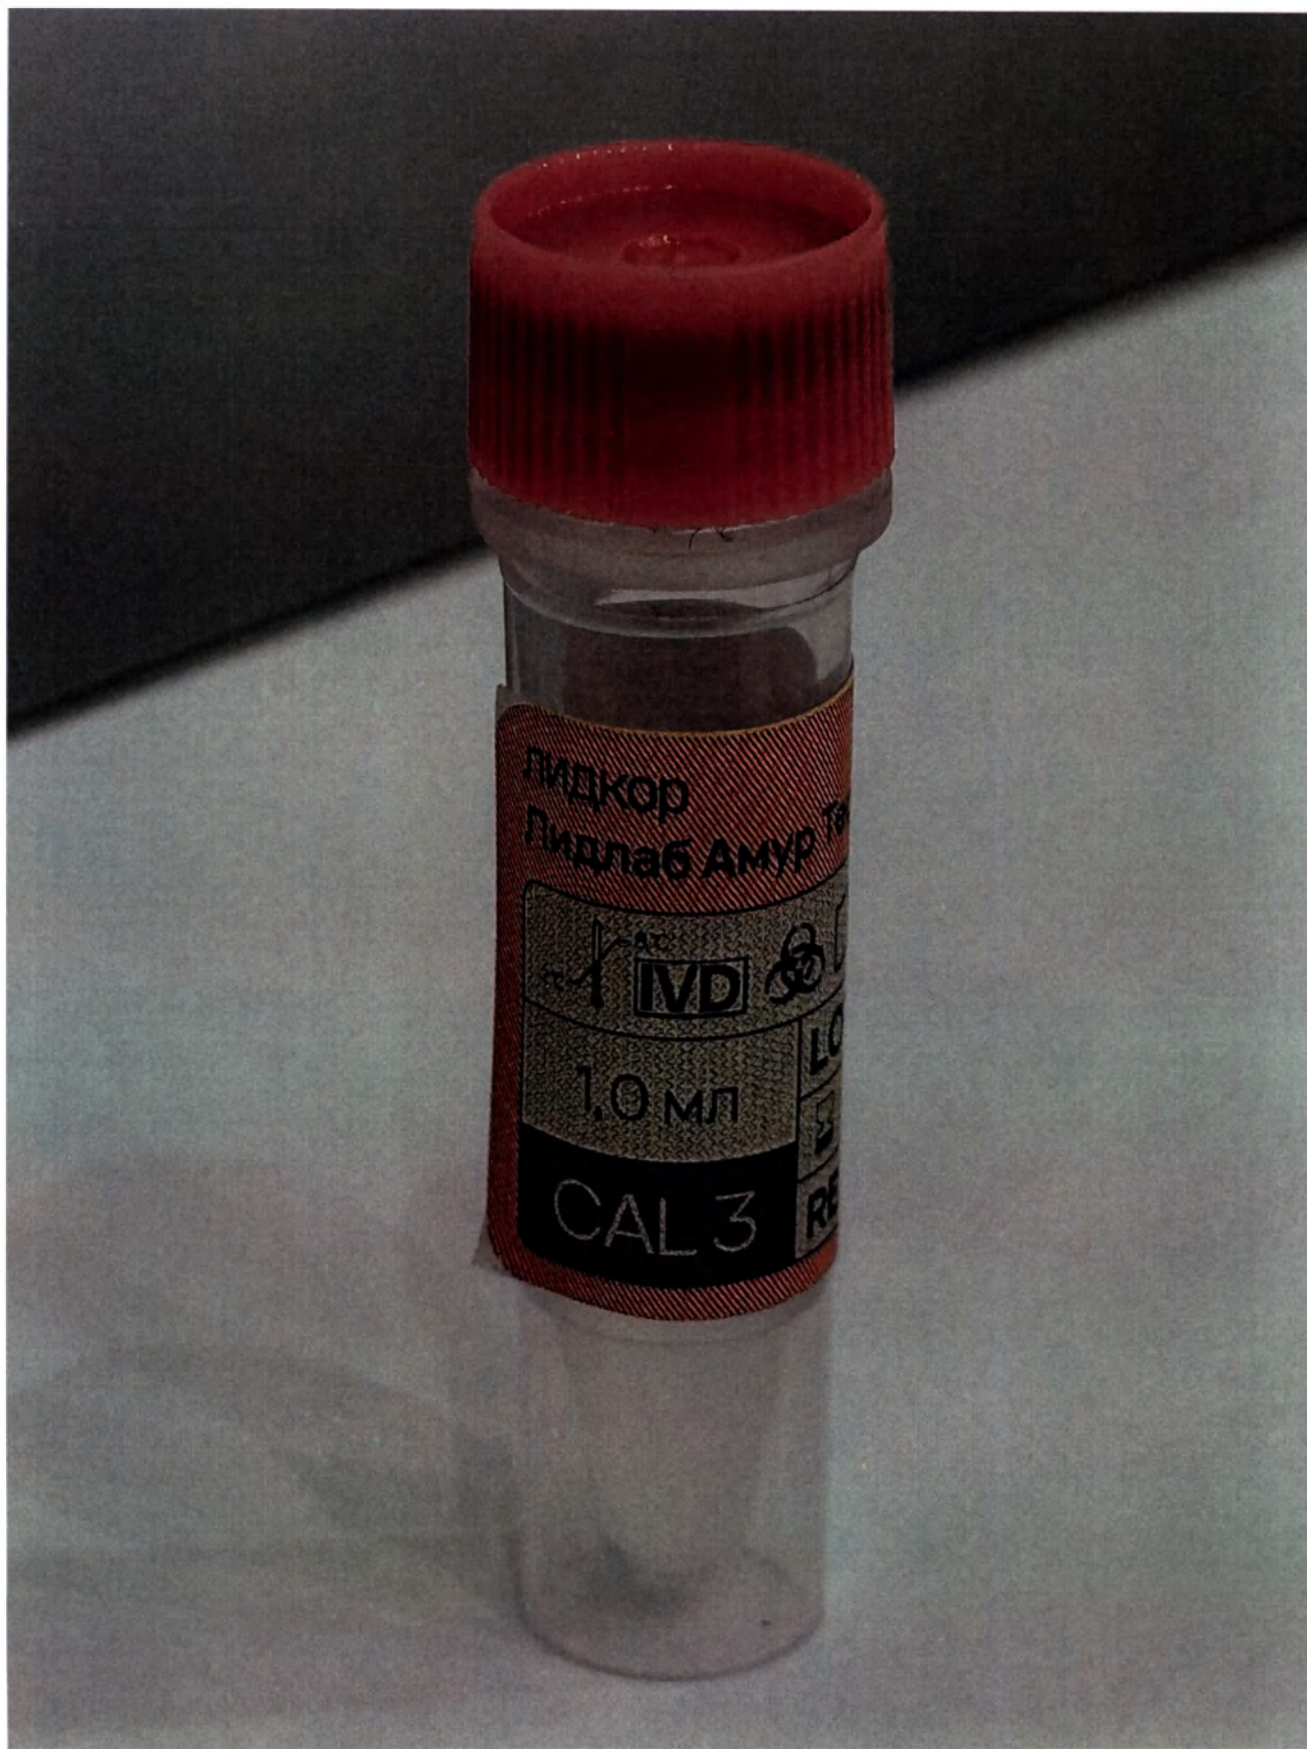



Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон

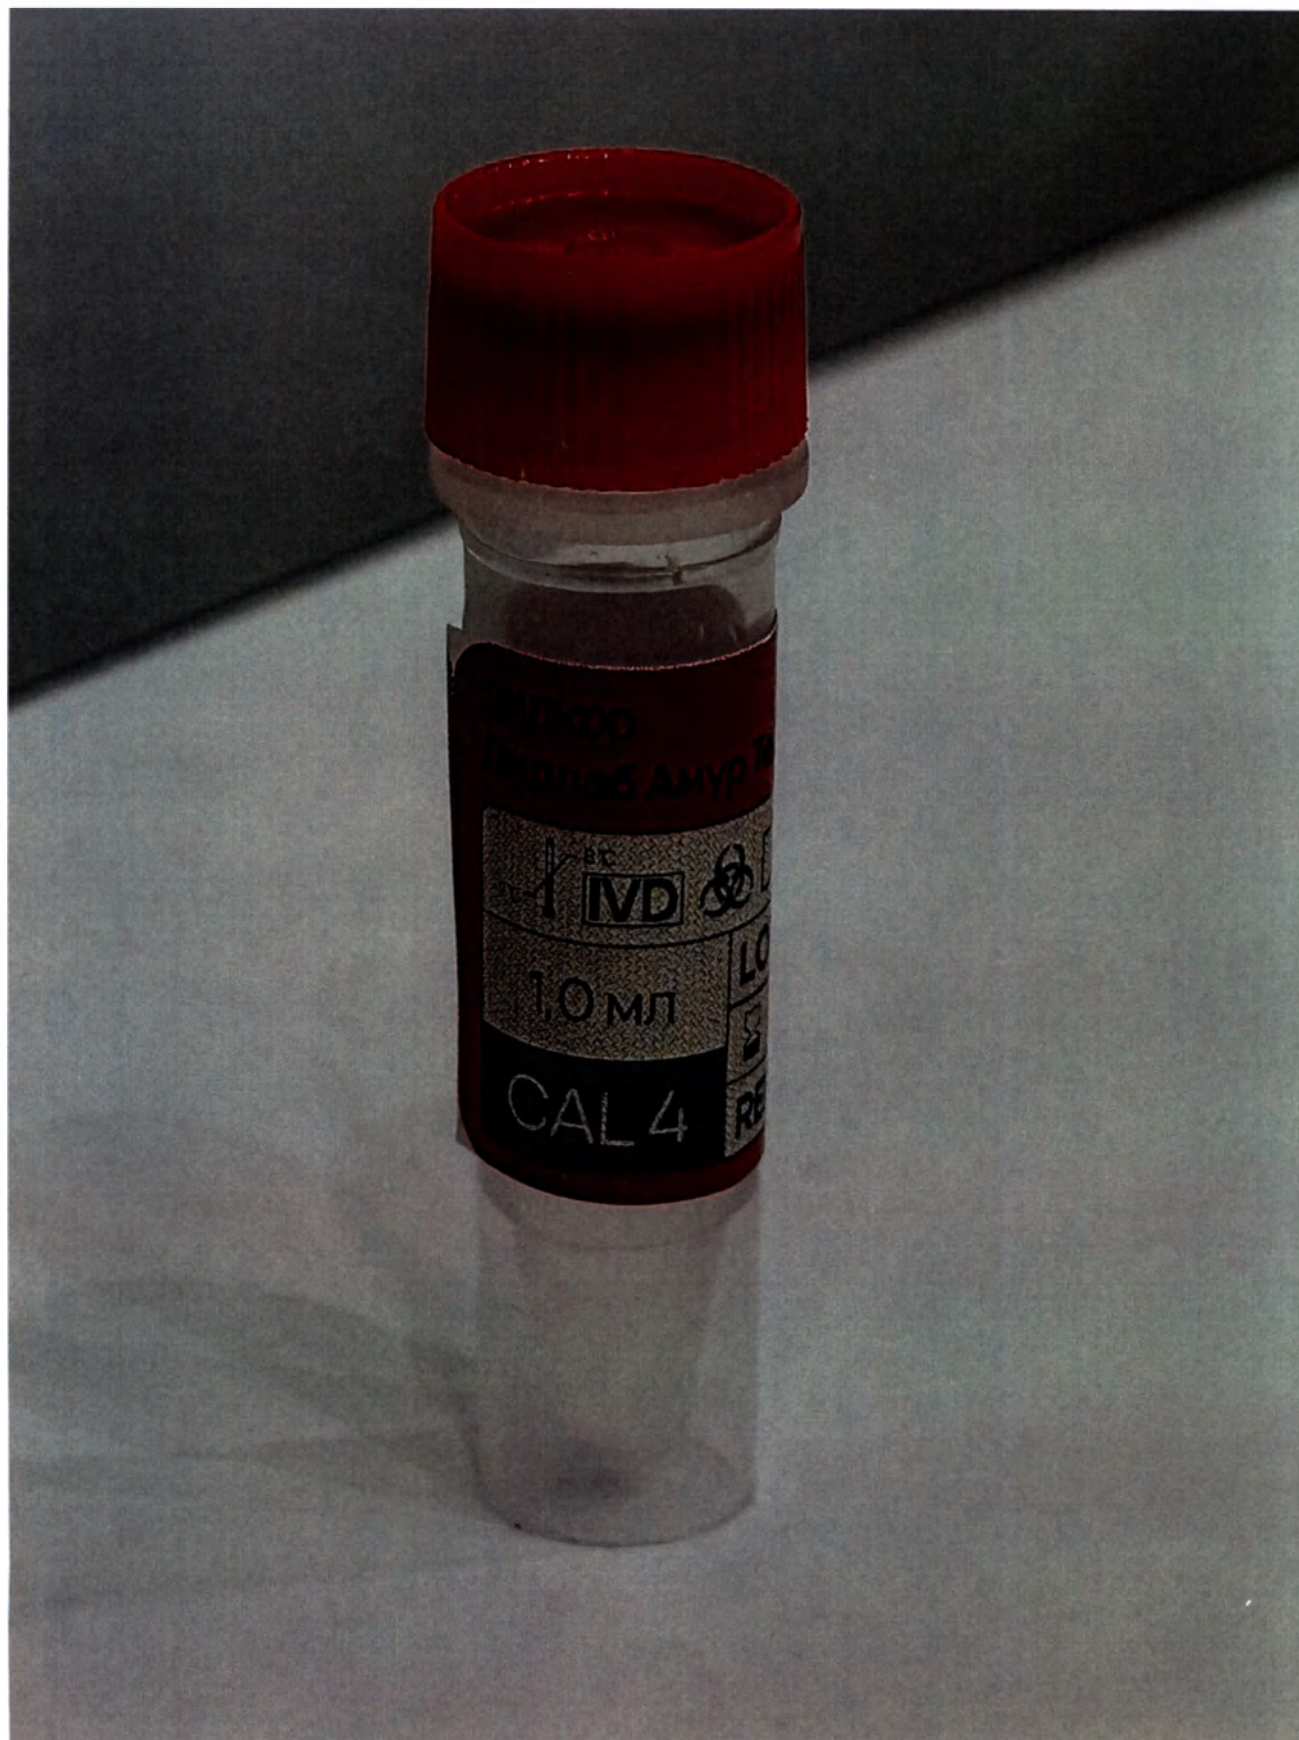

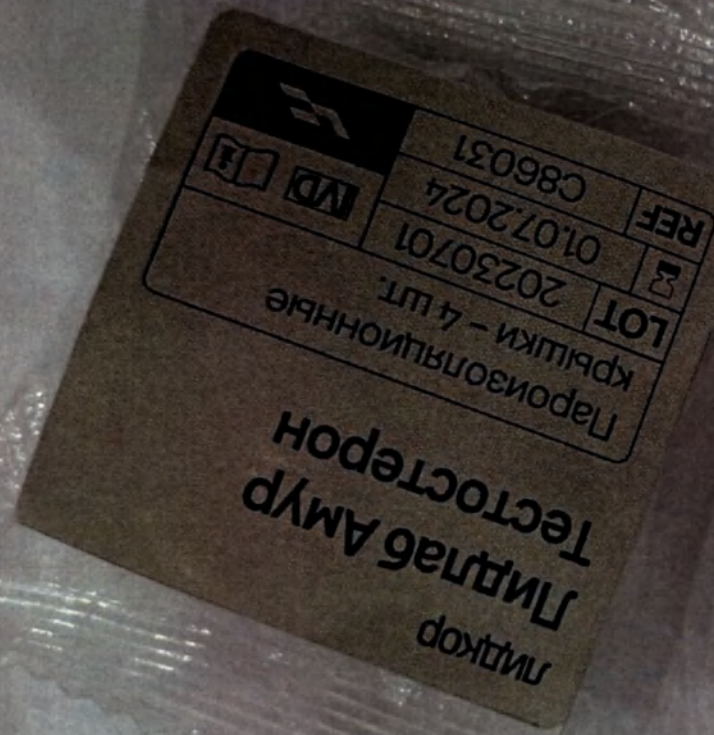



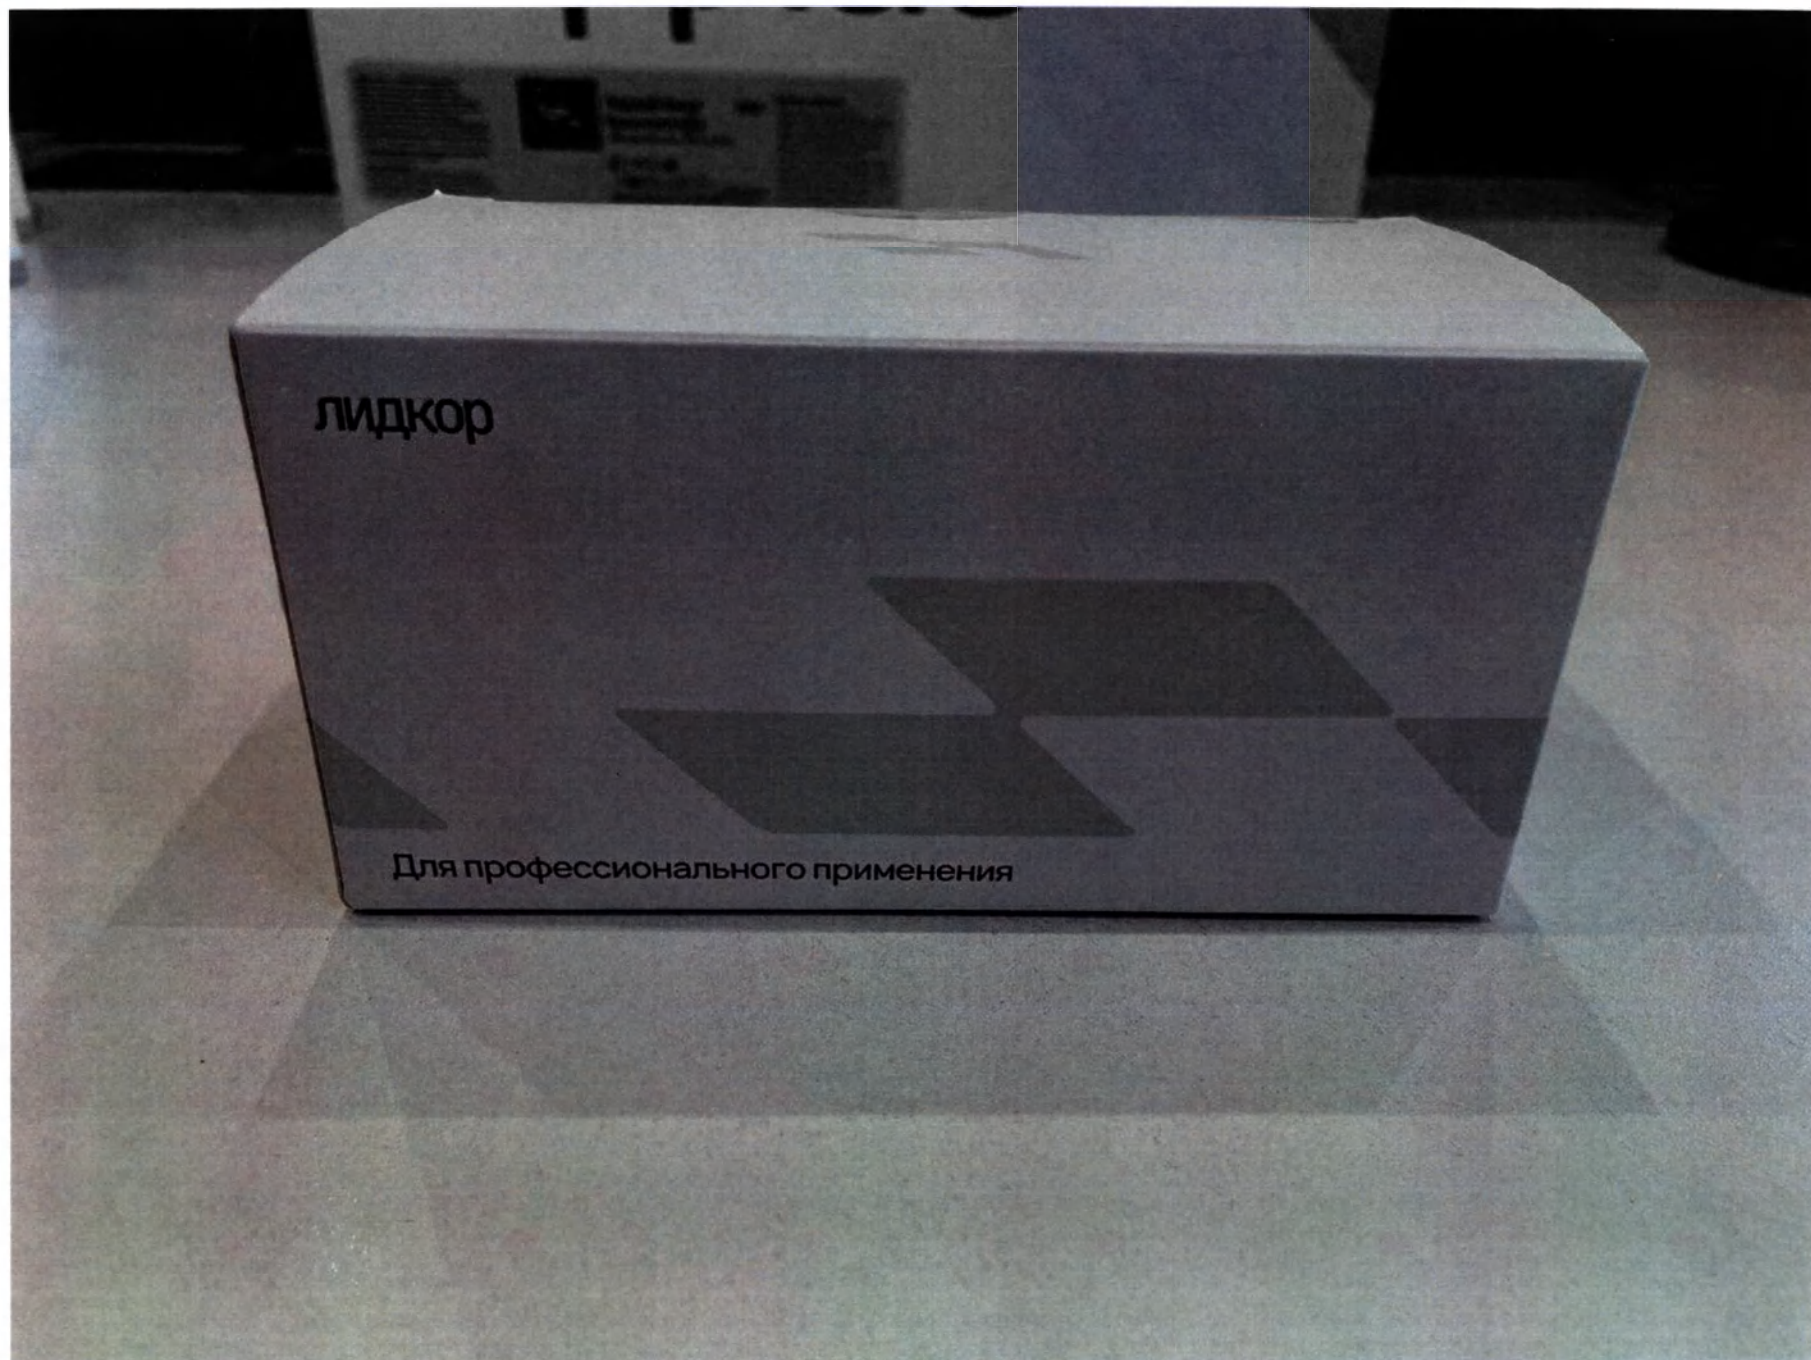

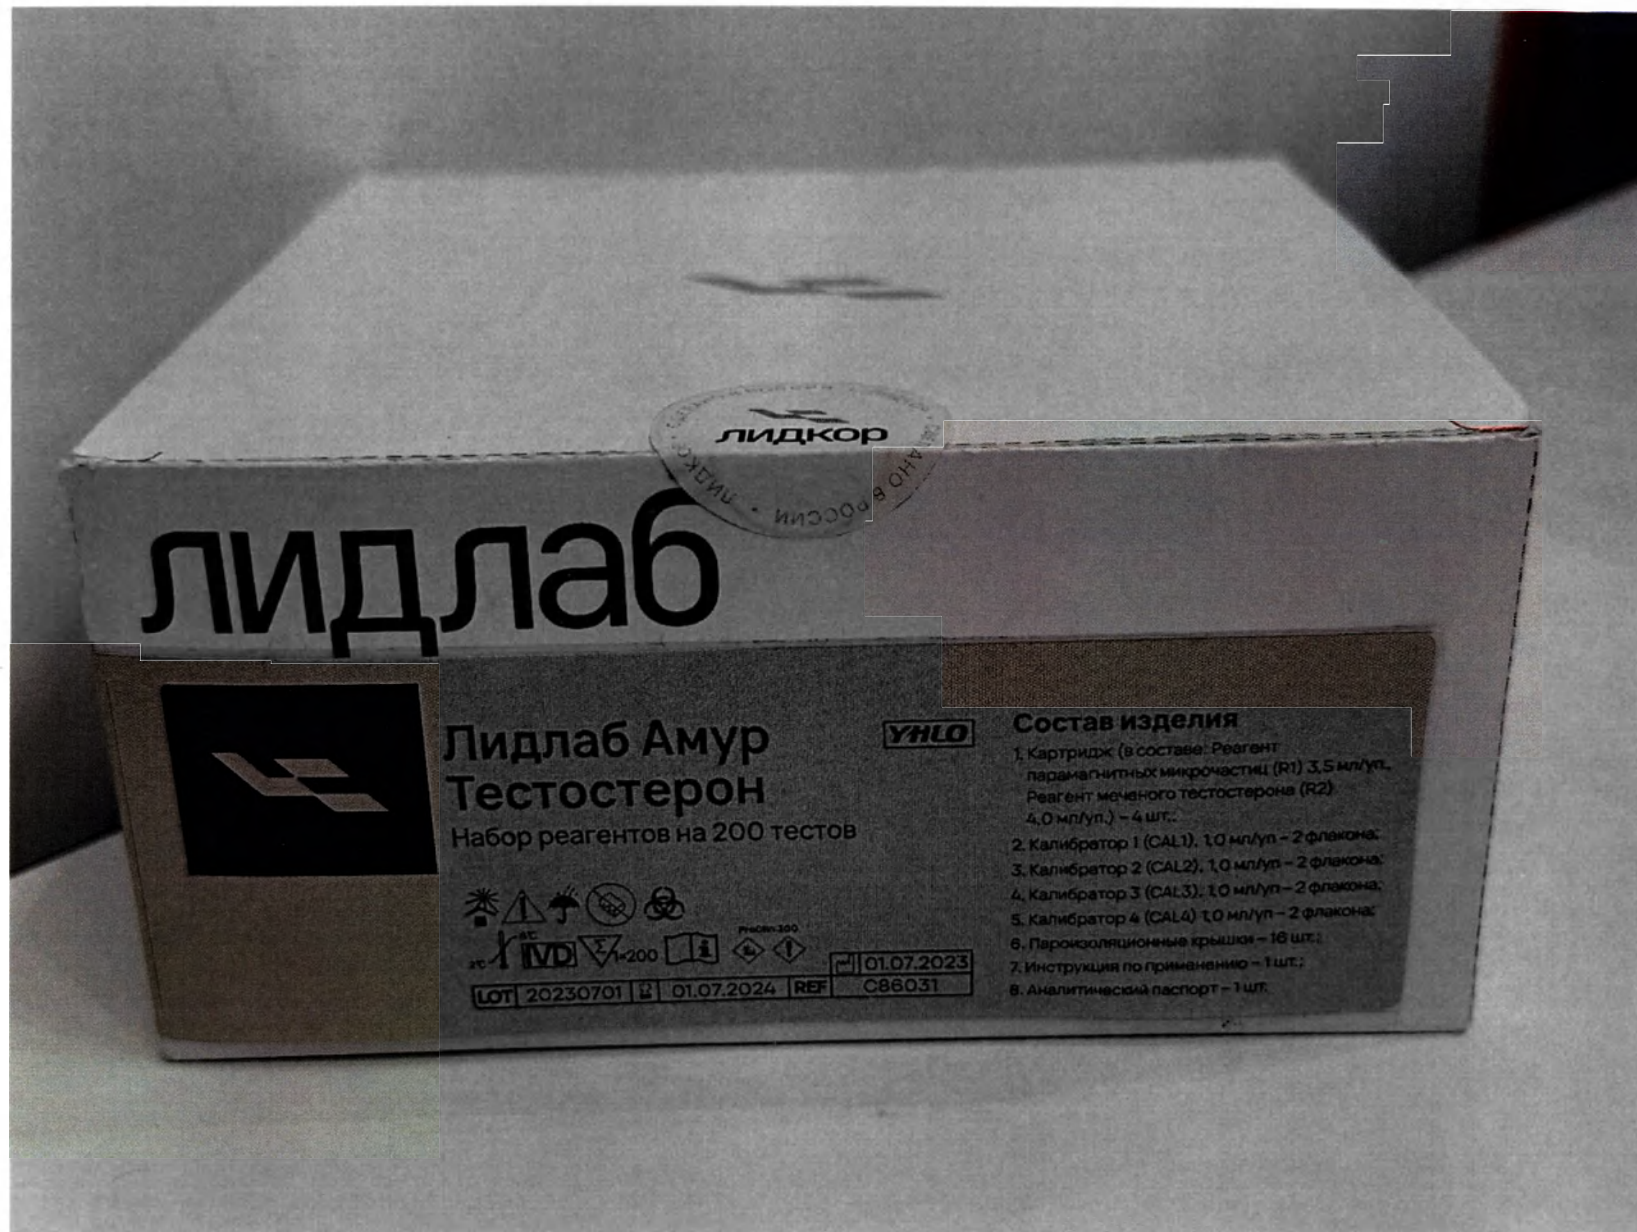

лидлаб



**Лидлаб Амур
Тестостерон**
Набор реагентов на 200 тестов

YHLO


Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп. Реагент меченого тестостерона (R2) 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1). 1,0 мл/уп – 2 флакона;
3. Калибратор 2 (CAL2). 1,0 мл/уп – 2 флакона;
4. Калибратор 3 (CAL3). 1,0 мл/уп – 2 флакона;
5. Калибратор 4 (CAL4) 1,0 мл/уп – 2 флакона;
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.



LOT 20230701 01.07.2024 REF C86031


Набор реагентов на 200 тестов (вид сверху)

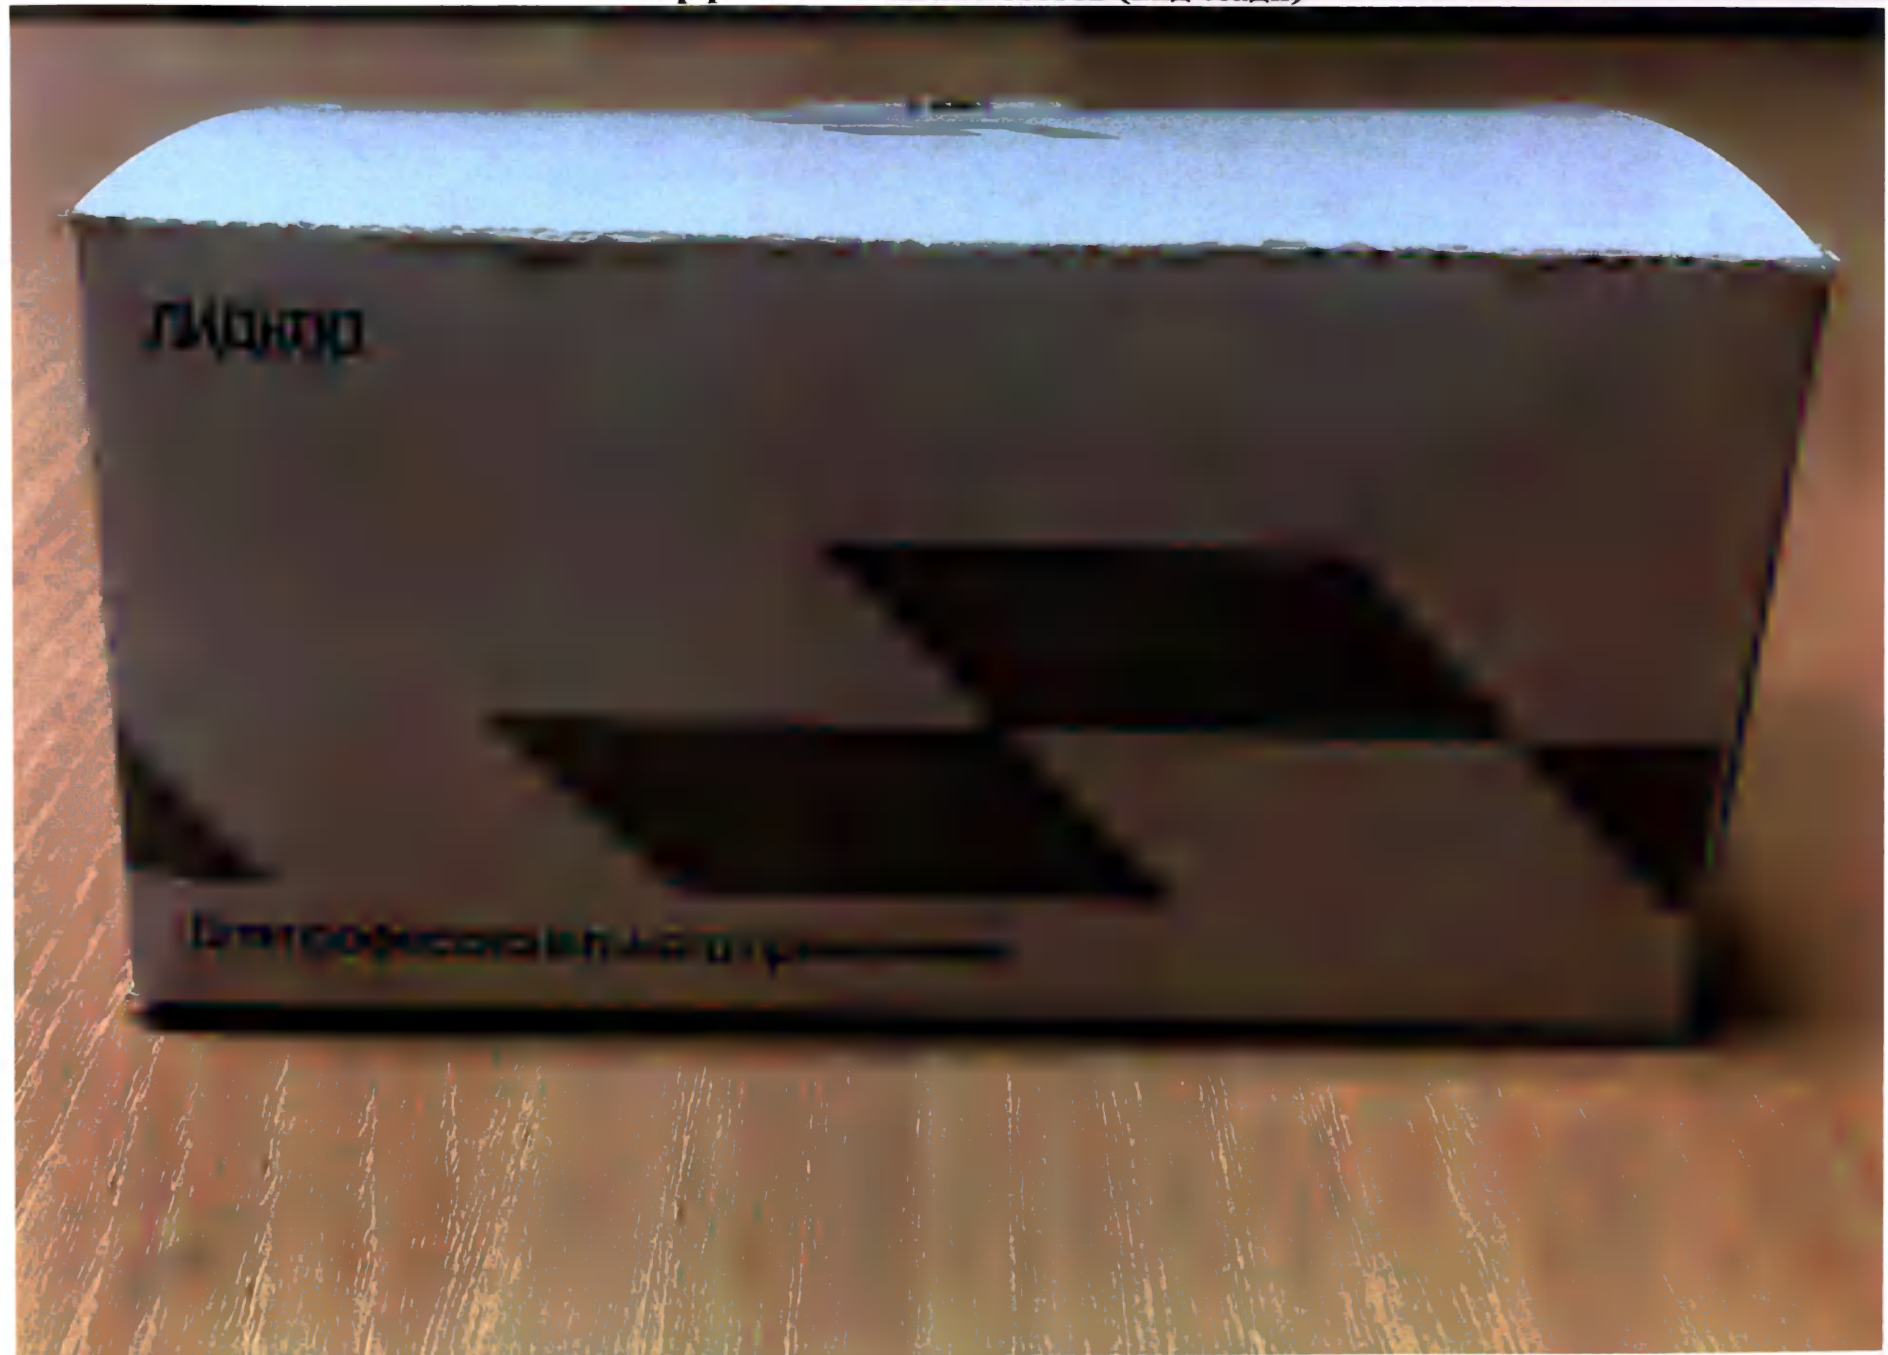


Набор реагентов на 200 тестов (вид сбоку)




Набор реагентов на 500 тестов

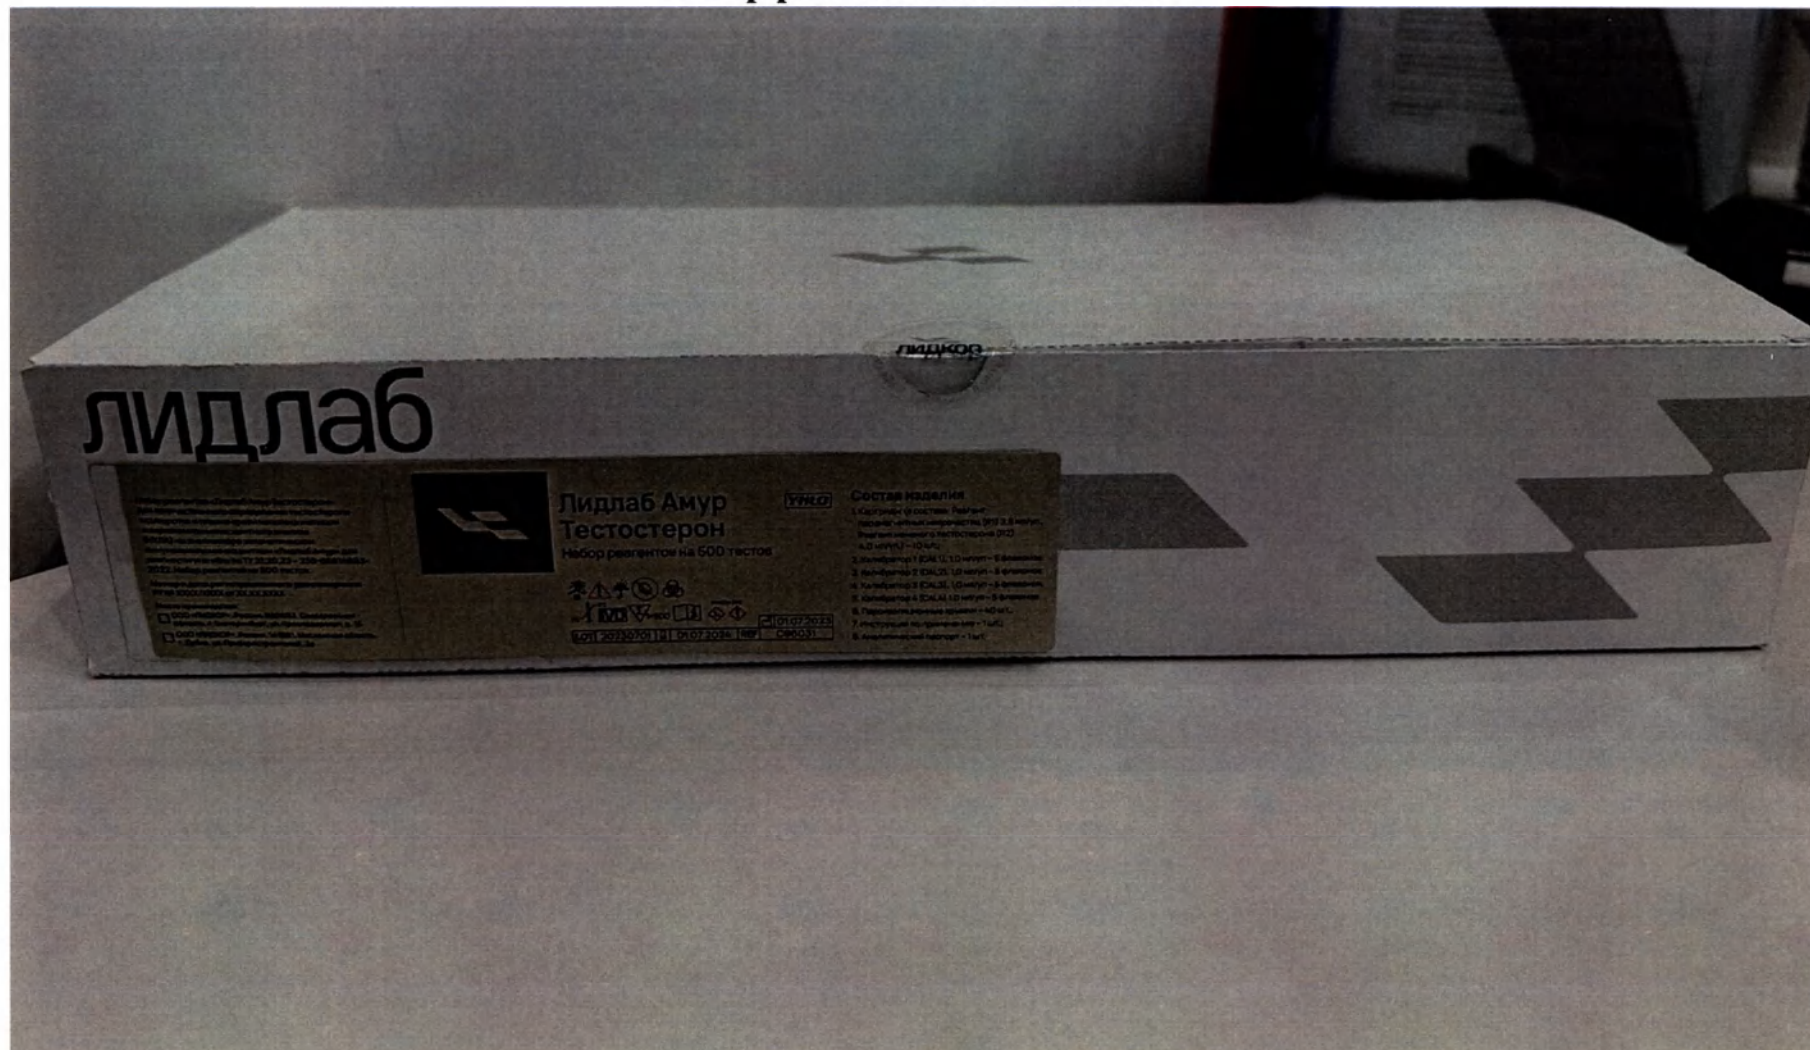

Набор реагентов на 500 тестов (вид сзади)

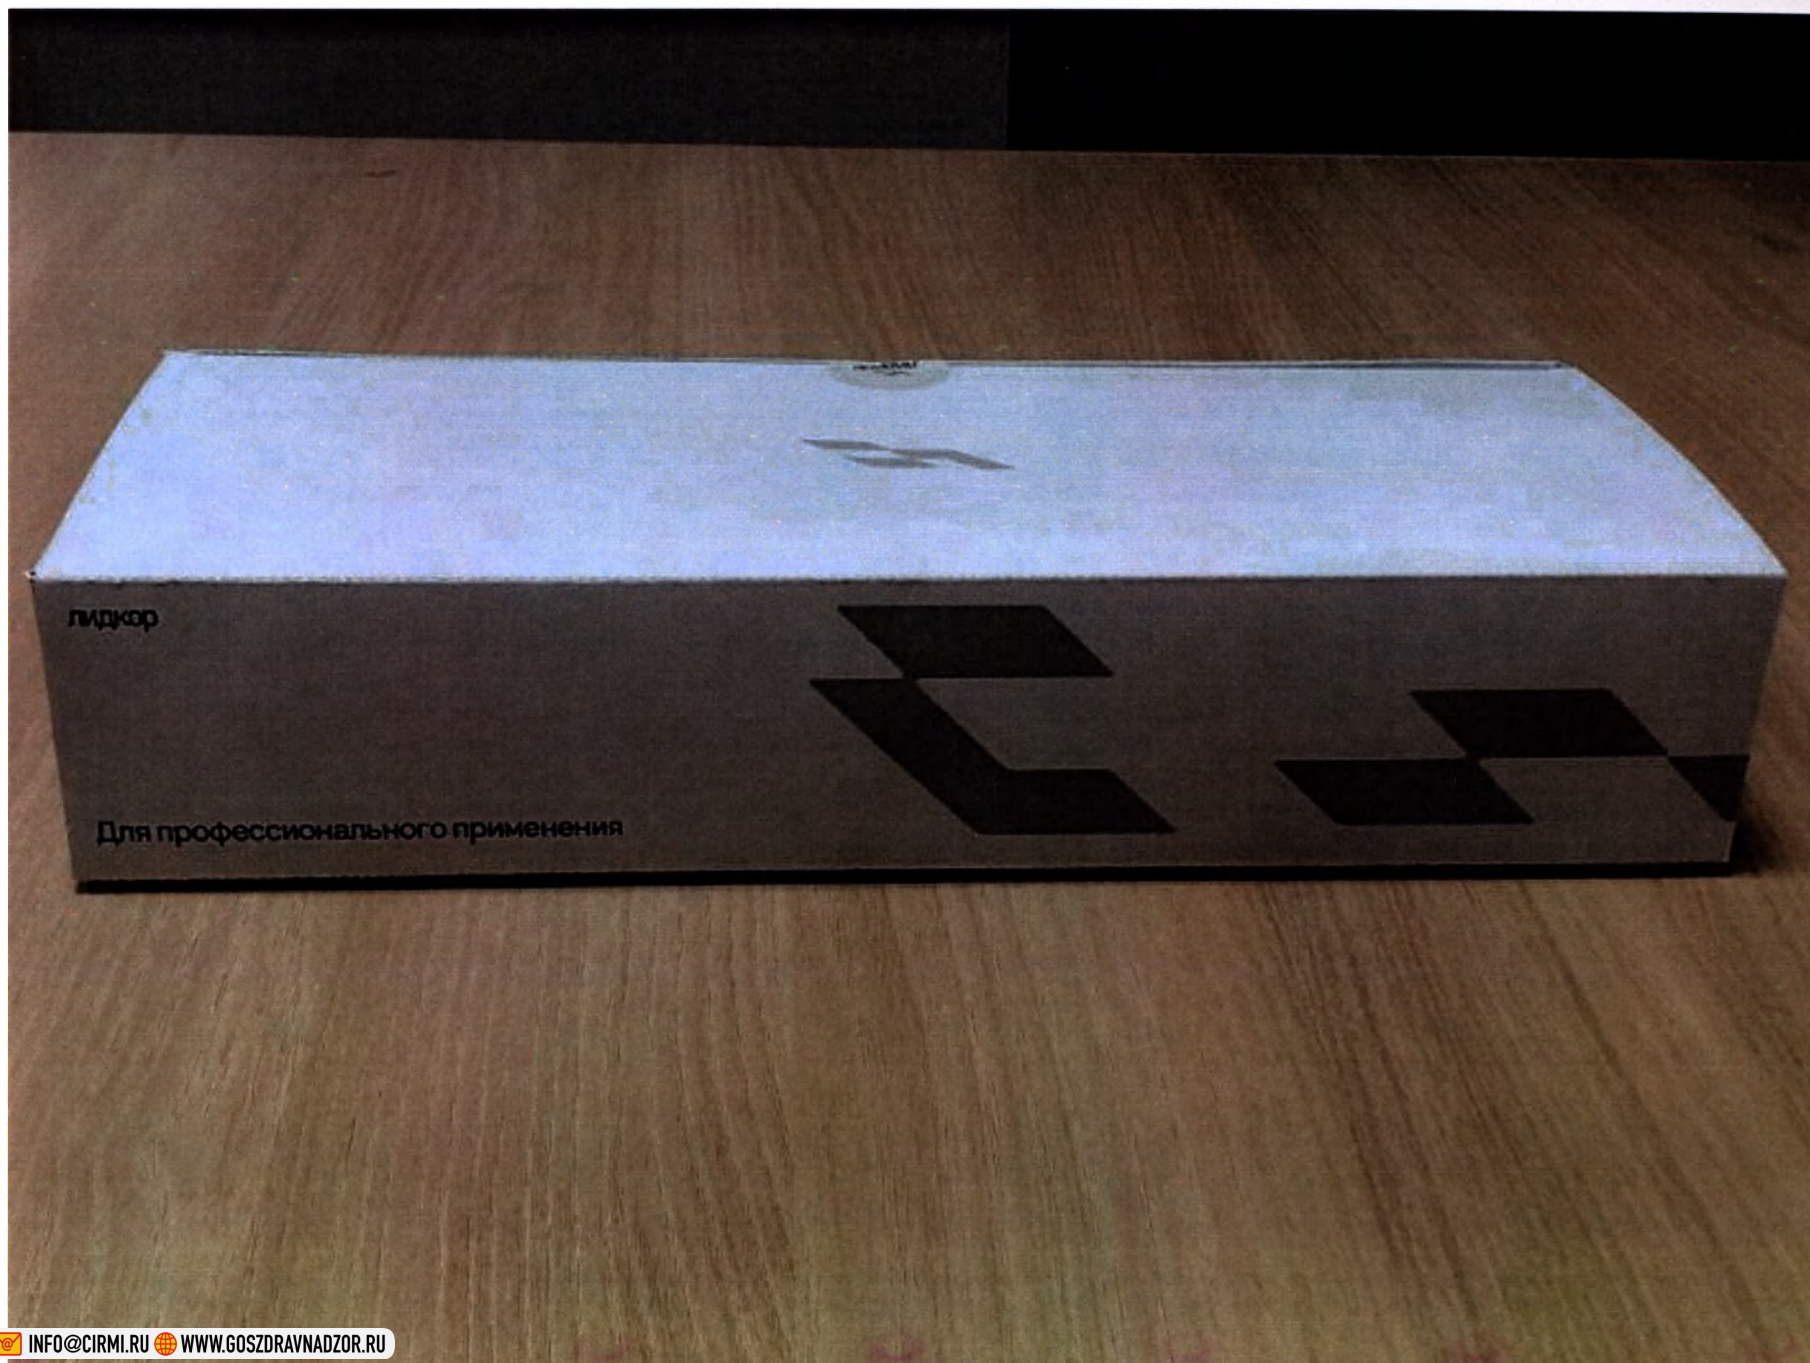

Набор реагентов на 500 тестов (вид сбоку)

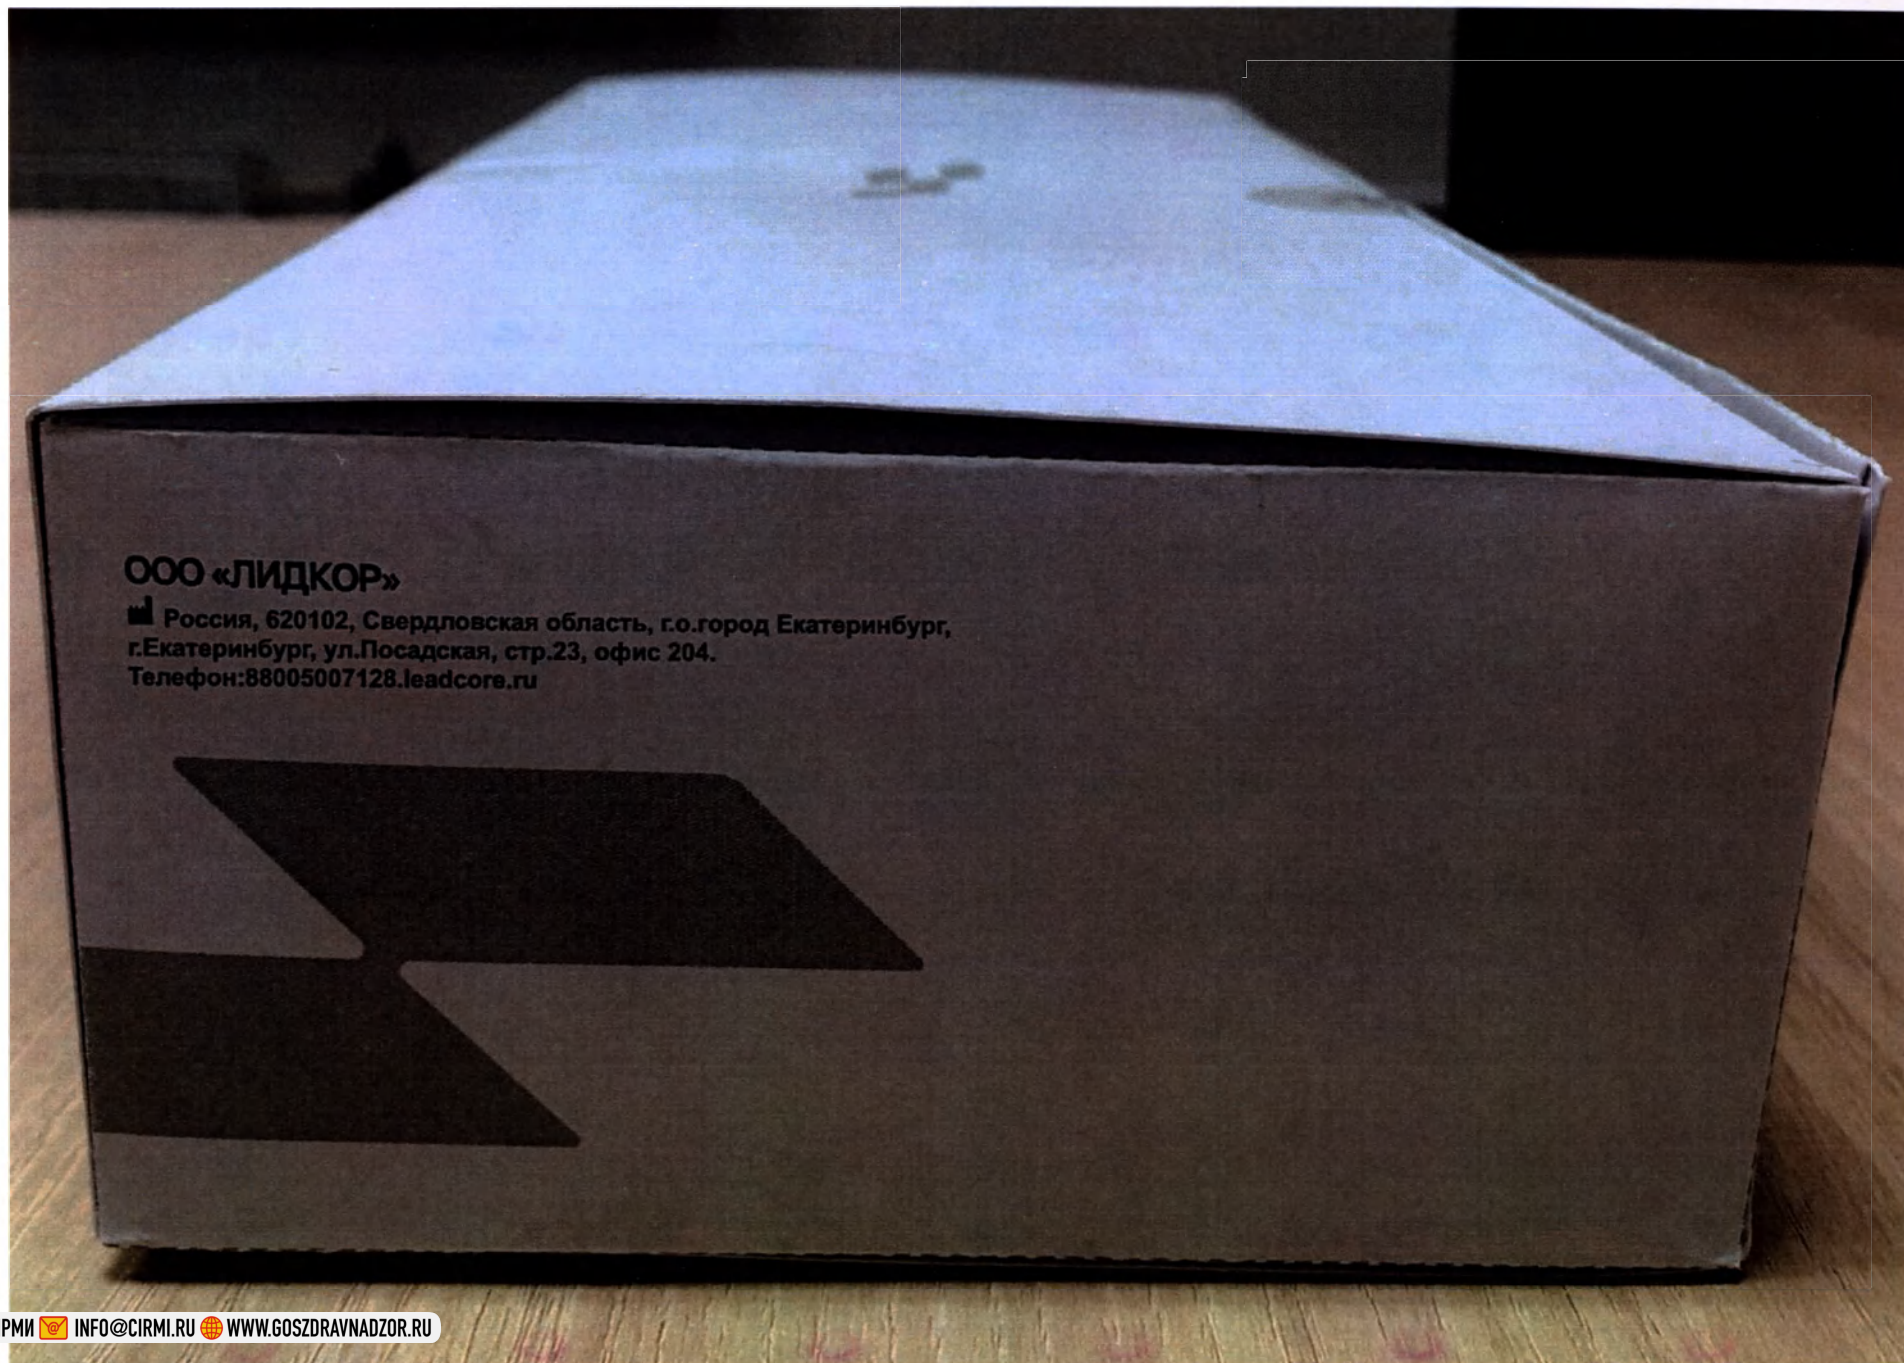

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.
Телефон:88005007128.leadcore.ru




лиддлаб

Лидлаб Амур
Тестостерон
 Набор реагентов на 1000 тестов

Состав набора:
 1. Реагент 1 (Смесь) - 100 мл
 2. Реагент 2 (Смесь) - 100 мл
 3. Реагент 3 (Смесь) - 100 мл
 4. Реагент 4 (Смесь) - 100 мл
 5. Реагент 5 (Смесь) - 100 мл
 6. Реагент 6 (Смесь) - 100 мл
 7. Реагент 7 (Смесь) - 100 мл
 8. Реагент 8 (Смесь) - 100 мл
 9. Реагент 9 (Смесь) - 100 мл
 10. Реагент 10 (Смесь) - 100 мл

2019.07.23

Набор реагентов на 1000 (вид сзади)

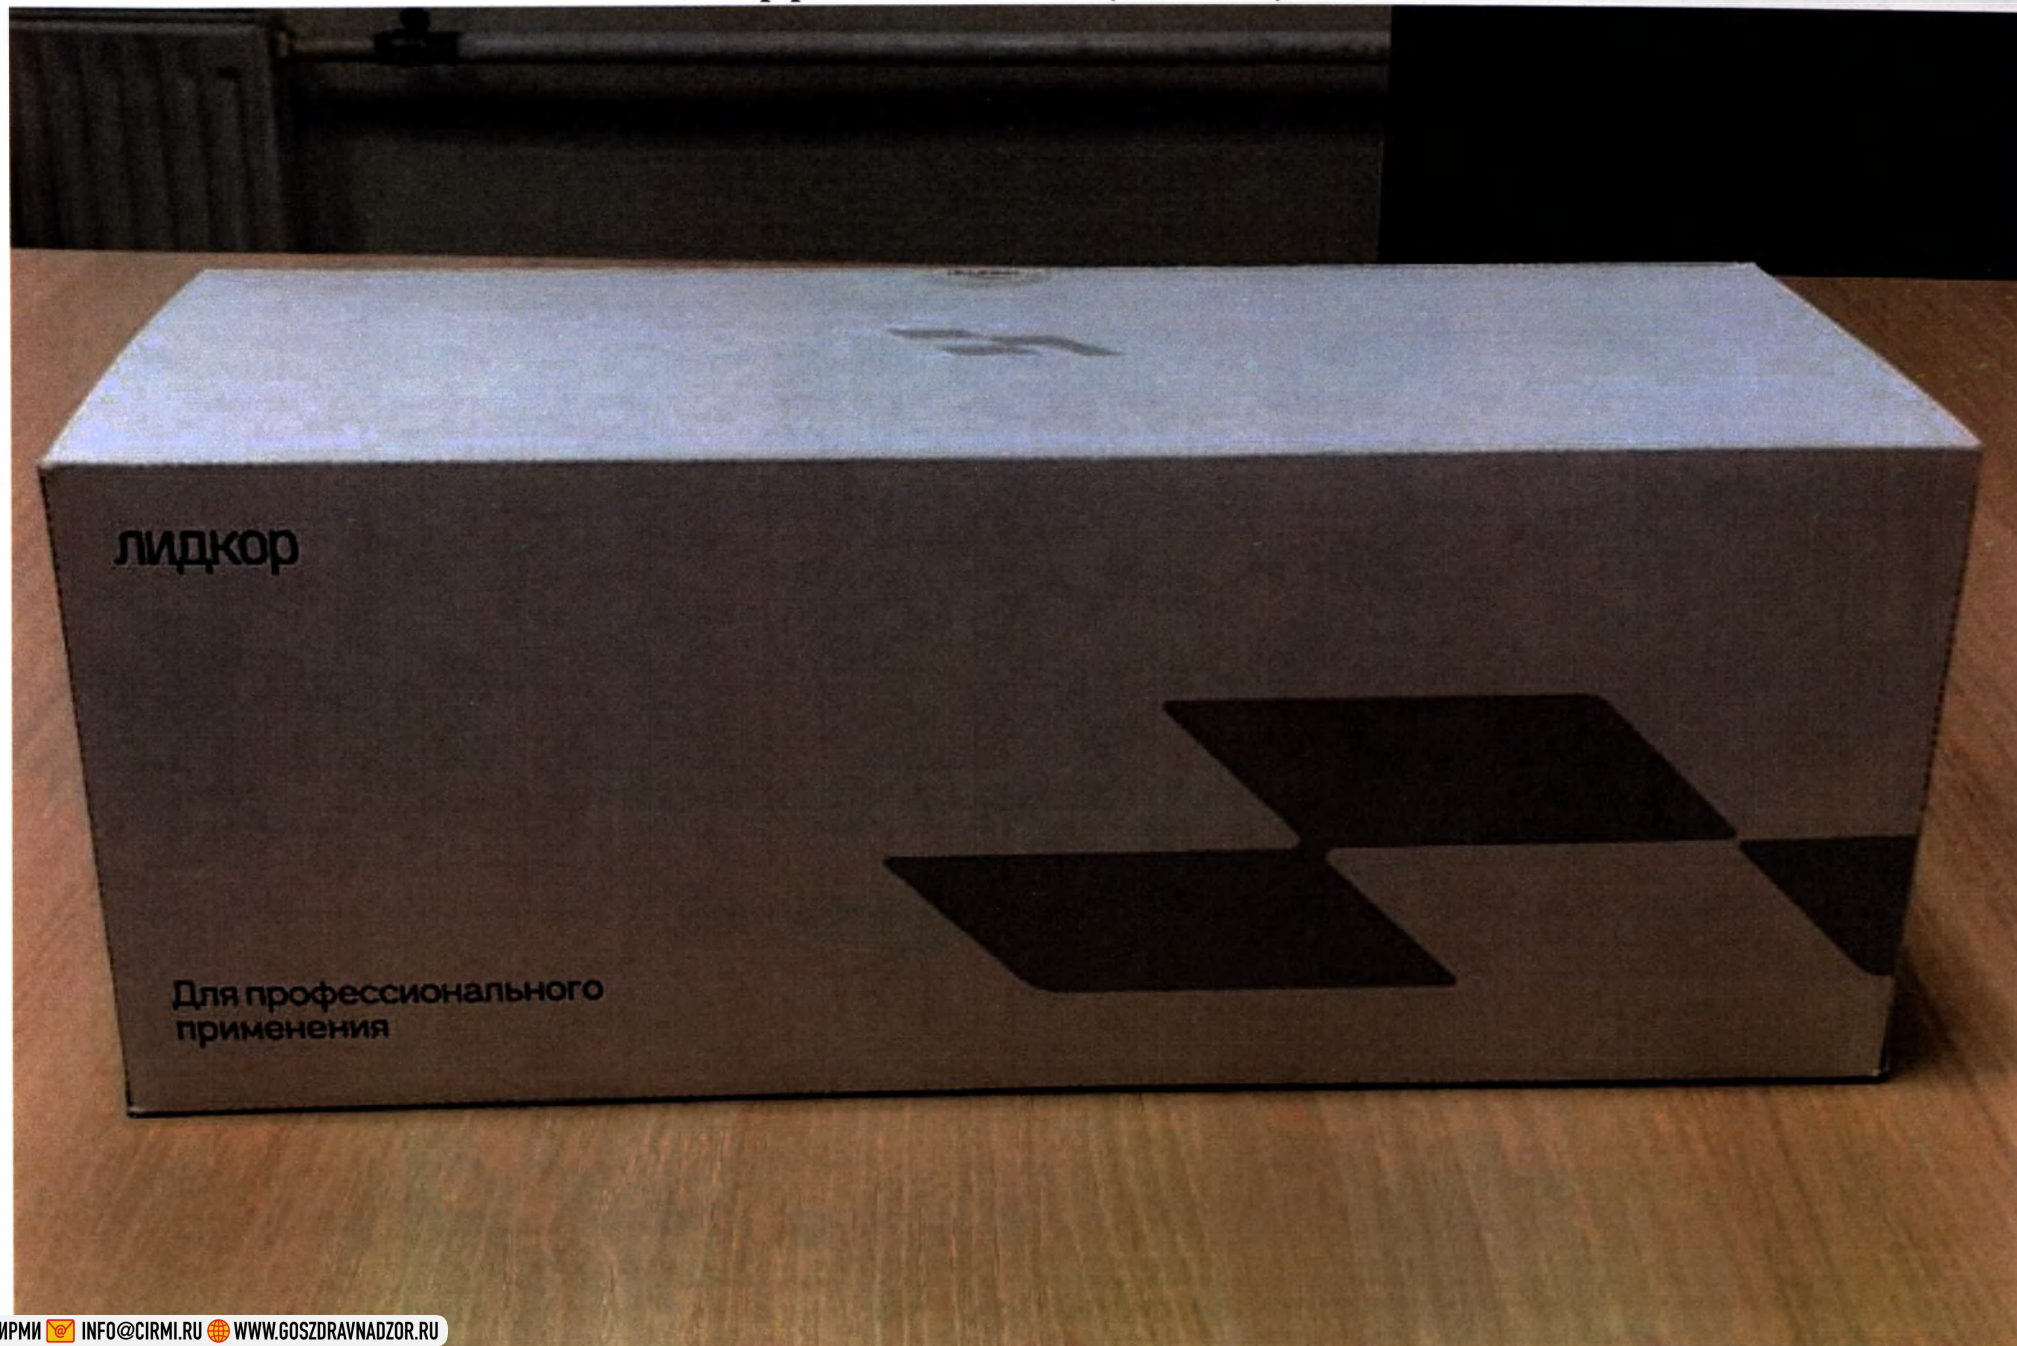


Набор реагентов на 1000 тестов (вид сбоку)

ООО «ЛИДКОР»


■ Россия, 620102, Свердловская область, г.о.город Екатеринбург,
г.Екатеринбург, ул.Посадская, стр.23, офис 204.
Телефон:88005007128.leadcore.ru



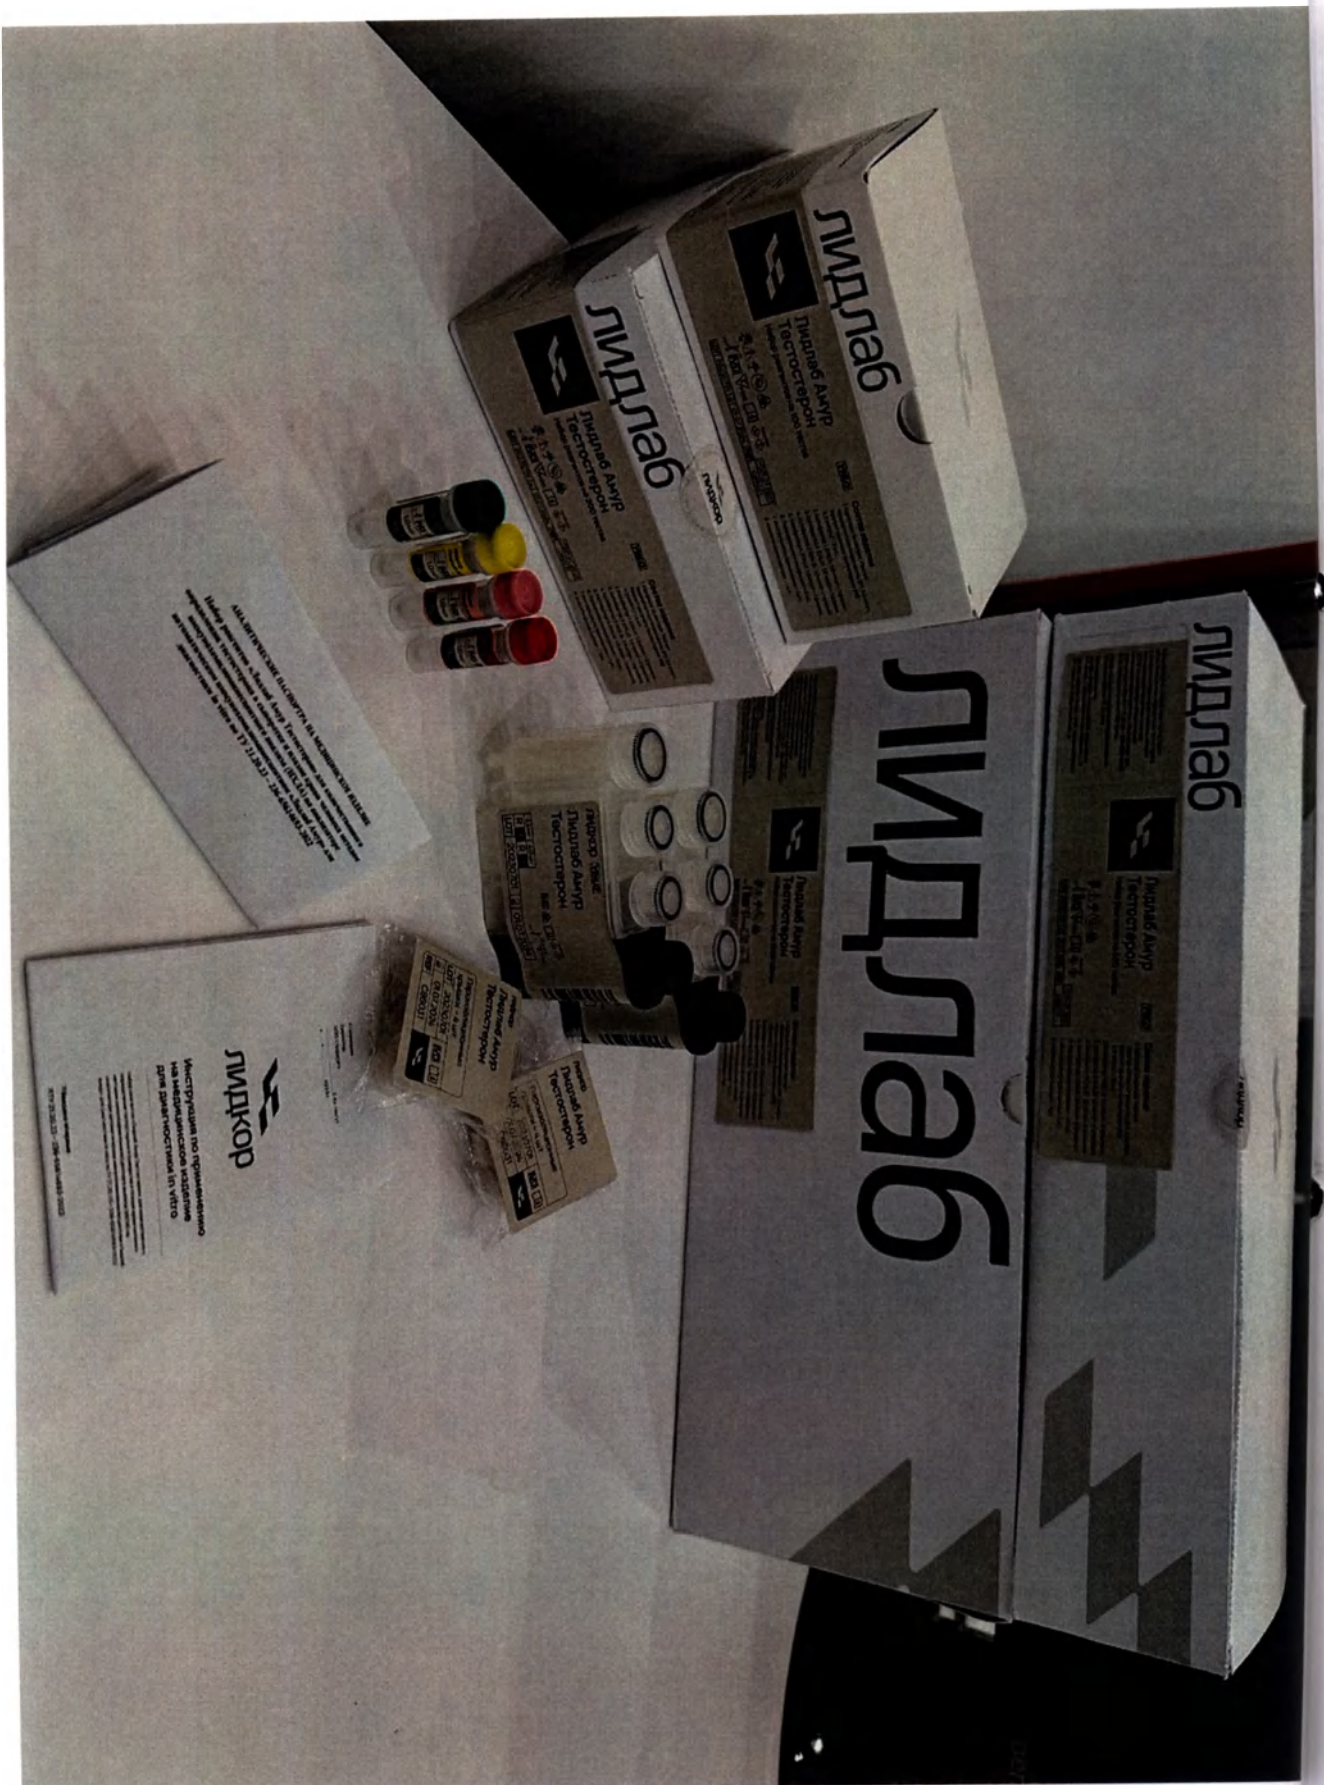



Набор реагентов «Лидлаб Амур Тестостерон» для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-236-65614693-2022

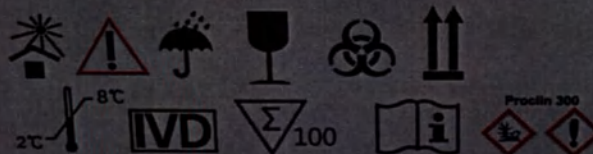

Для профессионального применения

		ООО «ЛИДЛАБ», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.			01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86031

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

20 (двадцать) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/