

ПОДТВЕРЖДАЮ
Директор
АО «МЕДСЕРВИС»
Луадж В.И.



«14» сентября 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Автоматический анализатор свертывания крови с принадлежностями
Вариант исполнения: MD-560
производства «Мереди́т Диагностикс Лтд.», Соединенное Королевство
(Meredith Diagnostics, United Kingdom).



Автоматический анализатор свертывания крови MD-560

Инструкция по эксплуатации автоматического анализатора свертывания крови MD-560


Инструкция пользователя

Автоматический анализатор свертывания крови MD-560


Страница 1 из 1

MD-560

Инструкция пользователя.

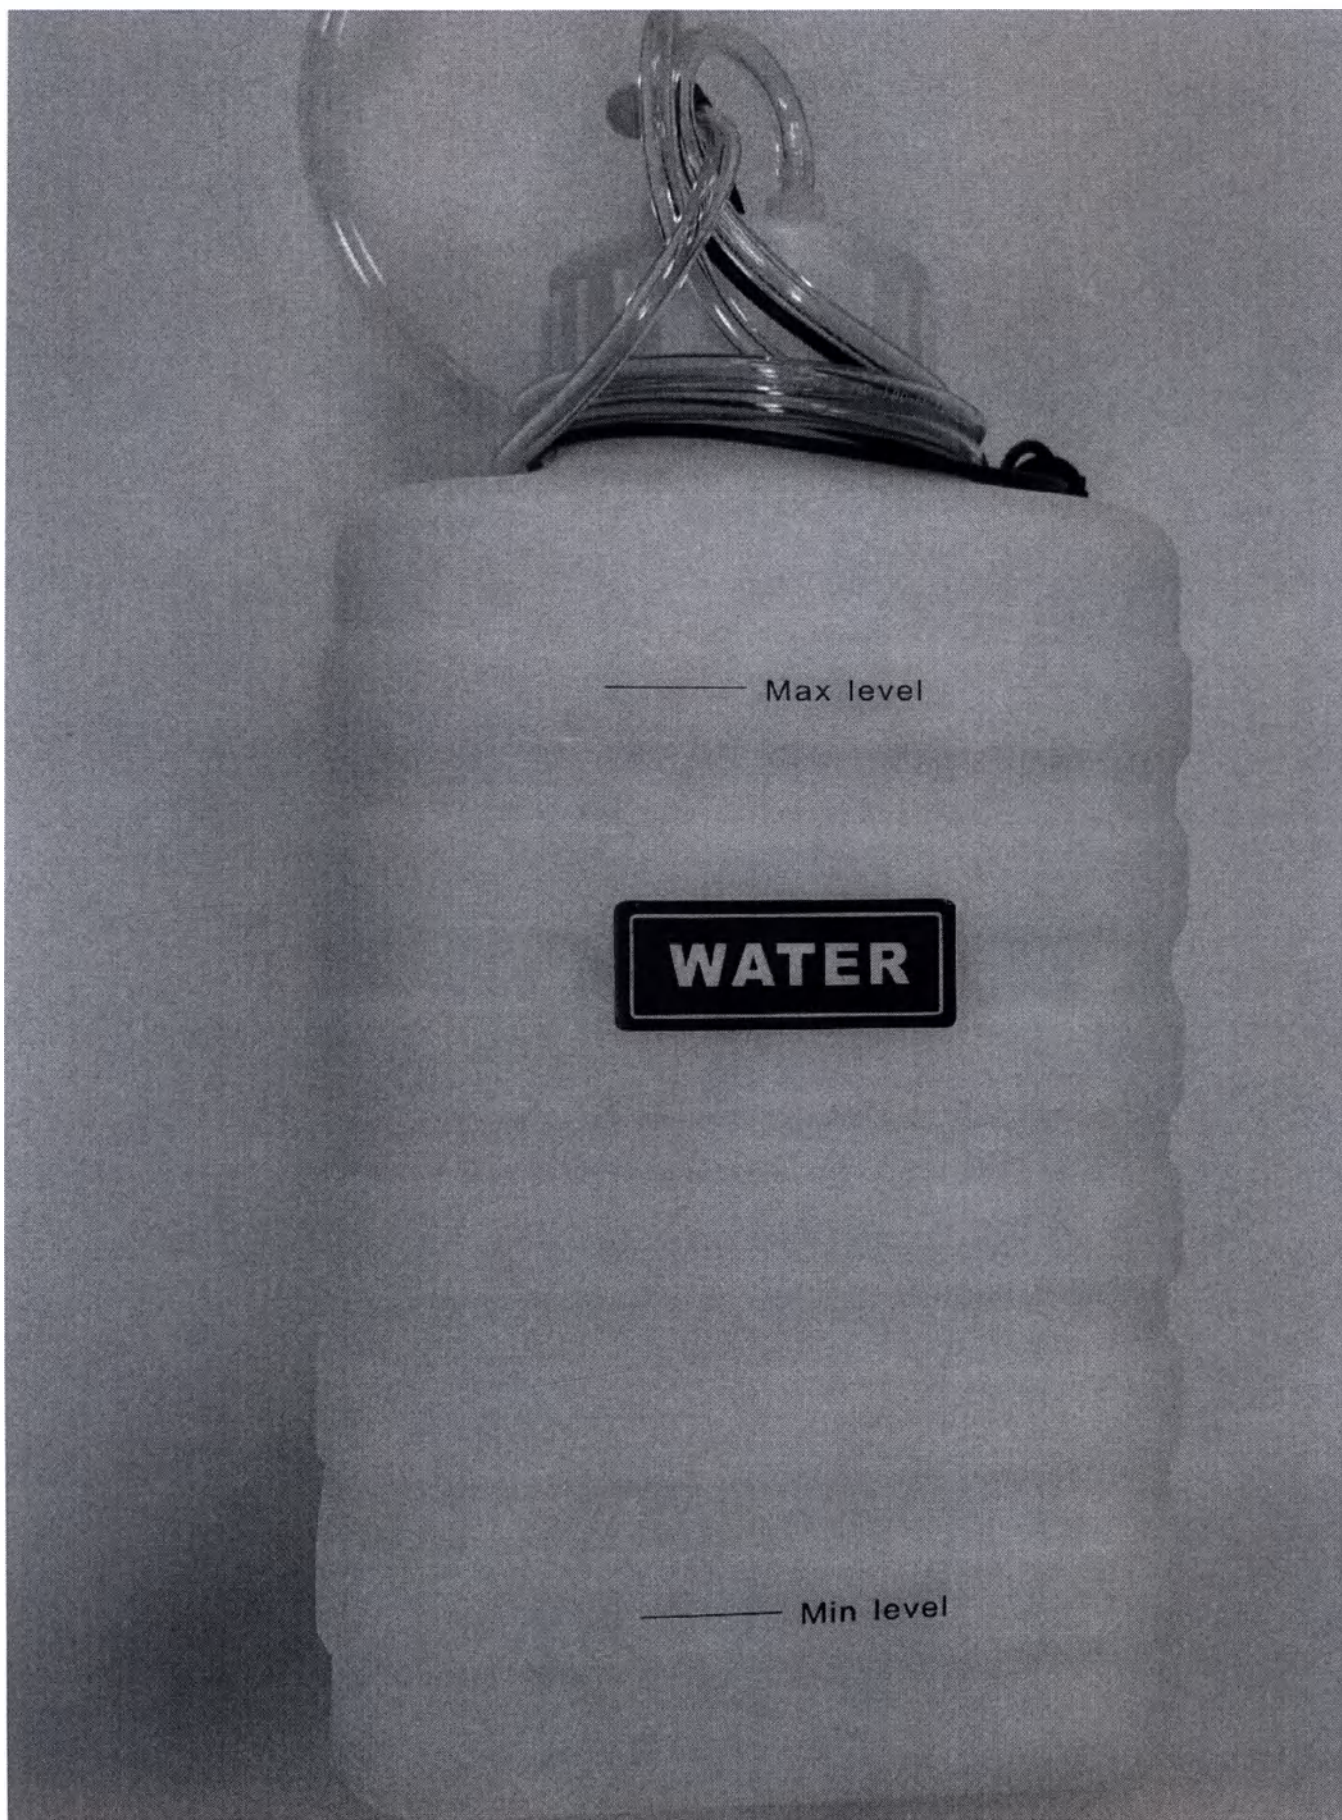


Ёмкость для промывающего раствора.

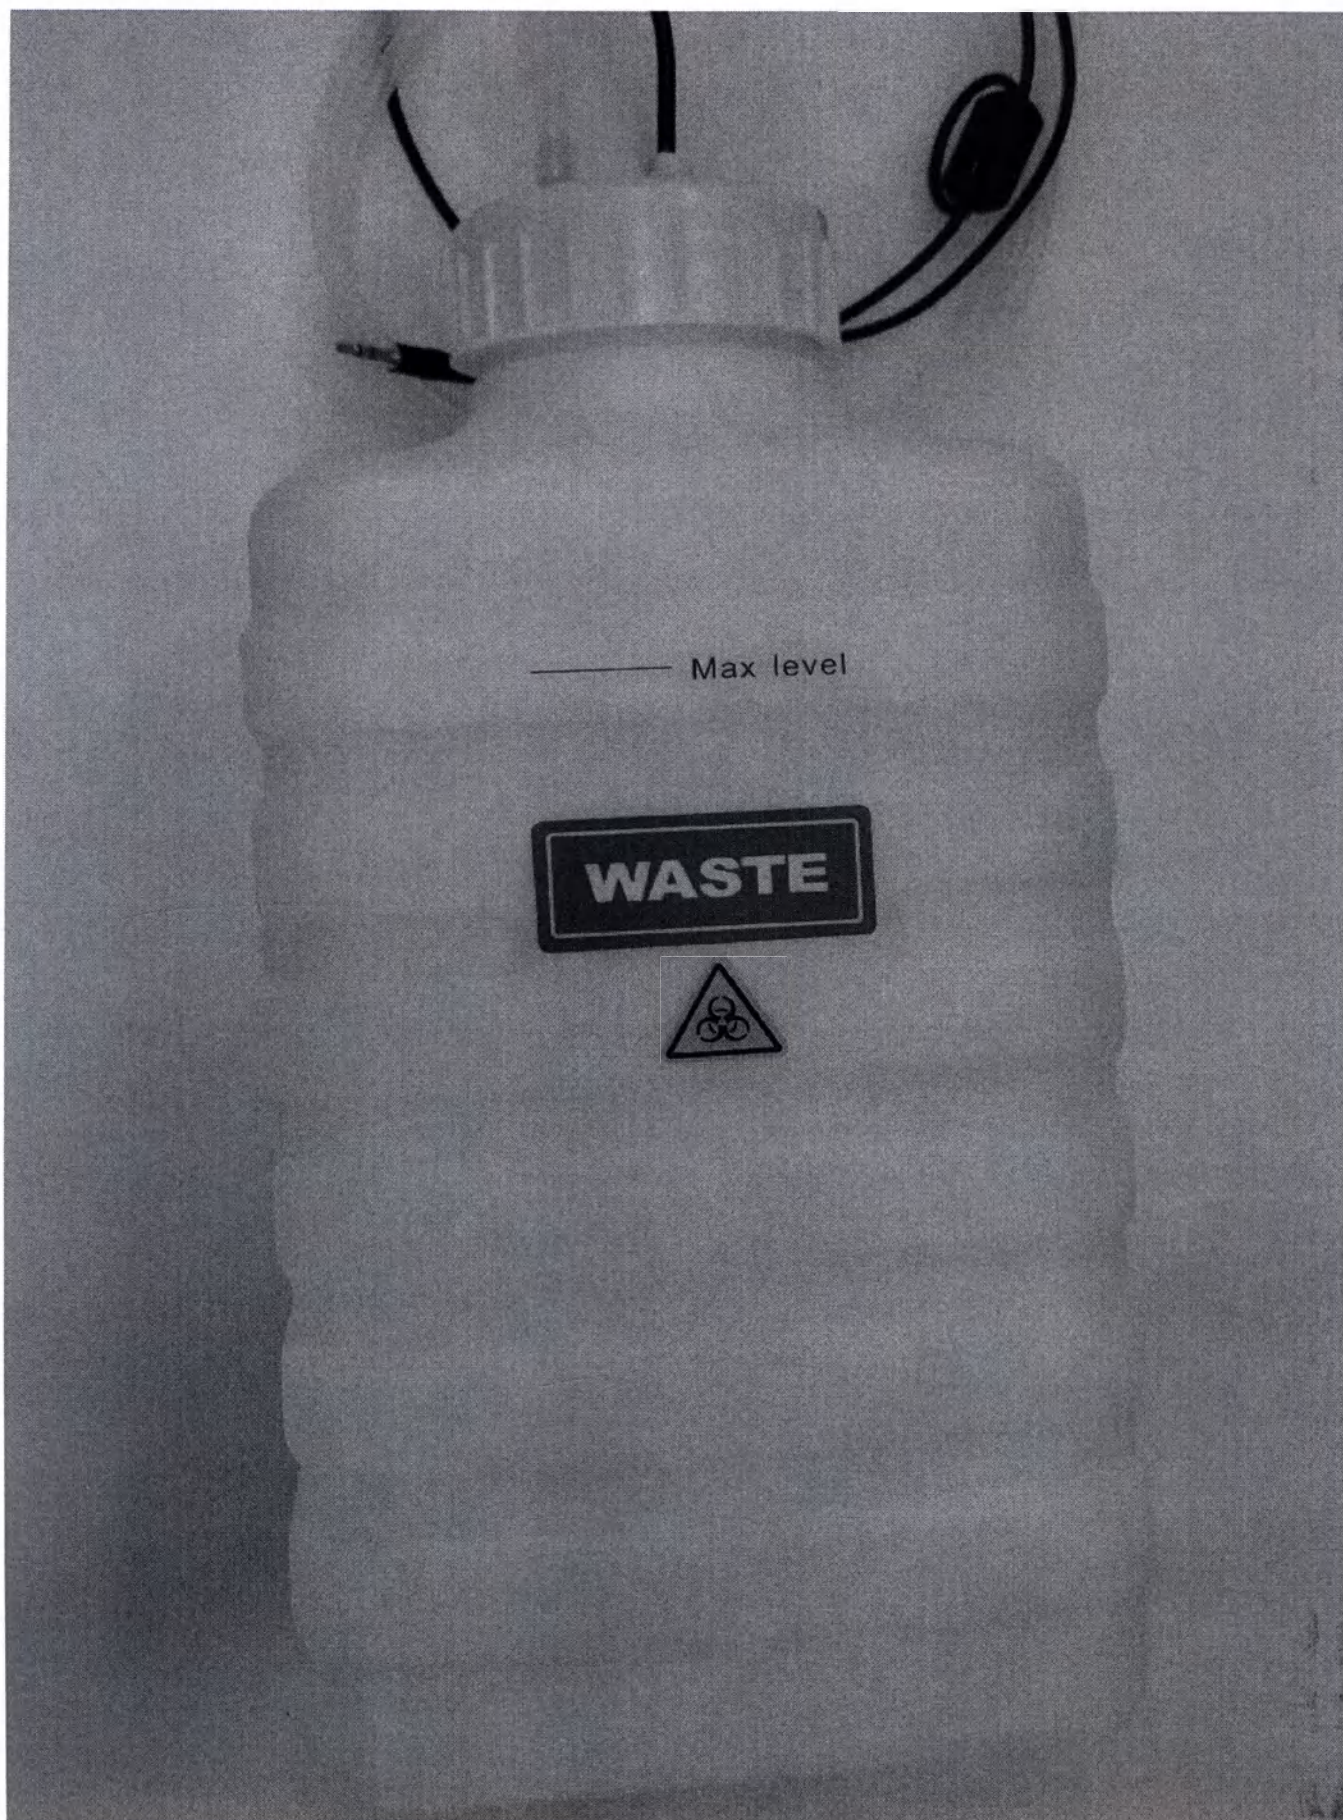

Ёмкость для отходов.

Чашки для образцов 1.5 мл х 100шт.

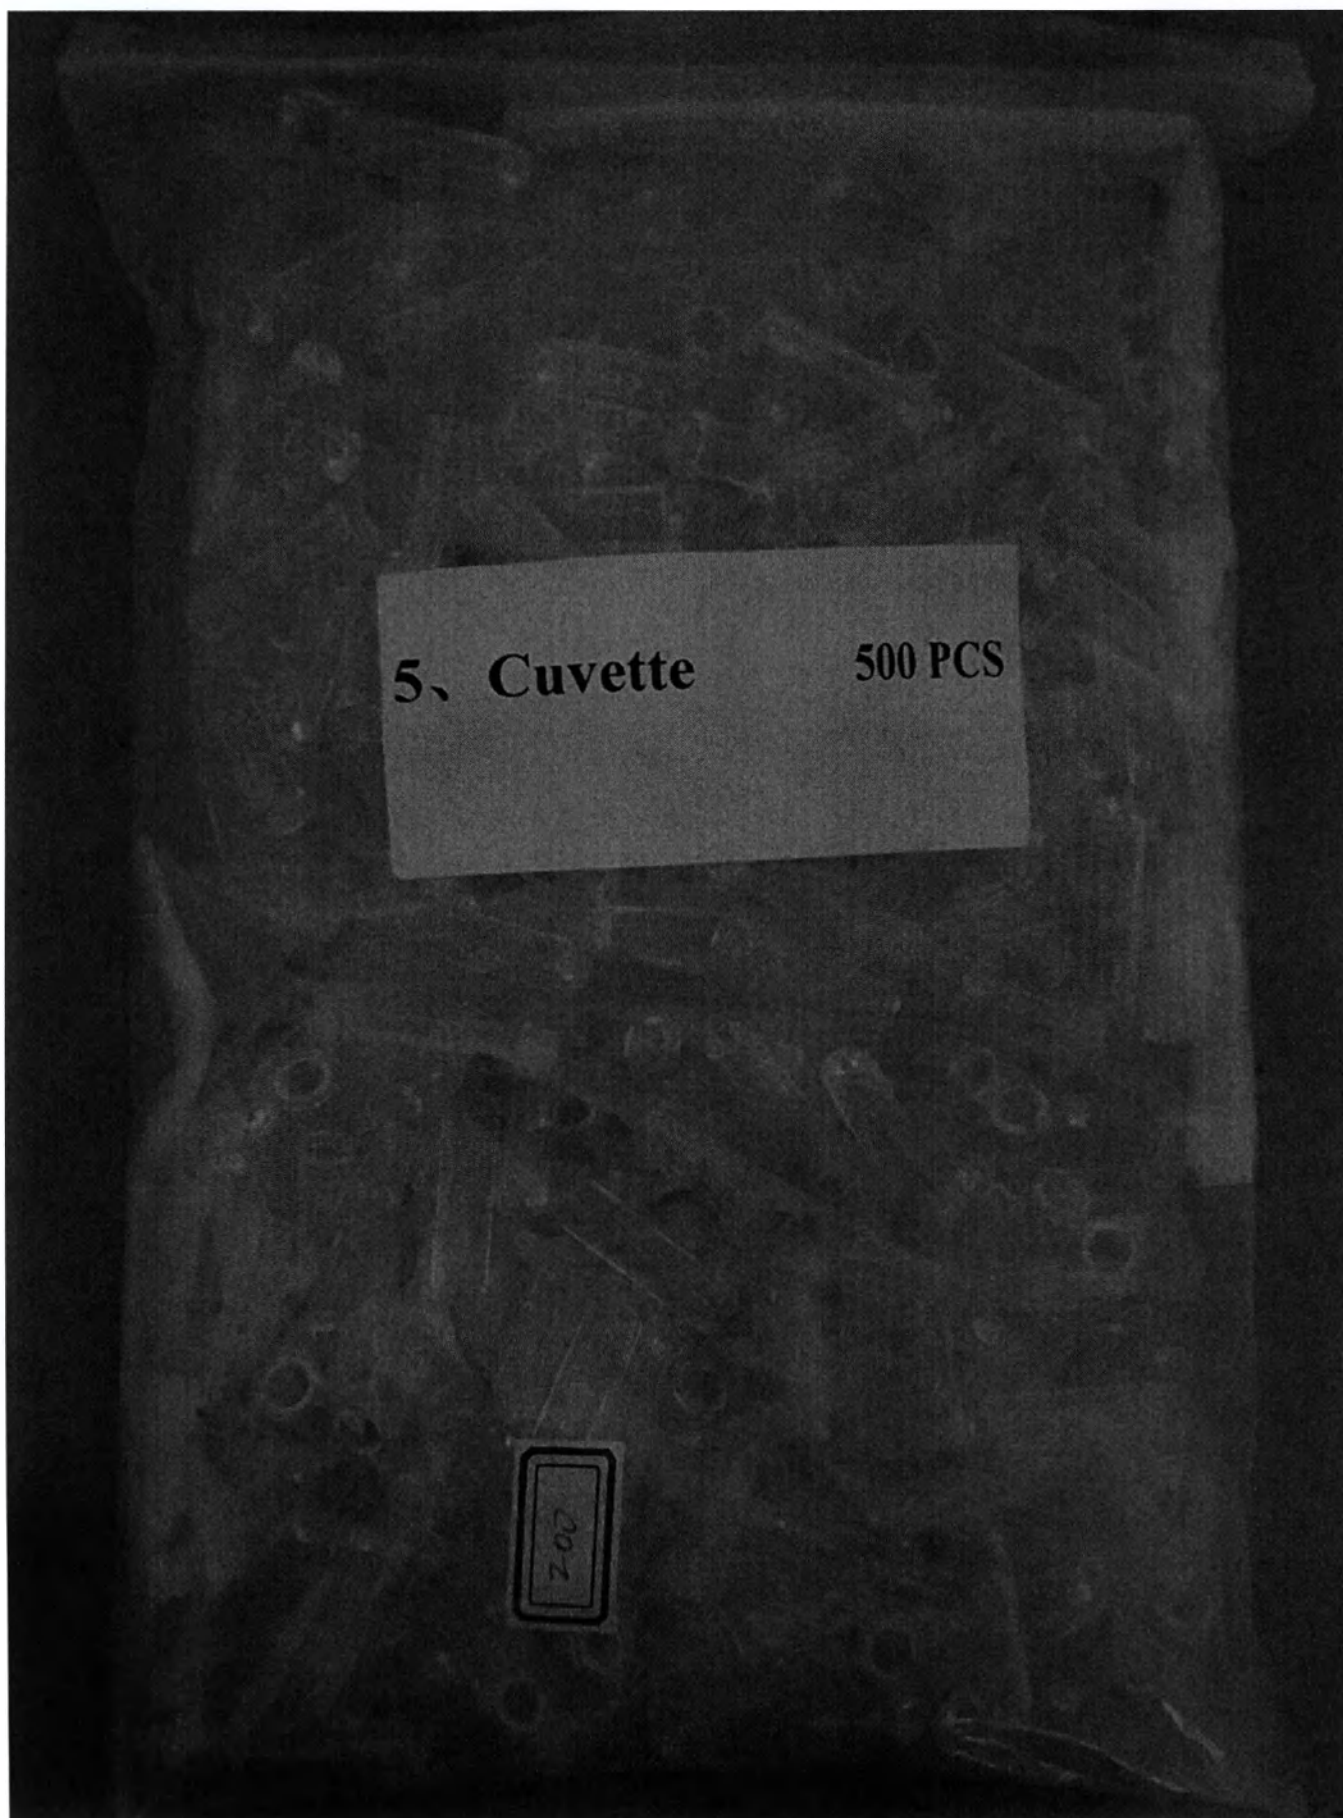

Кюветы измерительные 500 шт.




Сетевой кабель.




Заземляющий провод.



Бумага для принтера.

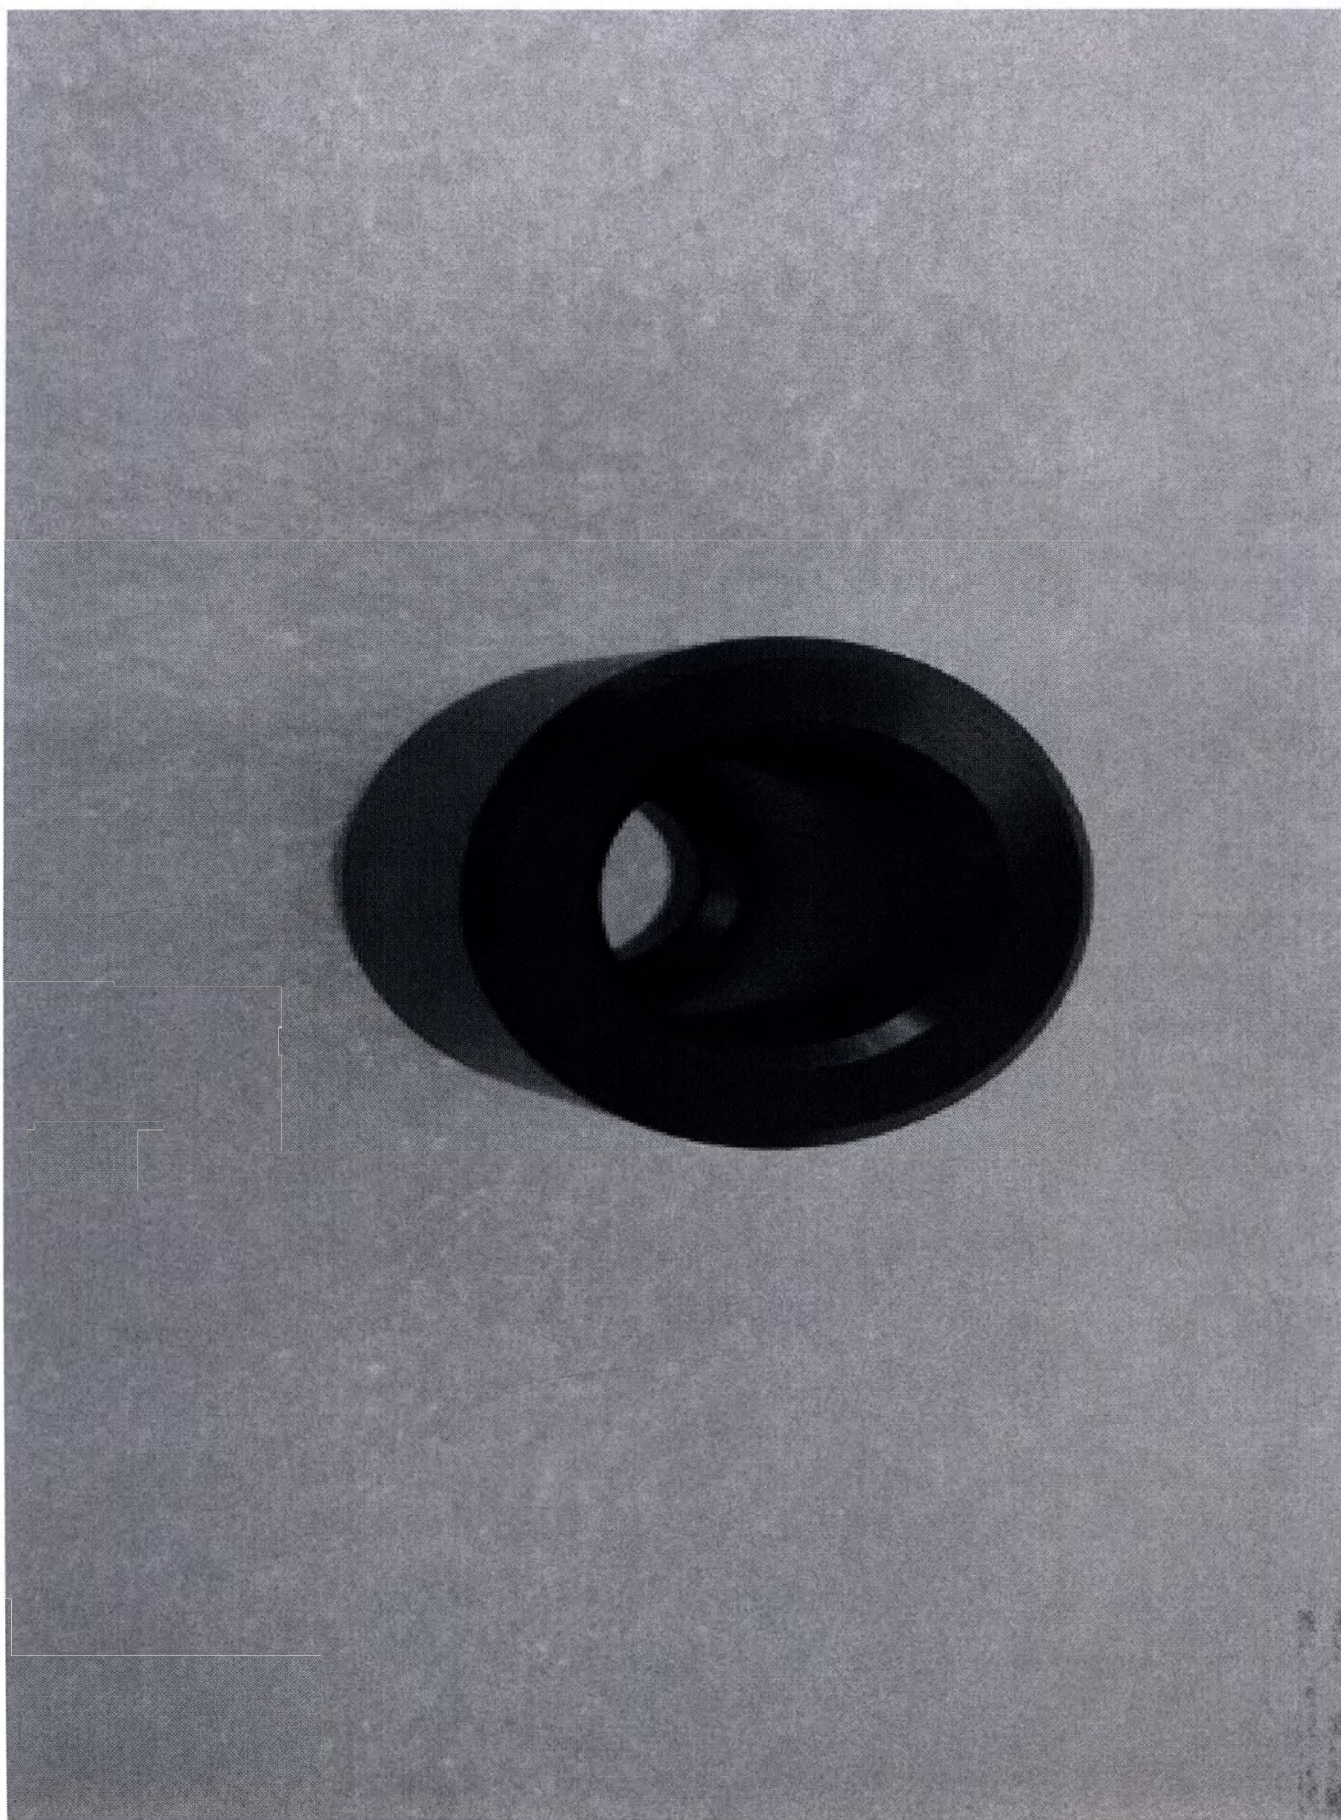

Адаптер для чашек 1.5мл x 1шт.

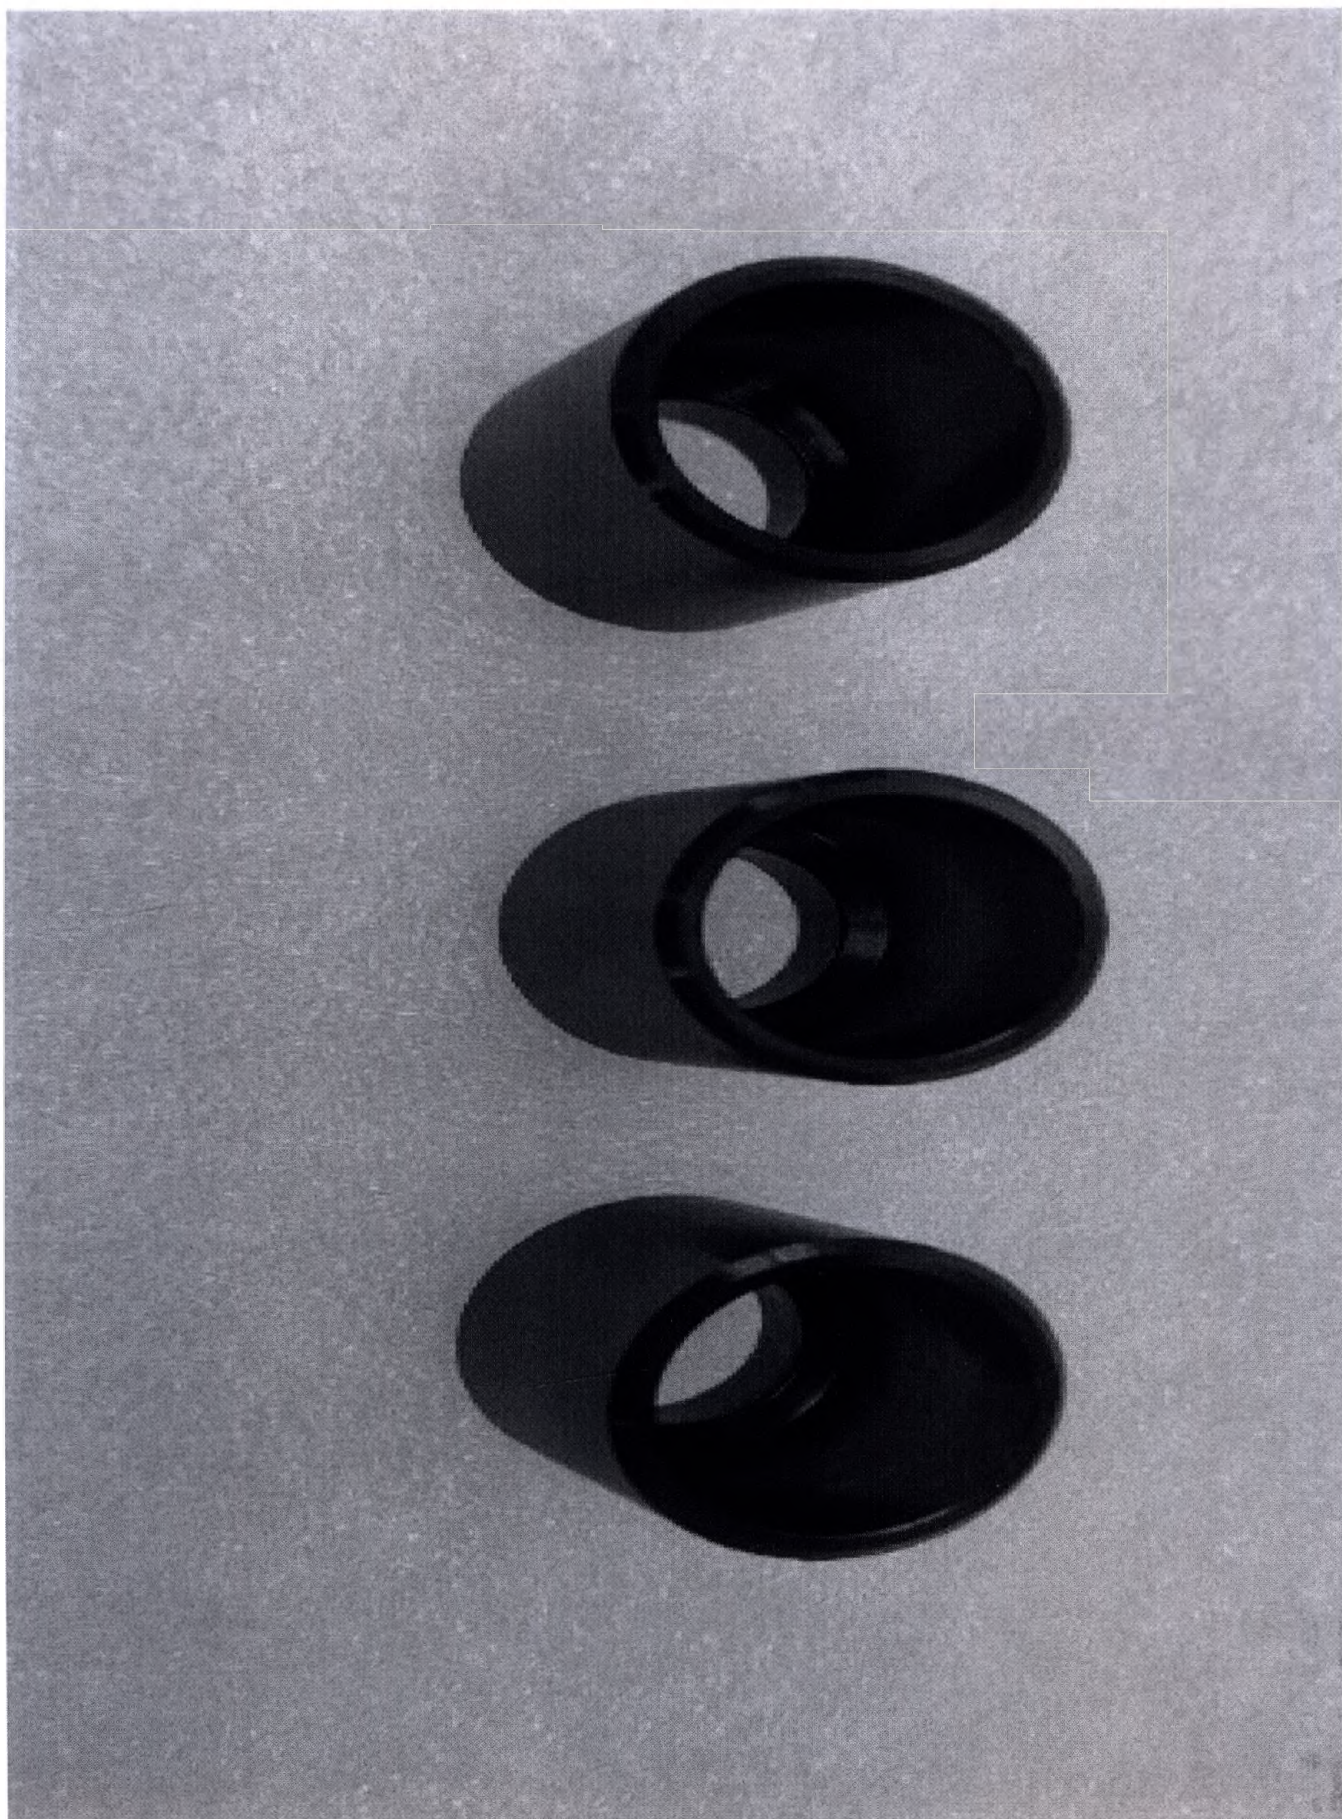


Адаптер для чашек (для реагентов) 3шт.

Предохранитель 5,0А x 2шт.



Компьютерное перо

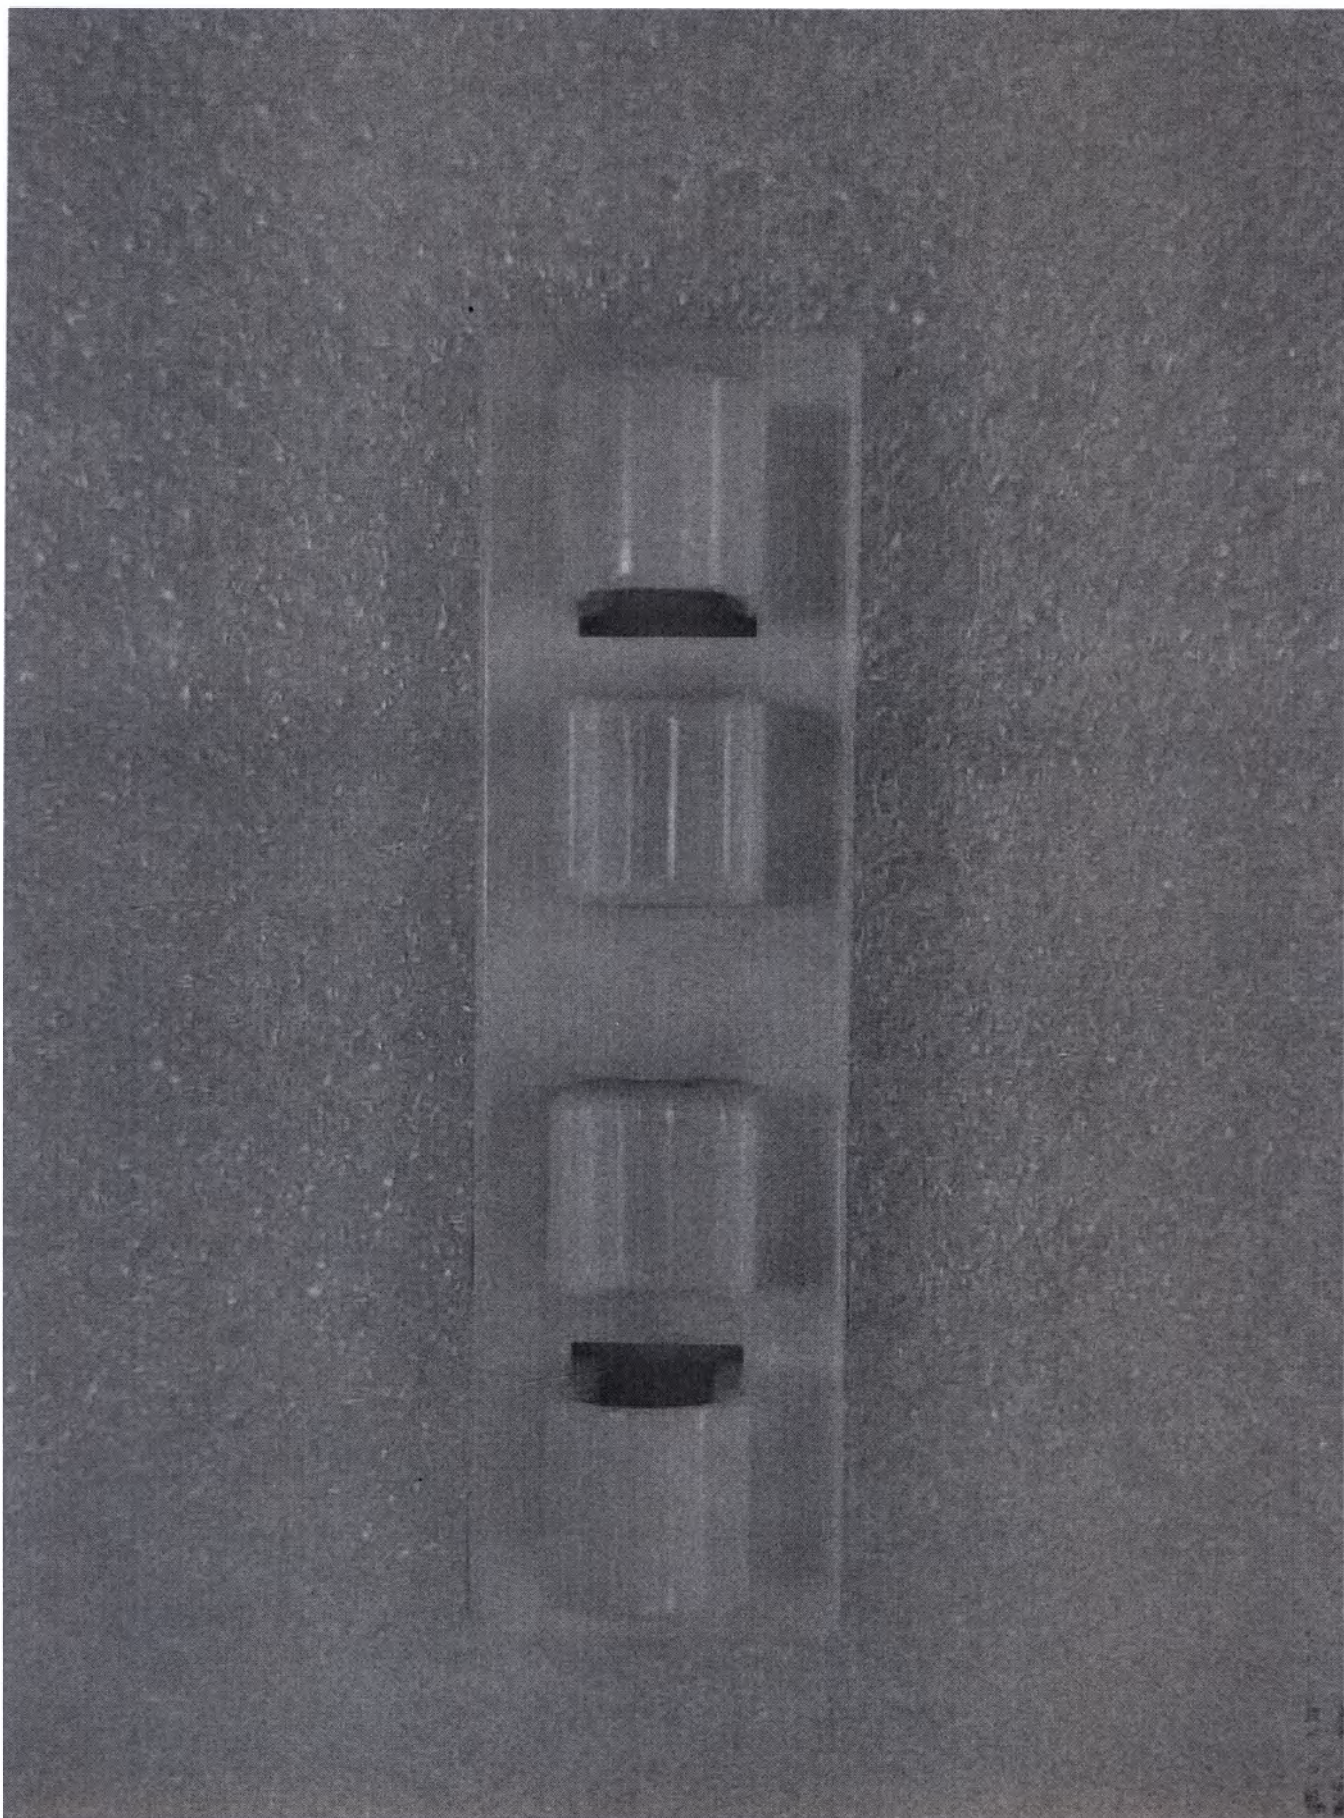

Держатель для компьютерного пера.




Ёмкость для реагентов 35мм x 2шт.



Ёмкость для реагентов 28мм x 2шт.



Ёмкость для реагентов 23мм x 2шт.



Магнитная мешалка 2шт.

CLEANER

Detergent for
automated coagulation analyzer

30mL×1

REF Q01411

LOT 20230222

 20240221



IVD



2°C  35°C

Composition:

Sodium hypochlorite 1.0%

Очищающий раствор 30мл. х 1шт.

Прошито и скреплено печатью
20 листов

Директор АО «МЕДСЕРВИС»

В.И. Луадж



ПОДТВЕРЖДАЮ
Директор
АО «МЕДСЕРВИС»
Луадж В.И.




«14» сентября 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Автоматический анализатор свертывания крови с
принадлежностями**

Вариант исполнения: MD-560i
производства «Мереди́т Диагностикс Лтд.», Соединенное Королевство
(Meredith Diagnostics, United Kingdom).

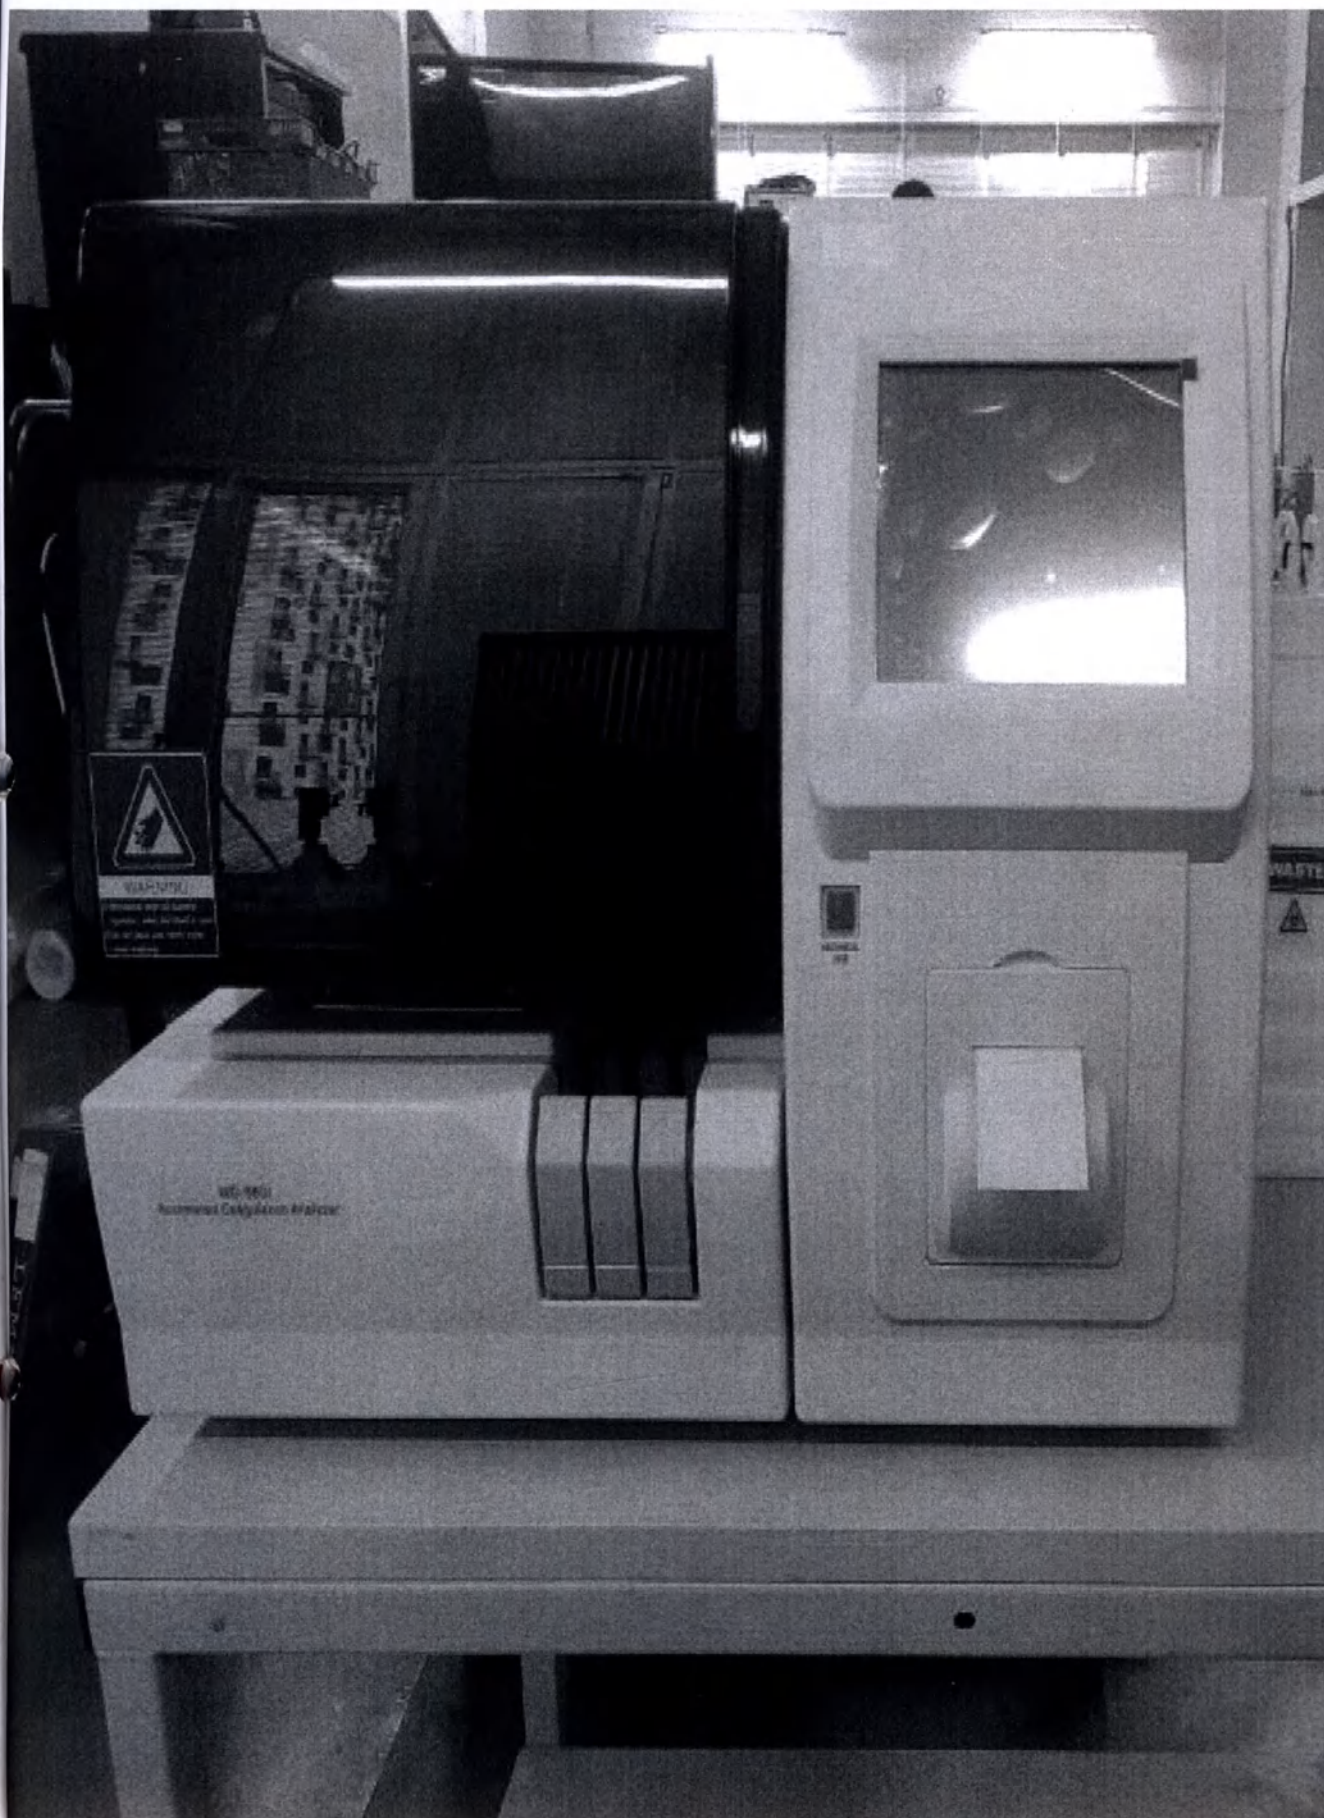


Автоматический анализатор свертывания крови MD-560i

Инструкция пользователя

Автоматический анализатор свертываемости крови MD-560i

Версия 2.0

Инструкция пользователя.

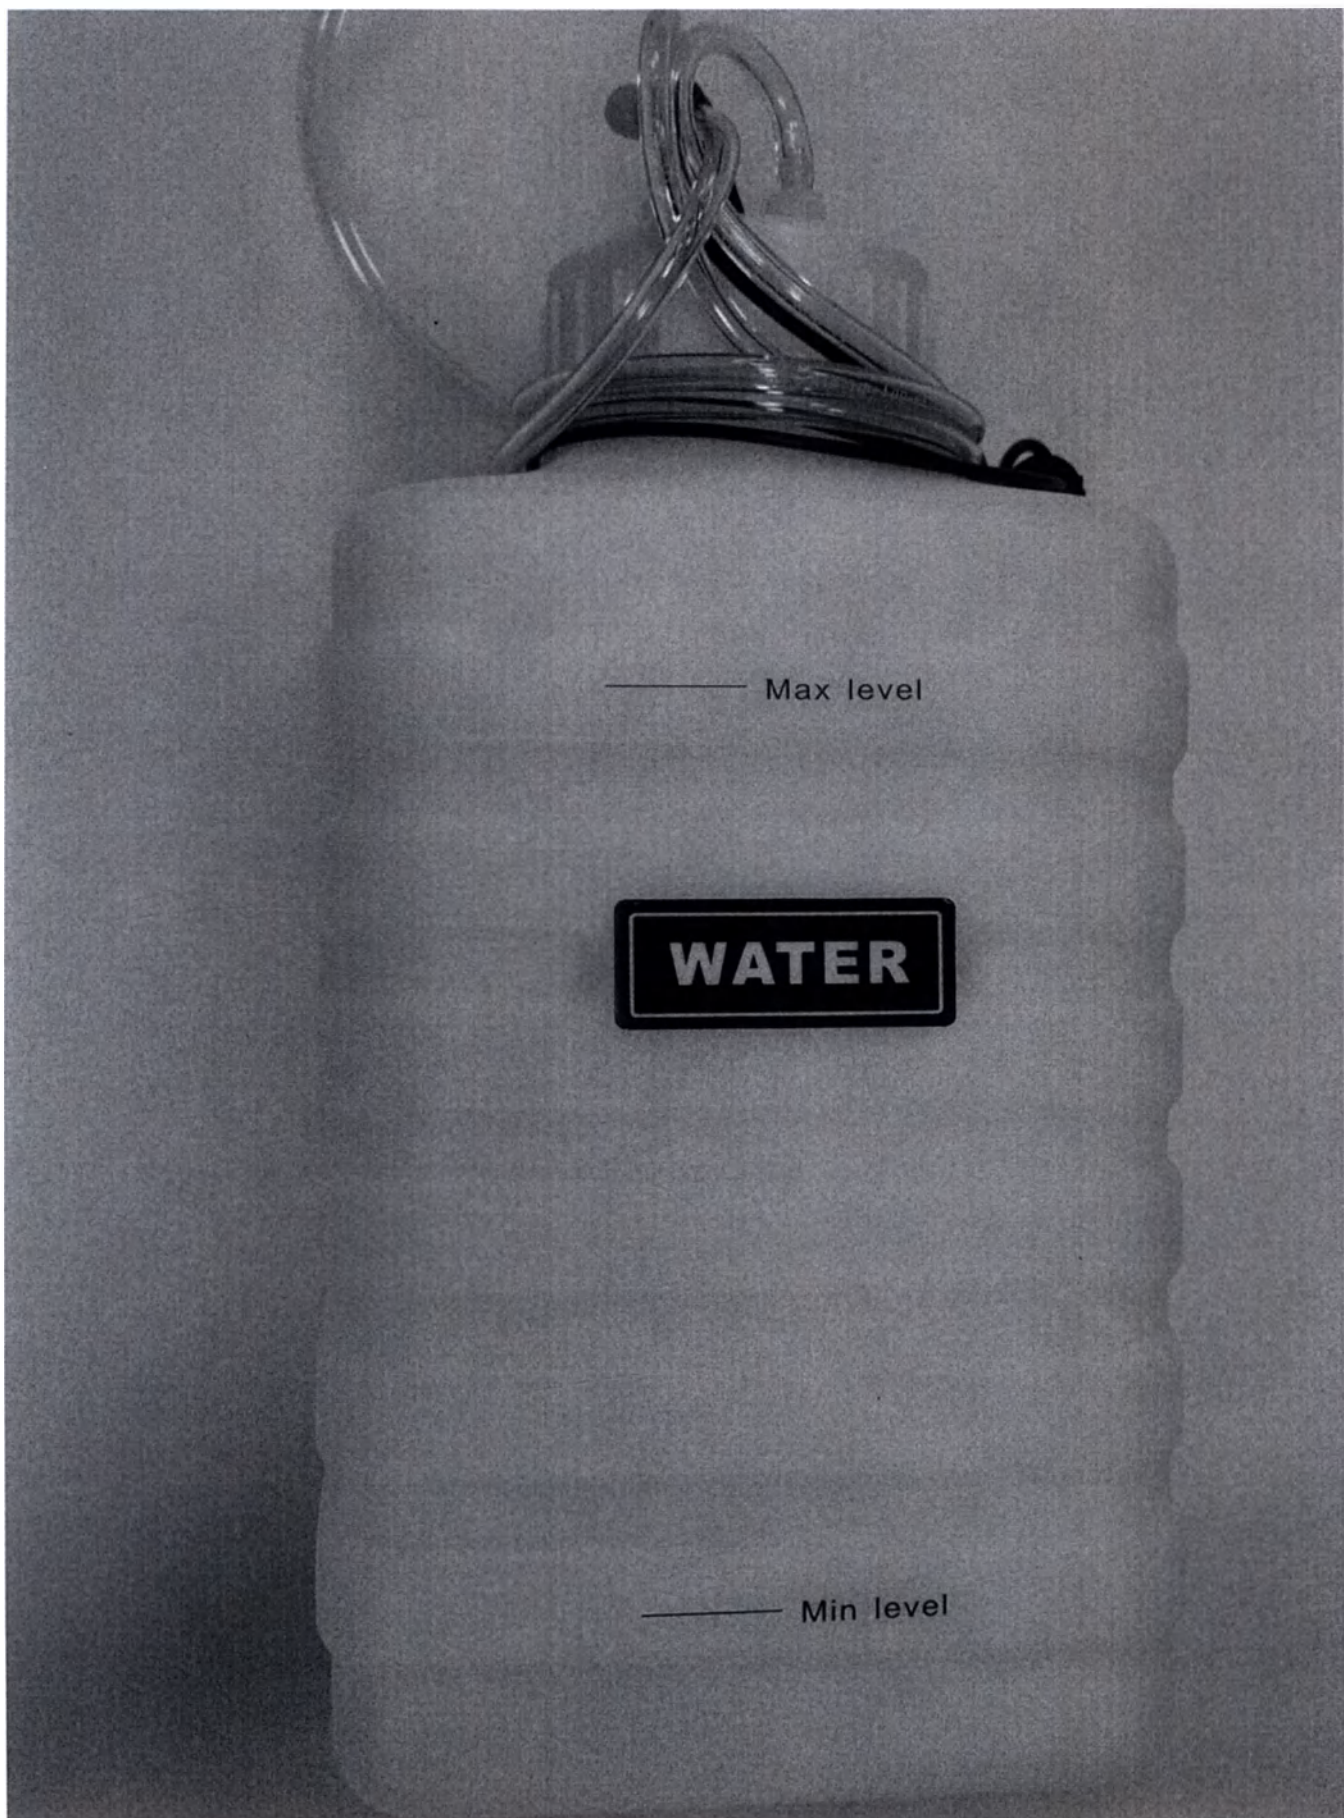

Ёмкость для промывающего раствора.




Ёмкость для отходов.

4. 1.5mL Sample Cup 100 PCS


Чашки для образцов 1.5 мл x 100шт.

5、 Cuvette

500 PCS



Кюветы измерительные 500 шт.

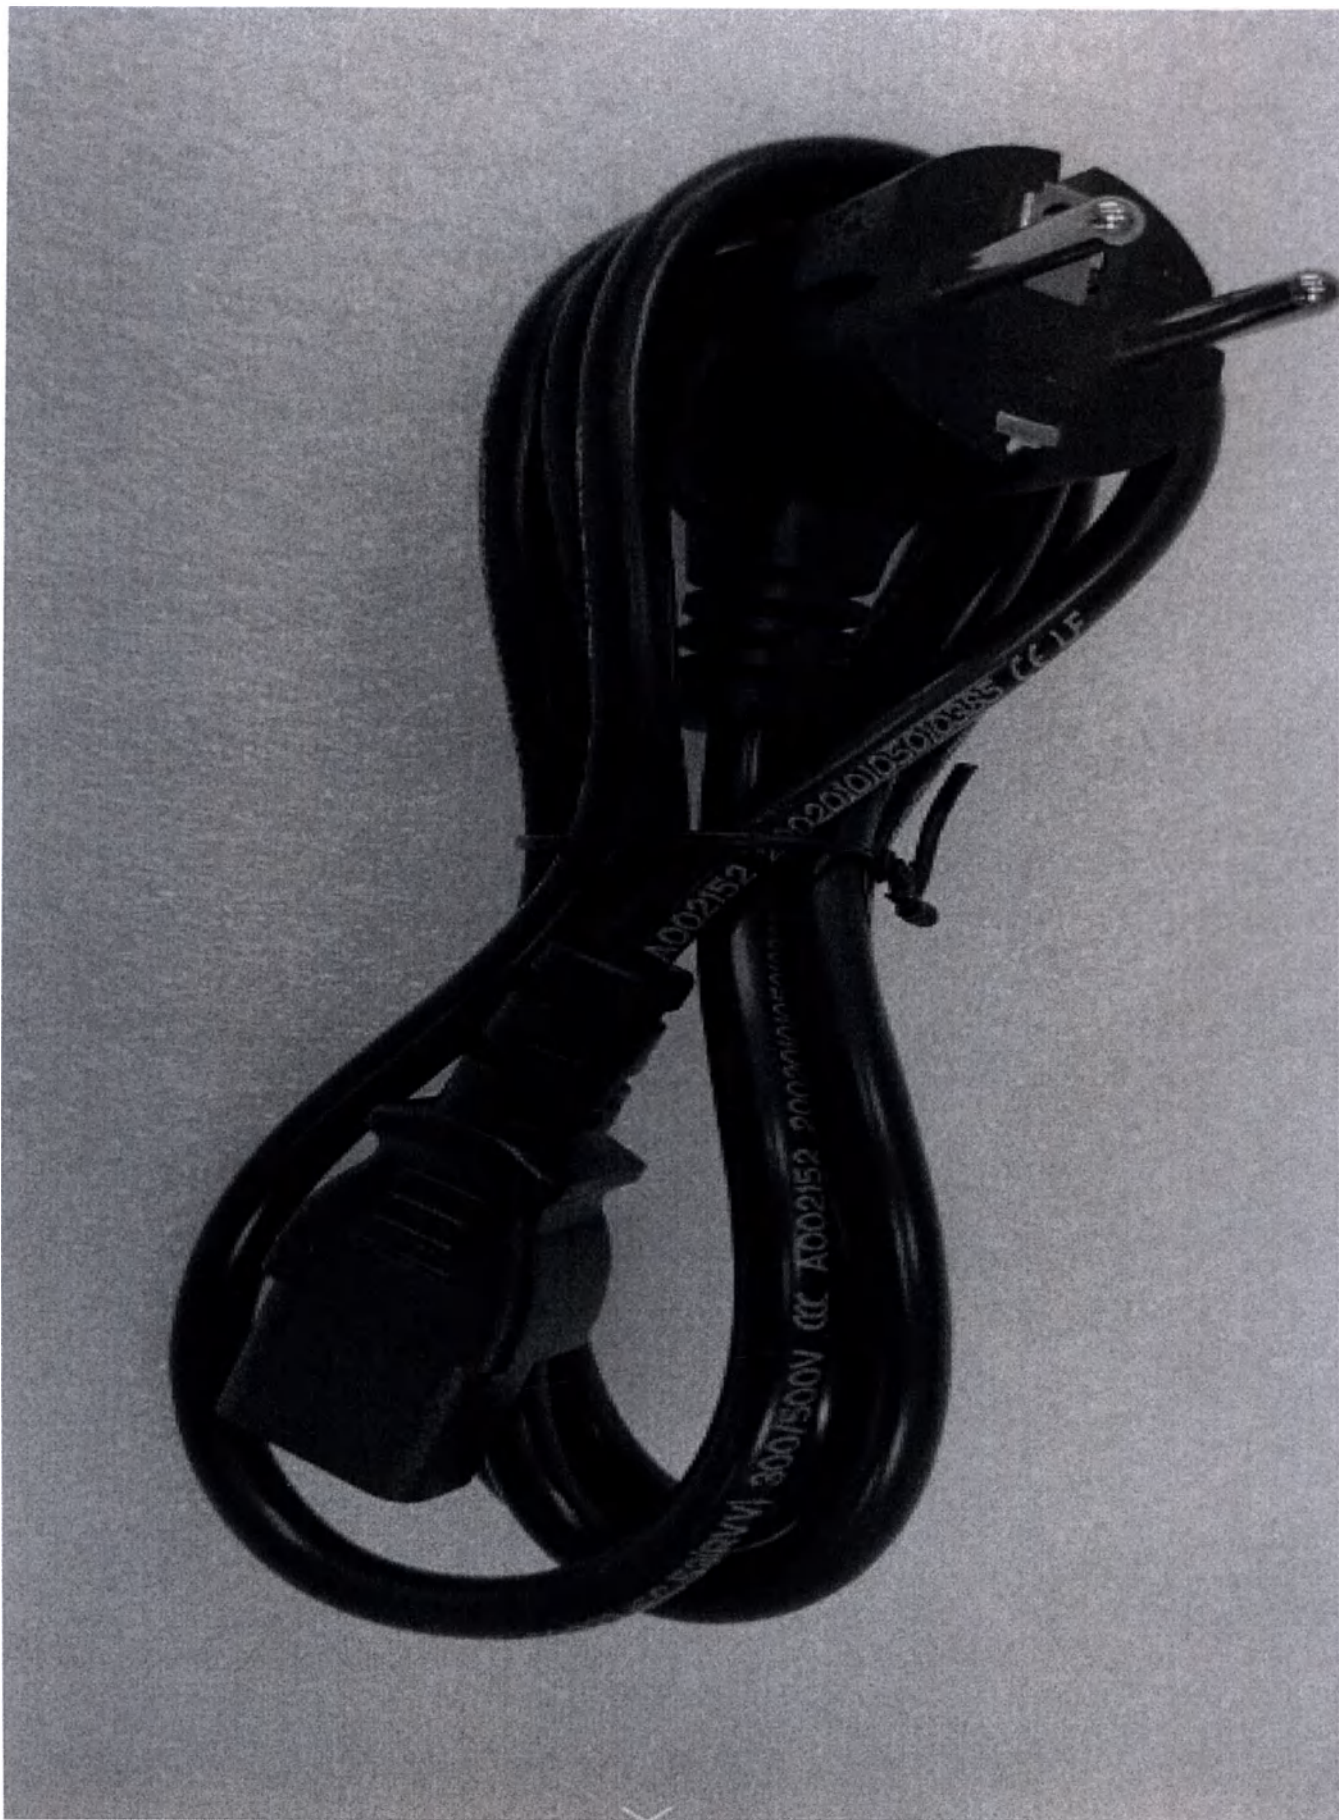


Сетевой кабель.




Заземляющий провод.




Бумага для принтера.

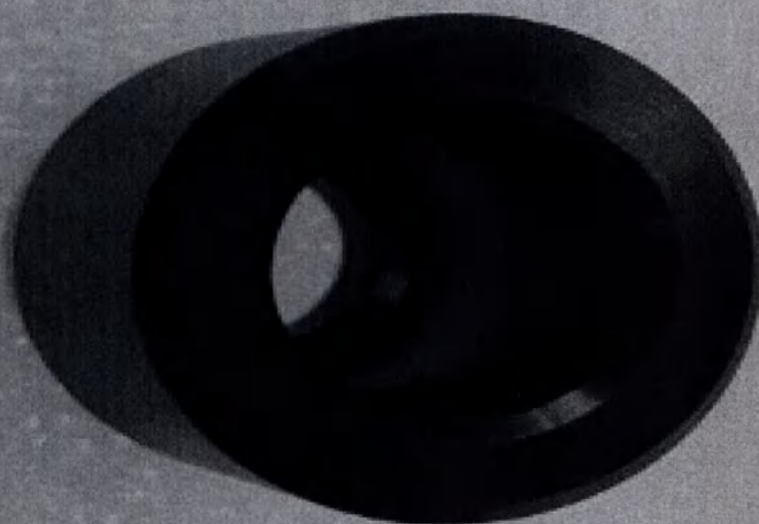


Адаптер для чашек 1.5мл x 1шт.

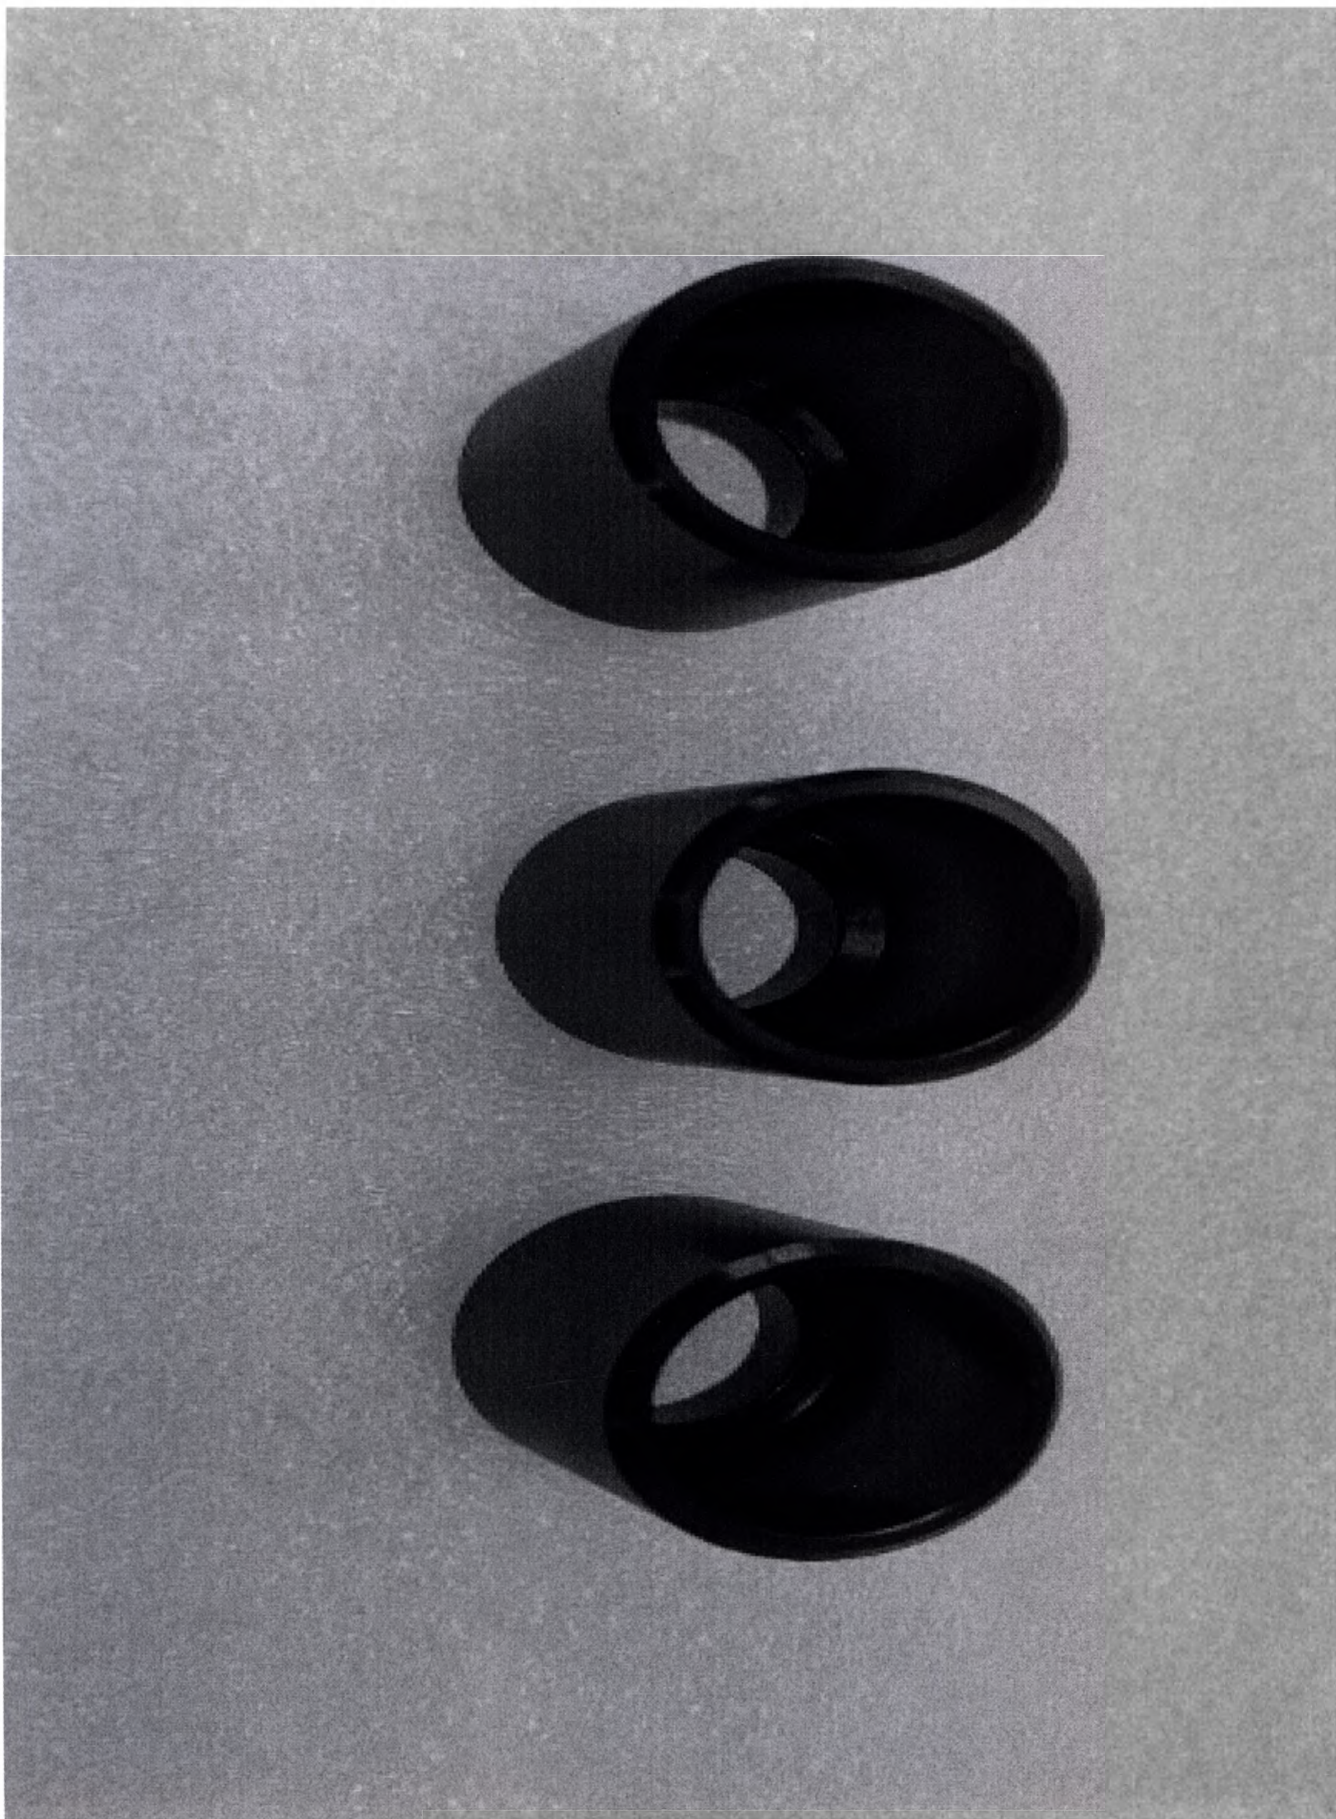


Адаптер для чашек (для реагентов) 3 шт.

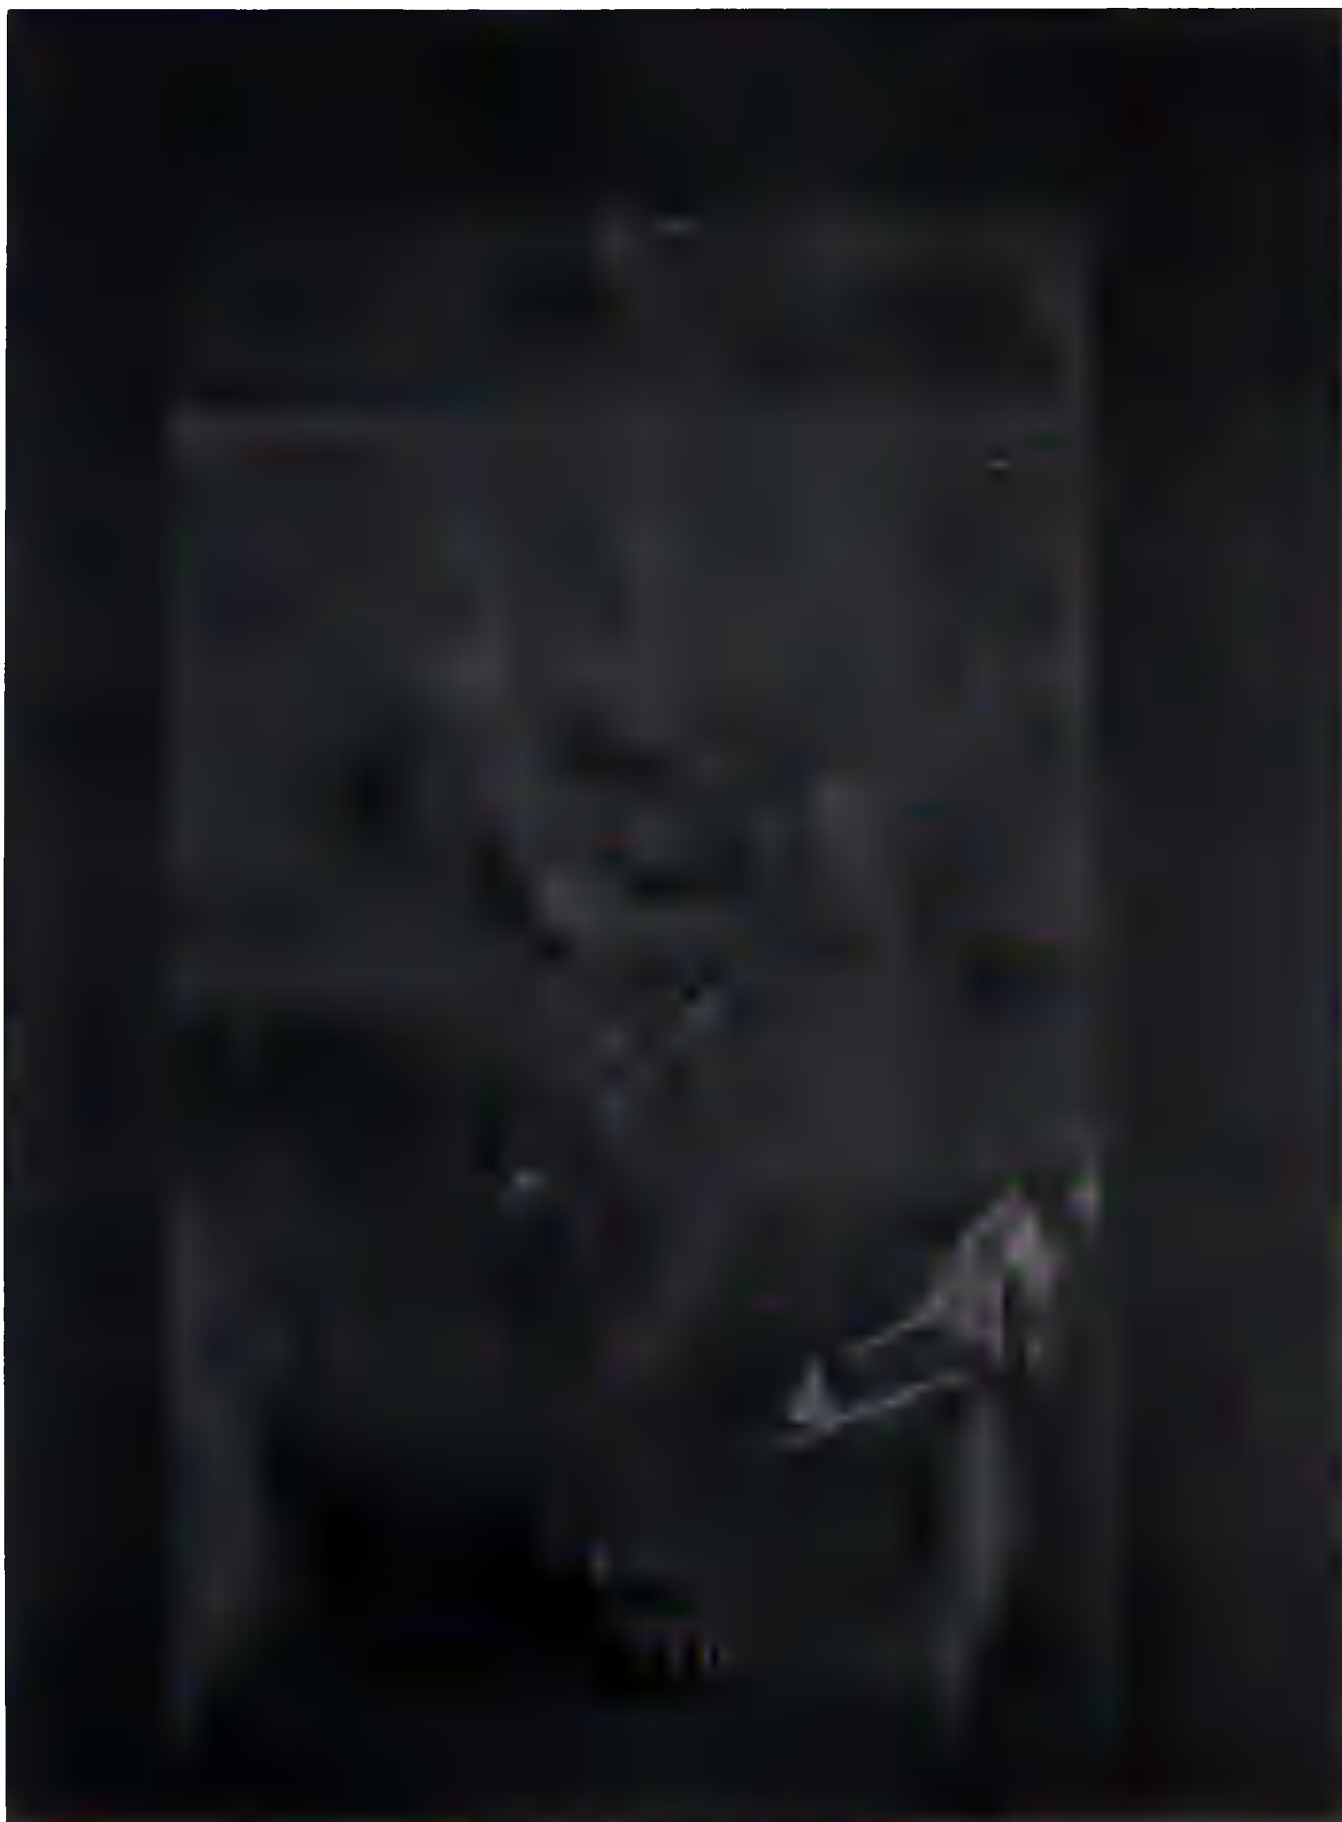

Предохранитель 5,0А x 2шт.

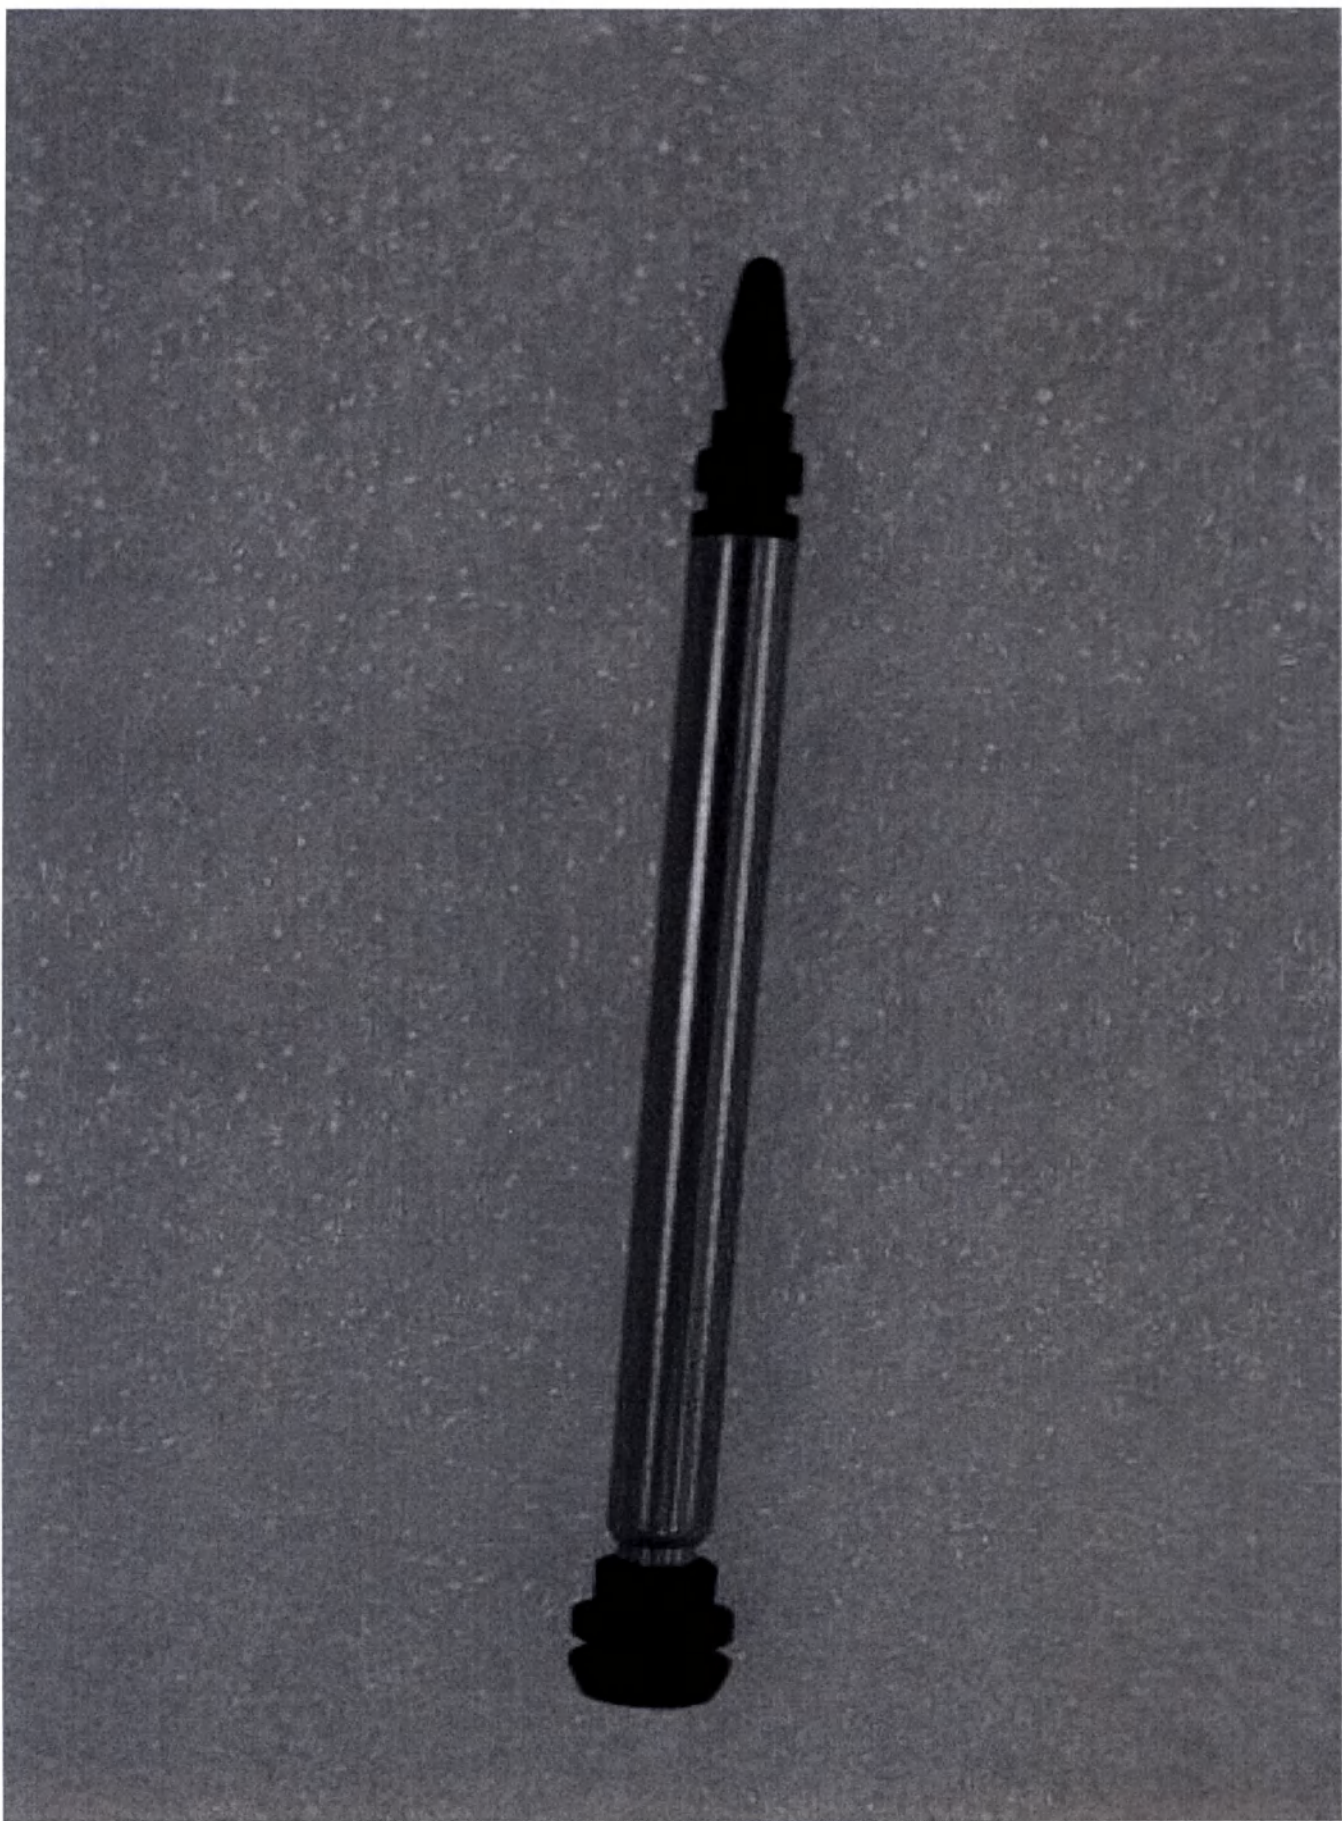

Компьютерное перо

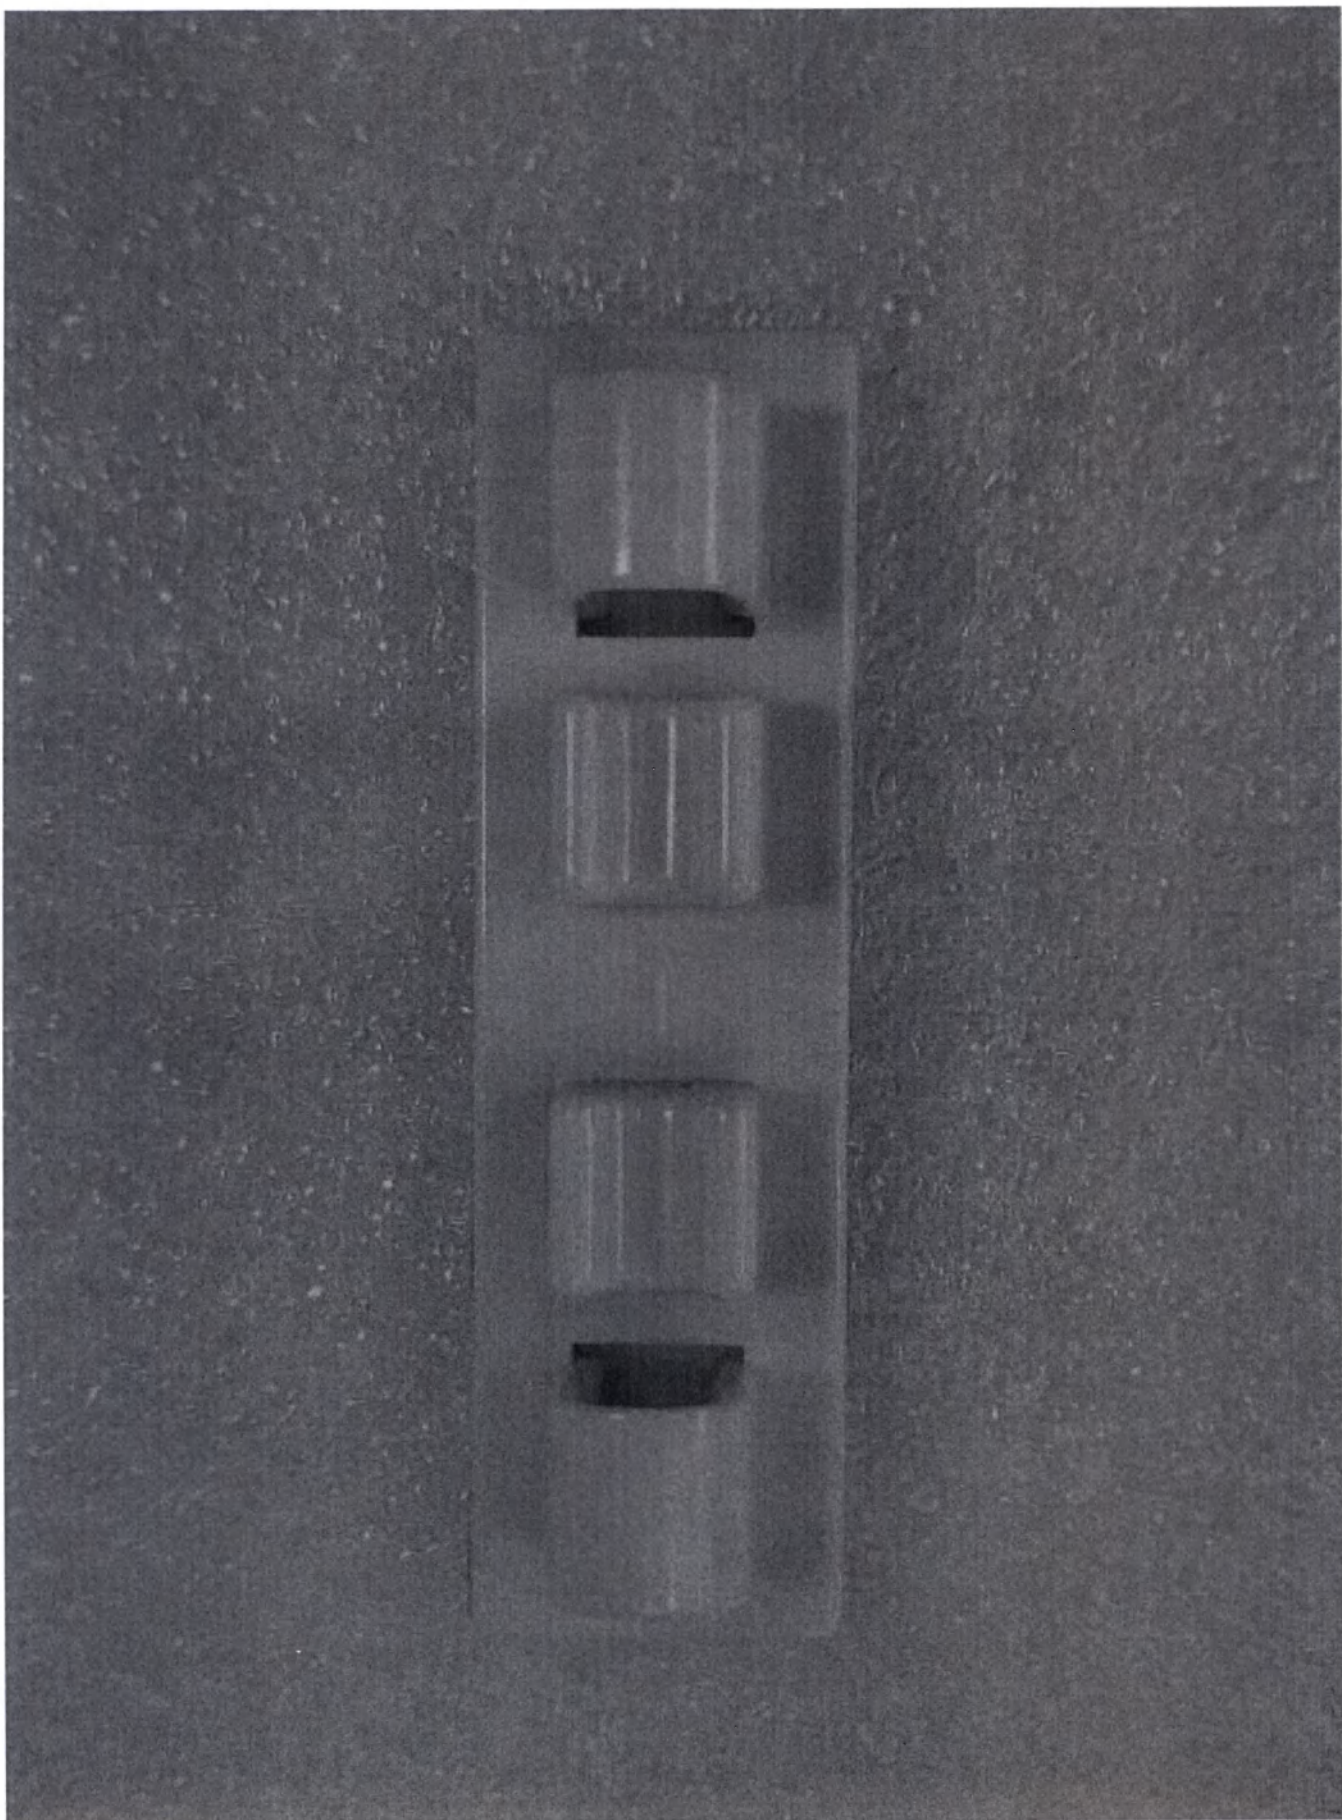

Держатель для компьютерного пера.




Ёмкость для реагентов 35мм x 2шт.



Ёмкость для реагентов 28мм x 2шт.



Ёмкость для реагентов 23мм x 2шт.



Магнитная мешалка 2шт.

CLEANER

Detergent for
automated coagulation analyzer

30mL×1

REF

Q01411

LOT

20230222



20240221



IVD



2°C ~~35°C~~

Composition:

Sodium hypochlorite 1.0%

Очищающий раствор 30мл. х 1шт.

Прошито и скреплено печатью

20 листов

Директор АО «МЕДСЕРВИС»

В.И. Луадж

