

Руководитель отдела нормативного регулирования

ООО "ФИЛИПС"

А.А.Град


«20» сентября 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы IntraSight Mobile с принадлежностями»

Система для внутрисосудистой ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы traSight Mobile с принадлежностями, общий вид.

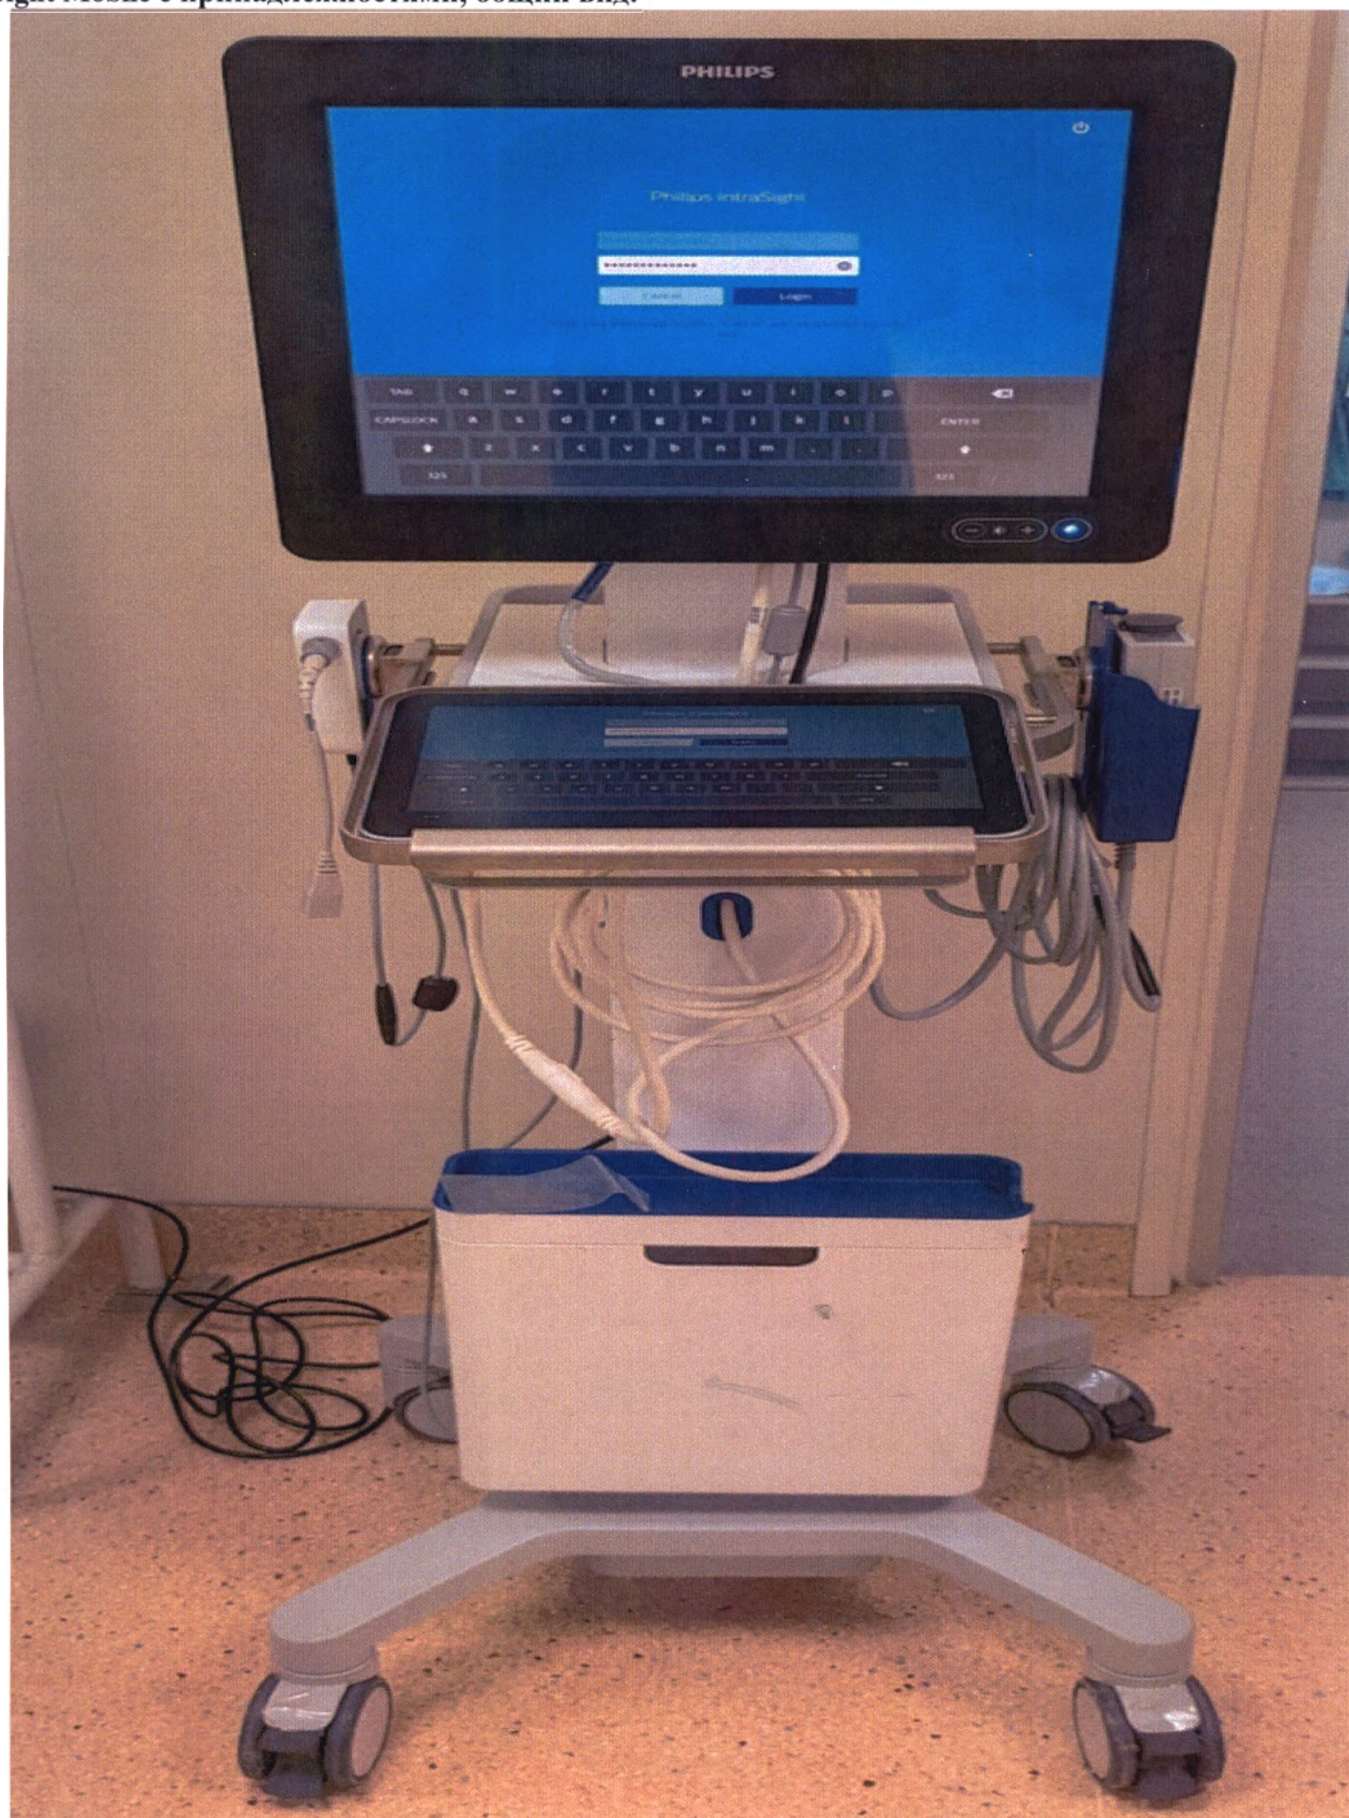


Панель основная с предустановленным программным обеспечением, в составе:
1.1 Монитор медицинского класса с сенсорным экраном

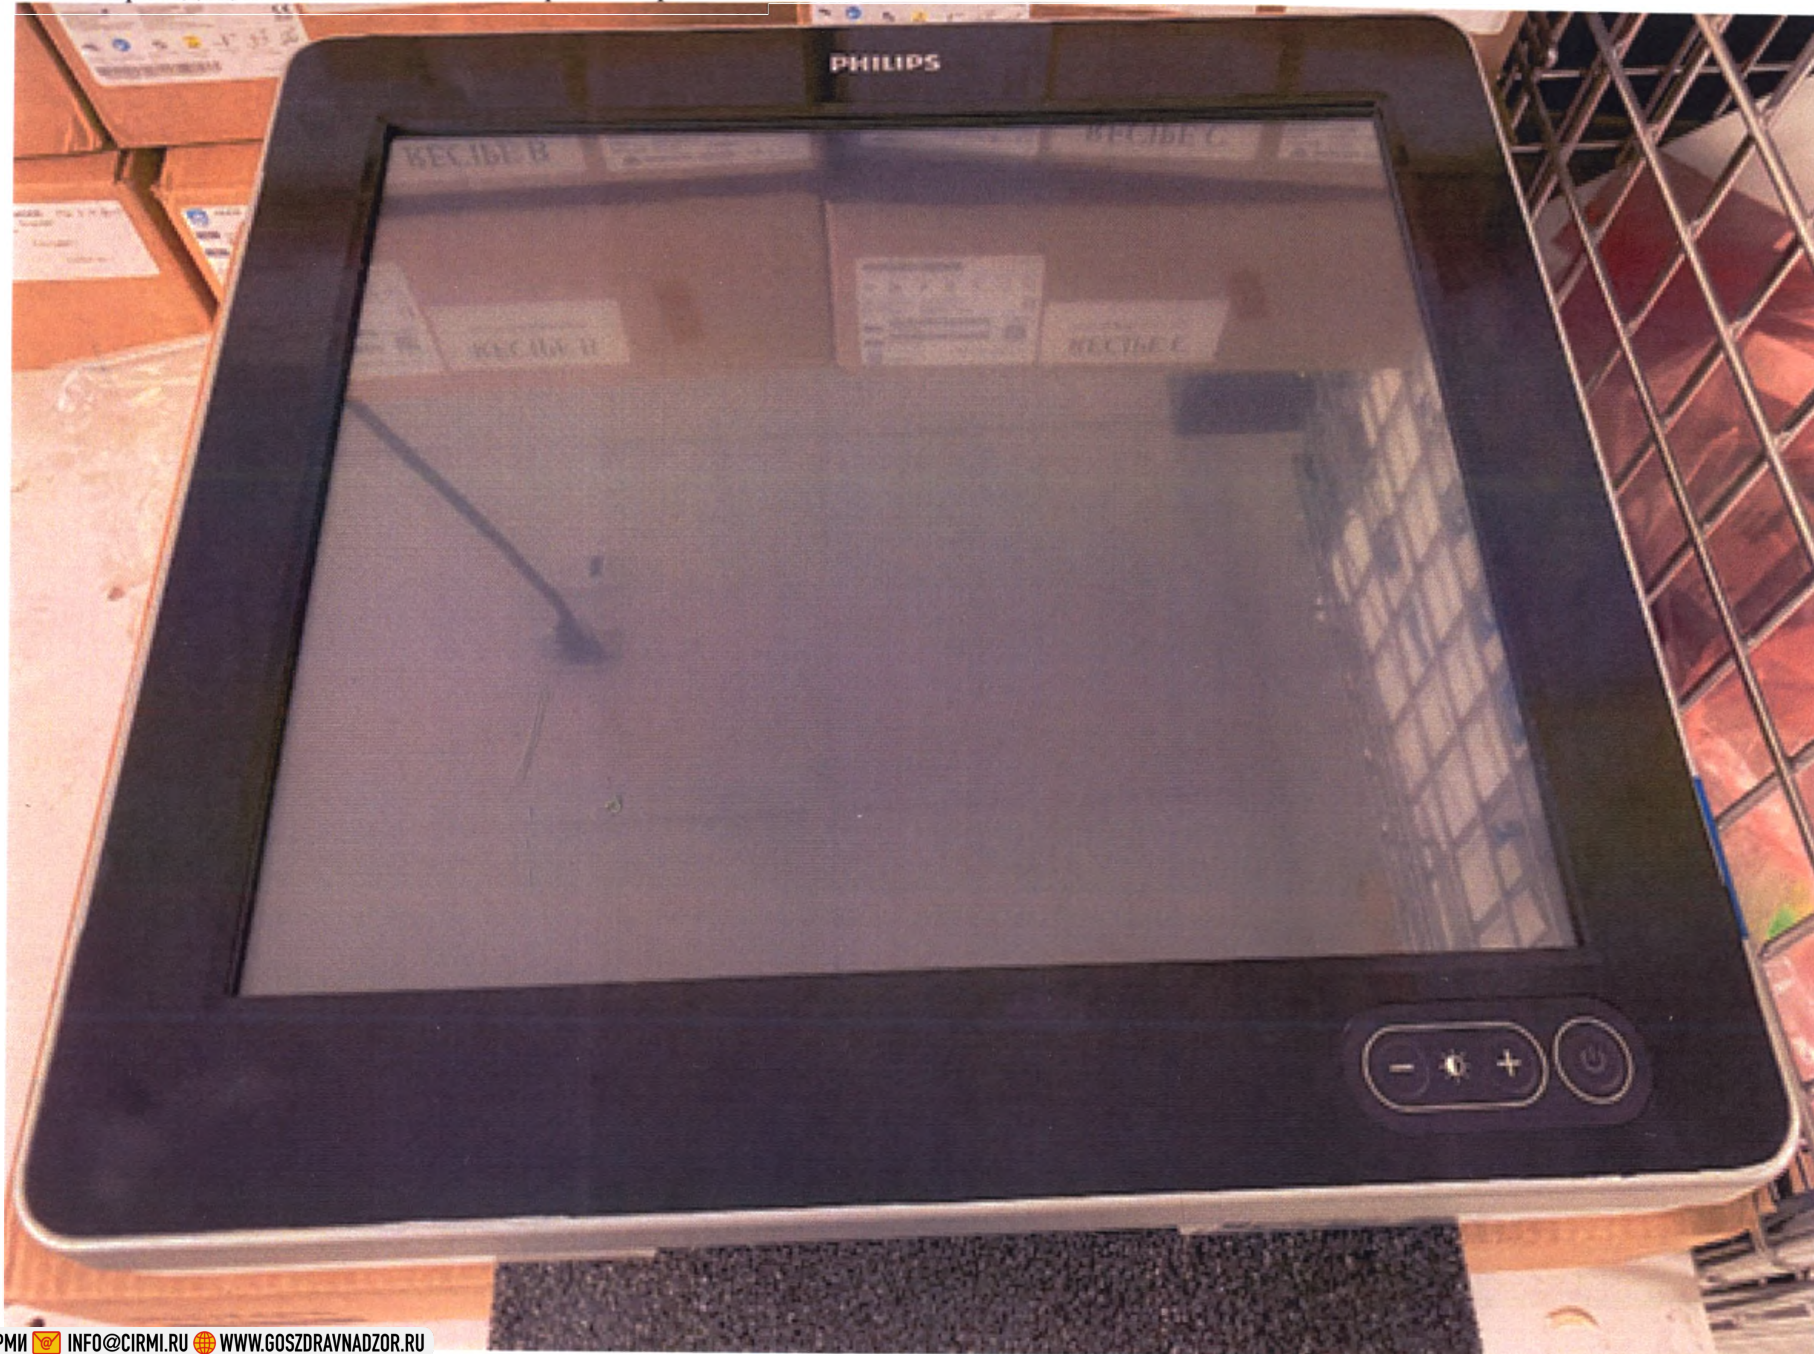








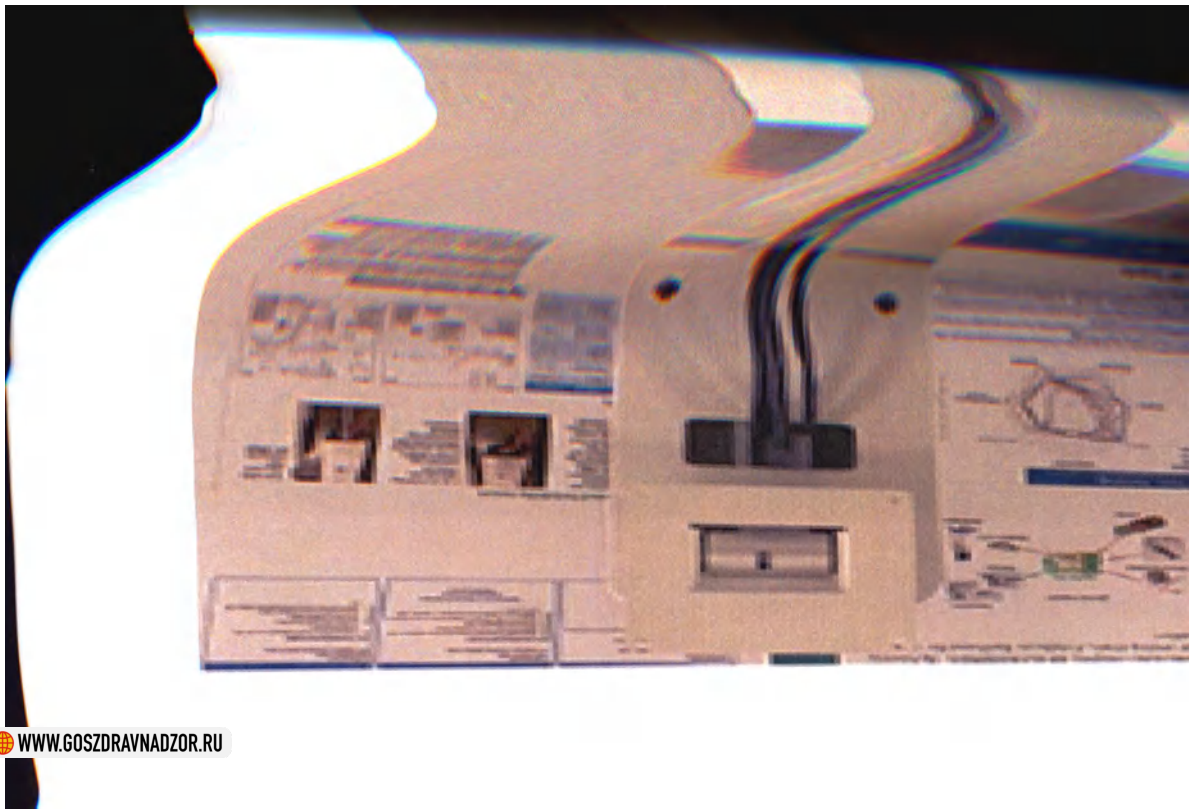

Тележка для системы




3.1 Модуль интерфейса пациента (SA PIM)

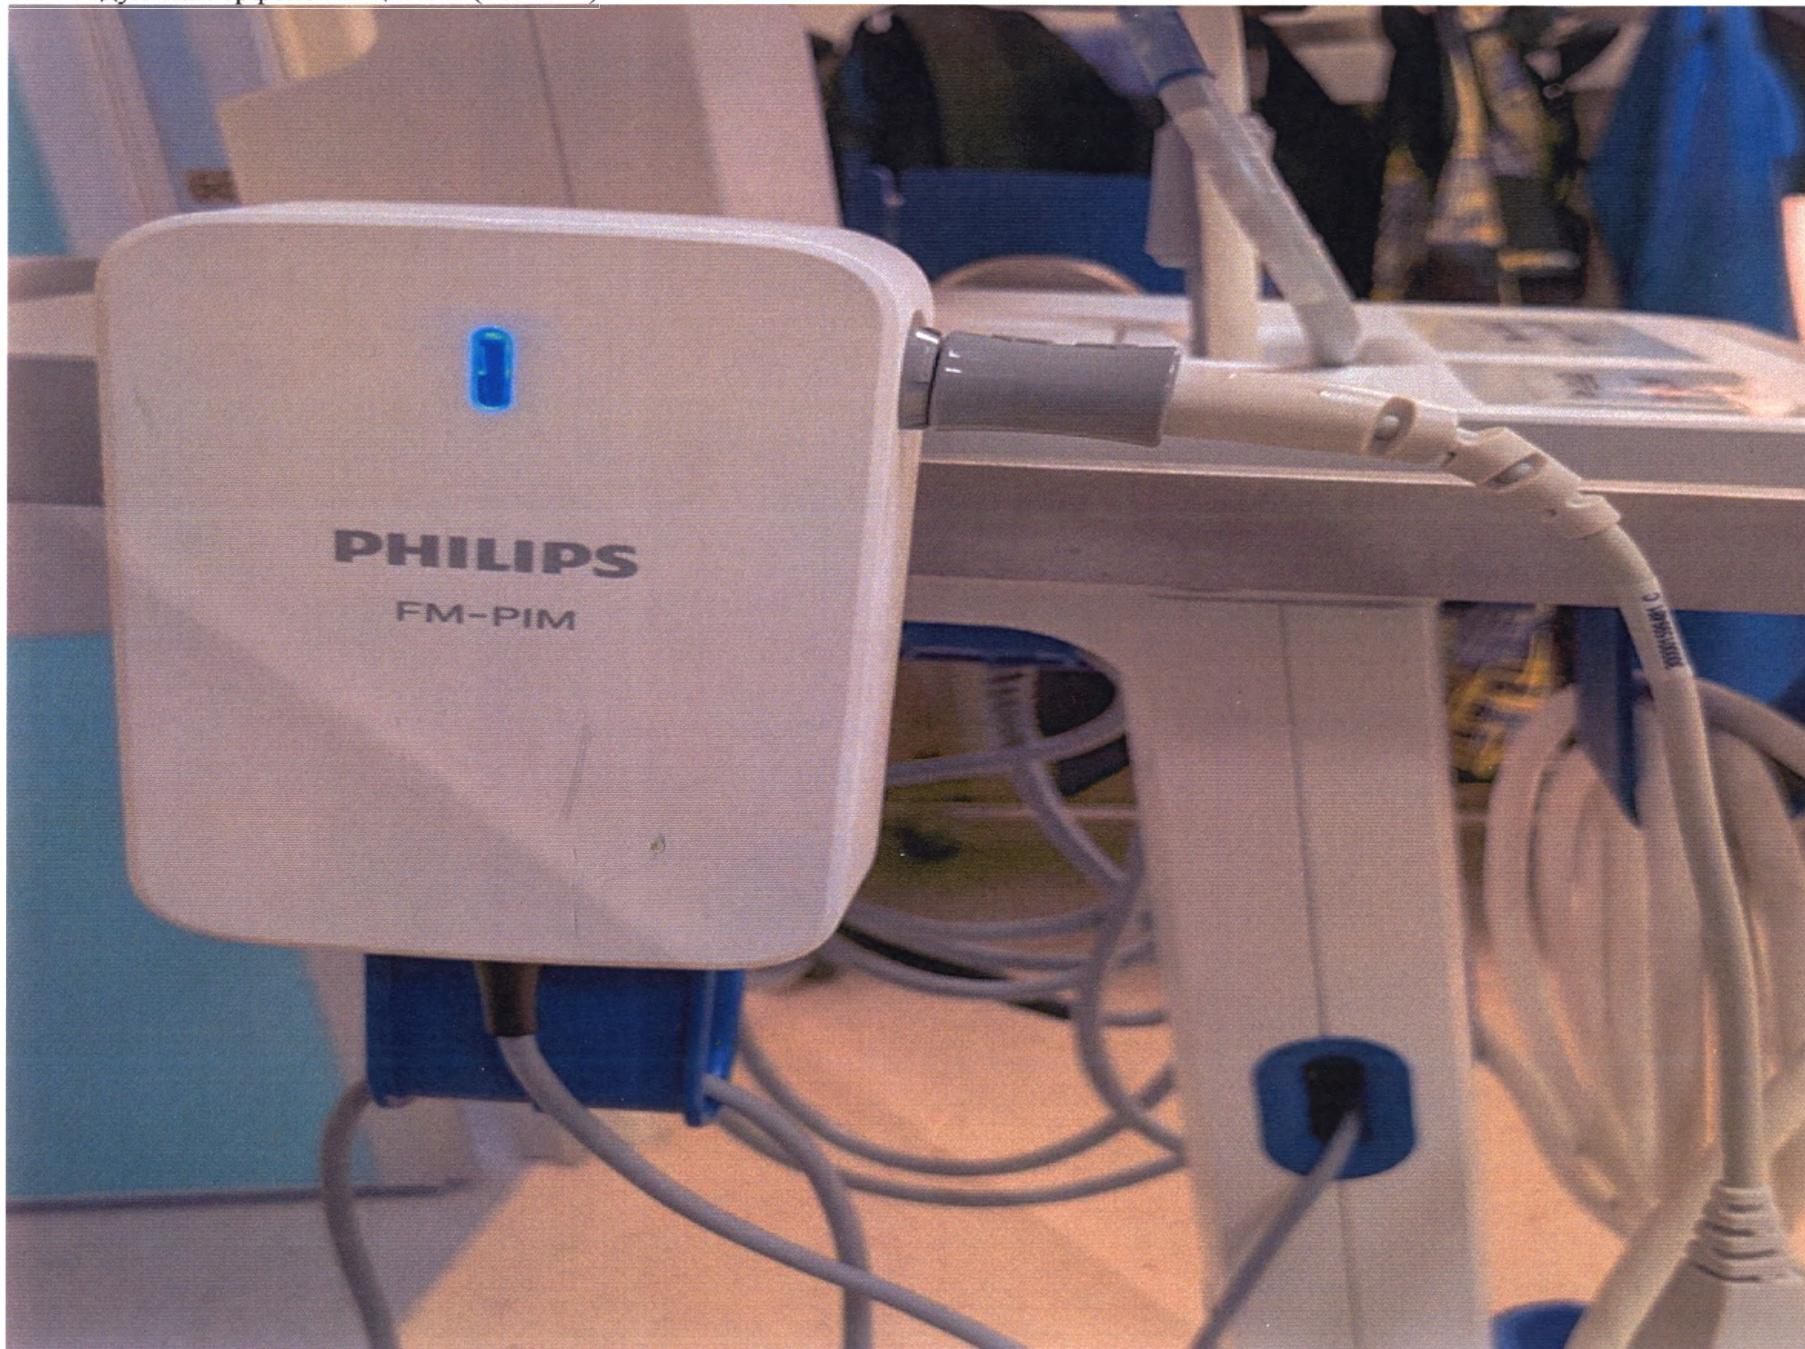





4.1 Модуль интерфейса пациента (FM PIM)

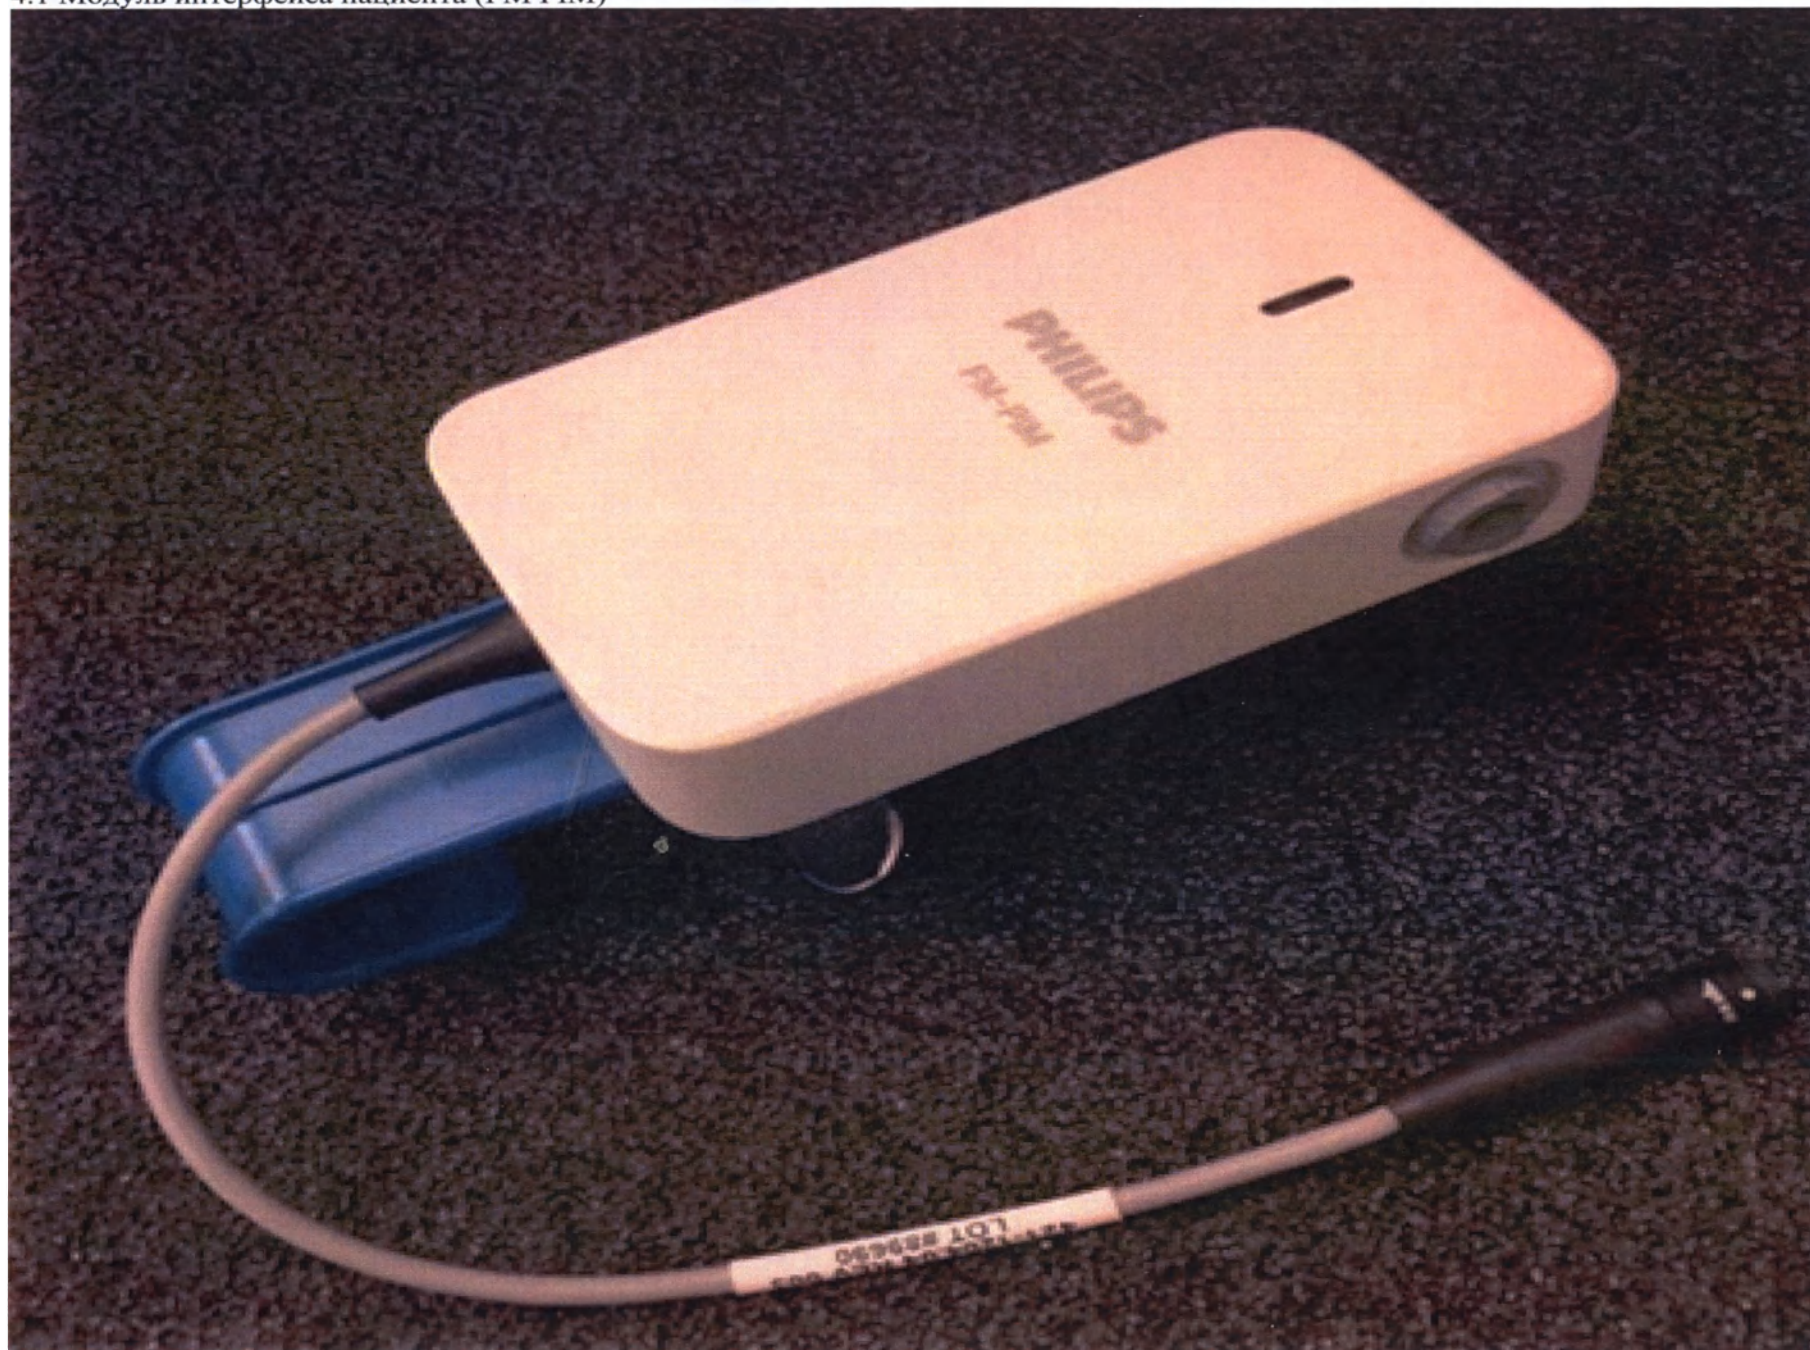



Держатель модуля интерфейса пациента (FM PIM)













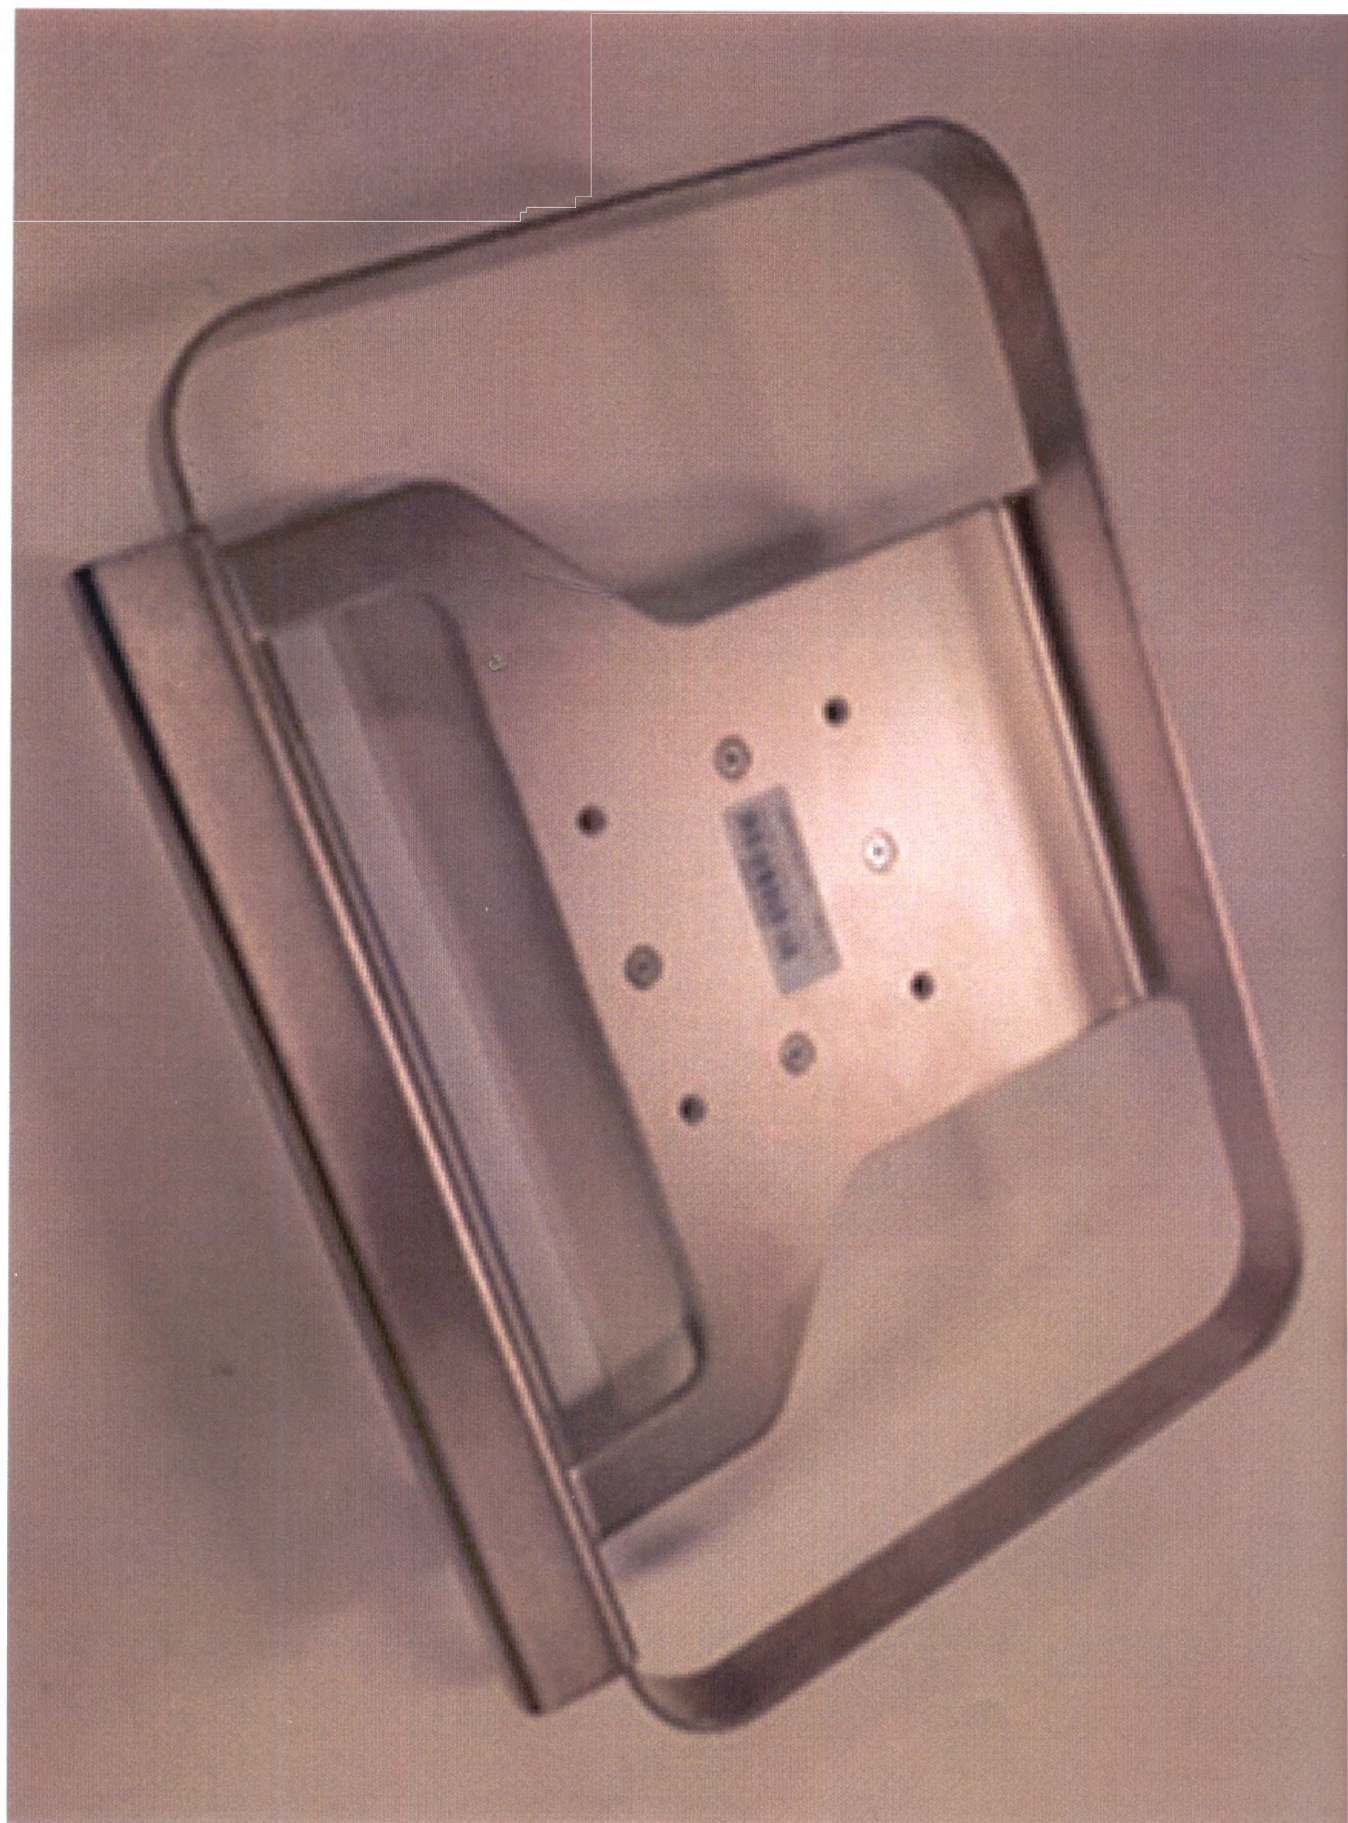

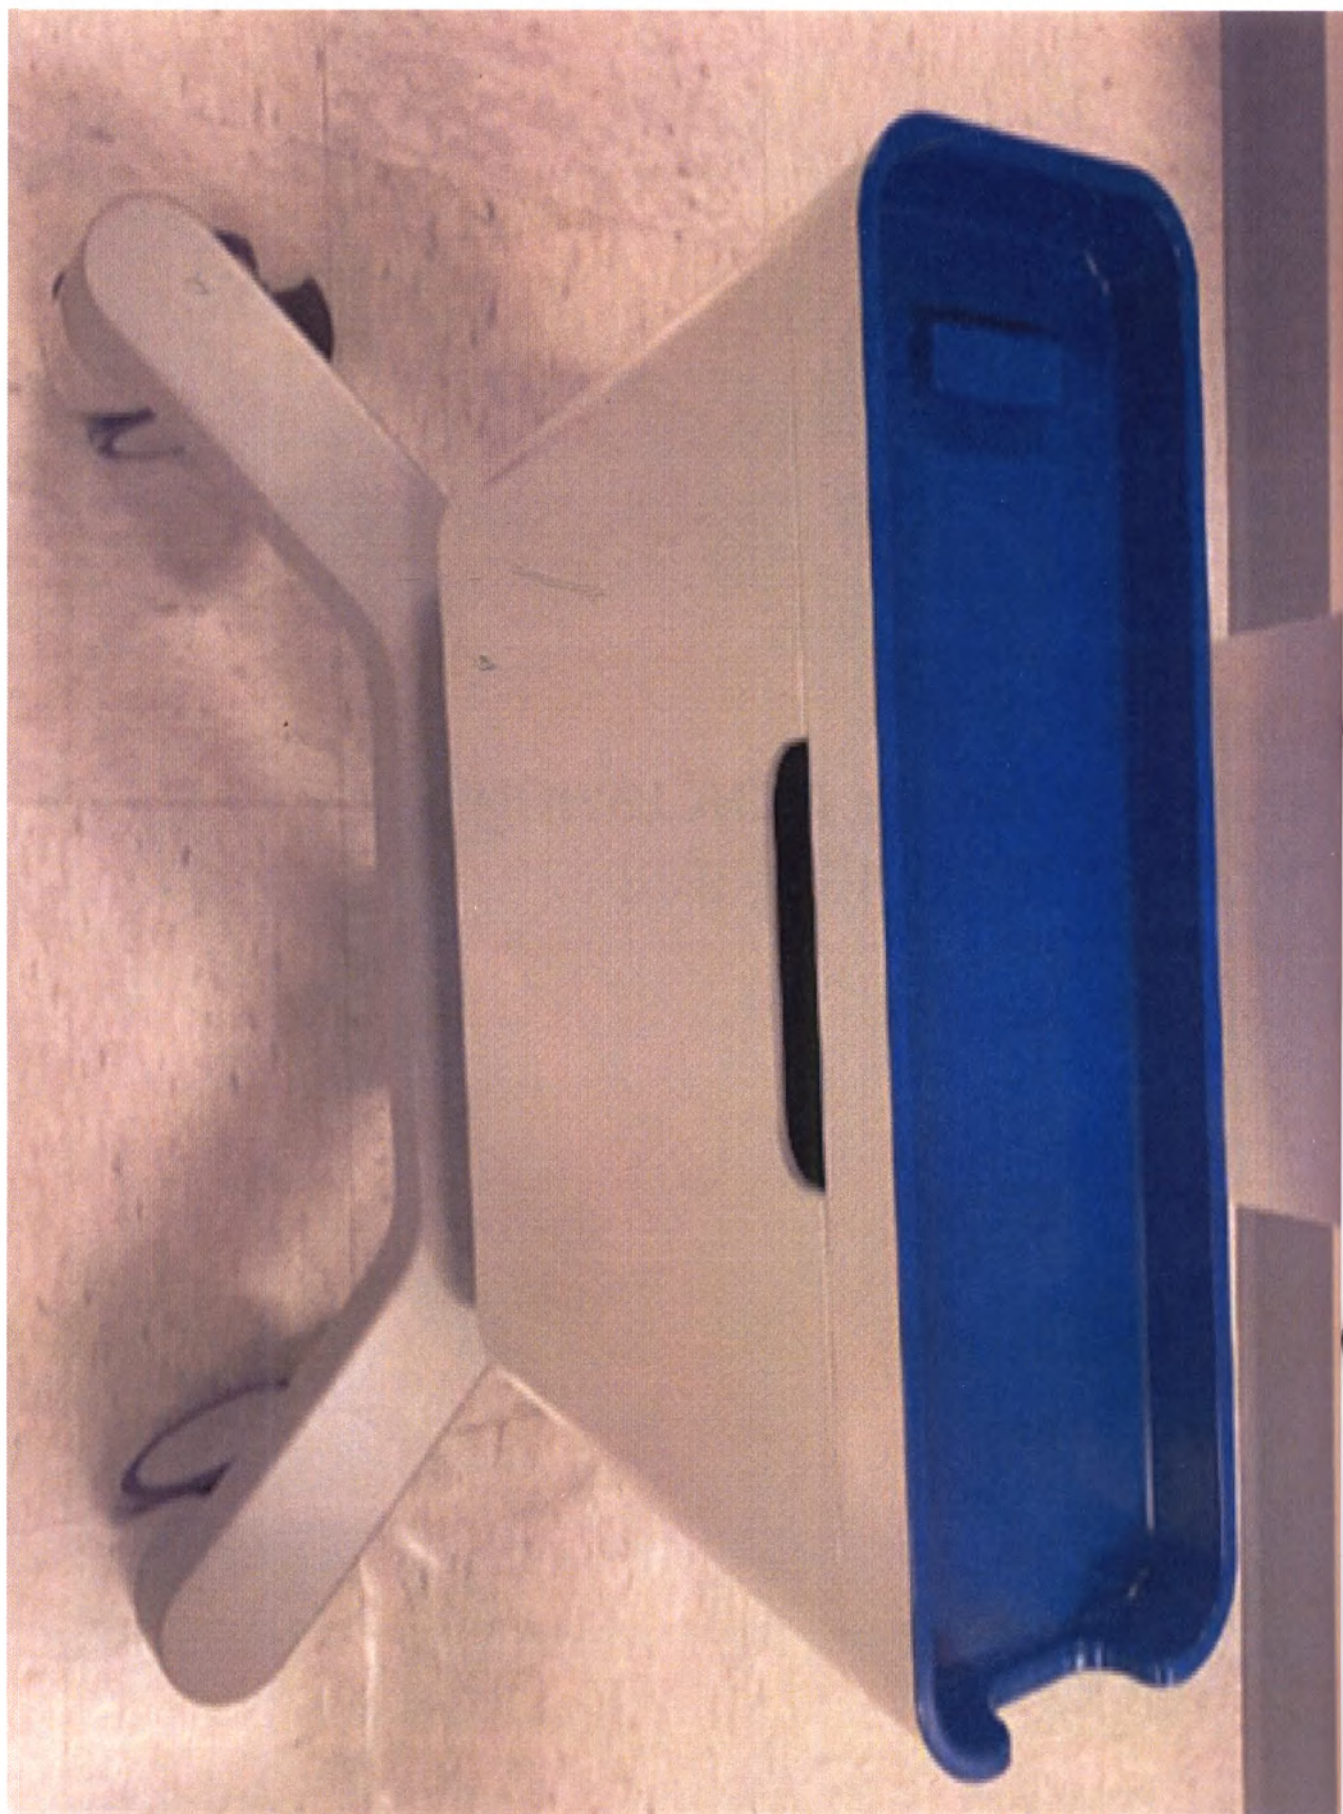



Руководство
оператора

Русский


IntraSight

Система IntraSight для использования с системой Philips Mobile

Система IntraSight Mobile 1.0 с ПО версии 5.2

PHILIPS

1. Принтер специальный цветной

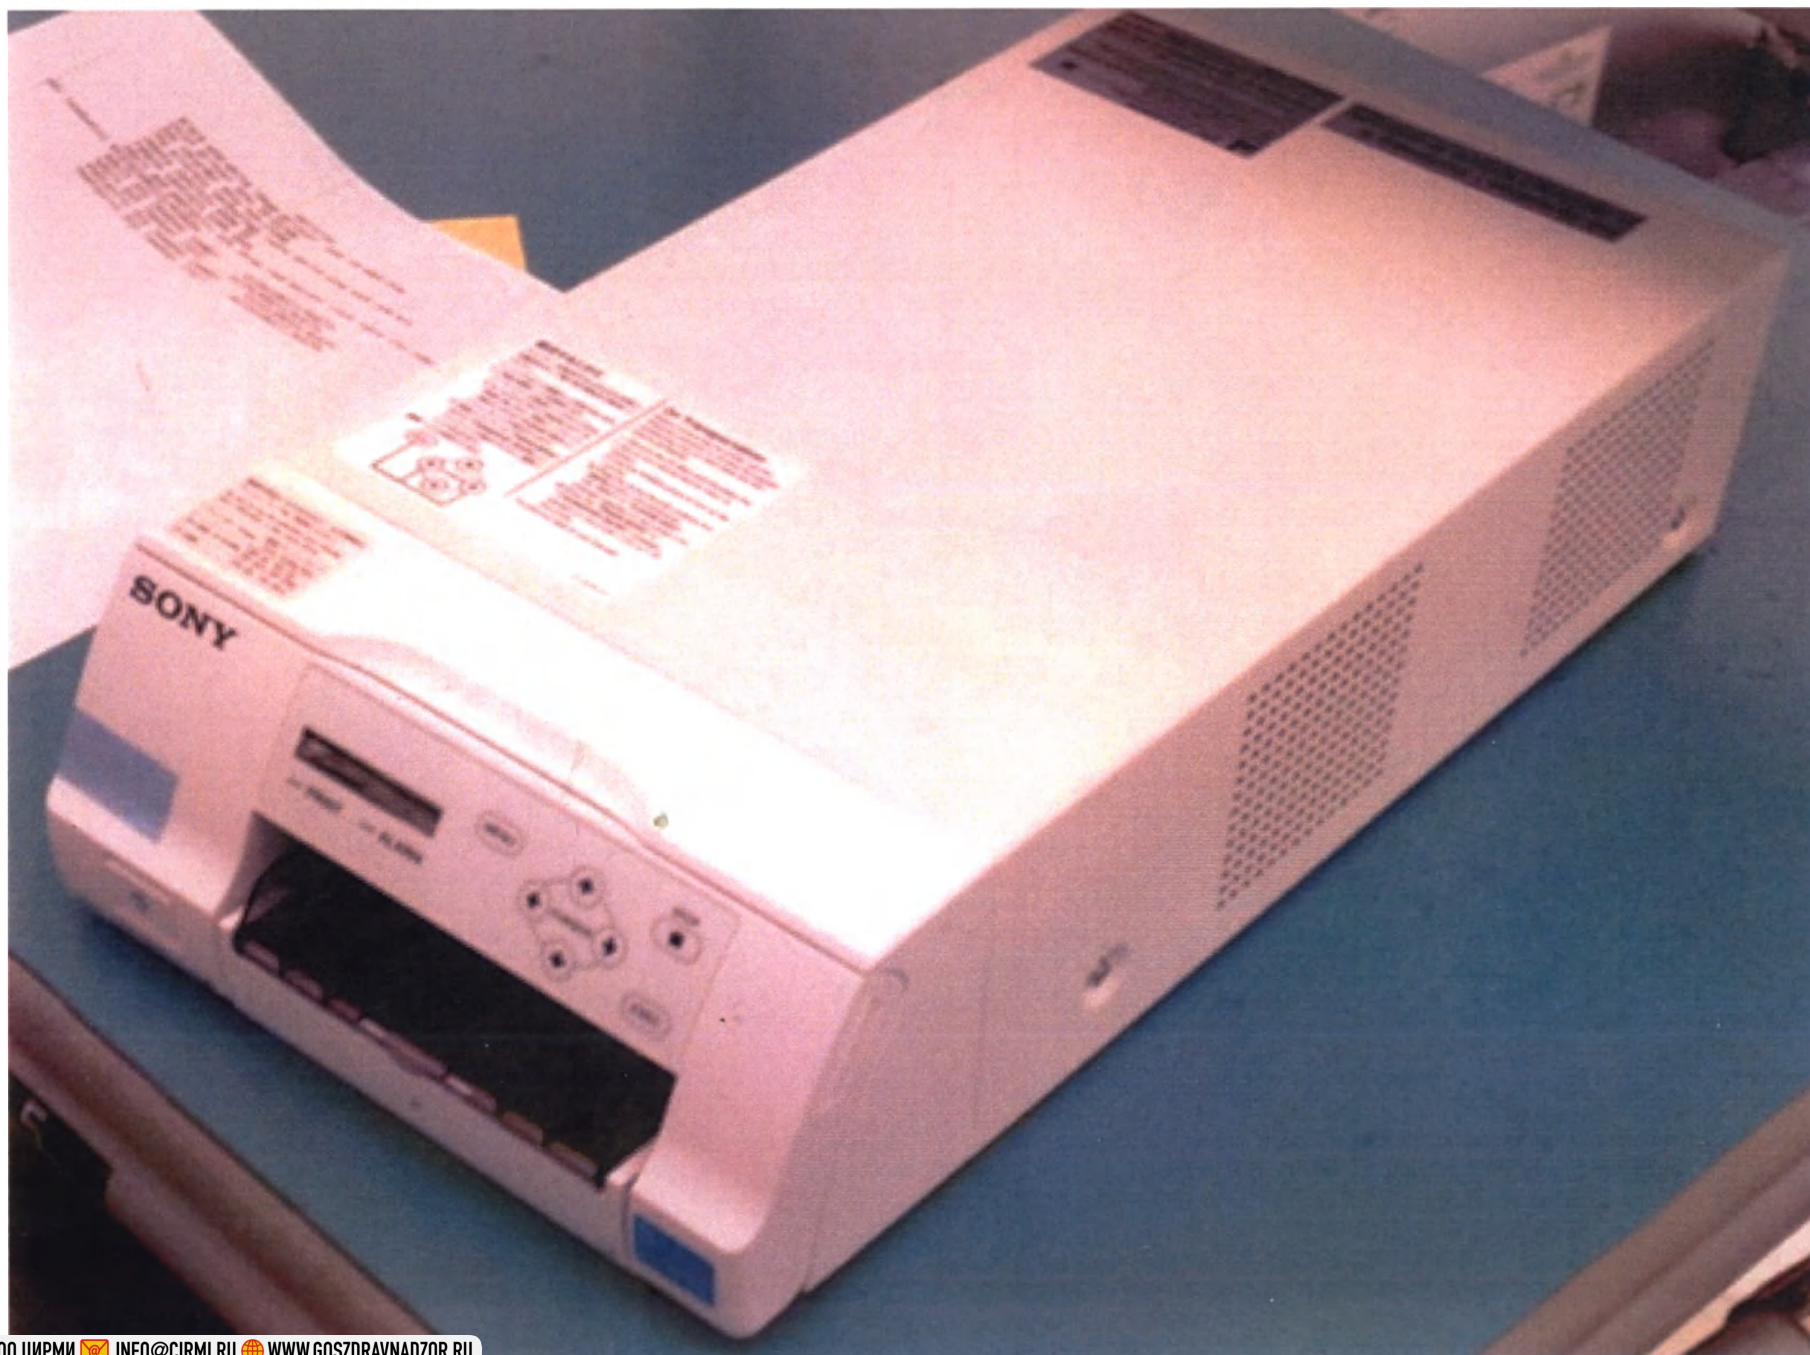






Крышка корзины для хранения.




умага для принтера






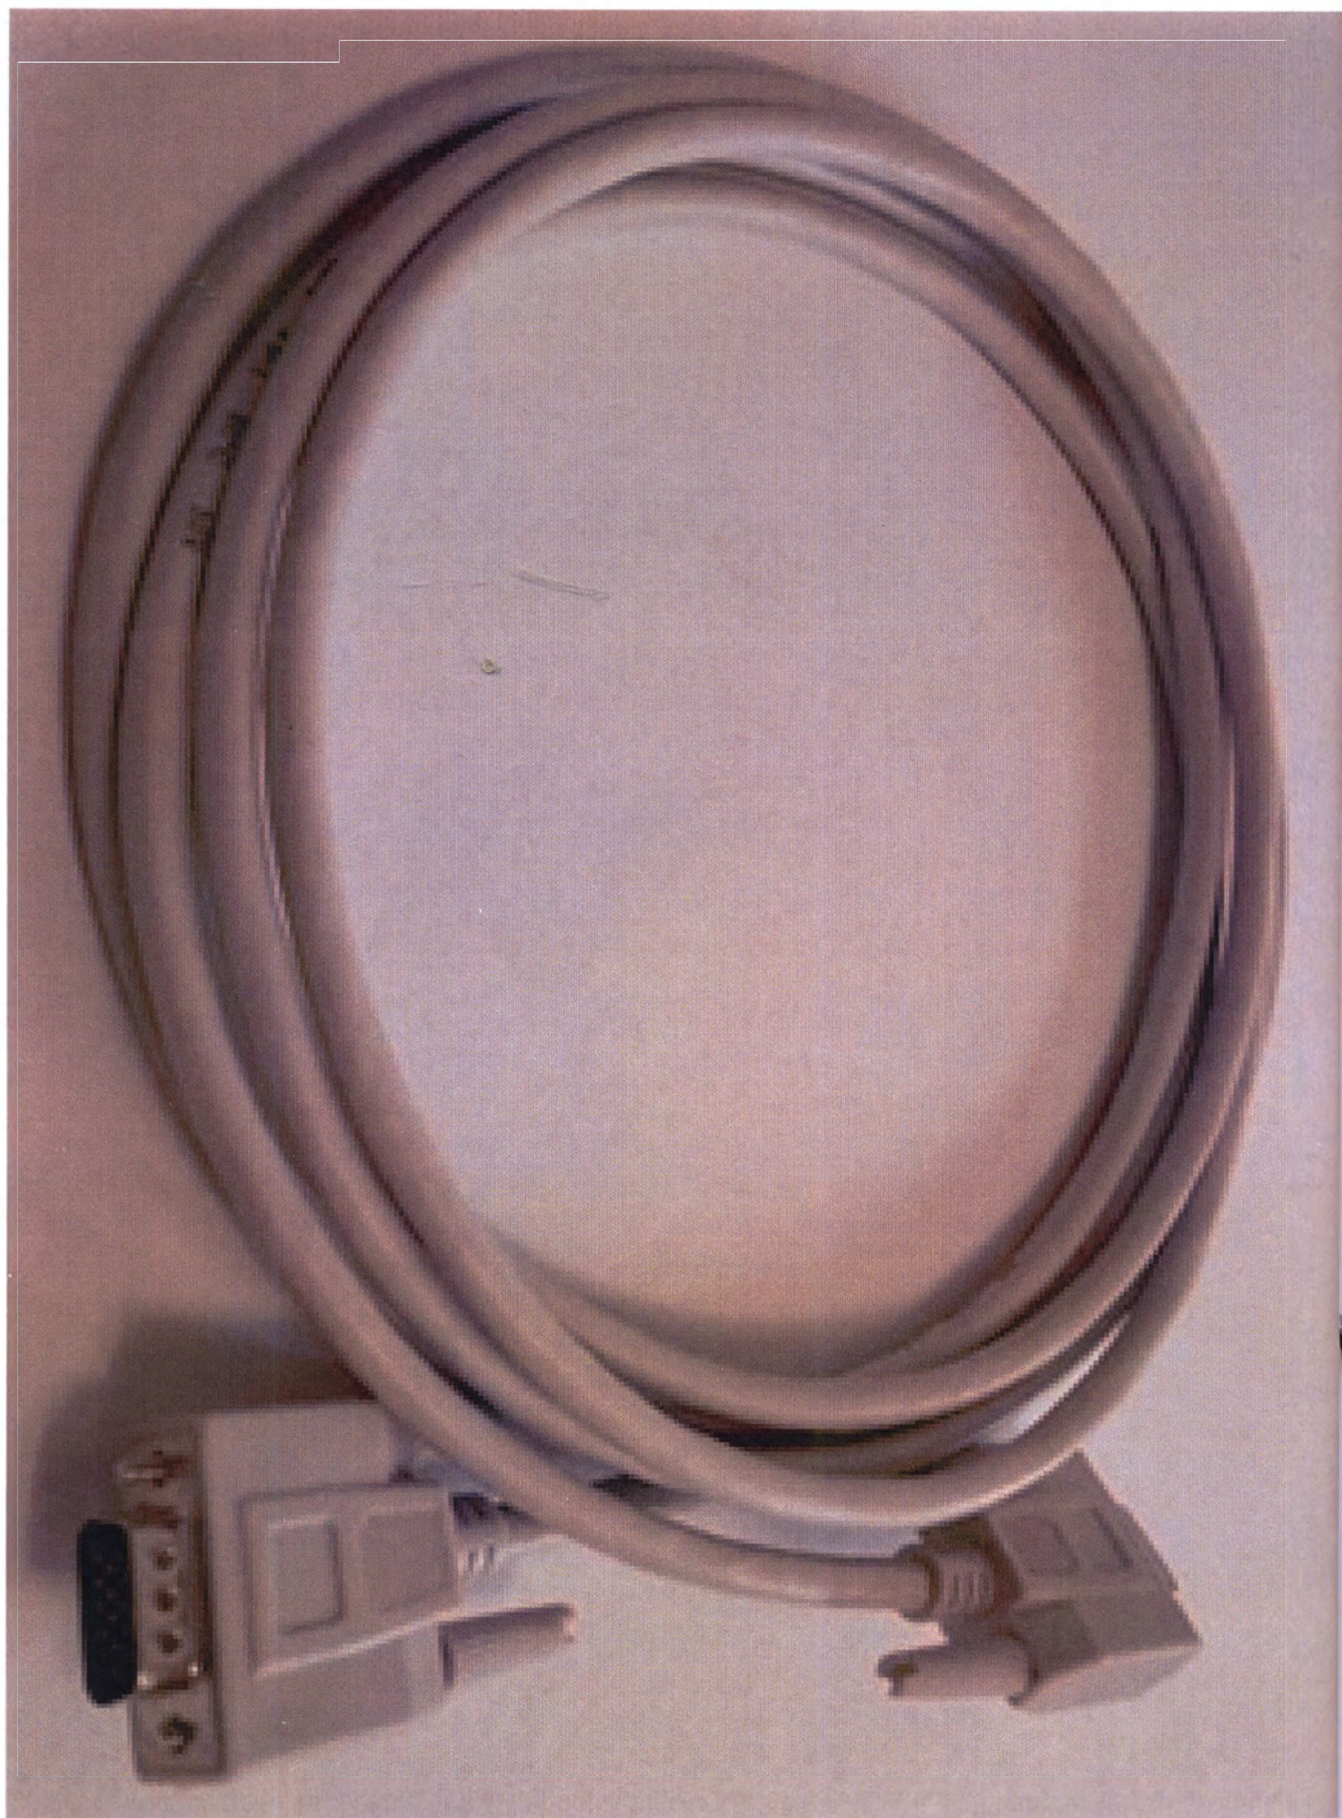




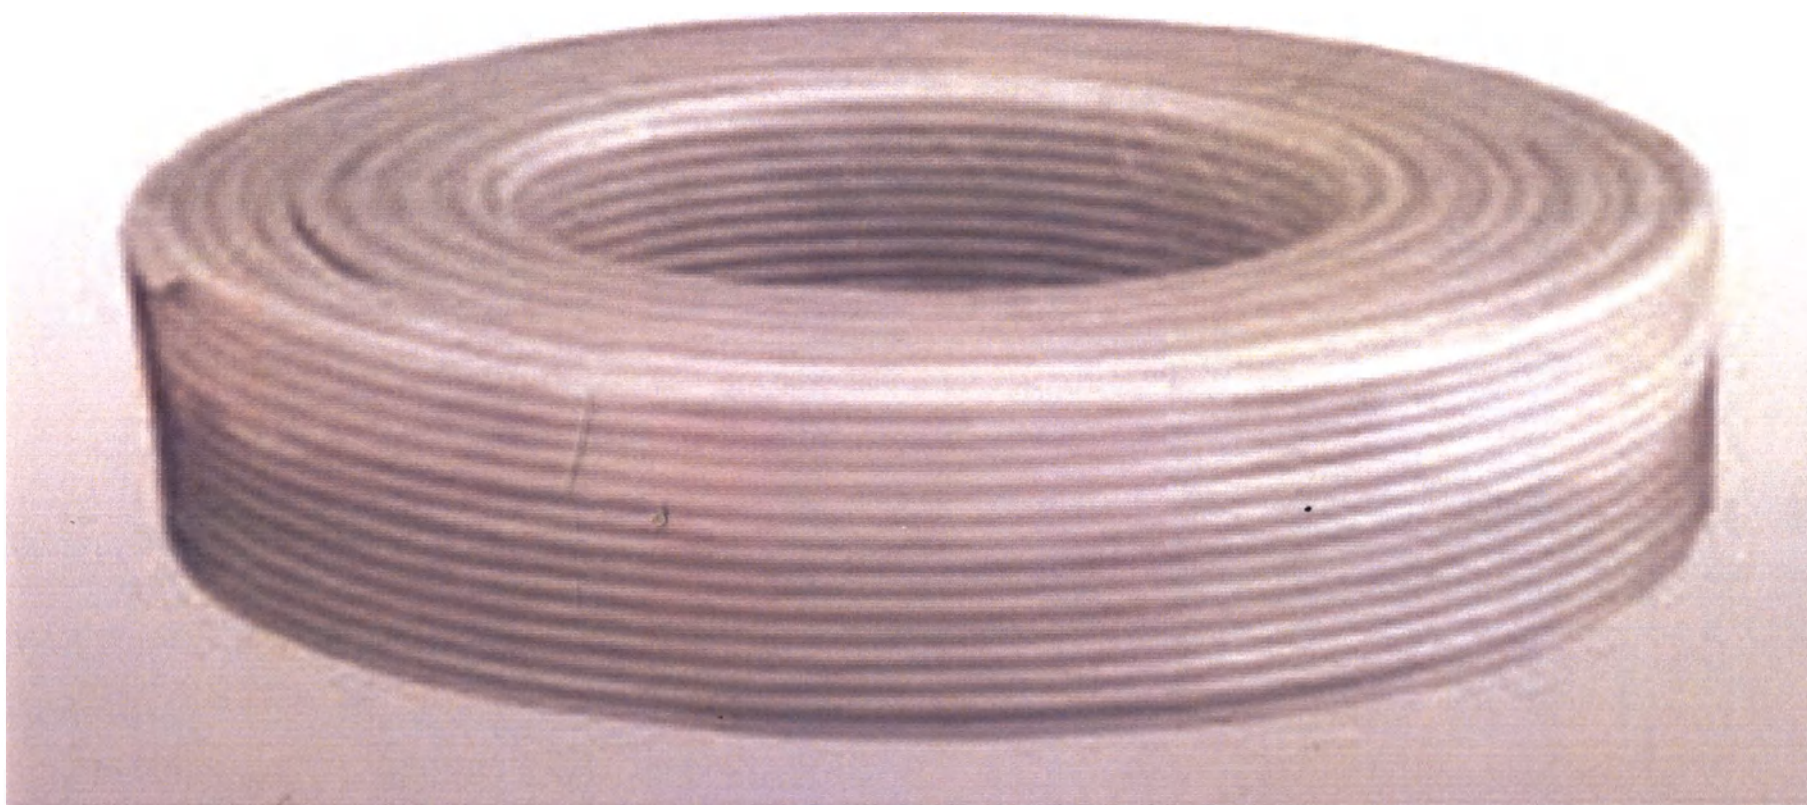



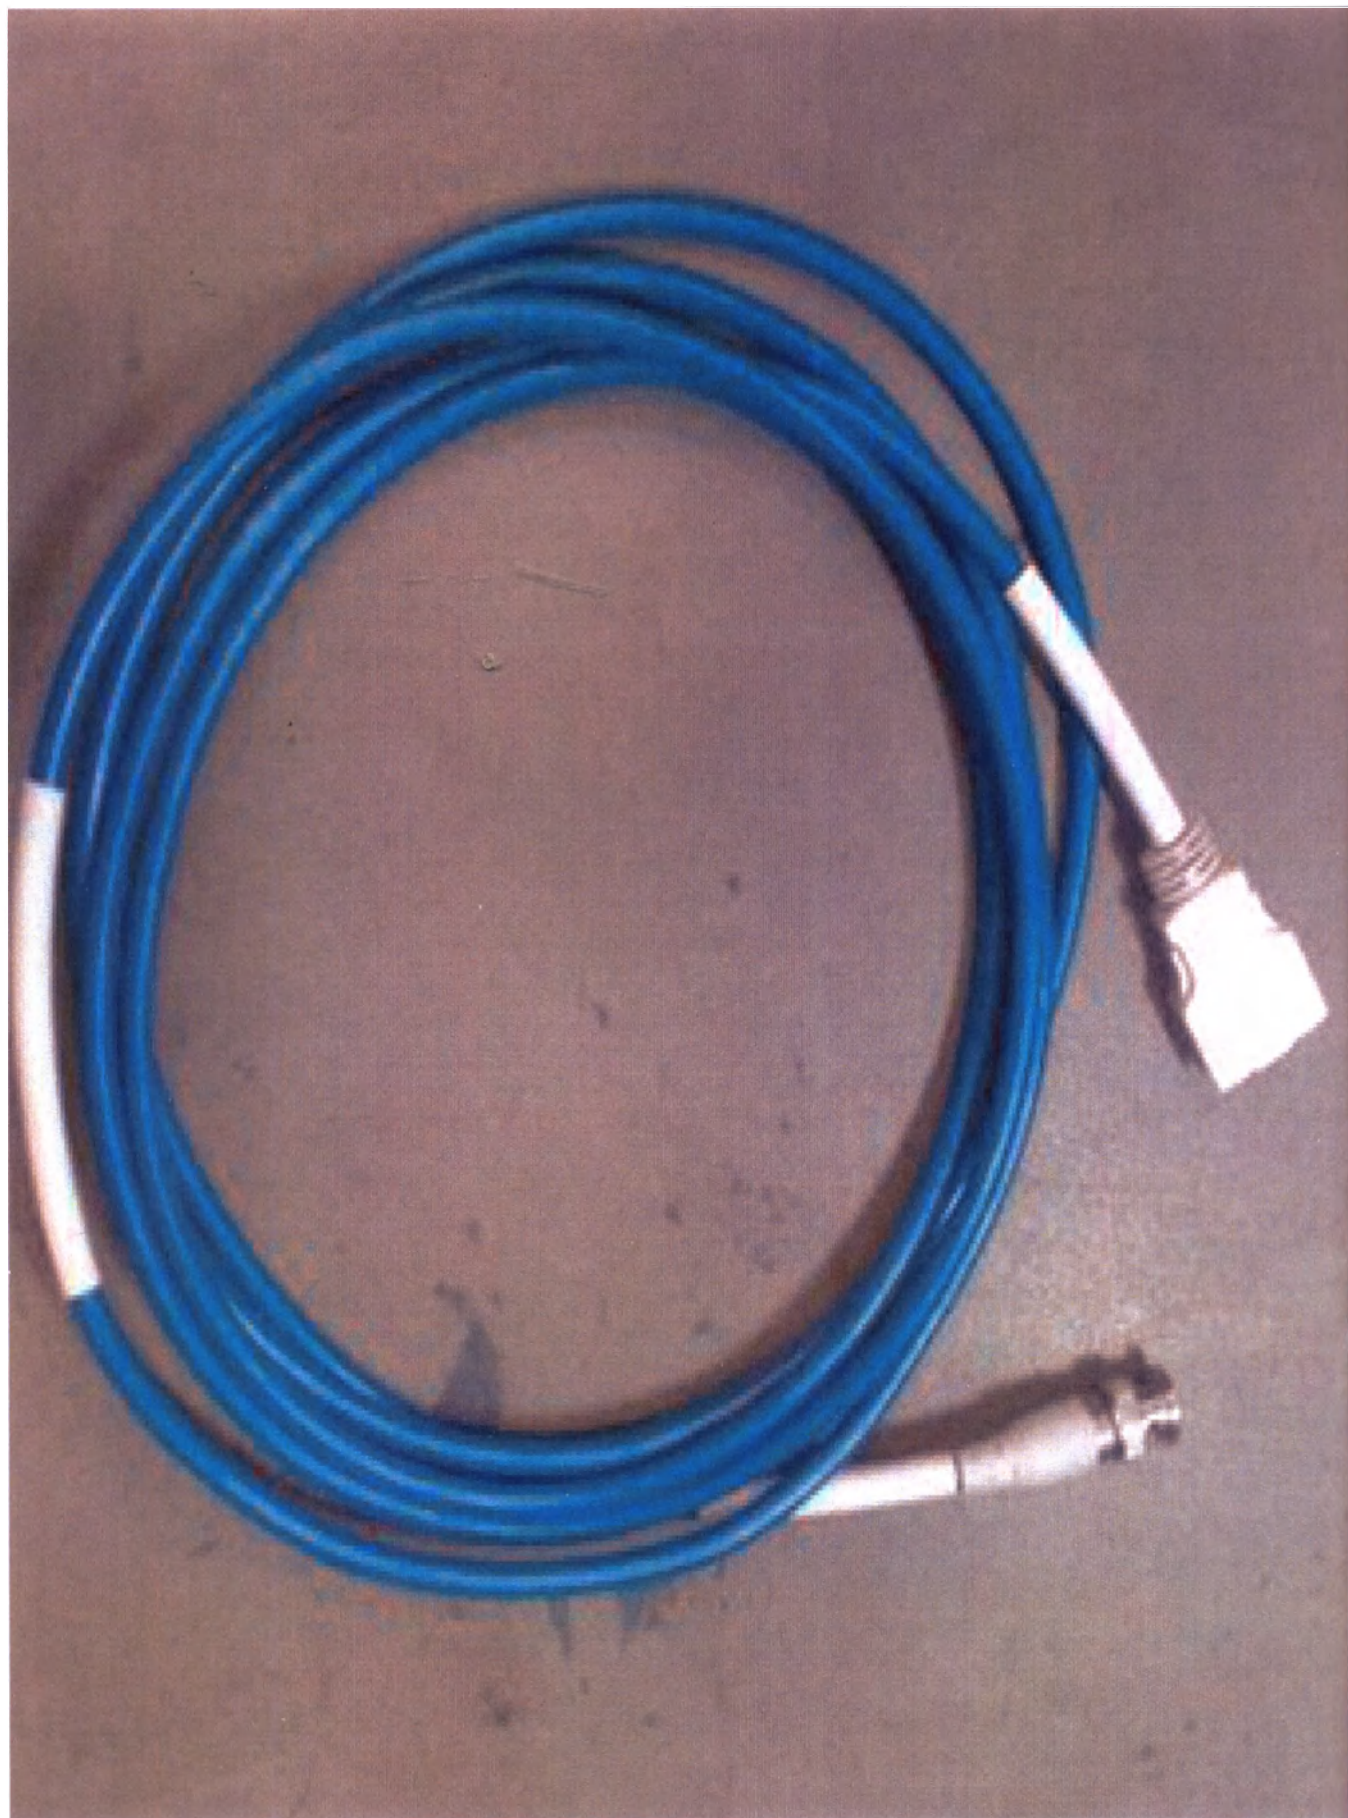

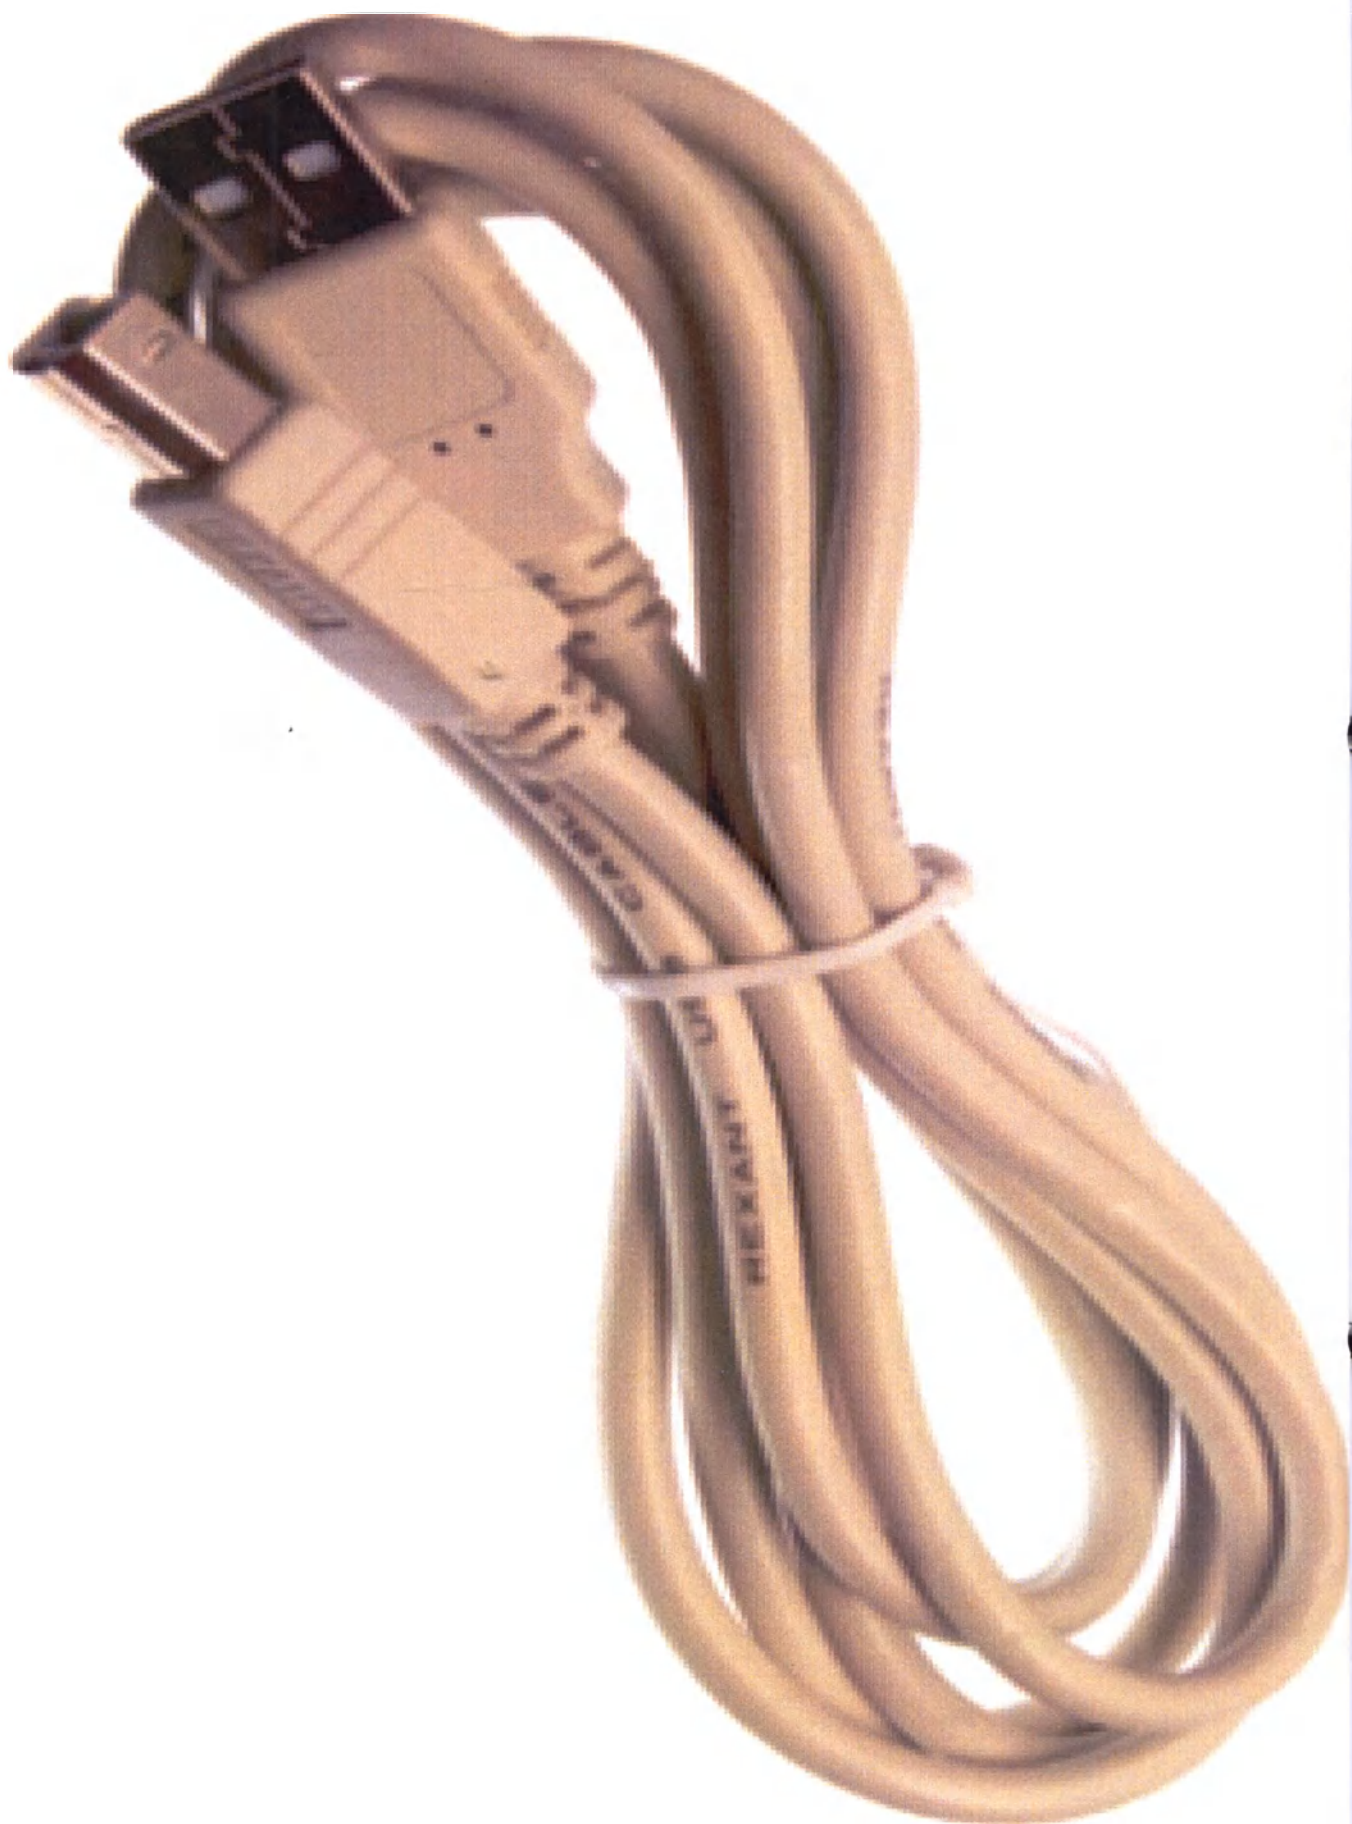

PHILIPS

DVD+R DL



8.5GB

240min

8X speed



PHILIPS

DVD+R DL



8.5GB

240 min

8X speed



Транспортная упаковка



Макет русскоязычной маркировки

Производитель: [по РУ]

Место производства: [по РУ]

Медицинское Изделие: [Наименование по РУ]

Серийный номер/номер партии:

см. **SN** / **LOT** на основной маркировке

12 NSкод

Дата изготовления: см.  на основной маркировке

Номинальный режим работы: см.  или на основной маркировке

Предупреждения и знаки опасности: см. 

Регистрационное удостоверение: № РЗН/ФСЗ

Всего пронумеровано,
гашено и
скреплено печатью
40 листа (ов)

