

Фотографические изображения медицинского изделия

**Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для
иммунофенотипирования методом проточной цитометрии
Производства Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences
(«Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз»)**


«УТВЕРЖДАЮ»

**Специалист по регистрации
медицинских изделий**

ООО «Бектон Дикинсон Восток»



Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл., 1 шт./уп. Общий вид маркировки групповой упаковки

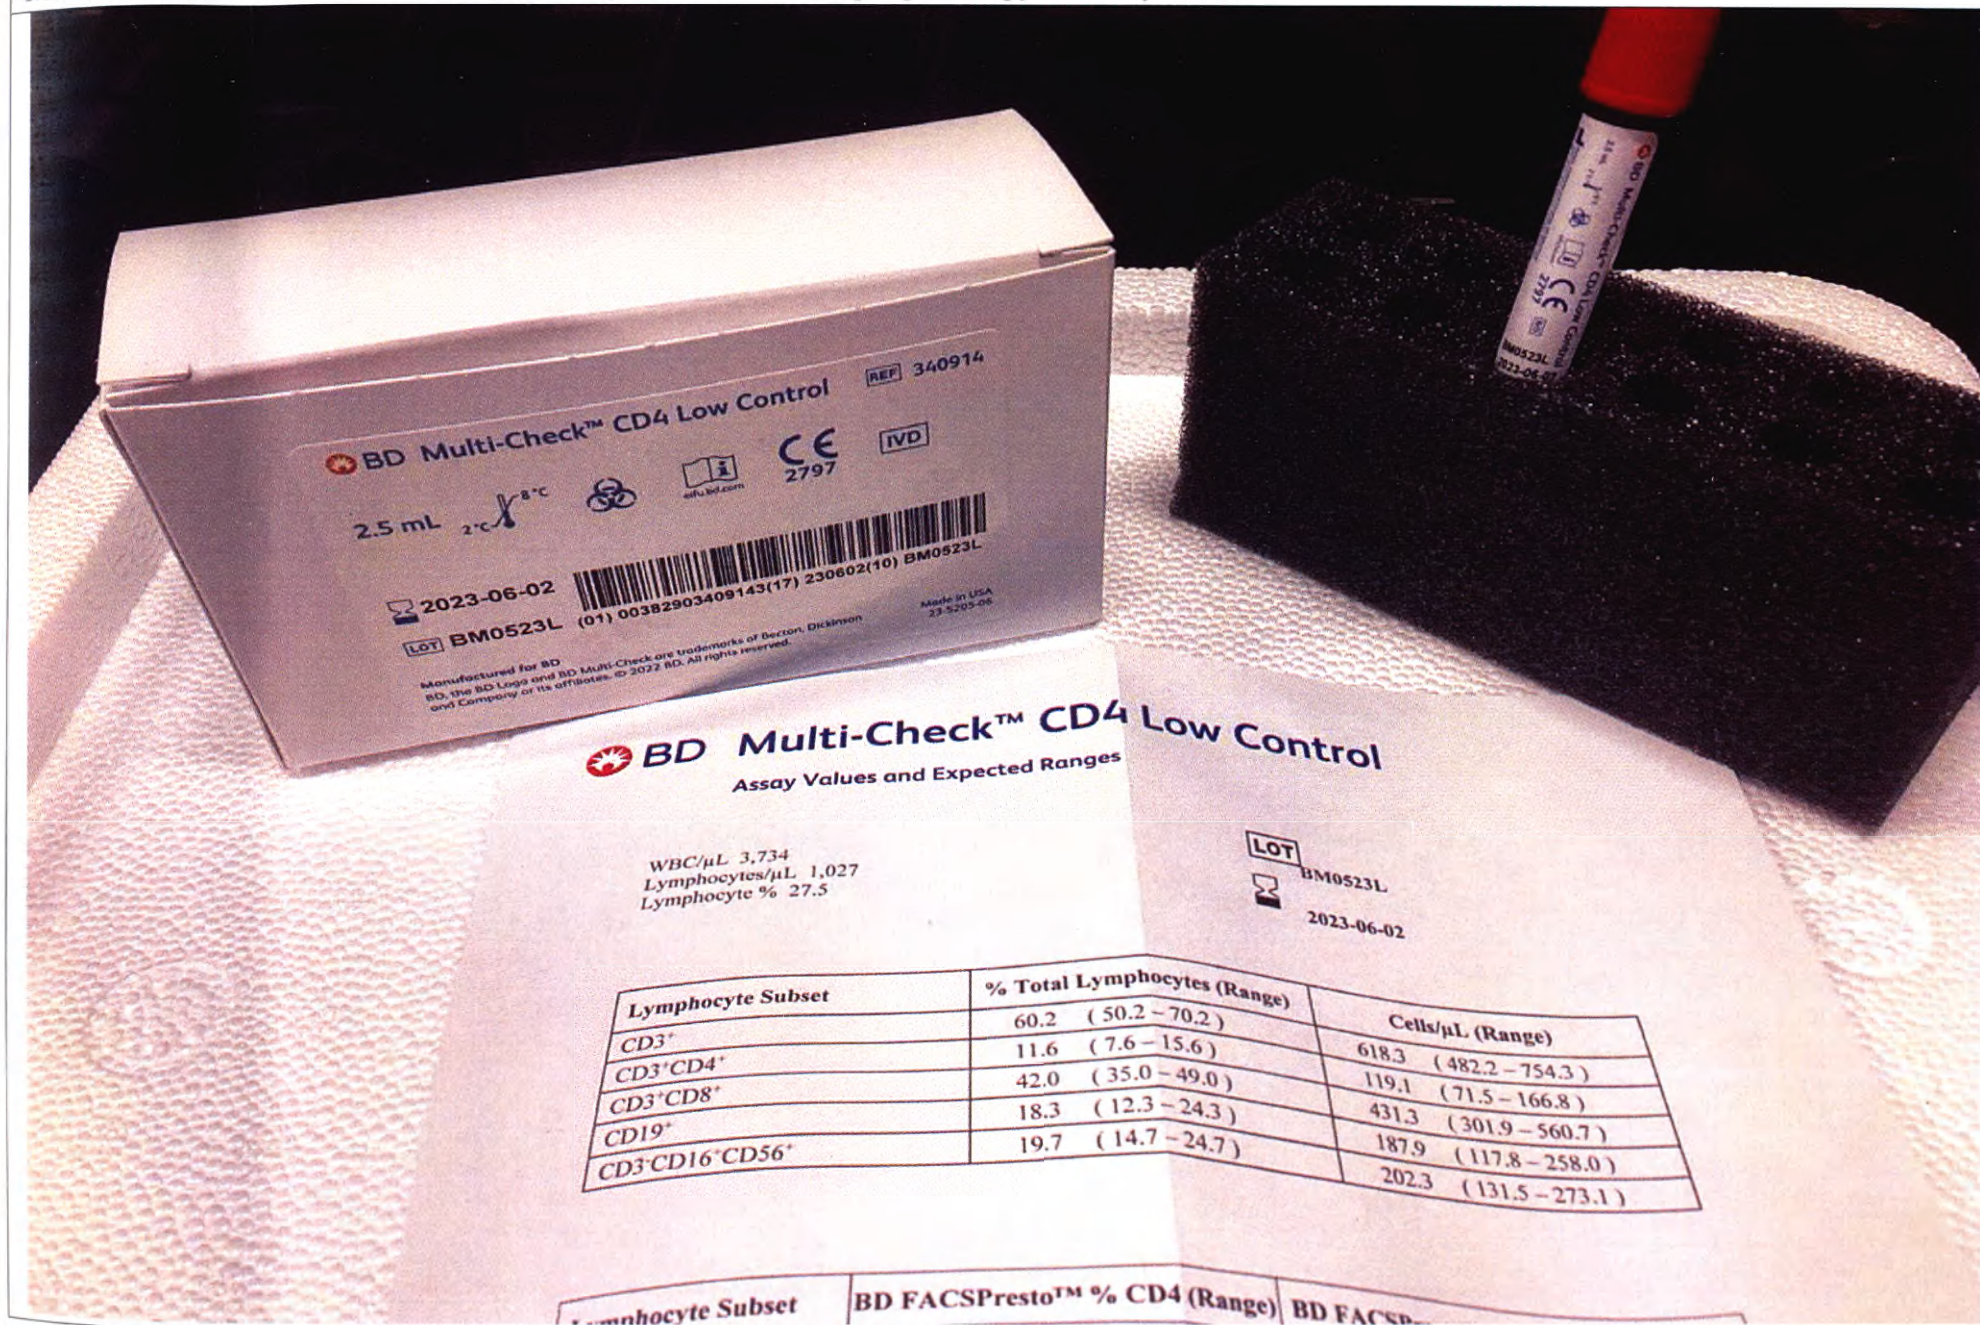

Beckon Dickinson and Company
BD Biosciences
2350 Quince Drive
San Jose, California 95131 USA

Beckon Dickinson Ireland Ltd
Donore Road, Donaghadee
Co. Louth, A62 YV26
Ireland

BD Switzerland Sarl
Terra Bonora Park - A1
Route de Crasles 17
1263 Eysins, Switzerland

BD Biosciences
European Customer Support
Tel: +32 53 738 650
help.biosciences@bdb.com

Australian and New Zealand Distributors
Beckon Dickinson Pty Ltd
65 Waterloo Road
Mulgrave Park NSW 2113
Australia

Beckon Dickinson Limited
141 George Street
Mt. Wellington Auckland 1060
New Zealand

Subsidiaries:
Credentia@bdb.com
Credentia@bdb.com

23-21677-02

BD Multi-Check™ CD4 Low Control

Assay Values and Expected Ranges

WBC/ μ L 3,734
Lymphocytes/ μ L 1,027
Lymphocyte % 27.5

LOT

BM0523L

2023-06-02


Lymphocyte Subset	% Total Lymphocytes (Range)	Cells/ μ L (Range)
CD3 ⁺	60.2 (50.2 – 70.2)	618.3 (482.2 – 754.3)
CD3 ⁺ CD4 ⁺	11.6 (7.6 – 15.6)	119.1 (71.5 – 166.8)
CD3 ⁺ CD8 ⁺	42.0 (35.0 – 49.0)	431.3 (301.9 – 560.7)
CD19 ⁺	18.3 (12.3 – 24.3)	187.9 (117.8 – 258.0)
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺	19.7 (14.7 – 24.7)	202.3 (131.5 – 273.1)

Lymphocyte Subset	BD FACSPresto™ % CD4 (Range)	BD FACSPresto™
CD3 ⁺ CD4 ⁺	78.1 (60.0 – 90.0)	


Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл., 1 шт./уп. Общий вид маркировки групповой упаковки




Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл. Внешний вид первичной упаковки (пробирка)

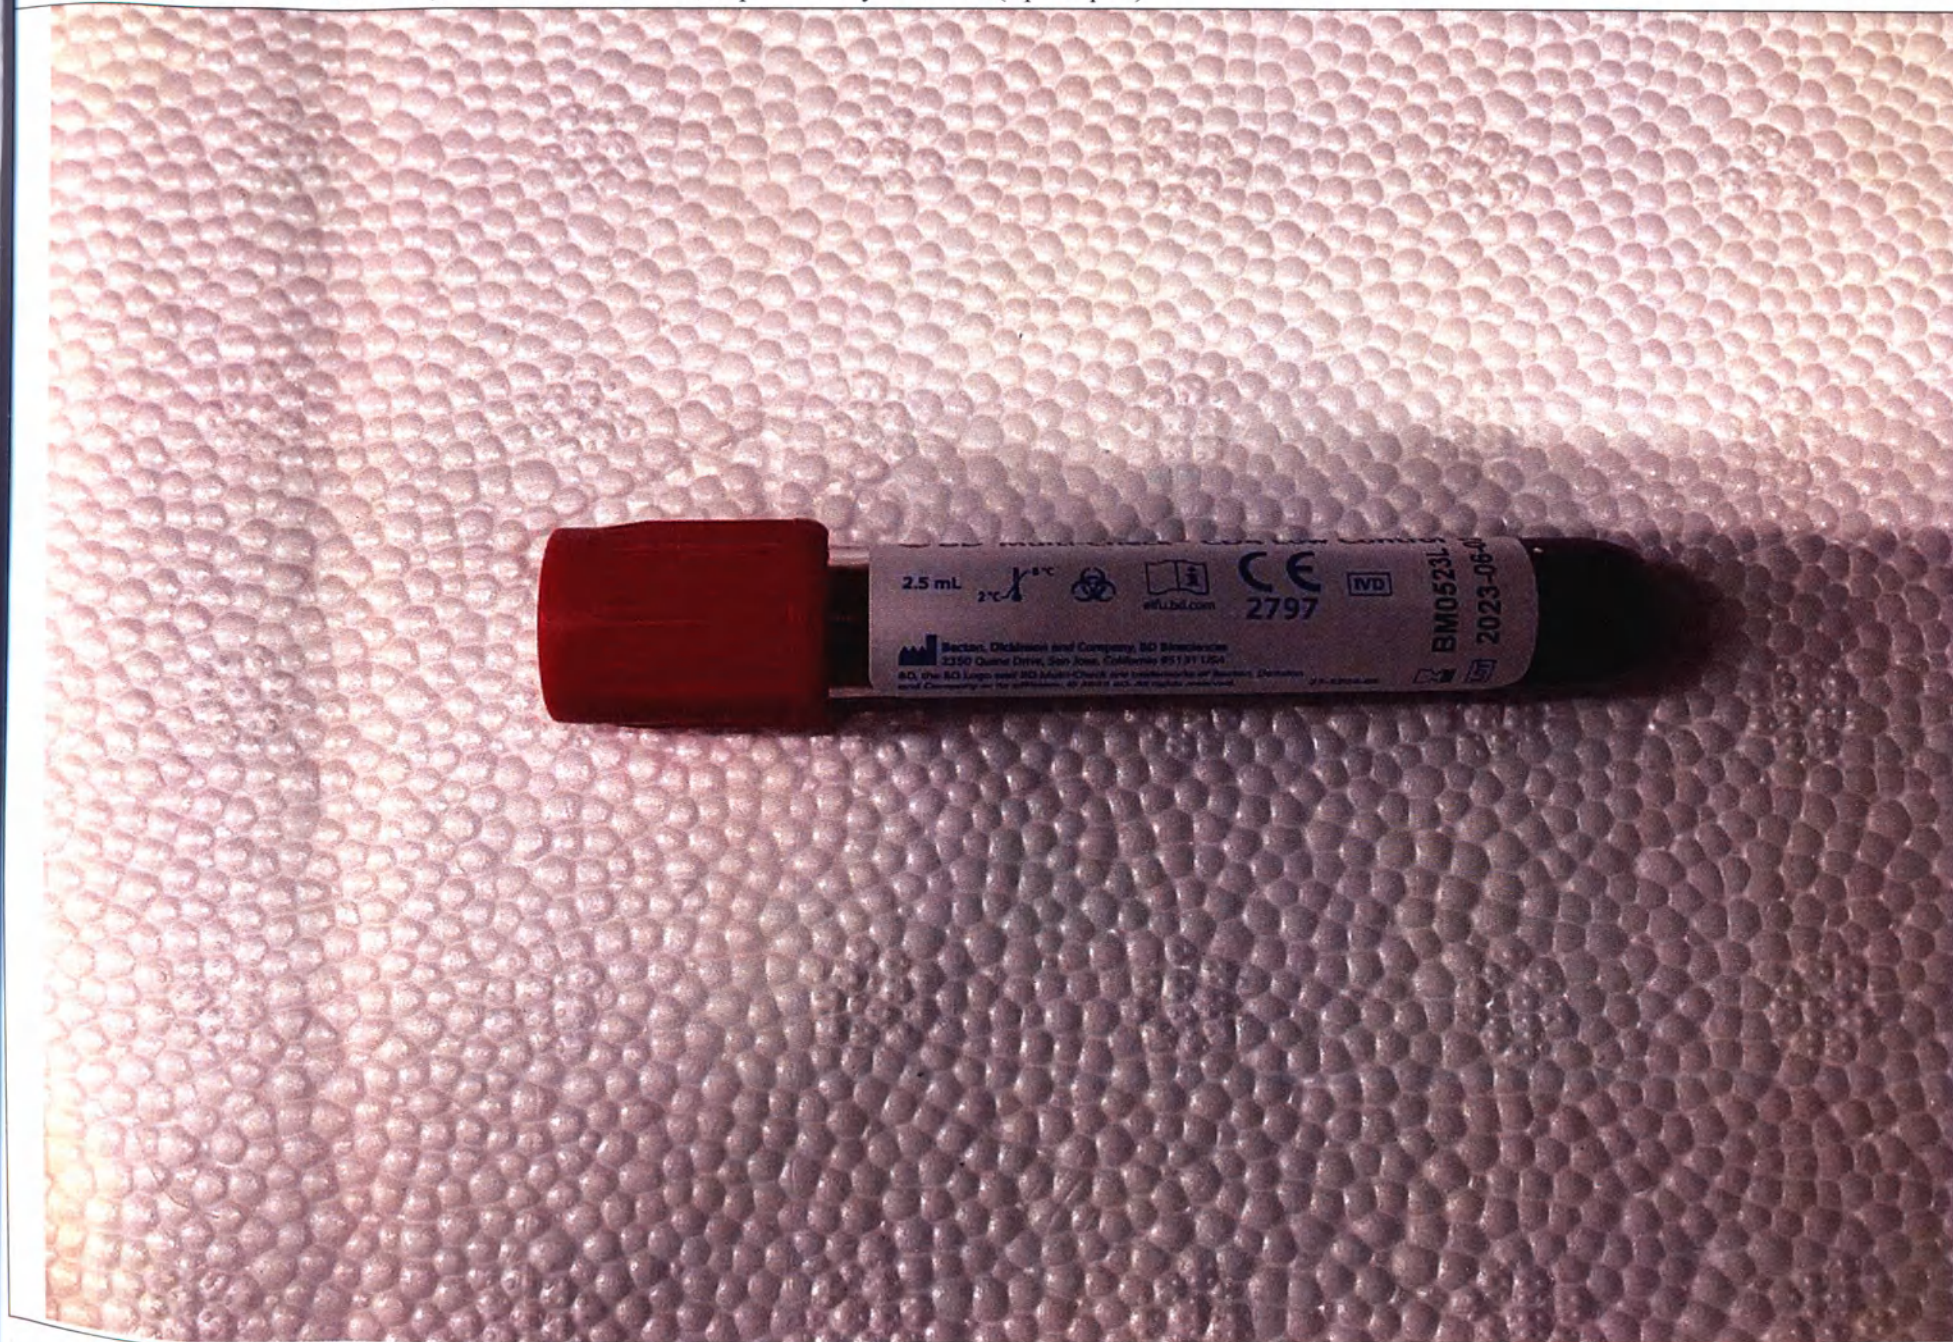

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл. Внешний вид первичной упаковки (пробирка)

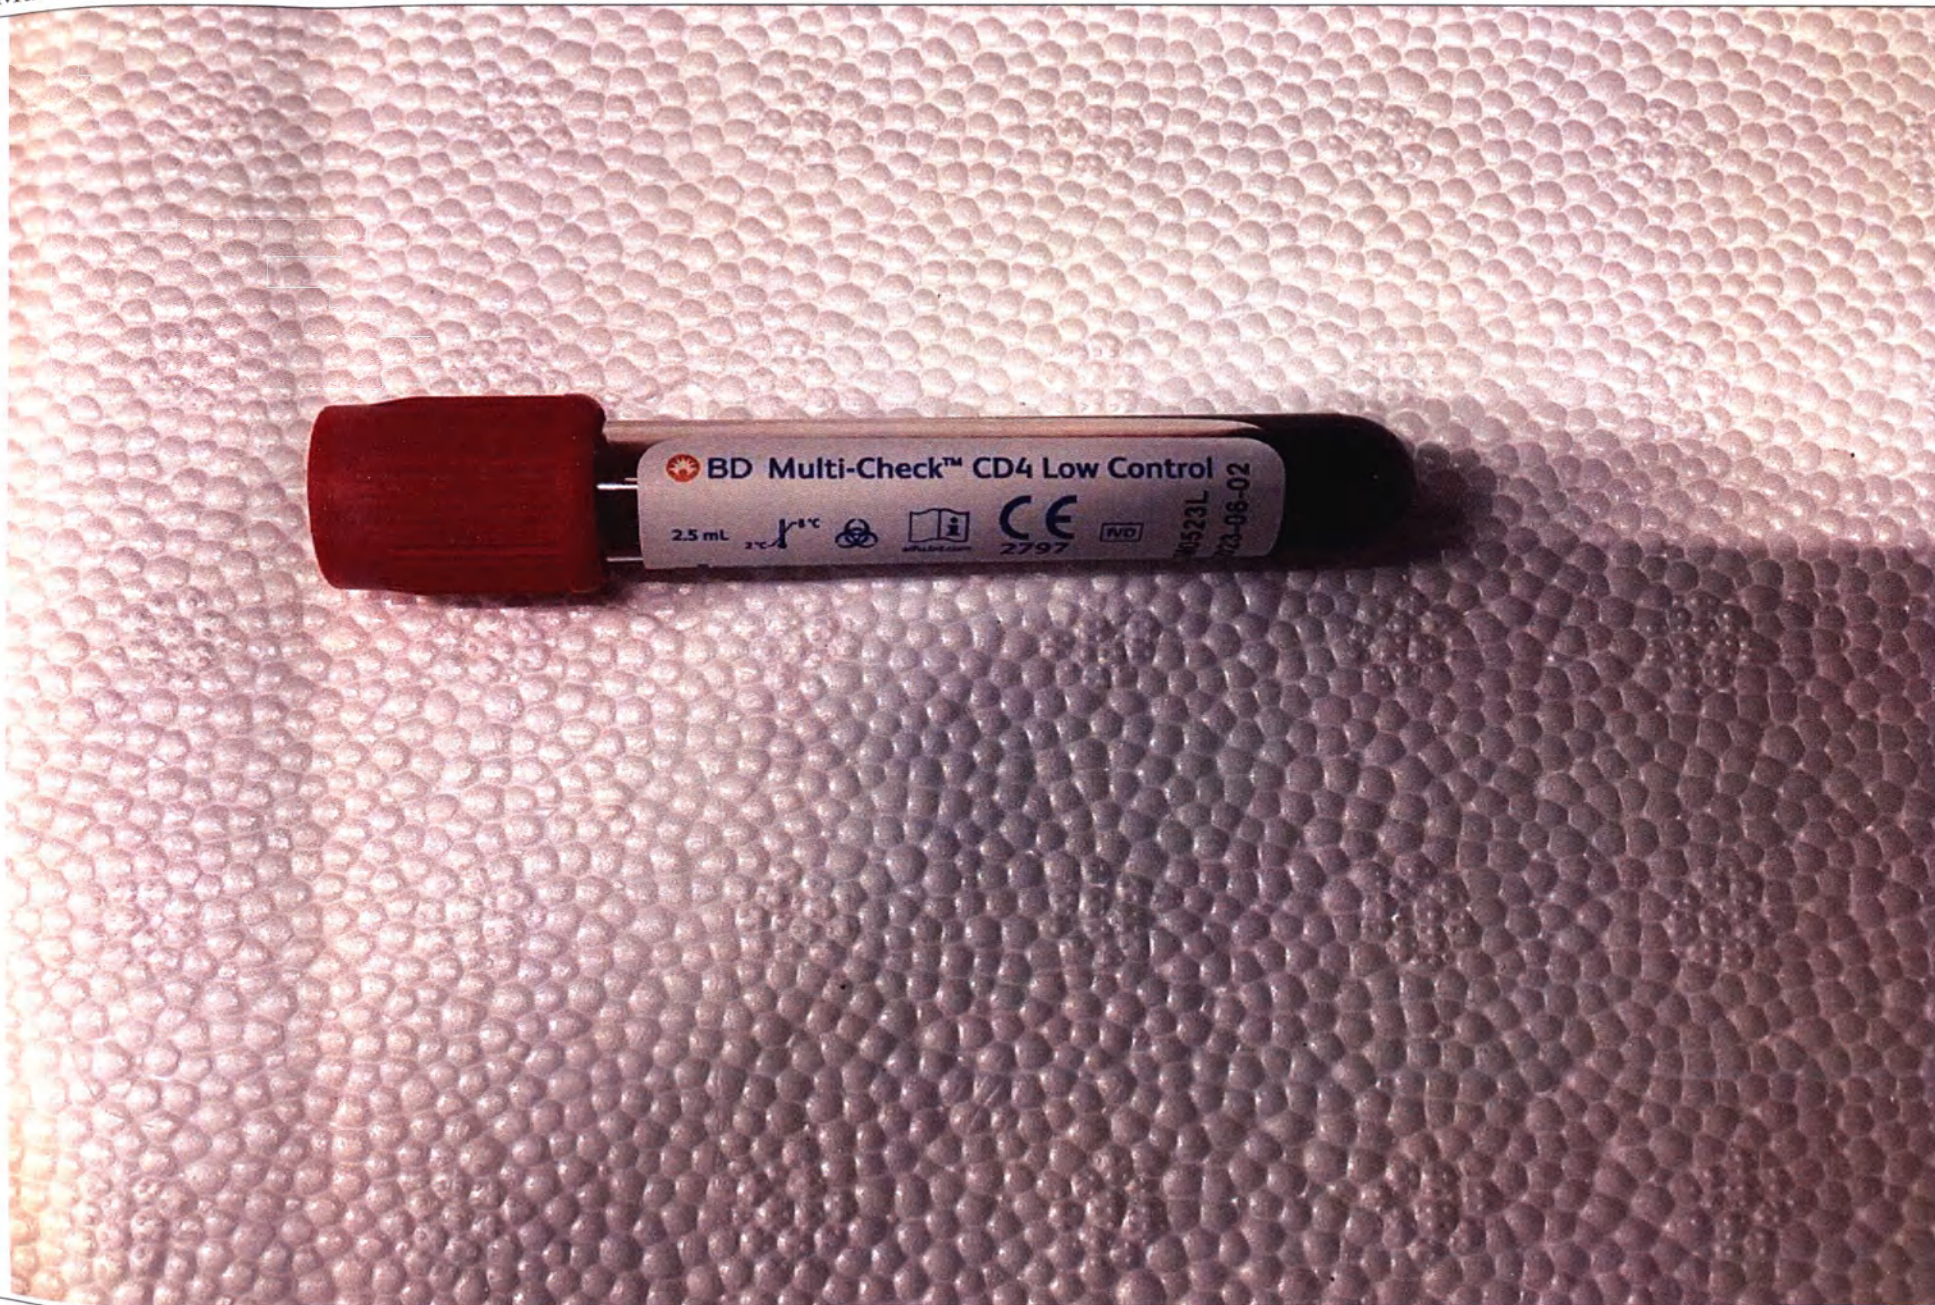


Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл., 2 шт./уп.
Общий вид маркировки групповой упаковки

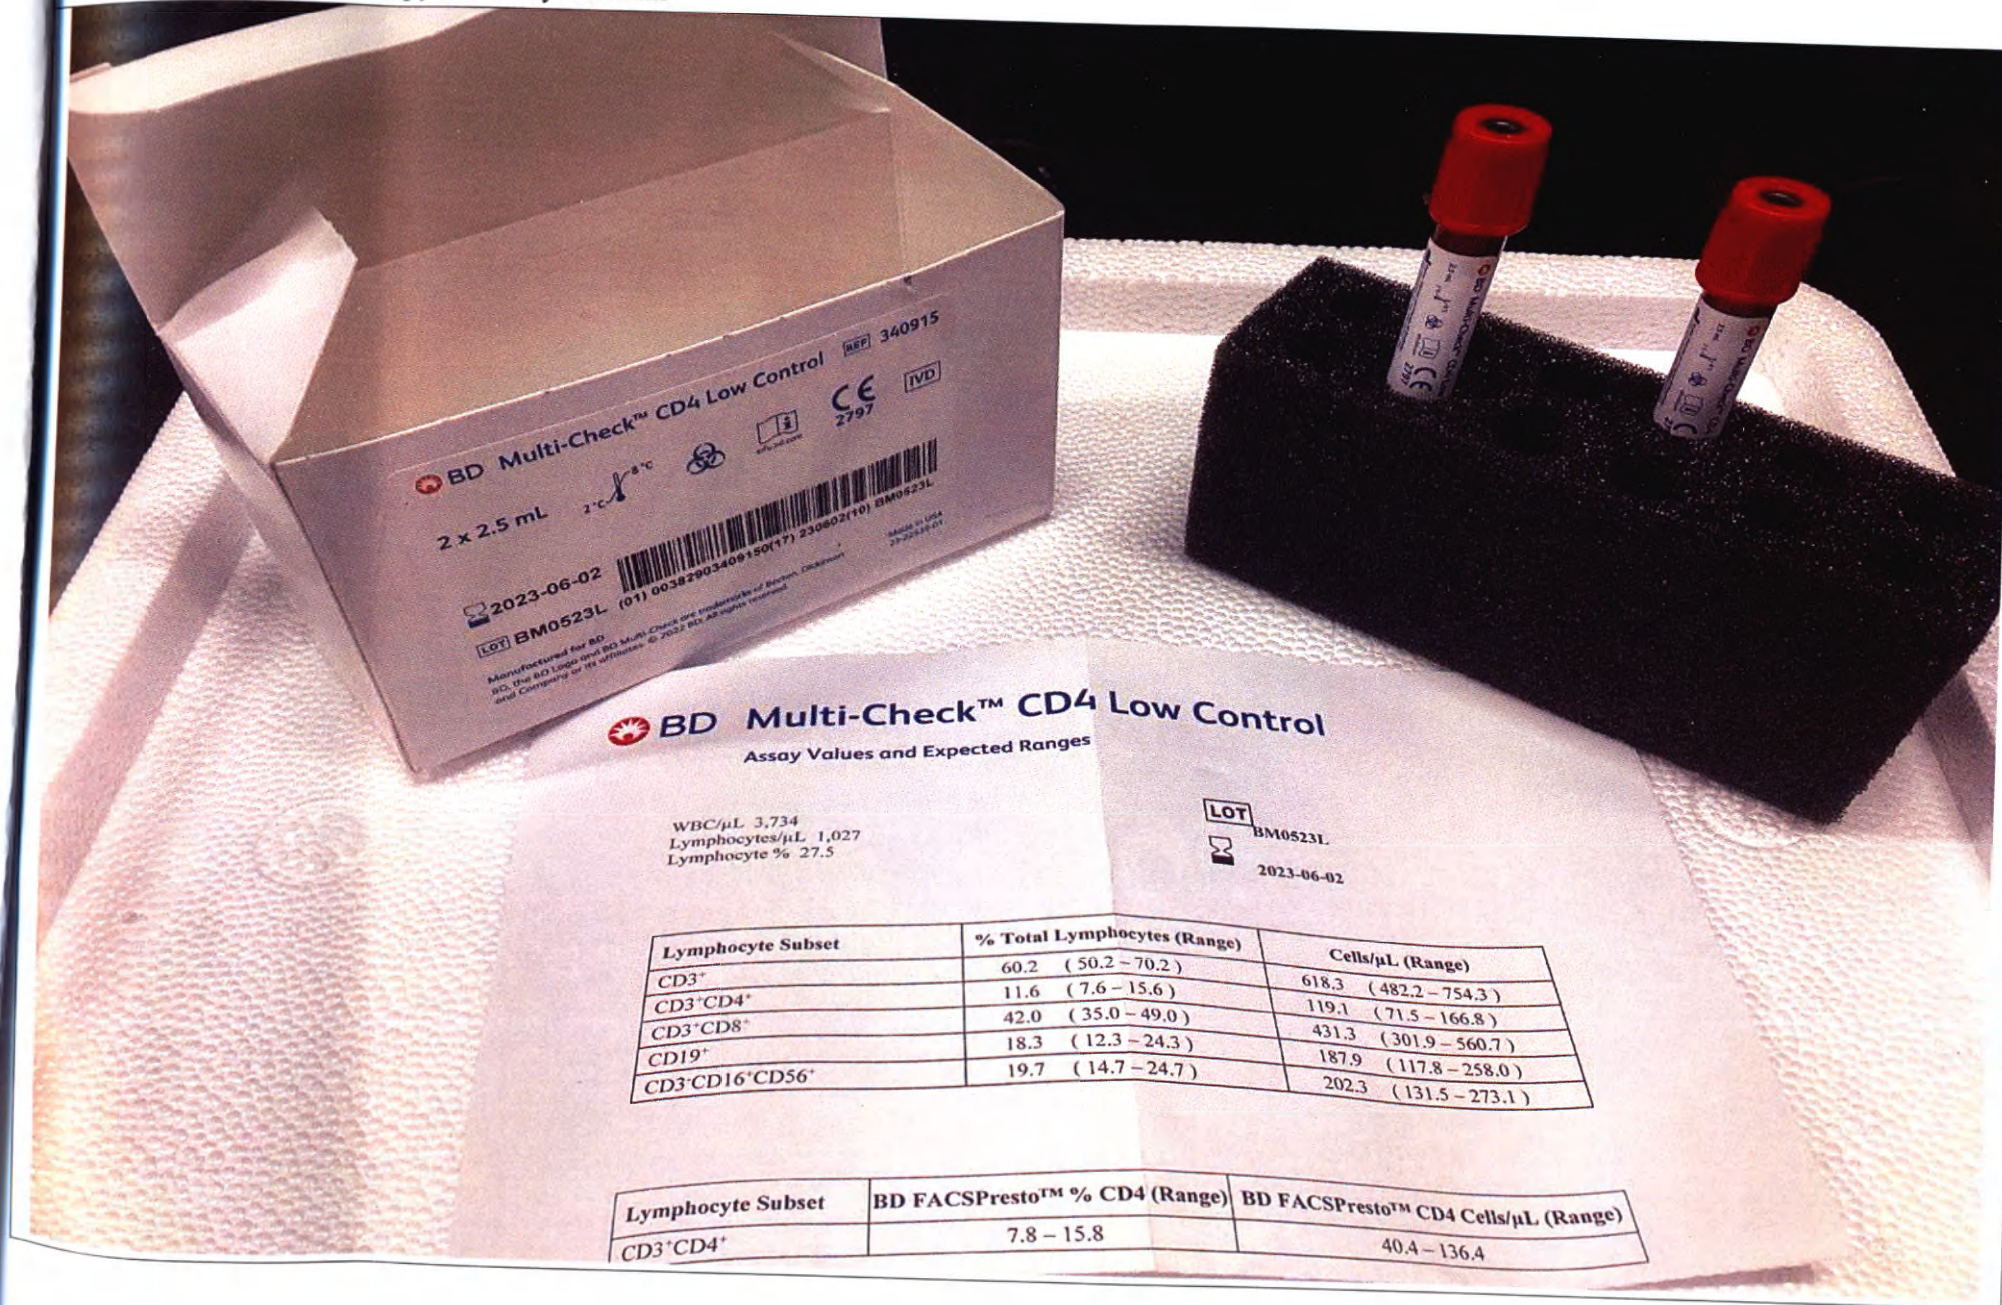


Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл., 2 шт./уп. Общий вид маркировки групповой упаковки




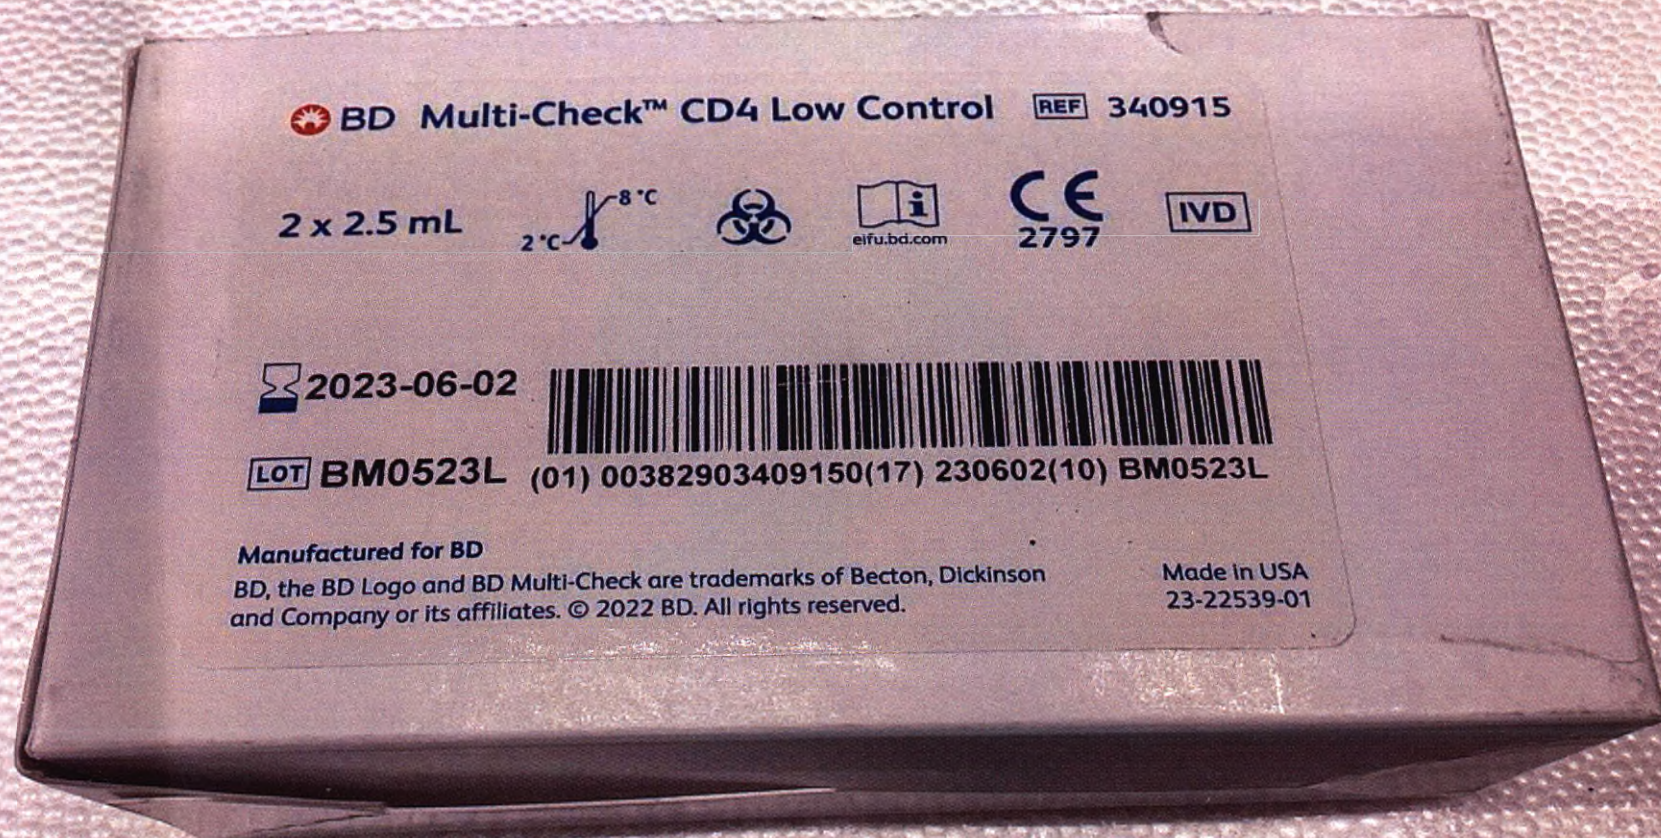

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл. Внешний вид первичной упаковки (пробирка)

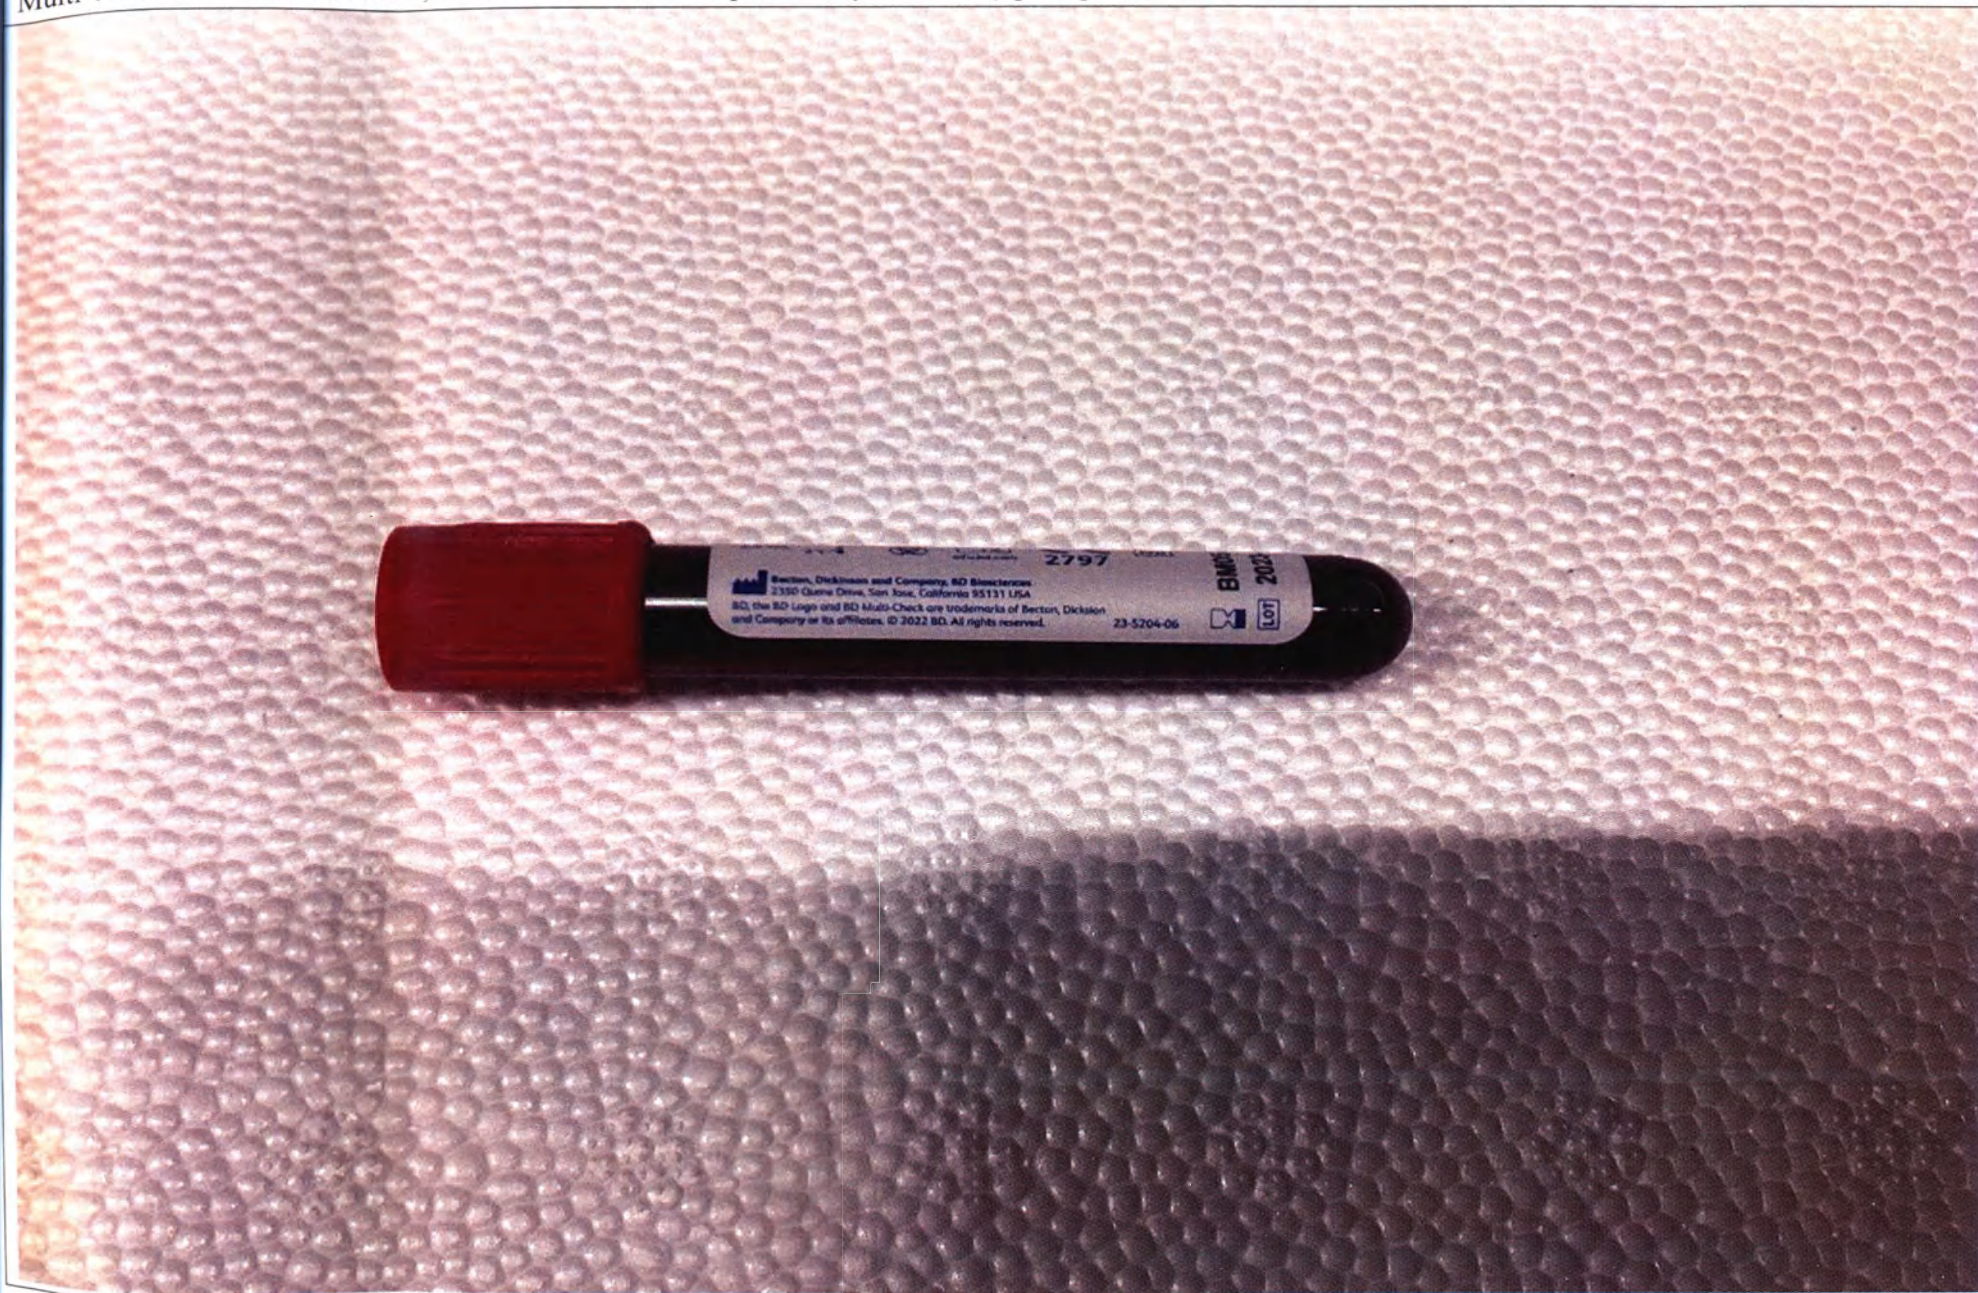


Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл. Внешний вид первичной упаковки (пробирка)

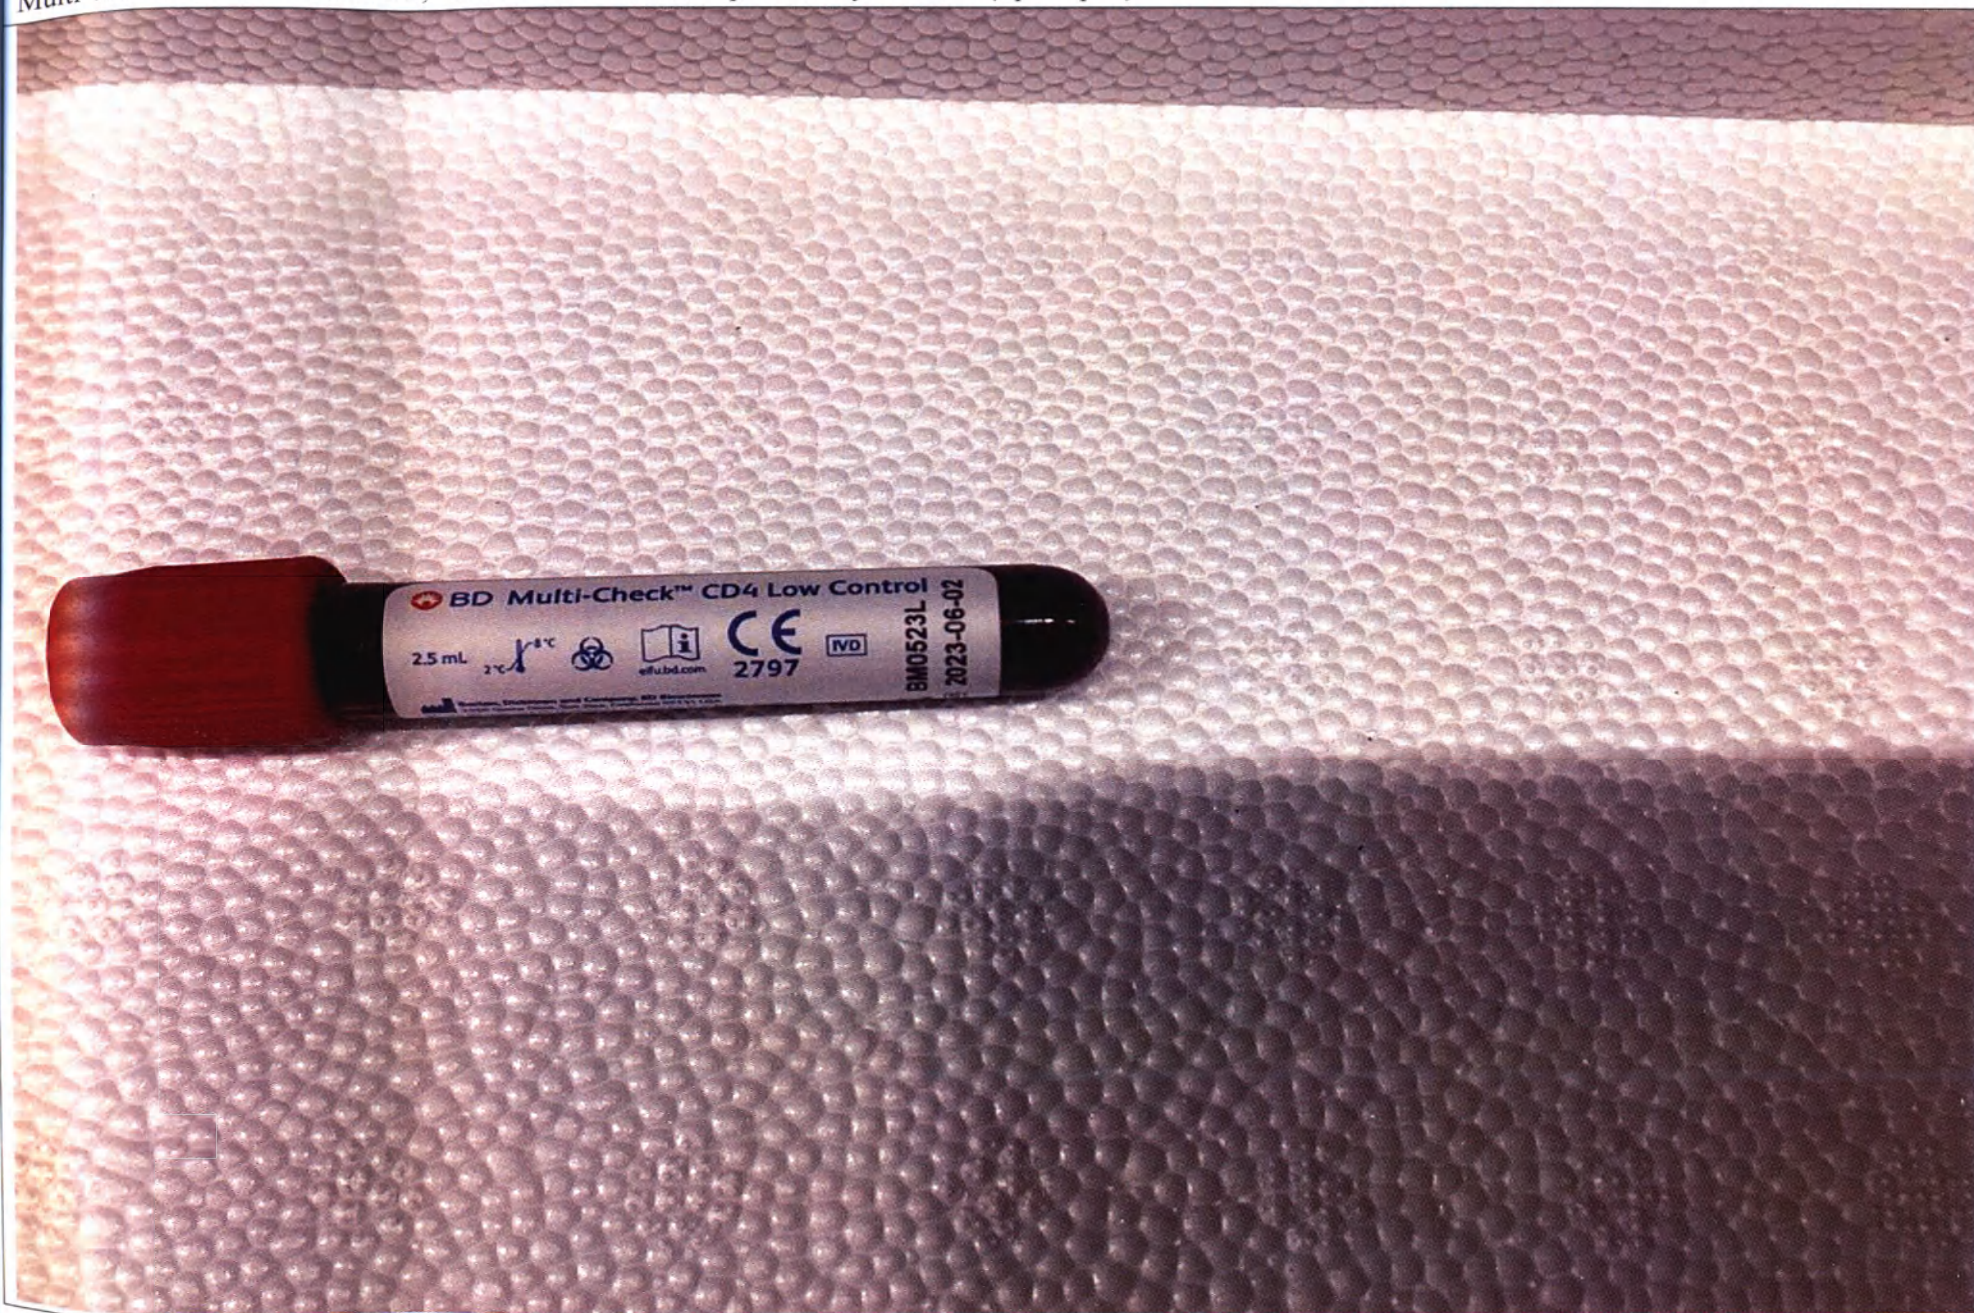

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл., 5 шт./уп. Общий вид маркировки групповой упаковки



Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл., 5 шт./уп. Общий вид маркировки групповой упаковки

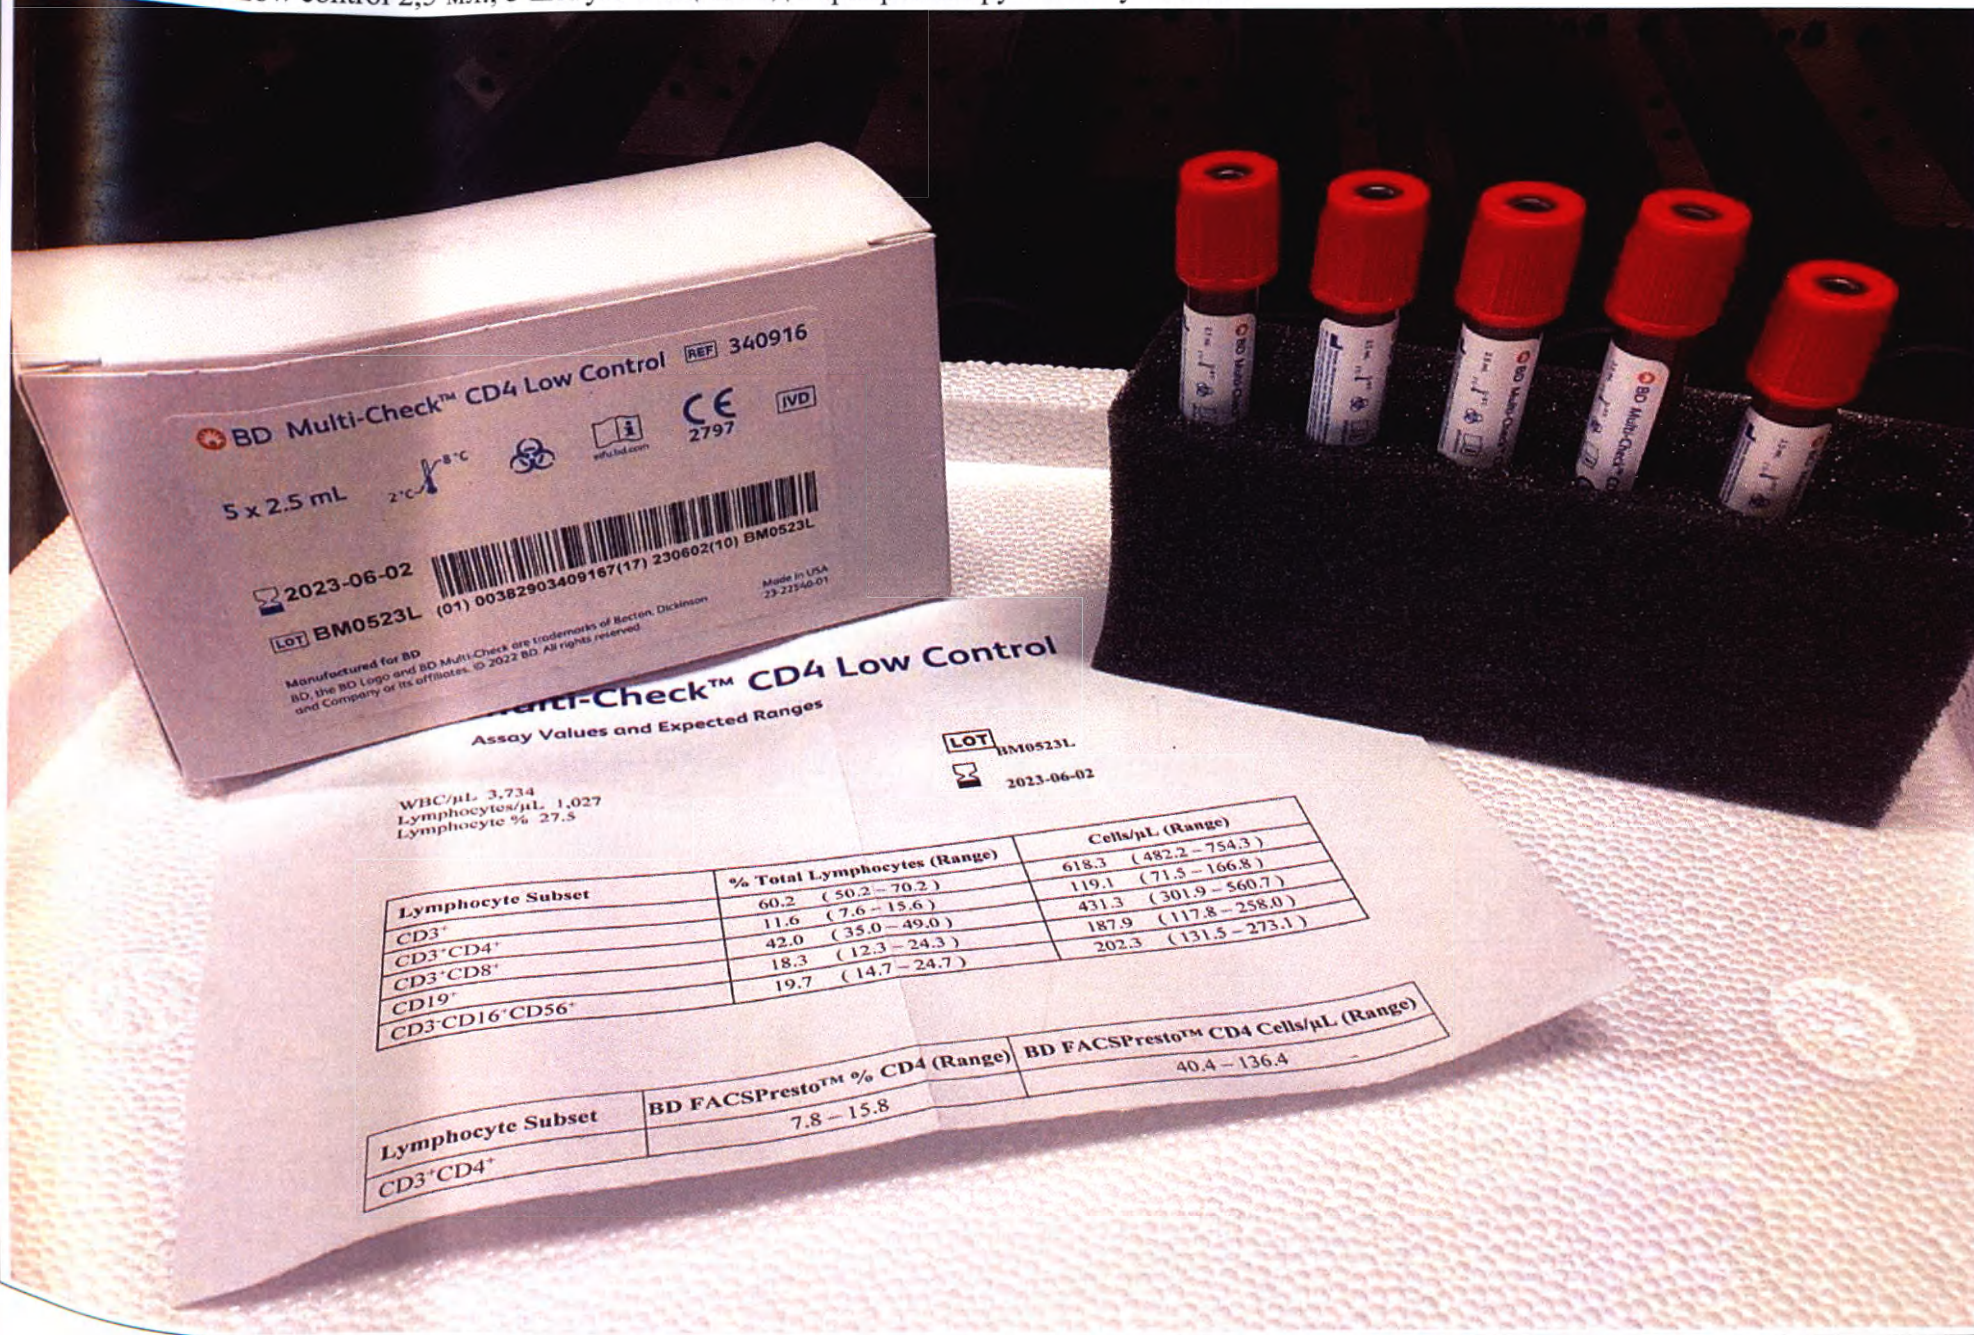

BD Multi-Check™ CD4
Assay Values and Expected Ranges

WBC/ μ L 3,734
Lymphocytes/ μ L 1,027
Lymphocyte % 27.5

Lymphocyte Subset	% Total Lymph
CD3 ⁺	60.2 (50.2)
CD3 ⁺ CD4 ⁺	11.6 (7.6)
CD3 ⁺ CD8 ⁺	42.0 (35.0)
CD19 ⁺	18.3 (12.3)
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺	19.7 (14.7)

BD Multi-Check™ CD4 Low Control


Assay Values and Expected Ranges

WBC/ μ L 3.734
Lymphocytes/ μ L 1.027
Lymphocyte % 27.5

LOT BM0521L
2023-06-02

Lymphocyte Subset	% Total Lymphocytes (Range)	Cells/ μ L (Range)
CD3 ⁺	60.2 (50.2 – 70.2)	618.3 (482.2 – 754.3)
CD3 ⁺ CD4 ⁺	11.6 (7.6 – 15.6)	119.1 (71.5 – 166.8)
CD3 ⁺ CD8 ⁺	42.0 (35.0 – 49.0)	431.3 (301.9 – 560.7)
CD19 ⁺	18.3 (12.3 – 24.3)	187.9 (117.8 – 258.0)
CD3 ⁺ CD16 ⁺ CD56 ⁺	19.7 (14.7 – 24.7)	202.3 (131.5 – 273.1)

Lymphocyte Subset	BD FACSPresto™ % CD4 (Range)	BD FACSPresto™ CD4 Cells/ μ L (Range)
CD3 ⁺ CD4 ⁺	7.8 – 15.8	40.4 – 136.4



23-5207040

Australian and New Zealand Distributors

Becton Dickinson Pty Ltd.
55 Waterloo Road
Macquarie Park NSW 2113
Australia

Becton Dickinson Limited
148 George Bourke Drive
Mt. Wellington Auckland 1060
New Zealand

BD Switzerland Srl

Terre Bonite Park - A4
Route de Croisier 17
1262 Eysins, Switzerland

BD Biosciences
European Customer Support
Tel +31 20 537 20 600
help.biosciences.com


Becton, Dickinson and Company
BD Biosciences

2350 Dume Drive
San Jose, California 95131 USA


Becton Dickinson Ireland Ltd.
Dunmore Road, Dingle
Co. Louth A22 TW26
Ireland

Becton Dickinson and Company
© 2022 BD. All rights reserved.

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл. Внешний вид первичной упаковки (пробирка)

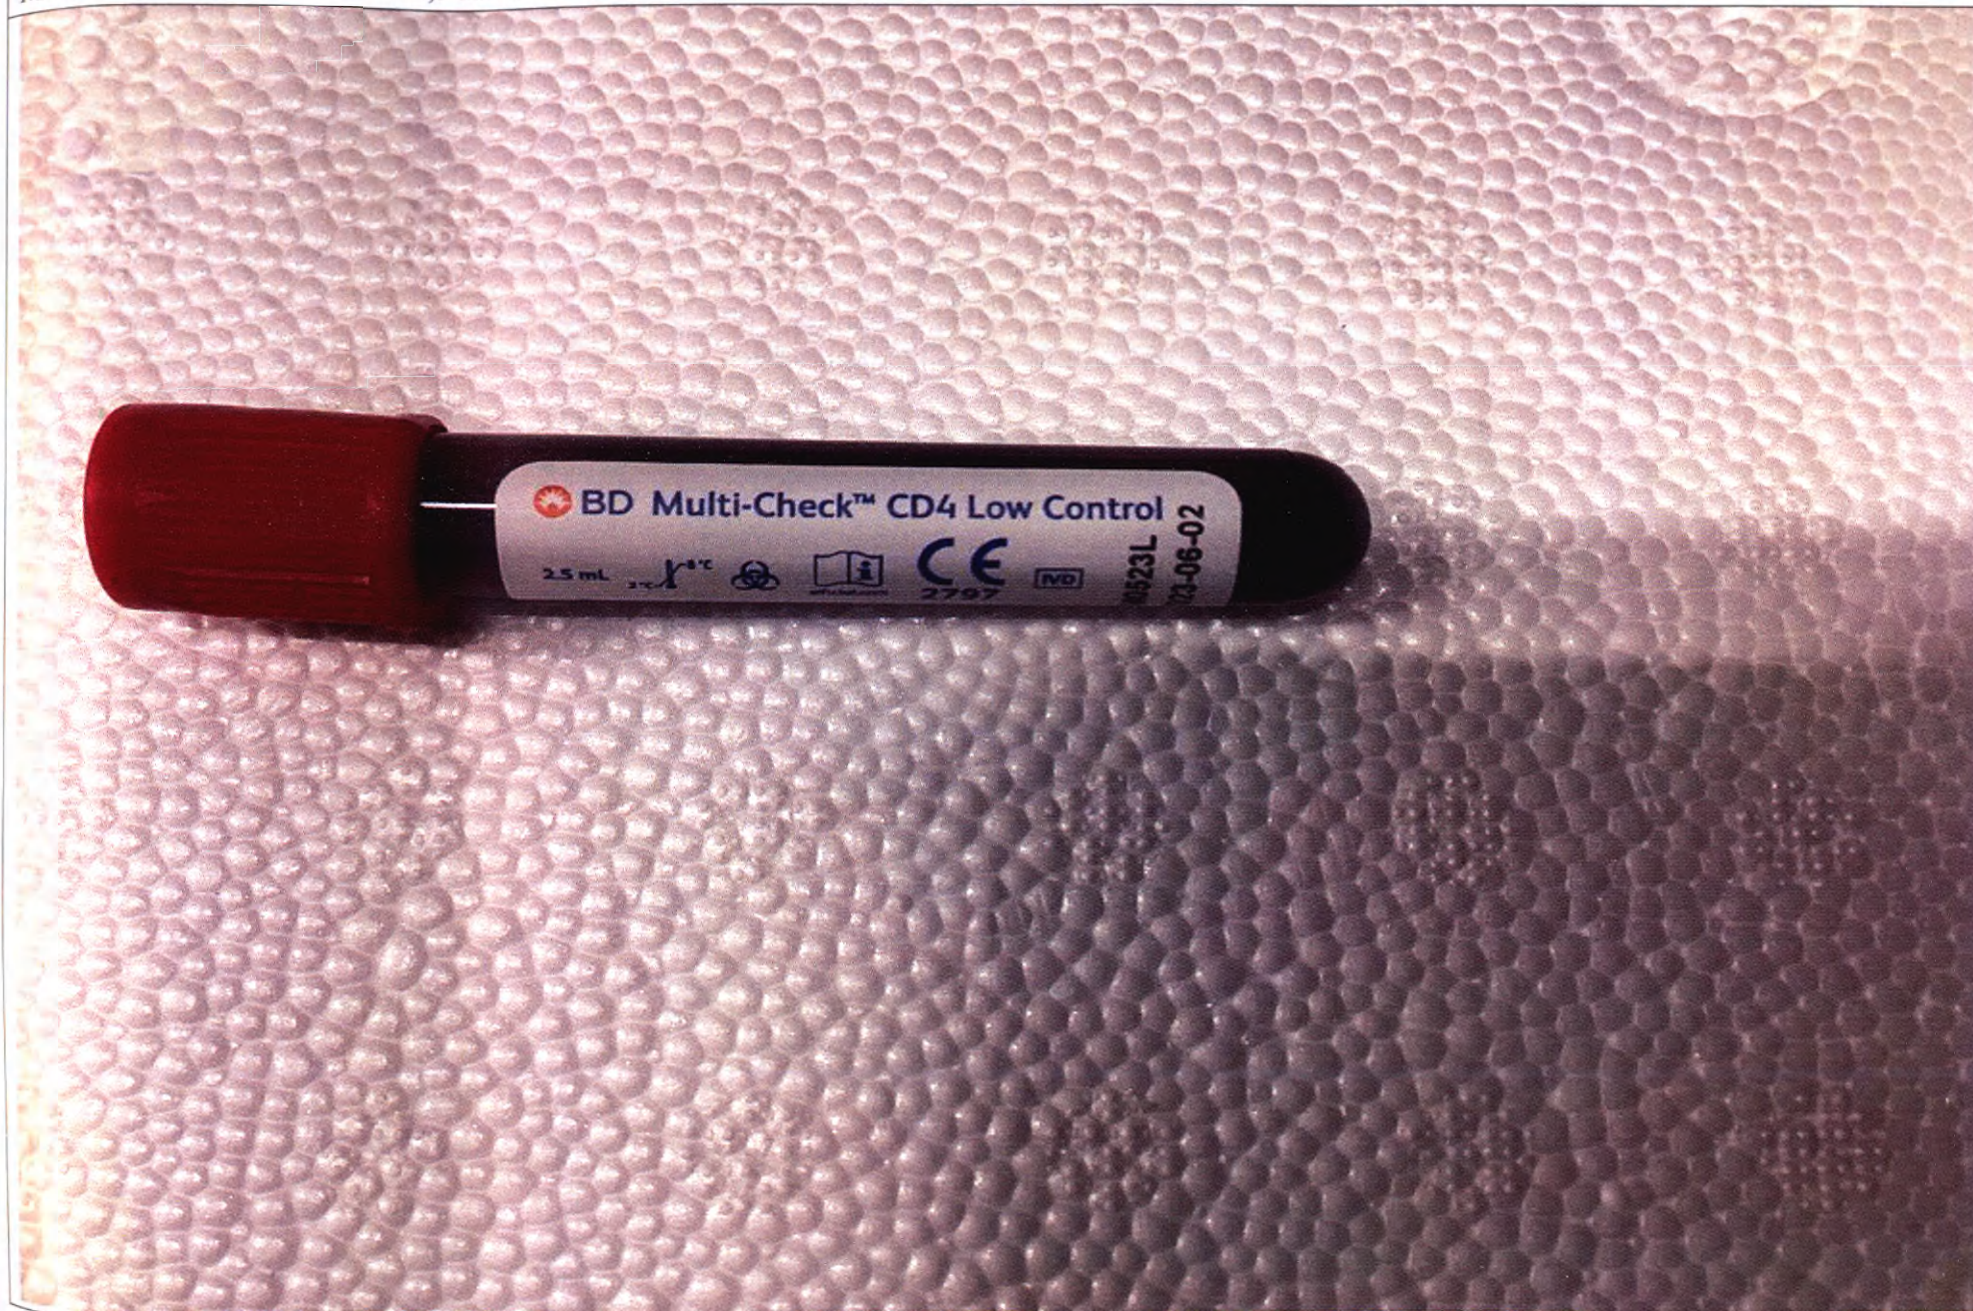

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл. Внешний вид первичной упаковки (пробирка)

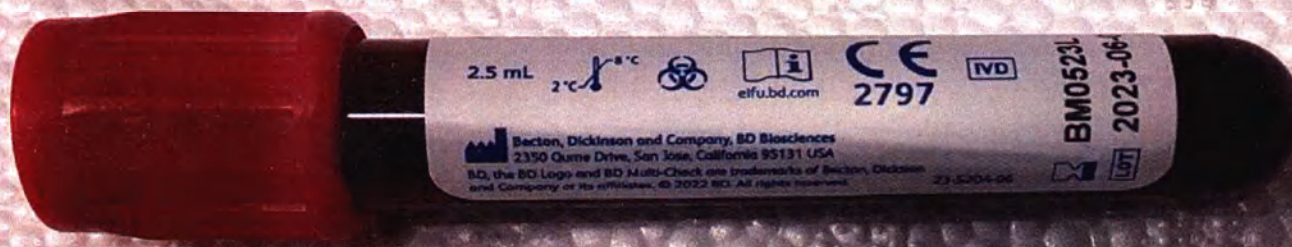

Макет дополнительной маркировки потребительской упаковки на русском языке

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии

Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл, 1 шт./уп.

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии

Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл, 1 шт./уп.

Производитель: Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз)
2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131, США

Страна происхождения: Сделано в США

Номер по каталогу **REF** см. на упаковке

Использовать до  см. на упаковке. Не использовать по окончании срока годности.

Код партии **LOT** см. на упаковке

Условия хранения: Хранить при температуре 2-8 °C.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Бектон Дикинсон Восток»

127051 Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18

Тел.: +7 (495)775-85-82; e-mail: complaints_CIS@bd.com

Регистрационное Удостоверение № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

xxxxxx

xxxx&xxxx



Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии

Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл, 2 шт./уп.

Производитель: Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз)
2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131, США

Страна происхождения: Сделано в США

Номер по каталогу **REF** см. на упаковке

Использовать до  см. на упаковке. Не использовать по окончании срока годности.

Код партии **LOT** см. на упаковке

Условия хранения: Хранить при температуре 2-8 °С.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Бектон Дикинсон Восток»

127051 Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18

Тел.: +7 (495)775-85-82; e-mail: complaints_CIS@bd.com

Регистрационное Удостоверение № _____ **от** ДД.ММ.ГГГГ

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

XXXXXX



XXXX&XXXX

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check CD4 Low для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии

Контроль BD Multi-check CD4 Low control 2,5 мл, 5 шт./уп.

Производитель: Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences (Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз)
2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131, США

Страна происхождения: Сделано в США



Номер по каталогу **REF** см. на упаковке

Использовать до см. на упаковке. Не использовать по окончании срока годности.

Код партии **LOT** см. на упаковке

Условия хранения: Хранить при температуре 2-8 °C.

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Бектон Дикинсон Восток»

127051 Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 24/27, 2 этаж, помещение I, комната 18

Тел.: +7 (495)775-85-82; e-mail: complaints_CIS@bd.com

Регистрационное Удостоверение № _____ от ДД.ММ.ГГГГ

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

XXXXXX

XXXX&XXXX

