



Фотографические изображения медицинского изделия

**Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check для
иммунофенотипирования методом проточной цитометрии, в вариантах
исполнения**

Производитель: Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences
(«Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз»), США


Специалист по регистрации
медицинских изделий
ООО «Бектон Дикинсон Восток»

М.П.





Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии.
Контроль BD Multi-check control 2,5 мл., 2 шт./уп., Инструкция по применению, Лист с ожидаемыми диапазонами значений («Assay Ranges»). Общий вид.

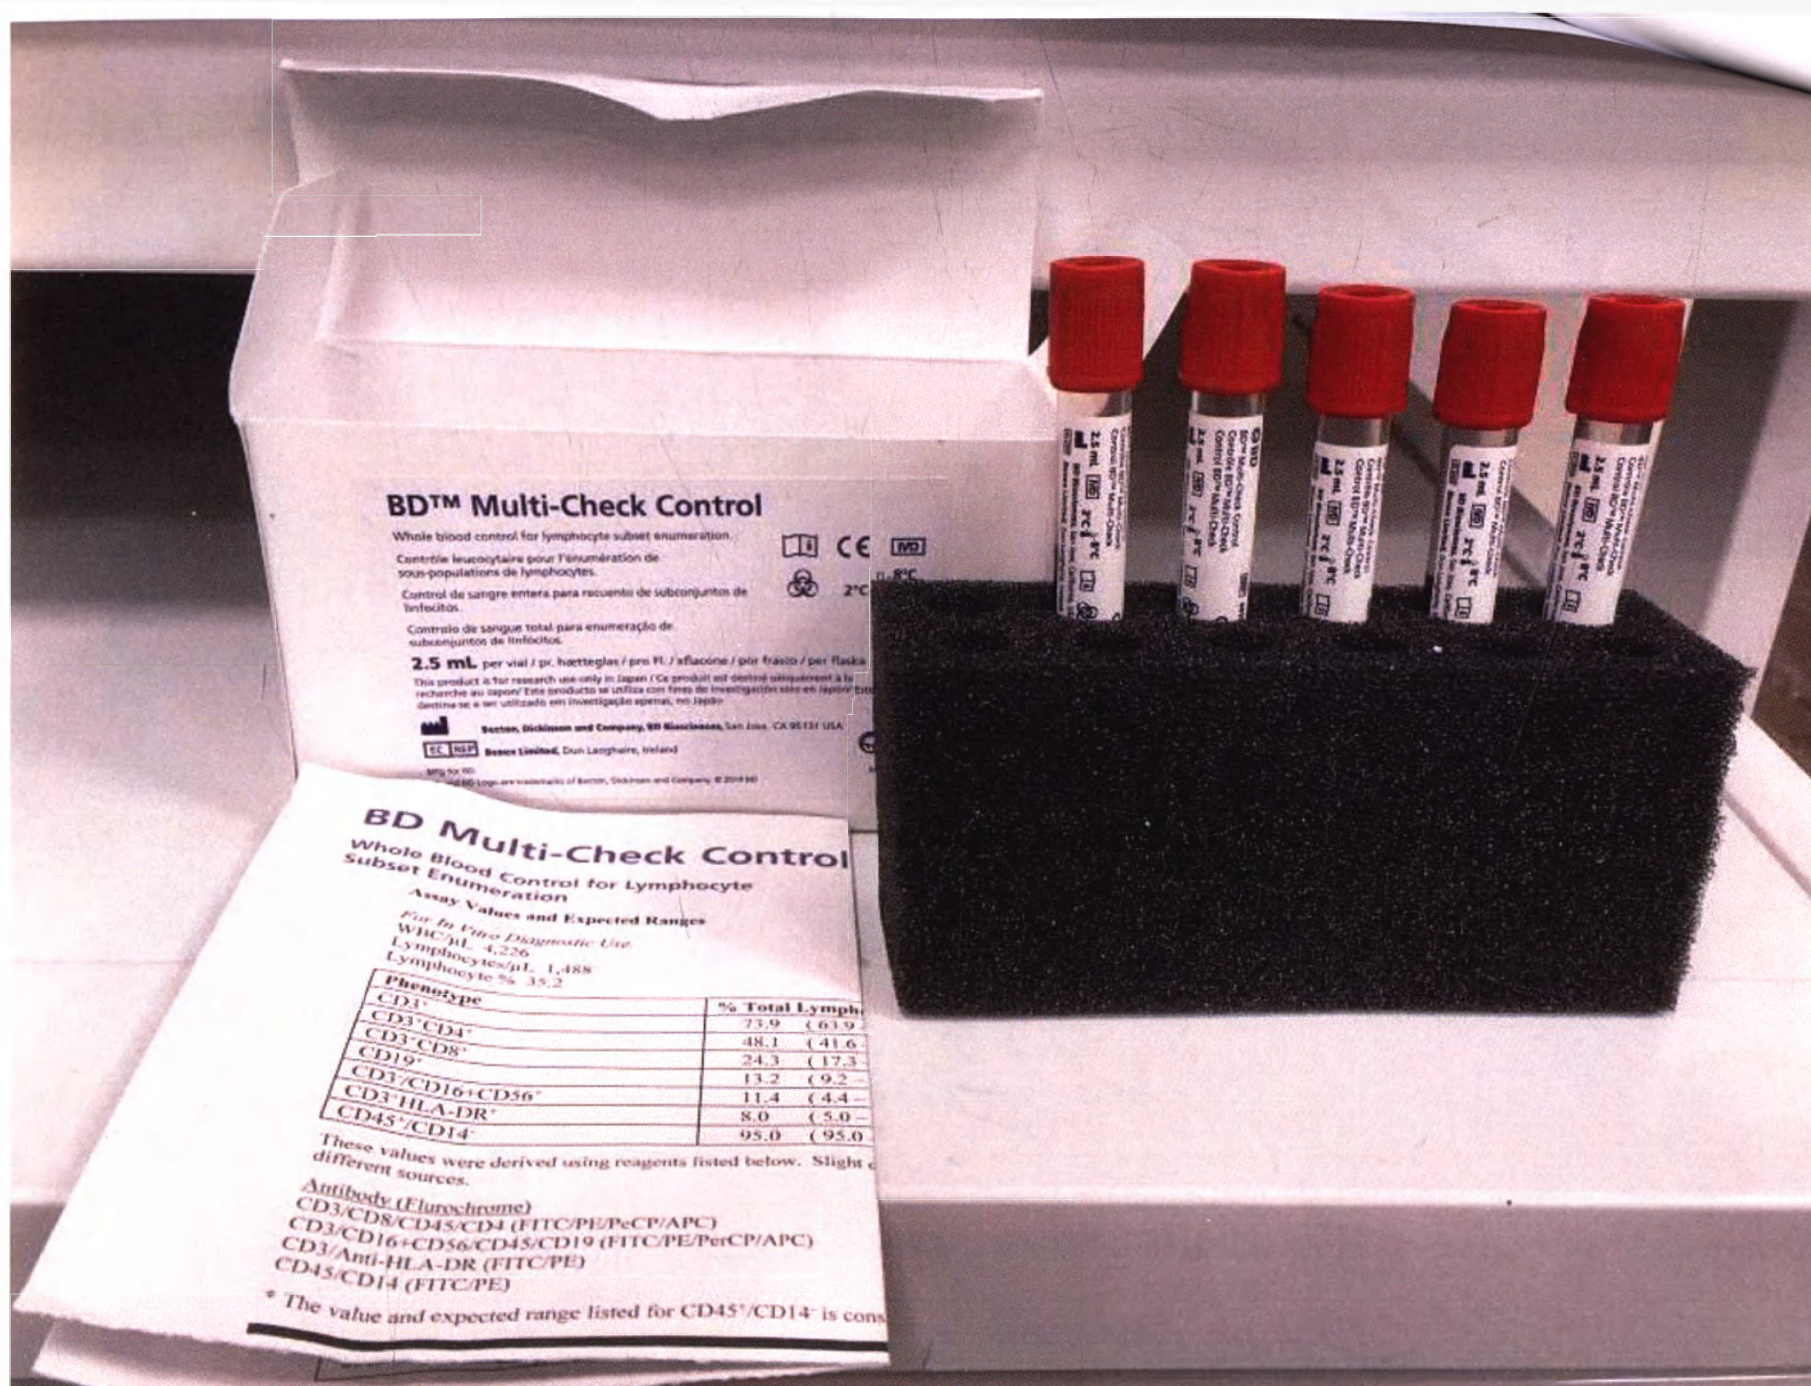

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии.
Контроль BD Multi-check control 2,5 мл., 5 шт./уп., Инструкция по применению, Лист с ожидаемыми диапазонами значений («Assay Ranges»). Общий вид.



Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Контроль BD Multi-check control 2,5 мл. Внешний вид первичной упаковки (пробирка)

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии

1. Контроль BD Multi-check control 2,5 мл, 1 шт./уп., в составе:
 - 1.1 Контроль BD Multi-check control 2,5 мл - 1 шт./уп.;
 - 1.2 Лист с ожидаемыми диапазонами значений («Assay Ranges»);
 - 1.3 Инструкция по применению.

Производитель:

Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences
(Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз)
2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131, США

Страна происхождения:

Сделано в США

Номер по каталогу **REF**: см. на упаковке

Использовать до : см. на упаковке. Не использовать по окончании срока годности.

Код партии **LOT**: см. на упаковке

Условия хранения: Хранить при температуре 2-8 °C.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток»
127051 Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 24/27,
2 этаж, помещение I, комната 18
Тел.: +7 (495)775-85-82; e-mail: complaints_CIS@bd.com



Регистрационное Удостоверение № _____ от ДД.ММ.ГГГГ г.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

XXXXXX

XXXX&XXXX

Макет дополнительной маркировки на русском языке варианта исполнения
«Контроль BD Multi-check control 2,5 мл, 1 шт./уп.»

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии

2. Контроль BD Multi-check control 2,5 мл, 2 шт./уп, в составе:

2.1 Контроль BD Multi-check control 2,5 мл -2 шт./уп.;

2.2 Лист с ожидаемыми диапазонами значений («Assay Ranges»);

2.3 Инструкция по применению.

Производитель:

Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences

(Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз)

2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131, США

Страна происхождения:

Сделано в США

Номер по каталогу **REF**: см. на упаковке

Использовать до Σ : см. на упаковке. Не использовать по окончании срока годности.

Код партии **LOT**: см. на упаковке

Условия хранения: Хранить при температуре 2-8 °C.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток»

127051 Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 24/27,

2 этаж, помещение I, комната 18

Тел.: +7 (495)775-85-82; e-mail: complaints_CIS@bd.com



Регистрационное Удостоверение № _____ от ДД.ММ.ГГГГ г.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

XXXXXX

XXXX&XXXX

Макет дополнительной маркировки на русском языке варианта исполнения

«Контроль BD Multi-check control 2,5 мл, 2 шт./уп.»

Контрольный образец цельной крови BD Multi-Check для иммунофенотипирования методом проточной цитометрии

3. Контроль BD Multi-check control 2,5 мл, 5 шт./уп., в составе:

3.1 Контроль BD Multi-check control 2,5 мл -5 шт./уп.;

3.2 Лист с ожидаемыми диапазонами значений («Assay Ranges»);

3.3 Инструкция по применению.

Производитель:

Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences

(Бектон, Дикинсон энд Компани, БД Байосайенсиз)

2350 Qume Drive, San Jose, California, 95131, США

Страна происхождения:

Сделано в США

Номер по каталогу **REF**: см. на упаковке

Использовать до : см. на упаковке. Не использовать по окончании срока годности.

Код партии **LOT**: см. на упаковке

Условия хранения: Хранить при температуре 2-8 °C.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Бектон Дикинсон Восток»

127051 Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 24/27,

2 этаж, помещение I, комната 18

Тел.: +7 (495)775-85-82; e-mail: complaints_CIS@bd.com



Регистрационное Удостоверение № _____ от ДД.ММ.ГГГГ г.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ

XXXXXX

XXXX&XXXX

Макет дополнительной маркировки на русском языке варианта исполнения

«Контроль BD Multi-check control 2,5 мл, 5 шт./уп.»

ПРОШТО, ПРОДУМИРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПОДПИСЬЮ И ПЕЧАТЬЮ
ЛИСТОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕГИСТРАЦИИ МИ
СКУЛЧИНА Е.В.

