




«Стерилизатор паровой «STERIVAP» («СТЕРИВАП») в вариантах исполнения с принадлежностями»


Фотографические изображения



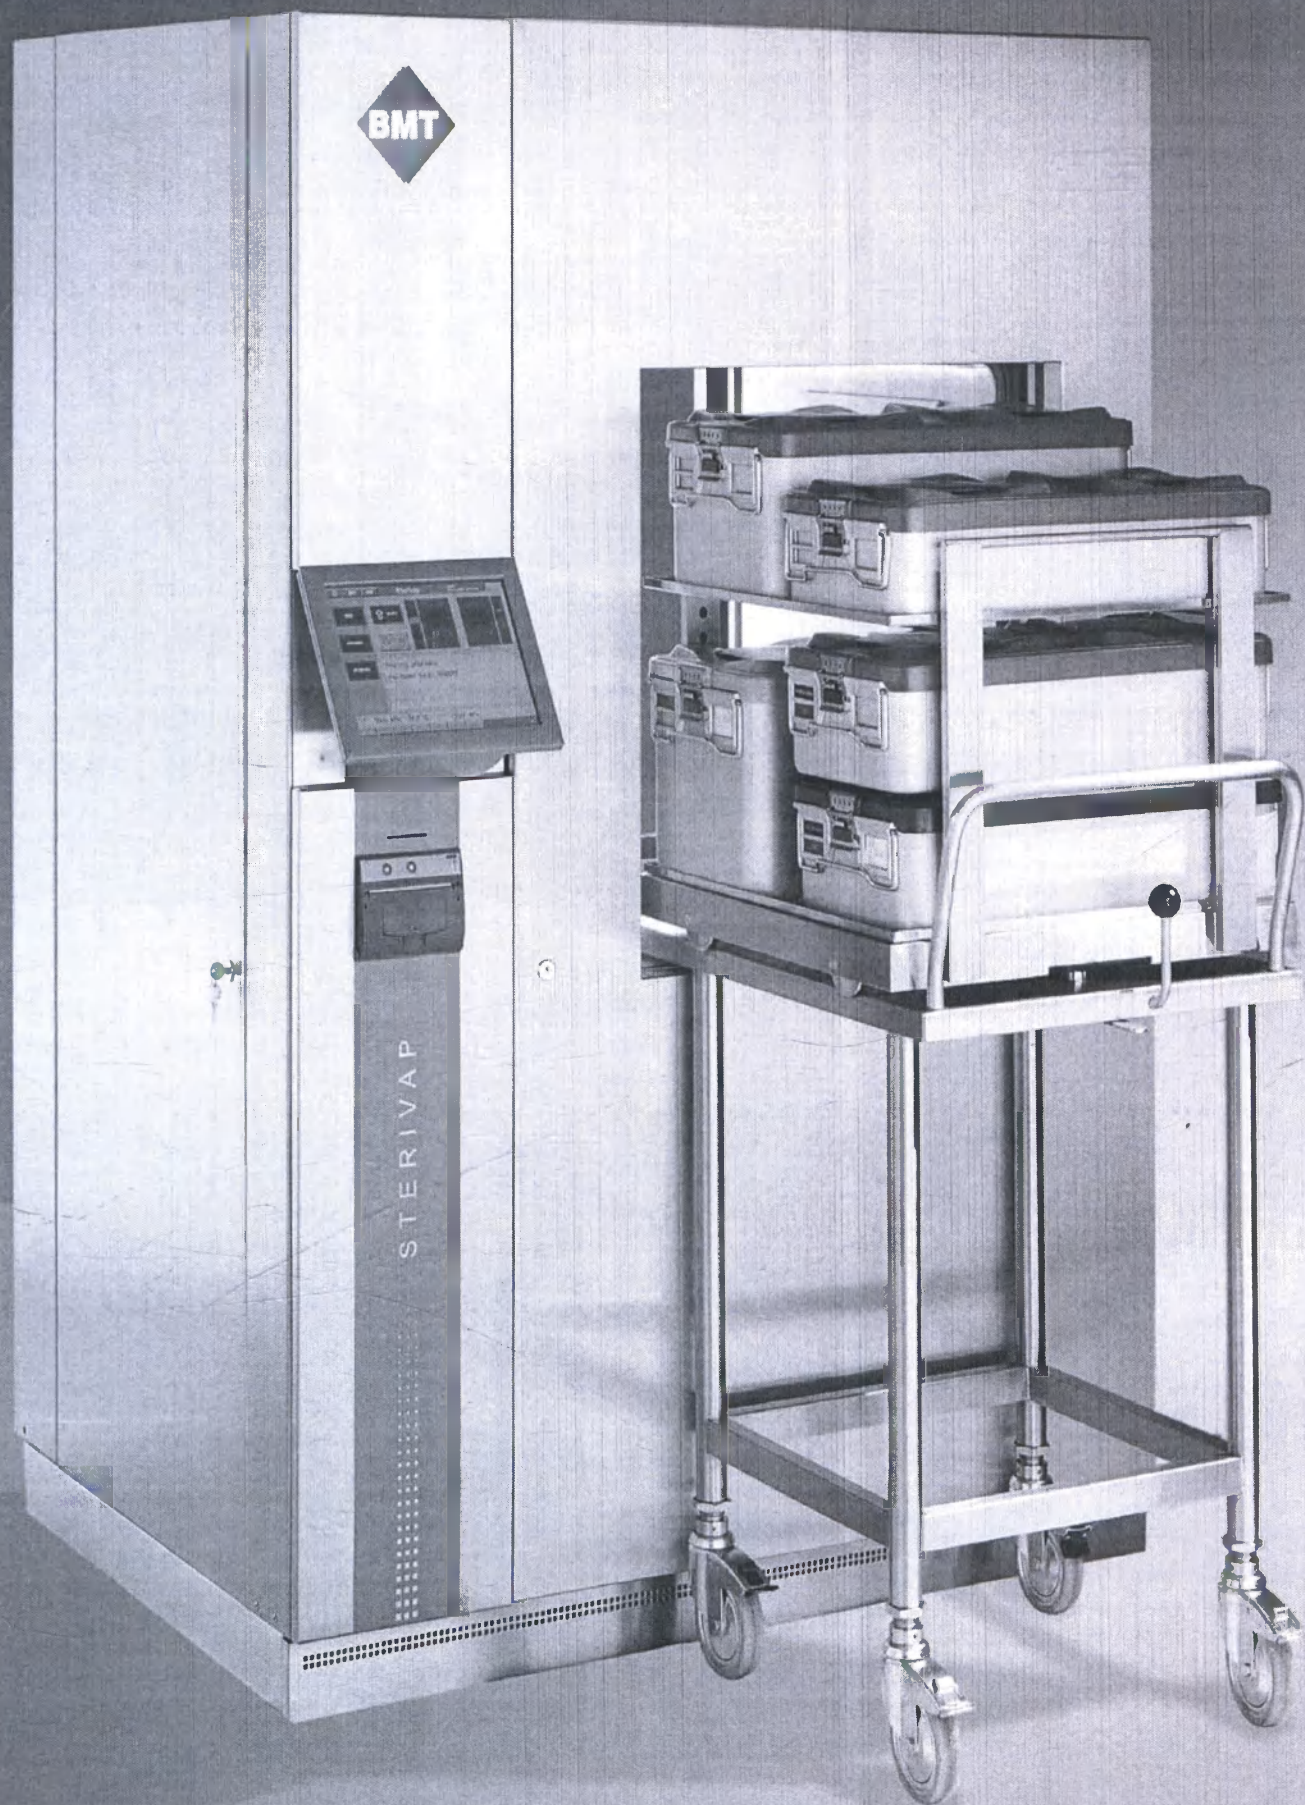

Стерилизатор паровой «STERIVAP» («СТЕРИВАП»), вариант исполнения SPHP IL



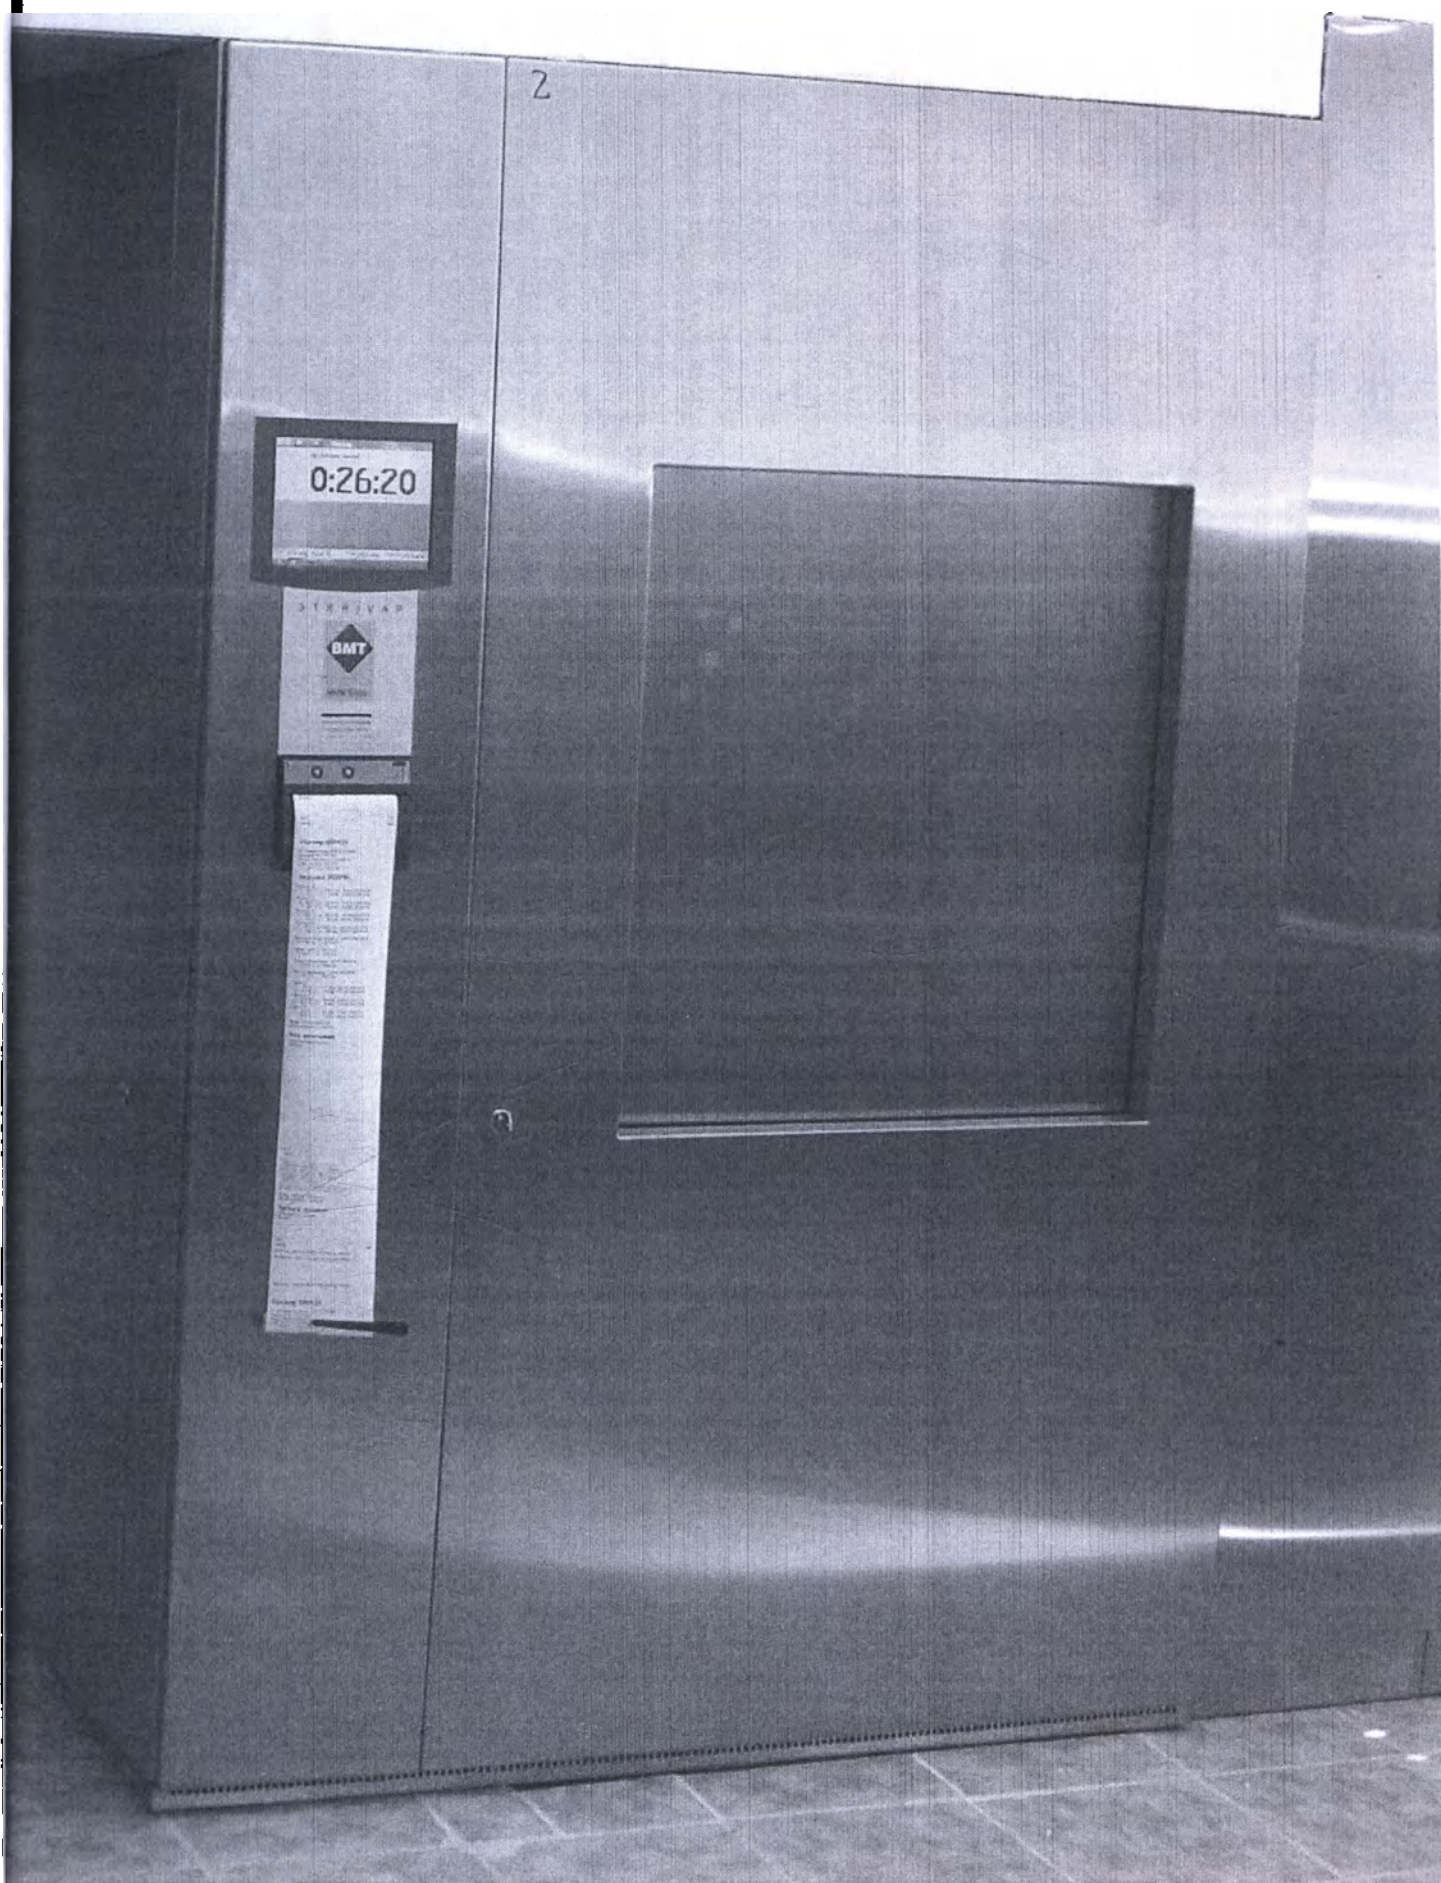

Стерилизатор паровой «STERIVAP» («СТЕРИВАП»), вариант исполнения SPHP E (правое исполнение)


1





SUNIVAR

BMT


BMT

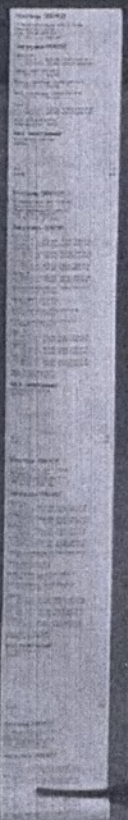


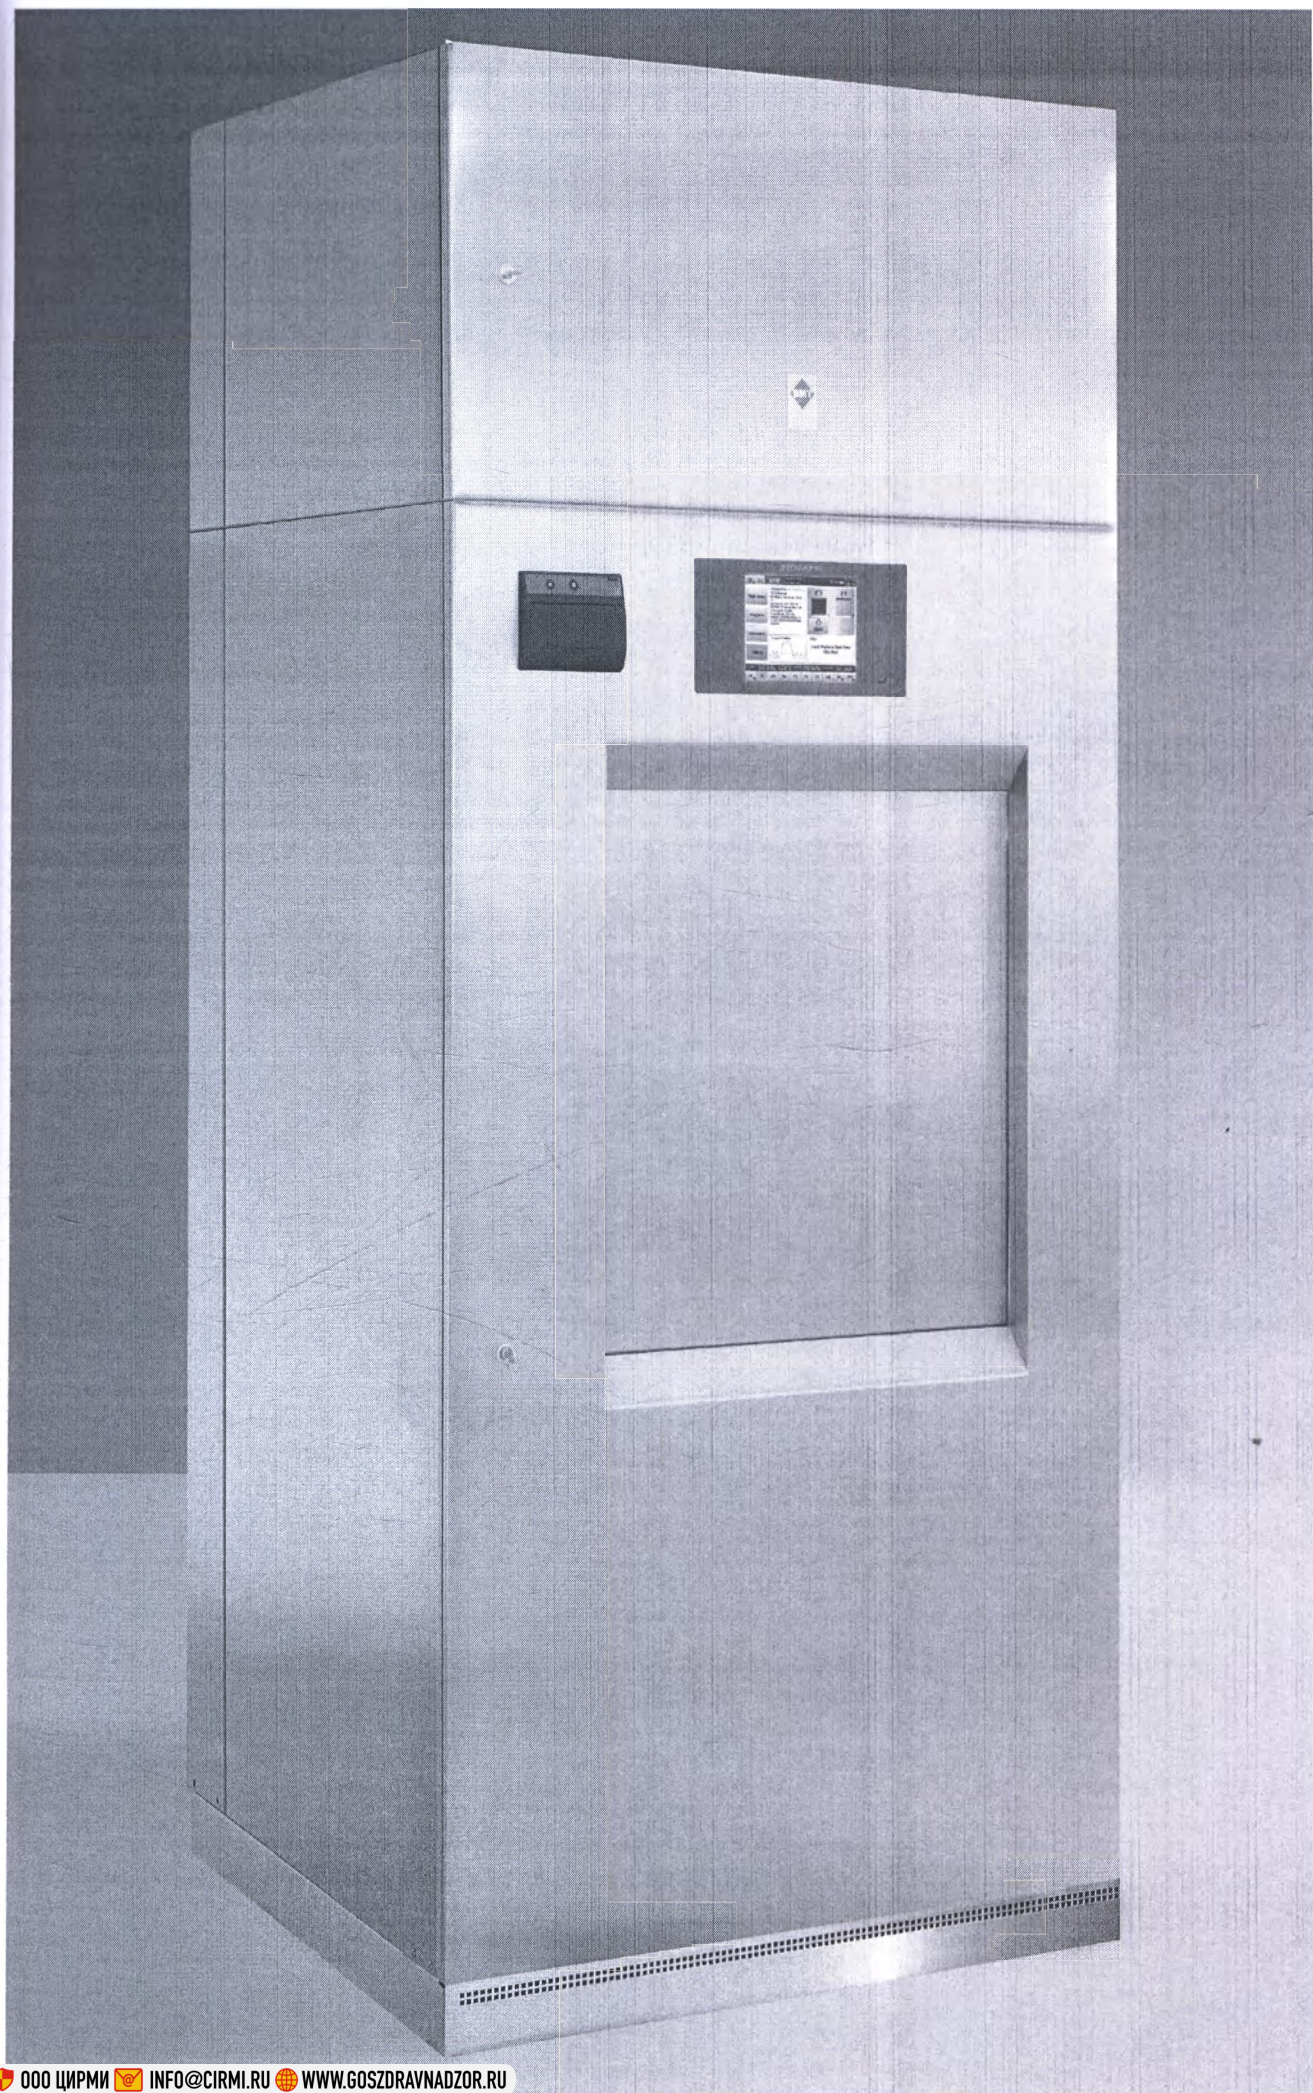


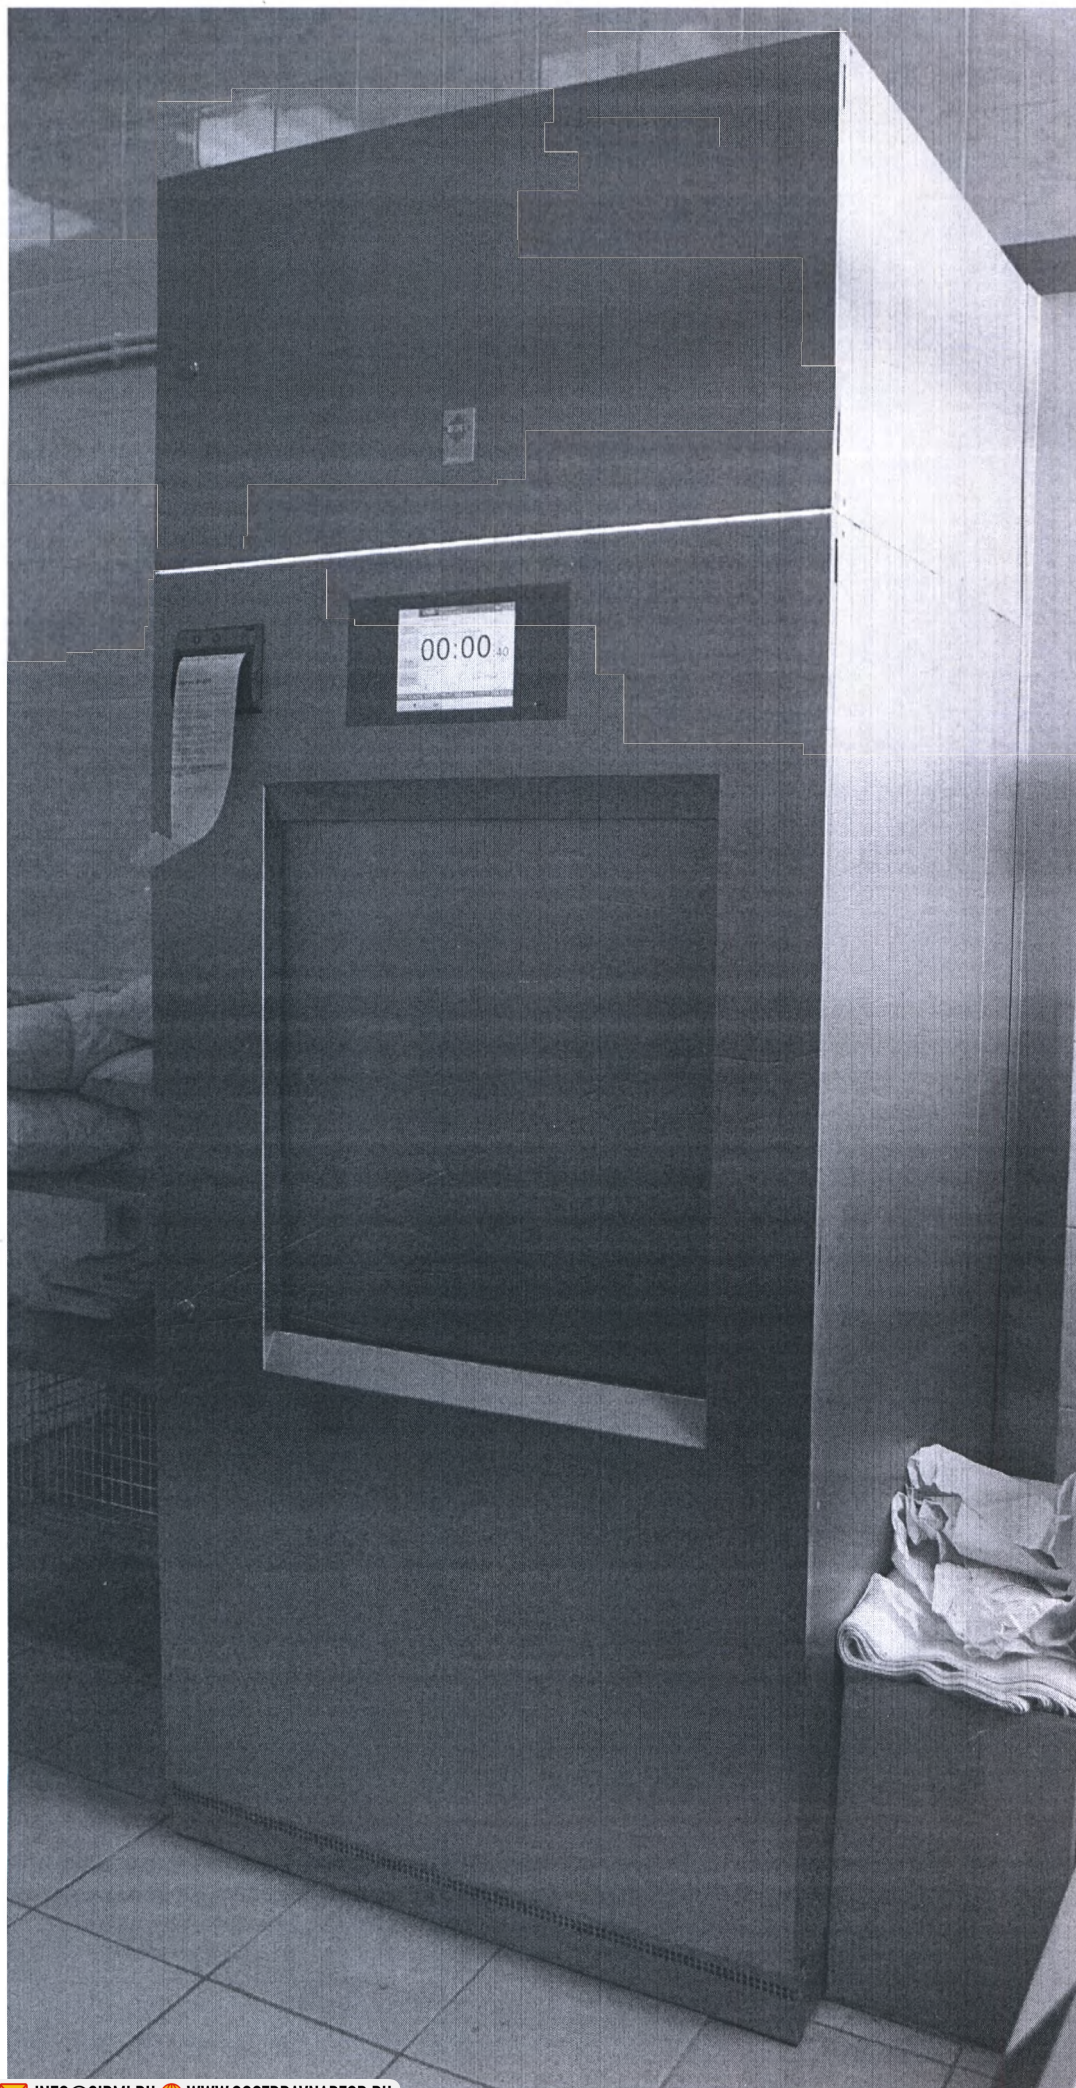





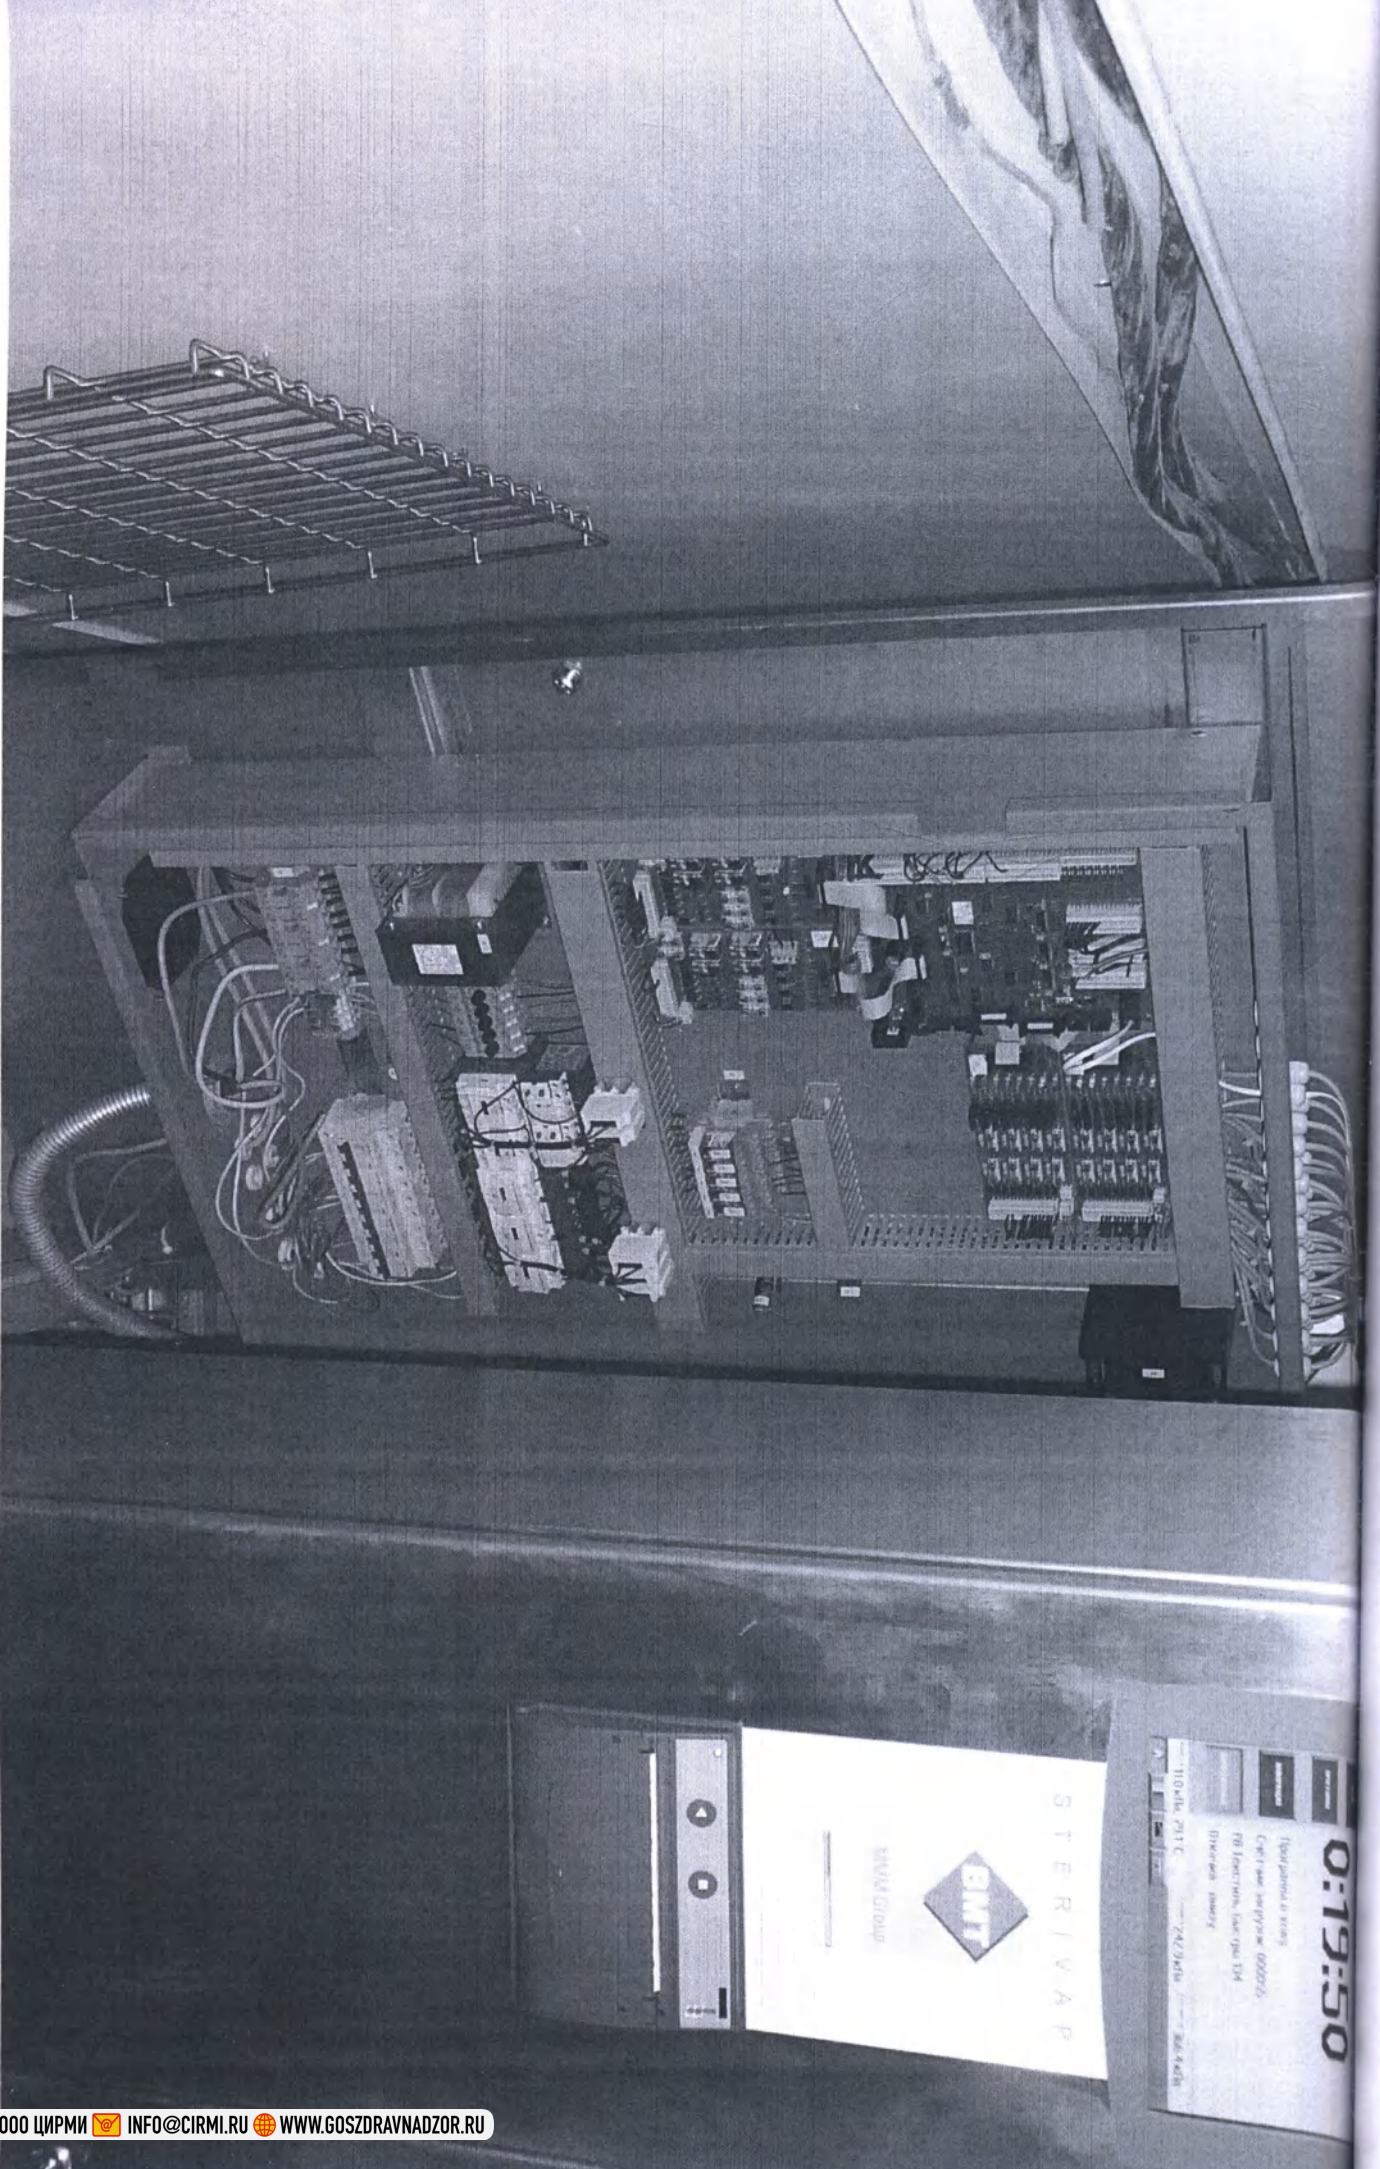


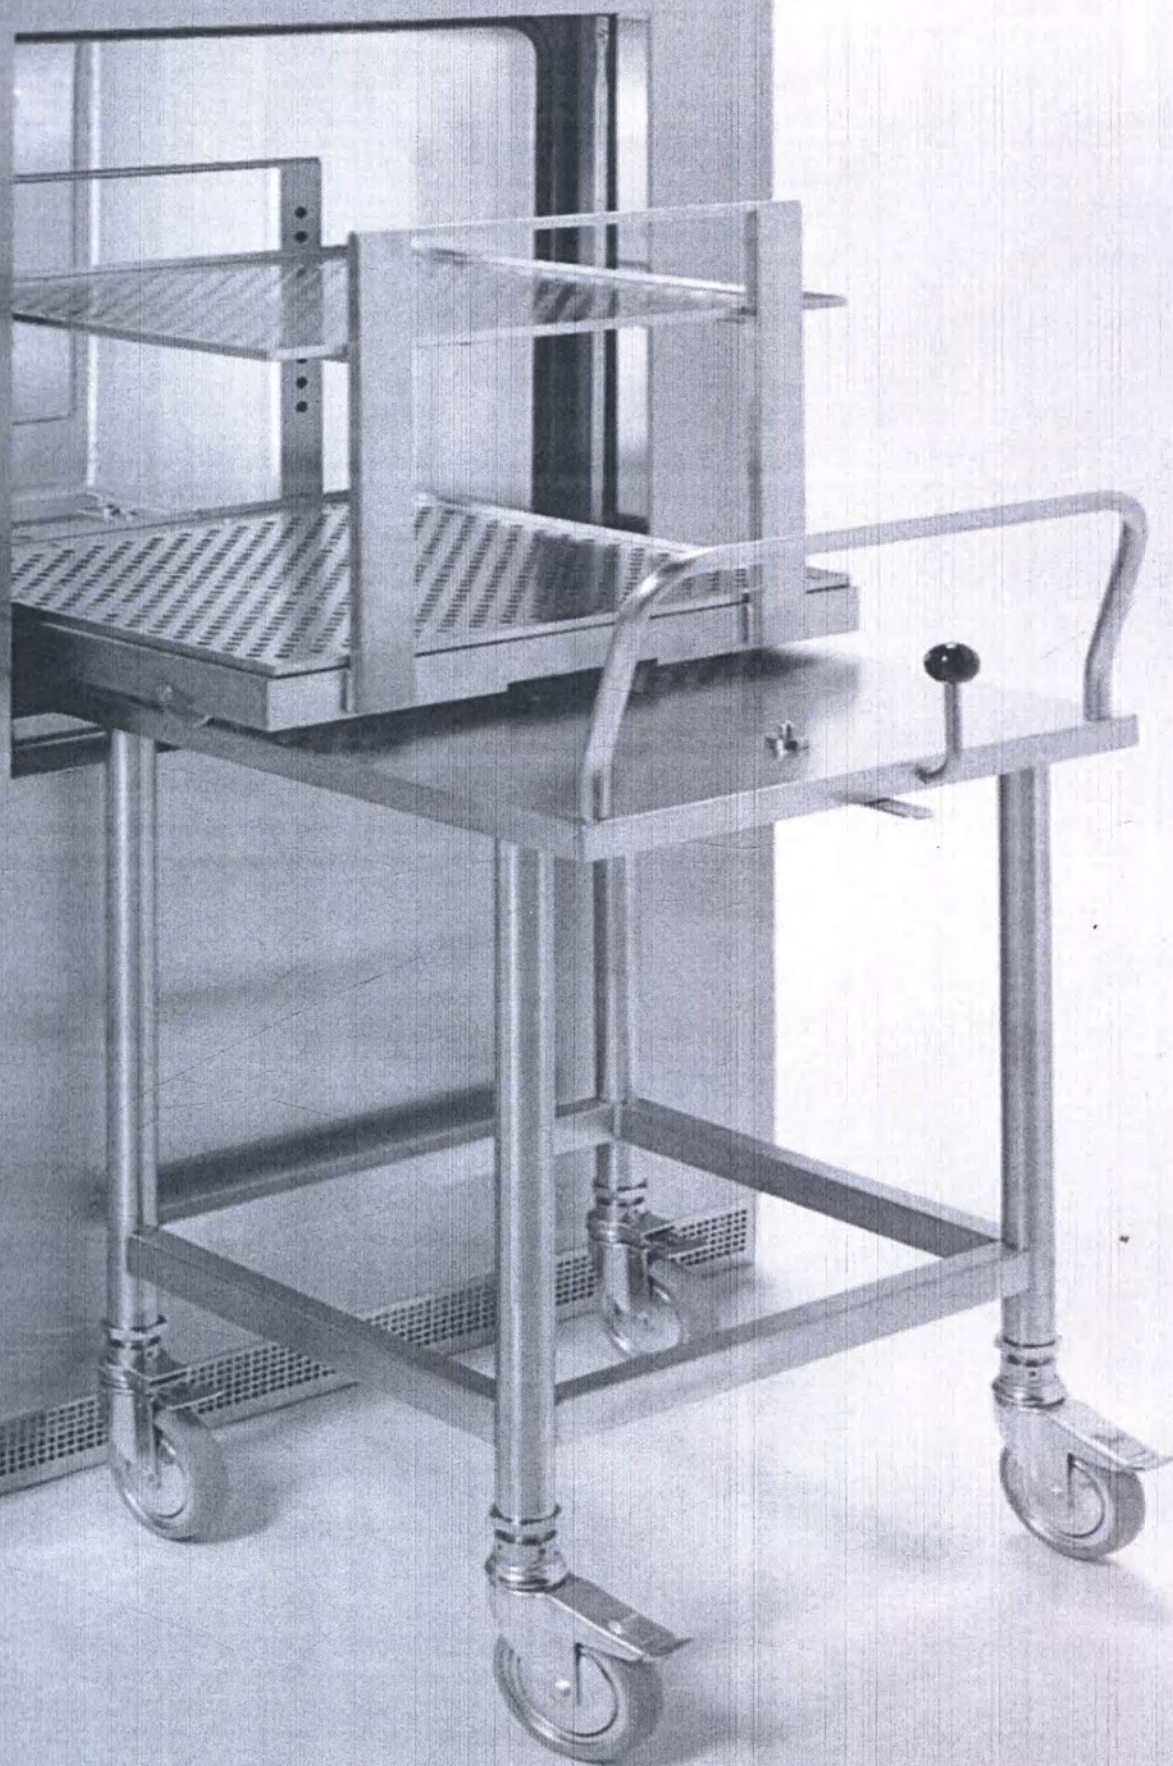

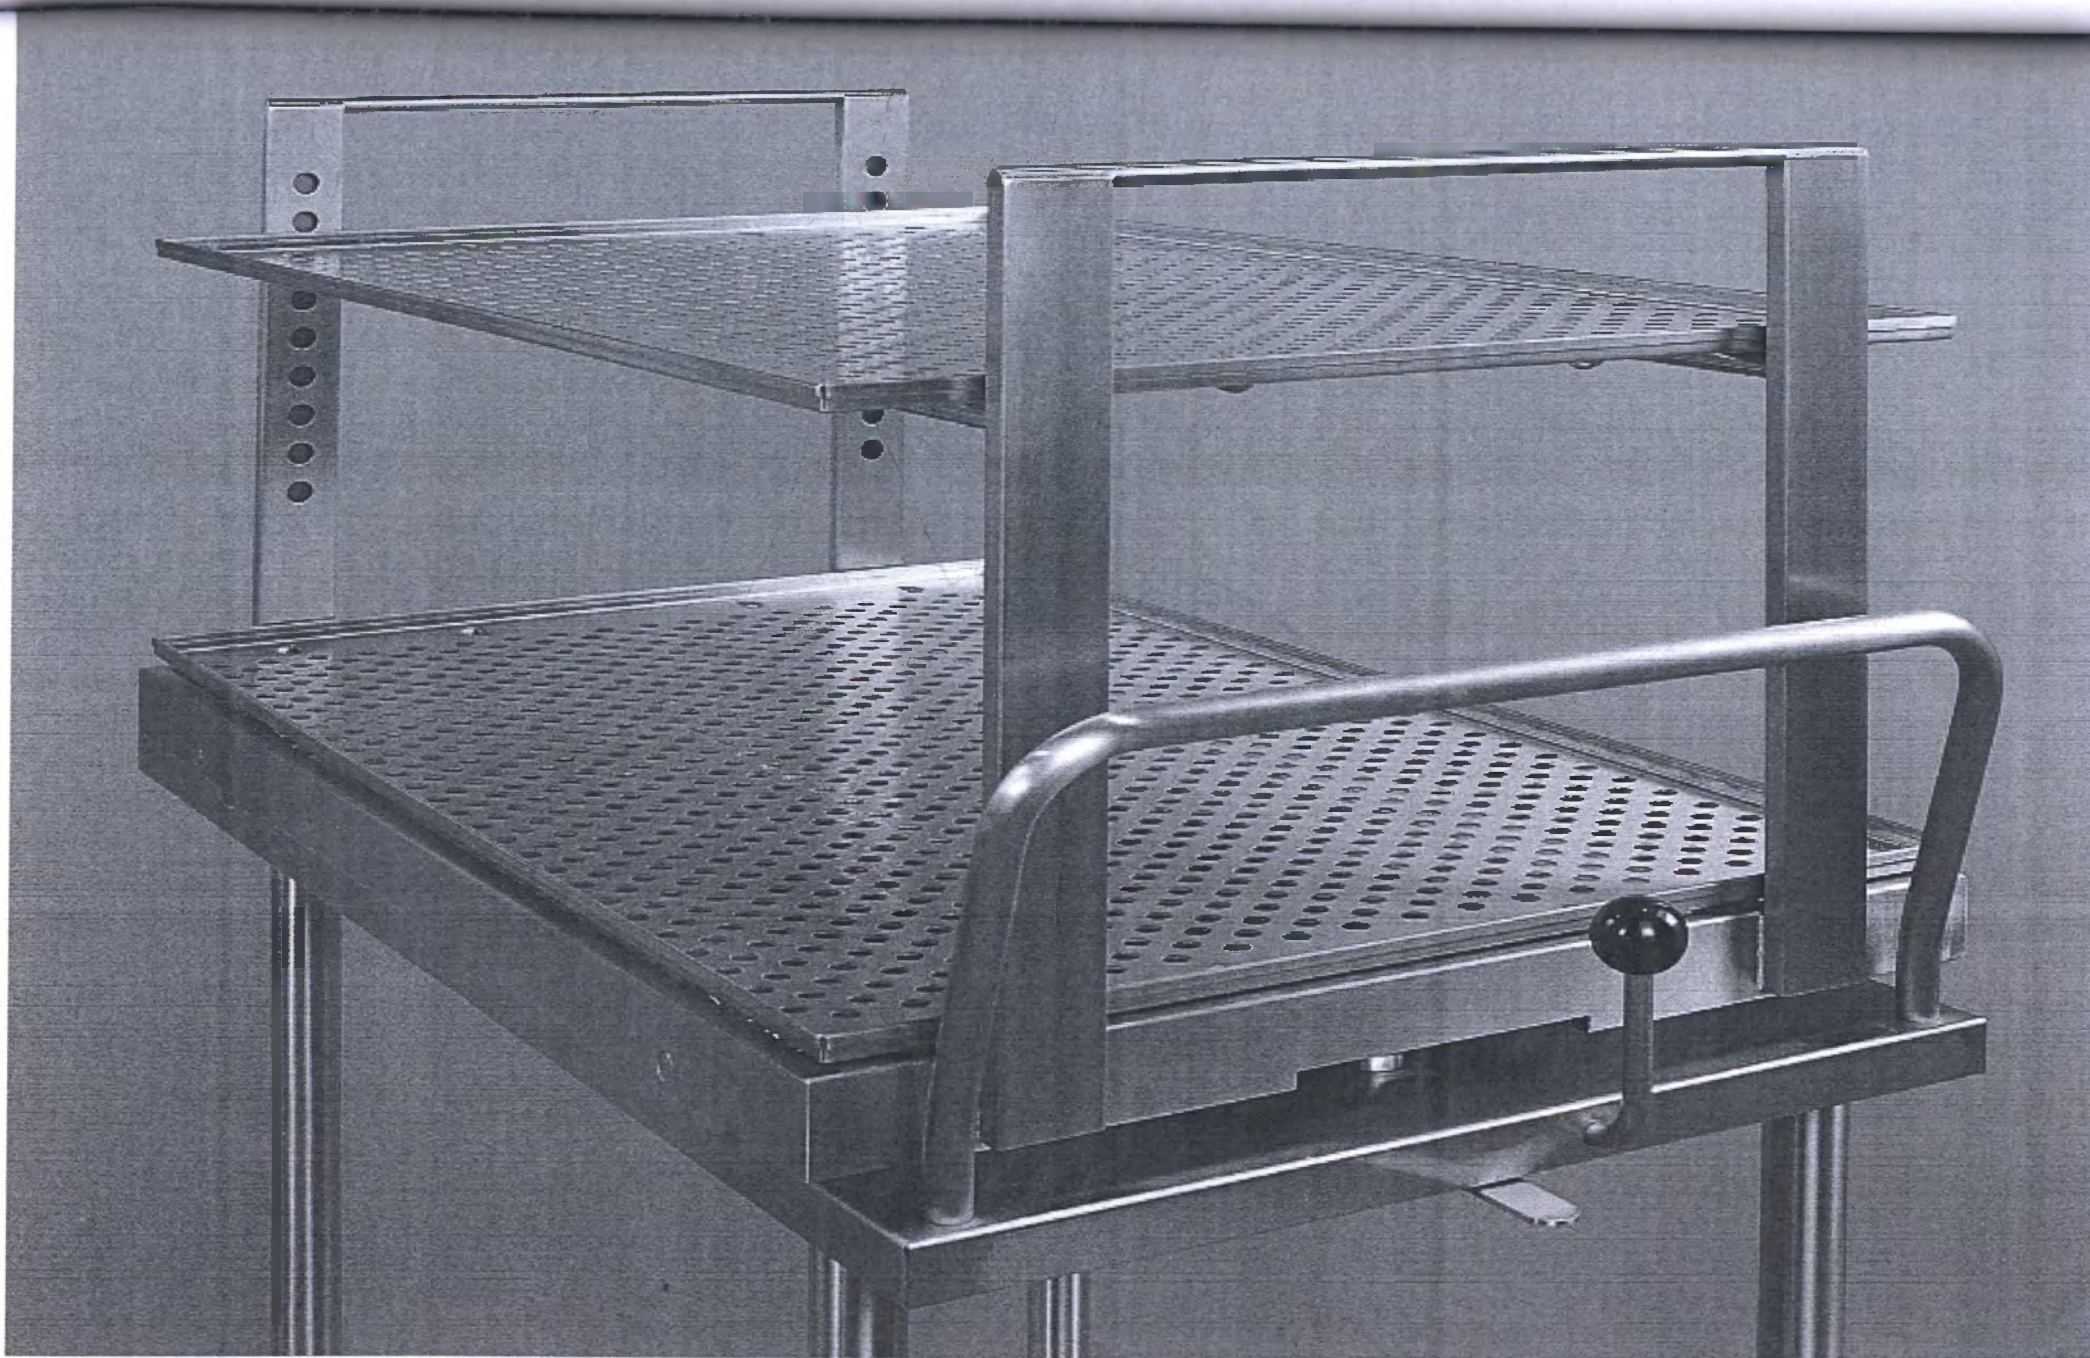


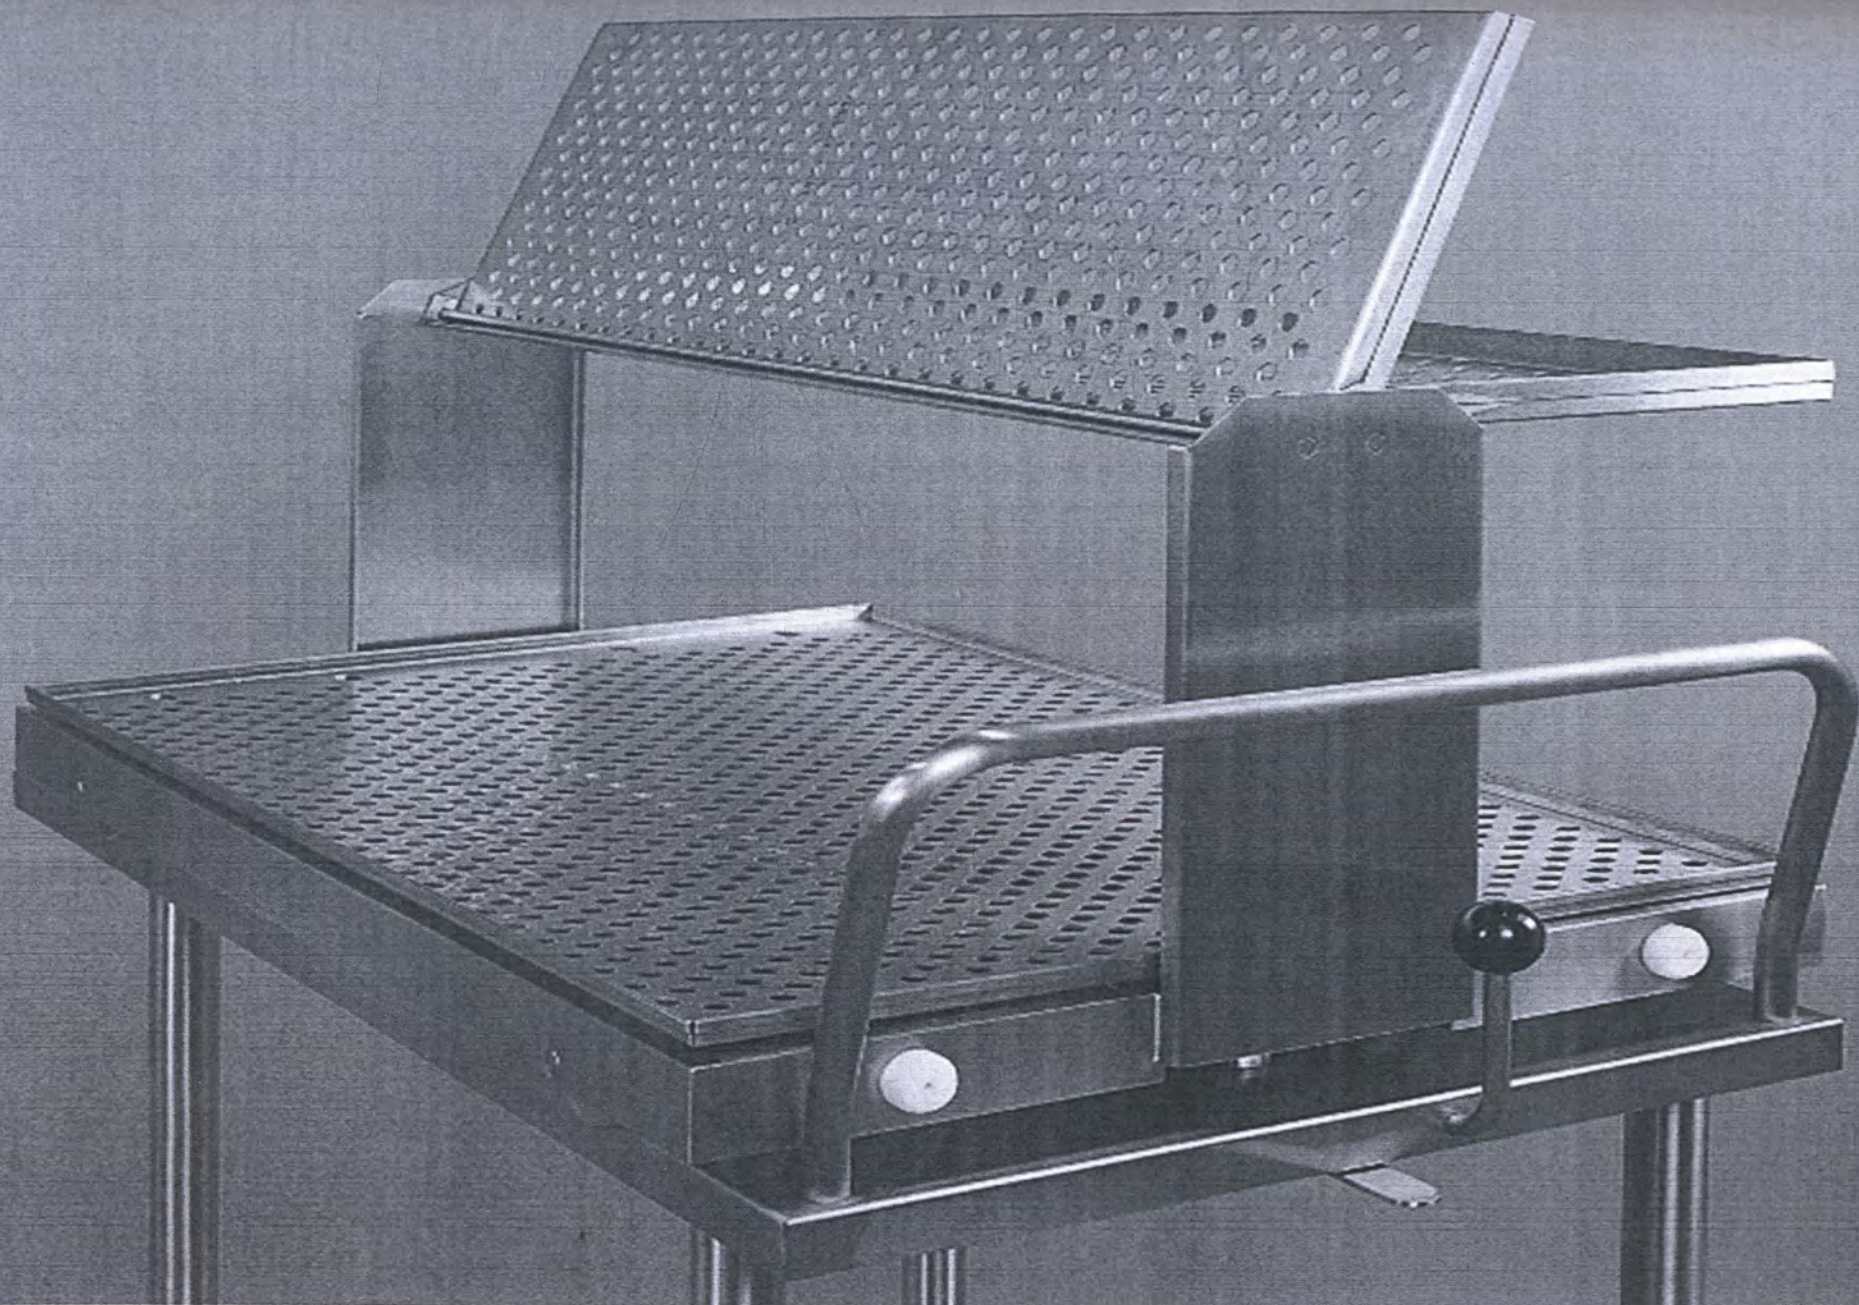

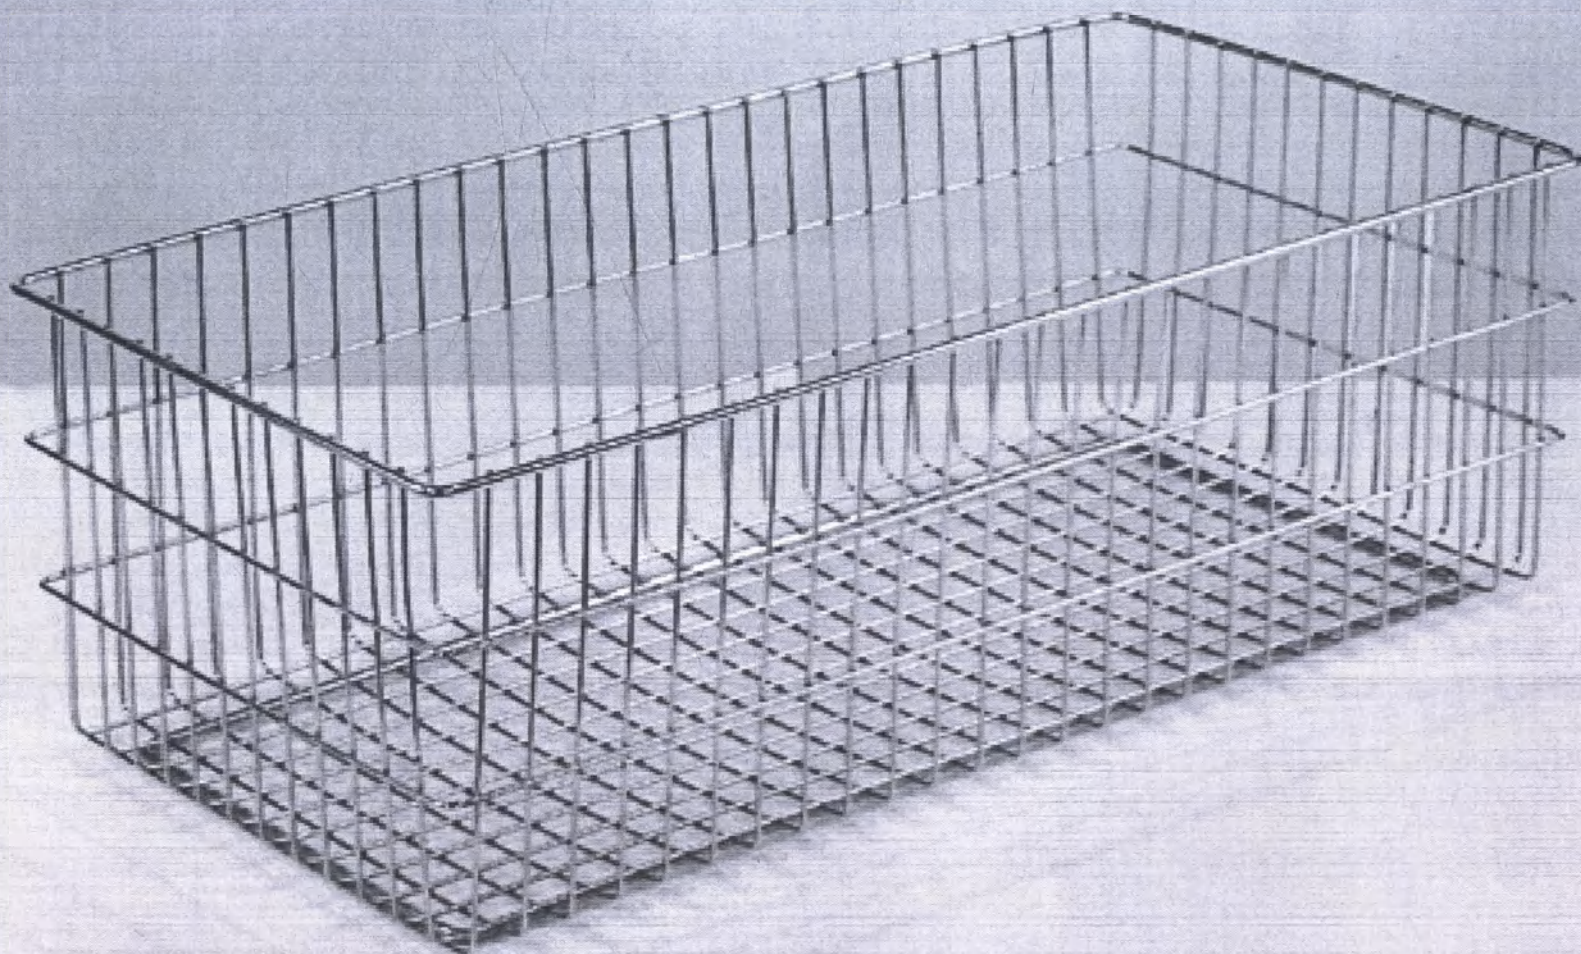


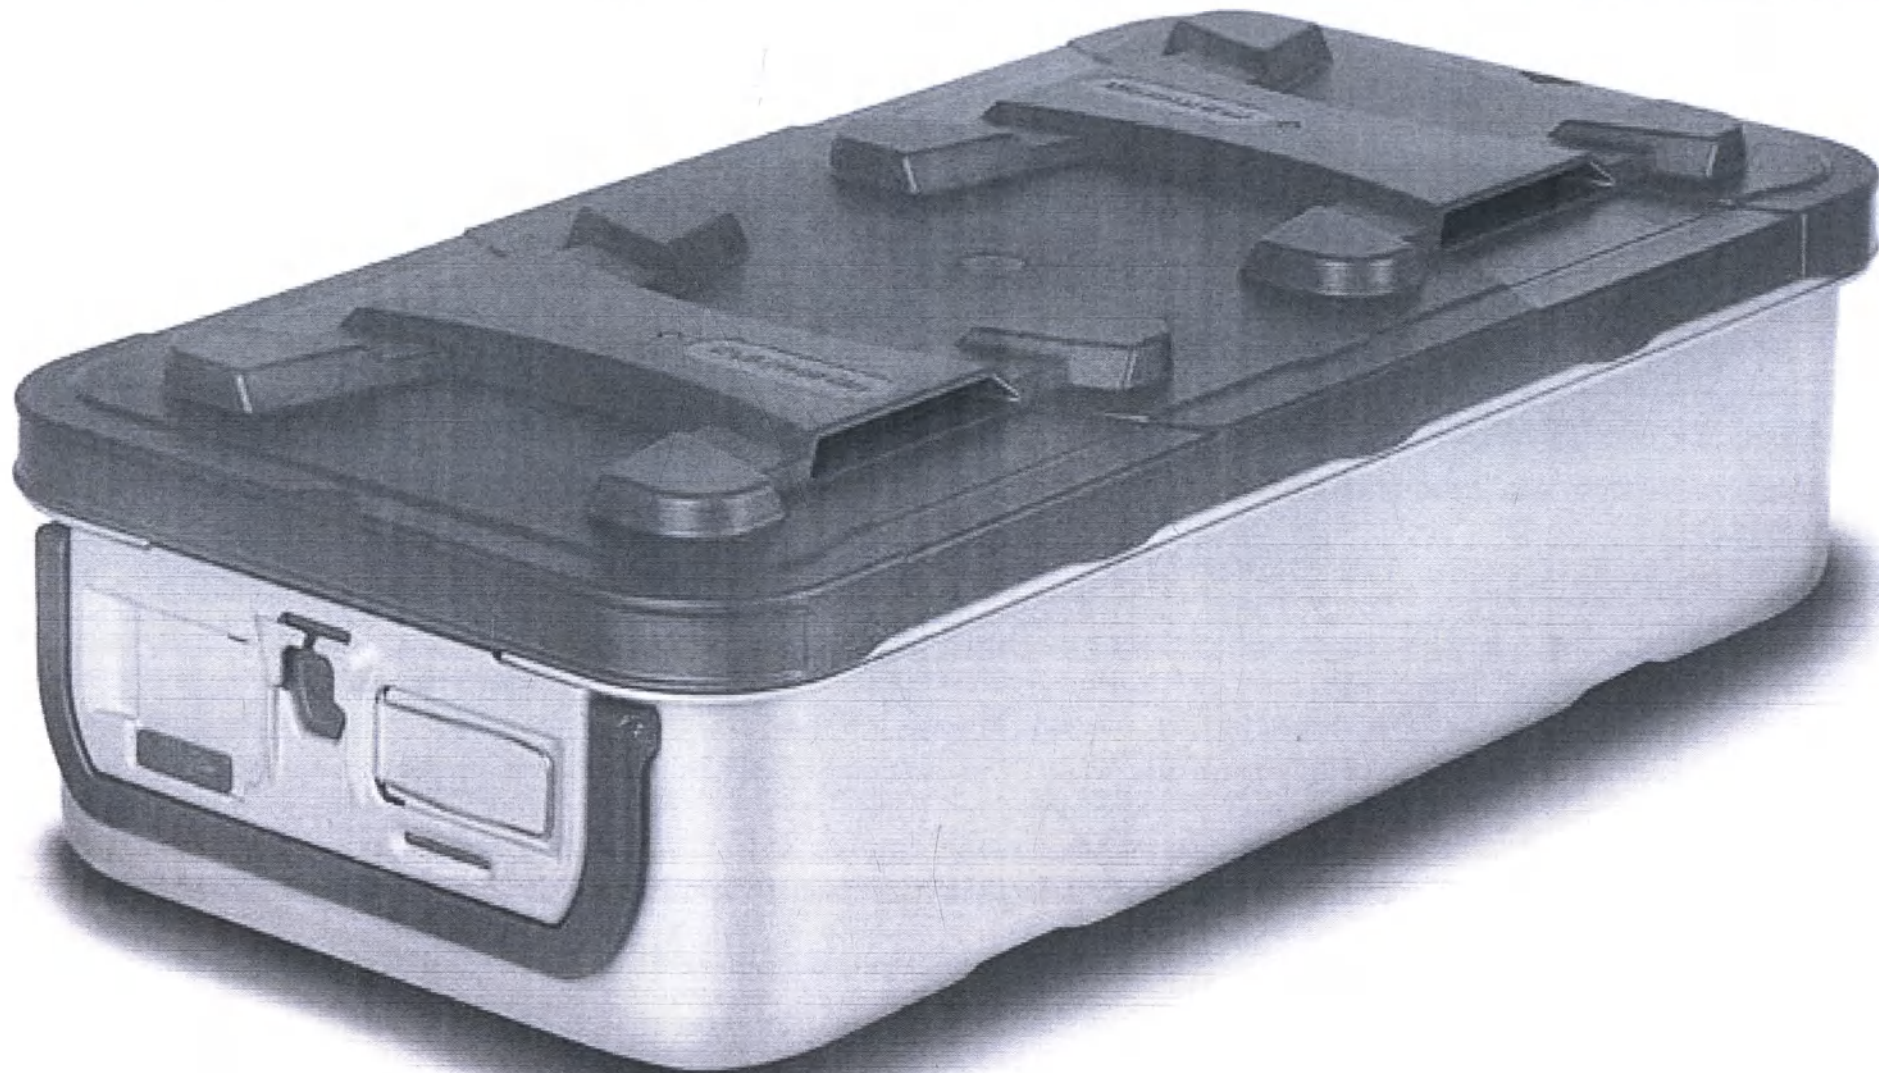


Коробка из нержавеющей стали

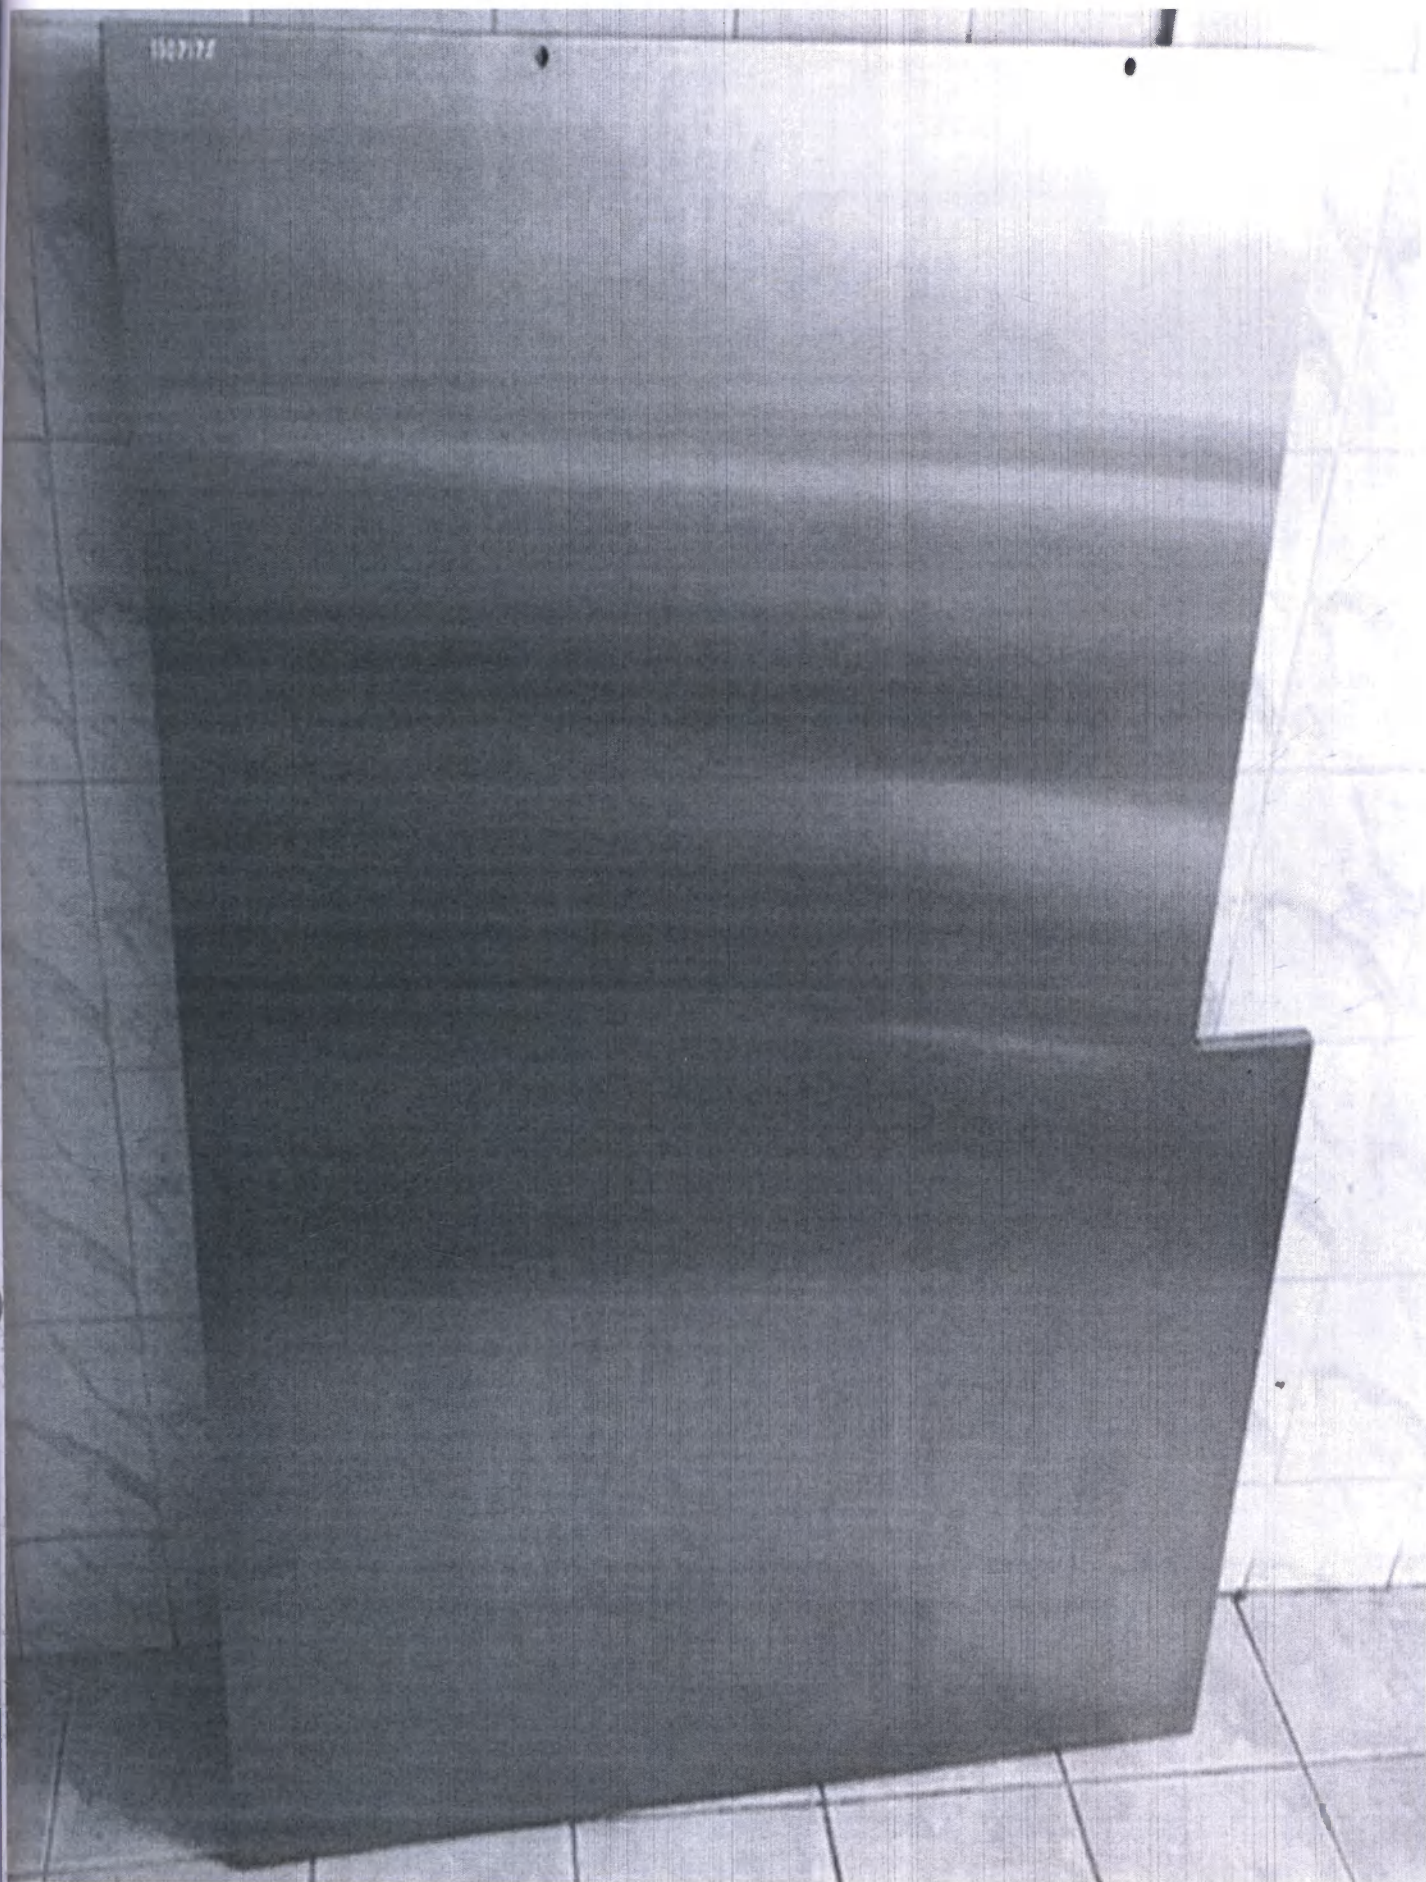


Комплект облицовочных панелей из нержавеющей стали

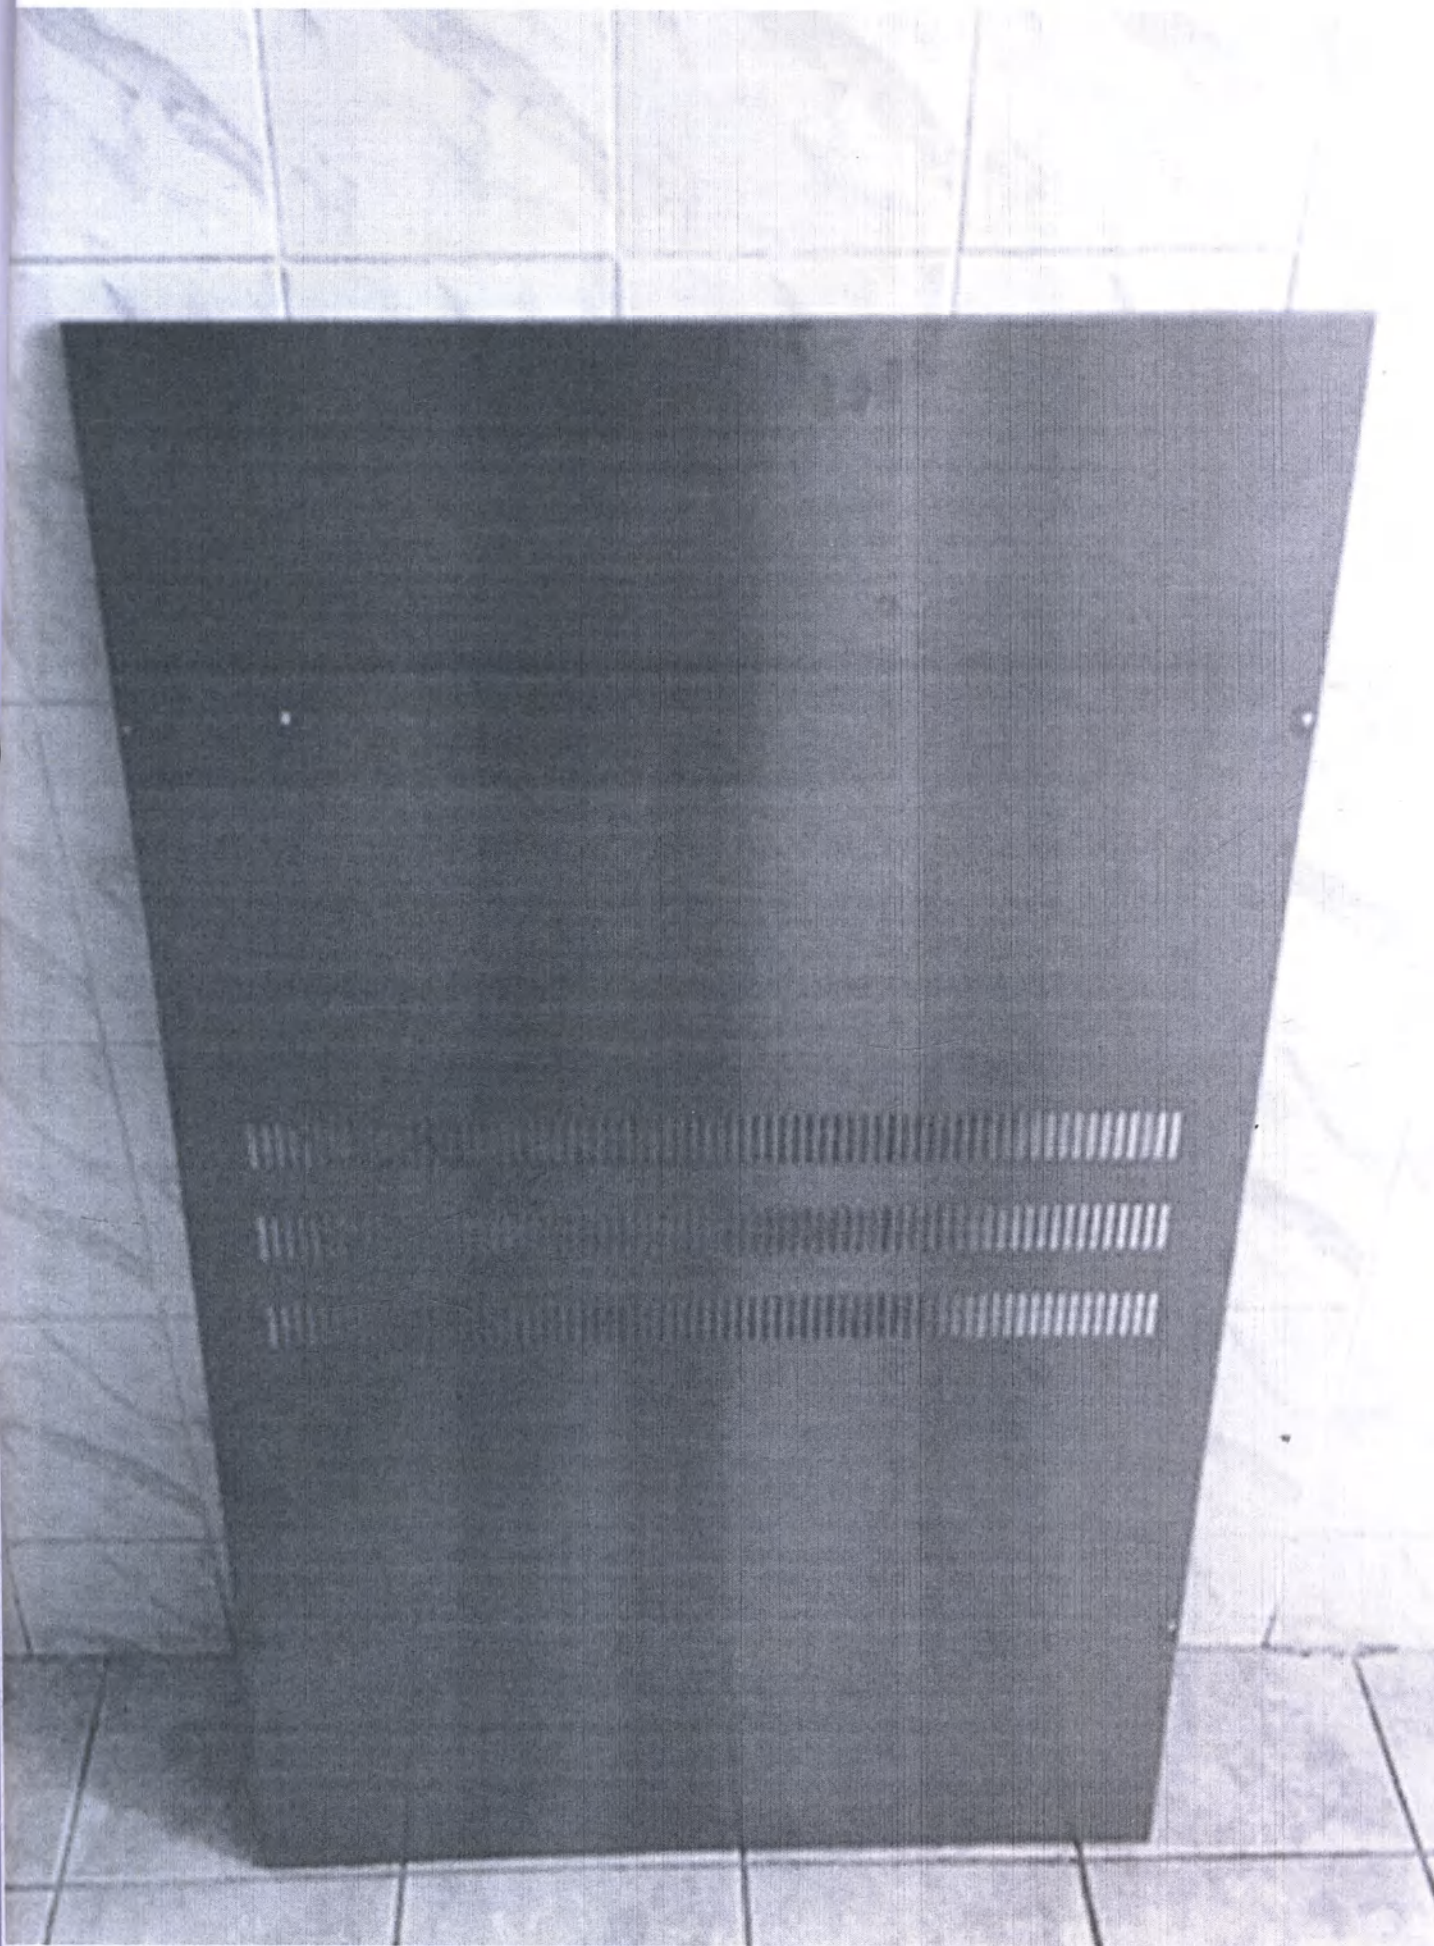


Комплект облицовочных панелей из нержавеющей стали

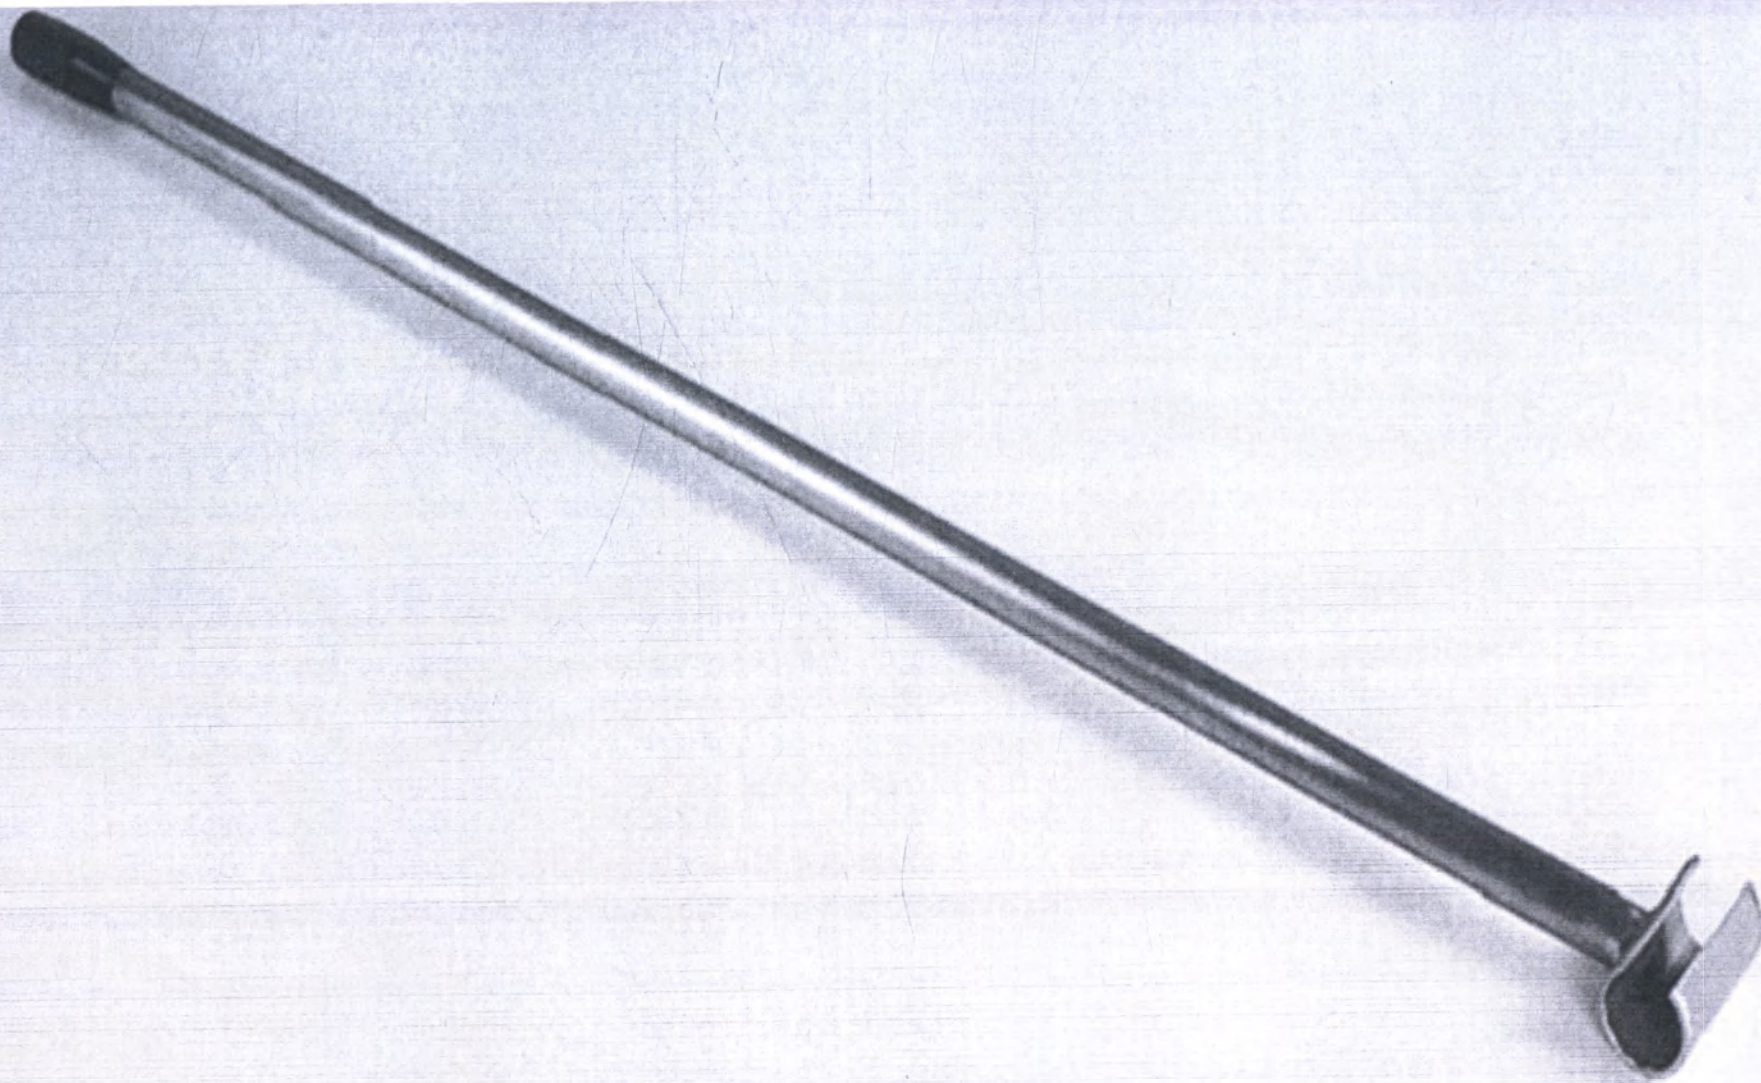



Крюк для выгрузки тележки из камеры

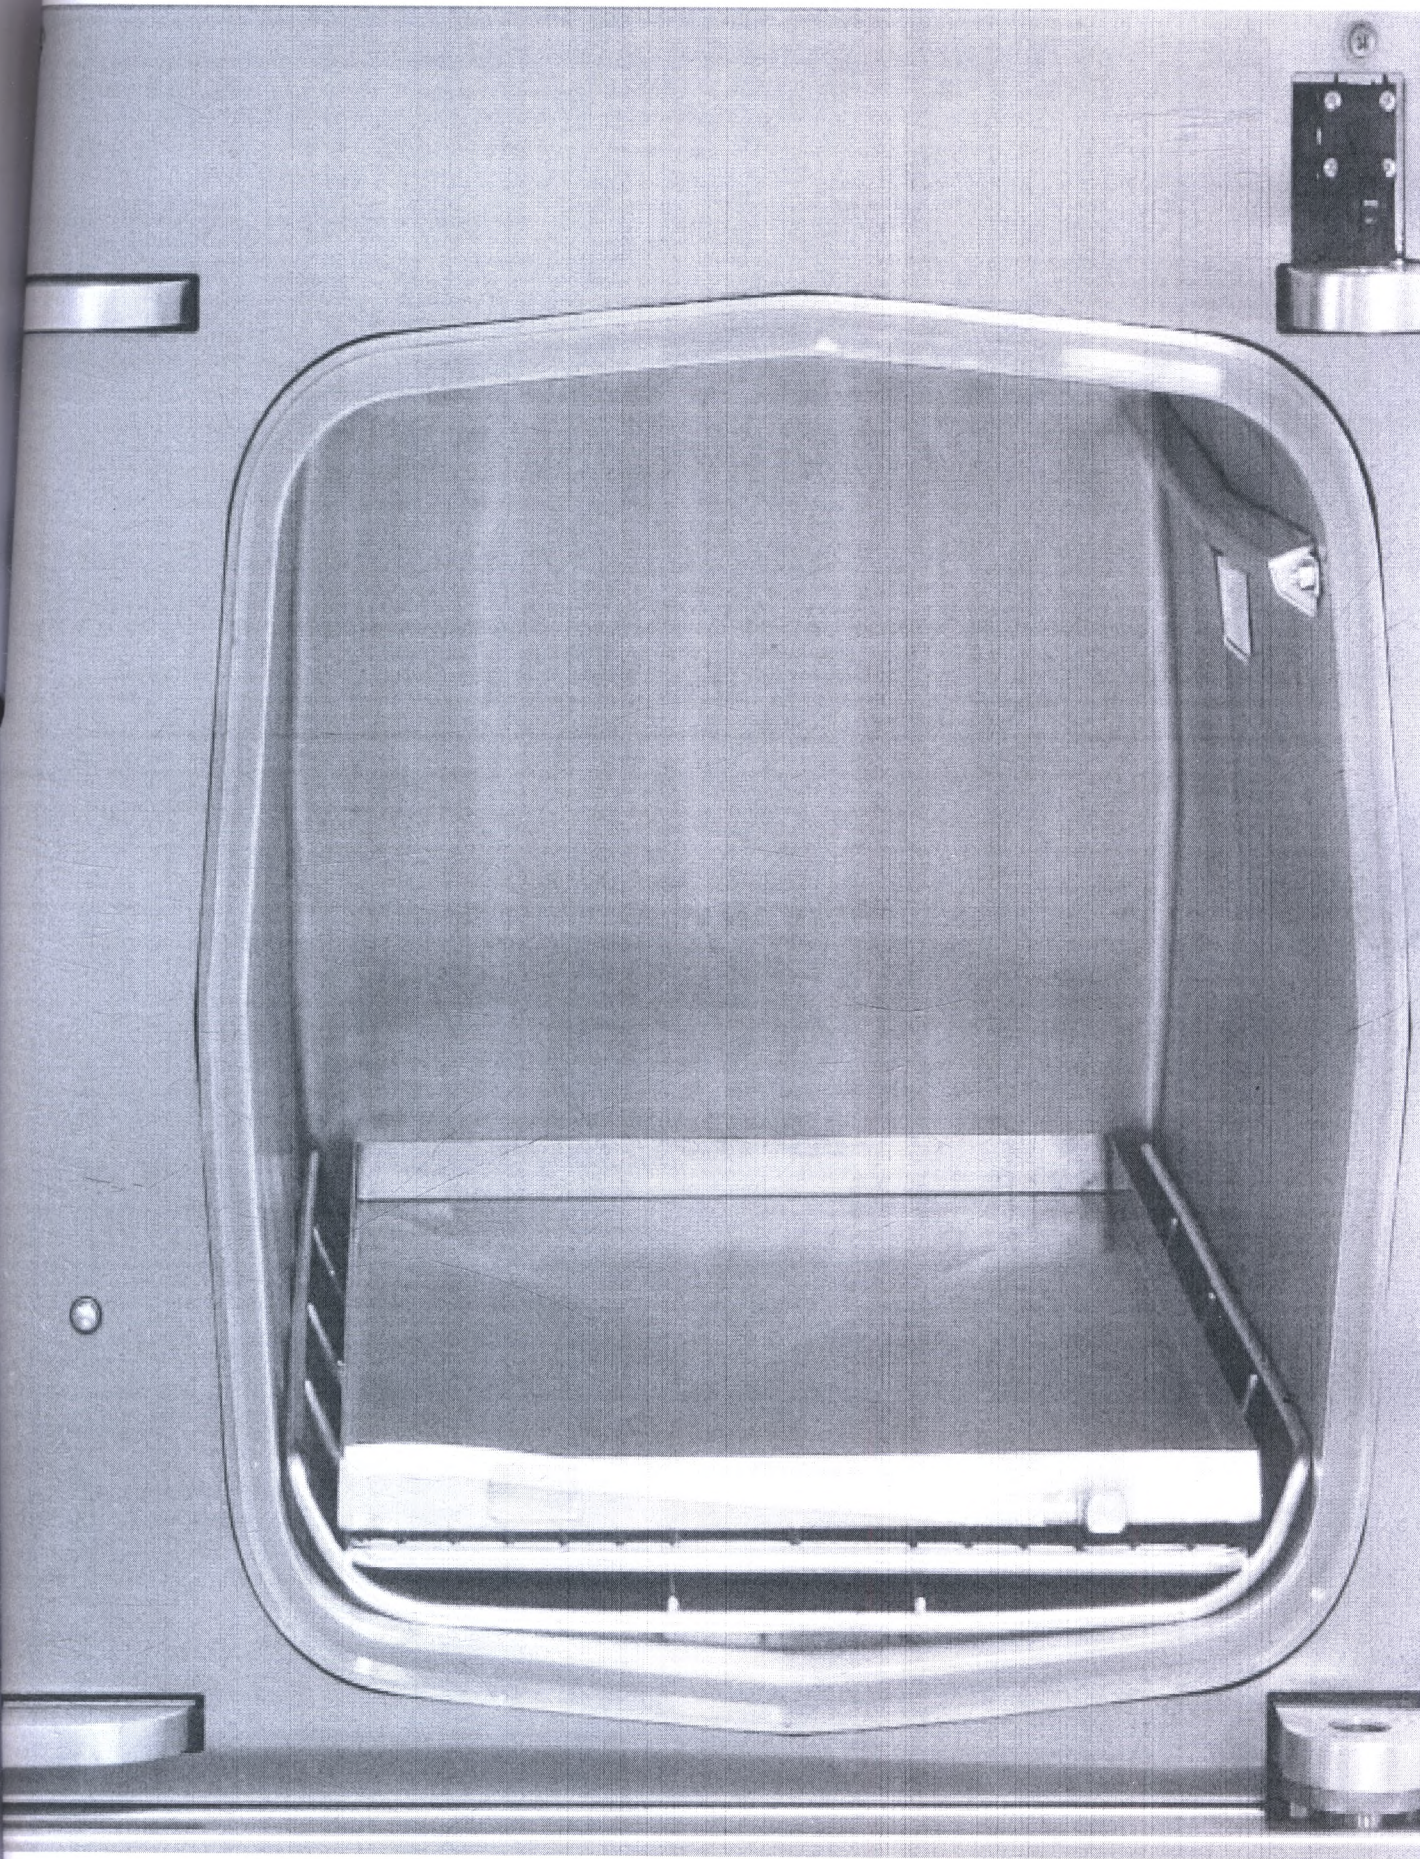



Ванна в камеру для стерилизации растворов

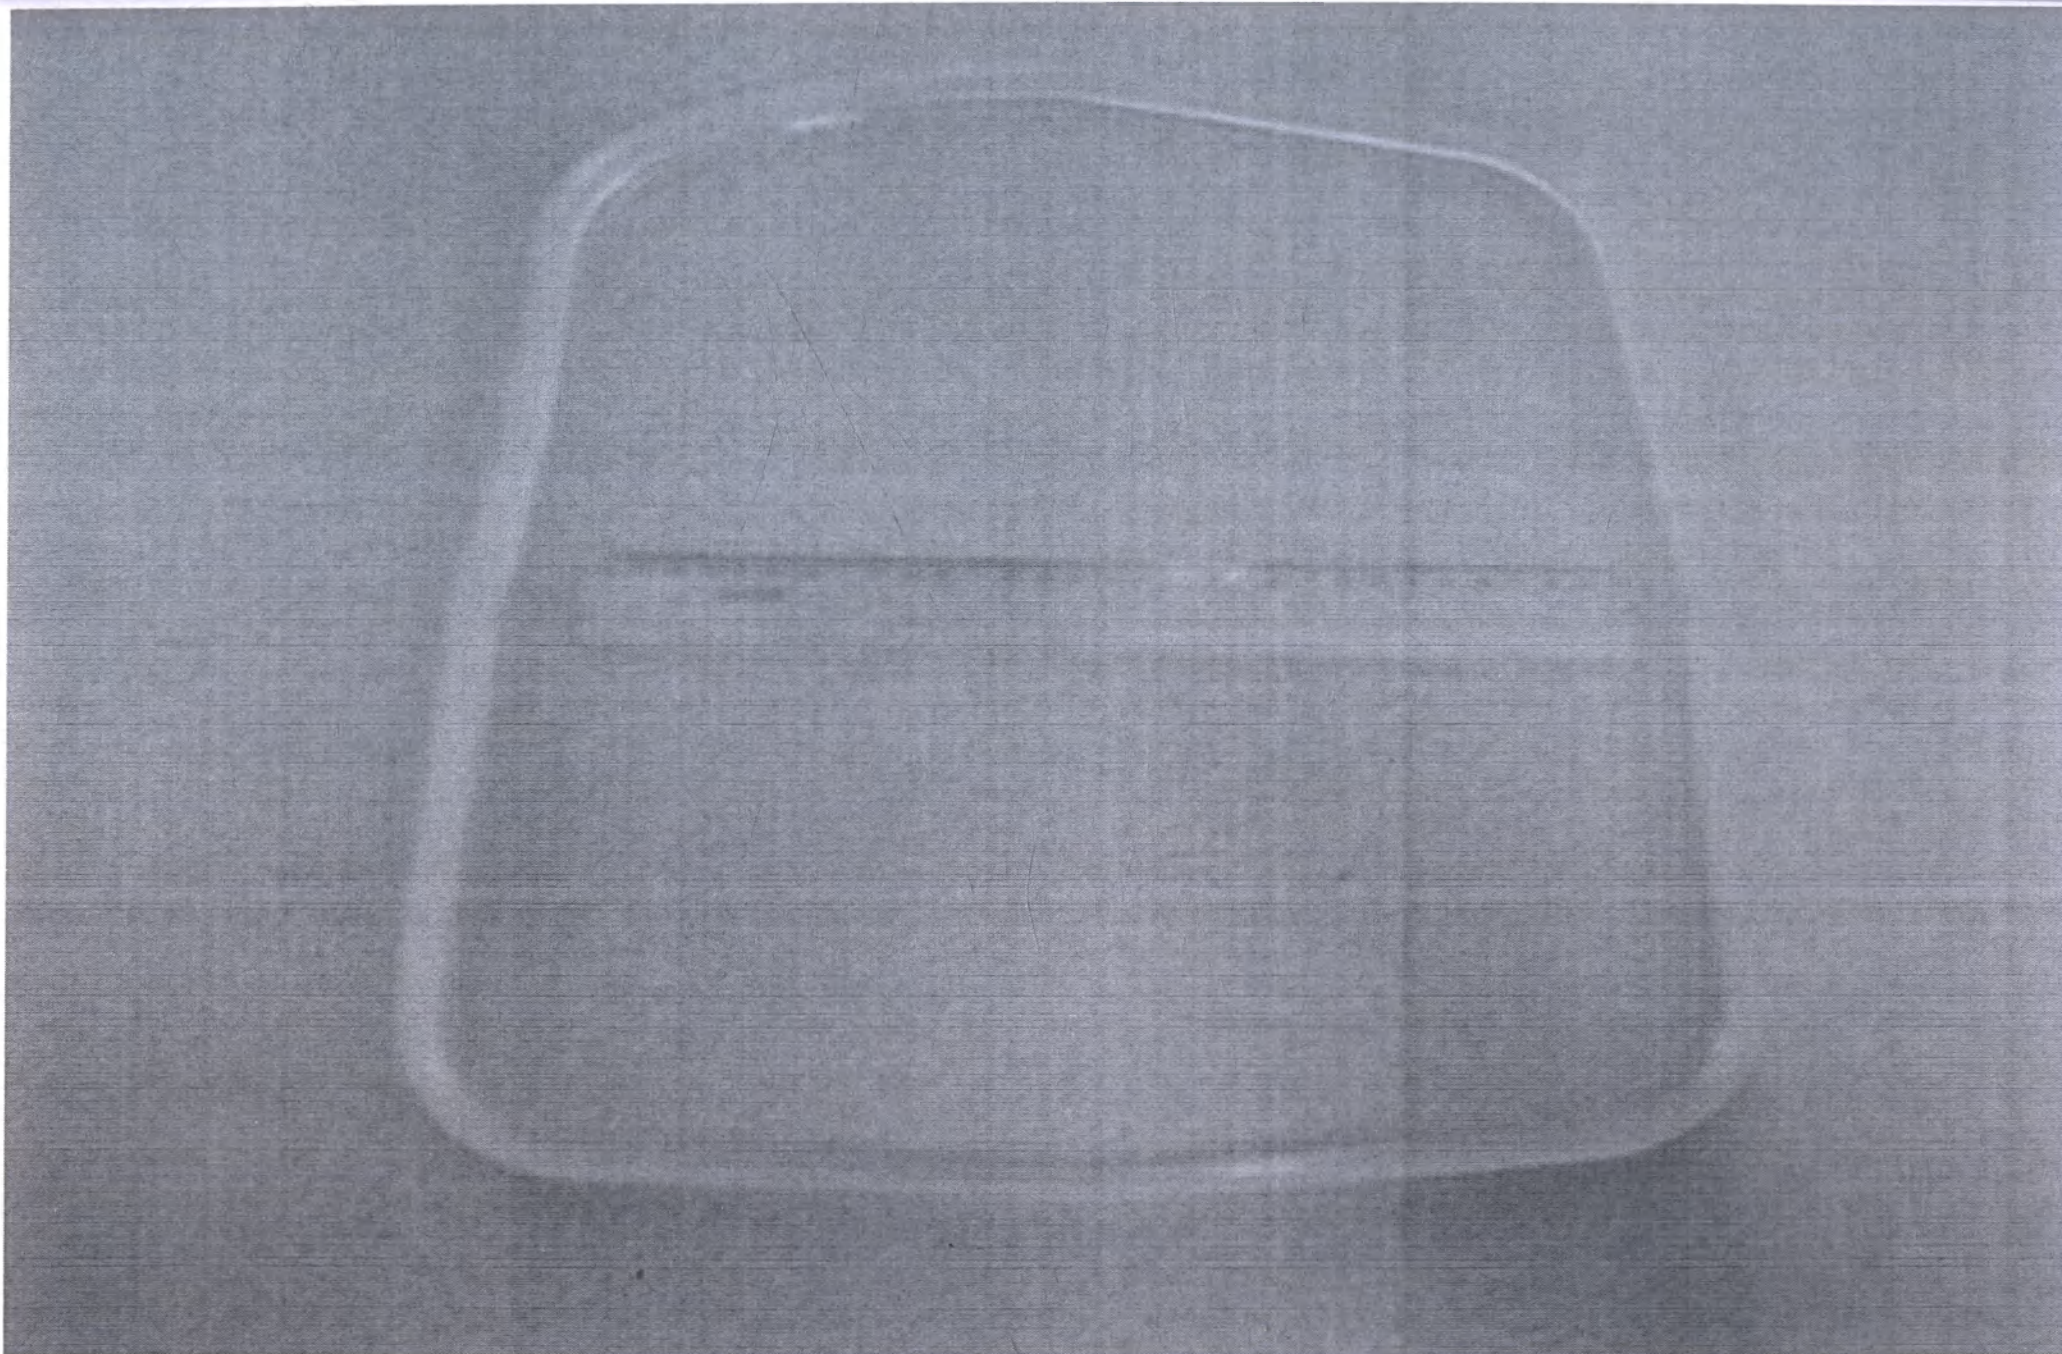


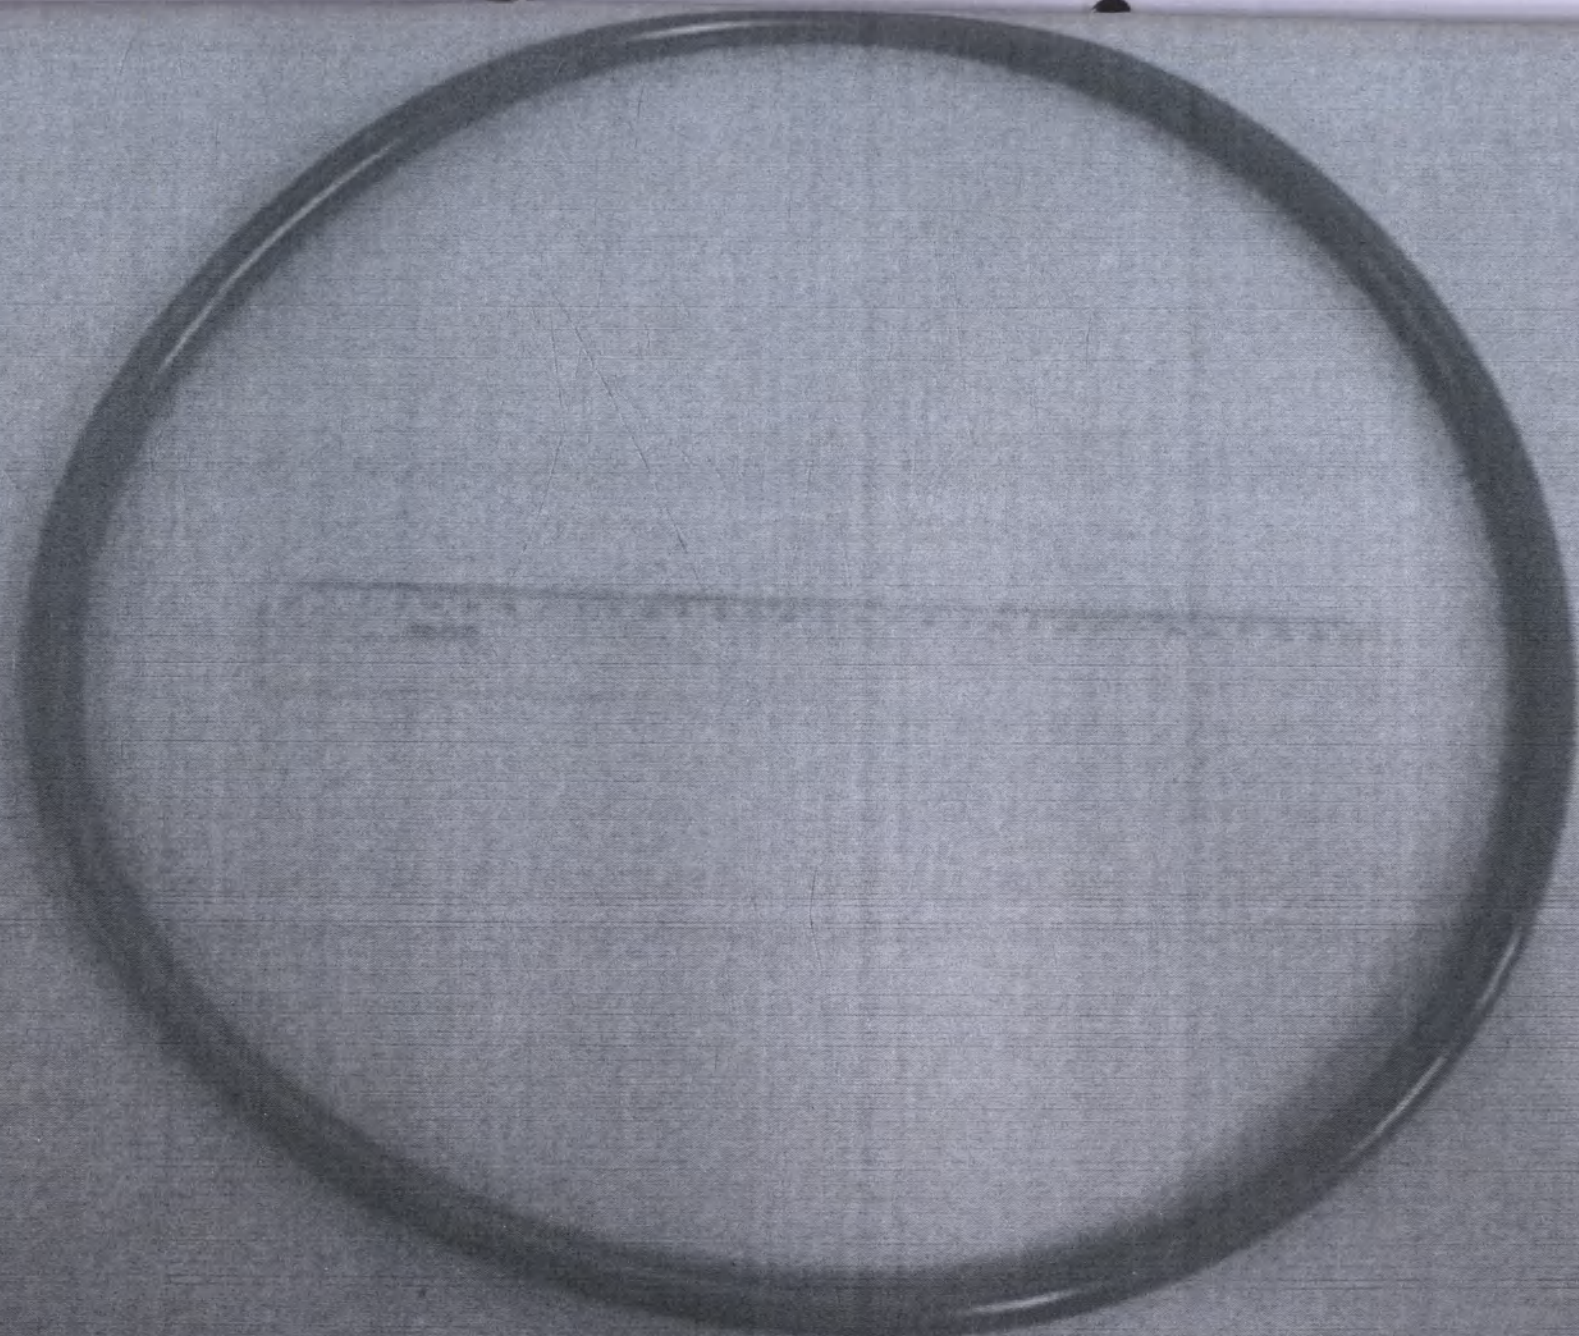

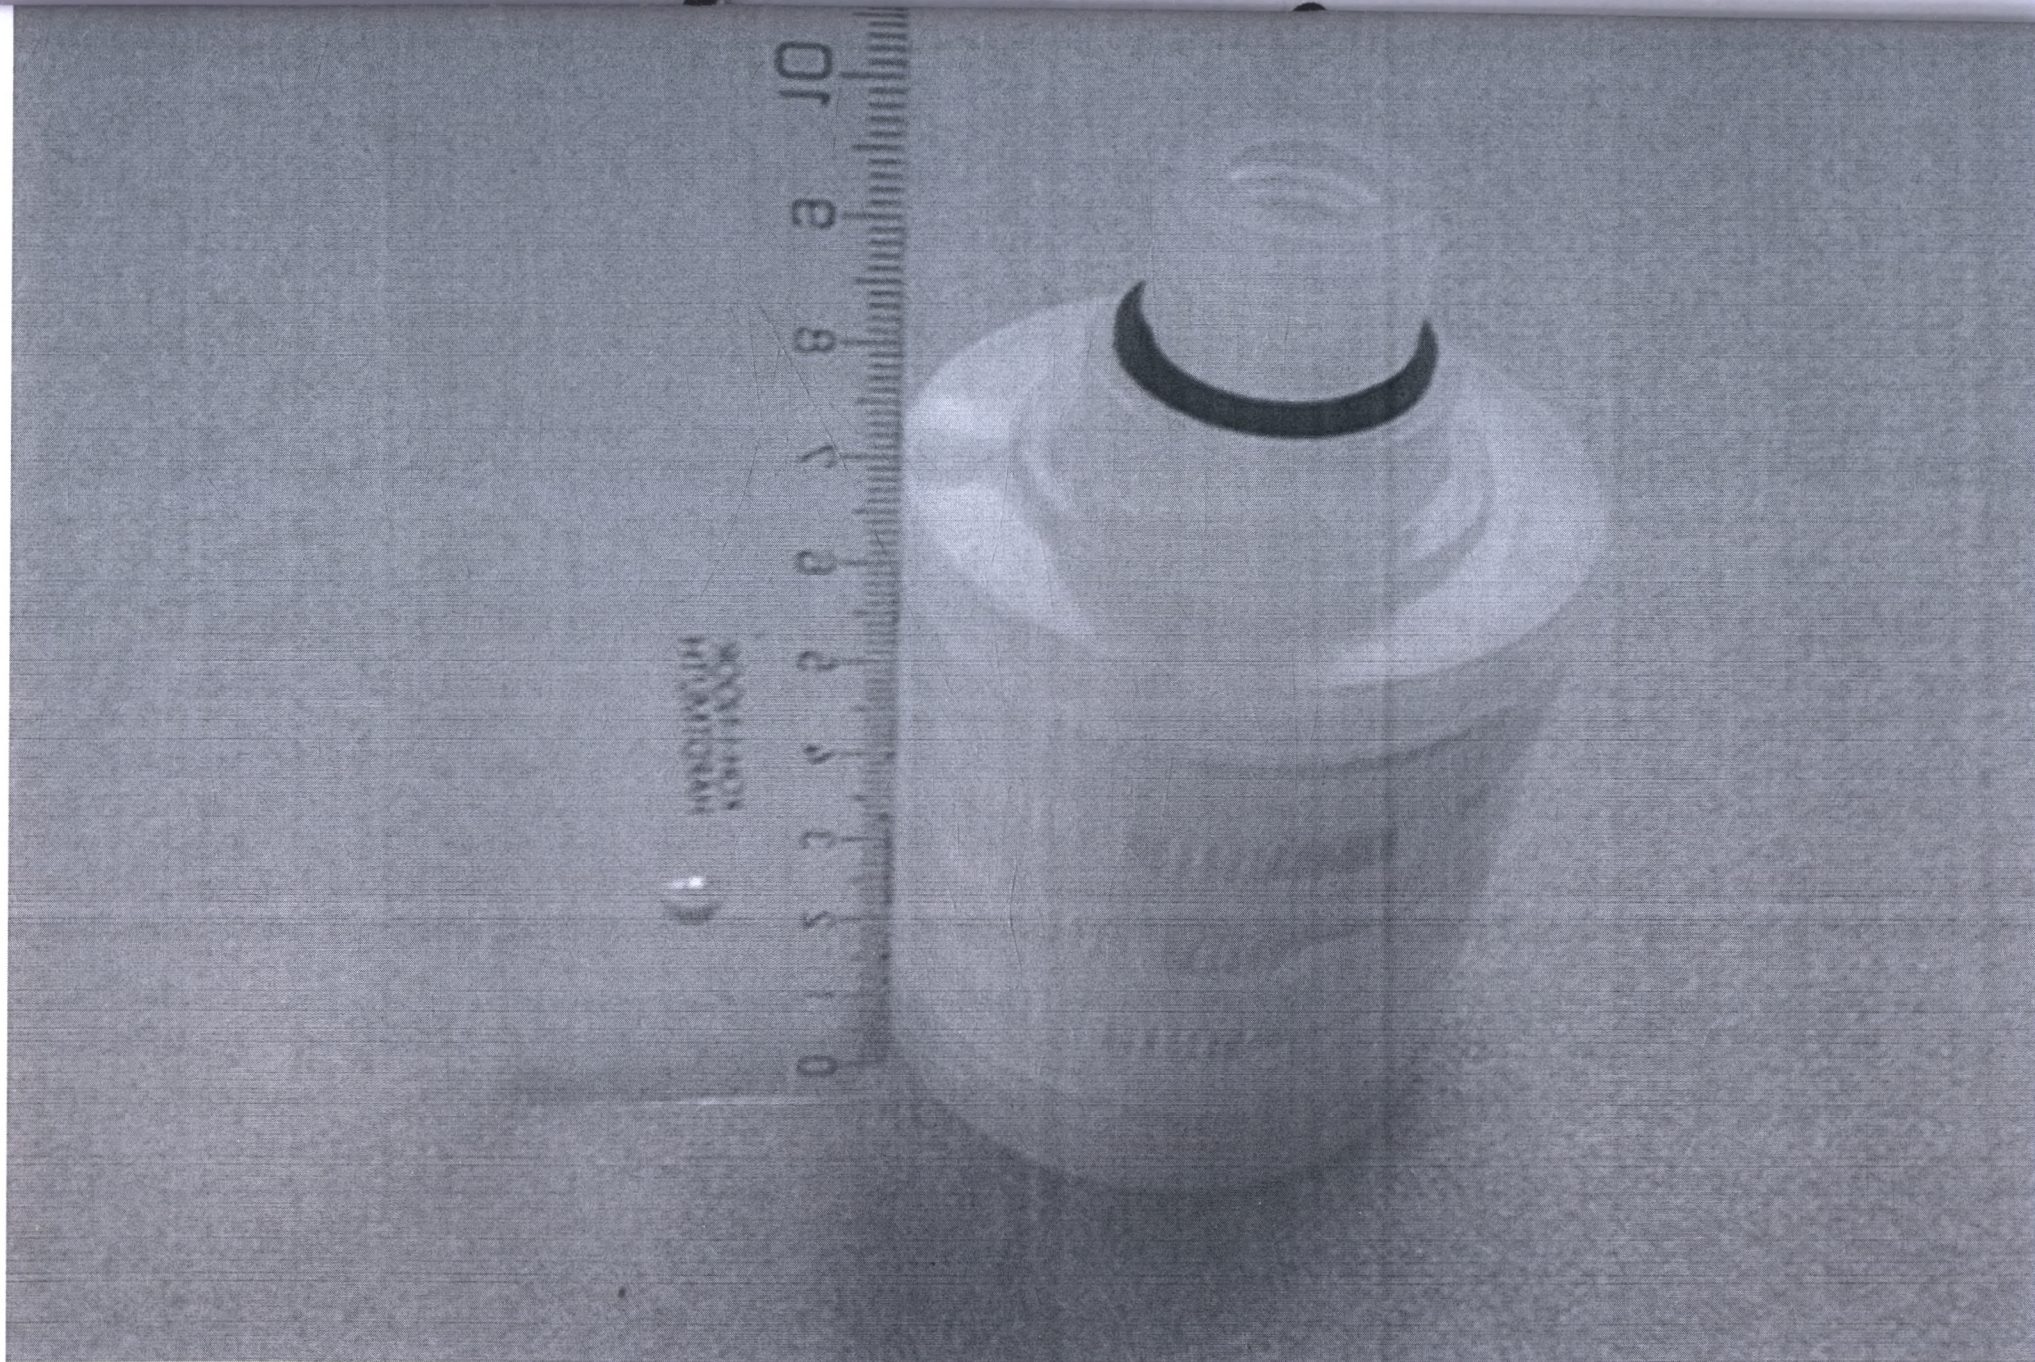


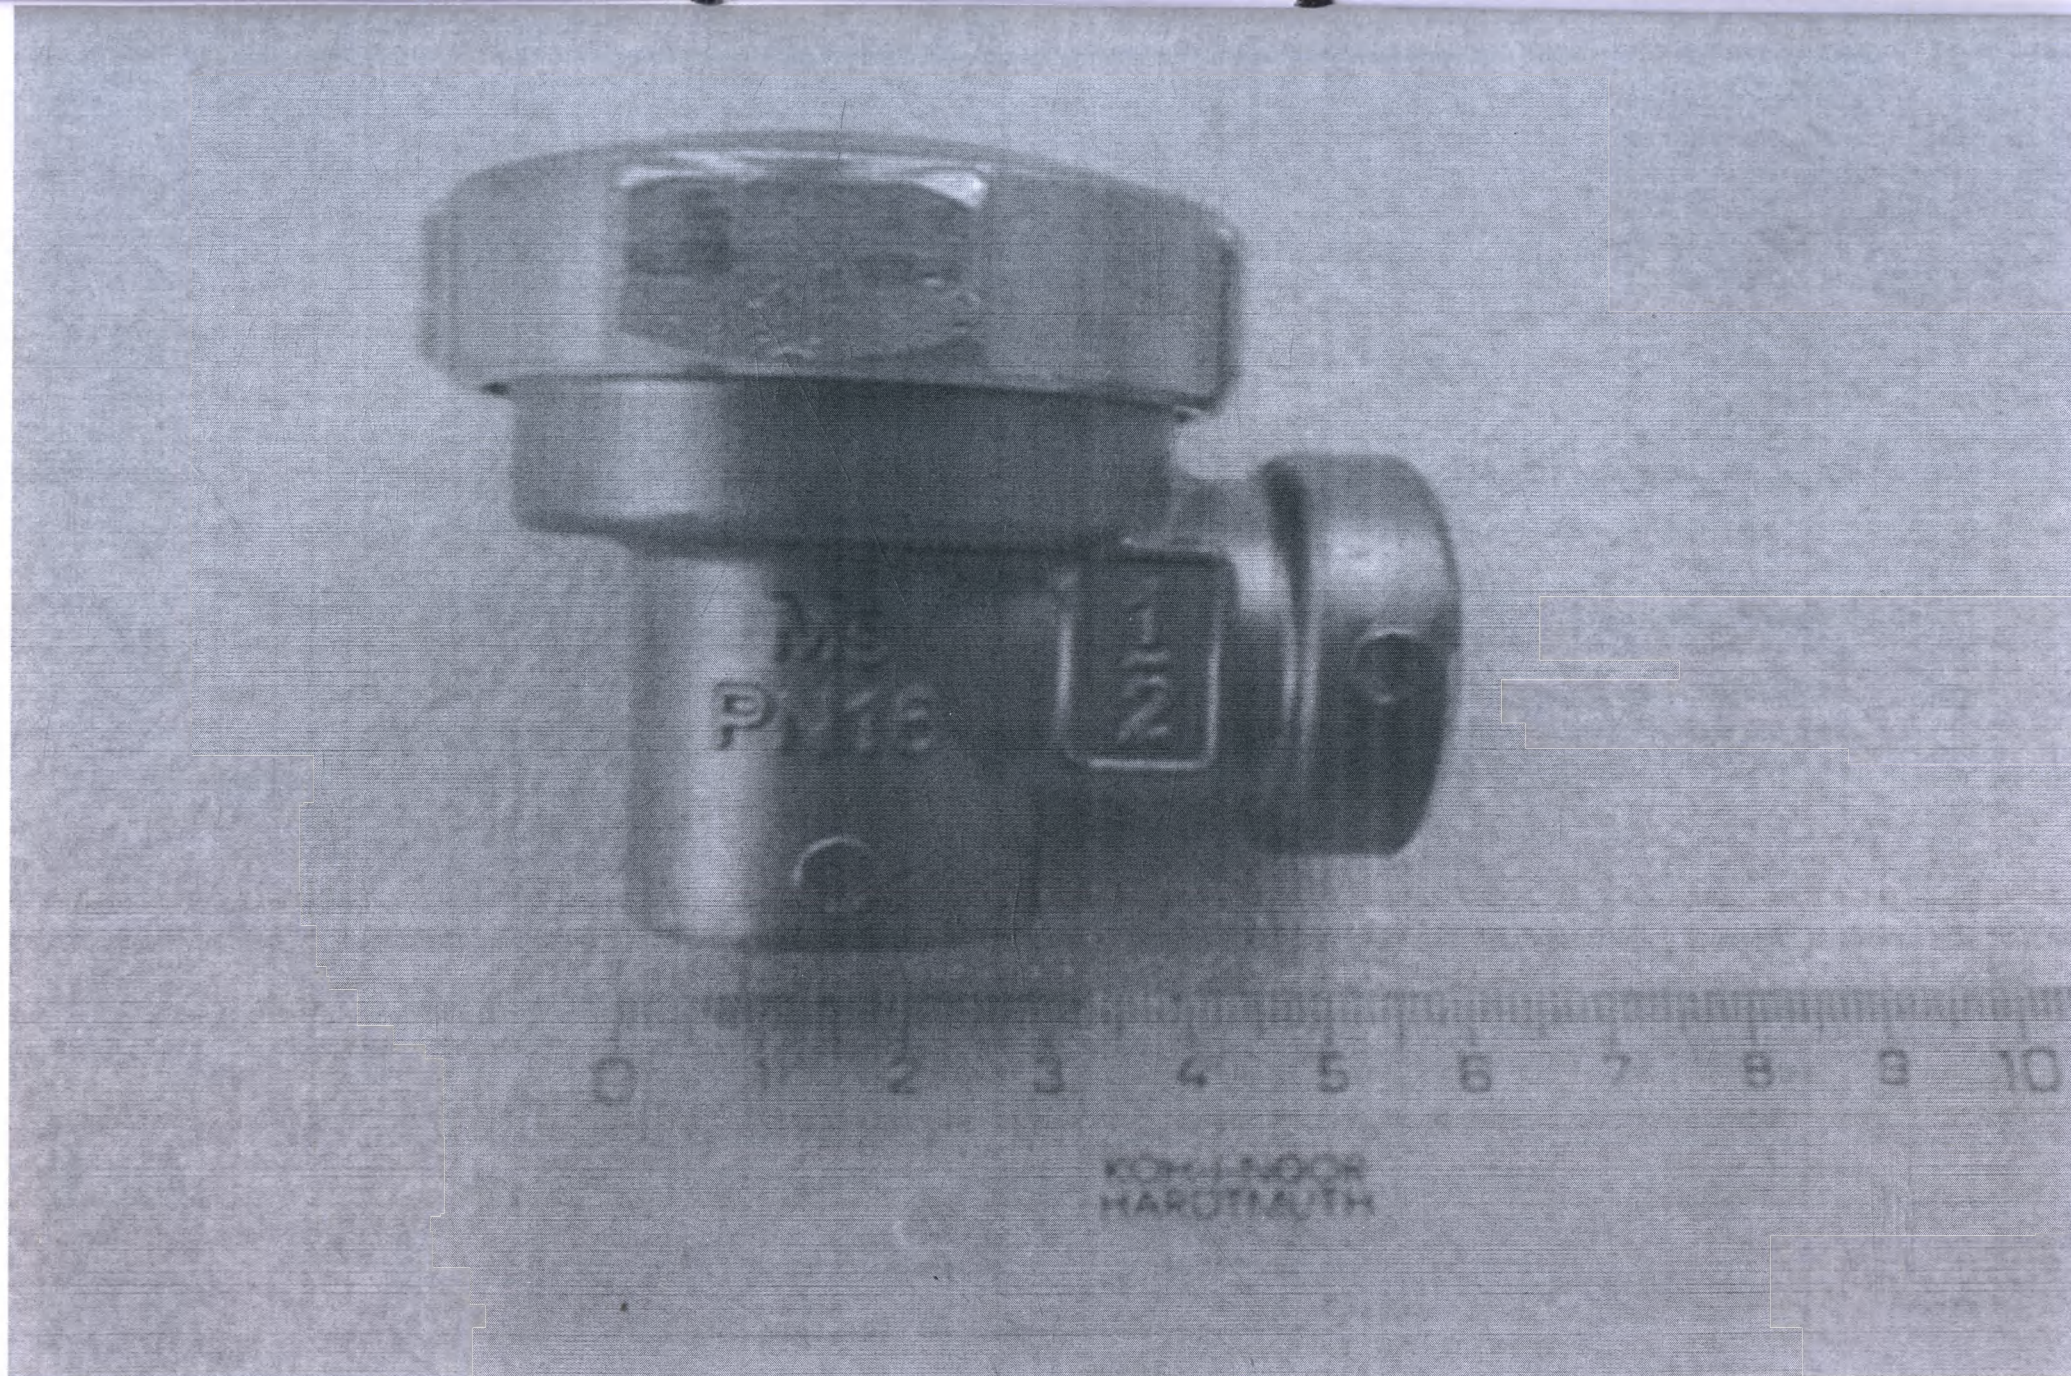

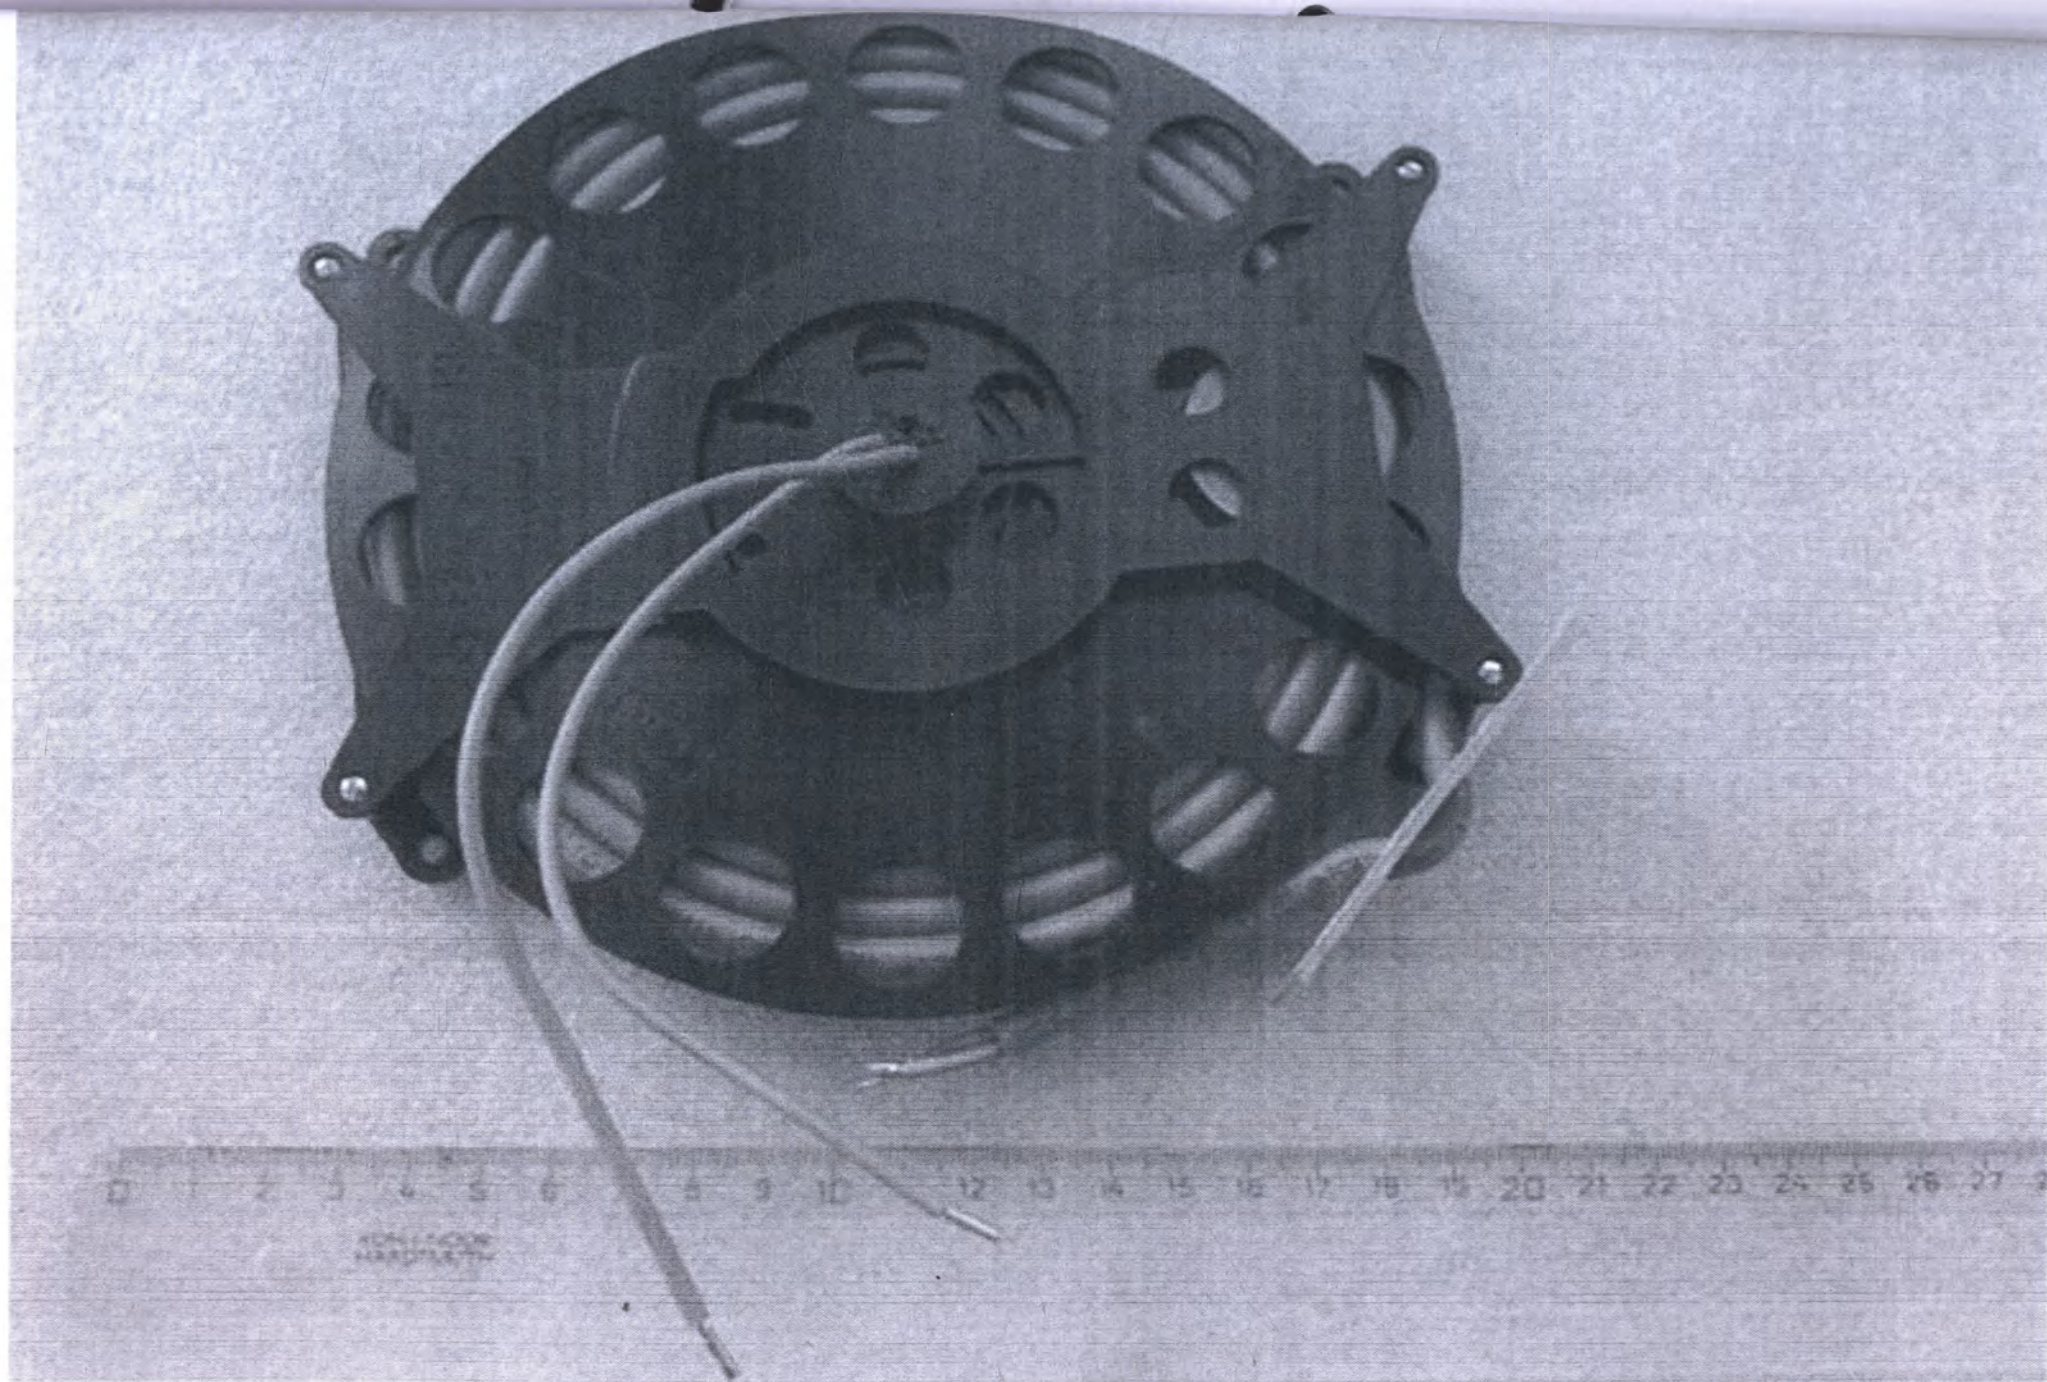


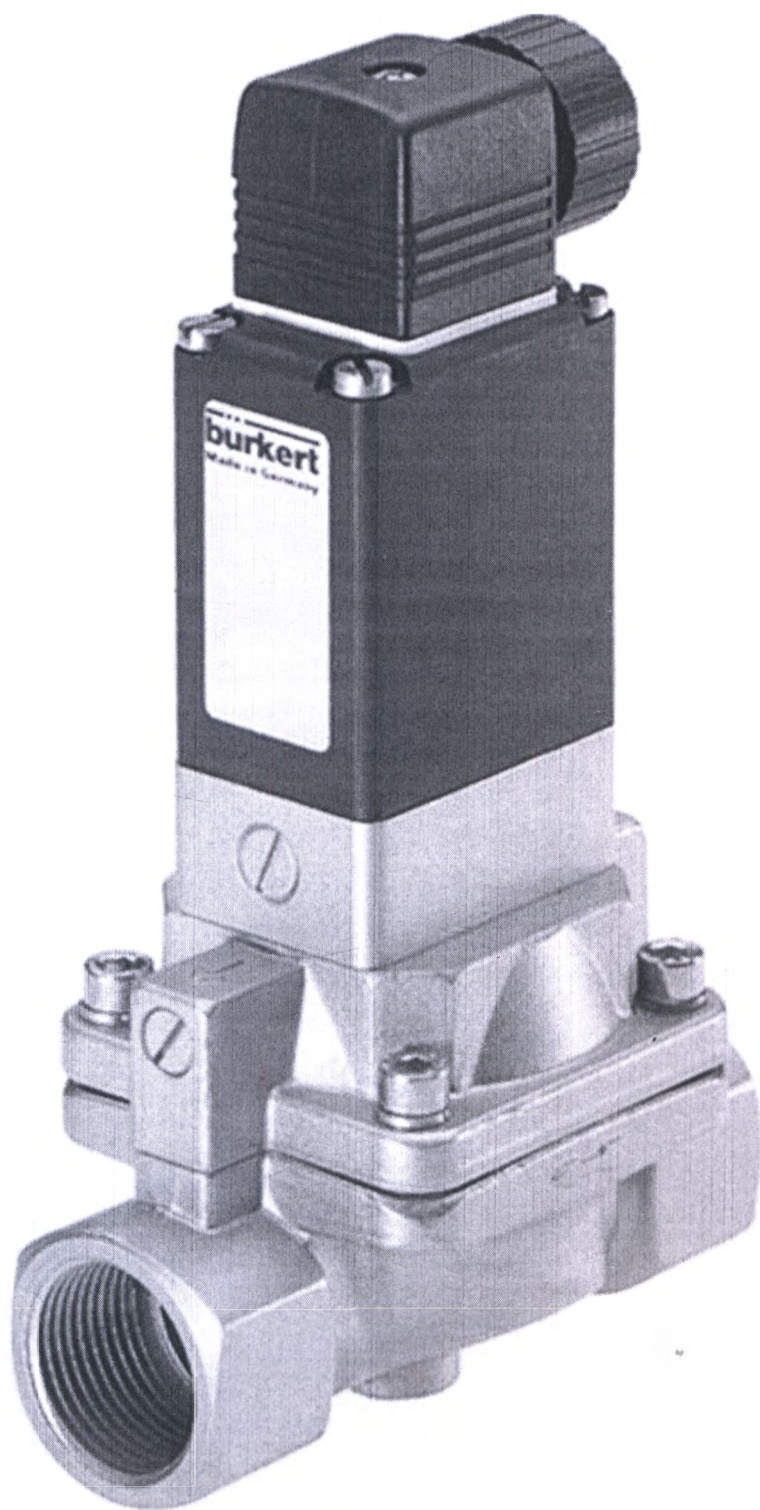


клапан электромагнитный

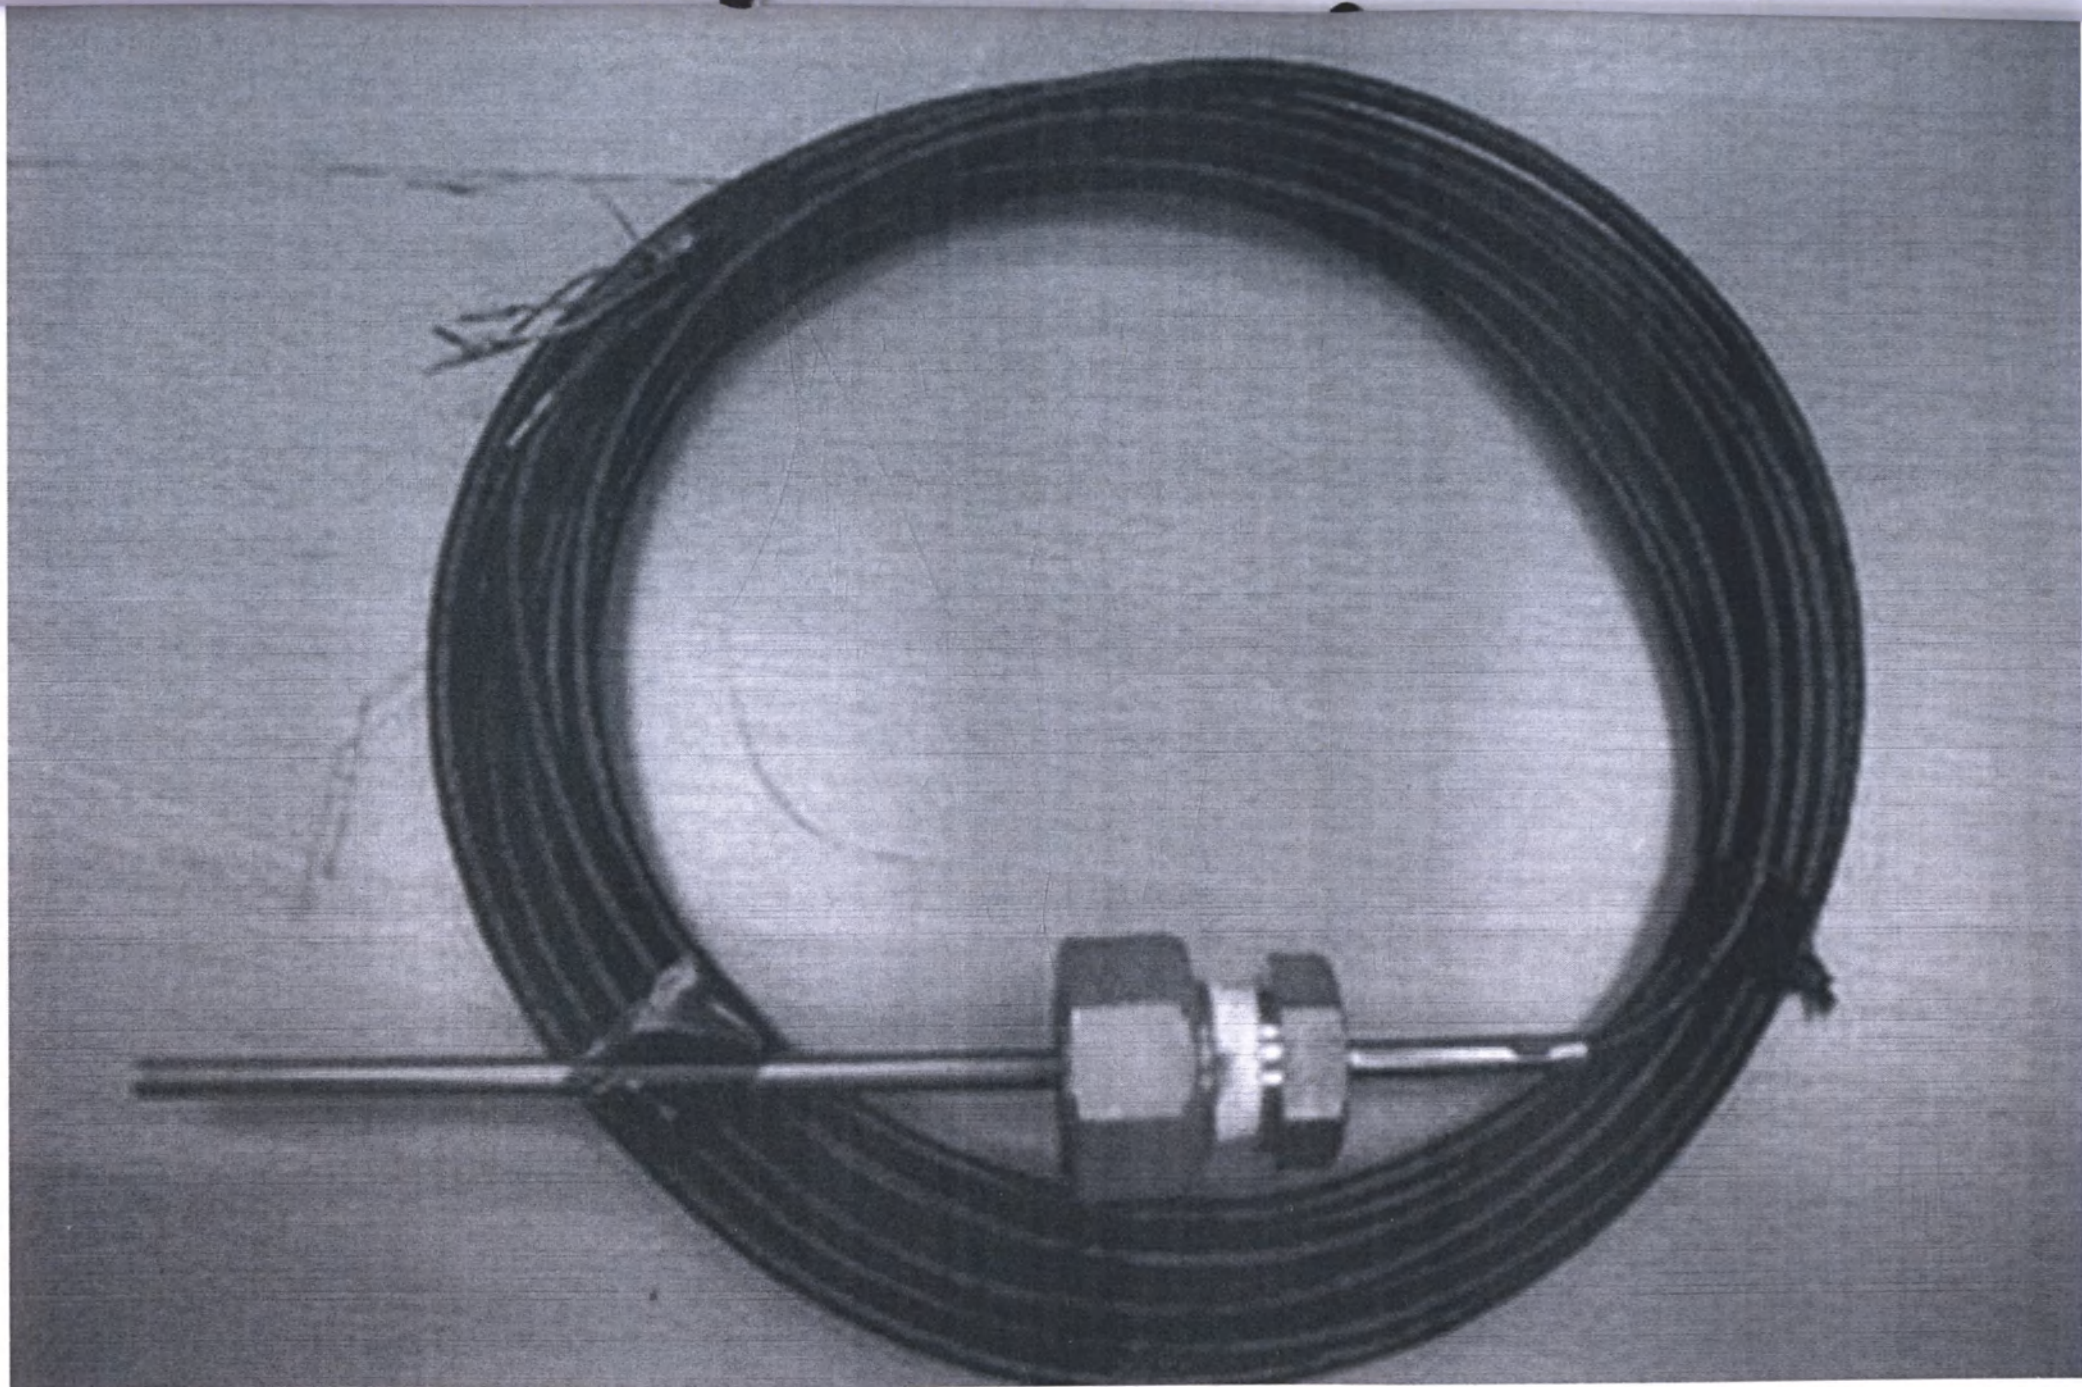

датчик температуры

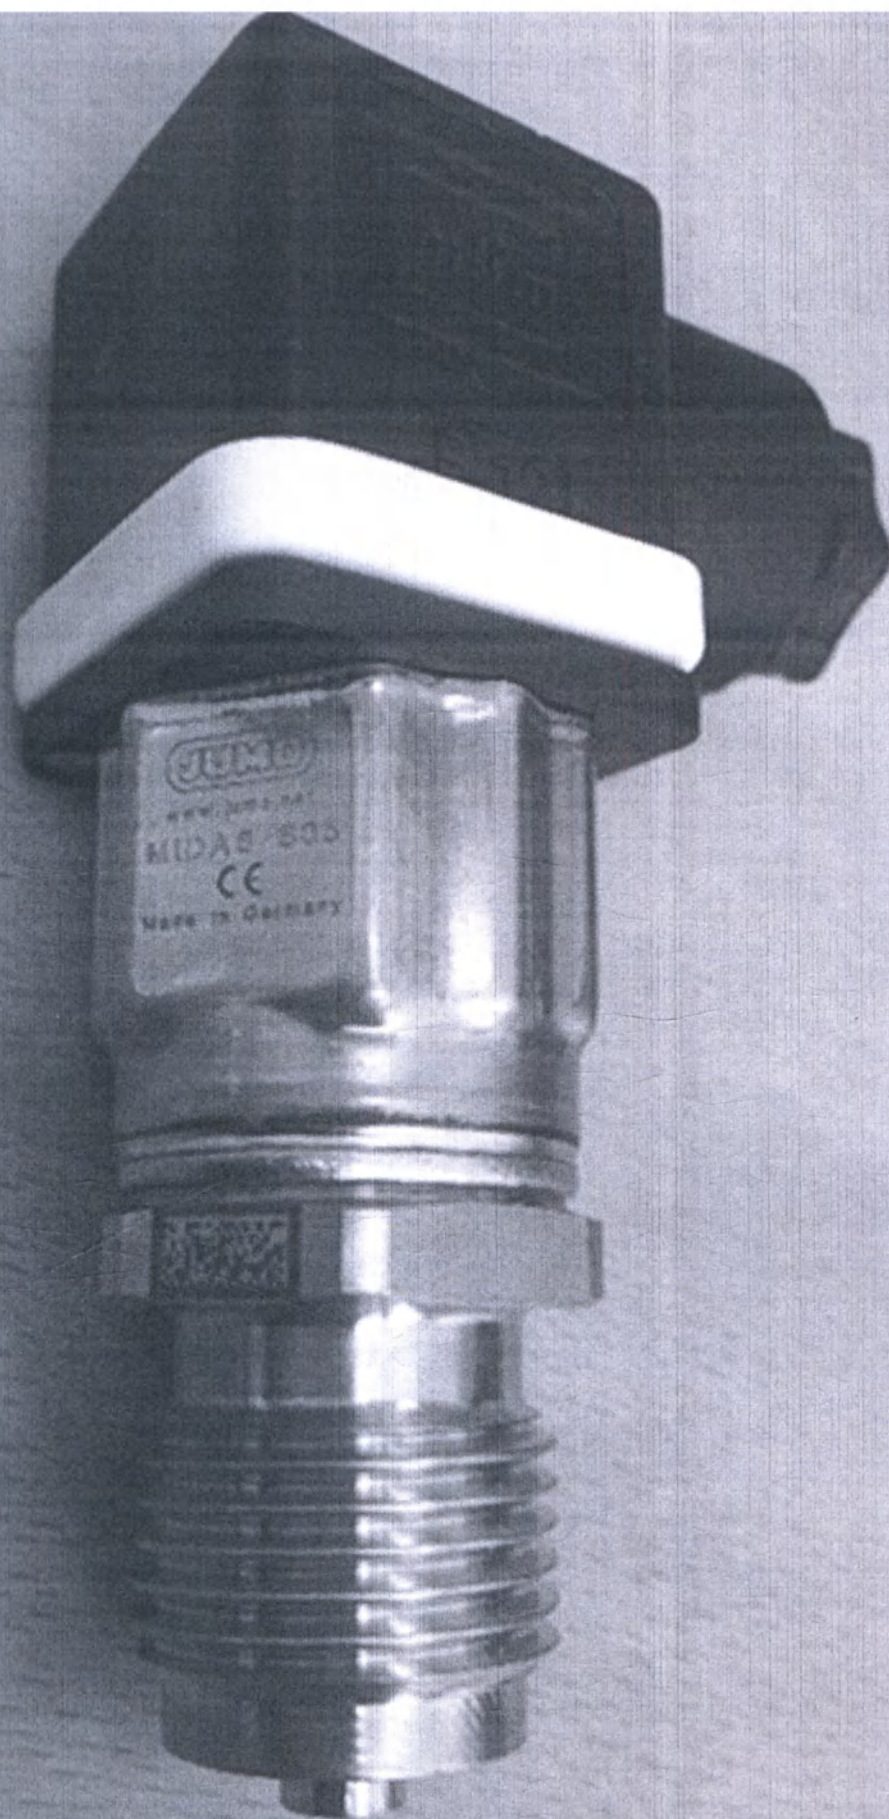

датчик давления

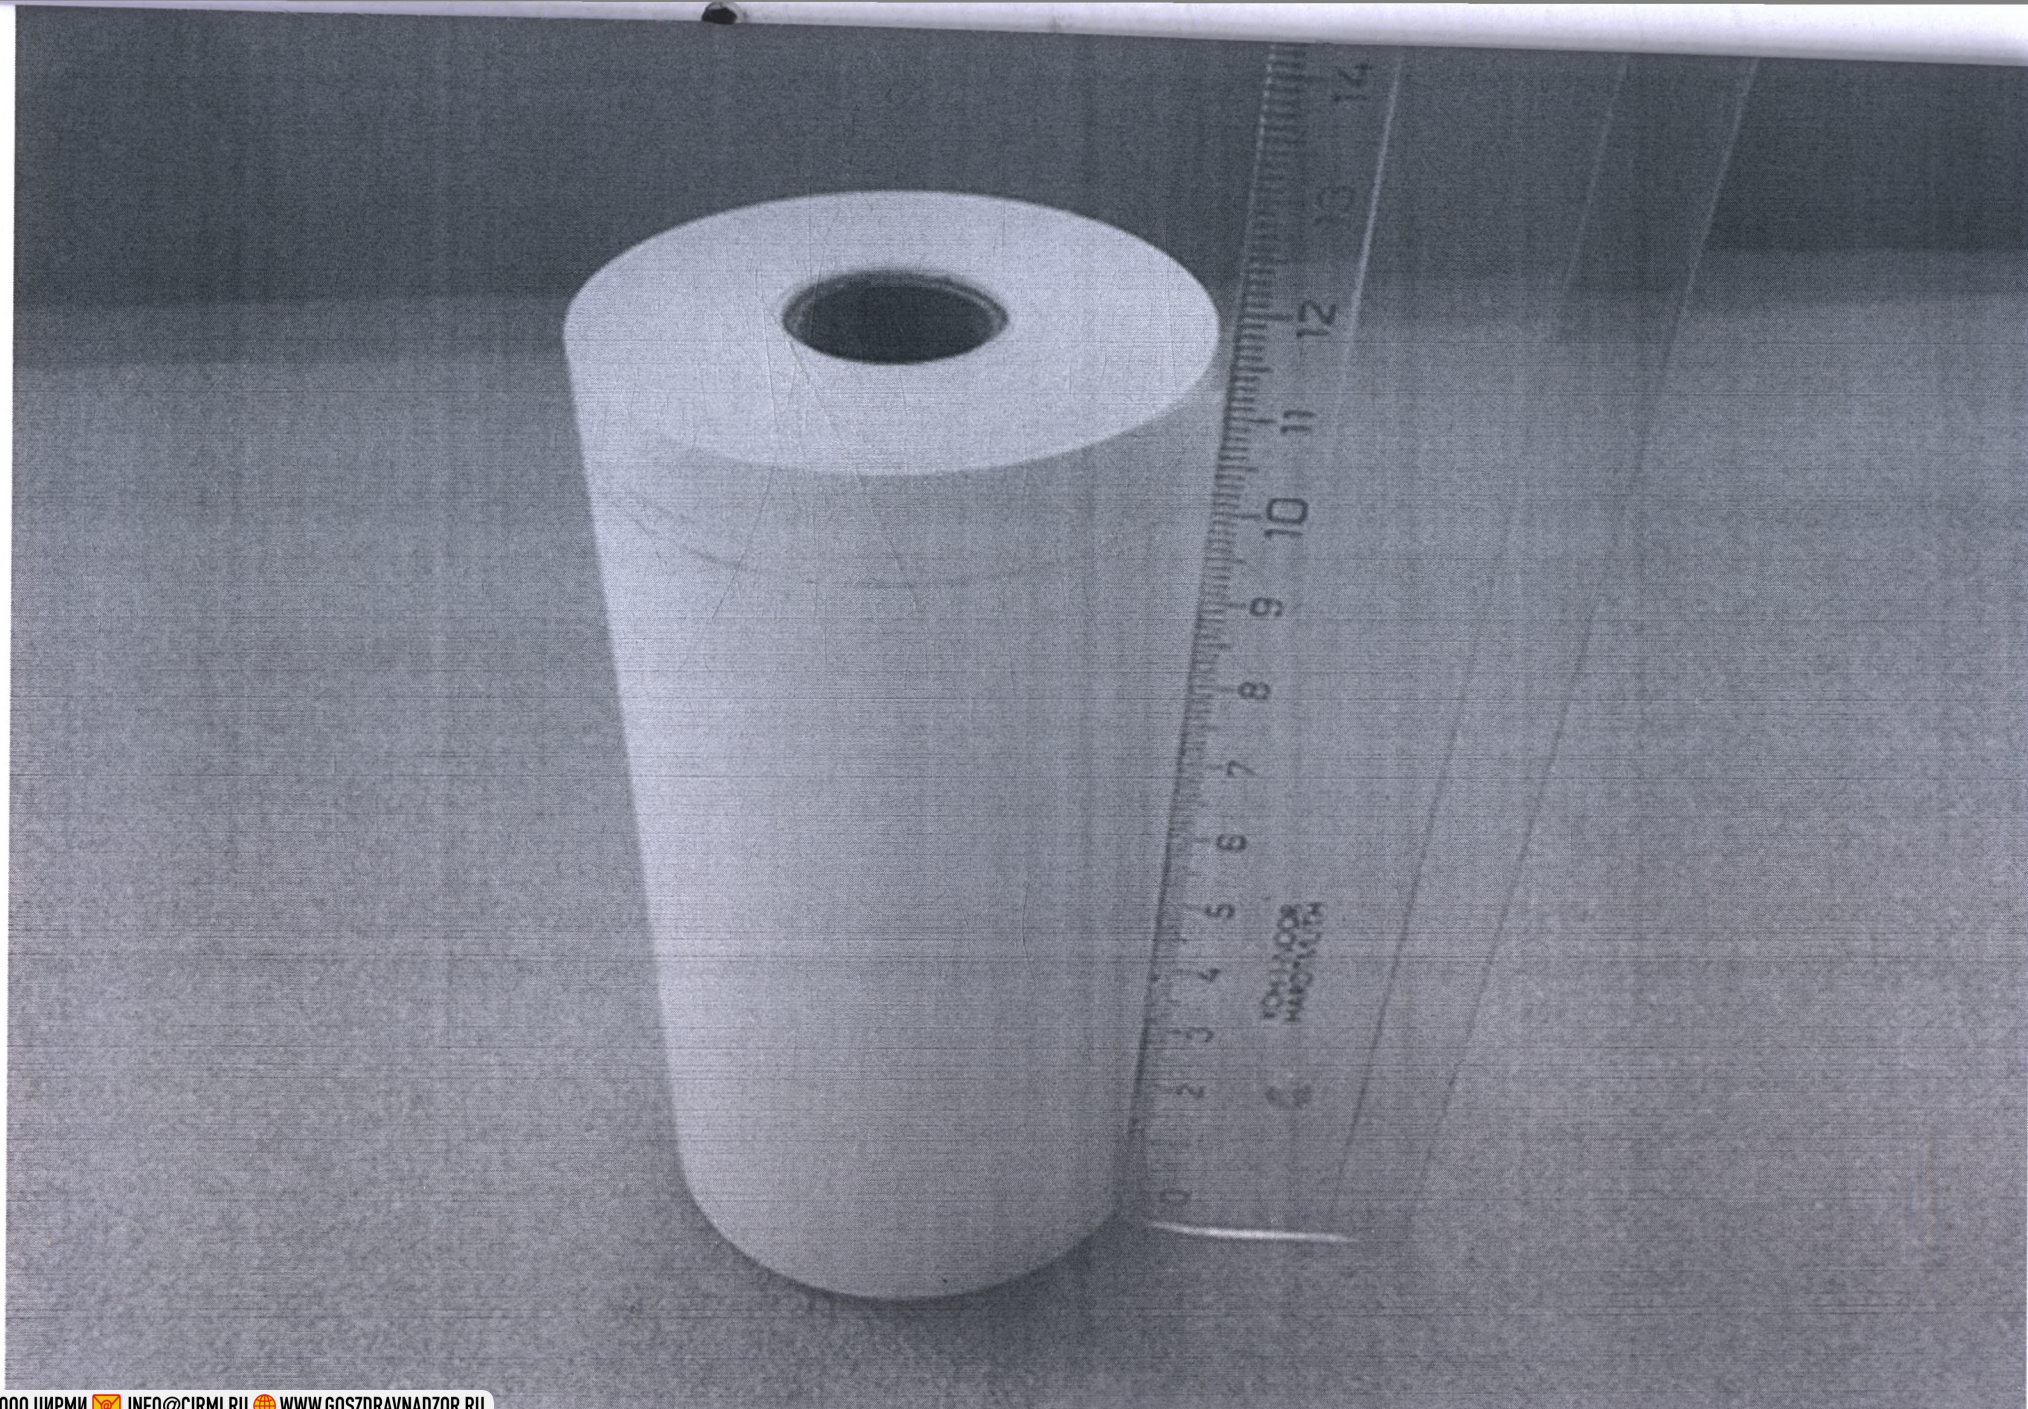



BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 157/50, Zábřdovice
60200 Brno
Czech Republic
Manufacturer



CE0123

STERIVAP

Trade name

2018

Built in

SPHP 6612-2ED

Model

5180719

Serial number

Max./min. allowed press. PS bar

3,2 / -1

Rated voltage

V 3/PE/AC400

Max./min. allowed temp. TS °C

144 / 5

Rated current

A

Volume

L

610

Rated frequency

Hz

50/60

Protection category

IP 21

Nominal consumption

kW

48



BMT Medical Technology s.r.o.
Cejl 157/50, Zábřdovice
60200 Brno
Czech Republic
Manufacturer

C€0123

STERIVAP

Trade name

2018

Built in

SPSL 6612-2ED

Model

5180625

Serial number

Max./min. allowed press. PS bar

3,2 / -1

Rated voltage

V 3/PE/AC400

Max./min. allowed temp. TS °C

144 / 5

Rated current

A

Volume

L

610

Rated frequency

Hz

50/60

Protection category

IP 21

Nominal consumption

kW

48

Фото маркировки

Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 32 листов.

Генеральный директор
ООО «Б.И.МММ»
Г. Рахманов

