



Фотографии медицинского изделия
«Дилуэнт UF-CELLPACK SF для автоматического анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000,
UF-5000»
производства компании SYSMEX CORPORATION, Япония


Дилуэнт UF-CELLPACK SF для автоматического анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000, UF-5000 (флакон, лот А 9003)

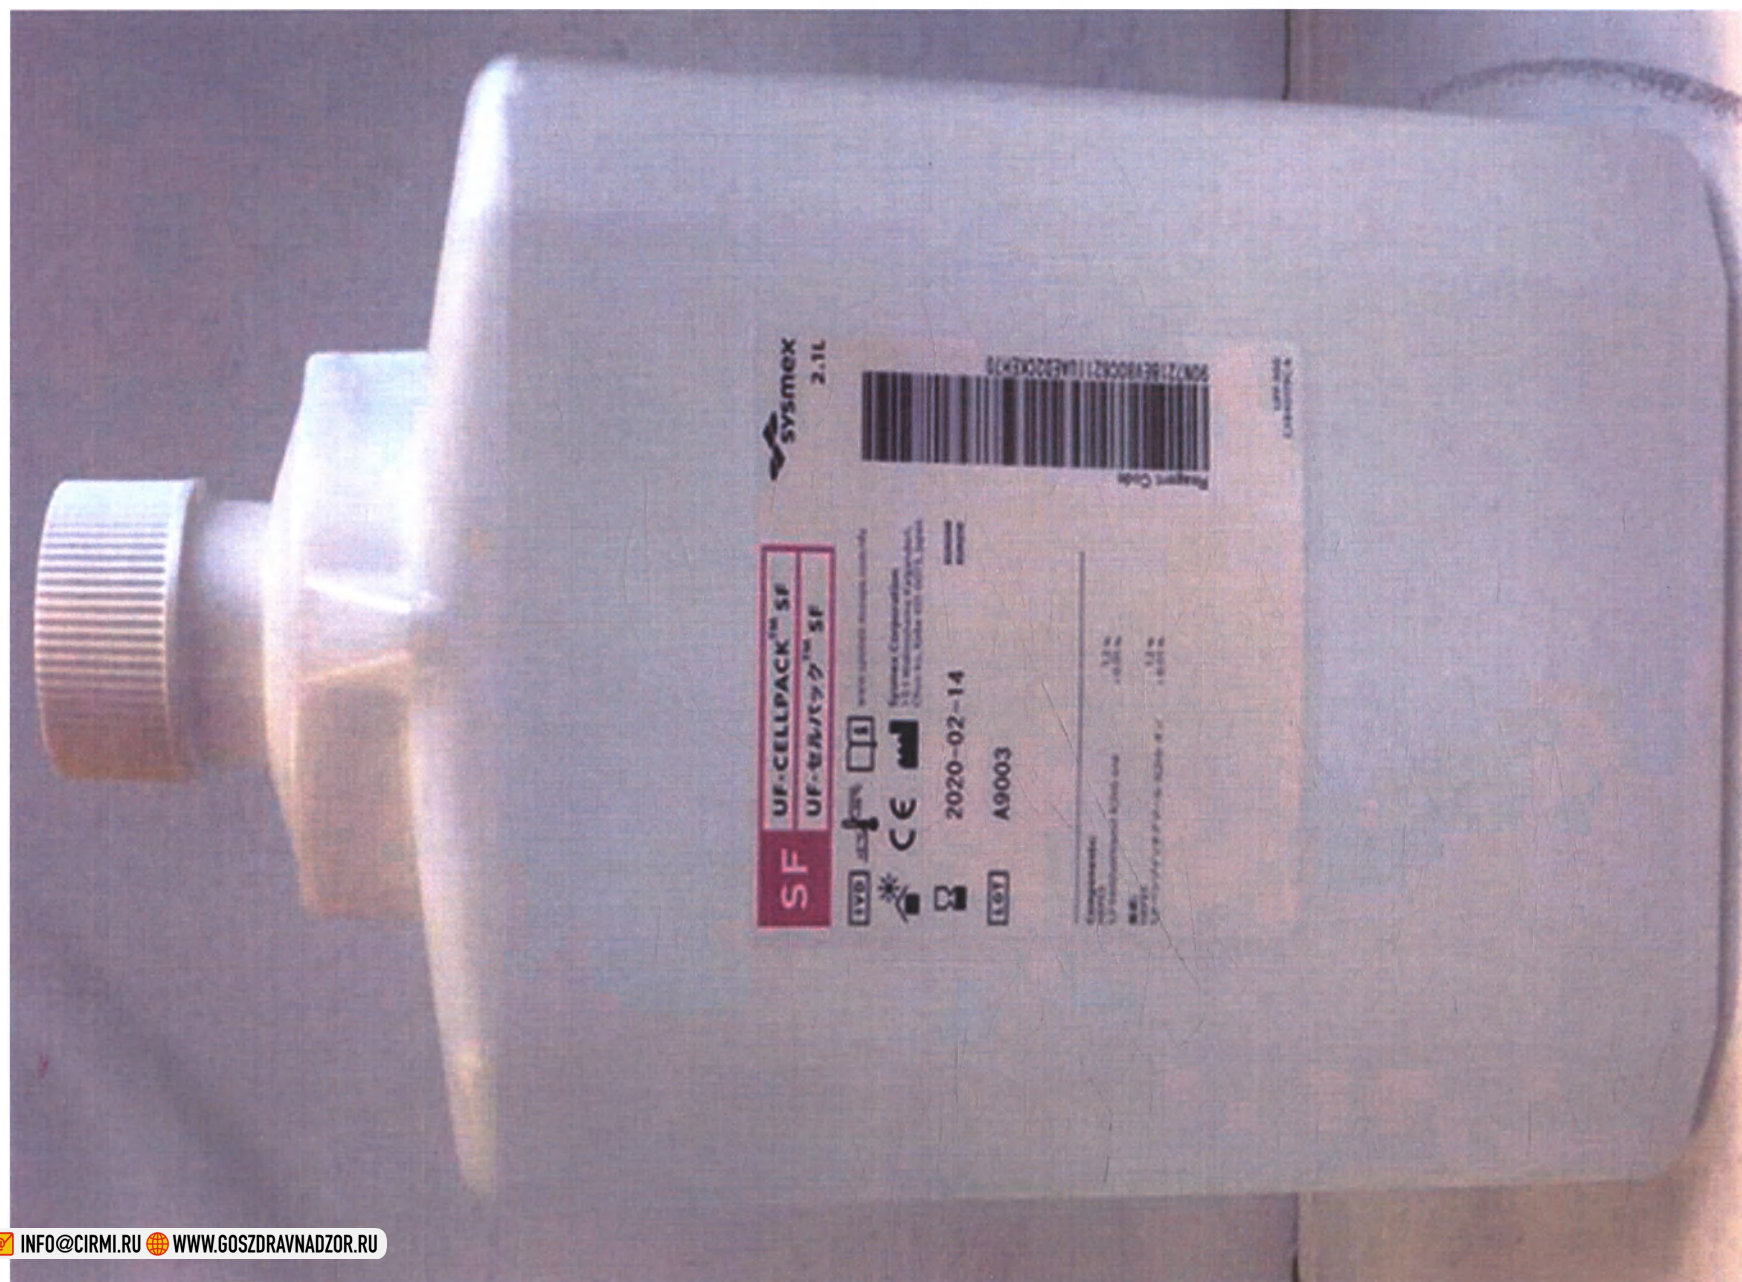


Диллюэнт UF-CELLPACK SF для автоматического анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000, UF-5000 (флакон, лот А 8034)

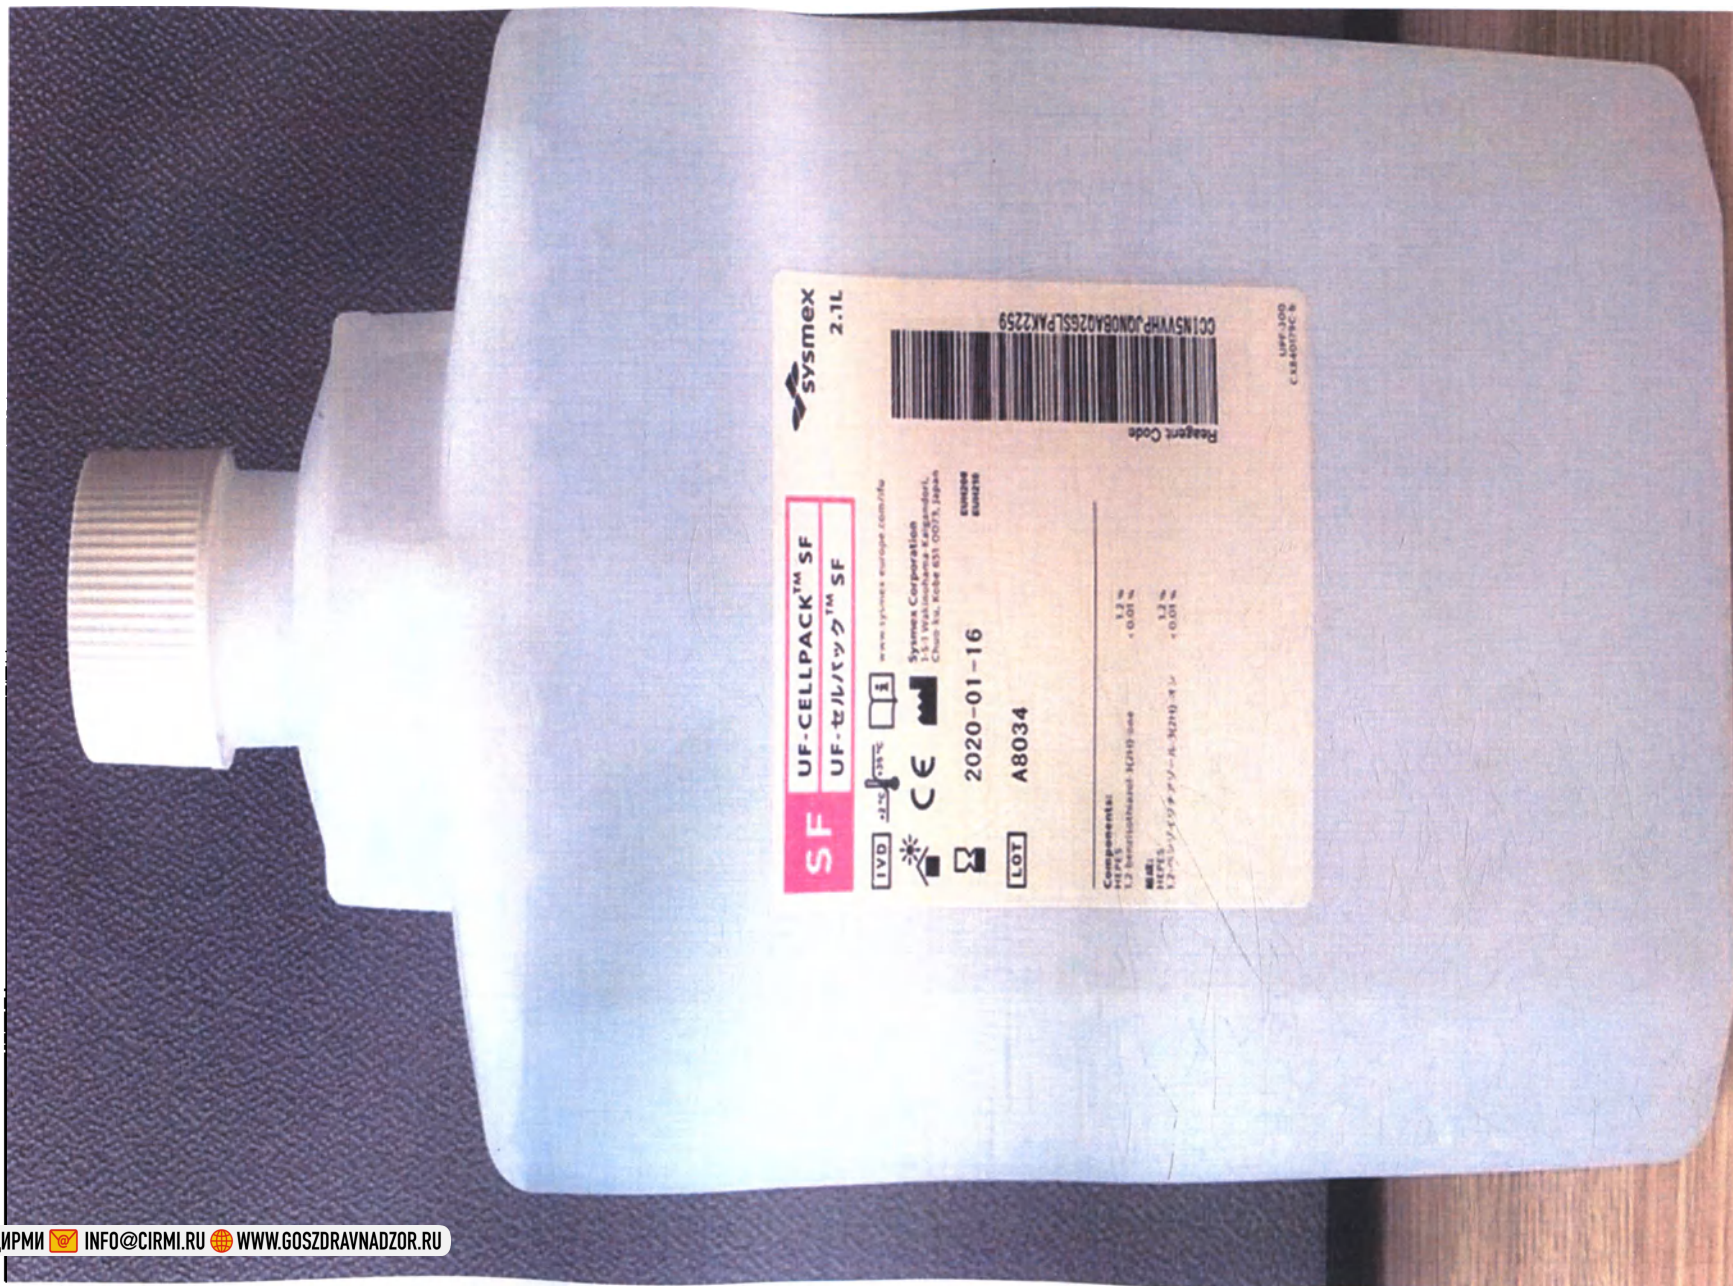

Дилуэнт UF-CELLPACK SF для автоматического анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000, UF-5000 (флакон, лот А 9038)

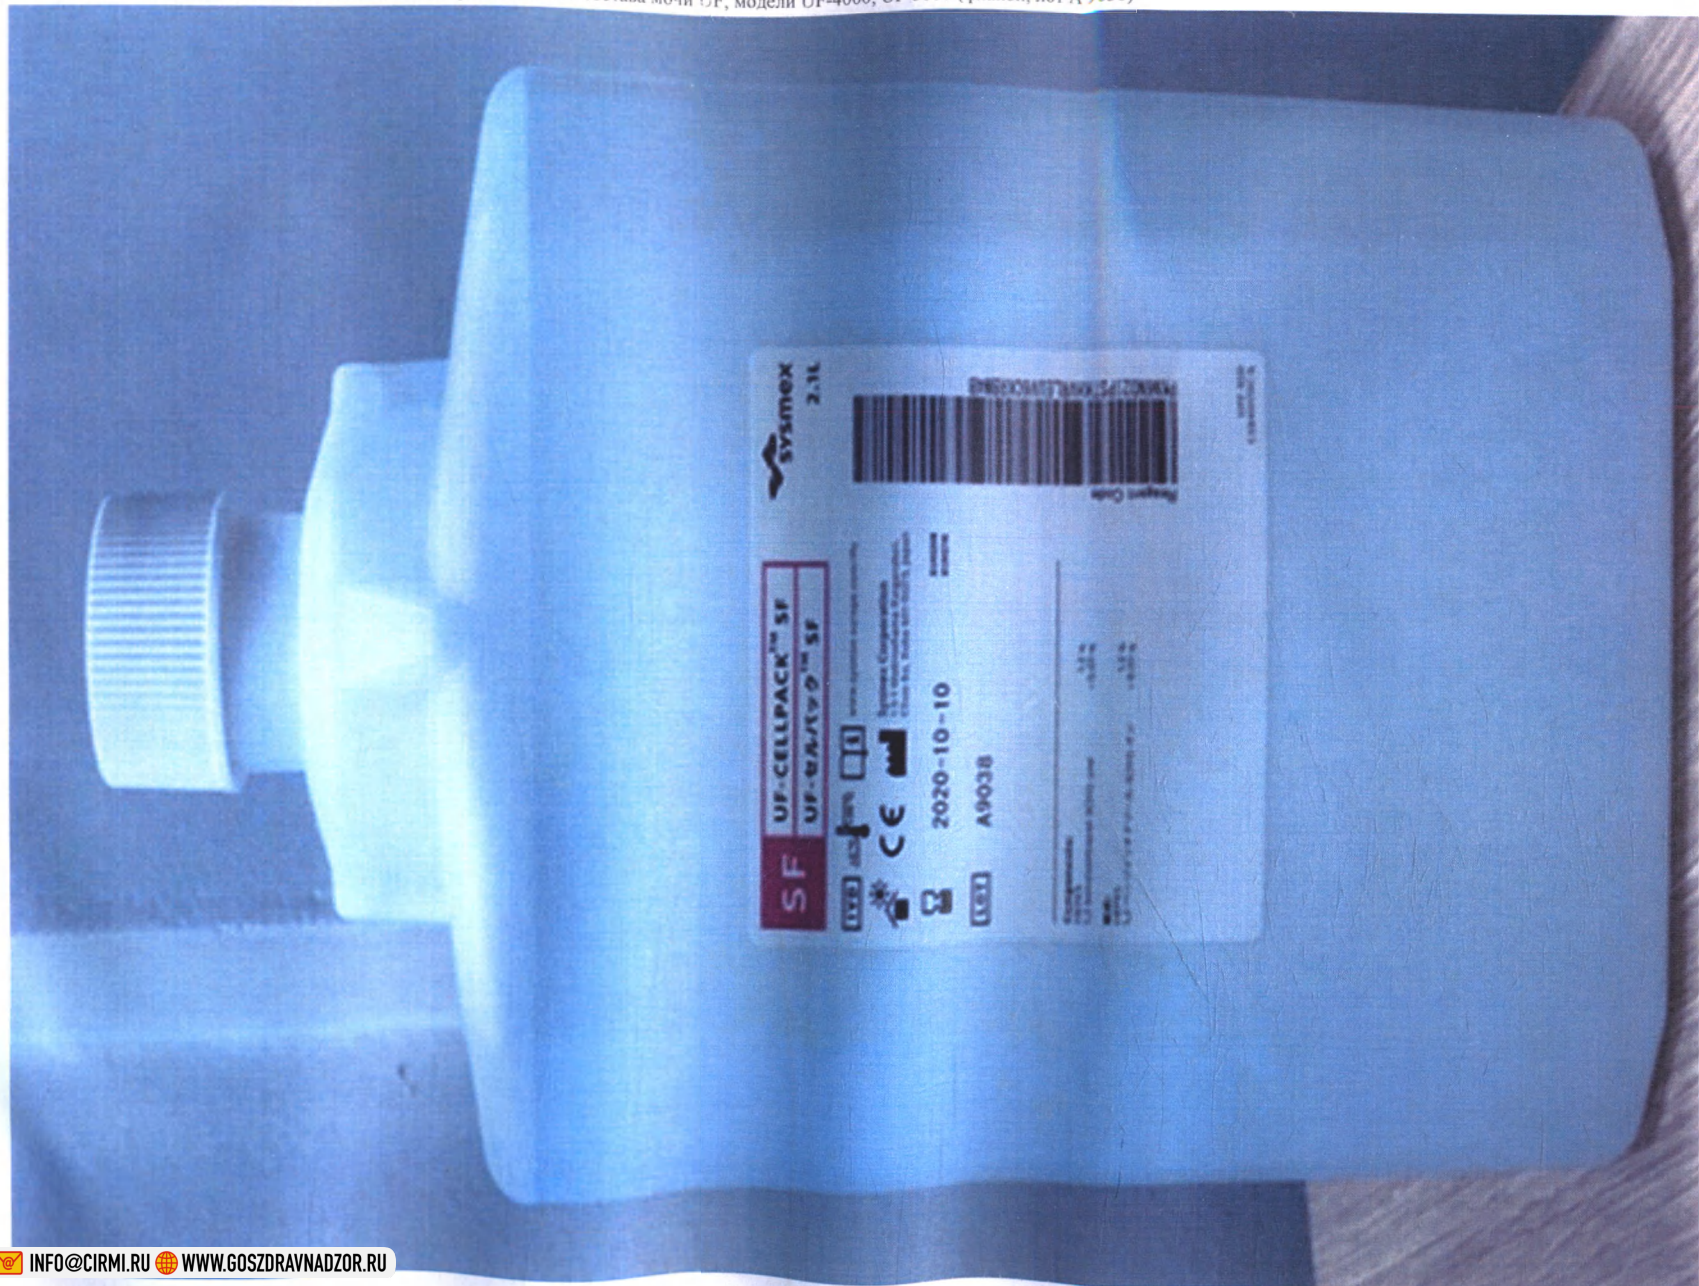

Дилуэнт UF-CELLPACK SF для автоматического анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000, UF-5000 (флакон, лот А 9039)

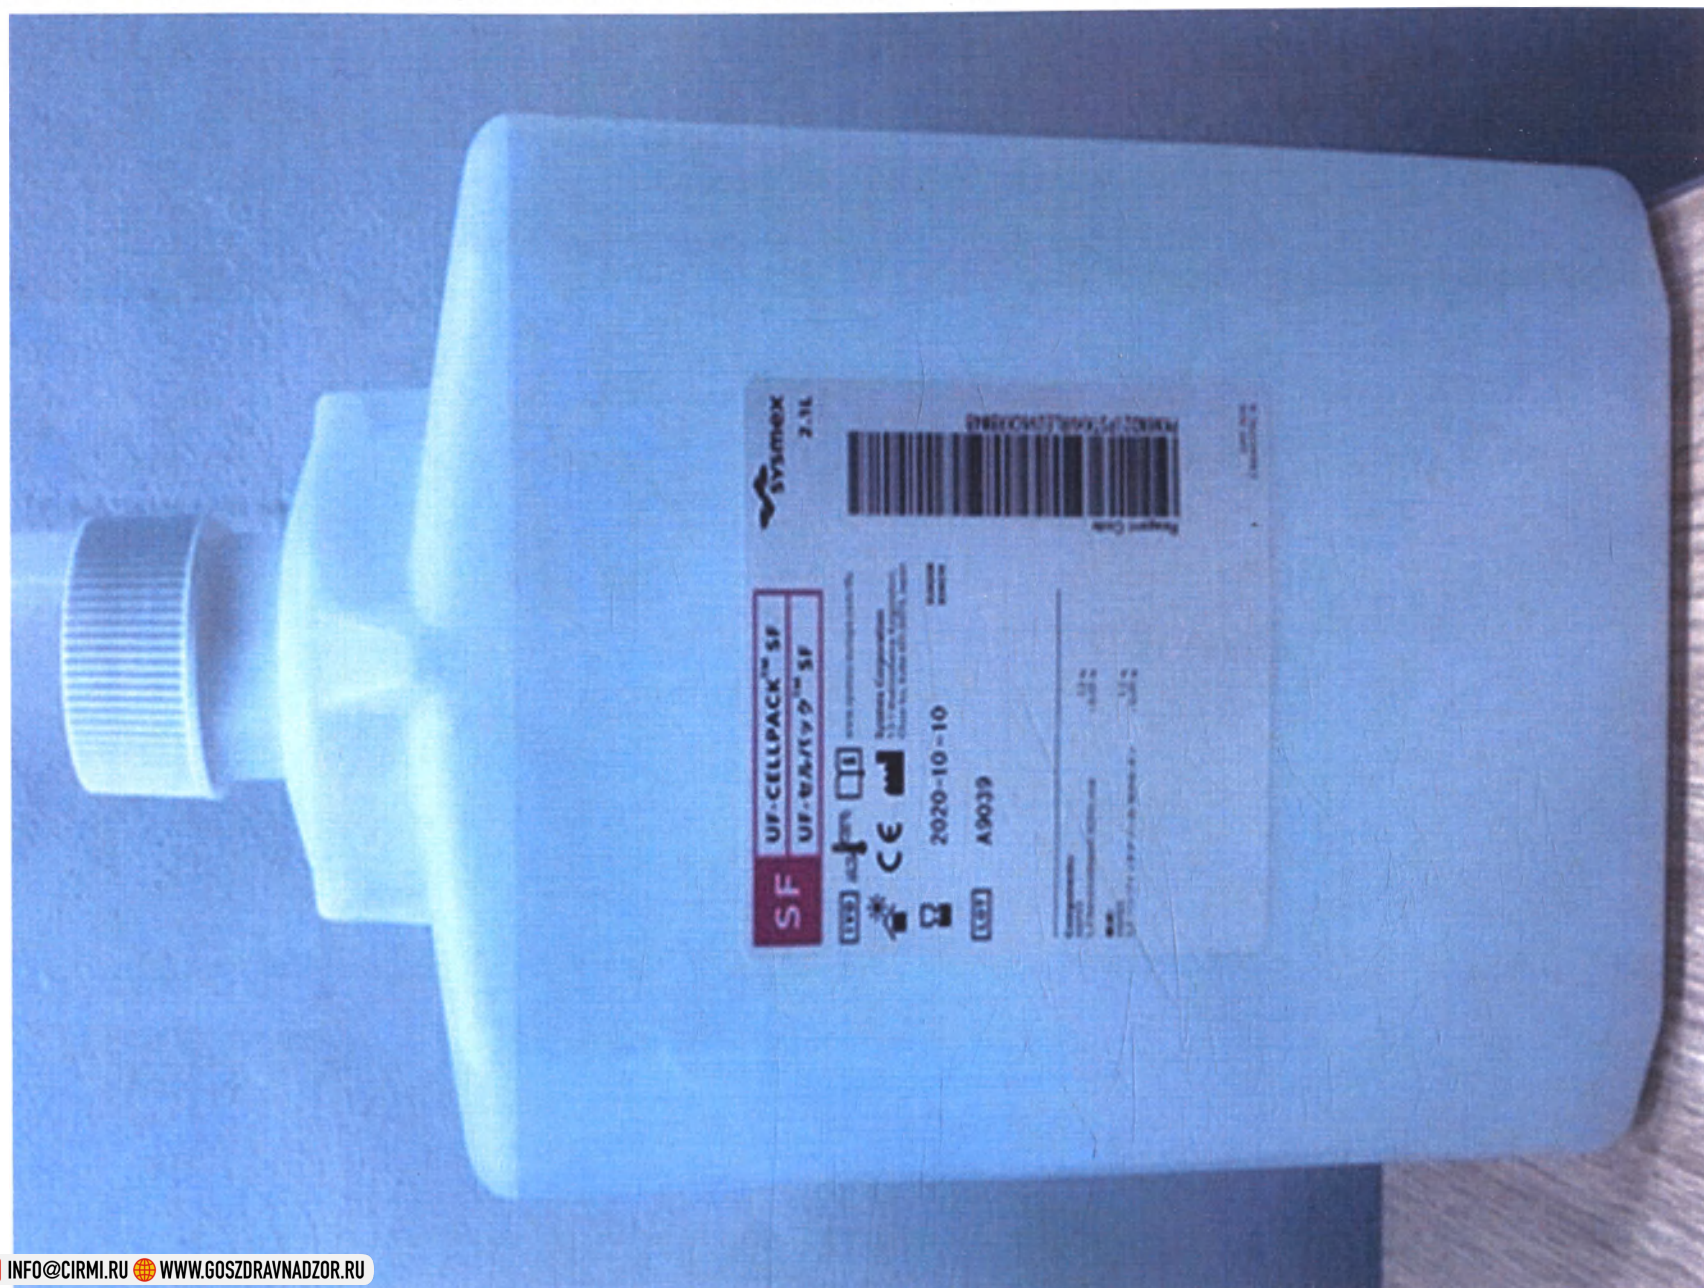

Пронумеровано, прошнуровано, прошито
и скреплено печатью

5 / листы

ЛИСТОВ

Руководитель департамента
по регистрации, сертификации
и качеству медицинских изделий
ООО «Сисмекс РУС»

А.О. Виглинская

