


«УТВЕРЖДАЮ»
Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»
М.А. Гребенкина
04 апреля 2024 г.

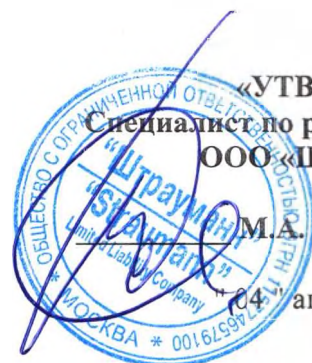

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Абатмент титановое основание ASC Flex,
MICROCONE/QUATTROCONE**



Рис. 1 Абатмент титановое основание ASC Flex, MICROCONE/QUATTROCONE, для коронки, платформа RI, десневая высота 1.2 мм, высота абатмента 3.5-6.5 мм, тип 1 / SF с винтом 1

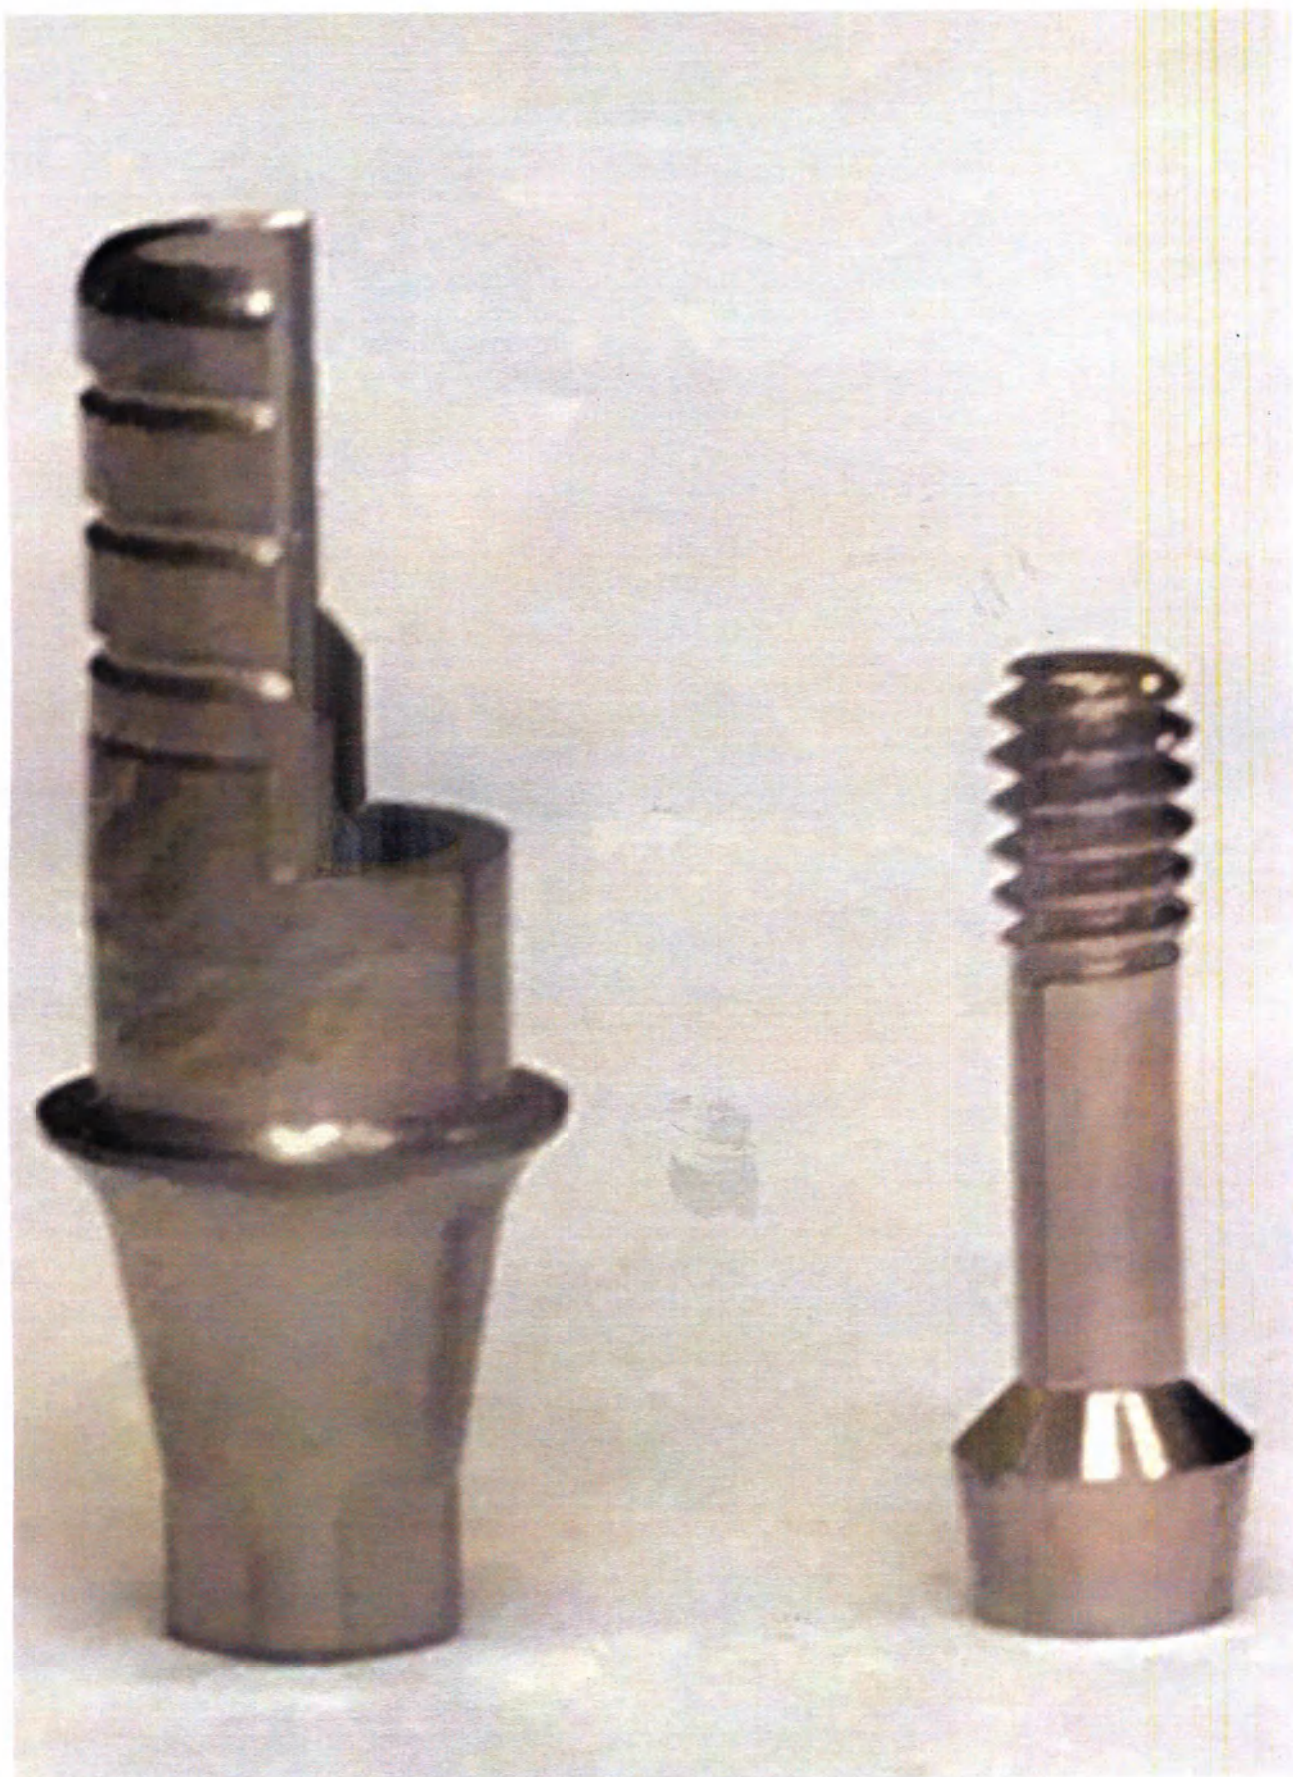


Рис. 2 Абатмент титановое основание ASC Flex, MICROCONE/QUATTROCONE, для коронки, платформа RI, десневая высота 1.2 мм, высота абатмента 3.5-6.5 мм, тип 2 / SC с винтом

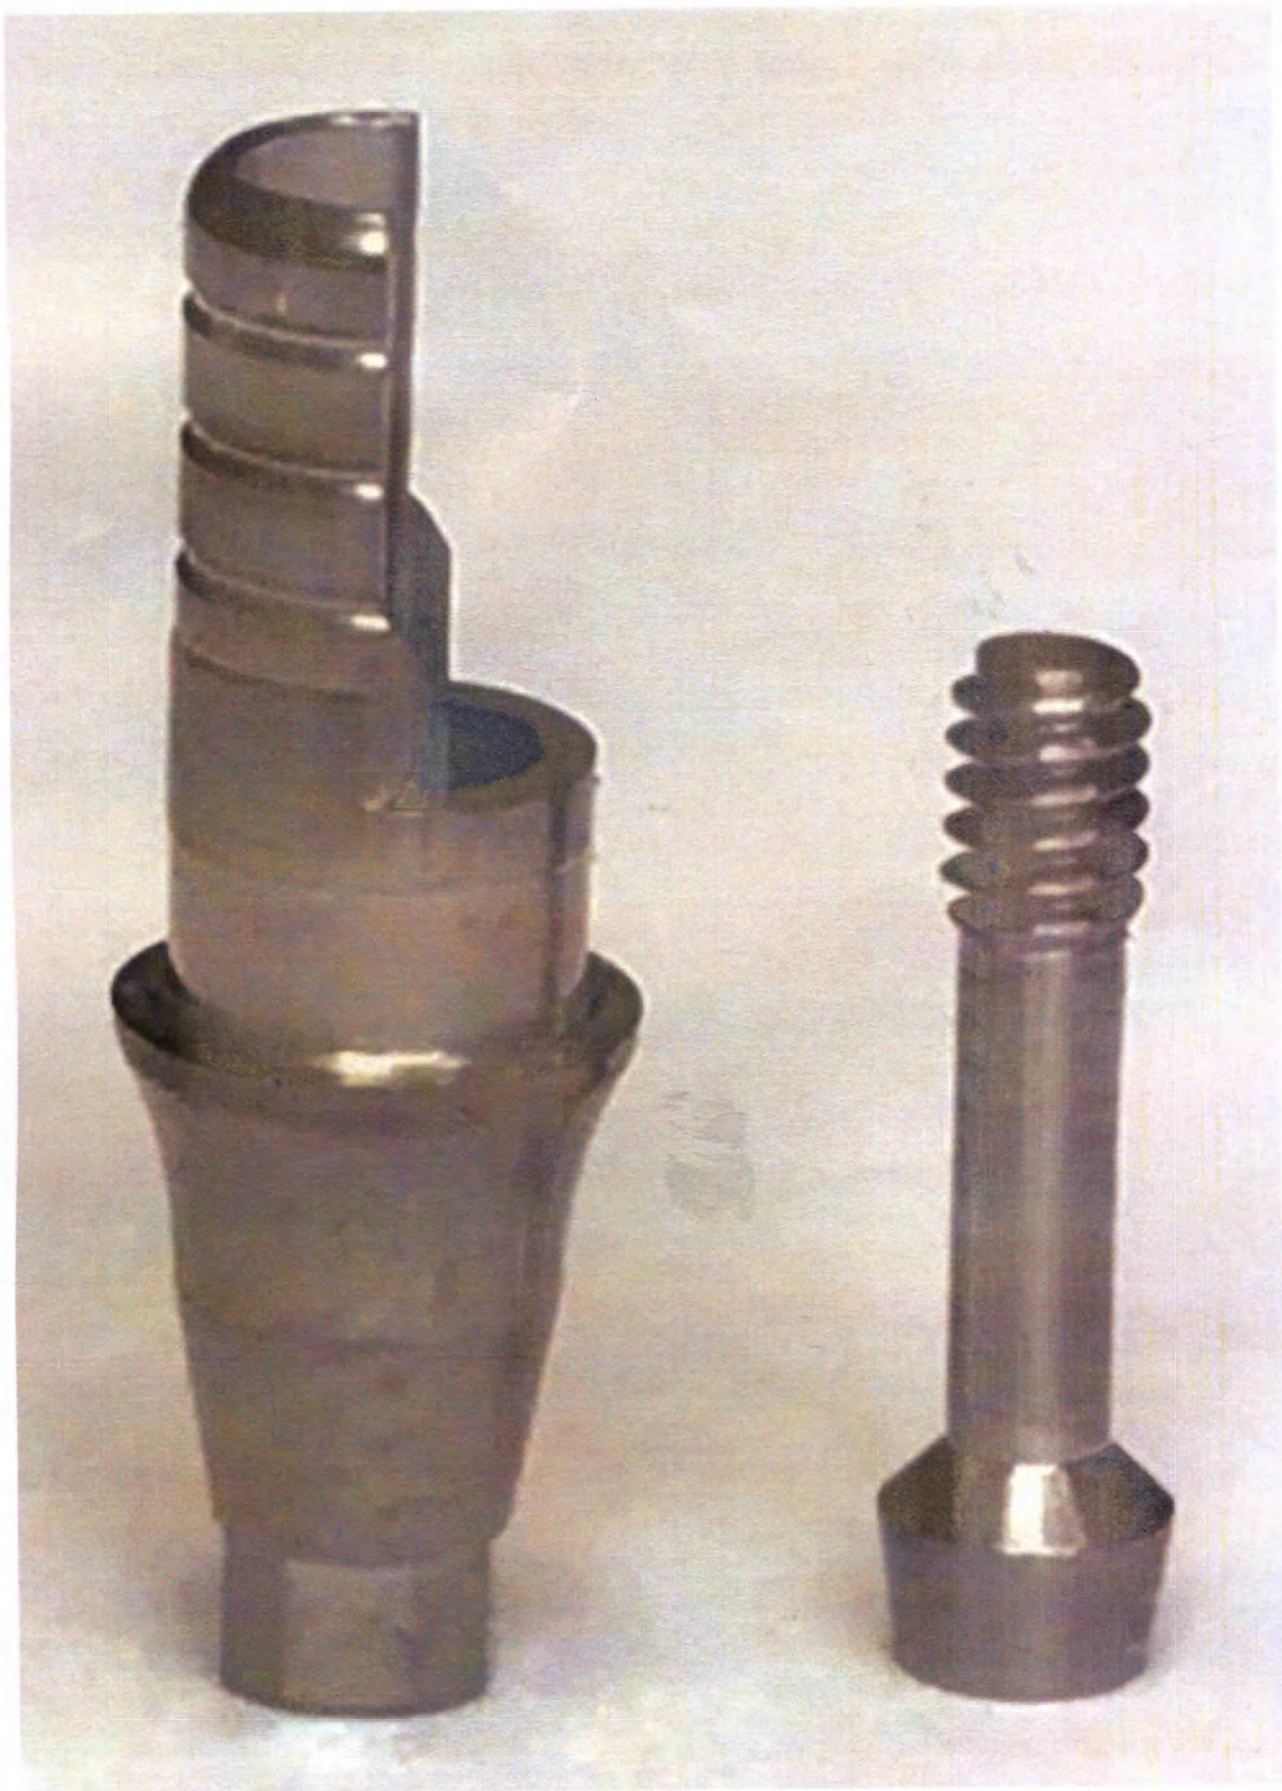


Рис. 3 Абатмент титановое основание ASC Flex, MICROCONE / QUATTROCONE, для коронки, платформа RI, десневая высота 2.5 мм, высота абатмента 3.5-6.5 мм, тип 1 / SF с винтом

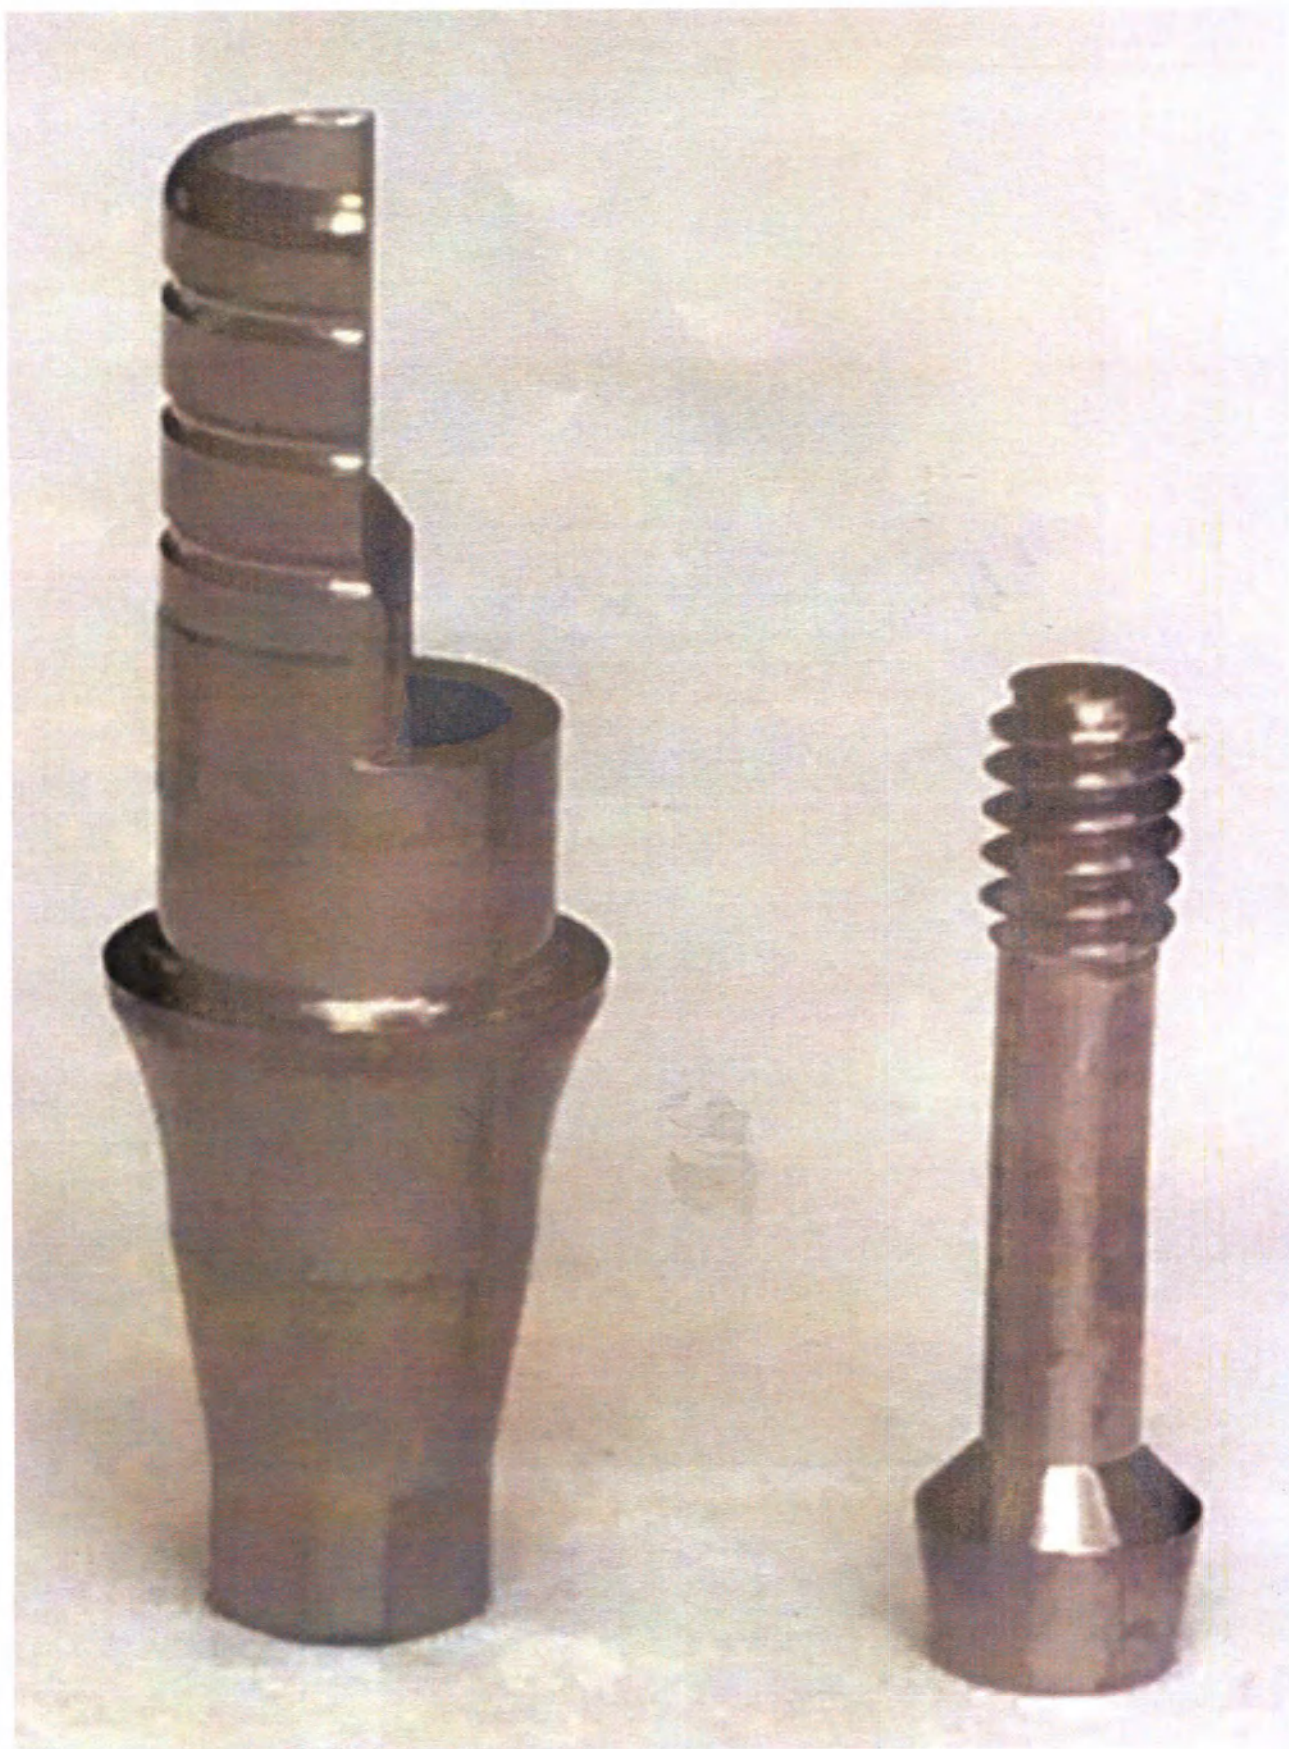


Рис. 4 Абатмент титановое основание ASC Flex, MICROCONE / QUATTROCONE, для коронки, платформа RI, десневая высота 2.5 мм, высота абатмента 3.5-4.5 мм, тип 2 / SC с винтом



Стикер для пациента

Рис. 3. Фотографии потребительской упаковки



Рис. 6 Пример маркировки на потребительской упаковке


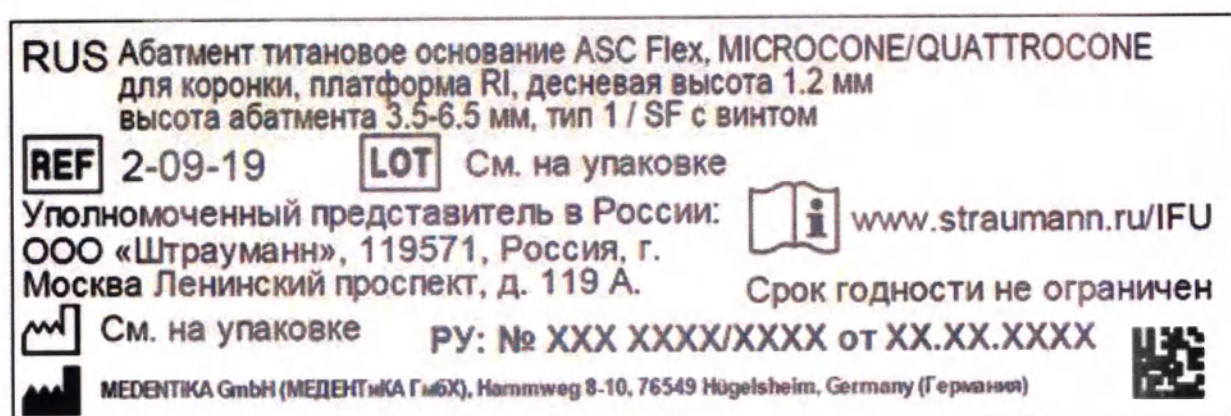


Рис. 7 Пример русскоязычного стикера

Рис. 8 Пример графической копии

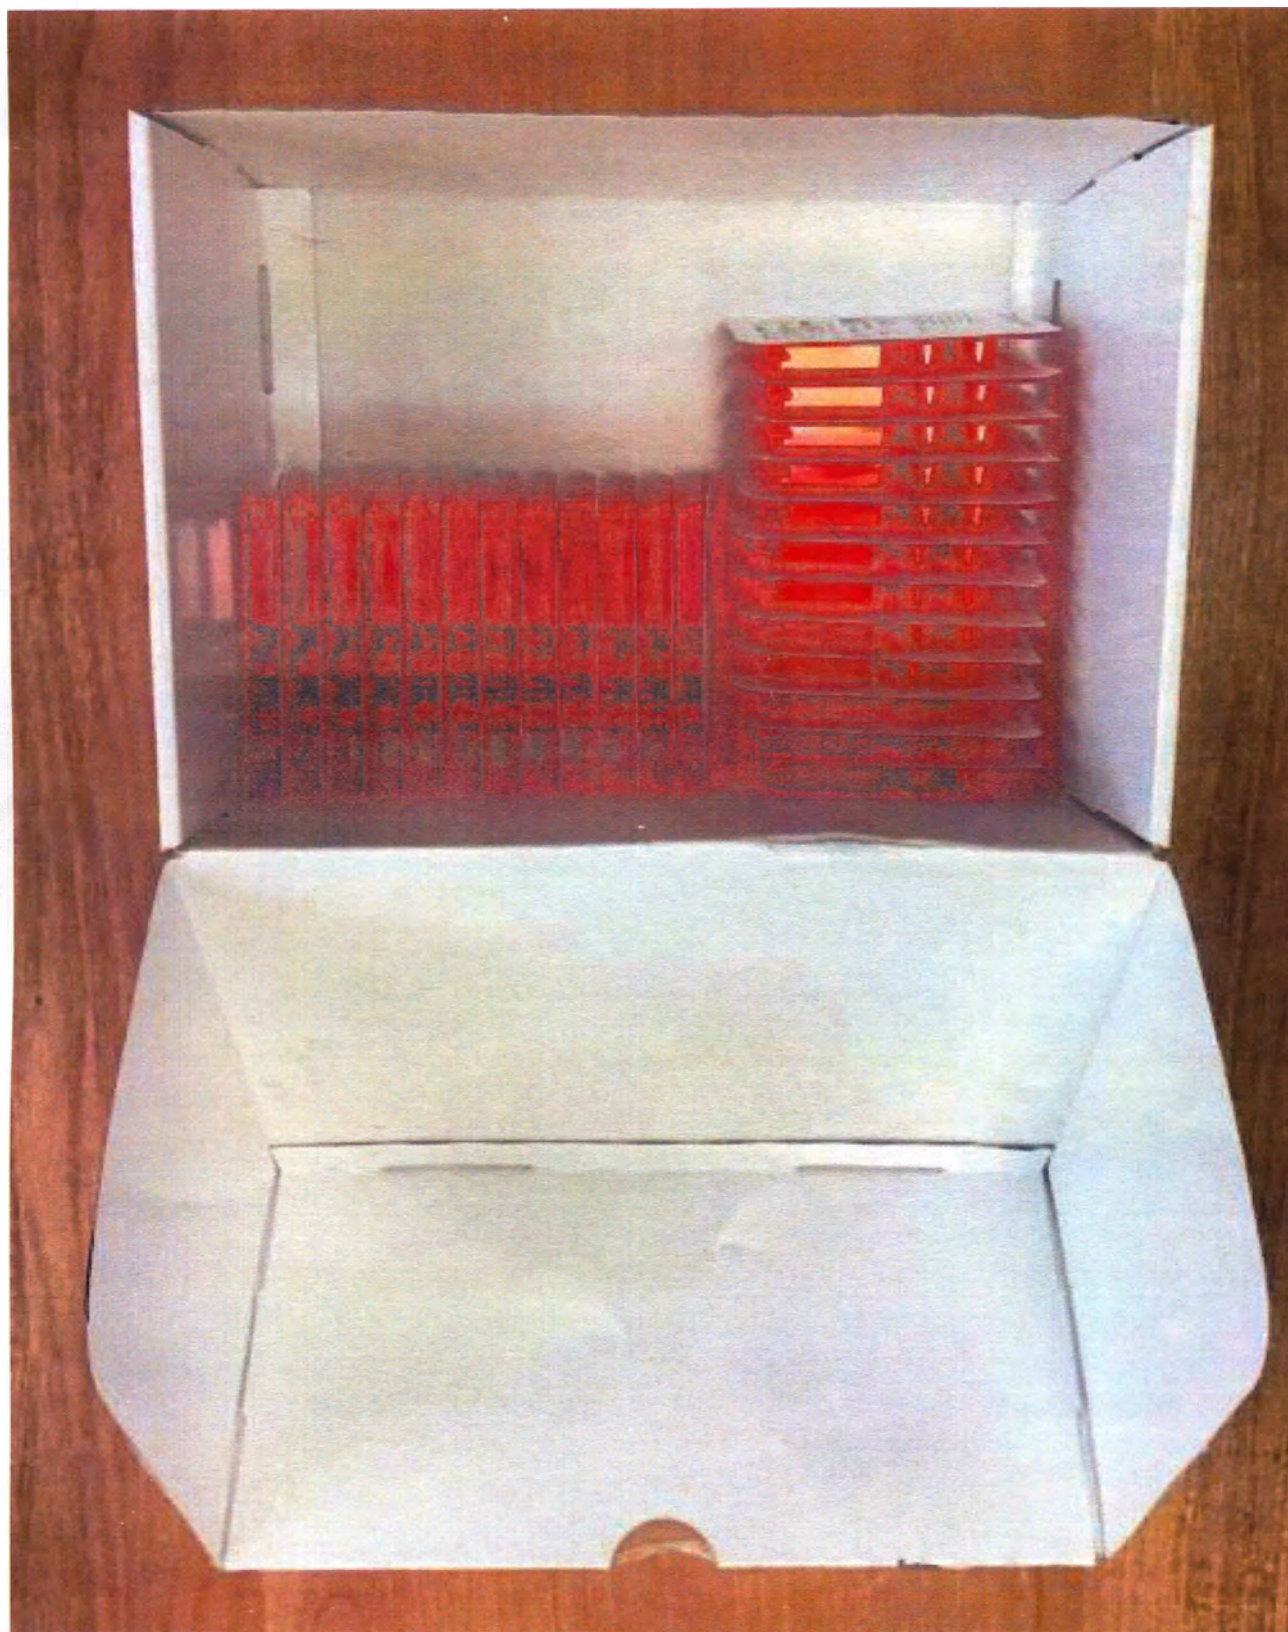

Прошнуровано 8 листа/ов

Специалист по регистрации
ООО «Штрауманн»

М.А.Гребенкина

