

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «СибАкадемТехнологии»

П.А. Самойлов
«05» мая 2023 г.
М.П.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ПЕТЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

Версия 1 от «05» мая 2023 г.

1. МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения	Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения
Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-1/S-W ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX ООО «СибАкадемТехнологии» 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1 Количество: 1 шт. ММ.ГГГГ Срок годности: ММ.ГГГГ LOT XXMMГГ REF XXXXXXXXXXXX Условия хранения: при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 % STERILE R	Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-5/S-W ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX ООО «СибАкадемТехнологии» 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1 Количество: 5 шт. ММ.ГГГГ Срок годности: ММ.ГГГГ LOT XXMMГГ REF XXXXXXXXXXXX Условия хранения: при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 % STERILE R
Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-10/S-W ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX ООО «СибАкадемТехнологии» 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1 Количество: 10 шт. ММ.ГГГГ Срок годности: ММ.ГГГГ LOT XXMMГГ REF XXXXXXXXXXXX Условия хранения: при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 % STERILE R	Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-20/S-W ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX ООО «СибАкадемТехнологии» 630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1 Количество: 20 шт. ММ.ГГГГ Срок годности: ММ.ГГГГ LOT XXMMГГ REF XXXXXXXXXXXX Условия хранения: при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 % STERILE R

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
синяя, артикул: LM-1-1/S-B

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «ОбАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ/ТТТ
Срок годности: ММ/ТТТ



LOT XXXMMT



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



STERILE R



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
синяя, артикул: LM-1-5/S-B

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «ОбАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ/ТТТ
Срок годности: ММ/ТТТ



LOT XXXMMT



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



STERILE R



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
синяя, артикул: LM-1-20/S-B

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «ОбАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ/ТТТ
Срок годности: ММ/ТТТ



LOT XXXMMT



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



STERILE R



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
синяя, артикул: LM-1-20/S-B

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «ОбАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ/ТТТ
Срок годности: ММ/ТТТ



LOT XXXMMT



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



STERILE R



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
желтая, артикул: LM-1-1/S-Y

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «ОбАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ/ТТТ
Срок годности: ММ/ТТТ



LOT XXXMMT



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



STERILE R



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
желтая, артикул: LM-1-5/S-Y

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «ОбАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ/ТТТ
Срок годности: ММ/ТТТ



LOT XXXMMT



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



STERILE R



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГТТГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
серийная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
желтая, артикул: LM-1-10/S-Y

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ




LOT XXXMMIT



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
серийная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
желтая, артикул: LM-1-20/S-Y

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMIT



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
серийная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
красная, артикул: LM-1-1/S-R

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMIT



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
серийная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
красная, артикул: LM-1-5/S-R

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMIT



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
серийная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
красная, артикул: LM-1-10/S-R

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMIT



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
серийная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

Петля микробиологическая Ø 1 мм,
красная, артикул: LM-1-20/S-R

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMIT



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 1 мм,
зеленая, артикул: LM-1-1/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ



LOT XXXMMTT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 1 мм,
зеленая, артикул: LM-1-5/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ



LOT XXXMMTT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 1 мм,
зеленая, артикул: LM-1-10/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ



LOT XXXMMTT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 1 мм,
зеленая, артикул: LM-1-20/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ



LOT XXXMMTT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
белая, артикул: LM-5-1/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ



LOT XXXMMTT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
белая, артикул: LM-5-5/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ



LOT XXXMMTT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ПТТТ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
белая, артикул: LM-5-10/S-W**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ




LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
белая, артикул: LM-5-20/S-W**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
синея, артикул: LM-5-1/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
синея, артикул: LM-5-5/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
синея, артикул: LM-5-10/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
синея, артикул: LM-5-20/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ/ГГГГ
Срок годности: ММ/ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением
последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки
относительно границ этикетки не нормировано.

Патла микробиологическа и биохимическа полимерна еднородна примесна
сериална по ТУ 23.05.00-000-72042304-0003 и маркирана автоматично

Патла микробиологическа Ø 5 мм,
жълта, артикул LM-S-1/S-Y

PY № XXXXXXXXXX от XJXJXX



ООО «Объединение»
630080 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Наличност: 1 шт.



Срок годности: M4/TTT



XJXJXX



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 1 MD

Патла микробиологическа и биохимическа полимерна еднородна примесна
сериална по ТУ 23.05.00-000-72042304-0003 и маркирана автоматично

Патла микробиологическа Ø 5 мм,
жълта, артикул LM-S-5/S-Y

PY № XXXXXXXXXX от XJXJXX



ООО «Объединение»
630080 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Наличност: 5 шт.



Срок годности: M4/TTT



XJXJXX



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 1 MD

Патла микробиологическа и биохимическа полимерна еднородна примесна
сериална по ТУ 23.05.00-000-72042304-0003 и маркирана автоматично

Патла микробиологическа Ø 5 мм,
жълта, артикул LM-S-10/S-Y

PY № XXXXXXXXXX от XJXJXX



ООО «Объединение»
630080 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Наличност: 20 шт.



Срок годности: M4/TTT



XJXJXX



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 1 MD

Патла микробиологическа и биохимическа полимерна еднородна примесна
сериална по ТУ 23.05.00-000-72042304-0003 и маркирана автоматично

Патла микробиологическа Ø 5 мм,
жълта, артикул LM-S-20/S-Y

PY № XXXXXXXXXX от XJXJXX



ООО «Объединение»
630080 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Наличност: 20 шт.



Срок годности: M4/TTT



XJXJXX



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 1 MD

Патла микробиологическа и биохимическа полимерна еднородна примесна
сериална по ТУ 23.05.00-000-72042304-0003 и маркирана автоматично

Патла микробиологическа Ø 5 мм,
красна, артикул LM-S-1/S-R

PY № XXXXXXXXXX от XJXJXX



ООО «Объединение»
630080 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Наличност: 1 шт.



Срок годности: M4/TTT



XJXJXX



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 1 MD

Патла микробиологическа и биохимическа полимерна еднородна примесна
сериална по ТУ 23.05.00-000-72042304-0003 и маркирана автоматично

Патла микробиологическа Ø 5 мм,
красна, артикул LM-S-5/S-R

PY № XXXXXXXXXX от XJXJXX



ООО «Объединение»
630080 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Наличност: 5 шт.



Срок годности: M4/TTT



XJXJXX



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 1 MD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГТТГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
красная, артикул: LM-5-10/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
красная, артикул: LM-5-20/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
зеленая, артикул: LM-5-1/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
зеленая, артикул: LM-5-5/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
зеленая, артикул: LM-5-10/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 5 мм,
зеленая, артикул: LM-5-20/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
бесцветная, артикул: LBS-1-1/S**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
бесцветная, артикул: LBS-1-5/S**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
бесцветная, артикул: LBS-1-10/S**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
бесцветная, артикул: LBS-1-20/S**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
белая, артикул: LBS-1-1/S-W**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
белая, артикул: LBS-1-5/S-W**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
белая, артикул: LBS-1-10/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
белая, артикул: LBS-1-20/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
голубая, артикул: LBS-1-1/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
голубая, артикул: LBS-1-5/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
голубая, артикул: LBS-1-10/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
голубая, артикул: LBS-1-20/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
желтая, артикул: LBS-1-1/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
желтая, артикул: LBS-1-5/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
желтая, артикул: LBS-1-10/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
желтая, артикул: LBS-1-20/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
красная, артикул: LBS-1-1/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
красная, артикул: LBS-1-5/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), MM – месяц, GTTГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
красная, артикул: LBS-1-10/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



ММ,ГГГГ
Срок годности: ММ,ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
красная, артикул: LBS-1-20/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



ММ,ГГГГ
Срок годности: ММ,ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
зеленая, артикул: LBS-1-1/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ,ГГГГ
Срок годности: ММ,ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
зеленая, артикул: LBS-1-5/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



ММ,ГГГГ
Срок годности: ММ,ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
зеленая, артикул: LBS-1-10/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



ММ,ГГГГ
Срок годности: ММ,ГГГГ




XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой,
зеленая, артикул: LBS-1-20/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



ММ,ГГГГ
Срок годности: ММ,ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением
последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки
относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
бесцветная, артикул: LBS-5-1/S**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.PTTT



XXMMPTT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
бесцветная, артикул: LBS-5-5/S**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



Срок годности: MM.PTTT



XXMMPTT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
бесцветная, артикул: LBS-5-10/S**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



Срок годности: MM.PTTT



XXMMPTT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
бесцветная, артикул: LBS-5-20/S**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



Срок годности: MM.PTTT



XXMMPTT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
белая, артикул: LBS-5-1/S-W**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.PTTT



XXMMPTT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
белая, артикул: LBS-5-5/S-W**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



Срок годности: MM.PTTT



XXMMPTT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение
последующего на строке текста), MM – месяц, ГТТГ и ГТ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки
относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
белая, артикул: LBS-5-10/S-W**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.

ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ

LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
белая, артикул: LBS-5-20/S-W**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.

ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ

LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
голубая, артикул: LBS-5-1/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.

ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ

LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
голубая, артикул: LBS-5-5/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.

ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ

LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
голубая, артикул: LBS-5-10/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.

ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ

LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
голубая, артикул: LBS-5-20/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.

ММ.ПТТТ
Срок годности: ММ.ПТТТ

LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %

STERILE R 2 3 i IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ПТТТ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
желтая, артикул: LBS-5-1/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
желтая, артикул: LBS-5-5/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
желтая, артикул: LBS-5-10/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
желтая, артикул: LBS-5-20/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
красная, артикул: LBS-5-1/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
красная, артикул: LBS-5-5/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение
последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки
относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
красная, артикул: LBS-5-10/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
красная, артикул: LBS-5-20/S-R**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
зеленая, артикул: LBS-5-1/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
зеленая, артикул: LBS-5-5/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
зеленая, артикул: LBS-5-10/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой,
зеленая, артикул: LBS-5-20/S-G**

РУ № XXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXXMMГГ



REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
бесцветная, артикул: LBS-1/5-1/S**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
бесцветная, артикул: LBS-1/5-5/S**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
бесцветная, артикул: LBS-1/5-10/S**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
бесцветная, артикул: LBS-1/5-20/S**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
белая, артикул: LBS-1/5-1/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
белая, артикул: LBS-1/5-5/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
белая, артикул: LBS-1/5-10/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.

 ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R    **IVD**

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
белая, артикул: LBS-1/5-20/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.

 ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R    **IVD**

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
голубая, артикул: LBS-1/5-1/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.

 ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R    **IVD**

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
голубая, артикул: LBS-1/5-5/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 5 шт.

 ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R    **IVD**

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
голубая, артикул: LBS-1/5-10/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 шт.

 ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R    **IVD**

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
голубая, артикул: LBS-1/5-20/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 20 шт.

 ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R    **IVD**

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
желтая, артикул: LBS-1/5-1/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
желтая, артикул: LBS-1/5-5/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
желтая, артикул: LBS-1/5-10/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
желтая, артикул: LBS-1/5-20/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
красная, артикул: LBS-1/5-1/S-R**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
красная, артикул: LBS-1/5-5/S-R**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением следующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная одноразового применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
красная, артикул: LBS-1/5-10/S-R**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



STERILE



R



2



i



IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная одноразового применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
красная, артикул: LBS-1/5-20/S-R**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



STERILE



R



2



i



IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная одноразового применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
зеленая, артикул: LBS-1/5-1/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



STERILE



R



2



i



IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная одноразового применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
зеленая, артикул: LBS-1/5-5/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 5 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



STERILE



R



2



i



IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная одноразового применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
зеленая, артикул: LBS-1/5-10/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 10 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



STERILE



R



2



i



IVD

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная одноразового применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля бактериологическая Ø 1+5 мм,
зеленая, артикул: LBS-1/5-20/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 20 шт.



ММ.ГГГГ

Срок годности: ММ.ГГГГ



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



STERILE



R



2



i



IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением
последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки
относительно границ этикетки не нормировано.

2. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ (ГРУППОВОЙ) УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пример маркировки транспортной (групповой) упаковки:

Петля микробиологическая и бактериологическая полимерная однократного применения
стерильная по ТУ 32.50.50-010-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Петля микробиологическая Ø 1 мм,
белая, артикул: LM-1-1/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

 ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1000 упаковок по 1 петле

 ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ
Условия хранения и транспортирования:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Масса брутто: XXXX кг

Примечание: при необходимости вместо «Петля микробиологическая Ø 1 мм, белая, артикул: LM-1-1/S-W» и «1000 упаковок по 1 петле» указывается требуемое наименование варианта исполнения и количество соответственно, согласно приведенным на маркировке потребительской упаковки, а также ТУ 32.50.50-010-72241324-2023.

Значения в **Масса брутто** допускается указывать от руки или с помощью клише.

Расположение информации и символов не нормировано.

3. ЭТИКЕТКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Маркировка потребительской и транспортной (групповой) упаковки медицинского изделия наносится на этикетку с фоном.

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 20 (*двадцати*) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»

ПА

П.А. Самойлов

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СибАкадемТехнологии»



С.А. Самойлов

«05» мая 2023 г.

М.П.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**ПЕТЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 32.50.50-010-72241324-2023
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Версия 1 от «05» мая 2023 г.


2023 г.

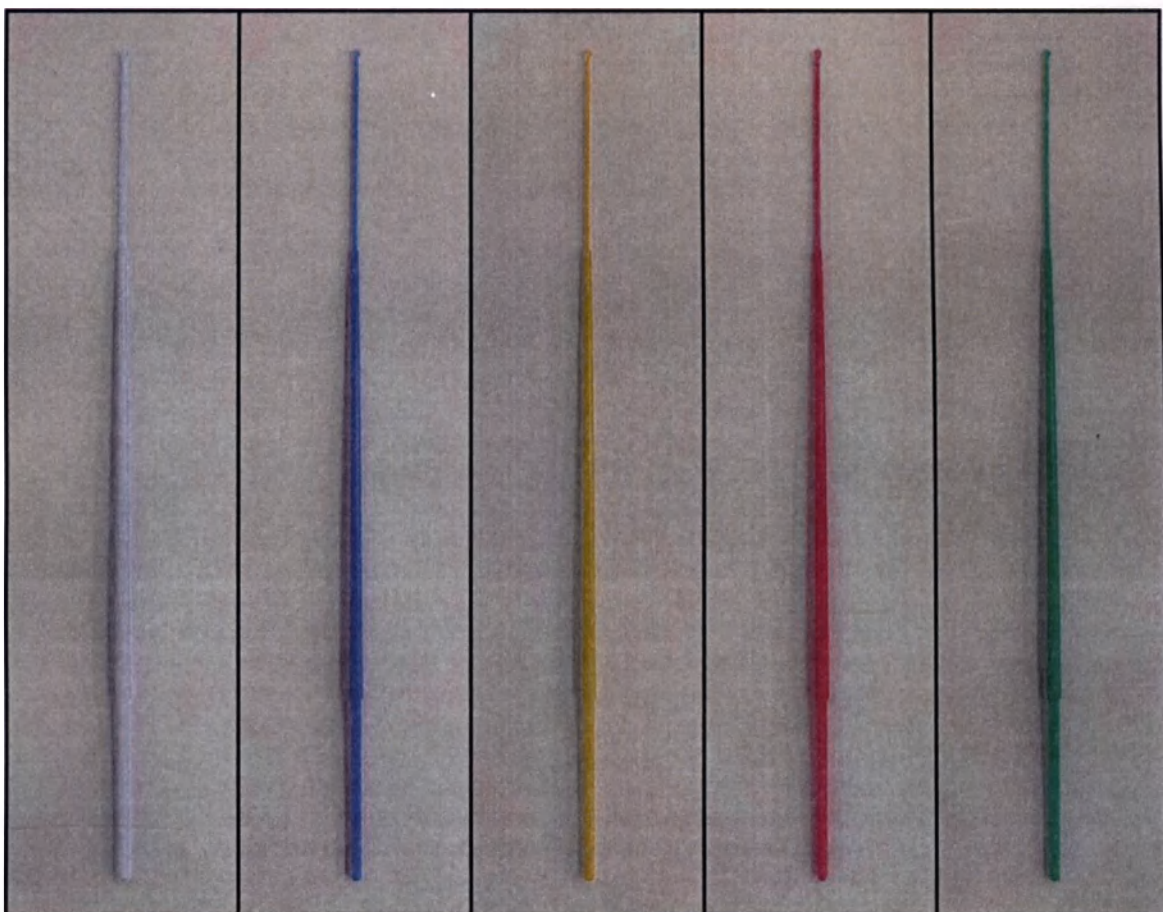

Внешний вид сокр. Петля микробиологическая $\varnothing$ 1 мм




Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки

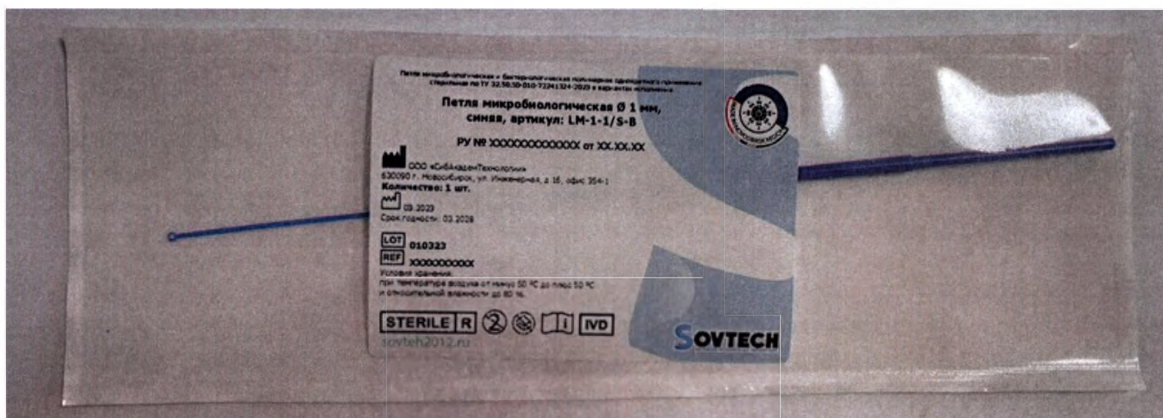

Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки




Внешний вид сокр. Петля микробиологическая Ø 5 мм

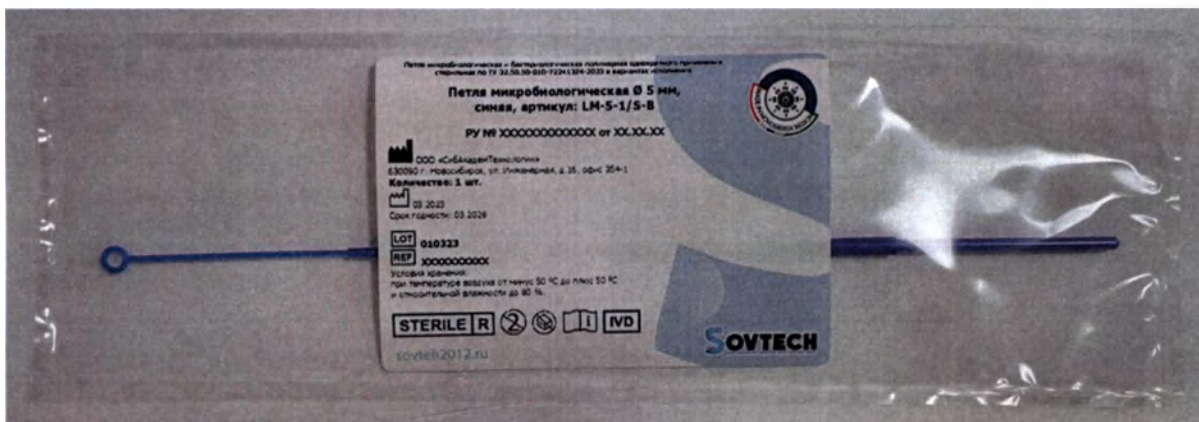


Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки



Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки

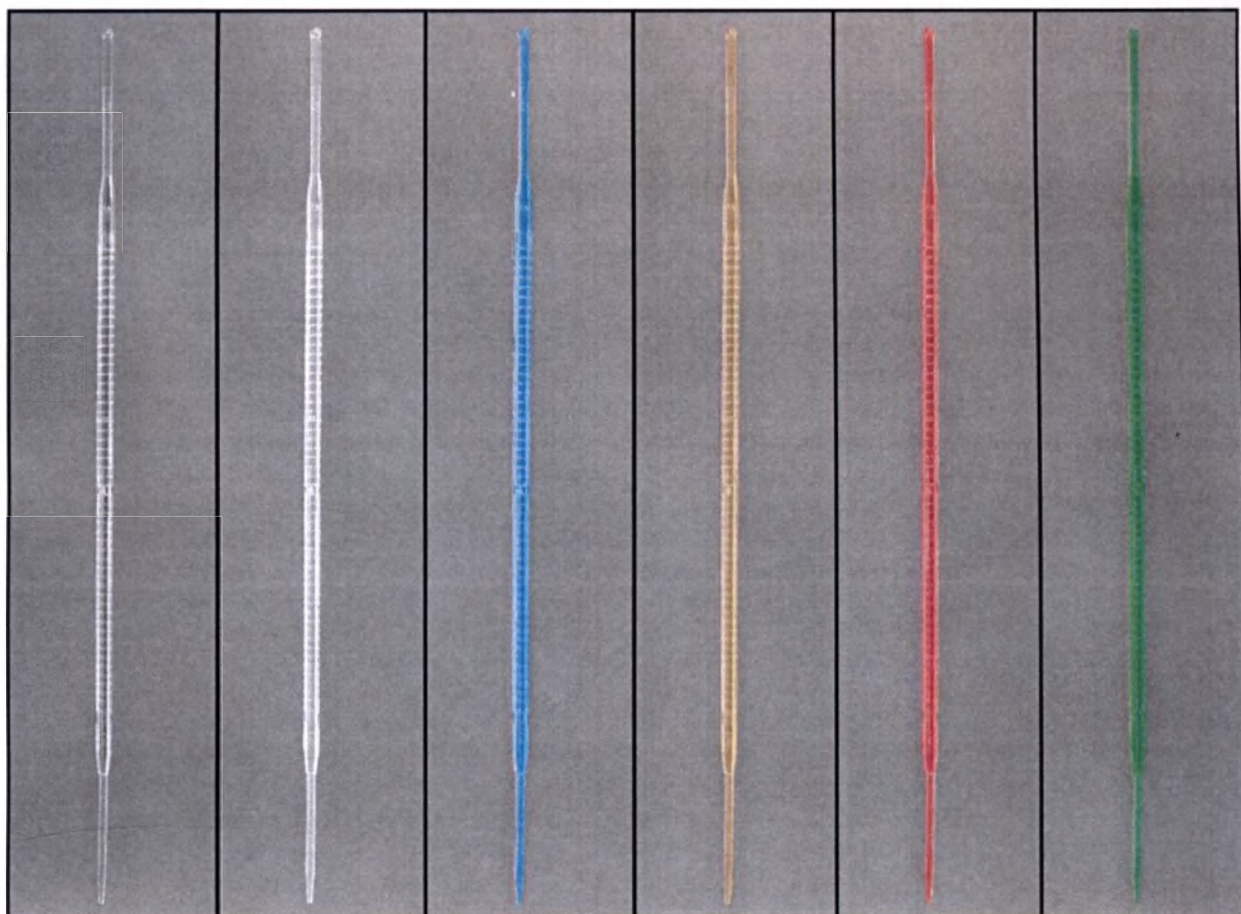


Внешний вид сокр. Петля бактериологическая Ø 1 мм с иглой

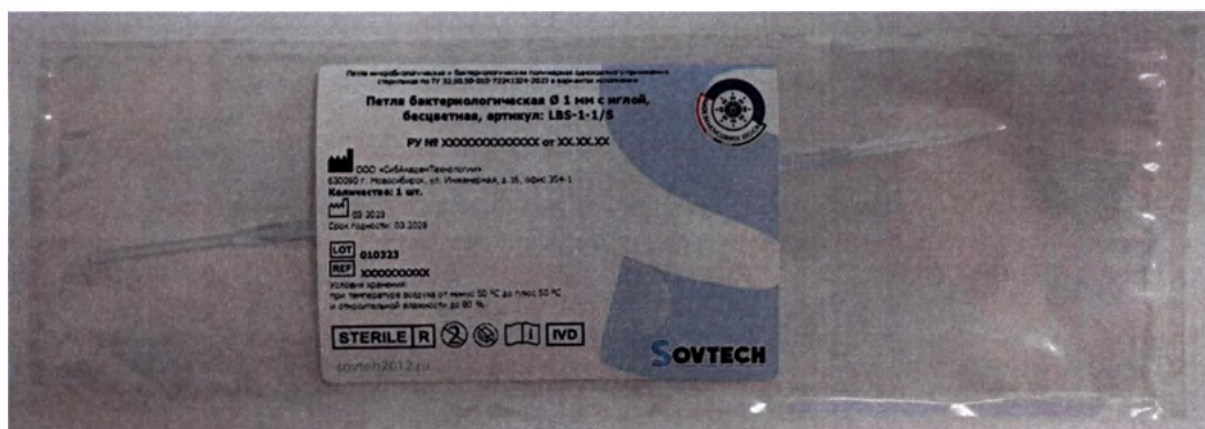

Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки



Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки

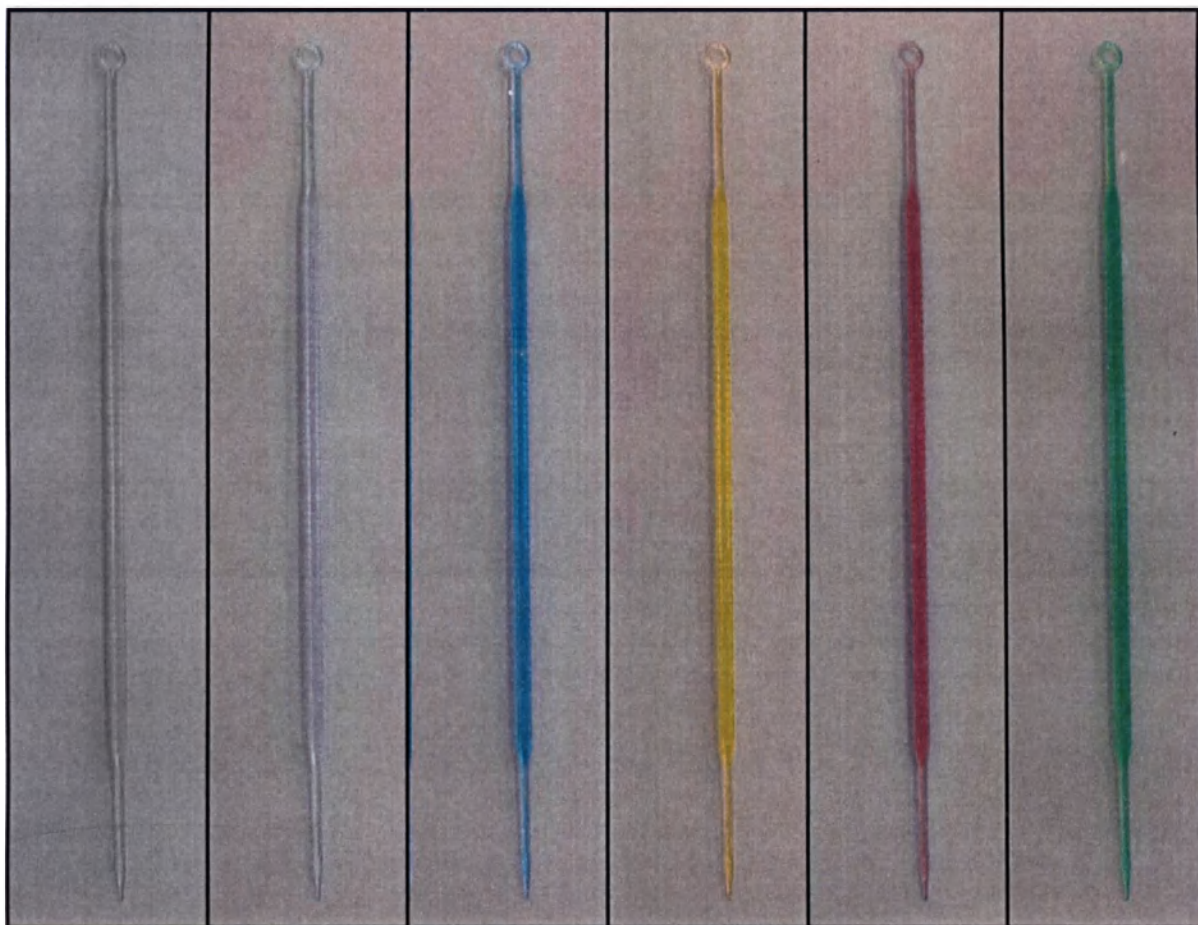


Внешний вид сокр. Петля бактериологическая Ø 5 мм с иглой



Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки



Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки

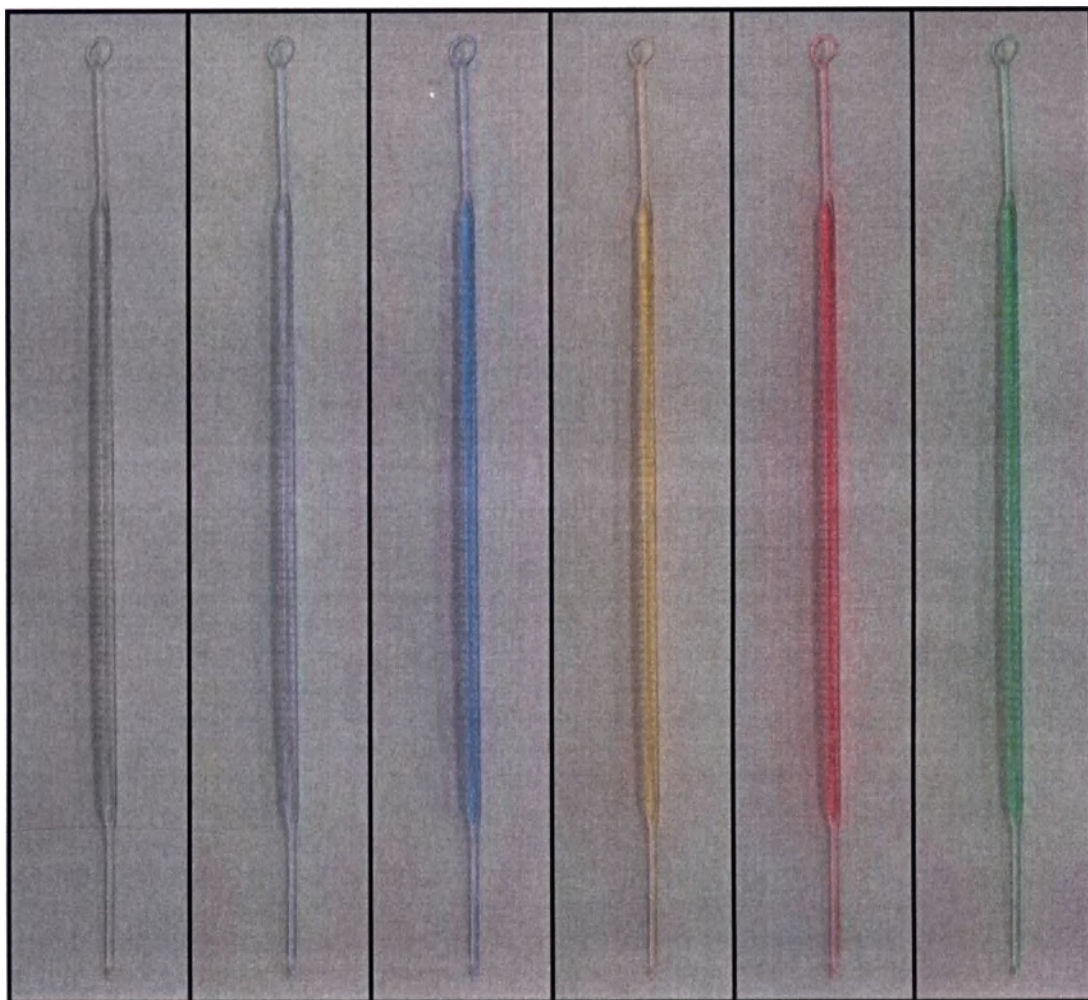

Внешний вид сокр. Петля бактериологическая Ø 1+5 мм



Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки, количество петлей 1 шт.



Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки, количество петлей 1 шт.




Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки, количество петель 5 шт.




Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки, количество петель 5 шт.



Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки, количество петель 10 шт.

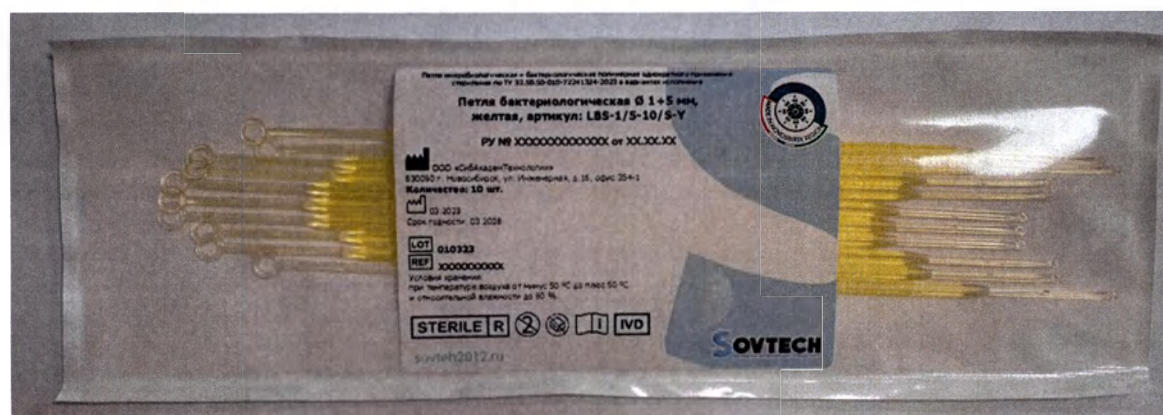

Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки, количество петель 10 шт.

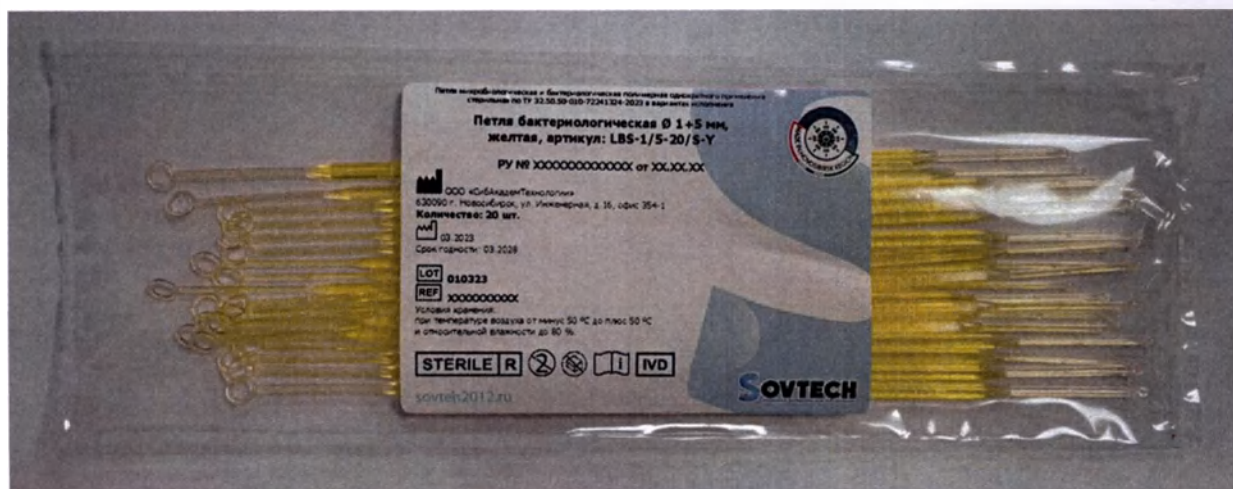

Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки, количество петель 20 шт.



Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки, количество петель 20 шт.



Образец транспортной (групповой) упаковки и ее маркировки, количество 100 упаковок по 20 петель

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 8 (*восемь*) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»

С.А. П.А. Самойлов

