

Директор

ООО «Медика Продакт»

Михалева Е.М.

2019 г.



**Фотографические изображения медицинского изделия
«Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 TOUCH (КУБ 30 ТАЧ), с
принадлежностями»**

производства «ДИЕССЕ Диагностика Сенезе С.п.А.», Италия

(«DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.», Via Solari, 19, 20144 Milano, Italy;Тел.: +39 02 48 59 121.

Факс: +39 02 48 00 85 30, E-mail: salesoffice@diesse.it).




Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 TOUCH (КУБ 30 ТАЧ)




Кабель питания




Предохранители

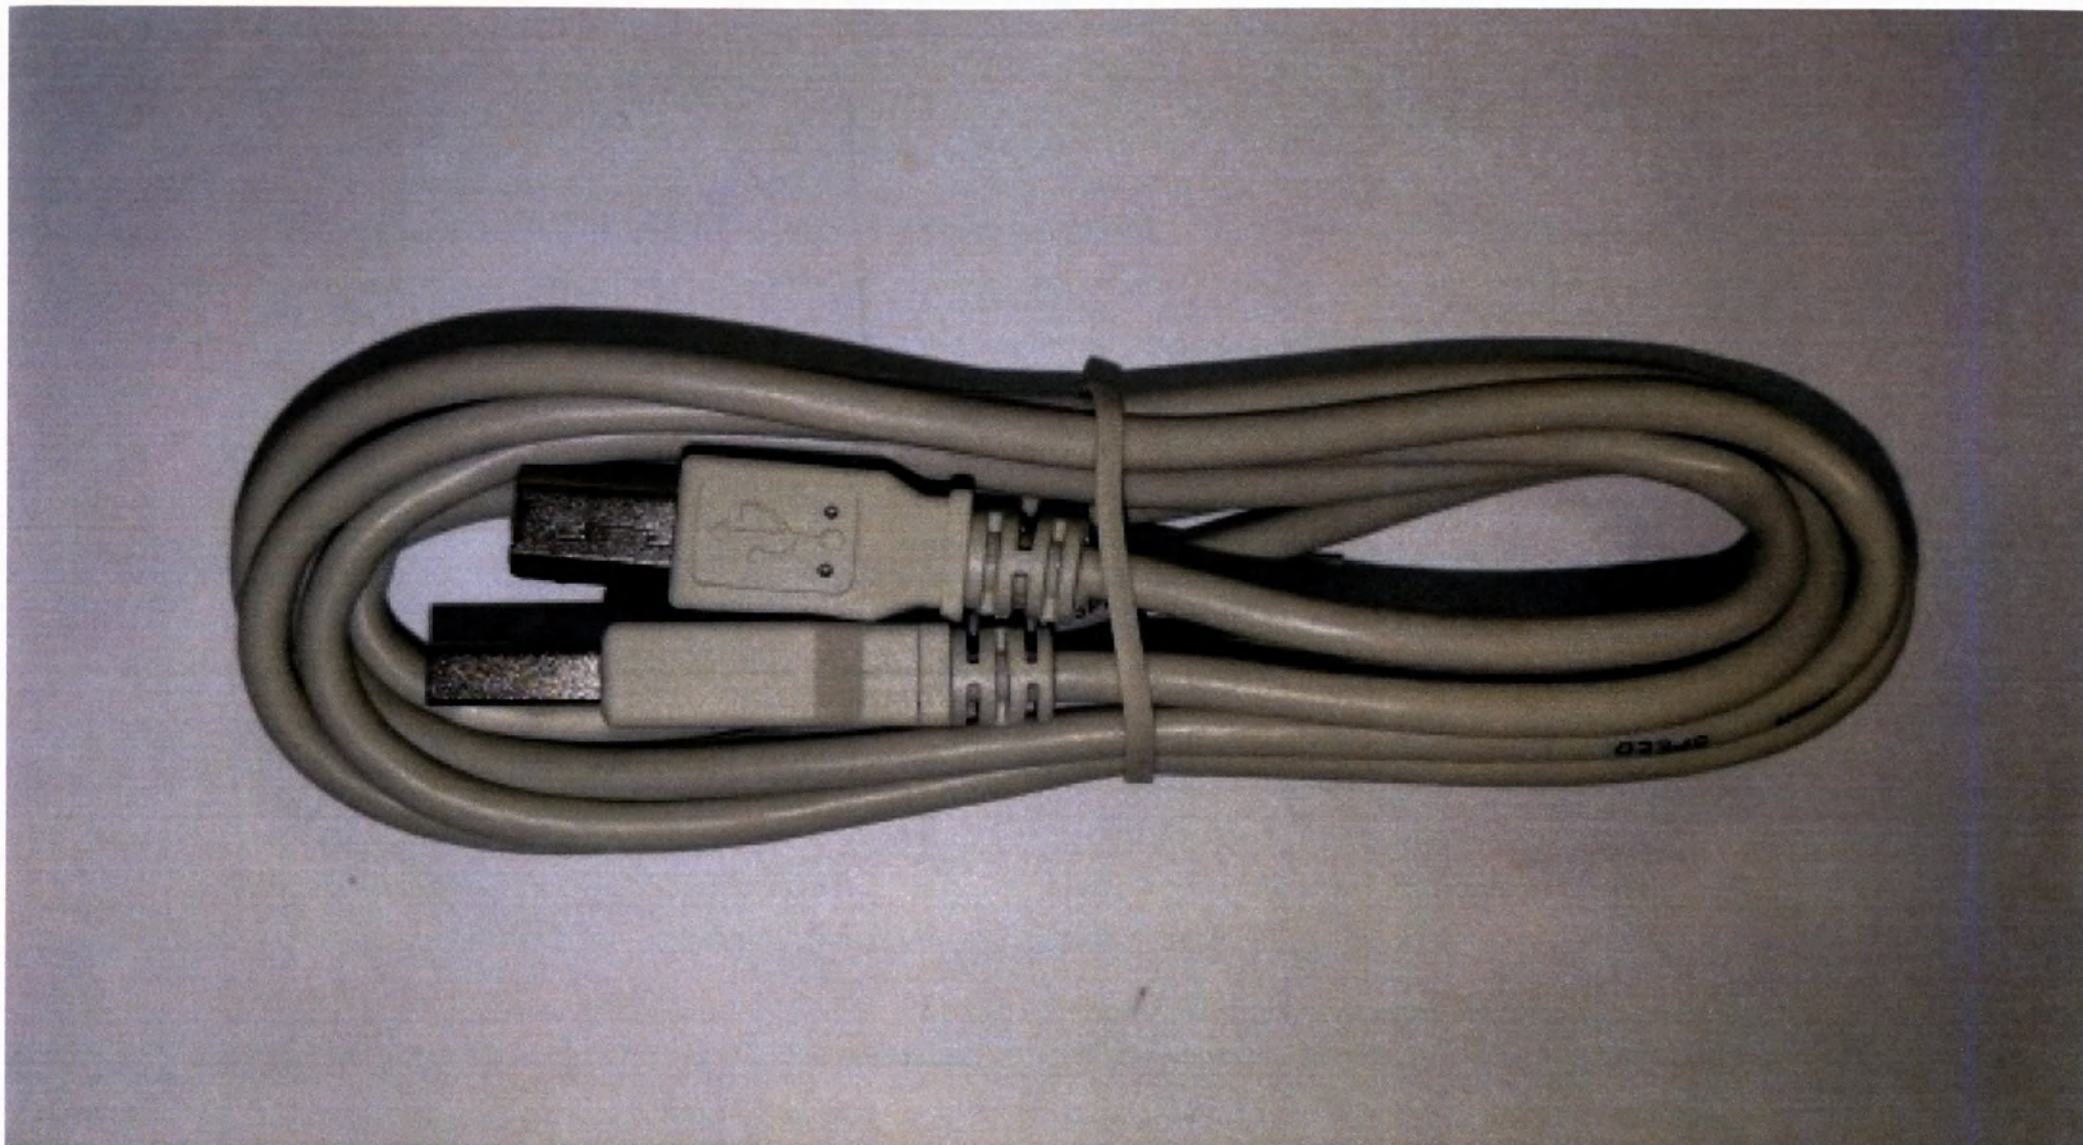


USB-кабель

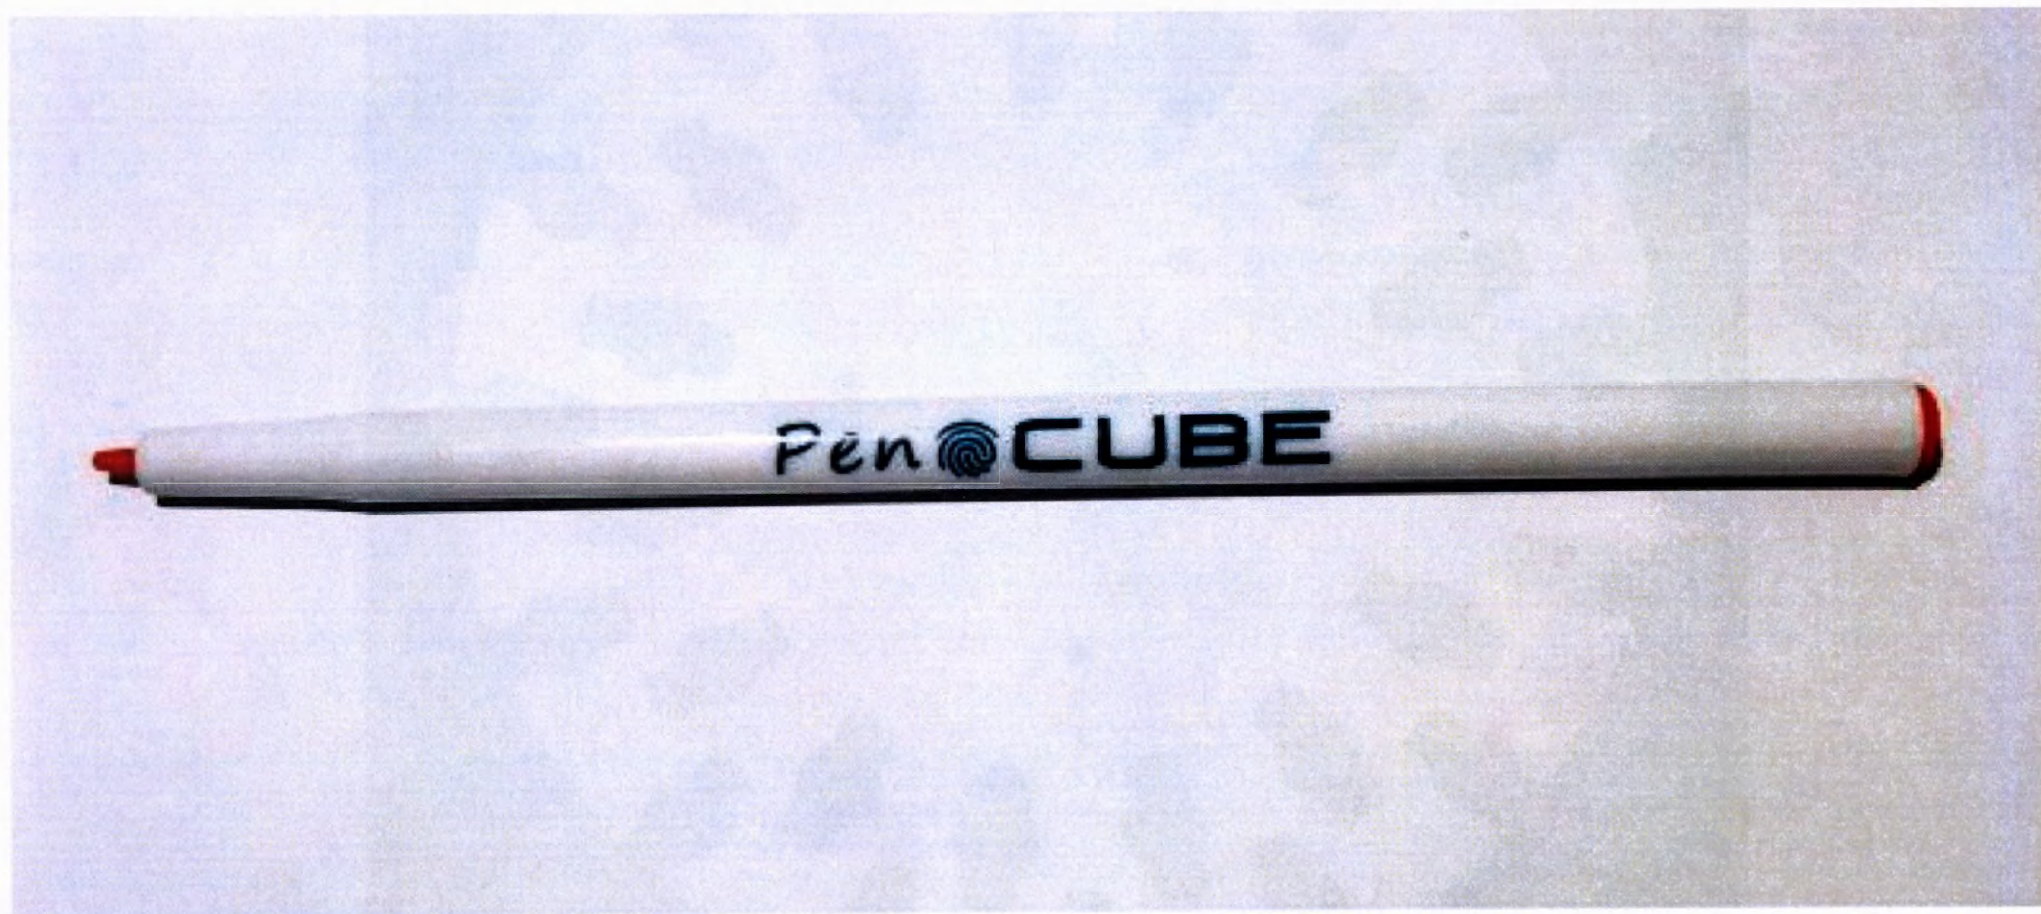

Стилус для сенсорного экрана «Cube pen»

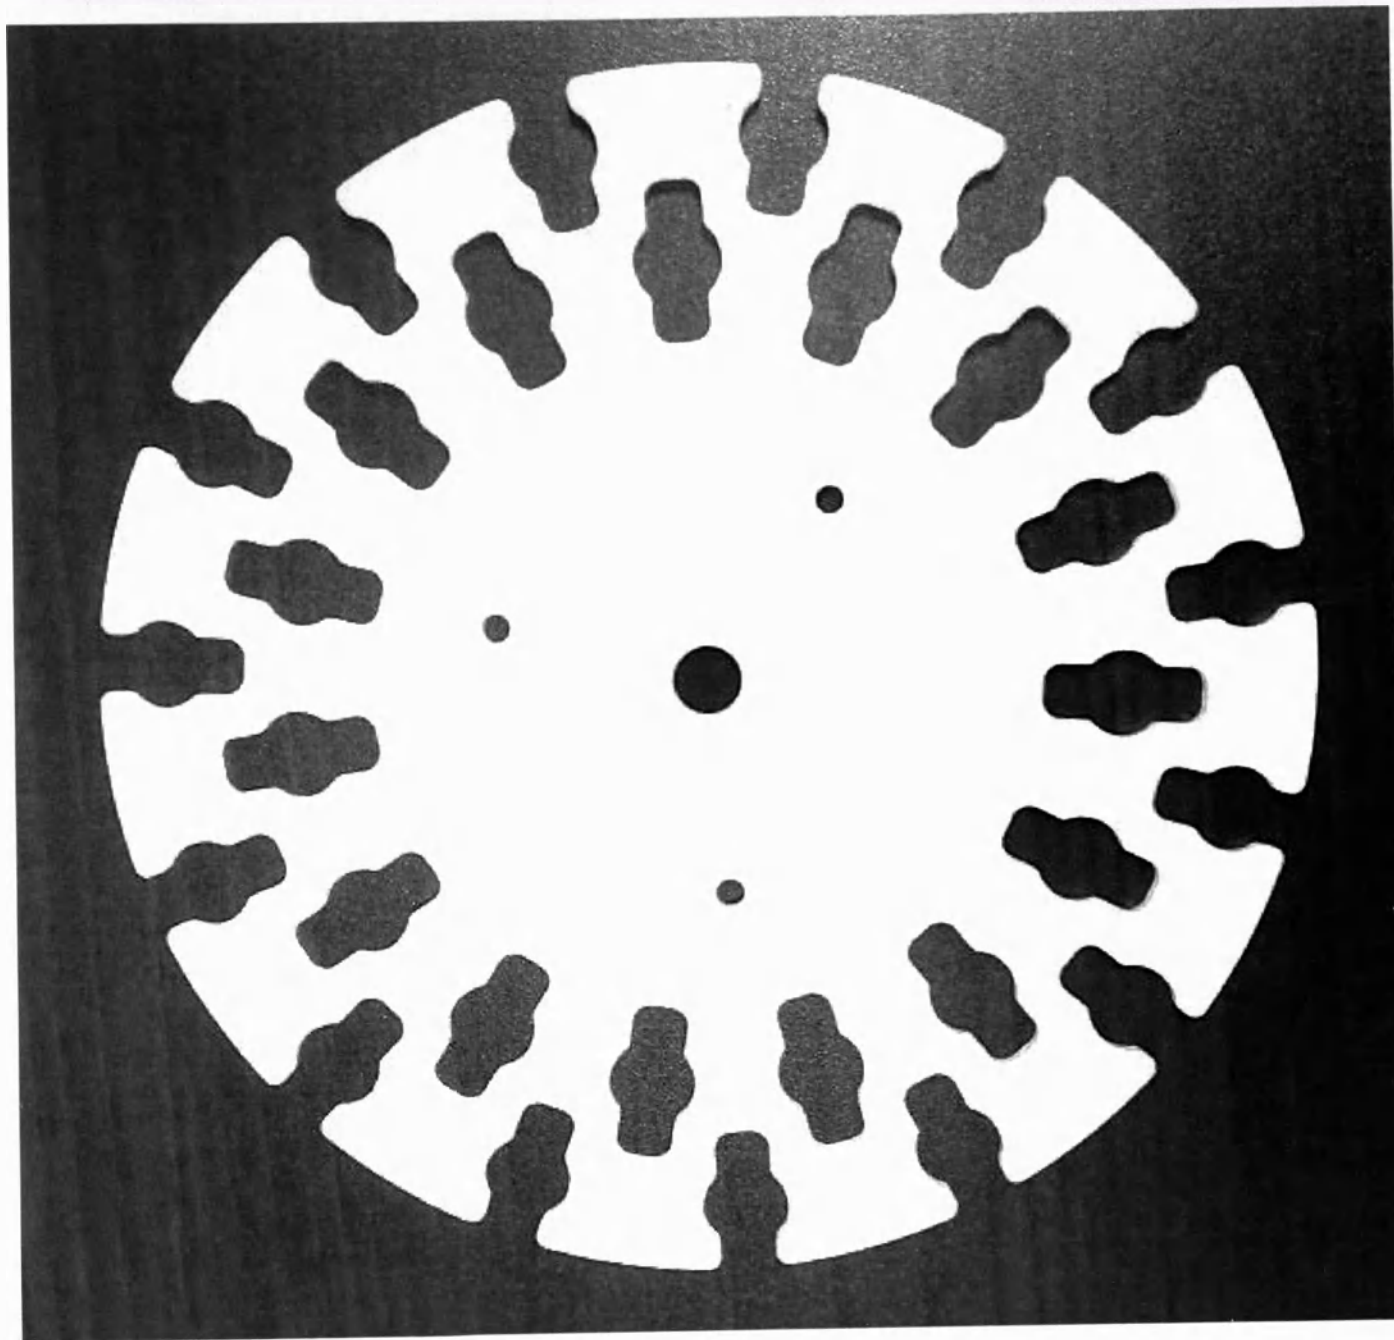


Держатель для пробирок

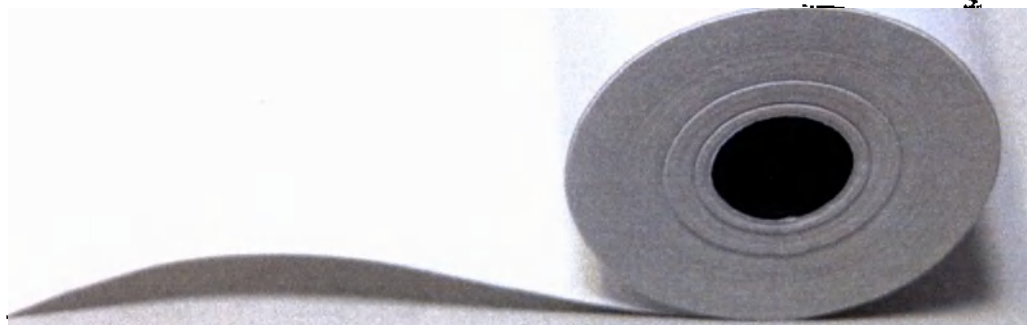

Термобумага



Транспондер на 500 тестов

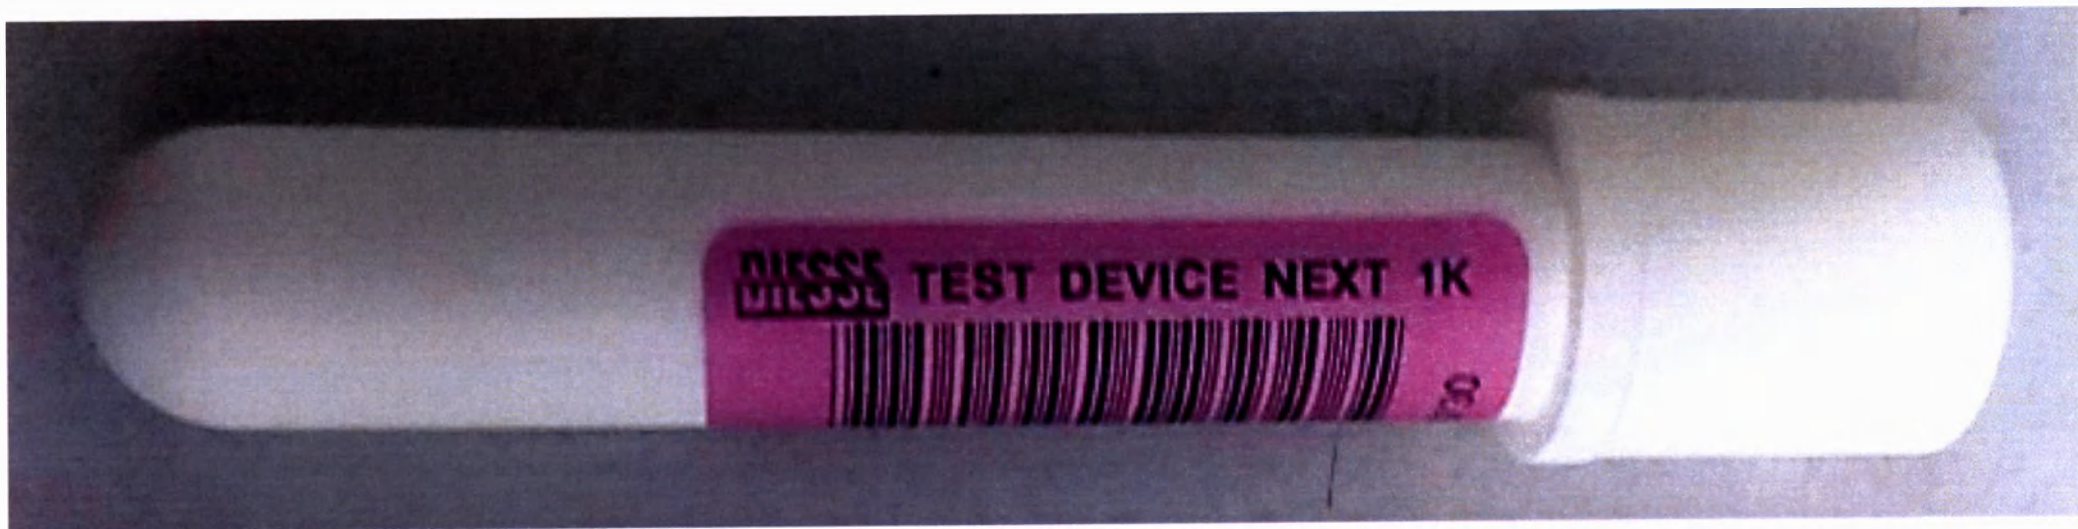

Транспондер на 1000 тестов



Транспондер на 5000 тестов



Транспондер на 10000 тестов

В данном документе прошнуровано
пронумеровано и скреплено печать
листьев (а/-ов) бумаги

Михалева Е. М., Директор

