

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
2024 г.

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
Кальцитонин», по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
Кальцитонин», по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 1

Кат. № 1530101

На коробку:



Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023

Комплект поставки:

Калибратор 1	1 шт.
Калибратор 2	1 шт.
Калибратор 3	1 шт.
Калибратор 4	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Для профессионального применения.




ТУ 21.20.23-665-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXX


ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:


Калибраторы
MagnoLIA
Кальцитонин
Калибратор 1
[+] 1,0 мл H₂O
2°C — 8°C
000 «Компания Алкор Био»




Калибраторы
MagnoLIA
Кальцитонин
Калибратор 2
[+] 0,75 мл H₂O
2°C — 8°C
000 «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
Кальцитонин
Калибратор 3
[+] 0,75 мл H₂O
2°C — 8°C
000 «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
Кальцитонин
Калибратор 4
[+] 1,0 мл H₂O
2°C — 8°C
000 «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин», по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1530105

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр. д. 40 лит А,
тел./факс: +7(812)878778, 8772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

REF 1530105

LOT E005

2024-11-14

2°C - 8°C

Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин



Комплект поставки:

Калибратор 1	5 шт.
Калибратор 2	5 шт.
Калибратор 3	5 шт.
Калибратор 4	5 шт.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E005

2023-11-14

2°C - 8°C

Биологический

REF 1530105

2024-11-14

Инструкция

IVD

25

Предупреждение



Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023

ТУ 21.20.23-665-98539446-2023
ПУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения.

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
Кальцитонин
Калибратор 1
1,0 мл H₂O

2°C - 8°C

ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
Кальцитонин
Калибратор 2
0,75 мл H₂O

2°C - 8°C

ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
Кальцитонин
Калибратор 3
0,75 мл H₂O

2°C - 8°C

ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
Кальцитонин
Калибратор 4
1,0 мл H₂O

2°C - 8°C

ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 (Тш) лист А

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

_____ Д.М. Полынцев



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Полынец Д.Г.

2024 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA

Кальцитонин», по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023»,

производства ООО «Компания Алкор Био»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023

Кат. № 1530101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Соответствие:



Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023

Комплект поставки:

Калибратор 1	1 шт.
Калибратор 2	1 шт.
Калибратор 3	1 шт.
Калибратор 4	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Для профессионального применения

«Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полный Д.Г.
«___» _____ 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023»

1. НАЗНАЧЕНИЕ




1.1. «Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин», по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023» (далее «Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин») предназначен для калибровки в установлении референтных значений) анализа при количественном измерении кальцитонина в сыворотке и плазме крови (интратековой жидкости, гомогената, дистиллированной воды, мочи, слюны).

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E005

**Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023**

Кат. № 1530101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

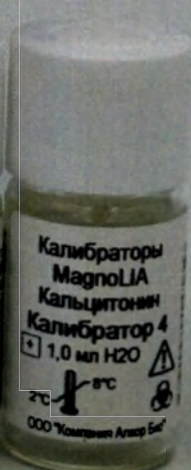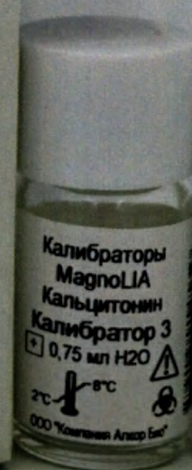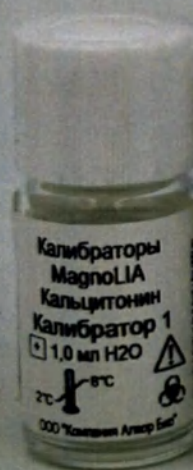

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E005

**Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023**

Кат. № 1530101 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.





LOT E005

REF 1530105

IVD

2023-11-14

2024-11-14

25

2°C

TY 21.20.23-665-98539446-2023
PY № XXXXXXXXXX

Для профессионального применения.



«Калибраторы Magnolia Калицитонин»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компани Аллар Билл»
Полномочий Д.Т.
2023 г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E005

Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023

Кат. № 1530105 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы MagnoLIA Кальцитонин

LOT E005

2024-11-14

REF 1530105

2°C 8°C



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E005


Набор реагентов для калибровки «Калибраторы Magnolia Кальцитонин»,
по ТУ 21.20.23-665-98539446-2023


Кат. № 1530105 Серия № E005 Формирование № 1 Количество 100 шт.



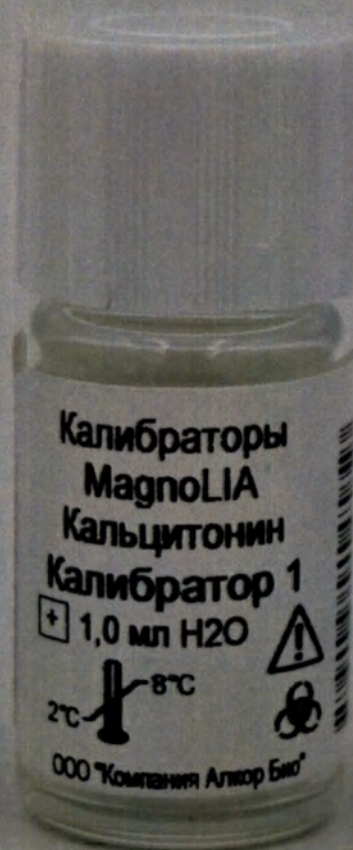

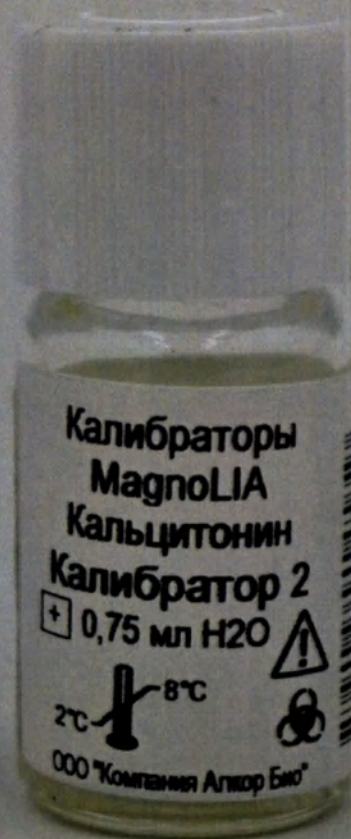

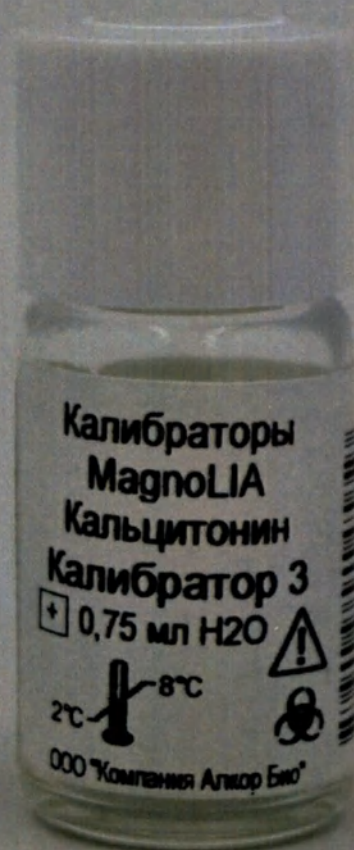

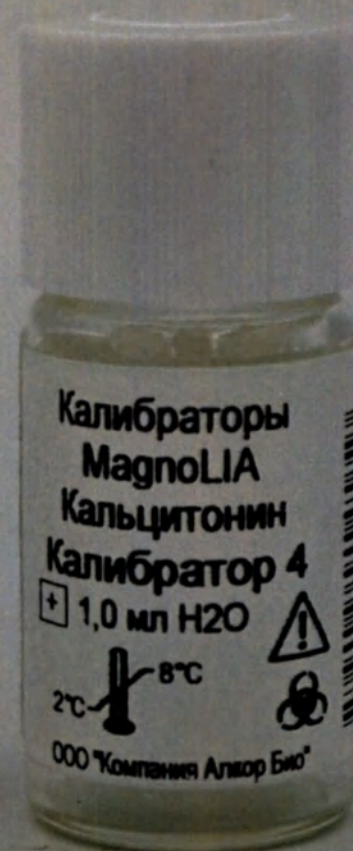

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (*одиннадцать*) лист *80*

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

