



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

2023 г.

**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного выявления HBsAg
«Вектоген HBsAg плюс Чароит»**

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Вектоген HBsAg плюс Чароит»

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	
Положительный контрольный образец (K+)	
Слабopоложительный контрольный образец (K+слаб.)	
Отрицательный контрольный образец (K-)	
Конъюгат	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Вектогеп HBsAg плюс Чароит»

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX	набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg																												
Вектогеп HBsAg плюс Чароит																													
LOT XXXX	Состав:	LOT																											
<table border="0"> <tr> <td>1. Пленшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg</td> <td>1 шт.</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>2. Положительный контрольный образец (K⁺)</td> <td>1 фл., 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>3. Слабоположительный контрольный образец (K⁺ слаб.)</td> <td>1 фл., 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>4. Отрицательный контрольный образец (K⁻)</td> <td>1 фл., 3,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>5. Конъюгат</td> <td>1 фл., 8,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)</td> <td>1 фл., 28,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)</td> <td>1 фл., 13,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>8. Стоп-реагент</td> <td>1 фл., 12,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>9. Схема расположения флаконов в штативе</td> <td>1 шт.</td> <td></td> </tr> </table>			1. Пленшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.	XXXX	2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 2,5 мл	XXXX	3. Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб.)	1 фл., 2,5 мл	XXXX	4. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 3,0 мл	XXXX	5. Конъюгат	1 фл., 8,0 мл	XXXX	6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	1 фл., 28,0 мл	XXXX	7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	1 фл., 13,0 мл	XXXX	8. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	XXXX	9. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.	
1. Пленшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.	XXXX																											
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл., 2,5 мл	XXXX																											
3. Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб.)	1 фл., 2,5 мл	XXXX																											
4. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл., 3,0 мл	XXXX																											
5. Конъюгат	1 фл., 8,0 мл	XXXX																											
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	1 фл., 28,0 мл	XXXX																											
7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	1 фл., 13,0 мл	XXXX																											
8. Стоп-реагент	1 фл., 12,0 мл	XXXX																											
9. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.																												

2.2. Боковая этикетка № 1.


REF X-XXXX		LOT XXXX
ТУ 21.20.23-226-23548172-2023		 XXXX-XX-XX
РУ №		 XXXX-XX-XX
Вектогеп HBsAg плюс Чароит		
    www.vector-best.ru	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют		

2.3. Боковая этикетка № 2.

 АО "Вектор-Бест" Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru
--

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
 Директор по производству
 АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«03» октября 2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В. Масяго
"08" июля 2014 г.

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Вектоген HBsAg плюс Чароит» (серия 7)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
Хусаинов М.Д.
«30» мая 2024 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Вектоген HBsAg плюс Чароит» (серия 8)

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
«30» март 2024 г.
Хусаинов М.Д.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ

ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ HBsAg

«Вектоген HBsAg плюс Чароит»

(серия 7)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия (в штативе)
«Вектогеп HBsAg плюс Чароит» (серия 7)














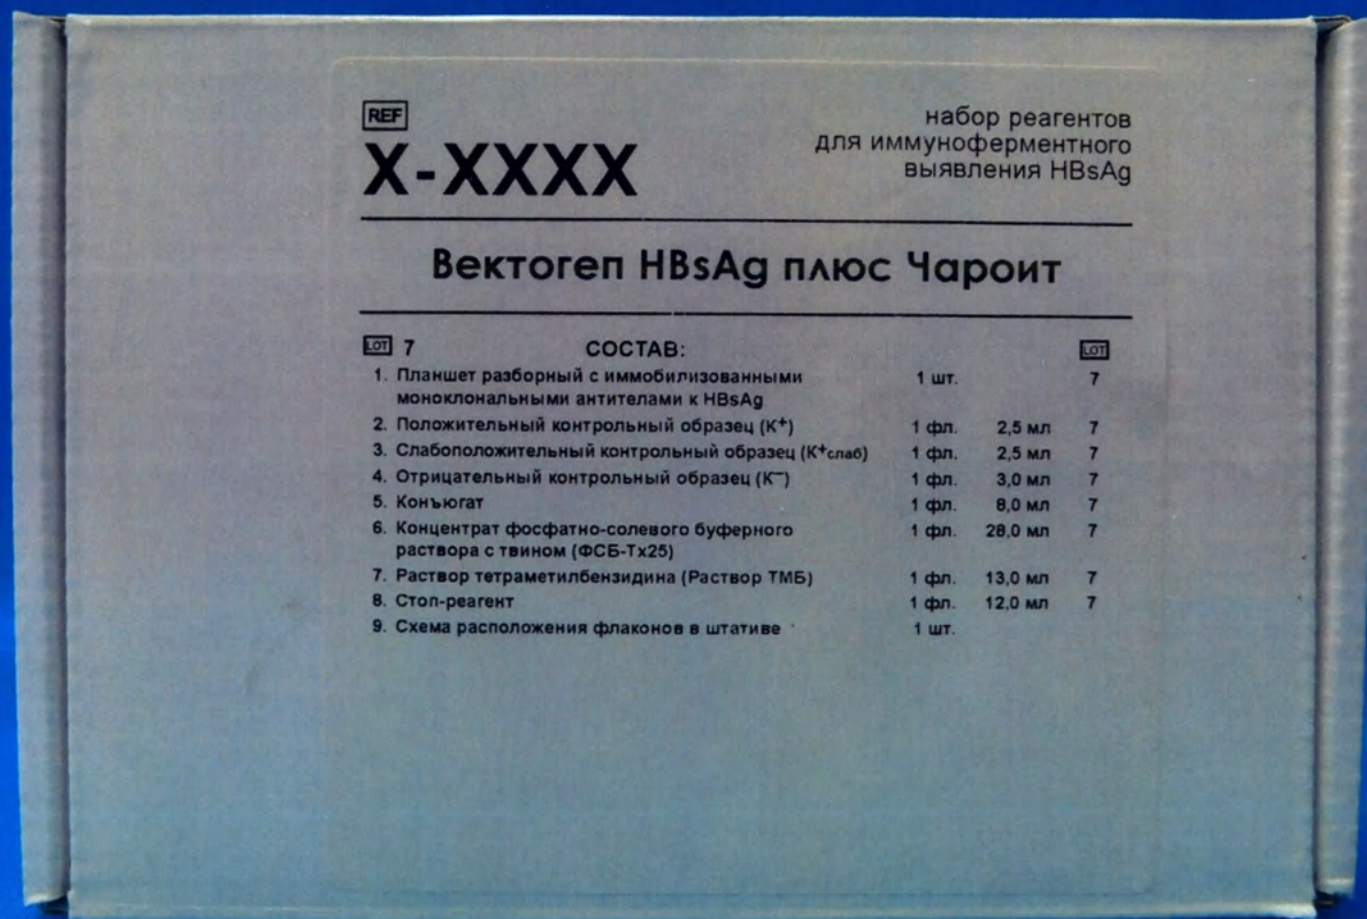

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного
выявления HBsAg

Вектогеп HBsAg плюс Чароит

LOT 7

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.	7
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл. 2,5 мл	7
3. Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб)	1 фл. 2,5 мл	7
4. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл. 3,0 мл	7
5. Конъюгат	1 фл. 8,0 мл	7
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	1 фл. 28,0 мл	7
7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	1 фл. 13,0 мл	7
8. Стол-реагент	1 фл. 12,0 мл	7
9. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.	

REF **X-XXXX**



LOT

7

ТУ 21.20.23-226-23548172-2023

РУ №



2023-10-10



2025-01-10

Вектогеп HBsAg плюс Чароит

IVD



www.vector-best.ru



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С отсутствуют



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



Пропиновано, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

А.В. Масяго А.В. Масяго

"10" ноября, 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ HBsAg «Вектоген HBsAg плюс Чароит» (серия 8)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия (в штативе)
«Вектоген HBsAg плюс Чароит» (серия 8)



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия (вне штатива)
«Вектоген HBsAg плюс Чароит» (серия 8)











REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного
выявления HBsAg


Вектогеп HBsAg плюс Чароит

LOT 8

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к HBsAg	1 шт.		8
2. Положительный контрольный образец (K ⁺)	1 фл.	2,5 мл	8
3. Слабоположительный контрольный образец (K ⁺ слаб)	1 фл.	2,5 мл	8
4. Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	1 фл.	3,0 мл	8
5. Конъюгат	1 фл.	8,0 мл	8
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	1 фл.	28,0 мл	8
7. Раствор тетраметилбензидина (Раствор ТМБ)	1 фл.	13,0 мл	8
8. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	8
9. Схема расположения флаконов в штативе	1 шт.		

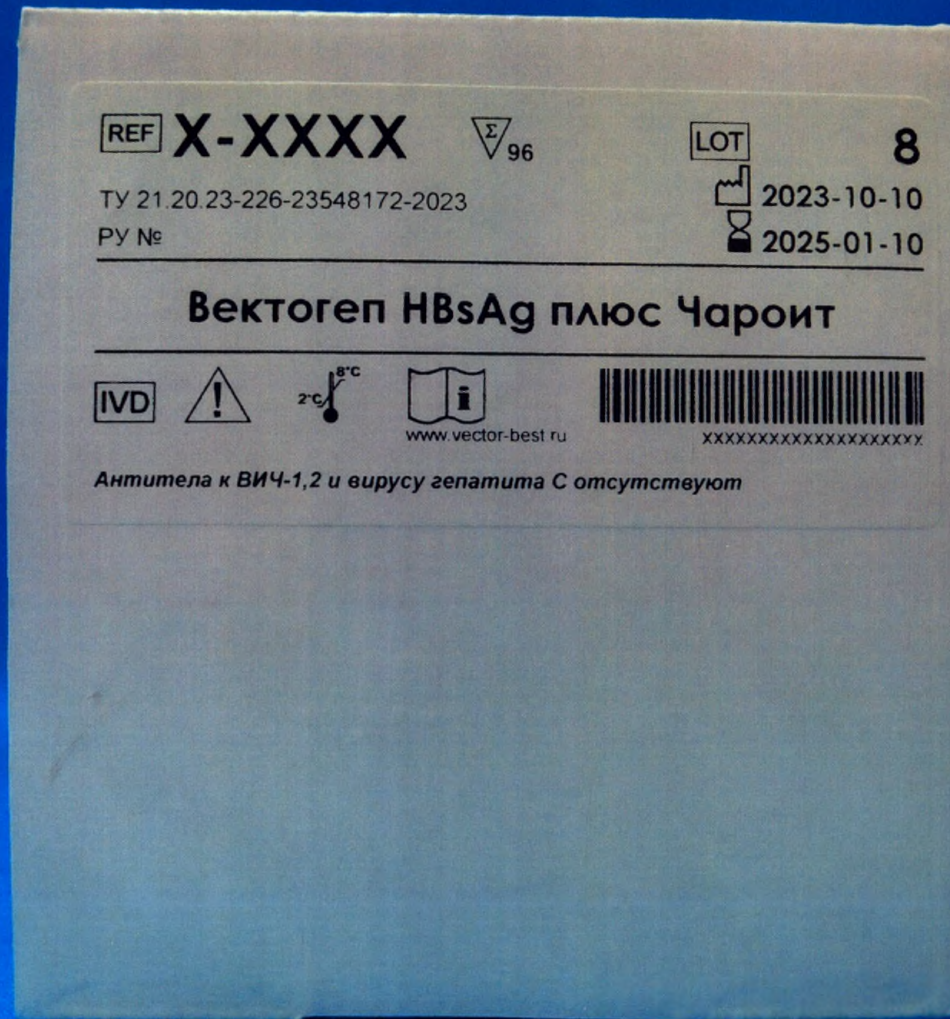



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»

А.В. Масяго
10 ноября 2023 г.