


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Кюветы реакционные одноразовые
Thromboelastography Reaction Cups для анализаторов
гемостаза серии Наема для *in vitro* диагностики в
вариантах исполнения»**

麦科田
MEDCAPTAIN

血栓弹力图反应杯
Thromboelastography Reaction Cups

Cups
25 Sets

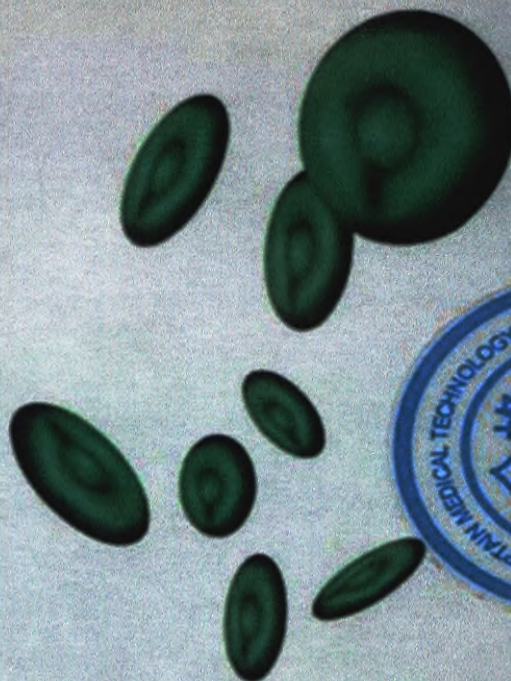

深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司
MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Внешний вид групповой упаковки «Кюветы реакционные одноразовые
Thromboelastography Reaction Cups для анализатора гемостаза Наема Т4»



«Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups для анализатора гемостаза Наема Т4» в групповой упаковке



Маркировка групповой упаковки «Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups для анализатора гемостаза Наема Т4»

Маркировка групповой упаковки «Кюветы реакционные одноразовые
Thromboelastography Reaction Cups для анализатора гемостаза Наема Т4»

Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups для анализатора гемостаза Наема Т4

Количество: 25 штук

REF

МСТ00701



10.08.2022


LOT

20220801



09.10.2027

IVD



Нестерильно! Не использовать повторно! Не применять при повреждении упаковки!
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед началом использования!
Хранить: в сухом помещении при температуре от + 5°C до + 40°C вдали от отопительных приборов.




Medcaptain Medical Technology Co., Ltd., («Медкаптейн Медикал Технолоджи Ко., Лтд.») 12th
Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055 Shenzhen,
Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель в России:


ЗАО «НПО АСТА», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к.13, эт.6; пом.№1

Тел.: 8-495-781-04-08; e-mail: pharm@asta.ru


РУ № _____

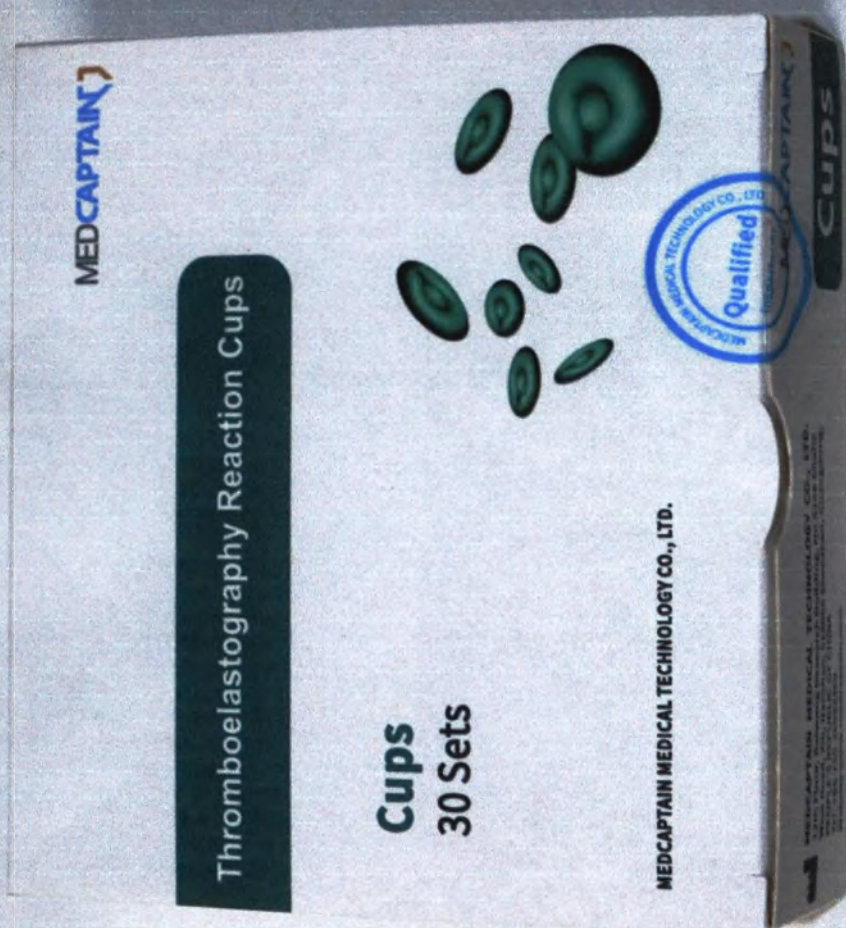

Внешний вид групповой упаковки «Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups в штативе для анализатора гемостаза Haema TX»

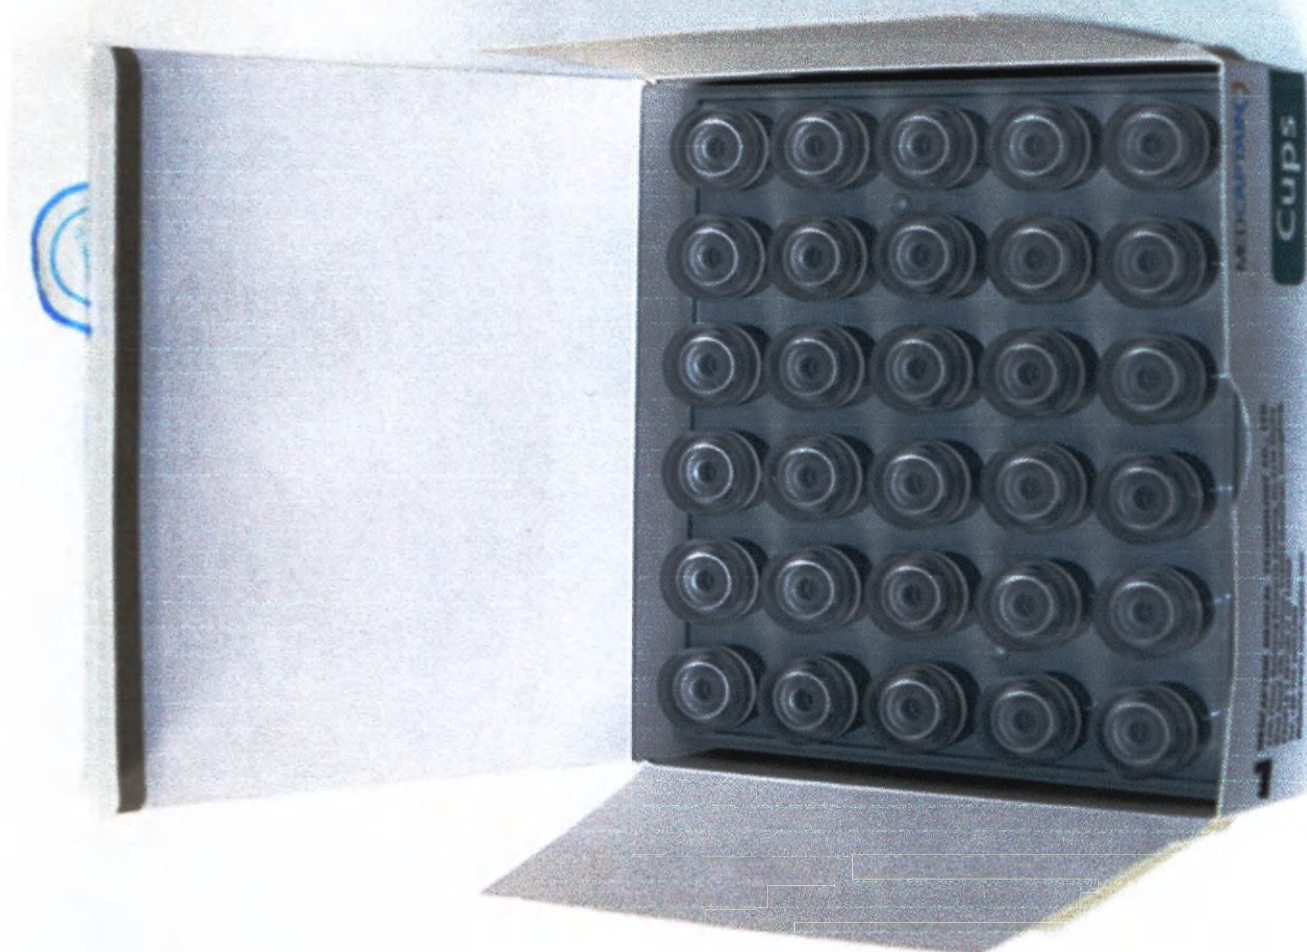

«Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups в штативе для анализатора гемостаза Наема TX» в групповой упаковке

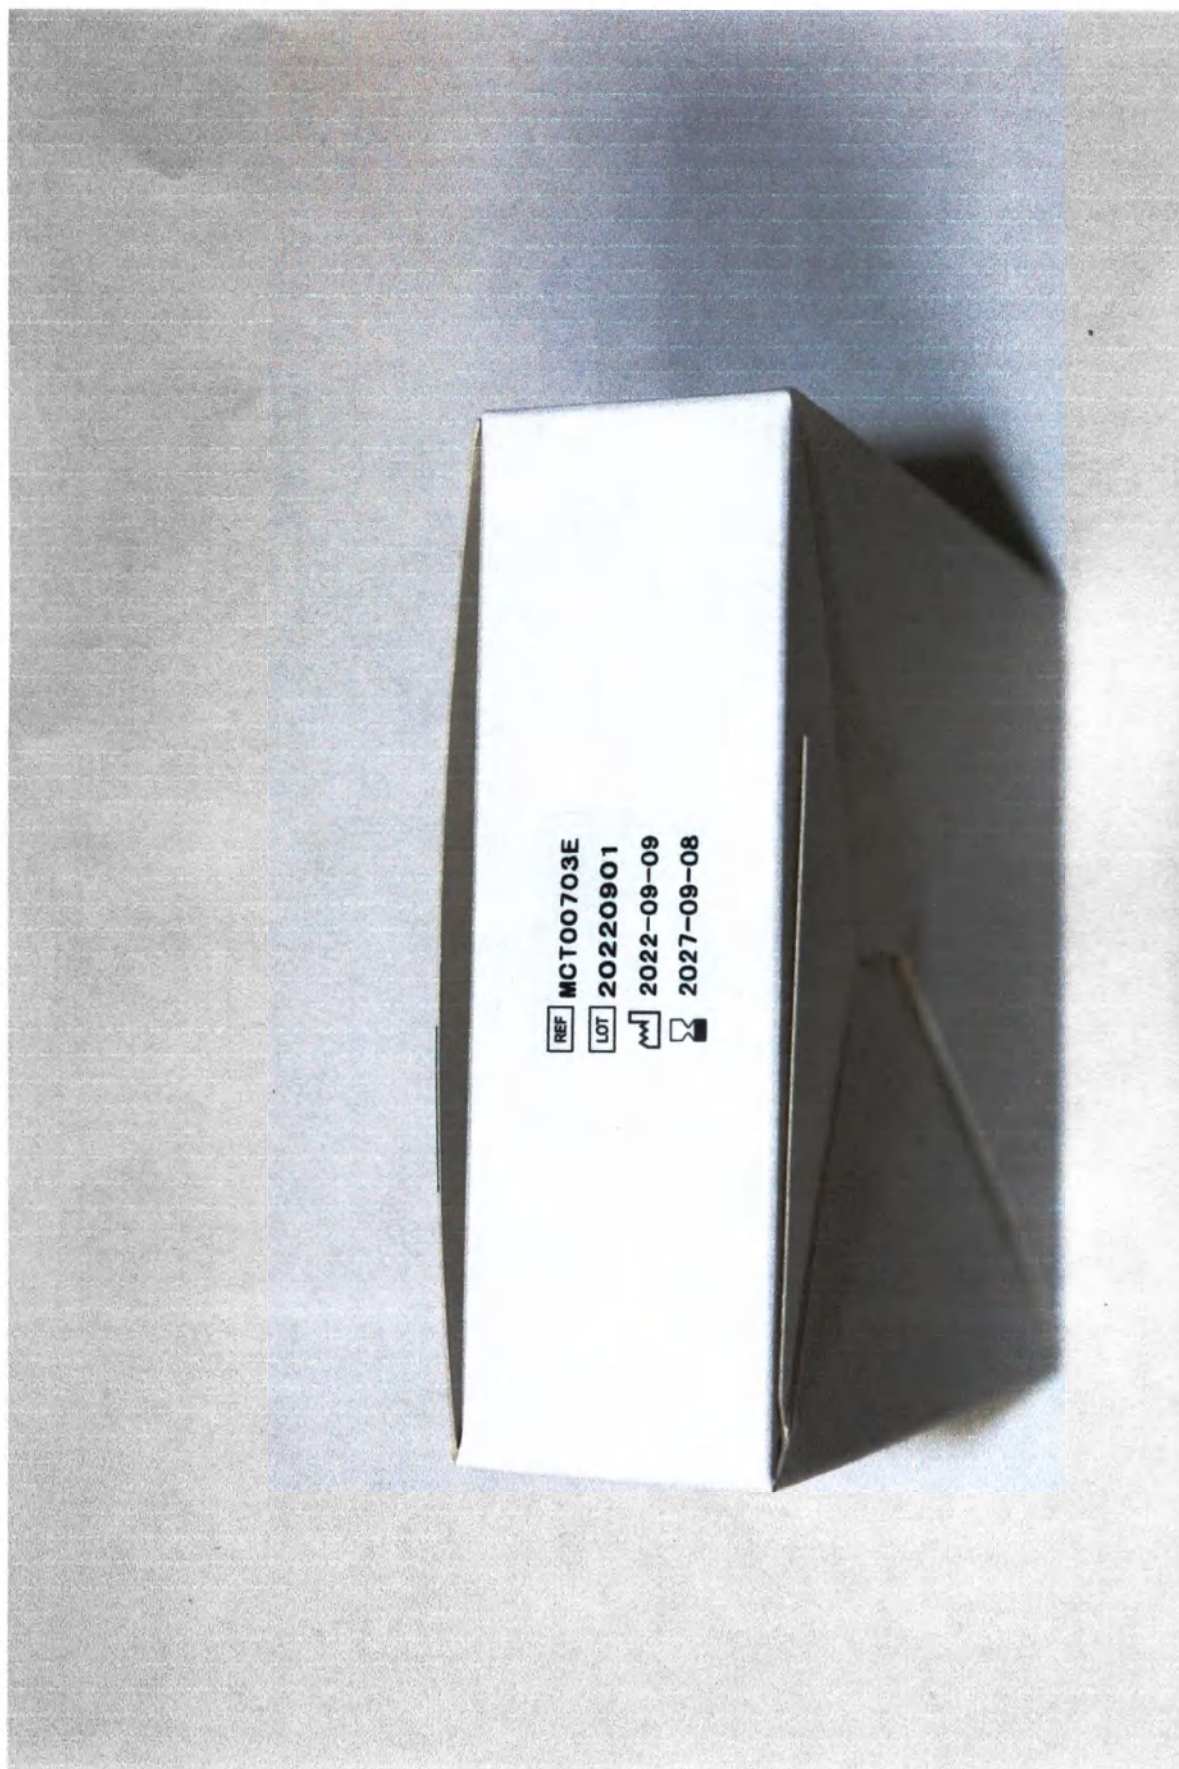

Маркировка групповой упаковки «Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups в штативе для анализатора гемостаза Haema TX»

Маркировка групповой упаковки «Кюветы реакционные одноразовые
Thromboelastography Reaction Cups в штативе для анализатора гемостаза
Наема TX»

Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups в штативе для анализатора гемостаза Наема TX

Количество: 30 штук



09.09.2022



08.09.2027

LOT

20220901

REF

МСТ00703Е

IVD



Нестерильно! Не использовать повторно! Не применять при повреждении упаковки!
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед началом использования! Хранить: в сухом помещении при температуре от + 5°C до + 40°C вдали от отопительных приборов.



Medcaptain Medical Technology Co., Ltd., («Медкаптейн Медикал Технолоджи Ко., Лтд.»)
12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili,
Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель в России:

ЗАО «НПО АСТА», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к.13, эт.6; пом.№1

Тел.: 8-495-781-04-08; e-mail: pharm@asta.ru

РУ № _____




Внешний вид групповой упаковки «Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups в штативах для анализатора гемостаза Haema TX»



«Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups в штативах для анализатора гемостаза Наема ТХ» в групповой упаковке

Маркировка групповой упаковки «Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups в штативах для анализатора гемостаза Наема TX»

Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography
Reaction Cups в штативах для анализатора гемостаза Наема TX
Количество: 120 штук




13.10.2022



12.10.2027

LOT

20221013



Нестерильно! Не использовать повторно! Не применять при повреждении упаковки!
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению перед началом использования! Хранить: в сухом помещении при температуре от + 5°C до + 40°C
вдали от отопительных приборов.



Medcaptain Medical Technology Co., Ltd.,
(«Медкаптейн Медикал Технолоджи Ко., Лтд.»)

12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili,
Nanshan, 518055 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA


Уполномоченный представитель в России:

ЗАО «НПО АСТА», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к.13, эт.6; пом.№1
Тел.: 8-495-781-04-08; e-mail: pharm@asta.ru

РУ № _____



Внешний вид штатива

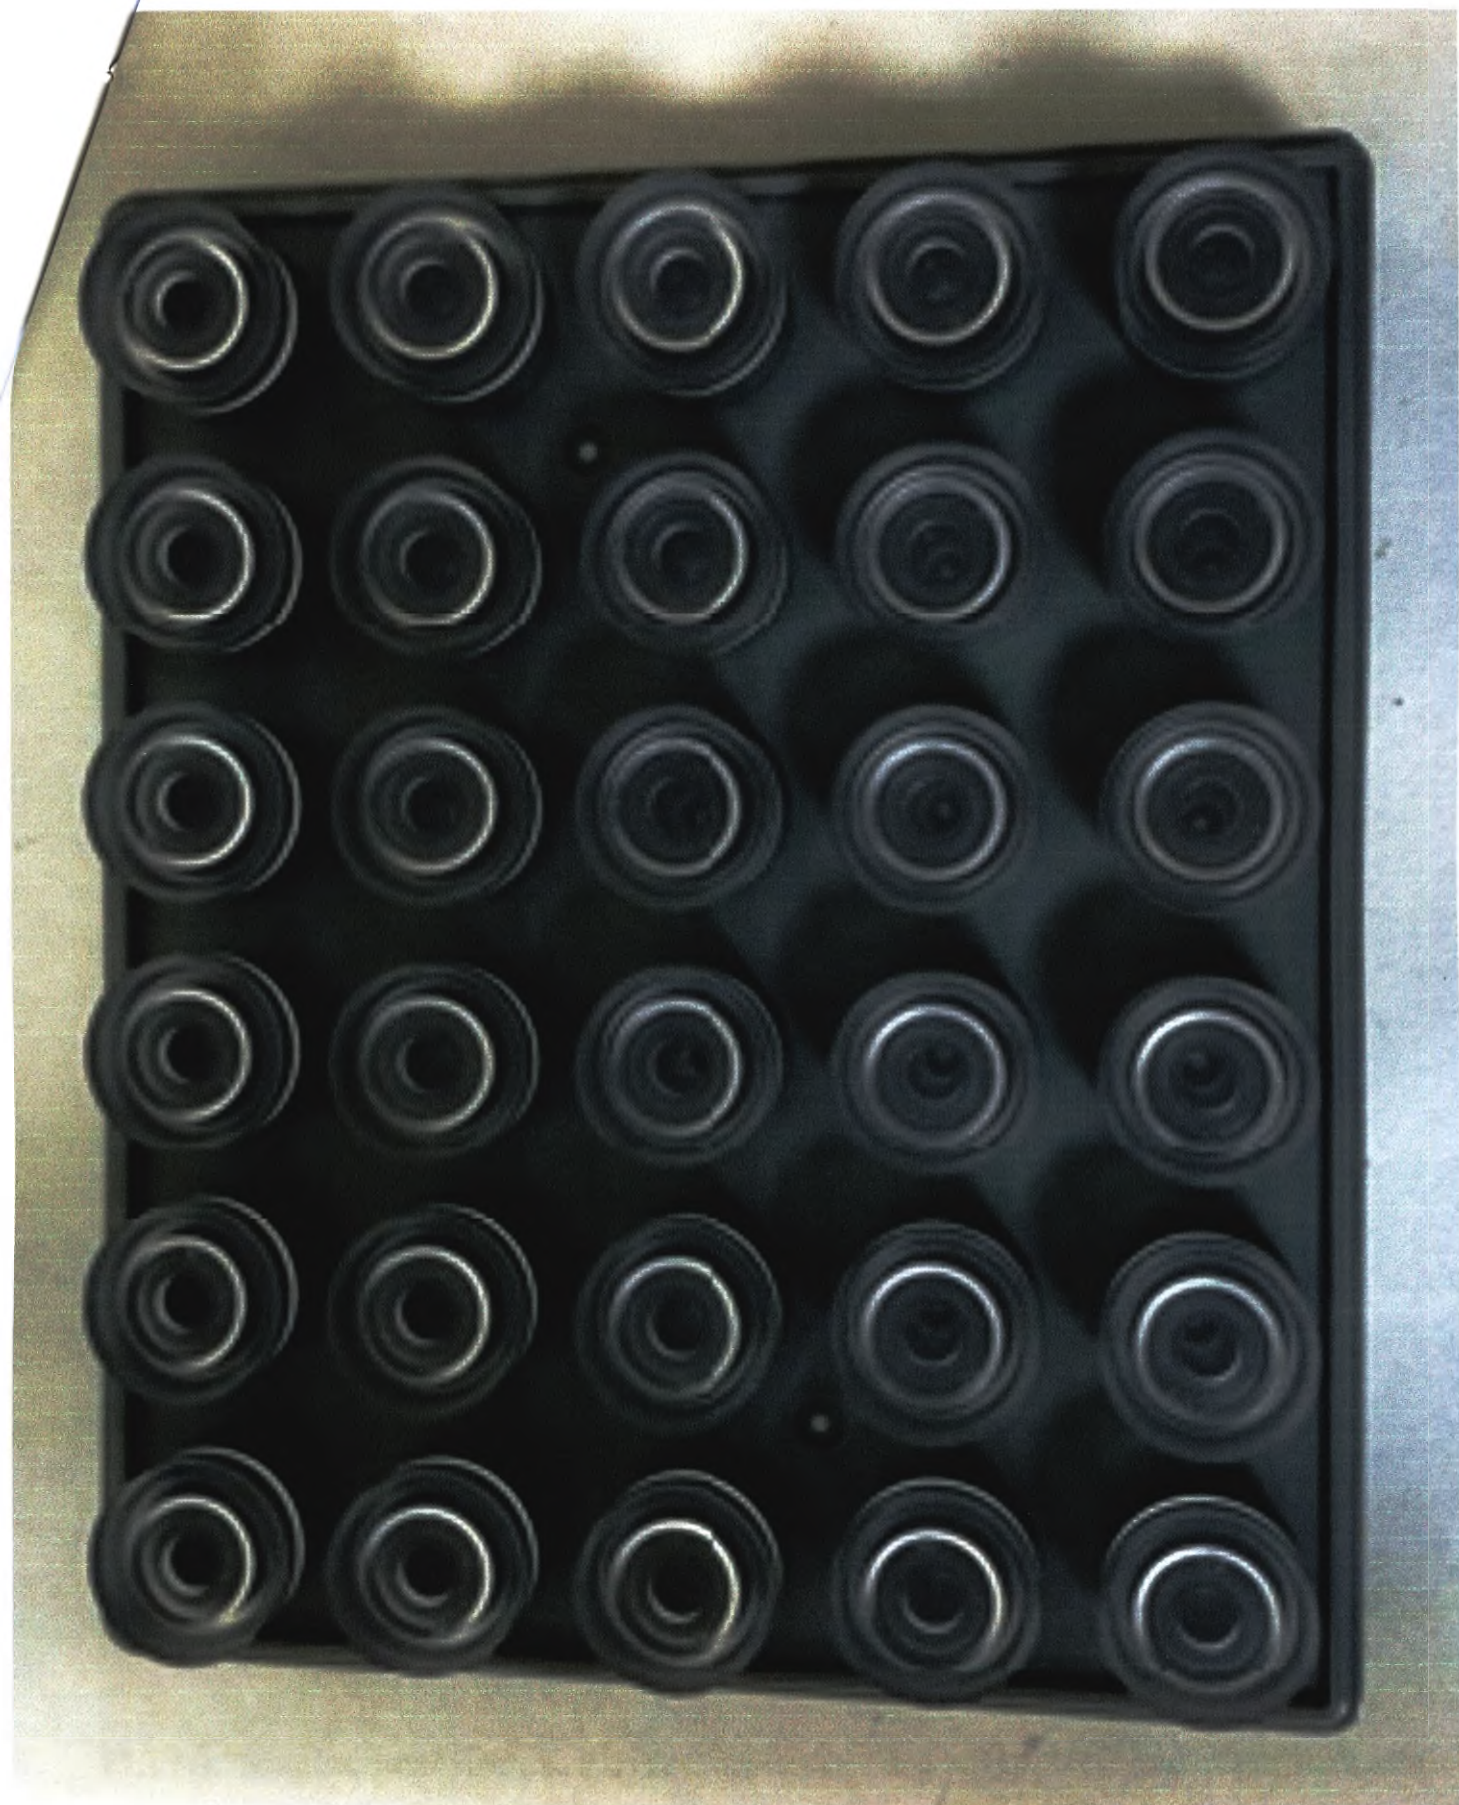

Кюветы реакционные одноразовые в штативе



Внешний вид кюветы реакционной одноразовой



Внешний вид внешней и внутренней кюветы реакционной одноразовой


Кюветы реакционные одноразовые Thromboelastography Reaction Cups для анализатора гемостаза Наема TX

РУ № _____

LOT


20221013

Количество: 10 упаковок по 120 штук



13.10.2022

IVD



Срок годности: 5 лет

Масса брутто: 4.5 кг.

Хранить: в сухом помещении при температуре от + 5°C до + 40°C вдали от отопительных приборов



Medcaptain Medical Technology Co., Ltd., («Медкаптейн Медикал Технолоджи Ко., Лтд.»)
12th Floor, Baiwang Research Building, No.5158 Shahe West Road, Xili, Nanshan, 518055
Shenzhen, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель в России:

ЗАО "НПО "АСТА", 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к.13, эт.6; пом.№1
Тел.: 8-495-781-04-08; e-mail: pharm@asta.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 18 листов

Генеральный директор
ЗАО «НПО «АСТА»
Спиридонов В.Н.

