

Лазер фемтосекундный хирургический Femto LDV Z8

Дисплей сенсорный

Держатель рукоятки сочлененный

Манипулятор «мышь»
беспроводной

Рукоятка

Клавиатура беспроводная

Набор офтальмологический
9.0 мм для хирургии роговицы.

Набор офтальмологический
9.5 мм для хирургии роговицы.

Набор офтальмологический
для хирургии катаракты.

Базовая станция.

Панель боковая стеклянная

Педаль ножная

Набор офтальмологический
10.0 мм для хирургии роговицы.

Кабель сетевой.



Кабель сетевой



Ручка




Handpiece


Patient docking and Laser beam delivery unit
for the Ziemer FEMTO LDV™
Femtosecond Surgical Laser

FEMTO LDV

Держатель рукоятки сочлененный

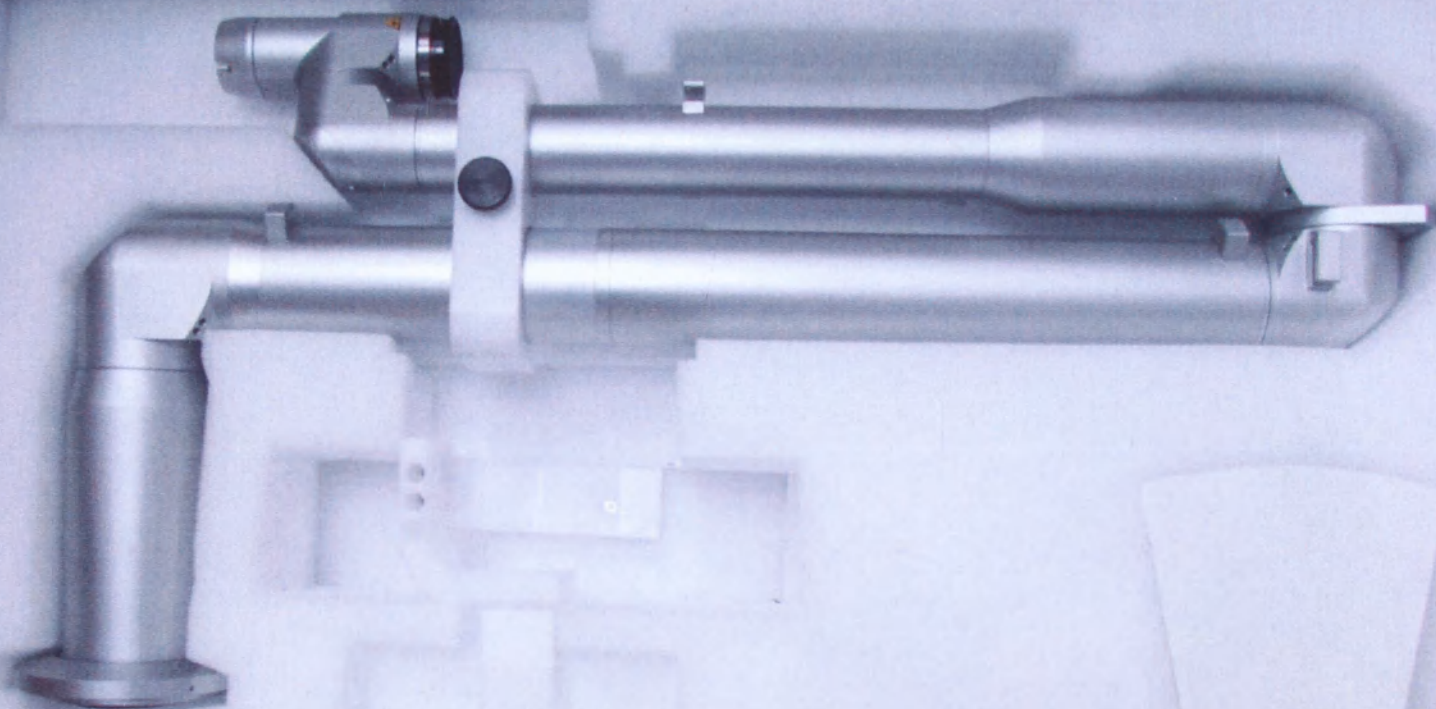

Дисплей сенсорный

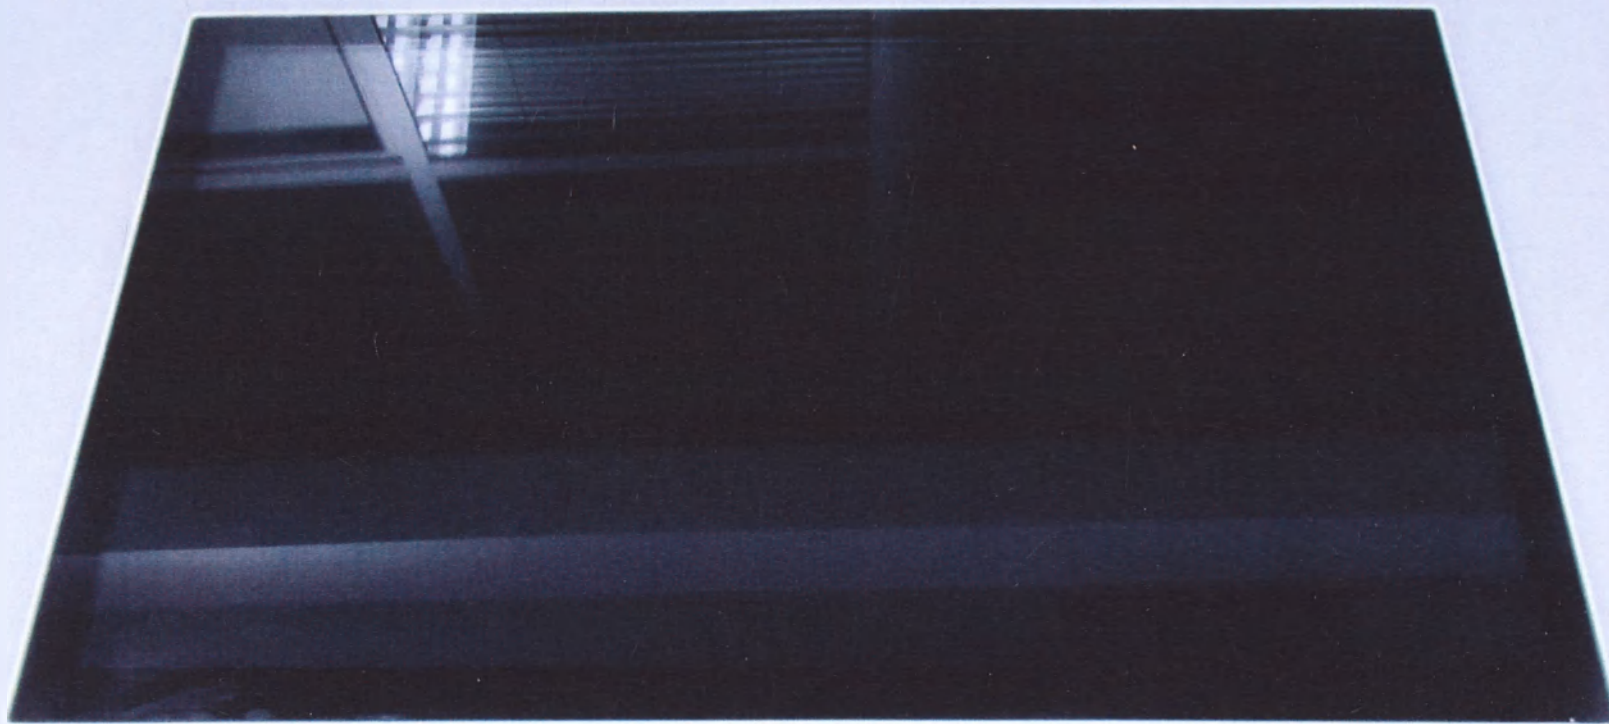

Педадь ножная



Лазерный хирургический прибор

Панель боковая стеклянная - 2 шт

ziemer 

ziemer 


FEMTO
Z

FEMTO
Z8

LDV

Cornea
Cataract
Presbyopia


Клавиатура беспроводная

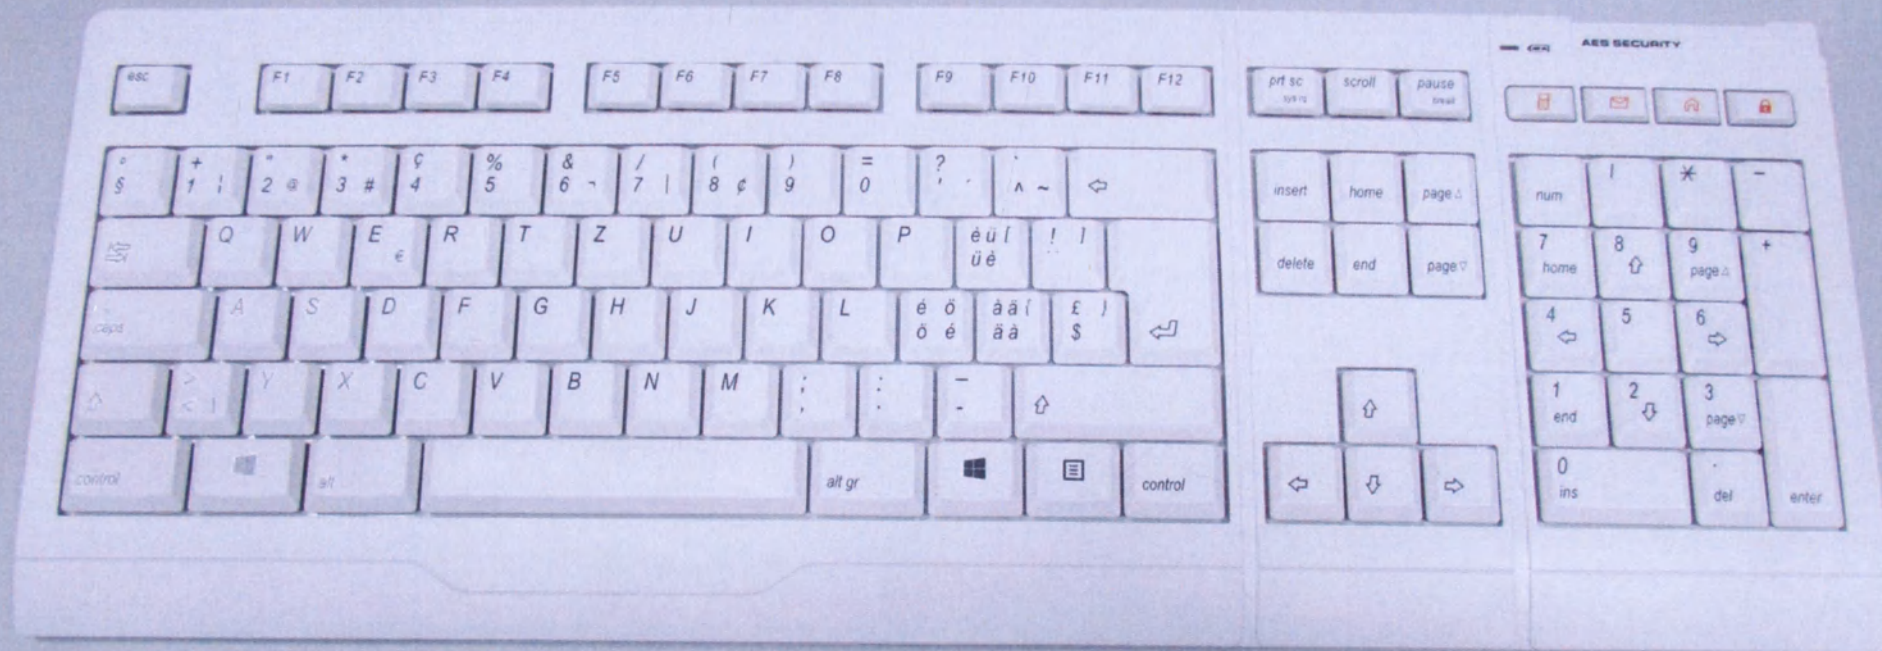

Лазер фемтосекундный хирургический Femto LDV Z8

Манипулятор «мышь» беспроводной





FEMTOSECOND SURGICAL LASER
FEMTO LDV Z8

Operator's Manual

Коммутатор сетевой



Адаптер



Кабель соединительный



Patchkabel S/FTP (PMF),
Cat 6, blau, 5,0 m

Patch cable S/FTP (PMF),
cat 6, blue, 5,0 m

Best.-Nr. 71805B



Набор офтальмологический для хирургии катаракты.

FEMTO LDV

STERILE EO 2 0297

ZIEGLER AG, Surgical Instrument Engineering
Allmendstrasse 71
2562 Port, Switzerland

ziemer

Content should be disposed of in a biohazard container after use.
Caution: Federal (U.S.) law restricts this device to sale by or on the order
of a physician or practitioner.

FEMTO LDV

Procedure Pack for
Cataract Surgeryto be used with the Handpiece for
Cataract surgery
with Liquid Interface

Security ID: HA95LS1VNCIP

REF 510.700.017

© 2017-08

ziemer



0030220141190834505 01 001 P1 12 X1

Футляр рукоятки защитный

Чехол стерильный- 4 шт

Трубка вакуумная

Набор офтальмологический 9.0 мм для хирургии роговицы. (содержимое LASIK, полная и сквозная кератопластика, интрастромальные тоннели)



Кольцо вакуумное 9.0 мм.

Футляр рукоятки защитный.

Чехол стерильный для базовой станции.

Трубка вакуумная.

FEMTO LOV

STERILE EO 2       CE 0297

SIF AG, Surgical Instrument Engineering
Allmendstrasse 35
2502 Pörs, Switzerland

ziemer

Content should be disposed of in a hazardous container after use.
Caution: Federal (U.S.) law restricts this device to sale by or on the order
of a physician or practitioner.

SEINTO IDV

9.5

Procedure Pack for Corneal Surgery

to be used with the Handpiece for
Refractive and Corneal surgery

Security ID: HA97H5IVNCIP

[REF] 510 700 014

7/2017 08

Ziegler 

06 70 3 237 49 984 14 633

Трубка вакуумная

Чехол стерильный для базовой станции

Чехол стерильный для базовой станции

Кольцо вакуумное 9.5 мм

Набор офтальмологический 10.0 мм для хирургии роговицы. (операции LASIK, полная и сквозная кератопластика, интрастромальные тоннели)

FEMTO LOV

STERILEEO ② ⓧ Ⓢ ⚠ Ⓣ Ⓜ CE 0297

 SIE AG, Surgical Instrument Engineering
Altmeindstrasse 11
2562 Port, Switzerland

Content should be disposed of in a biohazard container after use.
Caution: Federal (U.S.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician or practitioner.

SEMTO IDV

10.0

**Procedure Pack for
Corneal Surgery**

to be used with the Handpiece for
Refractive and Corneal surgery

Security ID: HA96JLS1VNCIP

REF 510.700.015

E 2017-08



0022-0474(199806)36:3;1-0

0220220141100826308

Трубка вакуумная

Футляр рукоятки защитный

Чехол стерильный для базовой станции

Кольцо вакуумное 10.0 мм