

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»

(ООО «АМА»)


М.А.Дмитриенко

«21» марта 2024 г.



Фотографии медицинского изделия

Система комбинированная ХЕЛИК®-скан-М по ТУ 9443-007-59483502-2014

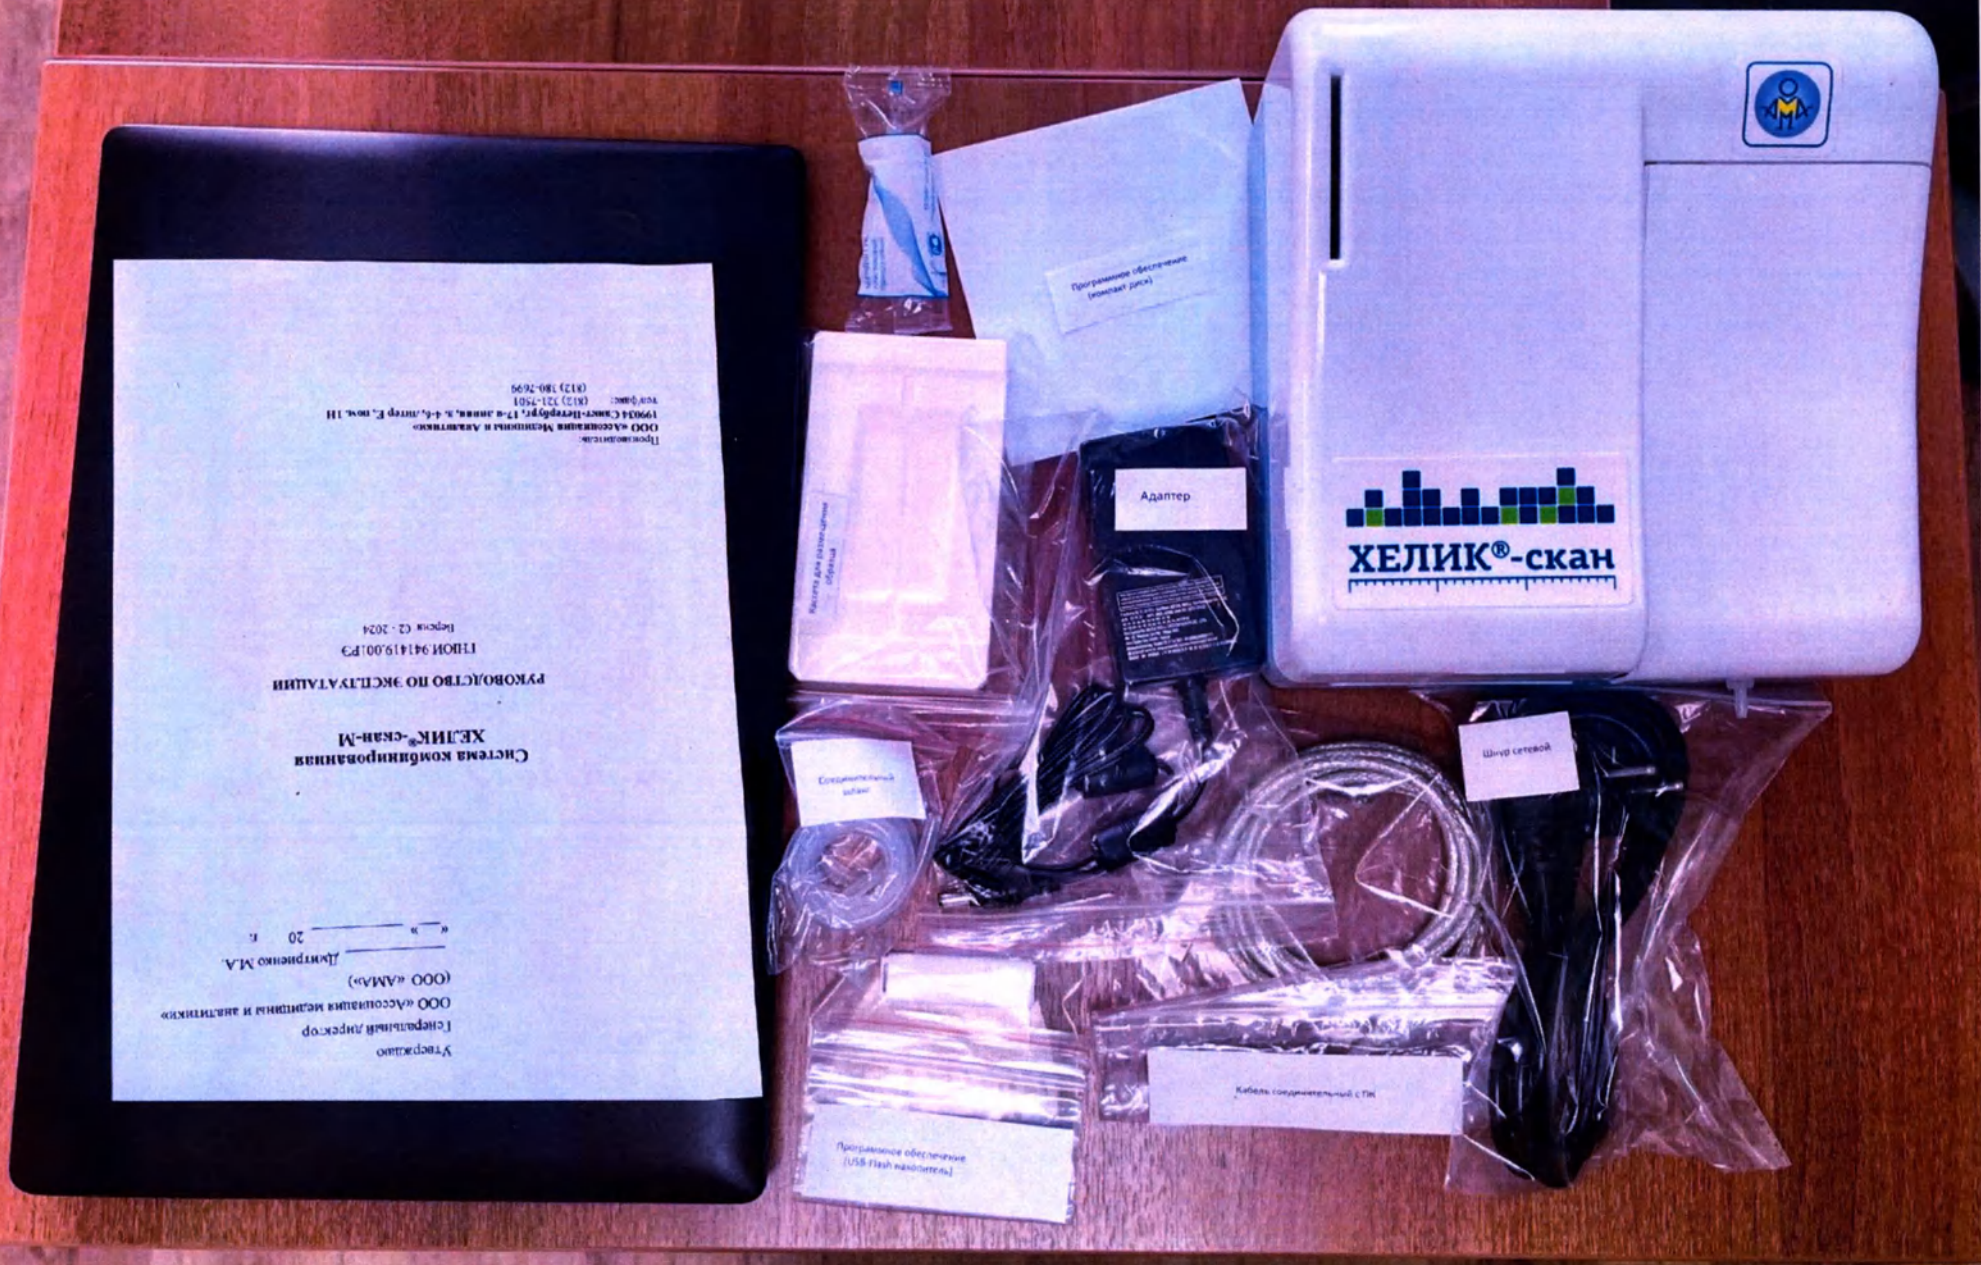


Общий вид Система комбинированная ХЕЛИК®-скан-М по ТУ 9443-007-59483502-2014



Блок отбора пробы и считывания результата (вид спереди)




Блок отбора пробы и считывания результата (вид сверху)

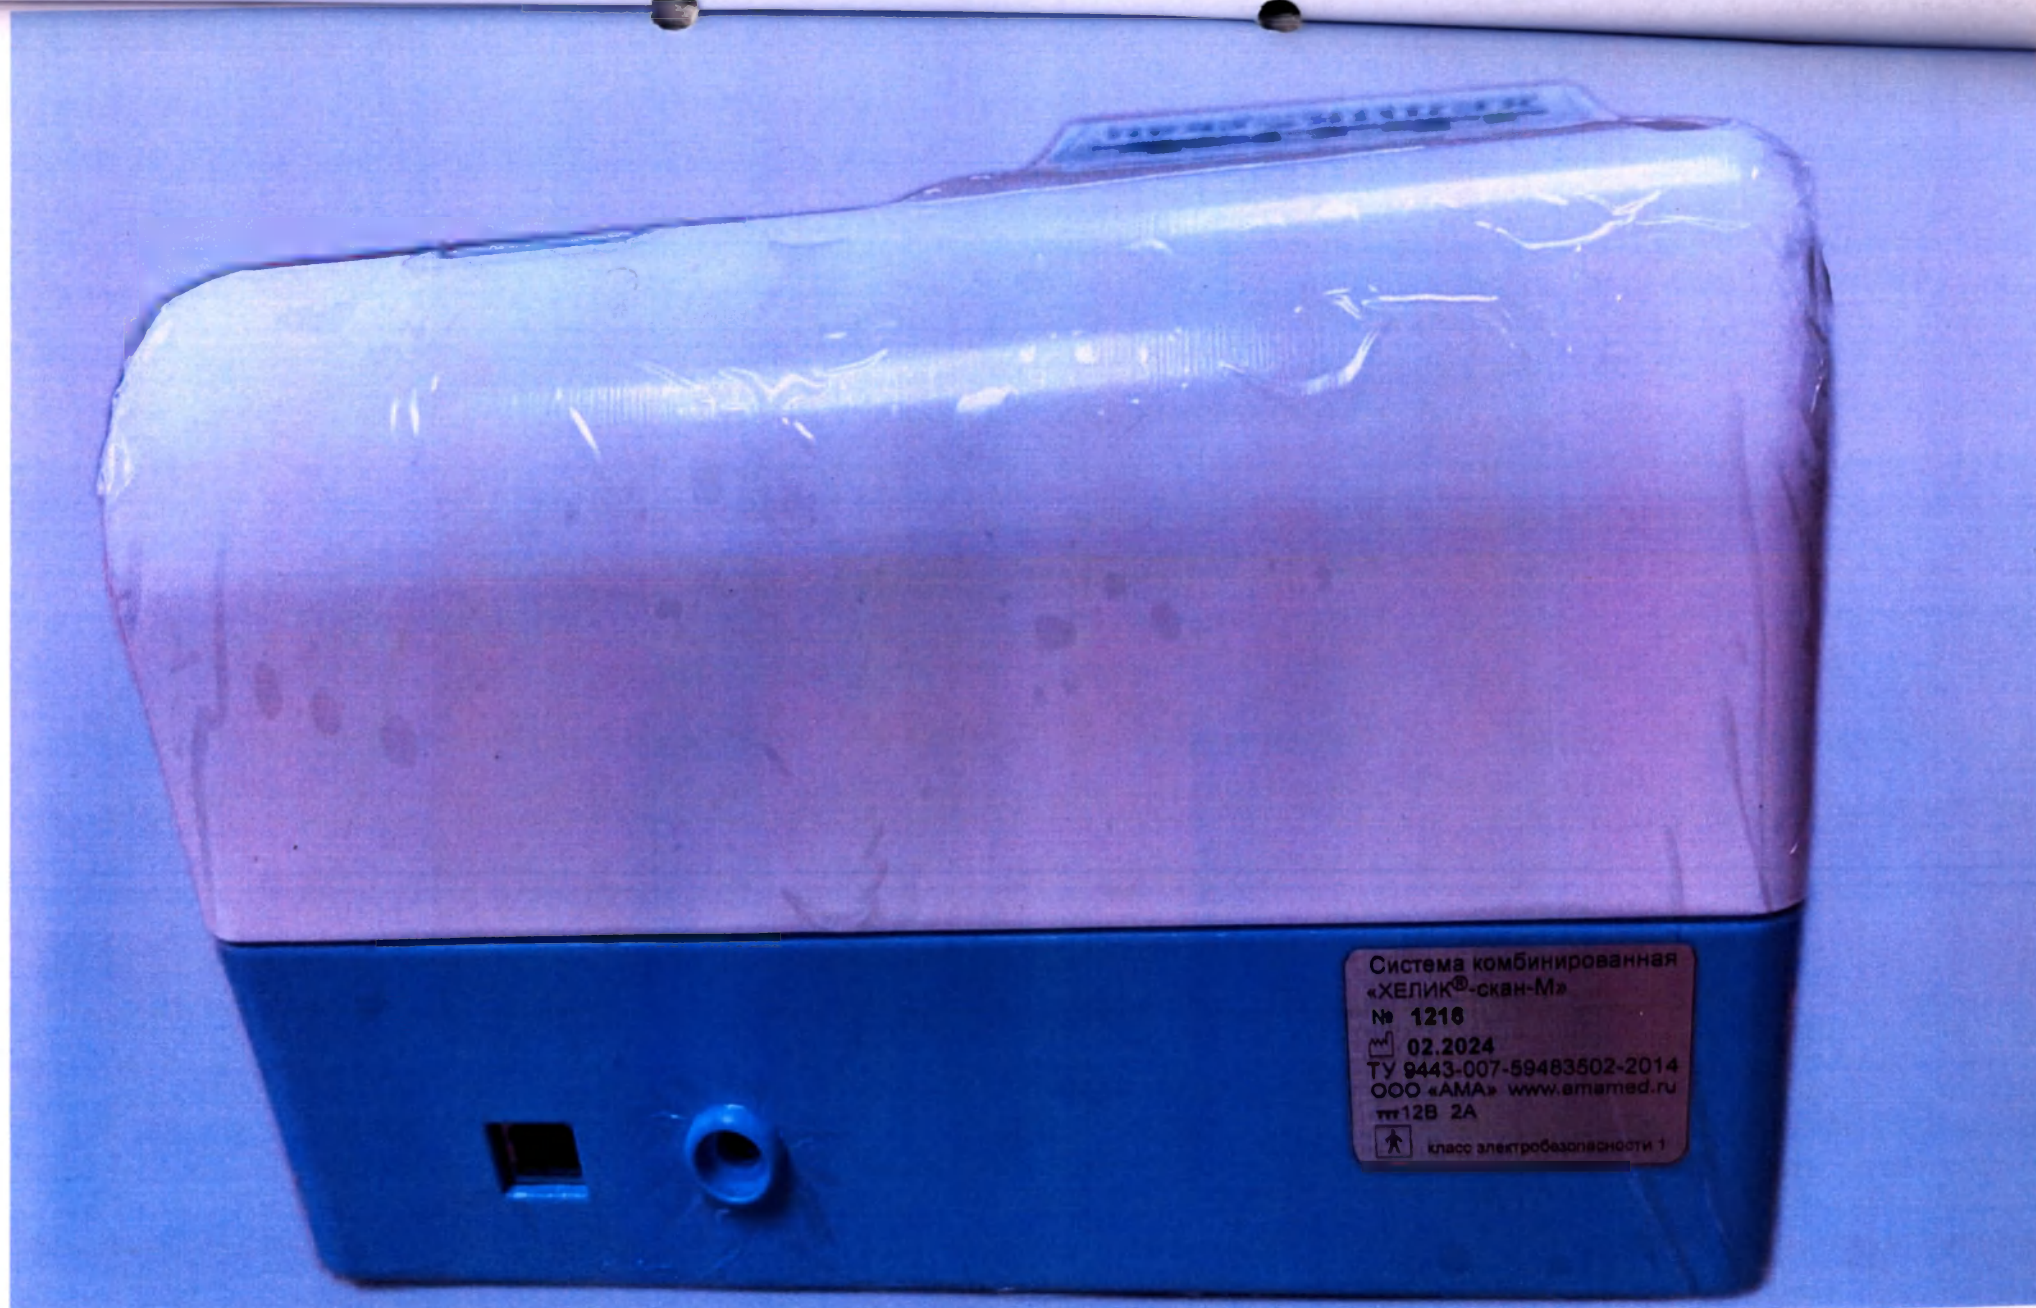

Блок отбора пробы и считывания результата (вид сзади)




Этикетка блока отбора пробы и считывания результата

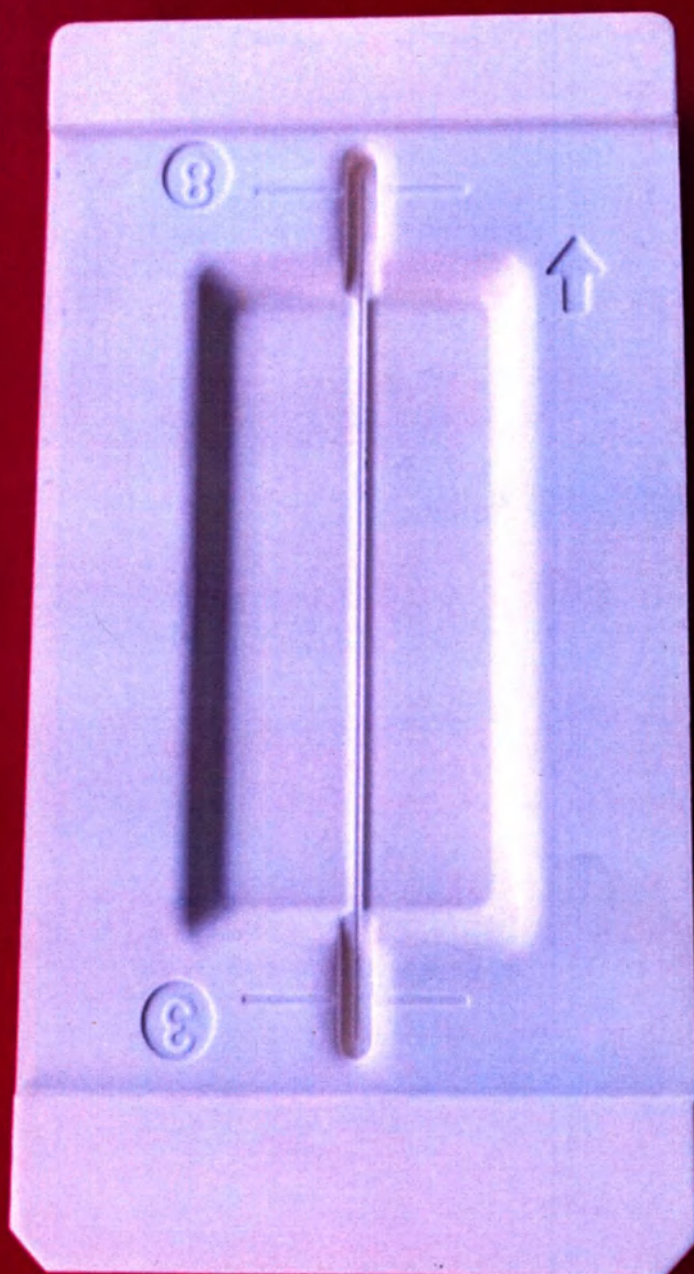

Кассета для размещения исследуемого образца




Кассета для размещения исследуемого образца в упаковке

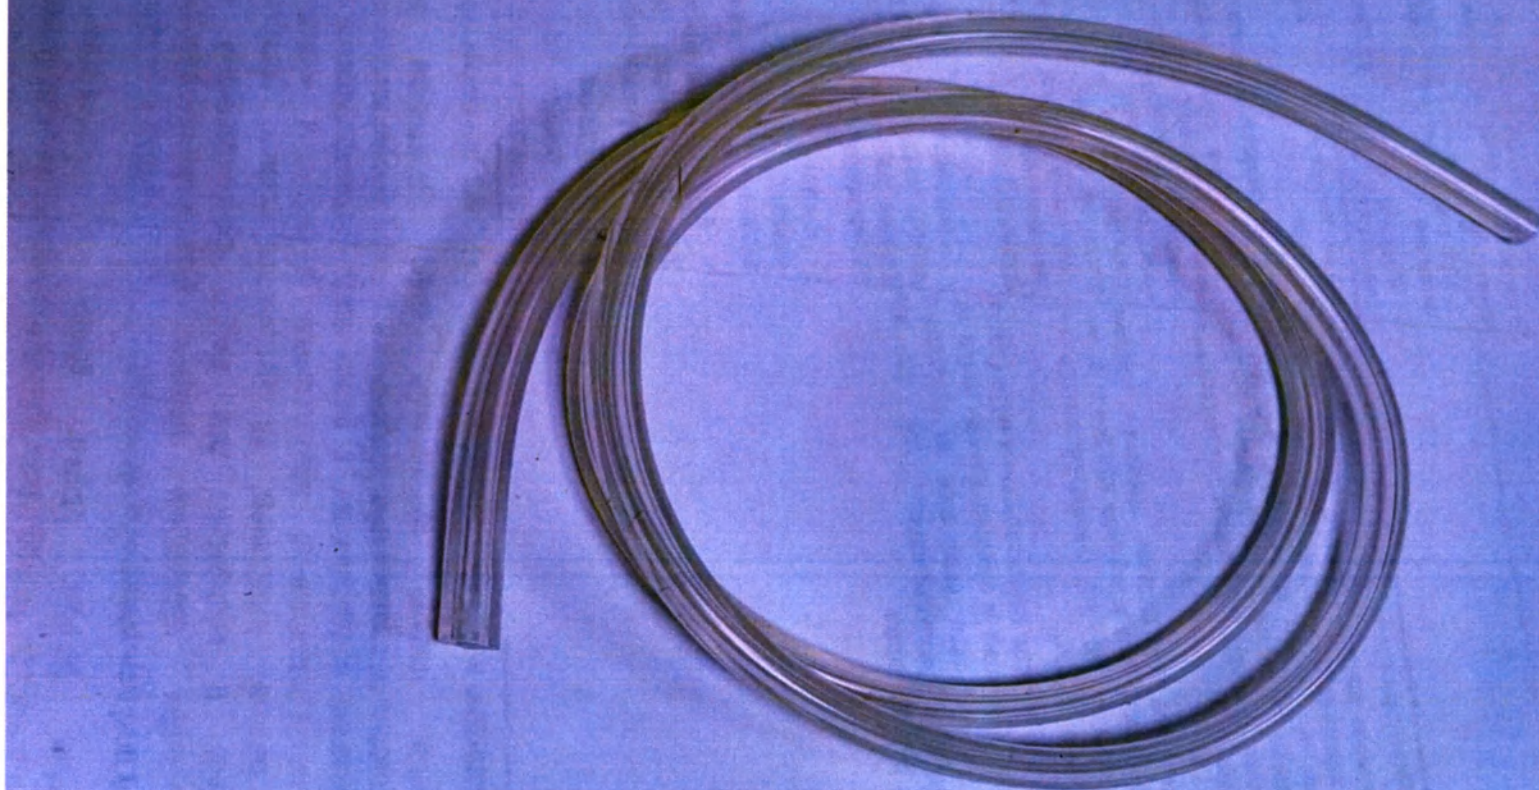

Соединительный шланг




Соединительный шланг в упаковке

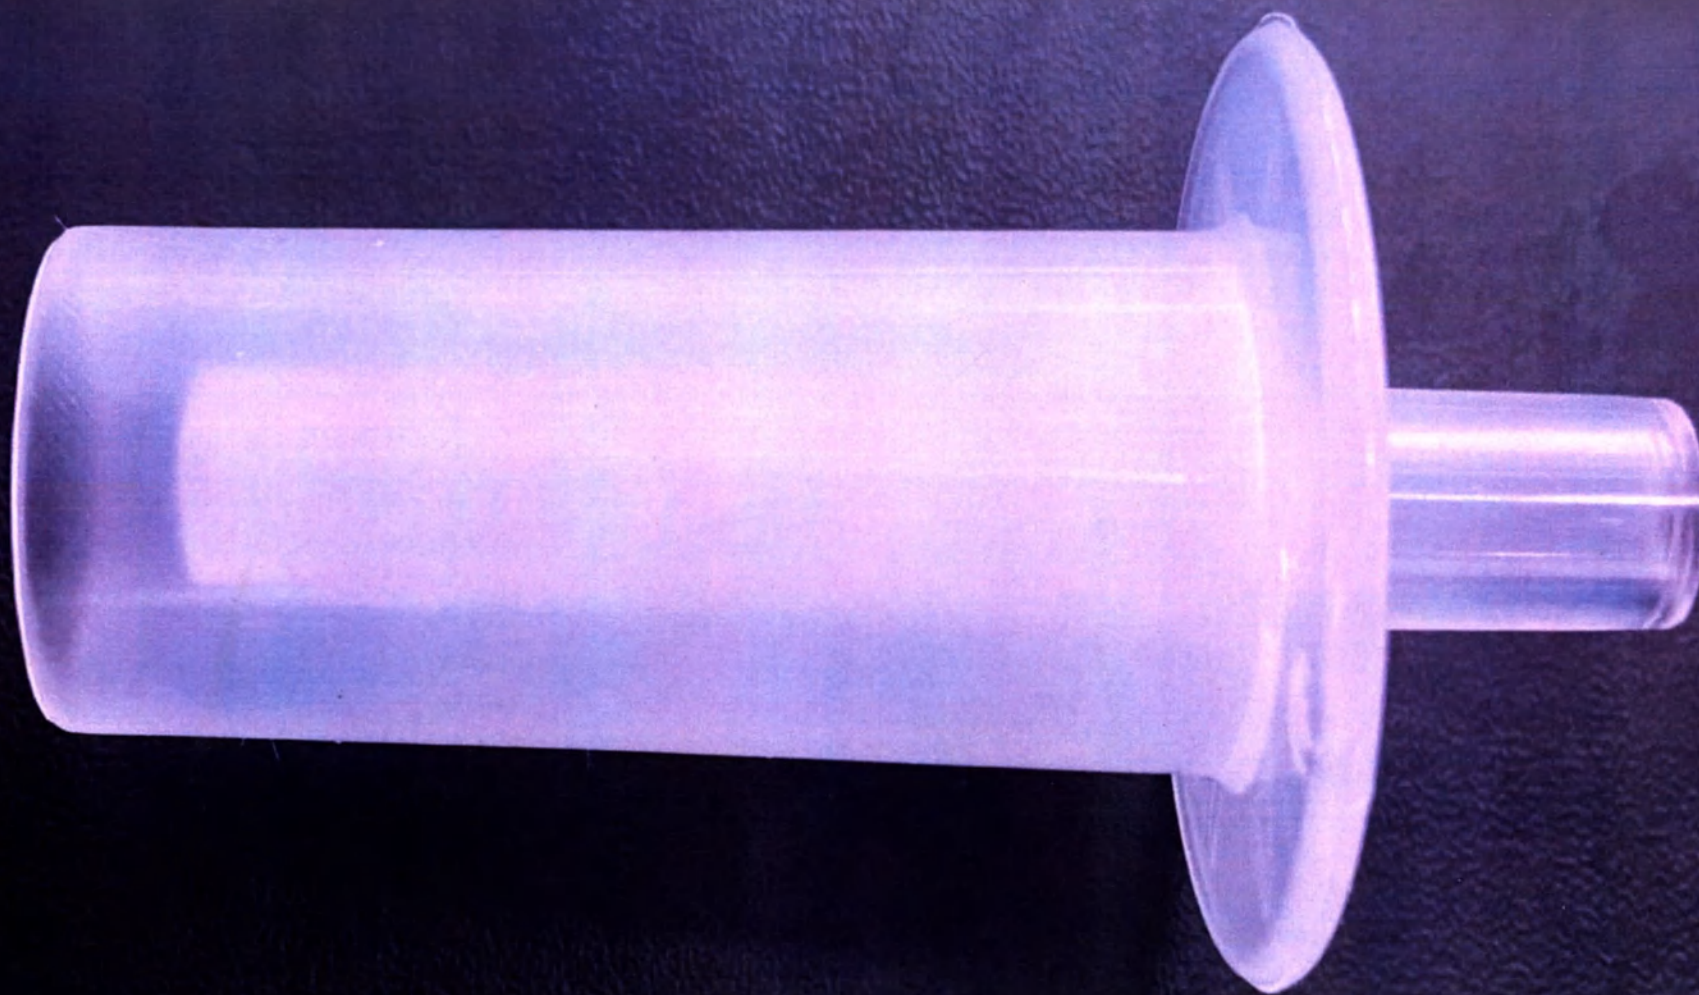

Одноразовый мундштук



Одноразовый мундштук в упаковке

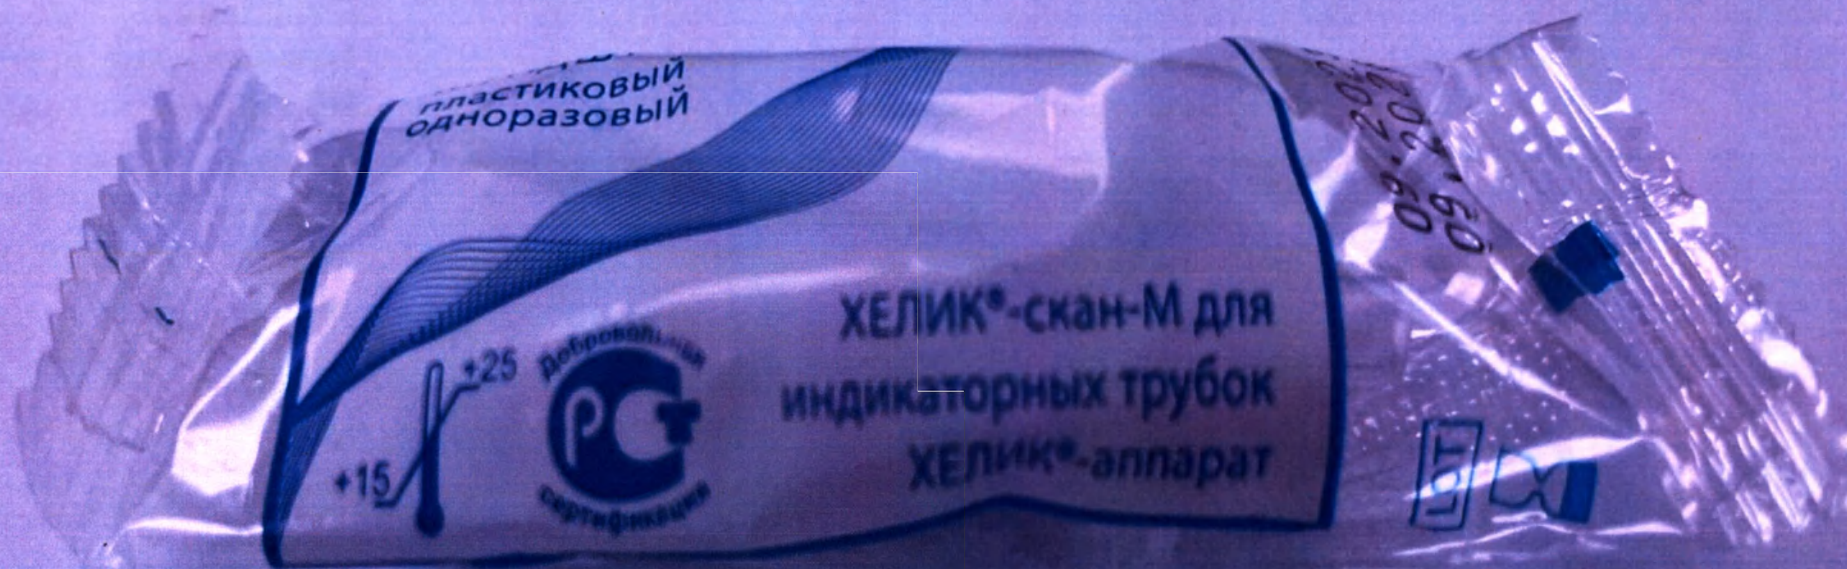

Одноразовый мундштук в индивидуальной упаковке (вид сбоку)

Этикетка на упаковке одноразового мундштука

Изготовитель: ООО «Нева пластик»

Адрес: 187340, Россия, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы 41

МУНДШТУК
пластиковый
одноразовый

ХЕЛИК®-скан-М для
индикаторных трубок
ХЕЛИК®-аппарат





Адаптер с несъемным соединительным шнуром (вид сверху)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Factory(제조공장): SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.

A/S 연락처 : 031-465-2206 and 02-337-3722

明纬企业股份有限公司

台湾新北市五股区五权三路28号

Designed By MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

No. 28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan

Manufacturing Date(제조년월) : 01(MM)2023(Y)

Manual: www.meanwell.com/manual.html

MADE IN CHINA (中国制造)(中國製造)(제조국:중국) MW02

Адаптер с несъемным
соединительным
шнуром

Адаптер с несъемным соединительным шнуром в упаковке




Кабель соединительный с ПК

Кабель соединительный с ПК




Кабель соединительный с ПК в упаковке

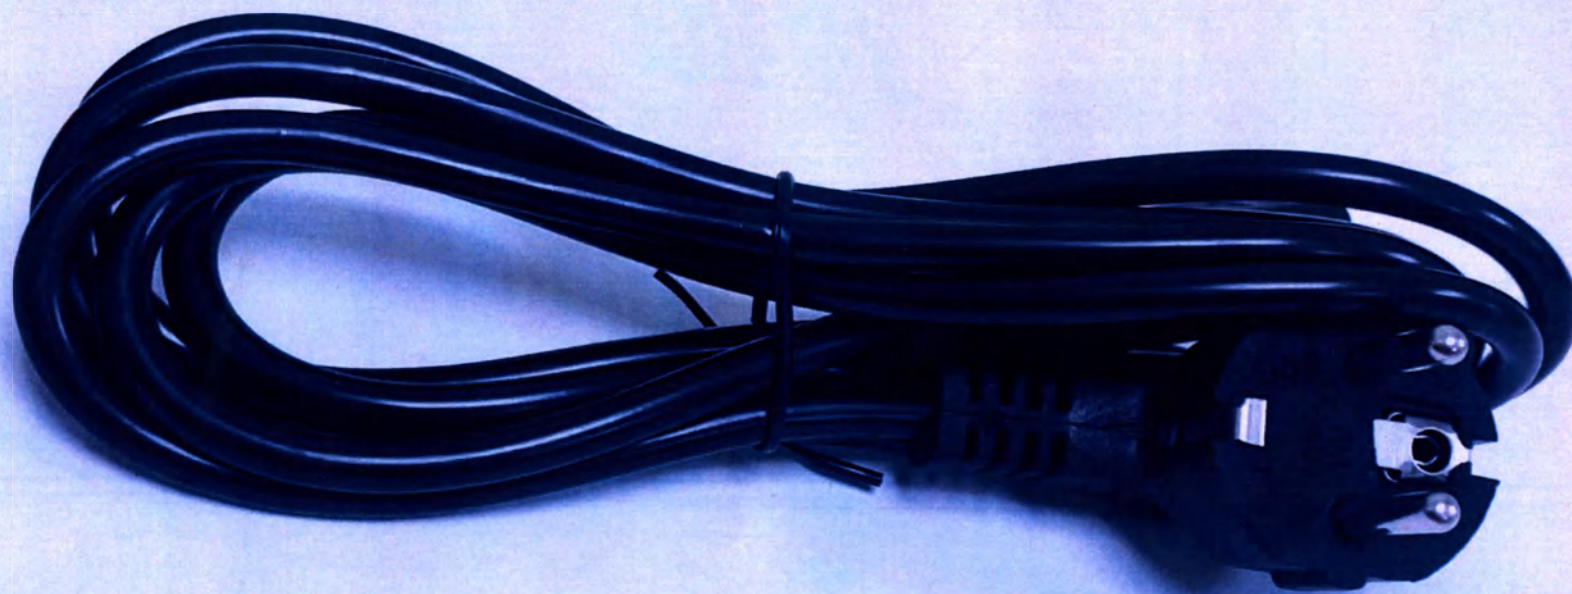


Шнур сетевой



Шнур сетевой в упаковке

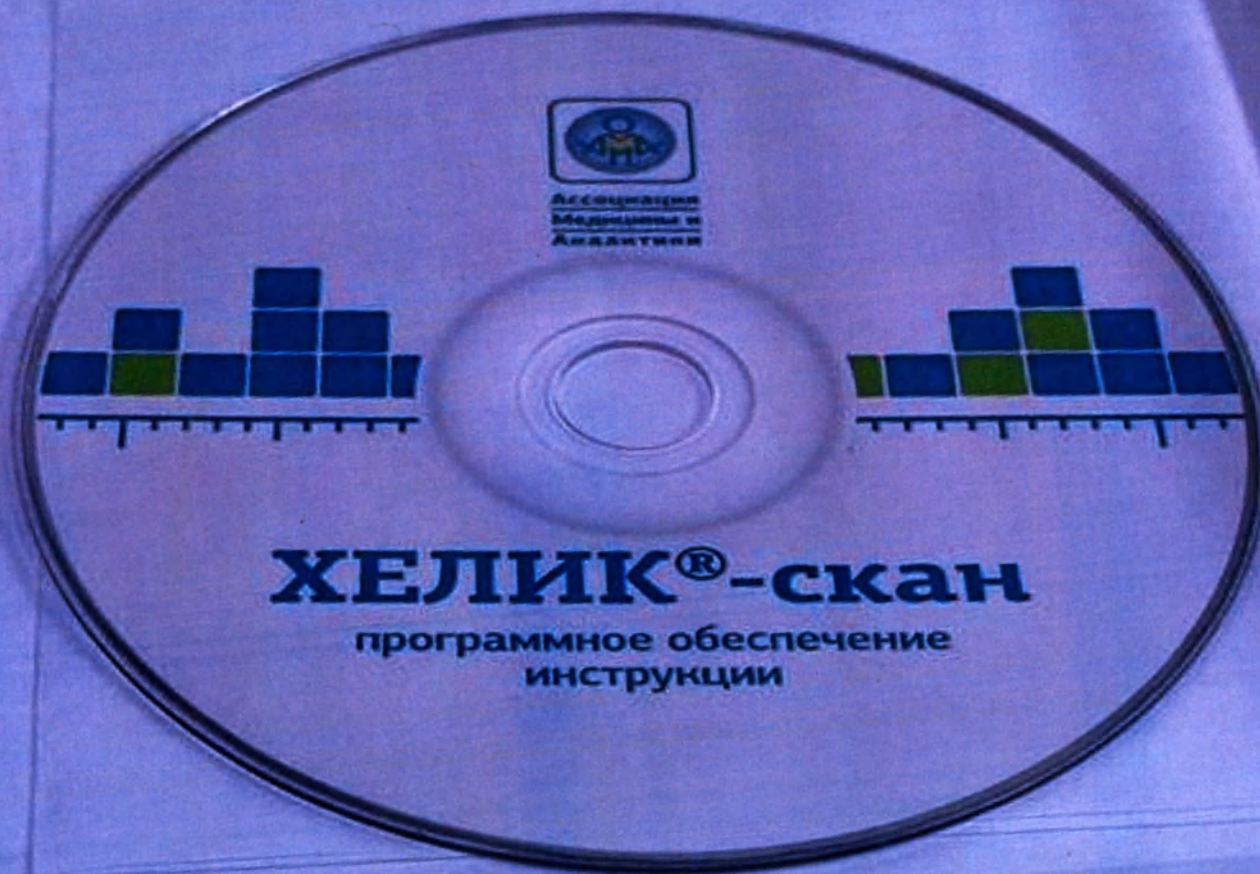

Программное обеспечение (компакт-диск)

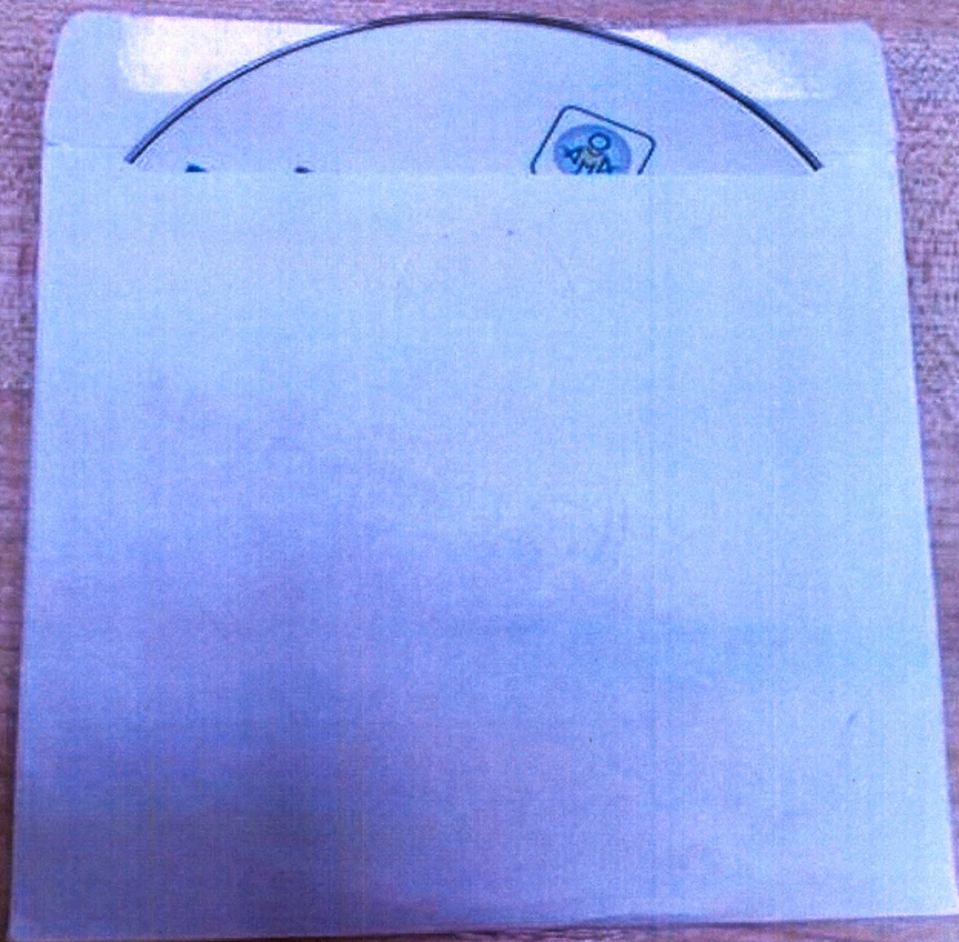

Программное обеспечение в упаковке (компакт-диск)

Программное обеспечение (компакт-диск)

Программное обеспечение в упаковке (компакт-диск)



Программное обеспечение (USB-Flash накопитель)


Программное обеспечение
(USB-Flash накопитель)



Программное обеспечение в упаковке (USB-Flash накопитель)



Персональный компьютер

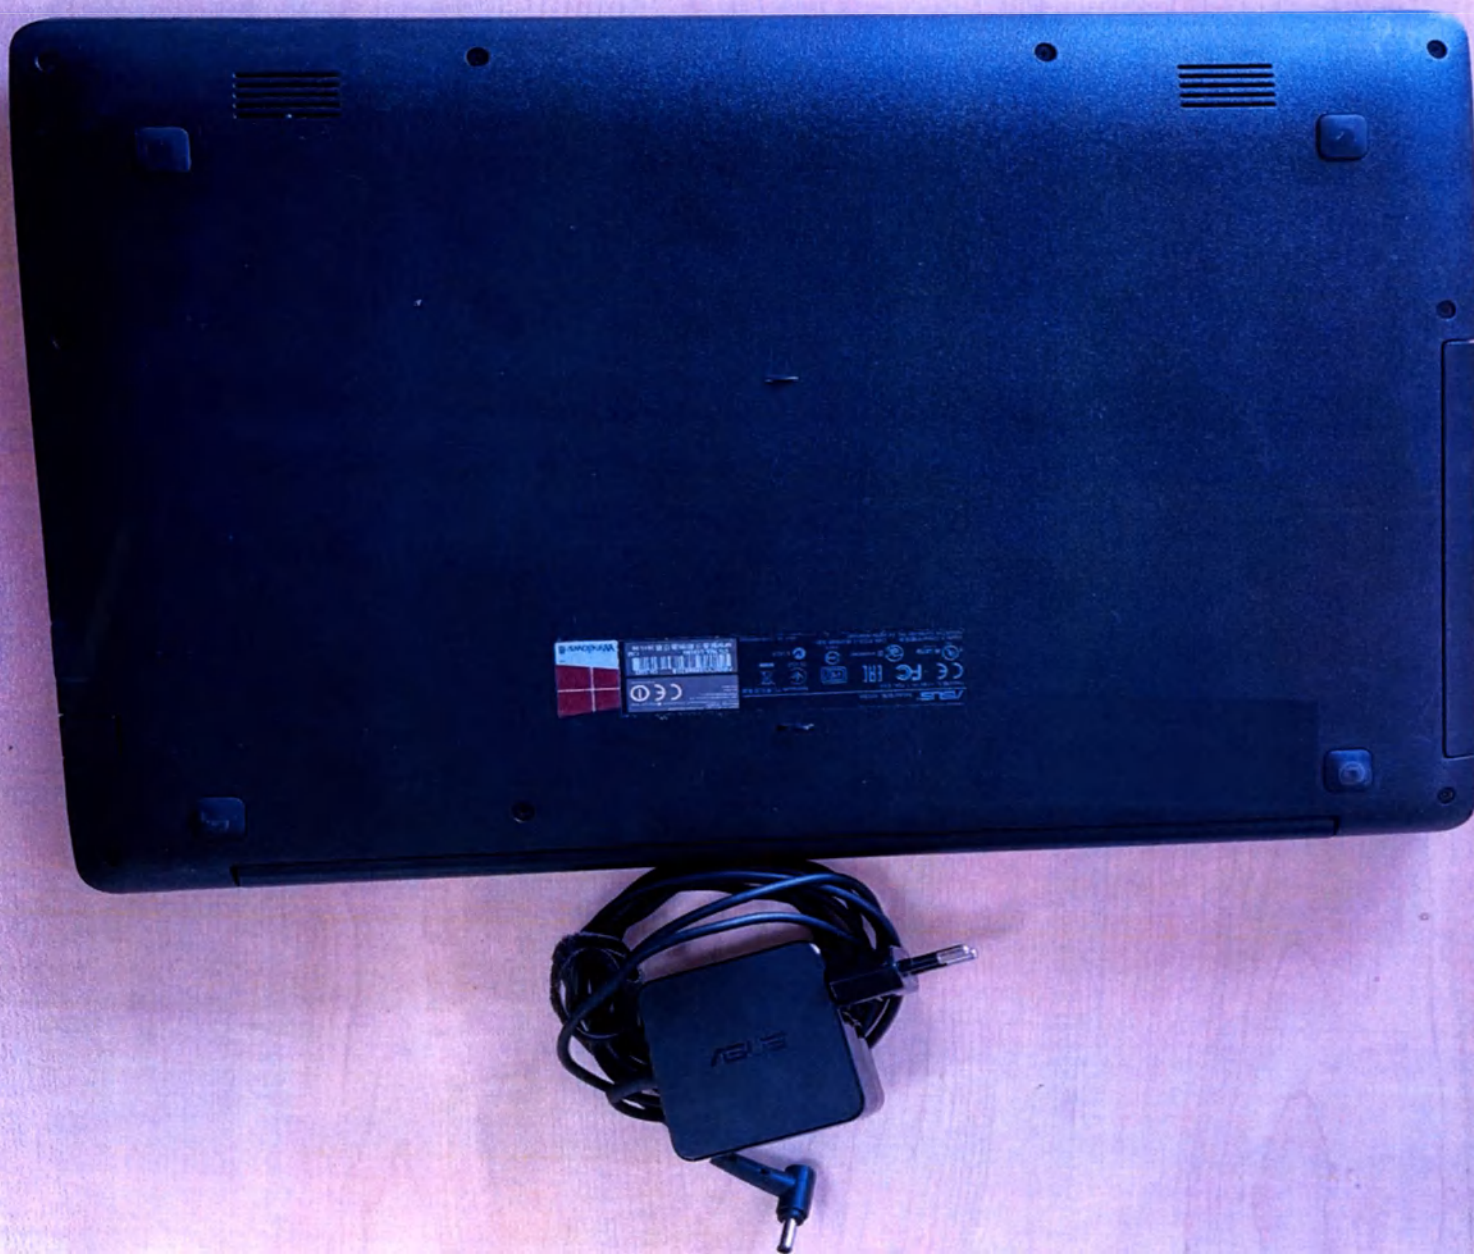

Персональный компьютер с блоком питания (вид сзади)

IN SEARCH OF
INCREDIBLE

ASUS

Упаковка персонального компьютера

Персональный компьютер



Играть
лучше с

Windows 10

CAUTION!



IF DAMAGED

Lithium ion batteries


DO NOT LOAD OR TRANSPORT
PACKAGE IF DAMAGED

For more information call:


1-703-527-3887 (International)

X553M

- 10.1" COLOR TA BLACK TEXTURE THICK
- LCD 15.6 HD GL
- VRAM N/A
- CPU INTEL N2640/RGA
- HDD 500G 5400R SATA
- ODD BX 5.1 M DL
- RAM DDR3L 1066 4G
- TFM/WO/TPM
- WLAN: 802.11bgn, WW-814.0
- USB: USB 2.0 - USB 3.0
- OS TYPE WITH 1.64BIT
- KB LANGUAGE RUSSIAN
- POWER CORD CEE
- ACCESSORY 3CELL 30MM




S/N: F6HBC/378158155



Patented Material - Reproduction may copy. See
www.asus.com/faq for details. Part number
M014141578



Маркировка упаковки персонального компьютера

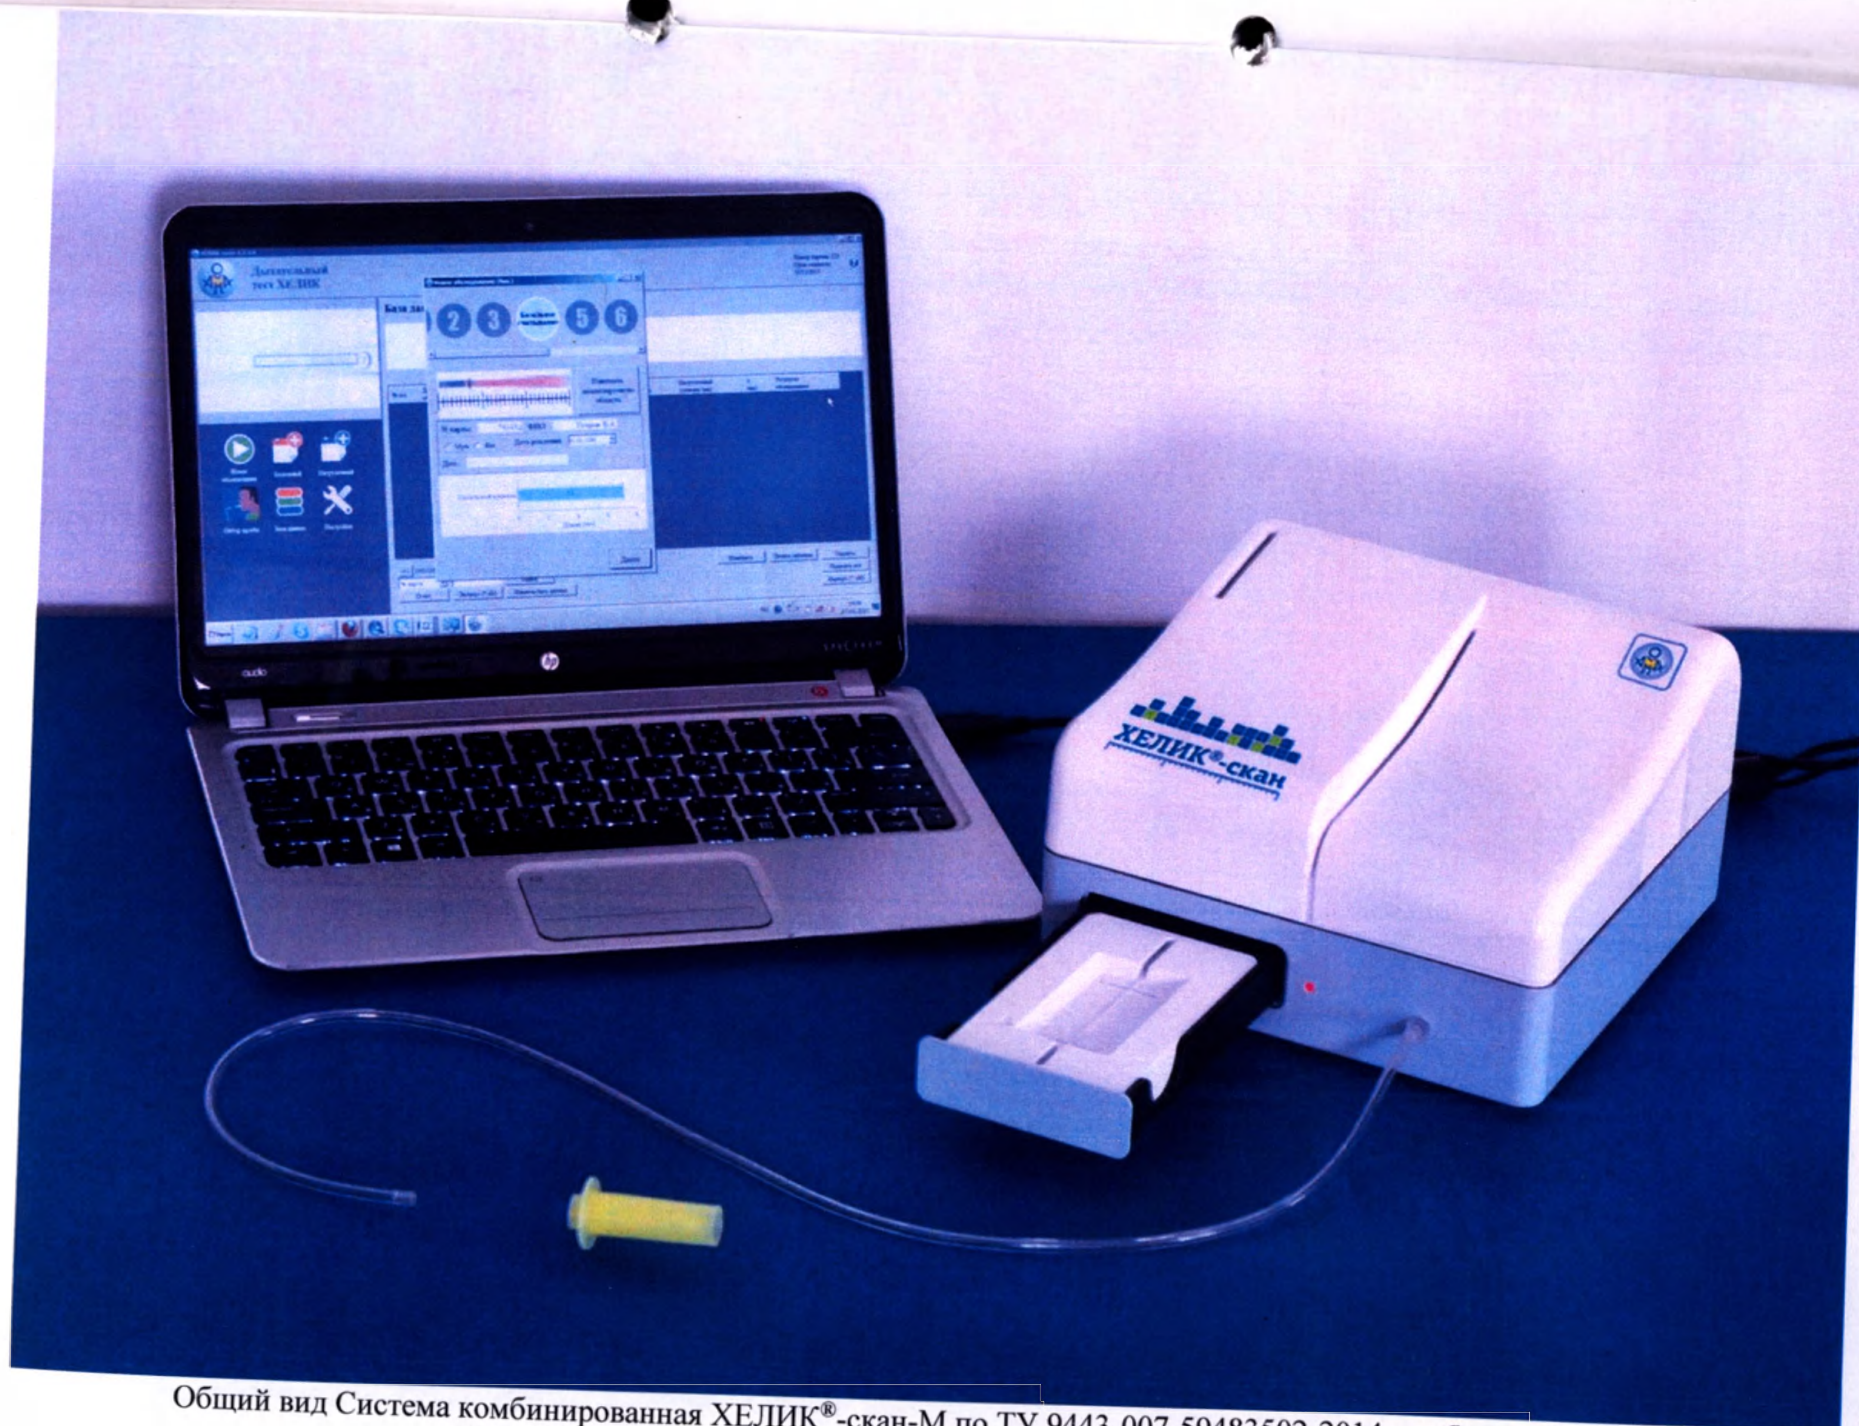

Общий вид Система комбинированная ХЕЛИК®-скан-М по ТУ 9443-007-59483502-2014 в рабочем состоянии

1 Пролито, пронумеровано, скреплено печатью

31 (тридцать один) листа(ов)

Менеджер по сертификации ООО «АМА»



И.А. Григорьева Григорьева И.А.

«22» марта 2024 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО «Ассоциация Медицины и Аналитики»

(ООО «АМА»)

М.А.Дмитриенко



2024 г.

Фотографии медицинского изделия

Система комбинированная ХЕЛИК®-скан-М по ТУ 9443-007-59483502-2014




Общий вид Система комбинированная ХЕЛИК®-скан-М по ТУ 9443-007-59483502-2014




Блок отбора пробы и считывания результата (вид спереди)




Блок отбора пробы и считывания результата (вид сверху)

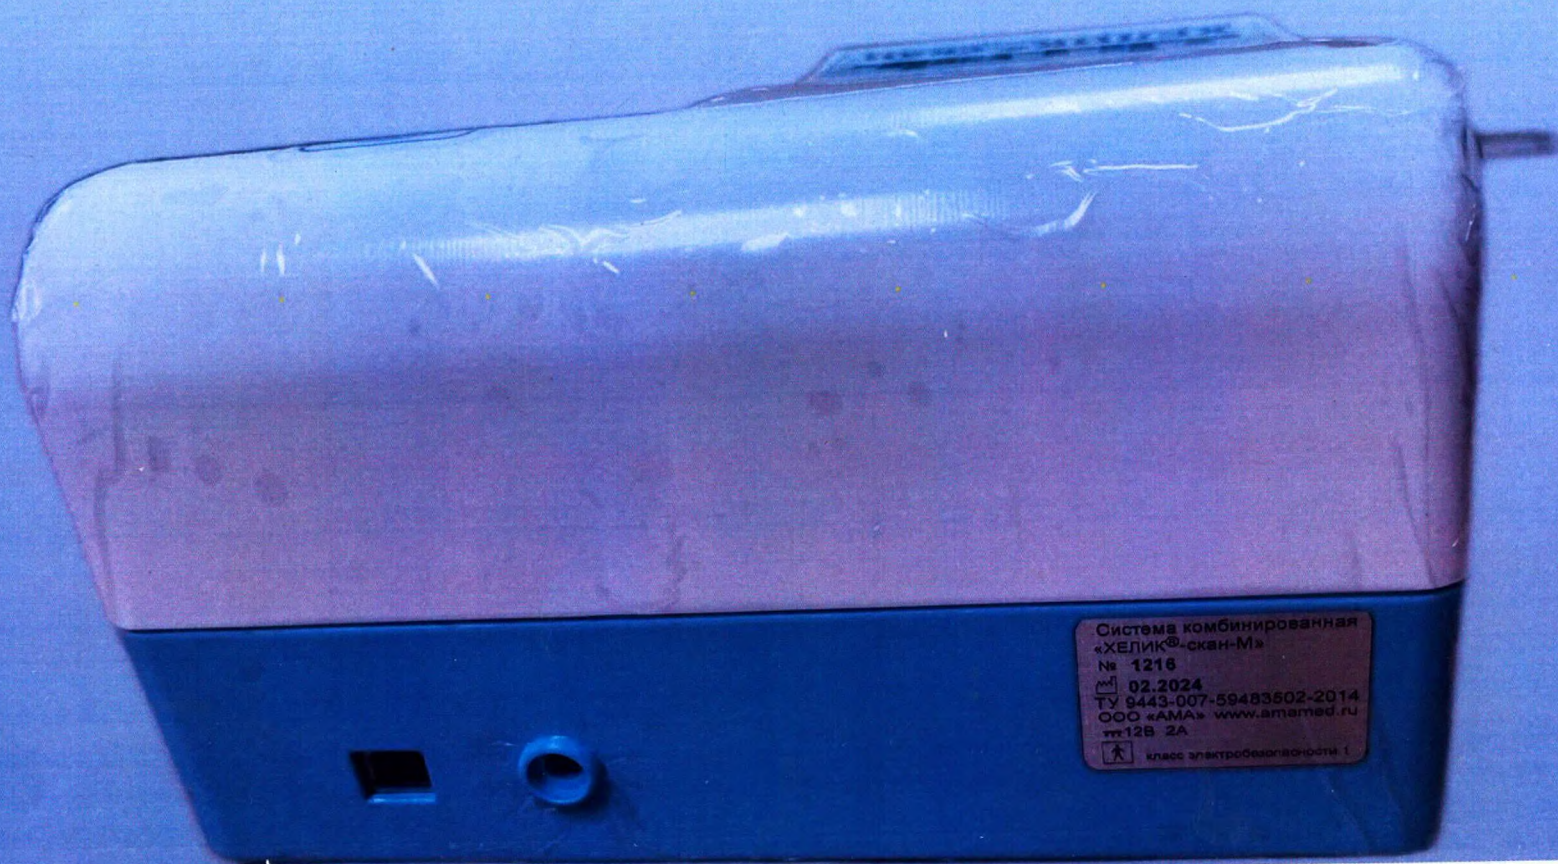


Блок отбора пробы и считывания результата (вид сзади)

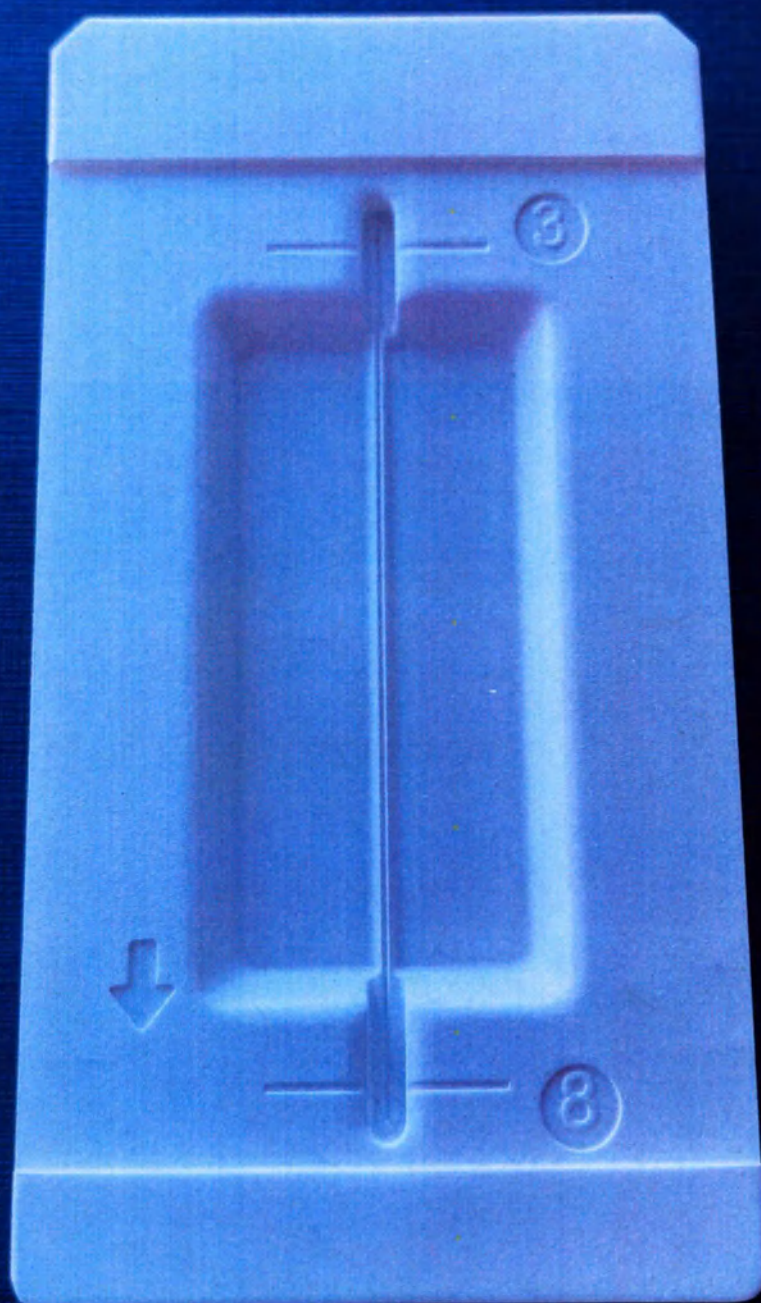


Кассета для размещения исследуемого образца

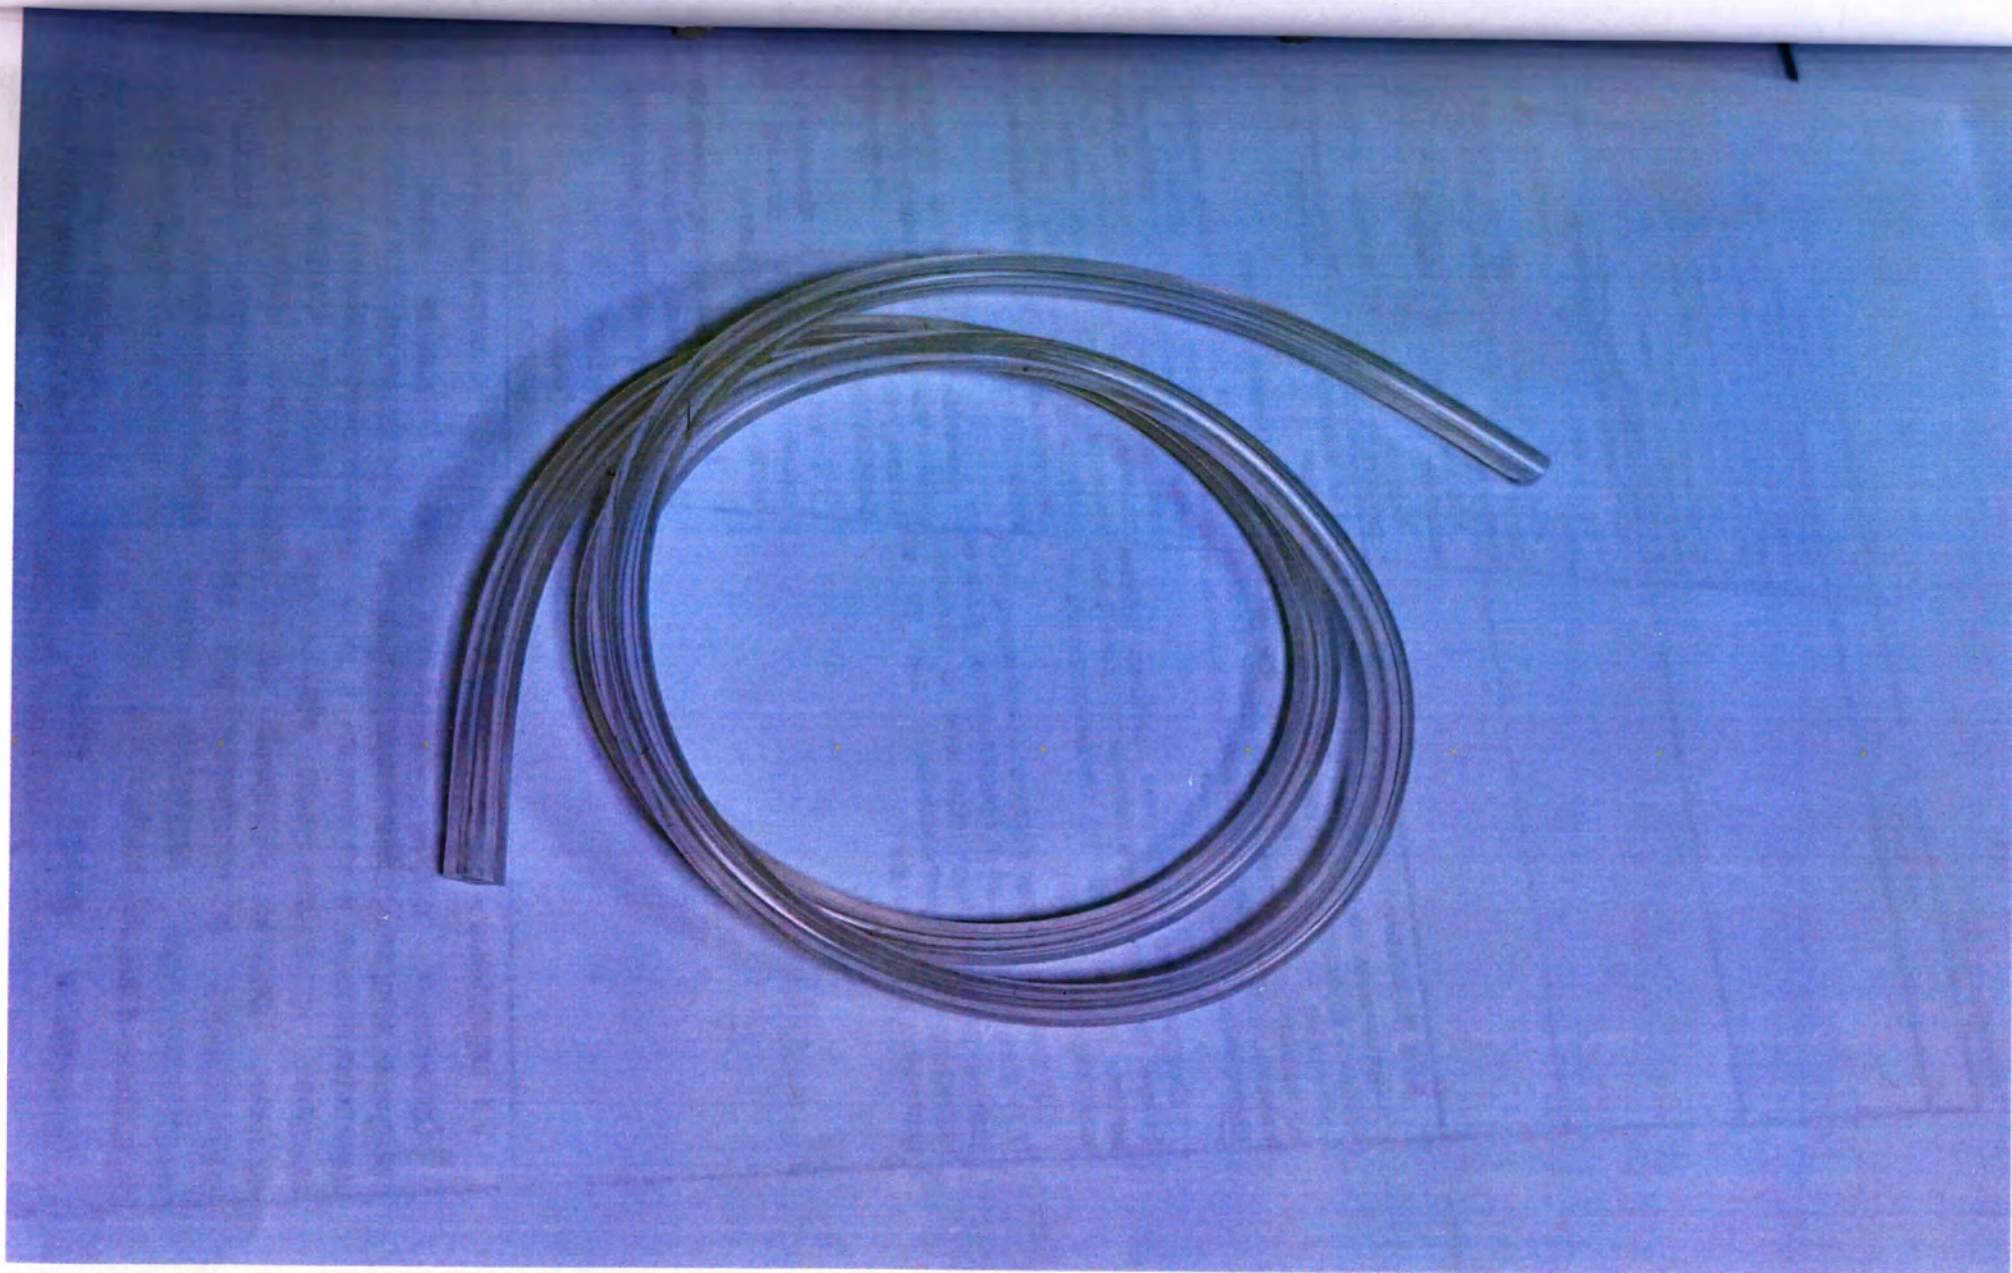

Соединительный шланг

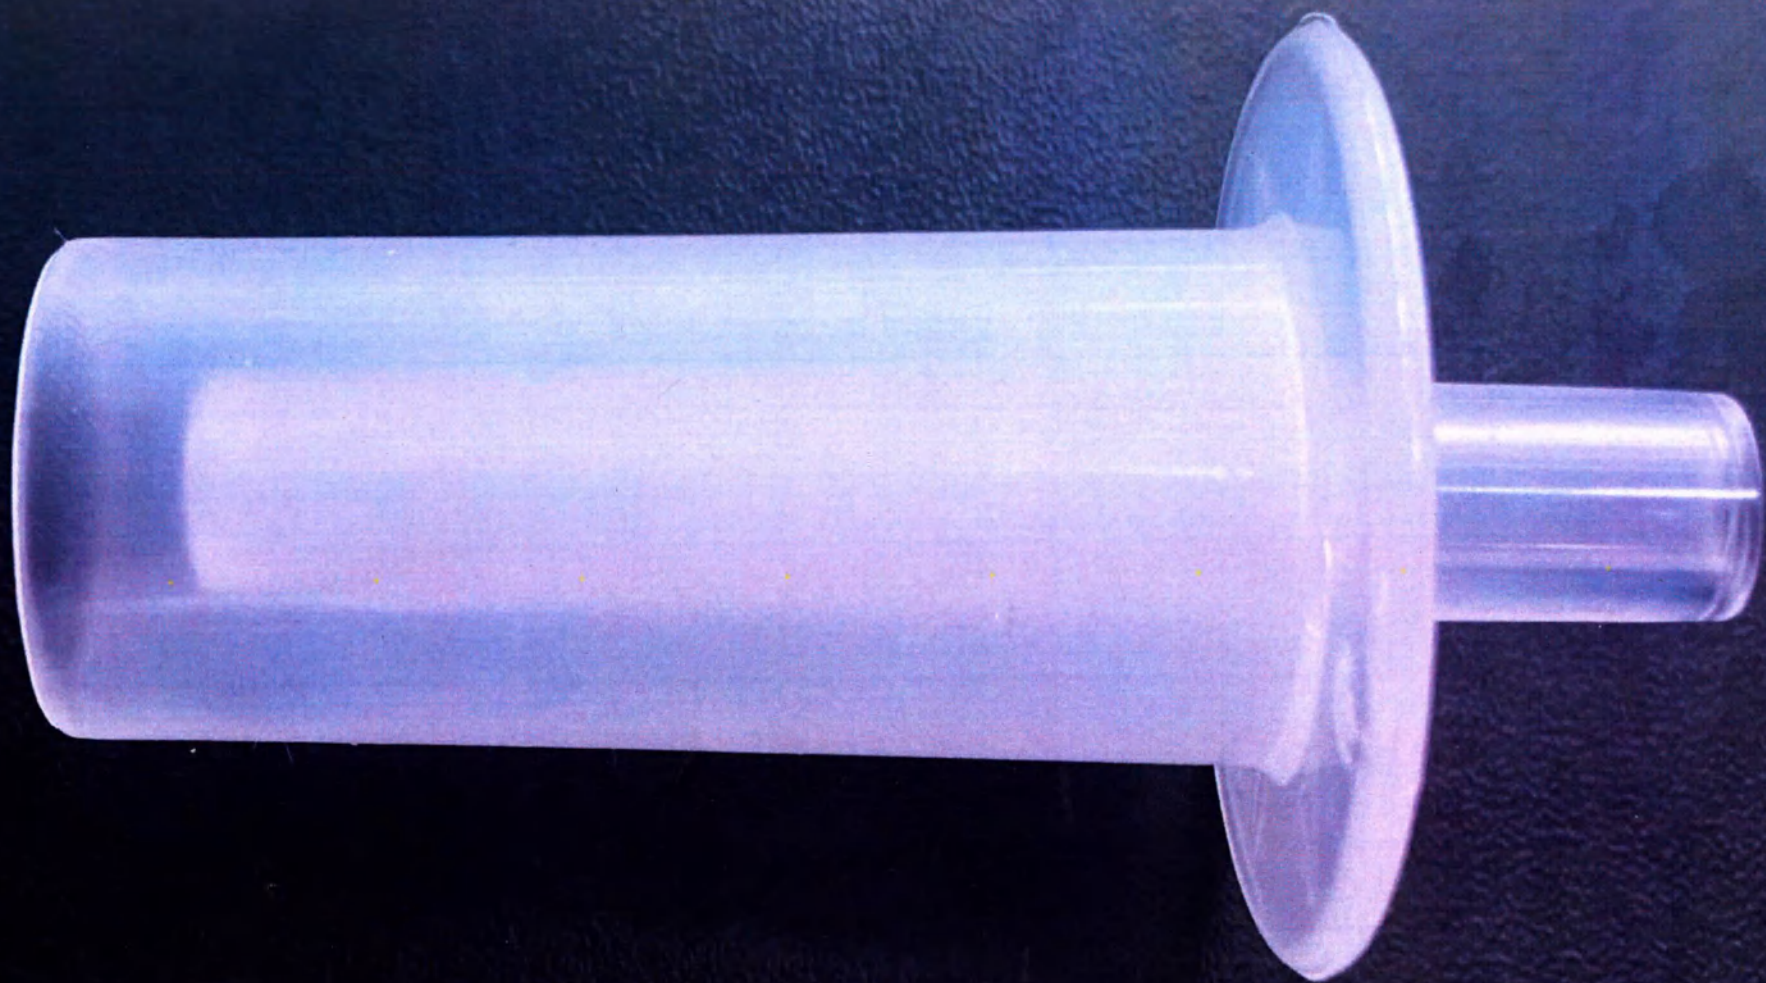

Одноразовый мундштук

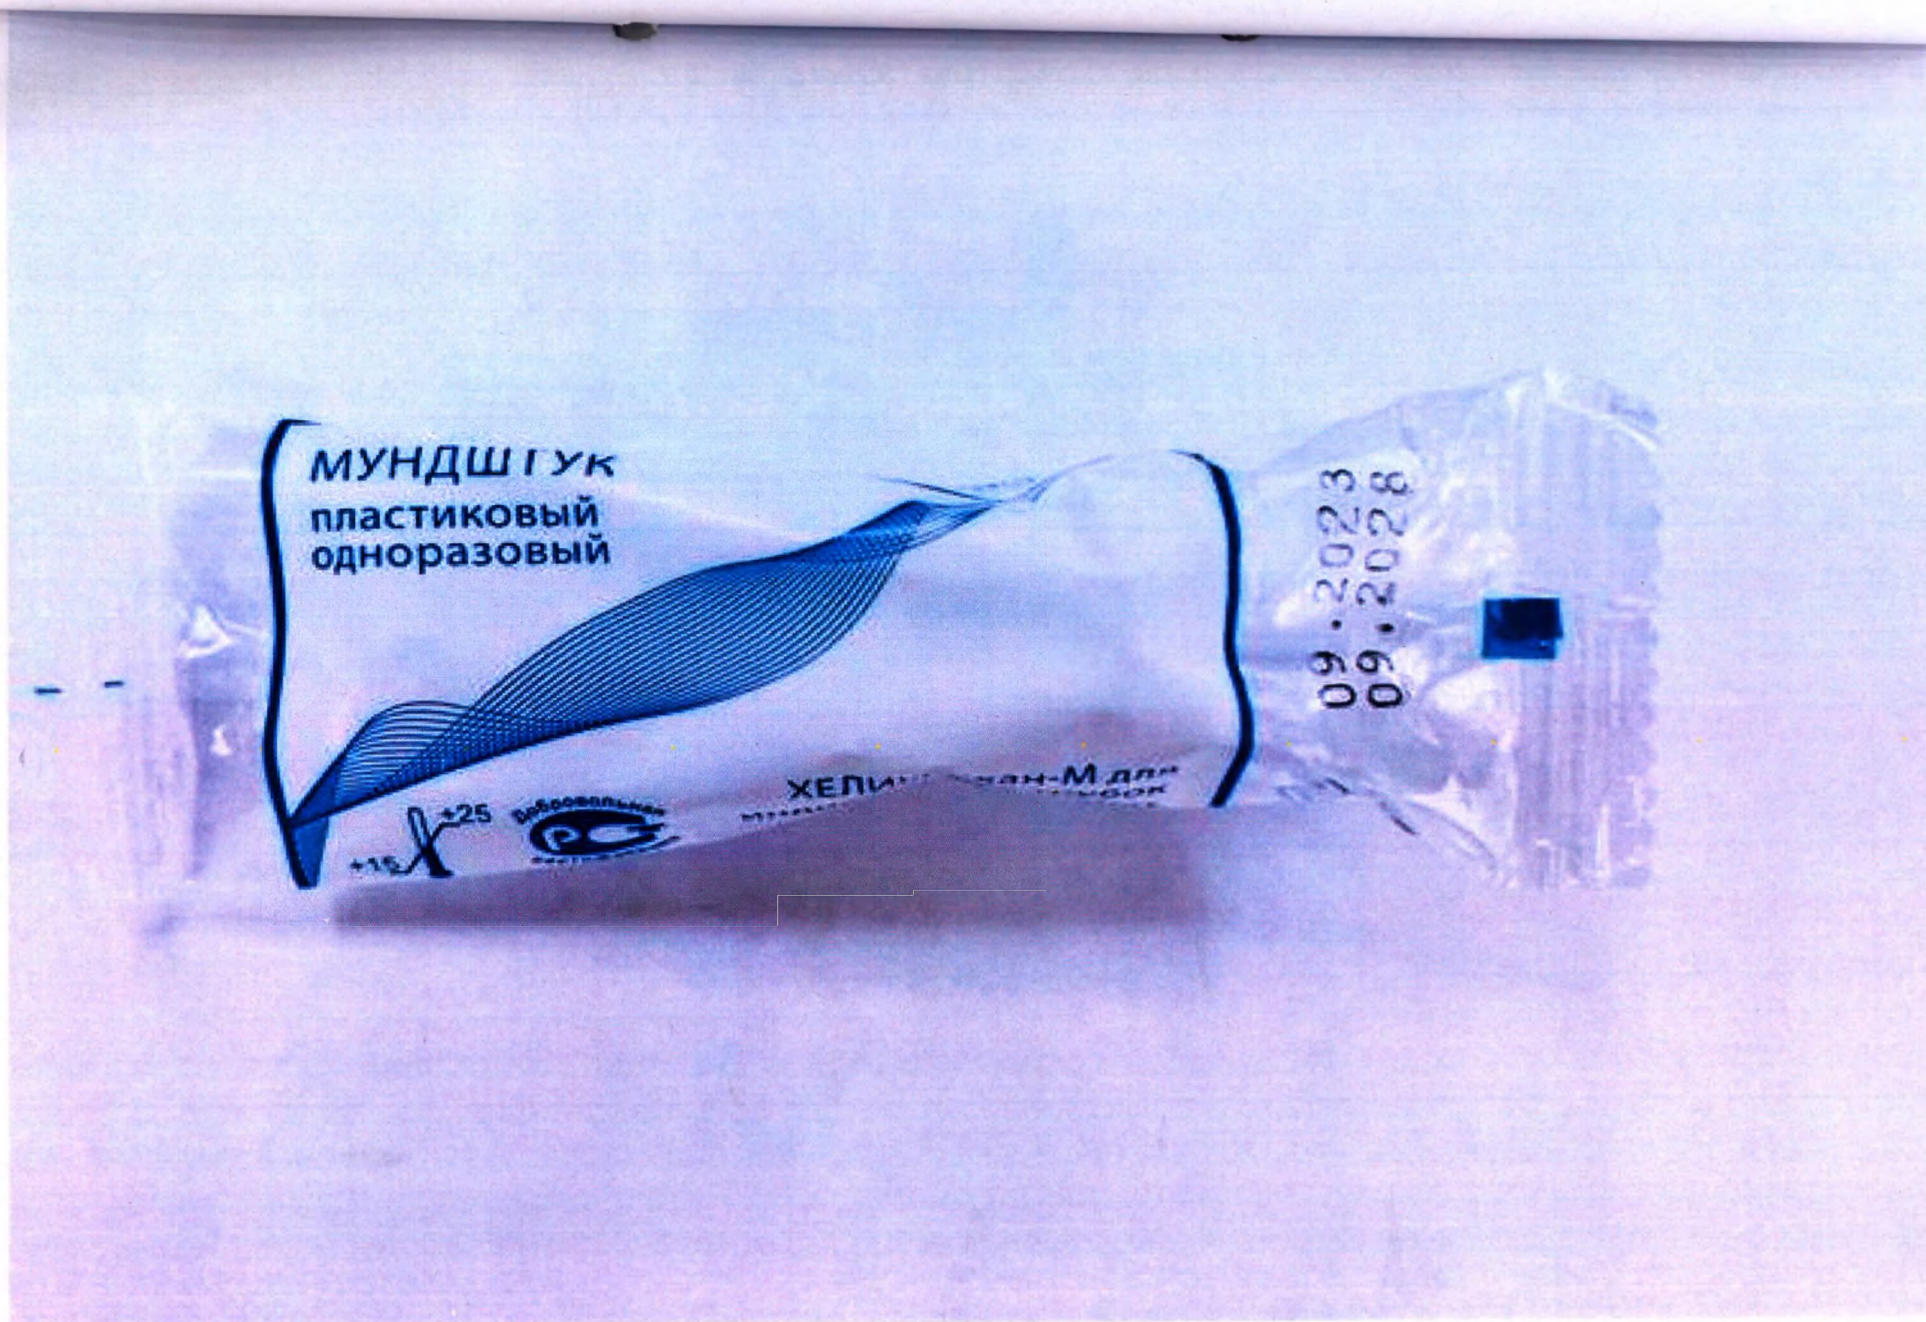



Одноразовый мундштук в индивидуальной упаковке (вид сбоку)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Factory(제조공장): SuZhou MEAN WELL Technology Co., Ltd.
A/S 연락처 : 031-465-2206 and 02-337-3722

明纬企业股份有限公司

台湾新北市五股区五权三路28号

Designed By MEAN WELL ENTERPRISES CO., LTD.

No. 28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,

New Taipei City 24891, Taiwan


Manufacturing Date(제조년월) : 01(MM)2023(YT)

Manual: www.meanwell.com/manual.html

MADE IN CHINA (中国制造)(中國製造)(제조국:중국) MW02



Кабель соединительный с ПК

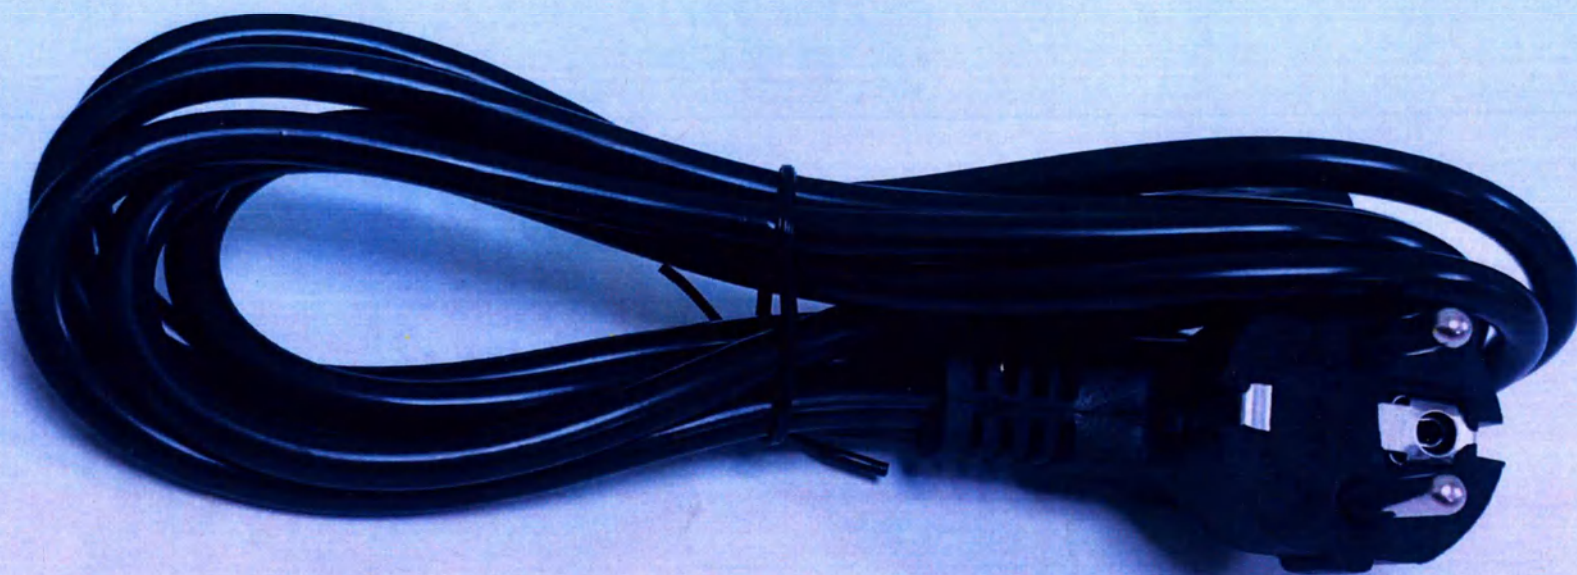


Шнур сетевой



Программное обеспечение (компакт-диск/ USB-Flash накопитель)



Персональный компьютер

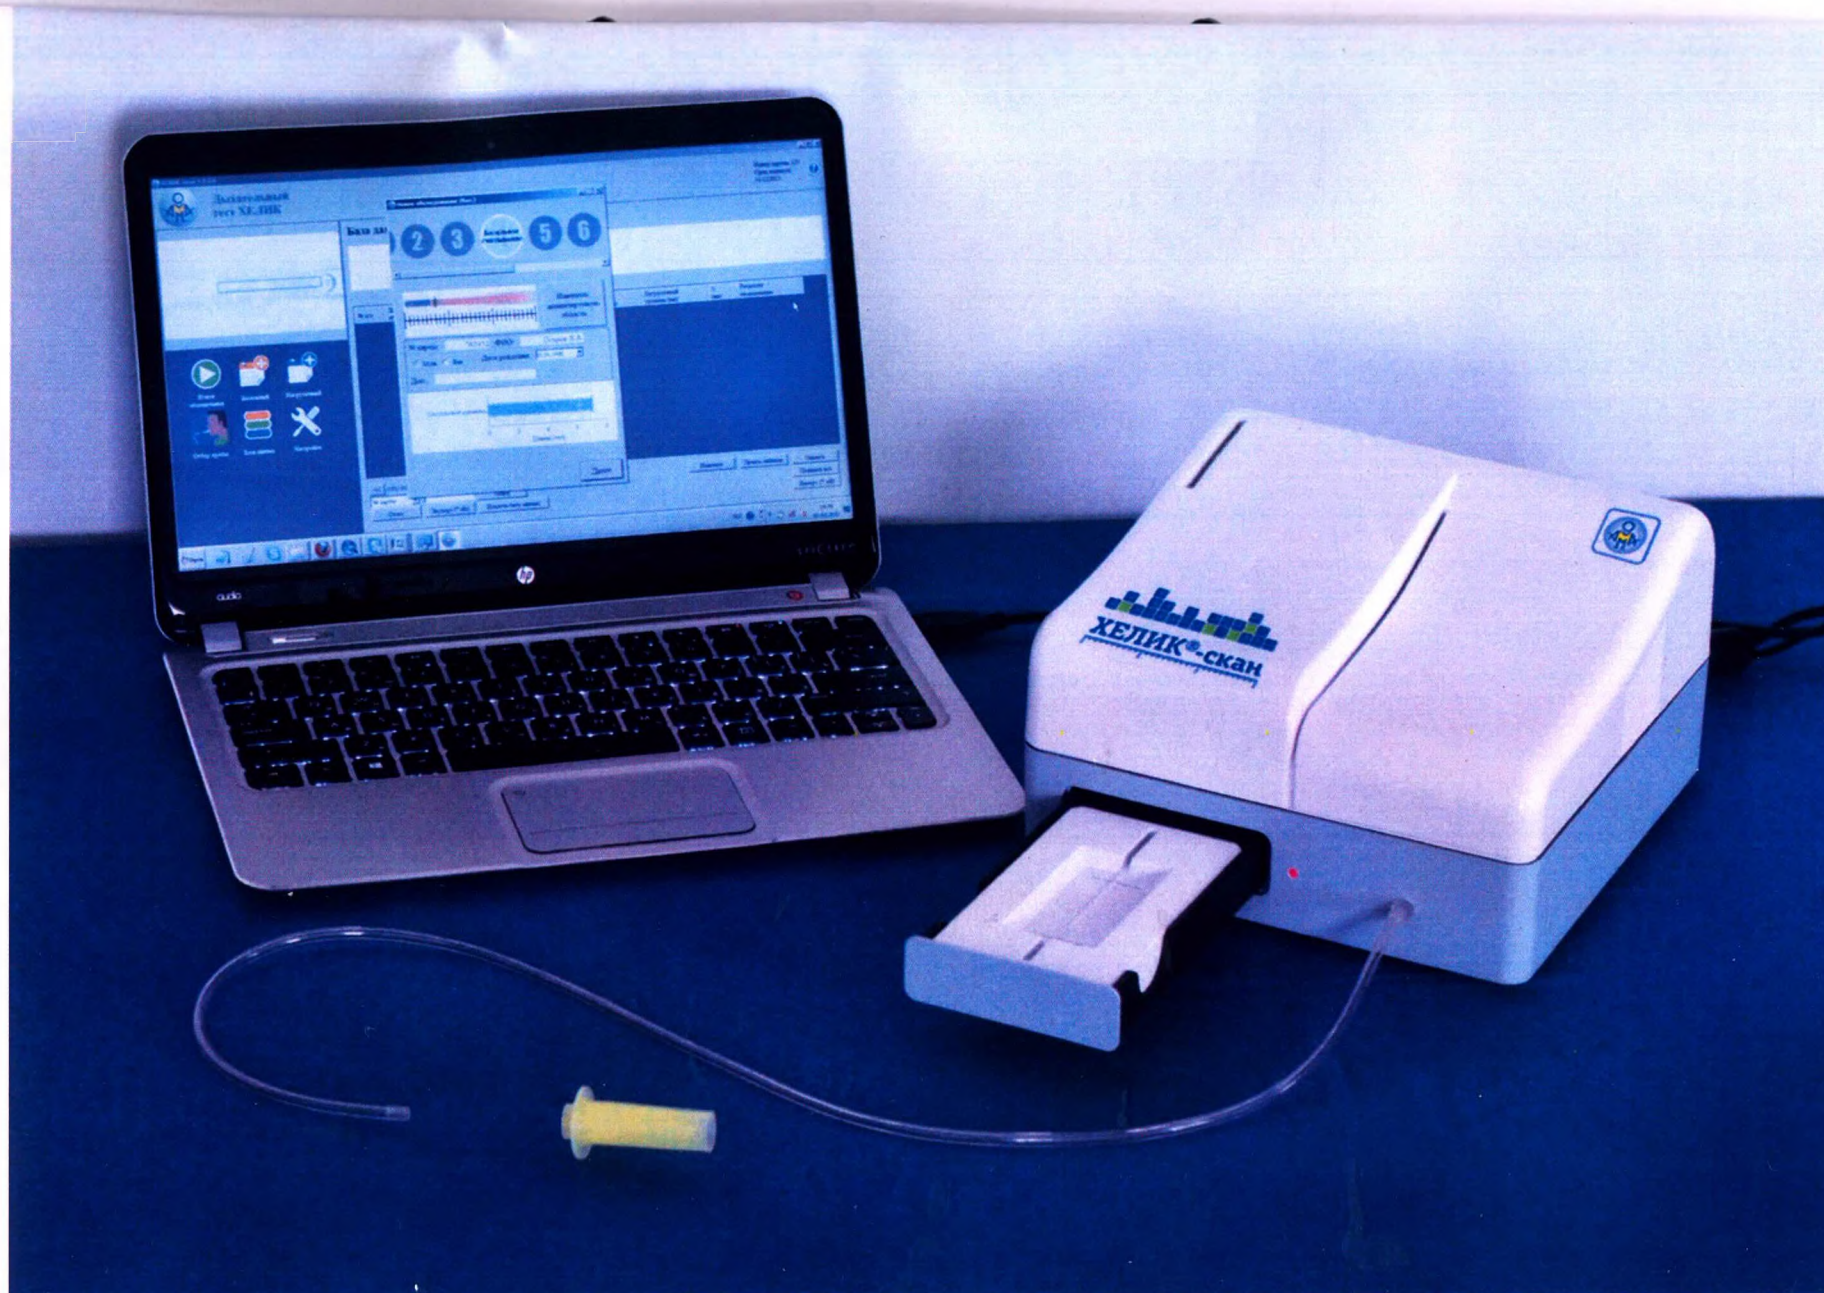

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
17 (сорок семь) листов

Генеральный директор ООО «АМА»

М.А. Дмитриенко

«27» декабря 2024 г.

