

PHILIPS

Руководитель

по нормативному регулированию

ООО «ФИЛИПС»

Горкуша Д.В.

2021 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ



«Система управления акушерскими данными IntelliSpace Perinatal»

Производства: Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH


(Филипс Медицин Систем Боблинген ГмбХ)

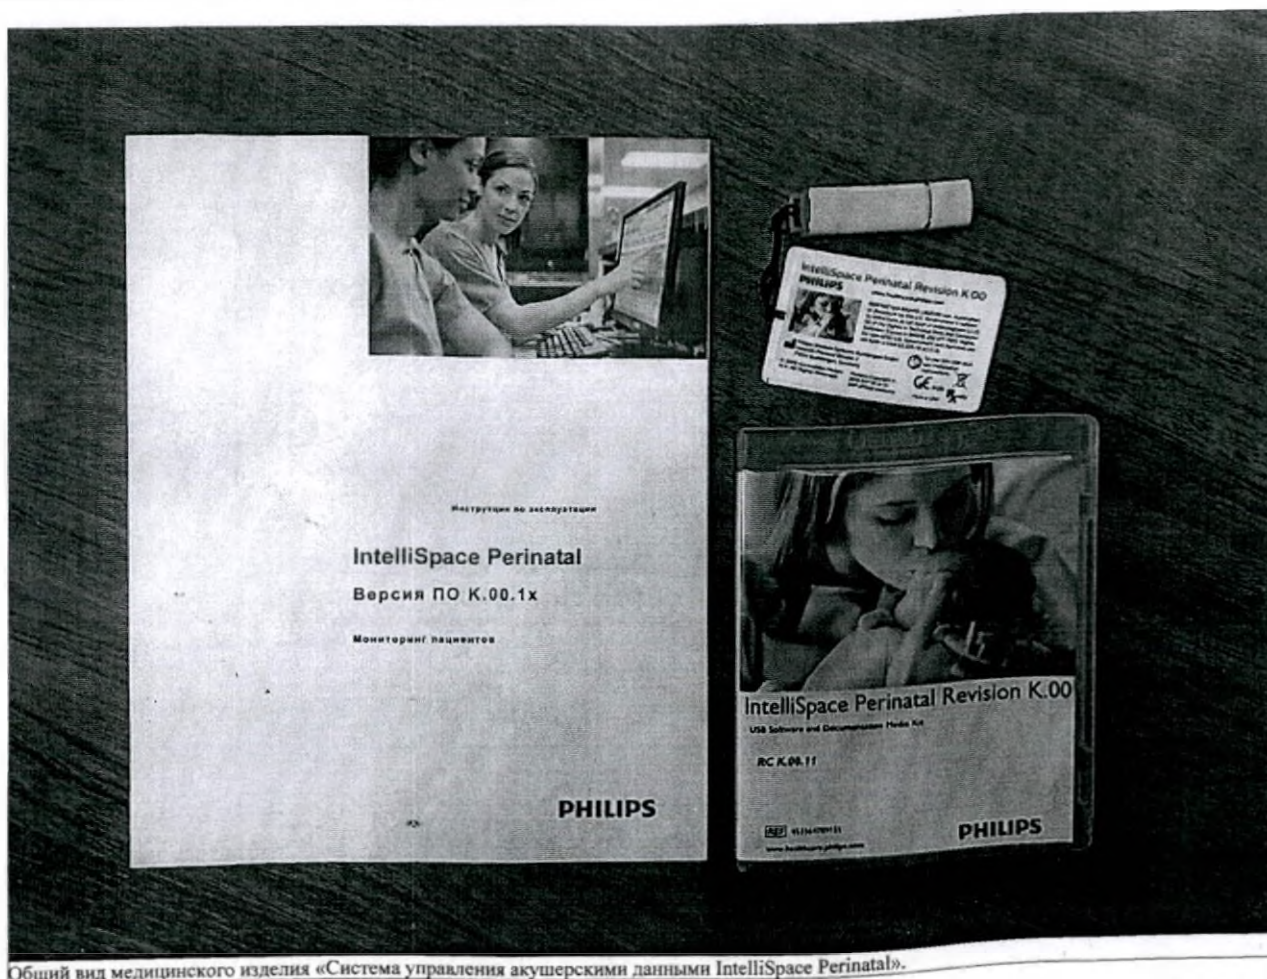

Общий вид медицинского изделия «Система управления акушерскими данными IntelliSpace Perinatal».

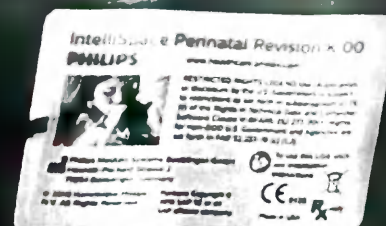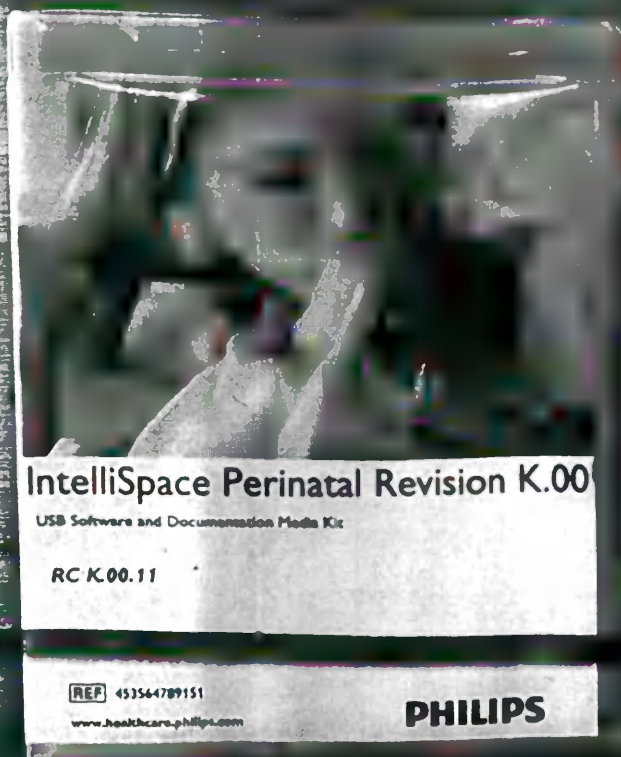


1.2 Обеспечение программного на USB флеш-накопителе. Упаковка ПО на USB флеш-накопителе. Вид спереди.

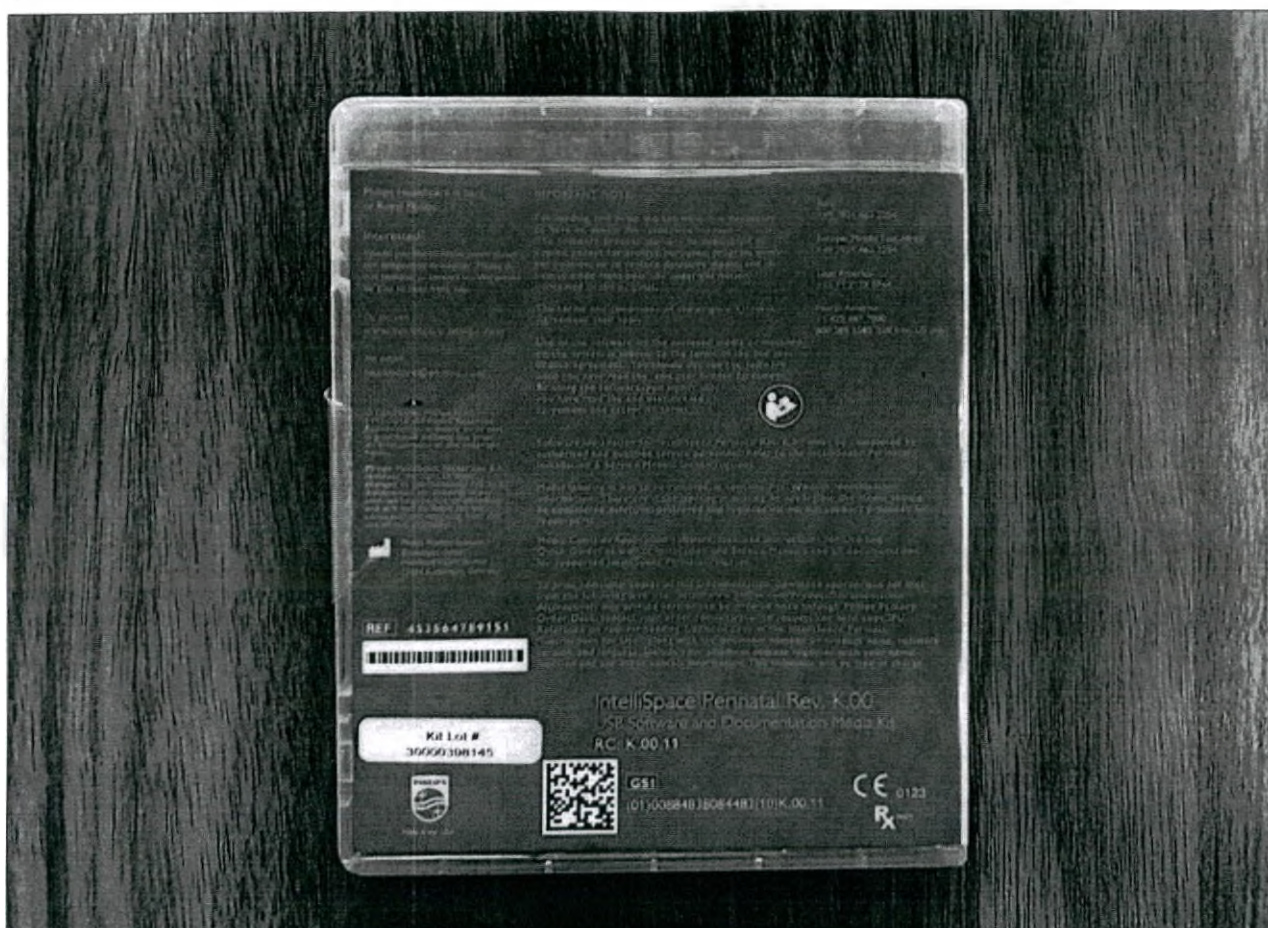


1.3 Обеспечение программное на USB флеш-накопителе. Упаковка ПО на USB флеш-накопителе. Вид сзади. Маркировка.



1.4 Обеспечение программное на USB флеш-накопителе. USB флеш-накопитель. Вид спереди.

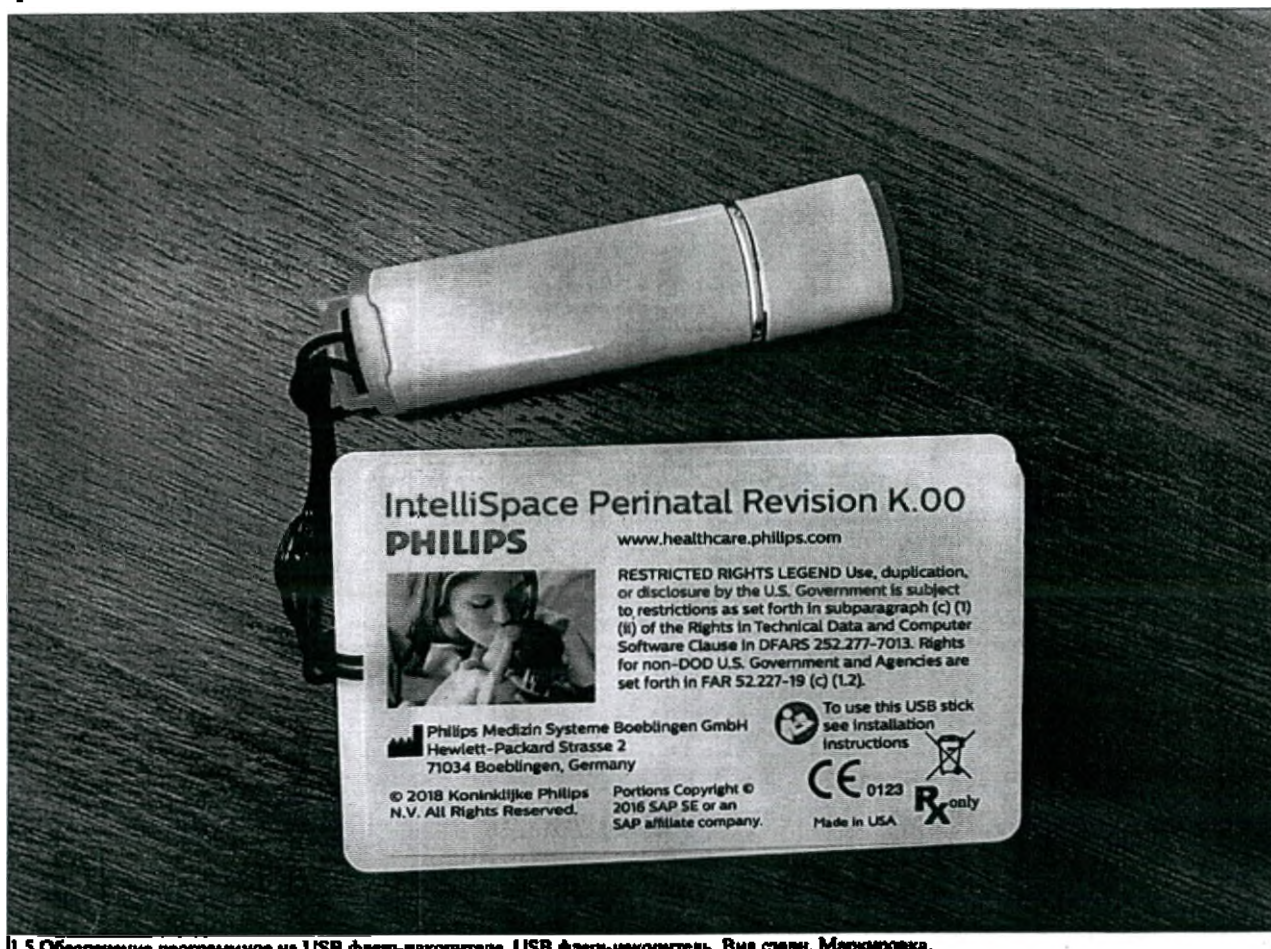

1.5 Обеспечение программное на USB флеш-накопителе. USB флеш-накопитель. Вид следн. Маркировка.

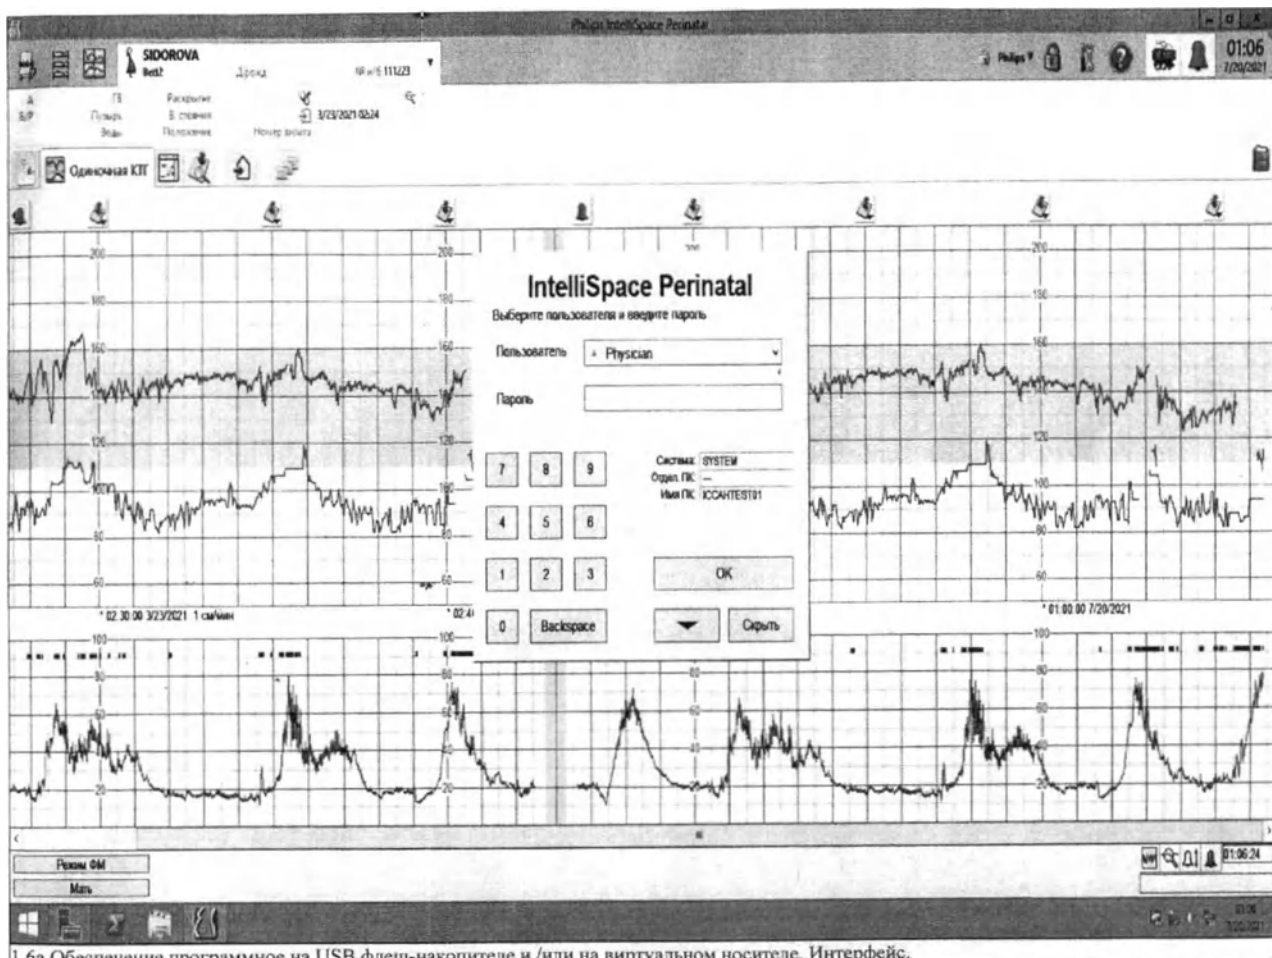

1.6а Обеспечение программное на USB флеш-накопителе и /или на виртуальном носителе. Интерфейс.

Поиск пациента Пациент не выбран

Регистрация 01:12 7/09/2021

Идентификационные данные пациента

Имя: _____ Отч.: _____ Дата рождения: ____/____/____

Фамилия: _____ Место рождения: _____

Видеокарта: _____ Номер истории болезни: _____ Номер страхового свидетельства: _____

Адрес электронной почты: _____ Оценки: _____

Очистить Поиск Новый пациент

Фамилия Имя Отч. Дата рож. Ю. пац. № иб. № ст. Вакс. ПР. ДР.

Регистрация карта
Выбор пациента
Запуск обследования
Удалить пациента
Новый эпизод
Закрыть эпизод
Прикрыть эпизод
Отмена обследования

1.66 Обеспечение программное на USB флеш-накопителе и /или на виртуальном носителе. Интерфейс.

Philips IntelliSpace Perinatal

Информация Пациент не выбран


Регистрация 01:11 7/09/2021

Отделение: _____ Инфопамять: _____ Включить ☐ В пределах отделе. ☐ Пустые ячейки


Сос	Койка	Физ. м.	Ф	У	ФИО пациента	Возра	ГВ	Б	Р	О	О	О	•	%	θ	Д(ч)	Δ	□	Дата род
\$ Bett1					Ivanova	47/0				подтека			6-7	75	-1		☒	☒	
\$ Bett2					Sidorova												☒	☒	
\$ Bett3					04:33:56 7/24/18												☒	☒	
\$ Bett4					НЕТ АРХИВАЦИИ												☒	☒	

Выбор пациента Комментарий Перевод Смена



1.6в Обеспечение программное на USB флеш-накопителе и /или на виртуальном носителе. Интерфейс.

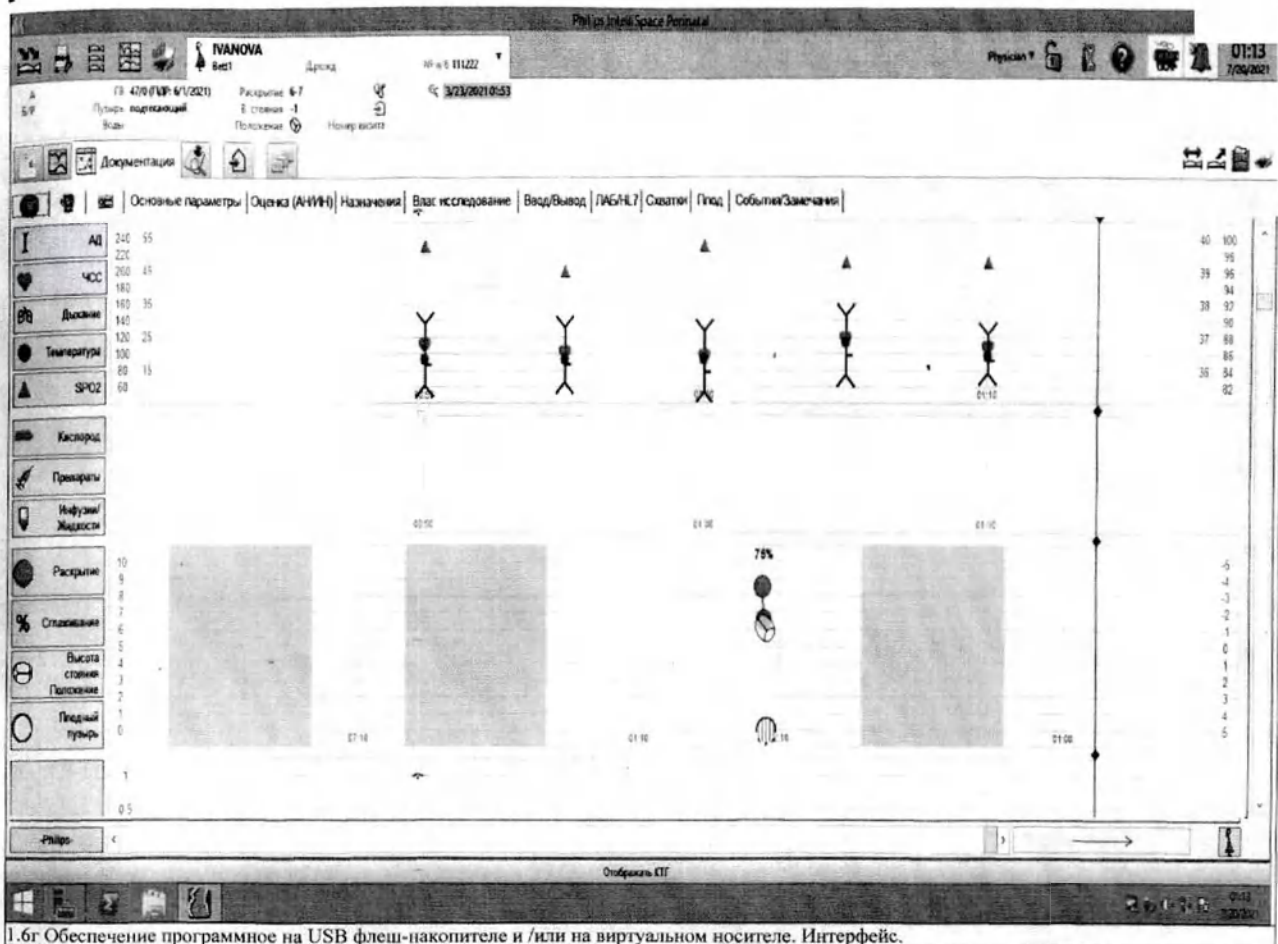

1.6г Обеспечение программное на USB флеш-накопителе и /или на виртуальном носителе. Интерфейс.

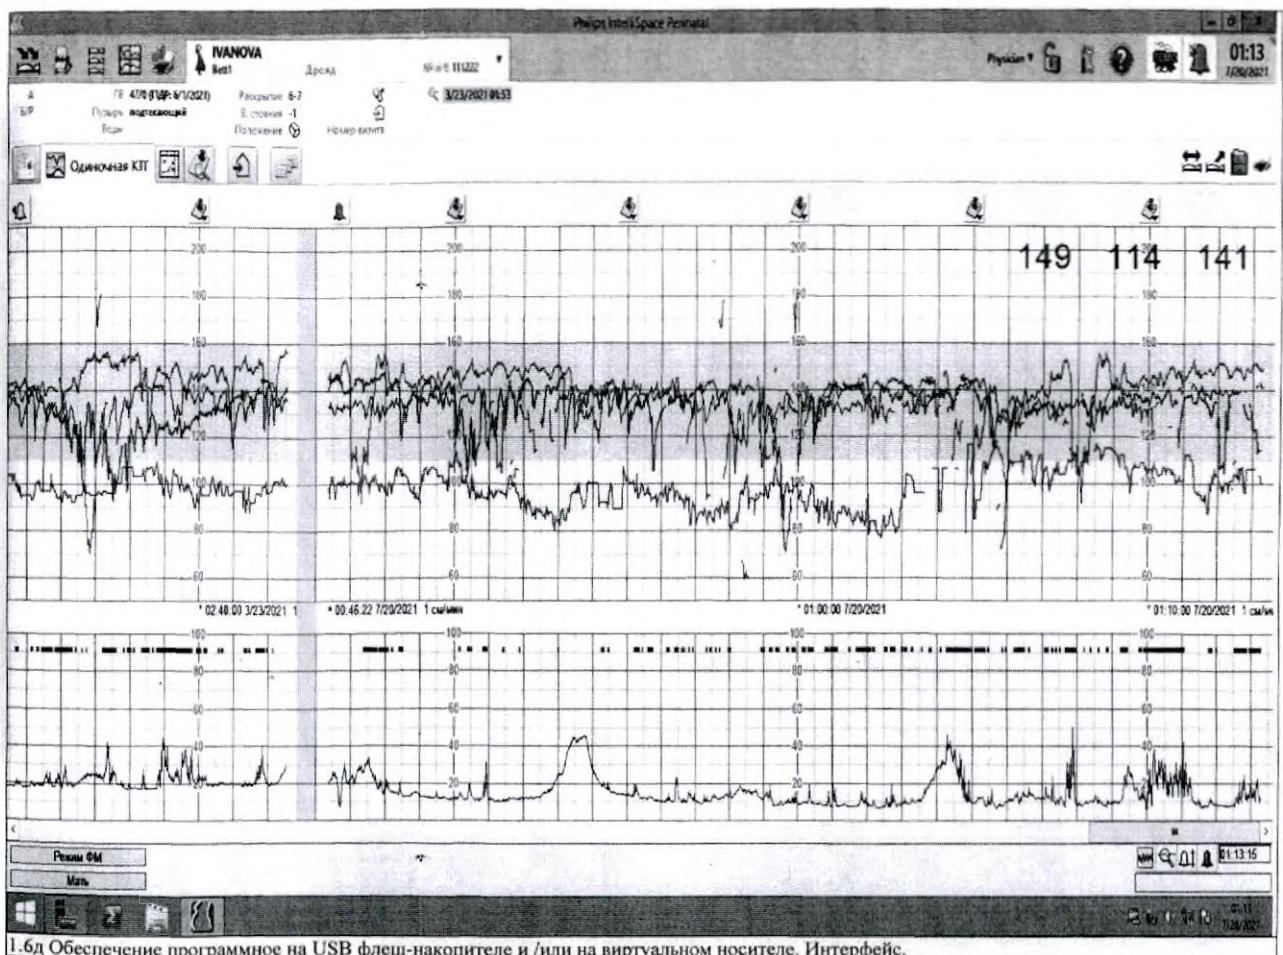

1.6д Обеспечение программное на USB флеш-накопителе и /или на виртуальном носителе. Интерфейс.

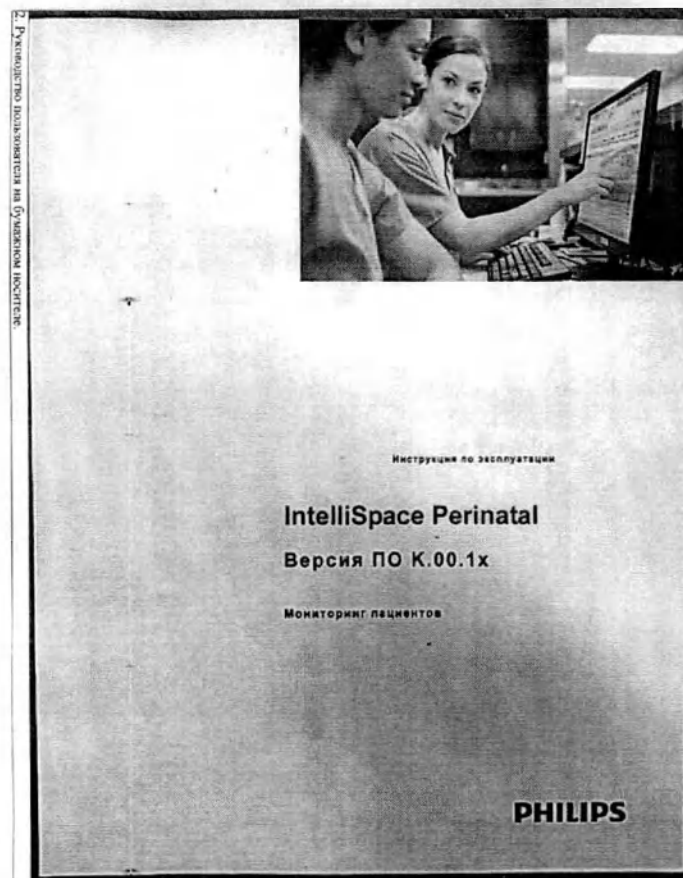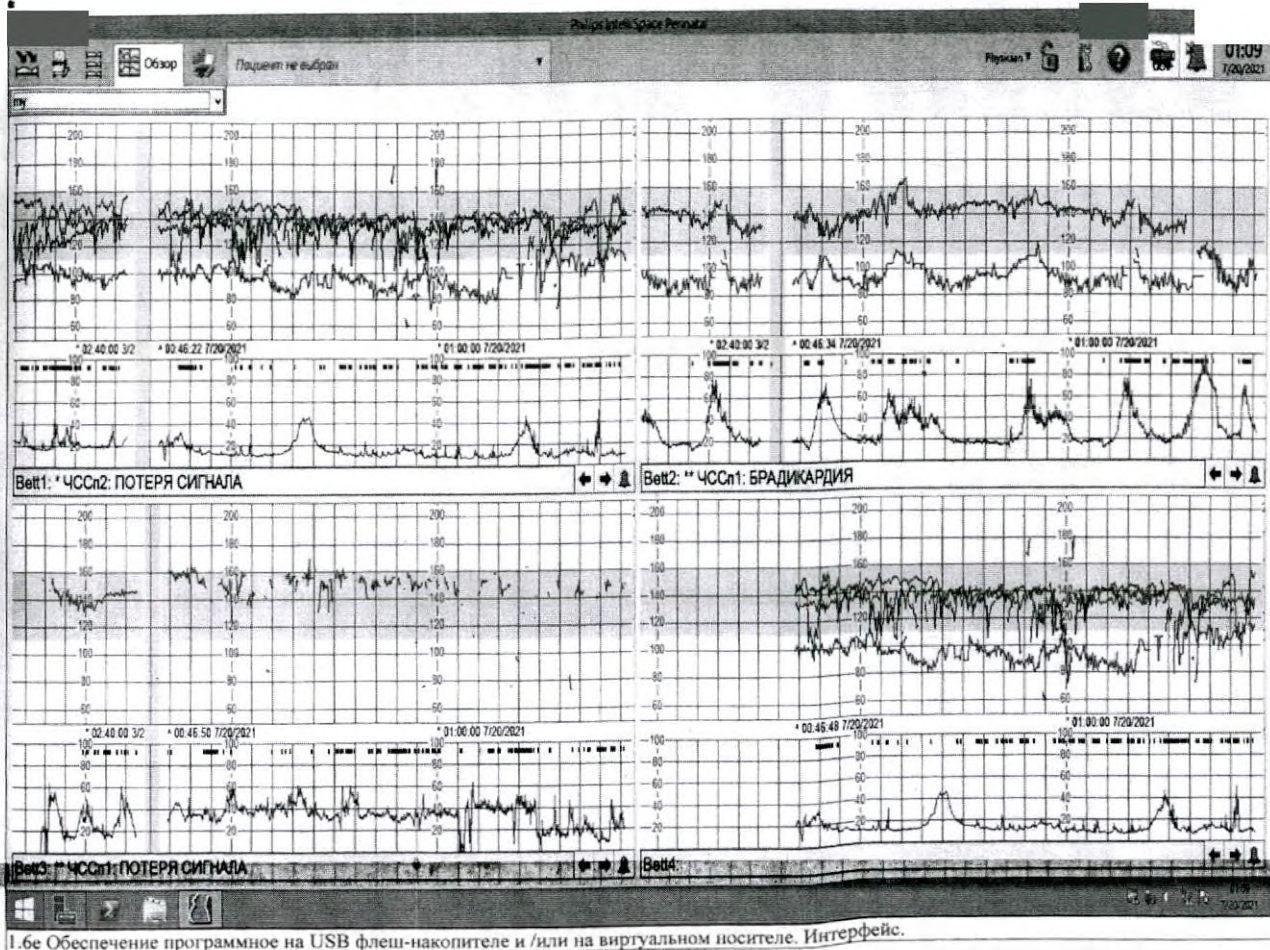

**“Система управления акушерскими данными
IntelliSpace Perinatal”**

«Филипс Медицин Систем Боблинген ГмбХ»,

Хьюлетт-Паккард Штрассе 2

71034 Боблинген, Германия

Серийный номер: см. Kit Lot # на маркировке изделия

Дата производства: см. на маркировке изделия

Предупреждения и знаки опасности: см.



Регистрационное удостоверение: № РЗН

EAC

Макет русскоязычной маркировки обеспечения программного.