

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK, варианты исполнения

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз» (ООО «Эбботт Лэбораториз») настоящим сообщает, что медицинское изделие «Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK, варианты исполнения» выпускается в различных вариантах исполнения, которые в свою очередь имеют различные размеры баллона (диаметр x длина), образующие размерный ряд:

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK, варианты исполнения:

1. Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 6; 2.25 x 8; 2.25 x 12; 2.25 x 15; 2.25 x 20; 2.25 x 25; 2.25 x 30; 2.50 x 6; 2.50 x 8; 2.50 x 12; 2.50 x 15; 2.50 x 20; 2.50 x 25; 2.50 x 30; 2.75 x 6; 2.75 x 8; 2.75 x 12; 2.75 x 15; 2.75 x 20; 2.75 x 25; 2.75 x 30; 3.00 x 6; 3.00 x 8; 3.00 x 12; 3.00 x 15; 3.00 x 20; 3.00 x 25; 3.00 x 30; 3.25 x 6; 3.25 x 8; 3.25 x 12; 3.25 x 15; 3.25 x 20; 3.25 x 25; 3.25 x 30; 3.50 x 6; 3.50 x 8; 3.50 x 12; 3.50 x 15; 3.50 x 20; 3.50 x 25; 3.50 x 30; 3.75 x 6; 3.75 x 8; 3.75 x 12; 3.75 x 15; 3.75 x 20; 3.75 x 25; 3.75 x 30; 4.00 x 6; 4.00 x 8; 4.00 x 12; 4.00 x 15; 4.00 x 20; 4.00 x 25; 4.00 x 30; 4.50 x 12; 4.50 x 15; 5.00 x 12; 5.00 x 15.

2. Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6; 1.20 x 8; 1.20 x 12; 1.20 x 15; 1.20 x 20; 1.50 x 6; 1.50 x 8; 1.50 x 12; 1.50 x 15; 1.50 x 20; 2.00 x 6; 2.00 x 8; 2.00 x 12; 2.00 x 15; 2.00 x 20; 2.00 x 25; 2.00 x 30.

3. Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 6; 2.25 x 8; 2.25 x 12; 2.25 x 15; 2.25 x 20; 2.25 x 25; 2.25 x 30; 2.50 x 6; 2.50 x 8; 2.50 x 12; 2.50 x 15; 2.50 x 20; 2.50 x 25; 2.50 x 30; 2.75 x 6; 2.75 x 8; 2.75 x 12; 2.75 x 15; 2.75 x 20; 2.75 x 25; 2.75 x 30; 3.00 x 6; 3.00 x 8; 3.00 x 12; 3.00 x 15; 3.00 x 20; 3.00 x 25; 3.00 x 30; 3.25 x 6; 3.25 x 8; 3.25 x 12; 3.25 x 15; 3.25 x 20; 3.25 x 25; 3.25 x 30; 3.50 x 6; 3.50 x 8; 3.50 x 12; 3.50 x 15; 3.50 x 20; 3.50 x 25; 3.50 x 30; 3.75 x 6; 3.75 x 8; 3.75 x 12; 3.75 x 15; 3.75 x 20; 3.75 x 25; 3.75 x 30; 4.00 x 6; 4.00 x 8; 4.00 x 12; 4.00 x 15; 4.00 x 20; 4.00 x 25; 4.00 x 30; 4.50 x 12; 4.50 x 15; 5.00 x 12; 5.00 x 15.



Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81

abbott-russia@abbott.com

15; 2.00 x 20.

5.00 x 15, 5.00 x 20.

нижеуказанными размерами баллонов с распространением на весь размерный ряд:

диаметр баллона х длина баллона (мм) – 2.25 х 12;

RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6;

диаметр баллона х длина баллона (мм) – 3.50 х 15;

ОТШ: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.20 х 6;

диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.50 х 20.

действующий на основании доверенности

« 05 » декабря 2019 г.

M-II.



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Общий вид потребительской упаковки (картонная коробка).

[illegible]

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Общий вид потребительской упаковки (картонная коробка).




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Комплект поставки.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Общий вид индивидуальной упаковки (пакет).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Изделие в спиральной оплетке.

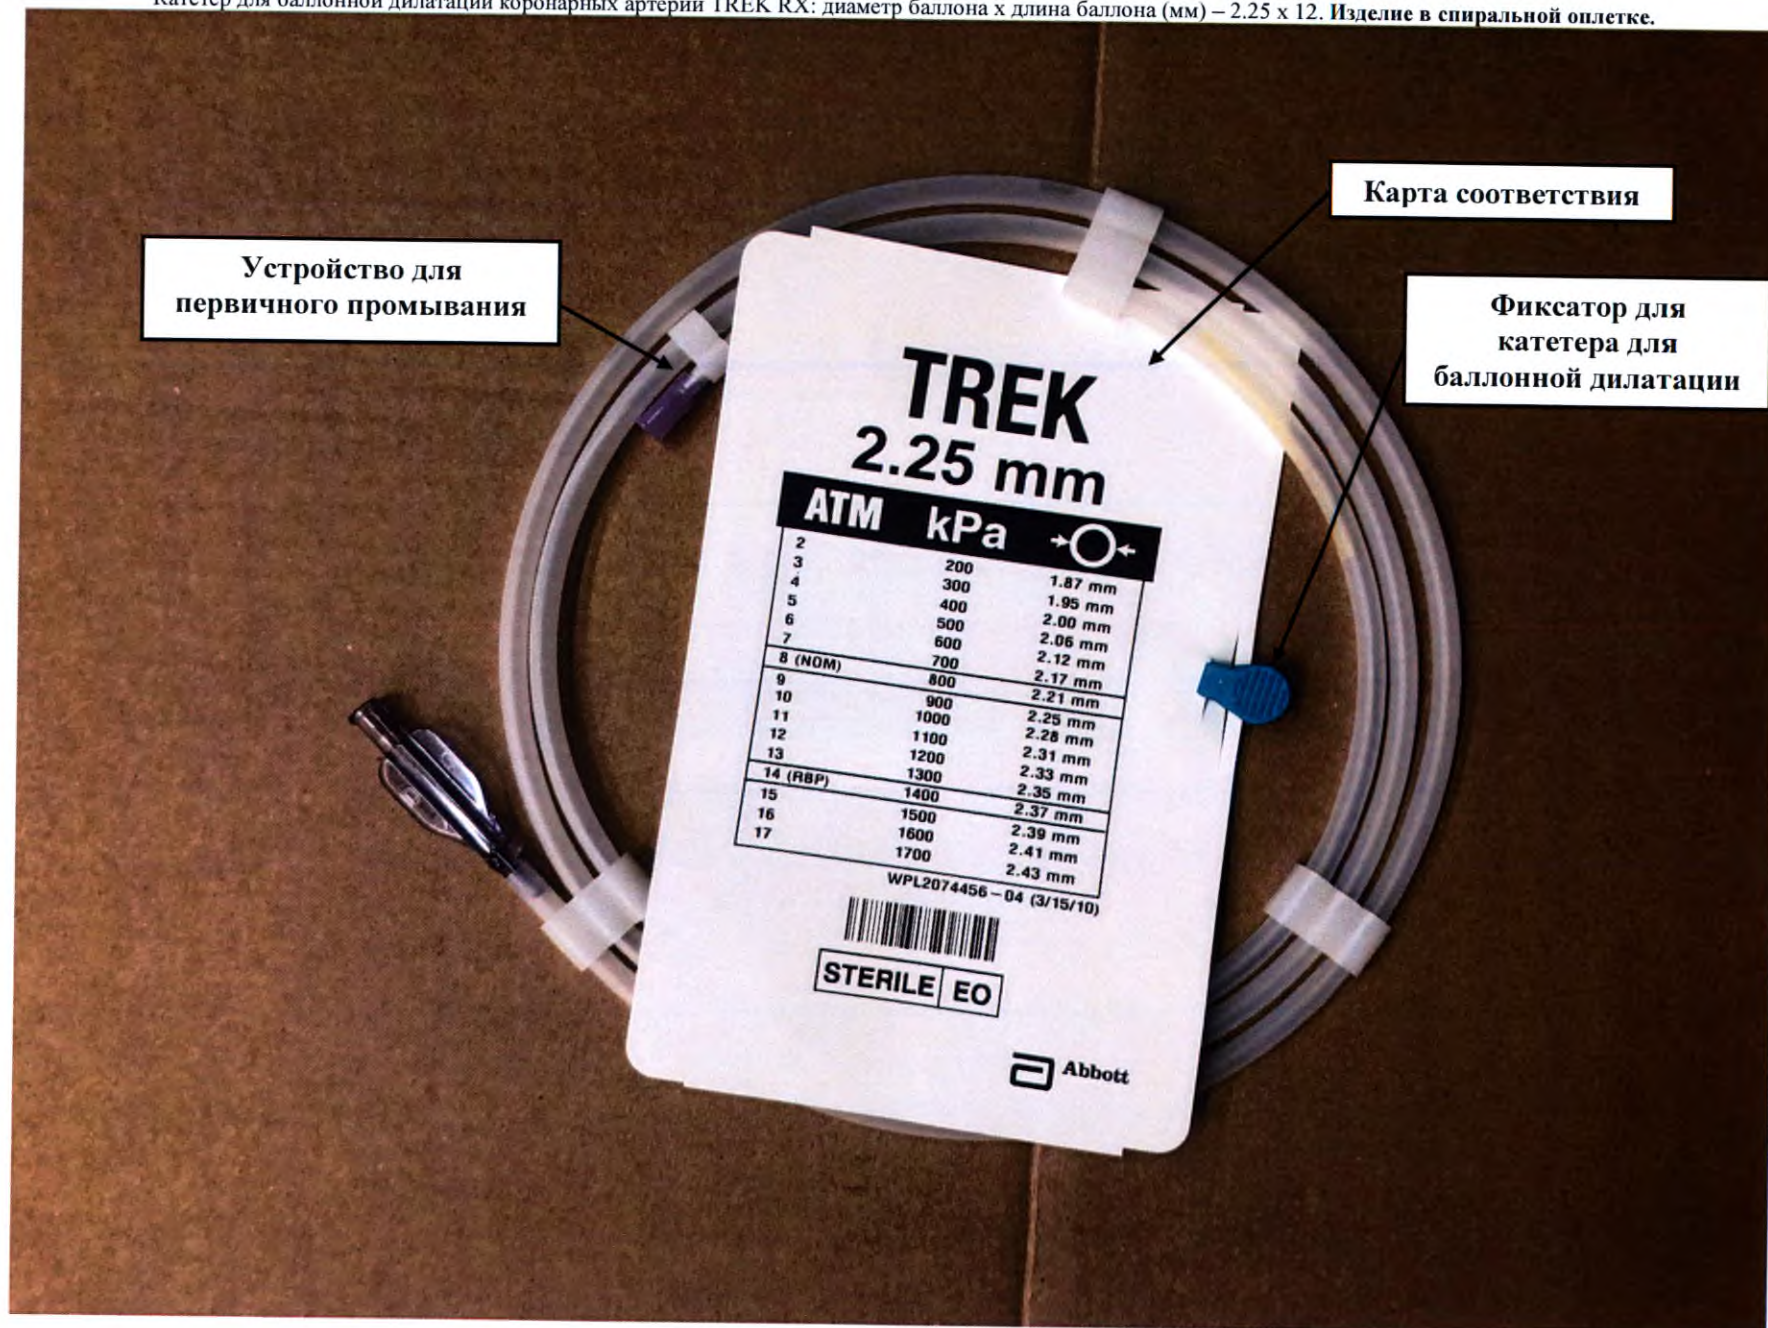

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Изделие в спиральной оплетке.

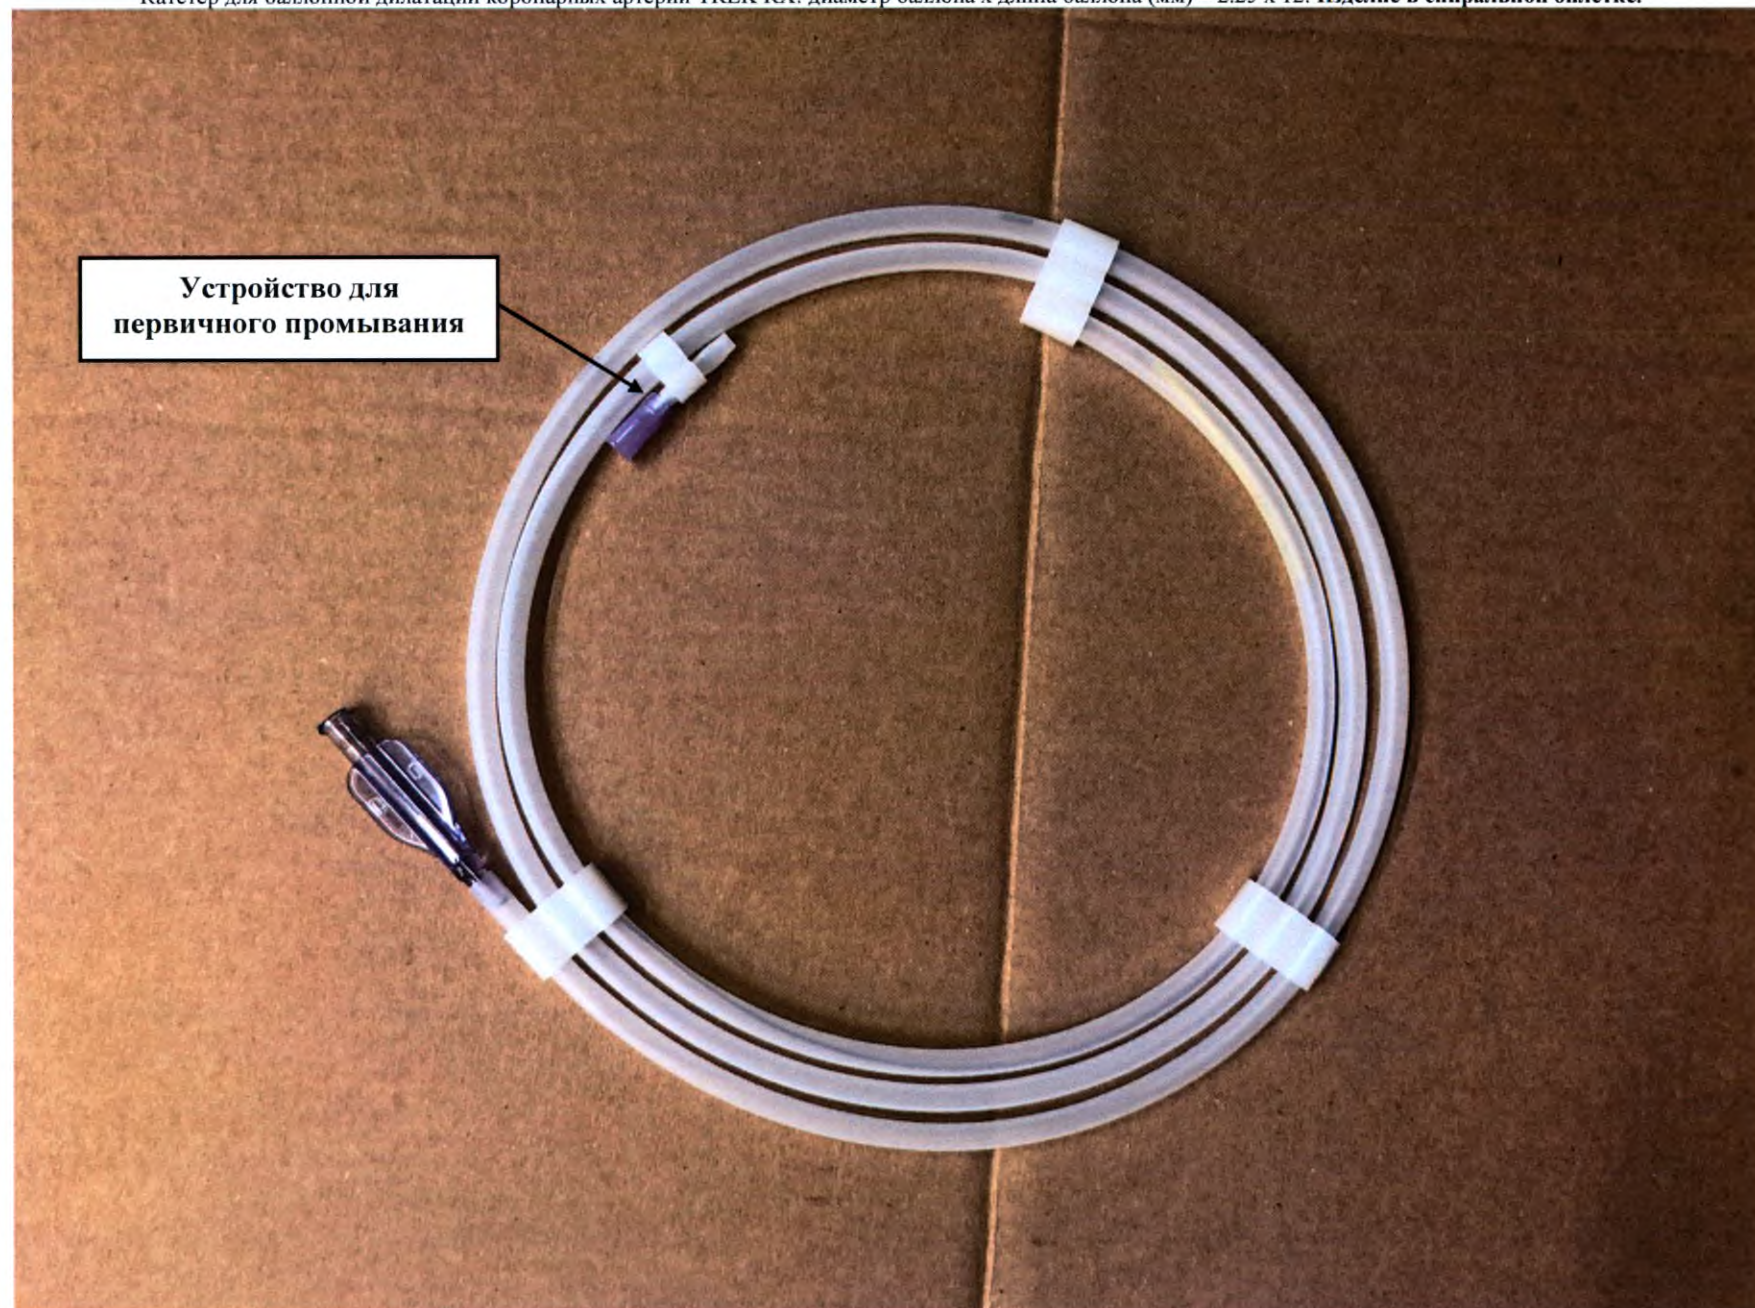

Устройство для
первичного промывания

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Фиксатор для катетера для баллонной дилатации.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Фиксатор для катетера для баллонной дилатации.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Устройство для первичного промывания.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Устройство для первичного промывания.

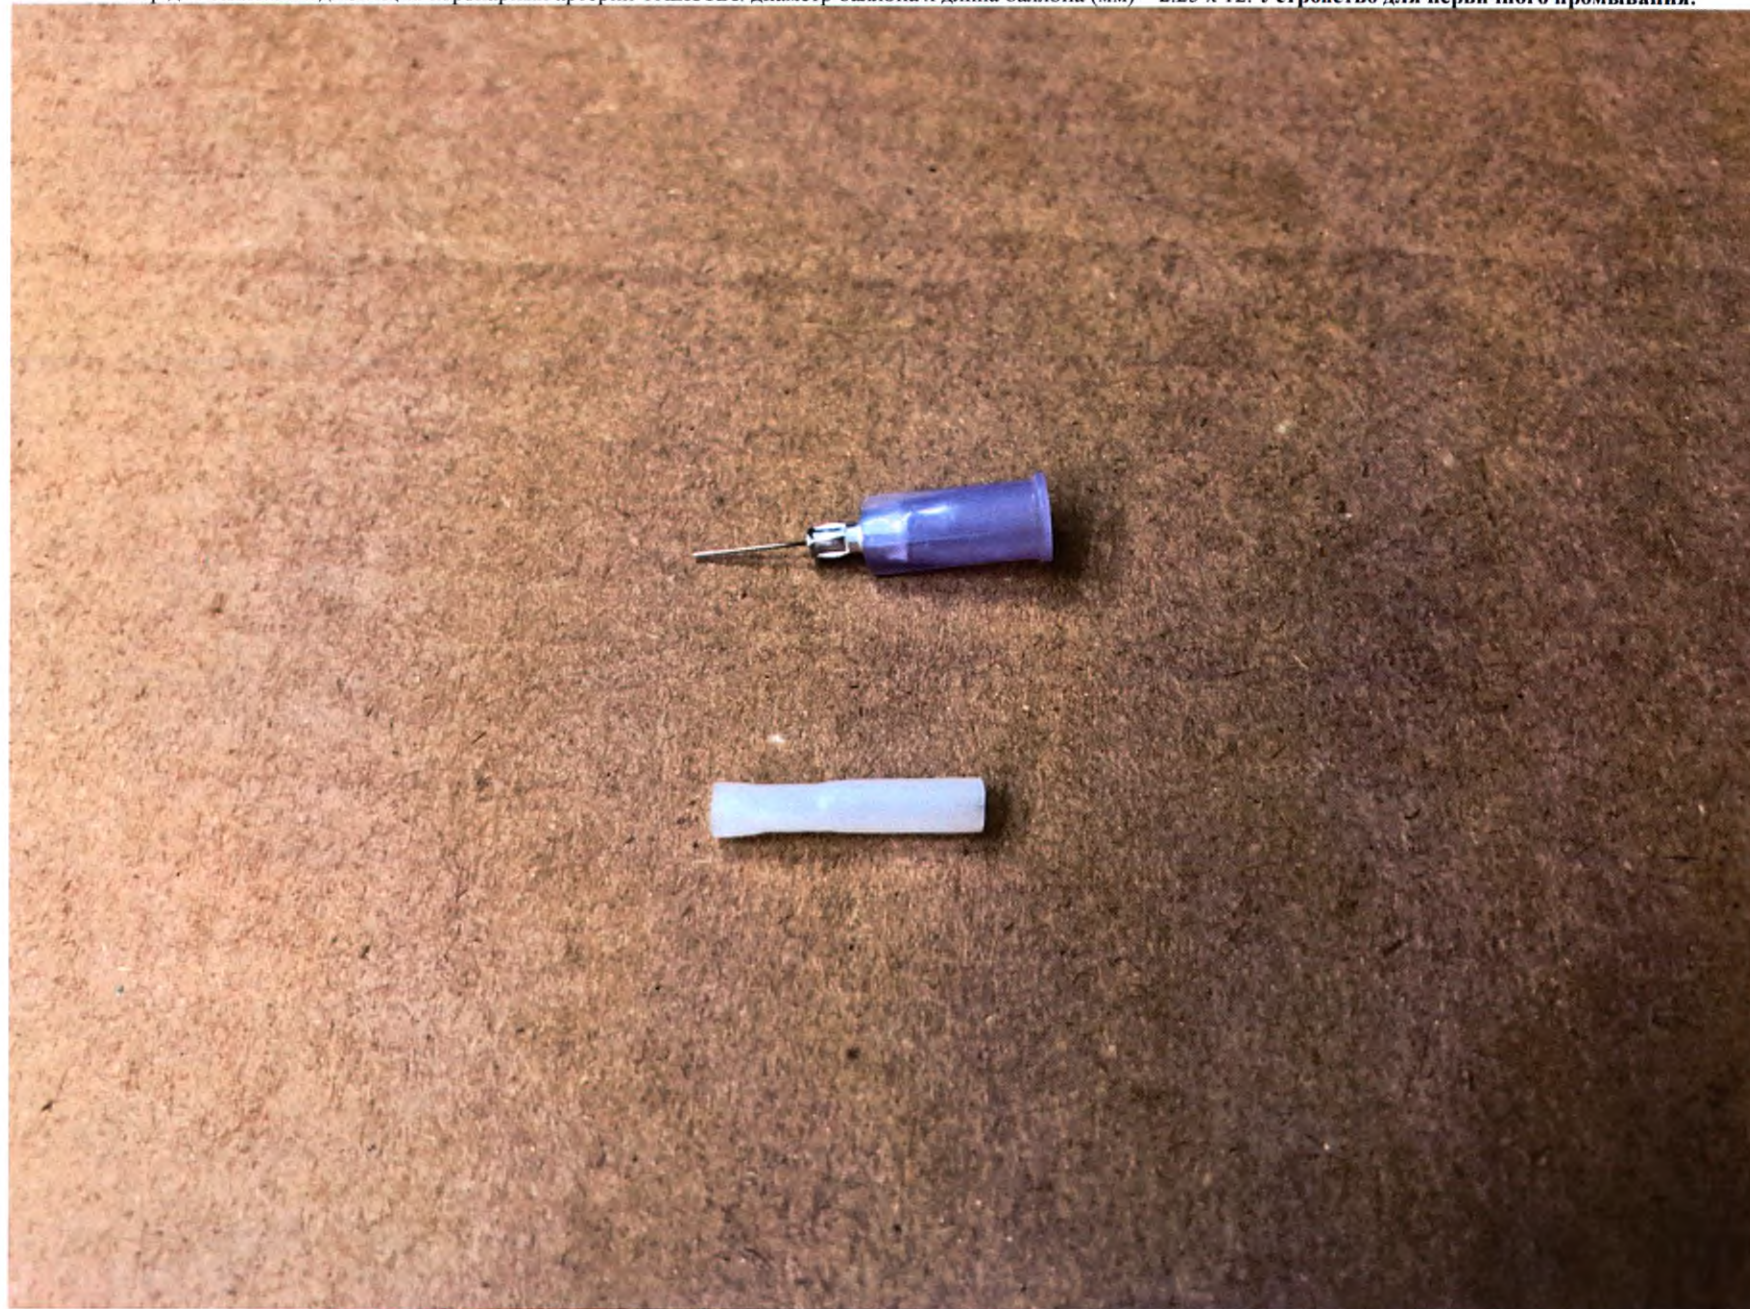

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Изделие.

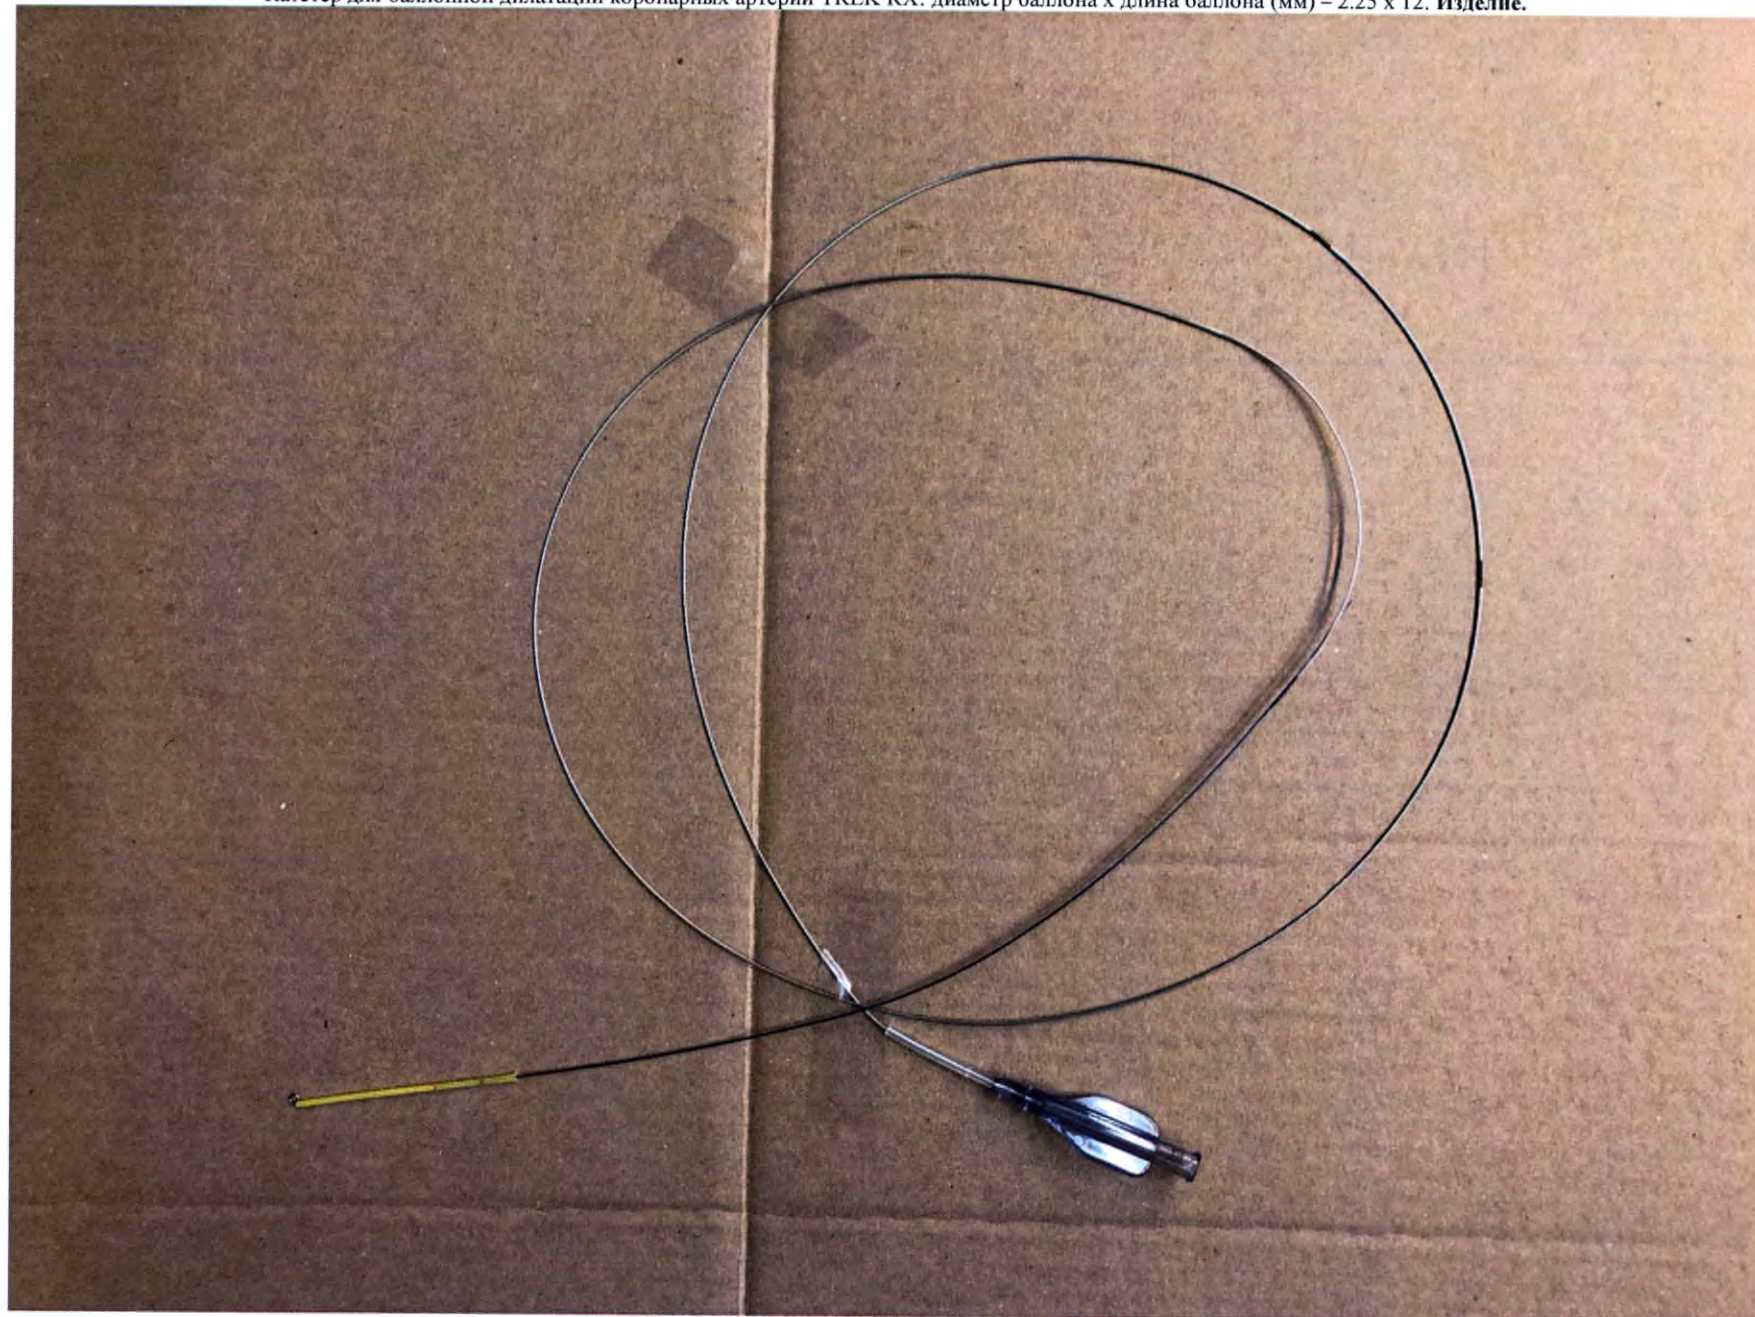

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Изделе.

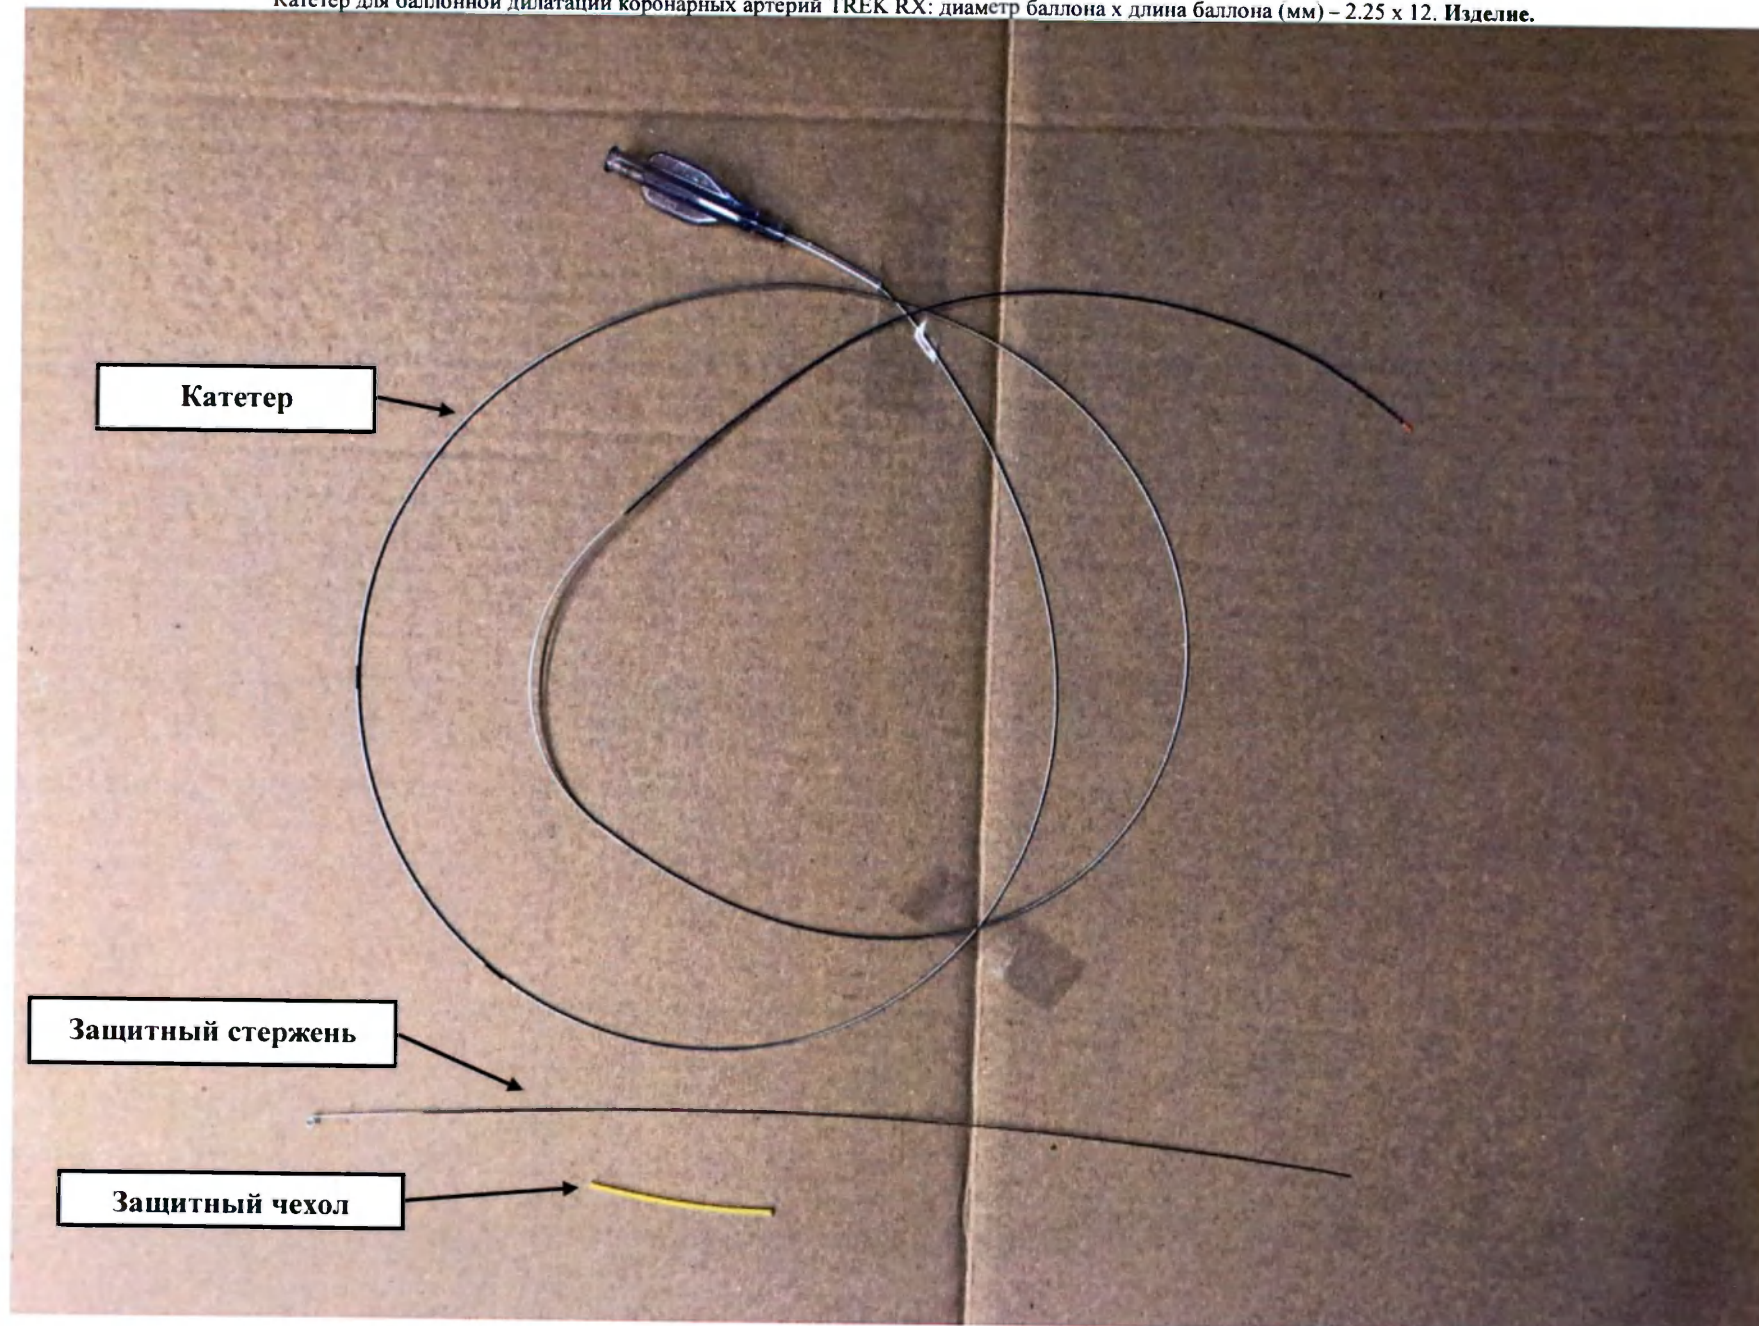

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 2.25 x 12. Изделие (баллон катетера).




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK RX: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 2.25 х 12. Изделие (накопечник катетера).




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Общий вид потребительской упаковки (картонная коробка).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Общий вид потребительской упаковки (картонная коробка).

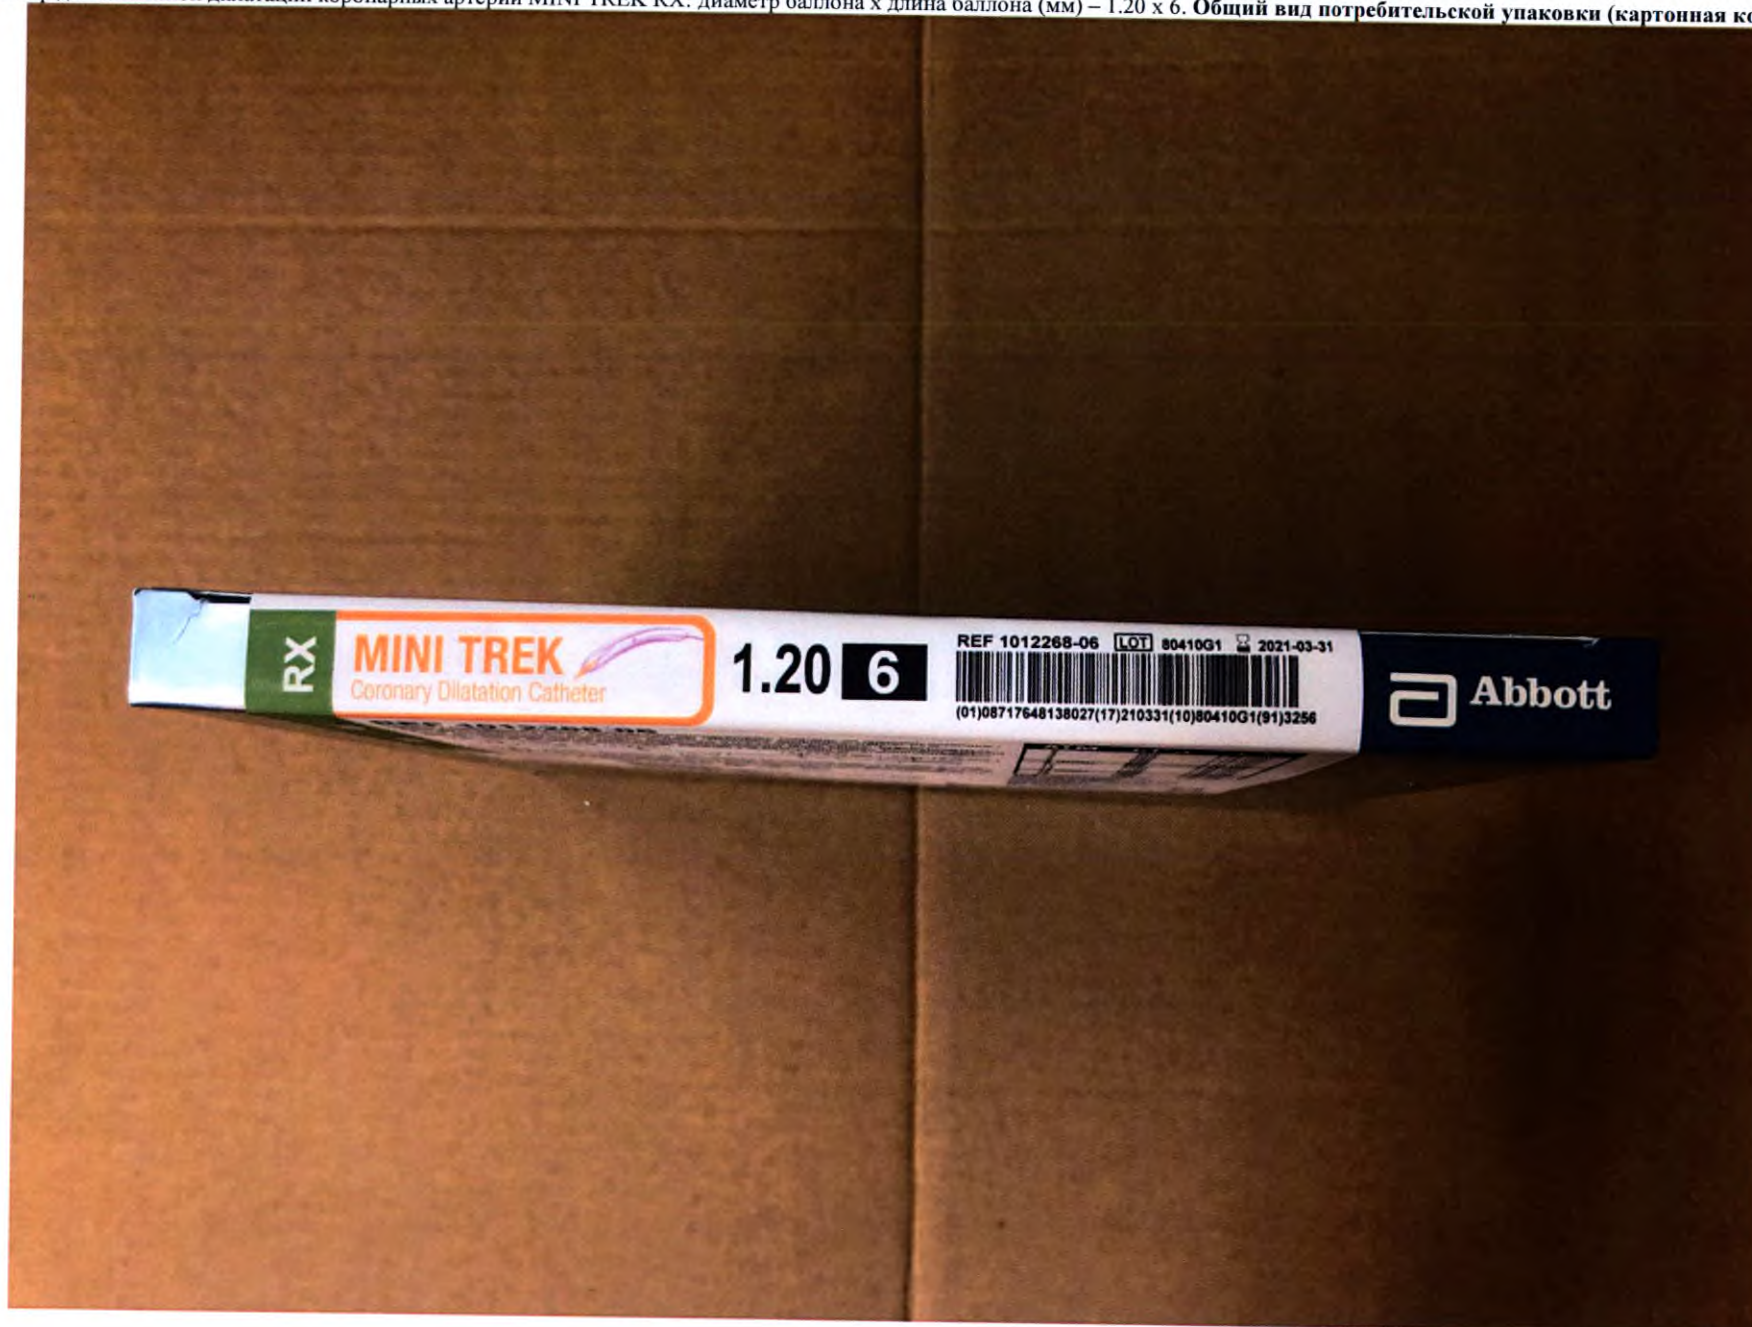


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Комплект поставки.

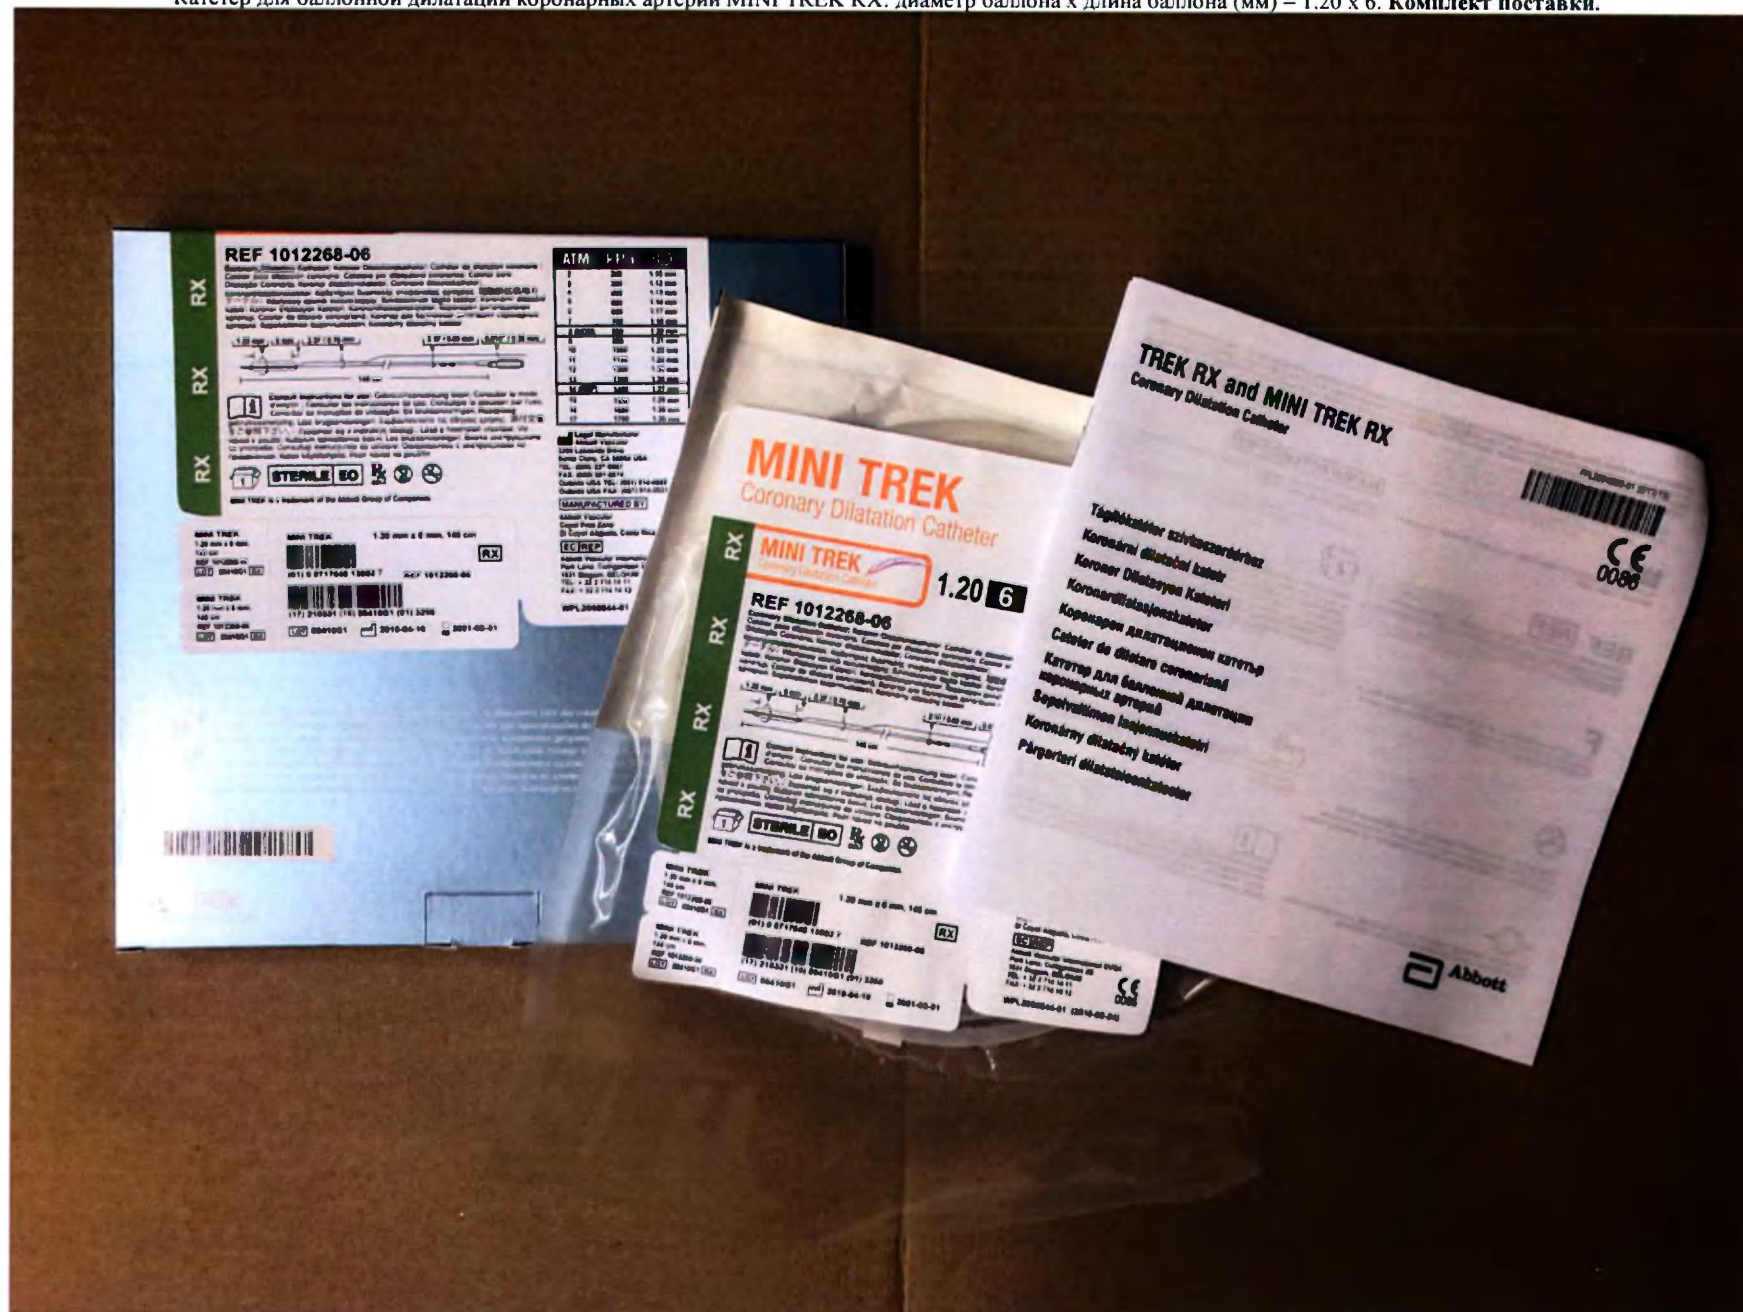


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Общий вид индивидуальной упаковки (пакет).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Изделие в спиральной оплетке.

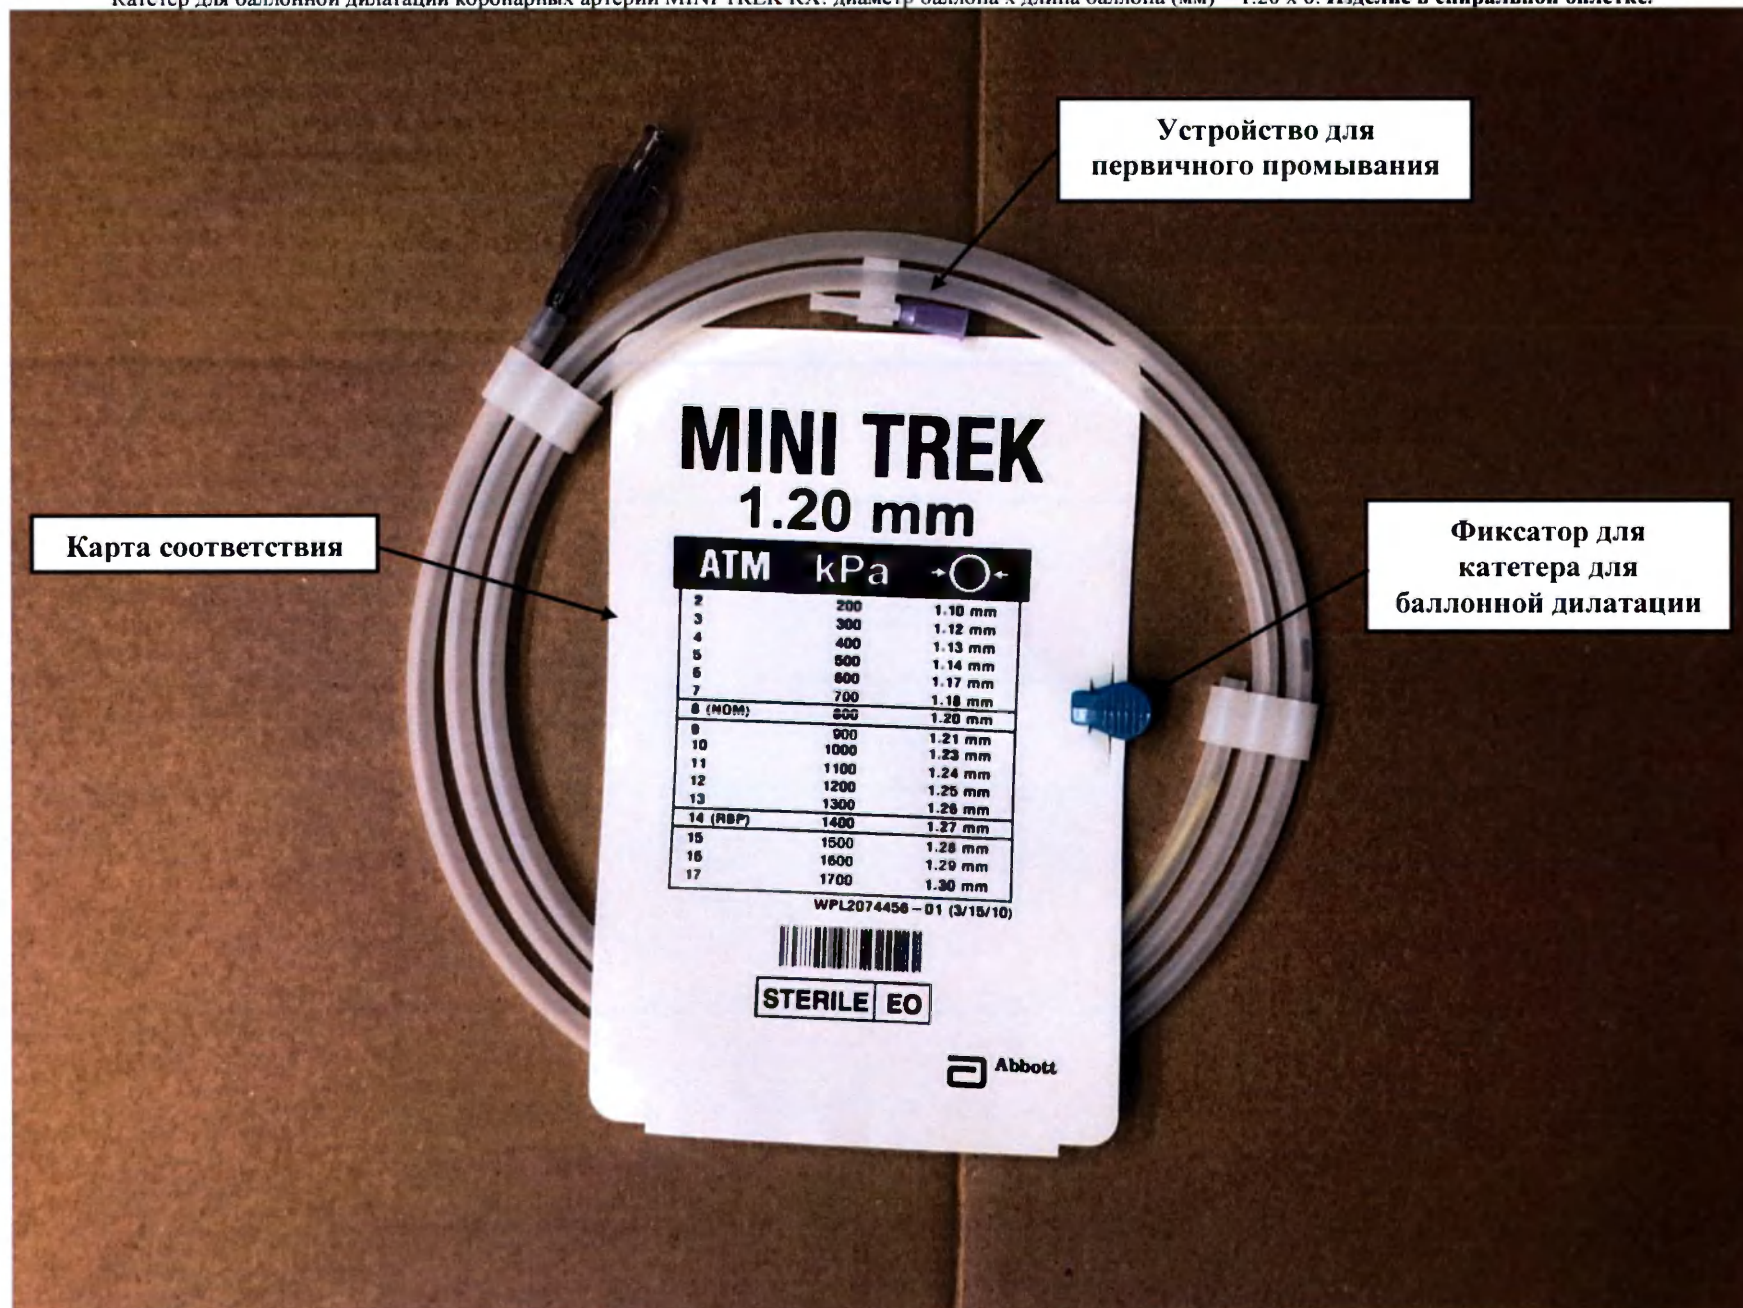

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.20 х 6. Изделие в спиральной оплетке.

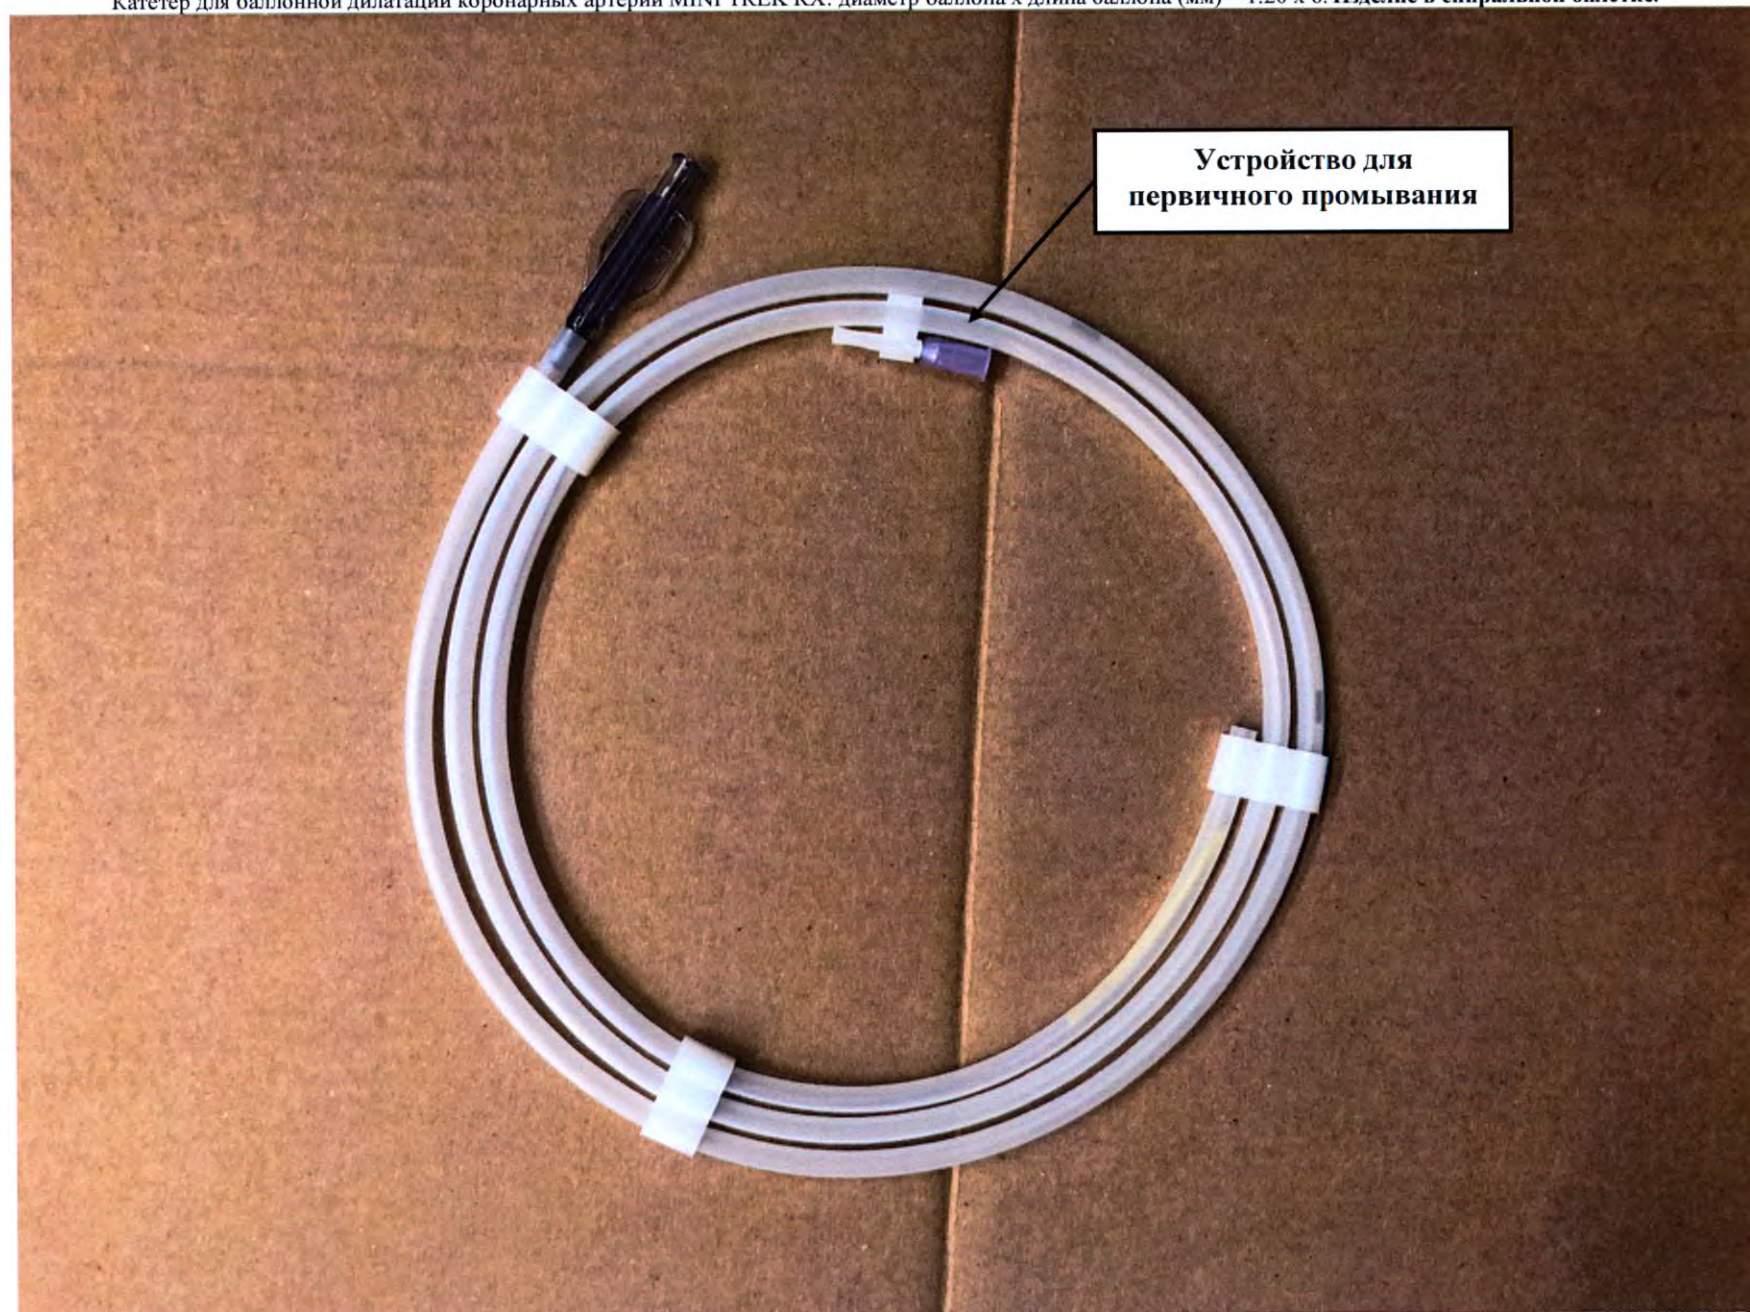

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Фиксатор для катетера для баллонной дилатации.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Фиксатор для катетера для баллонной дилатации.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.20 х 6. Устройство для первичного промывания.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Устройство для первичного промывания.

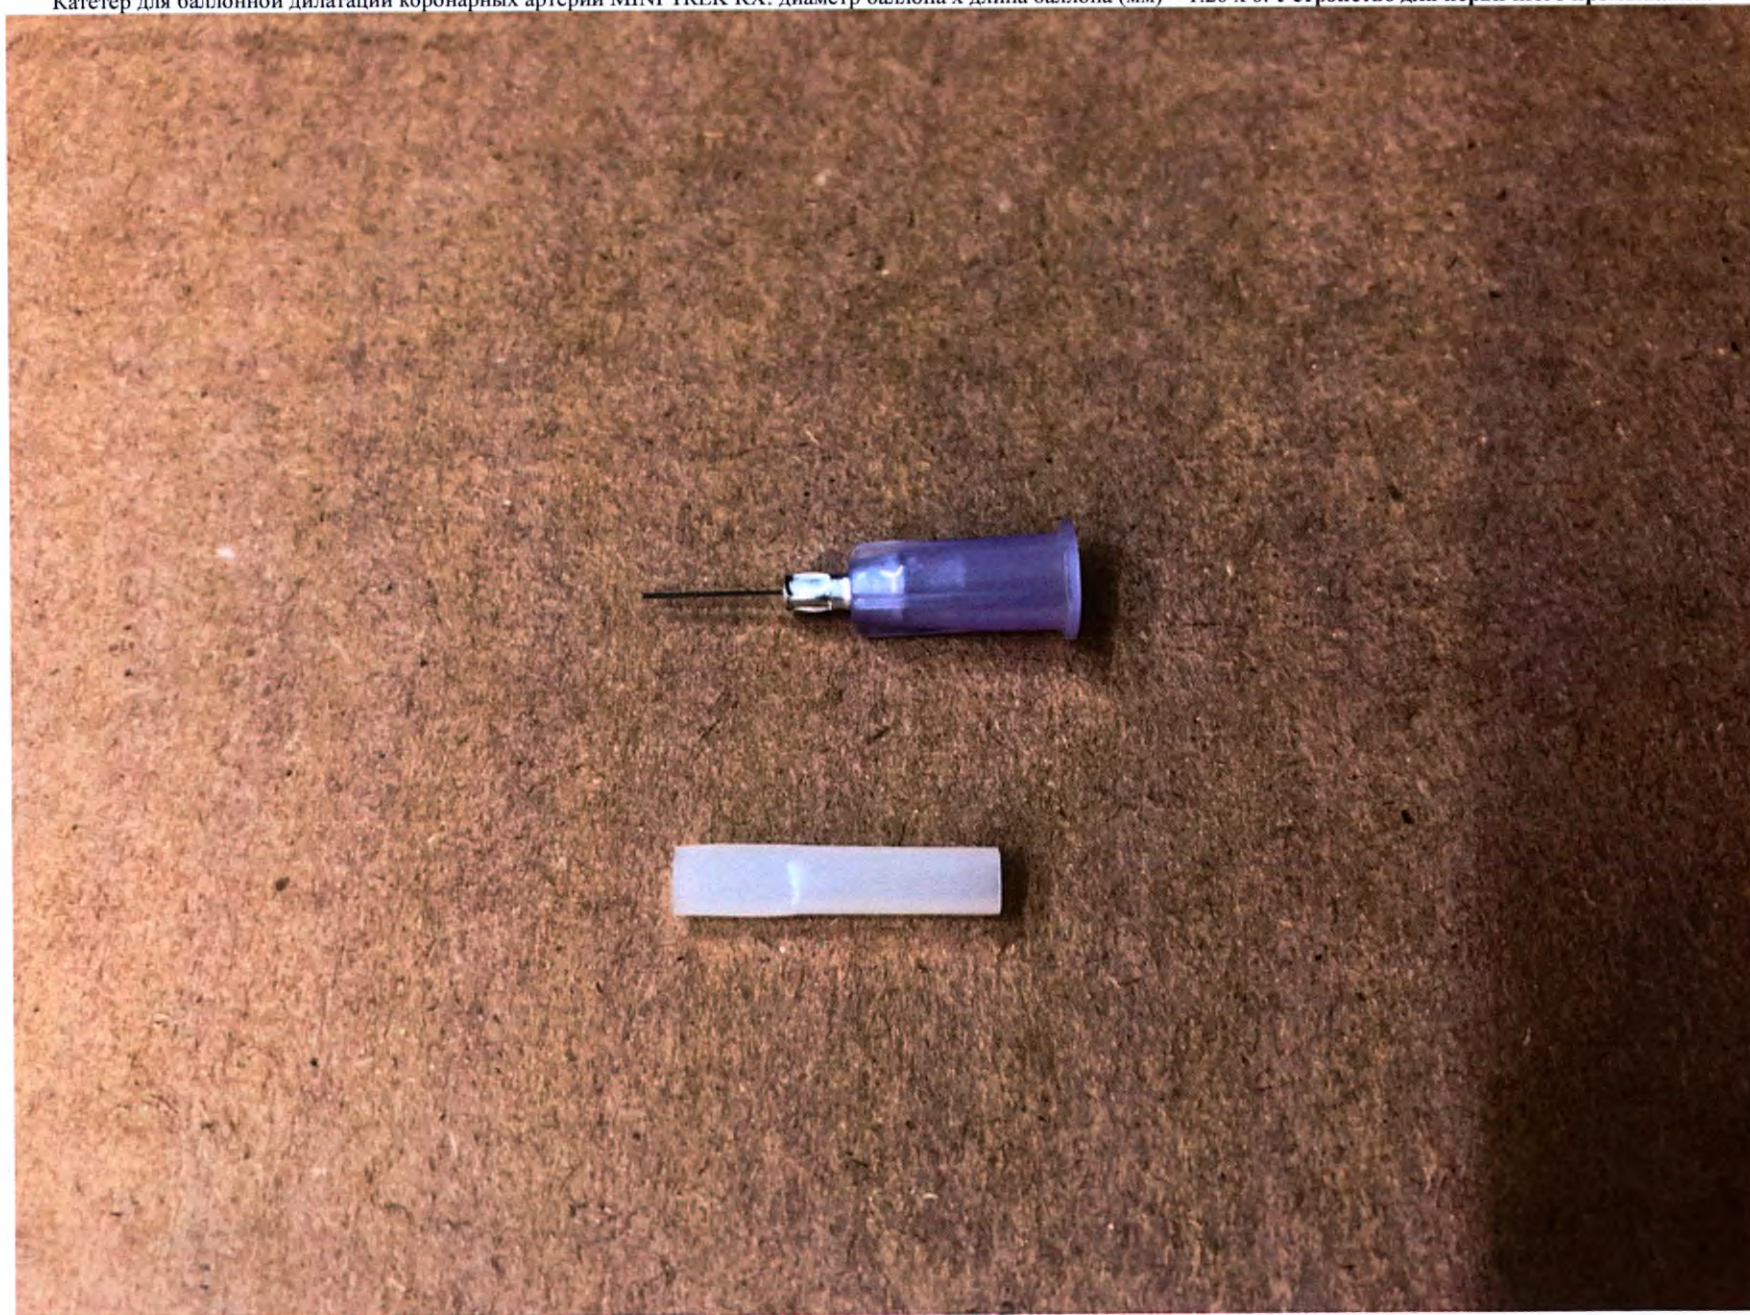


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Изделие.

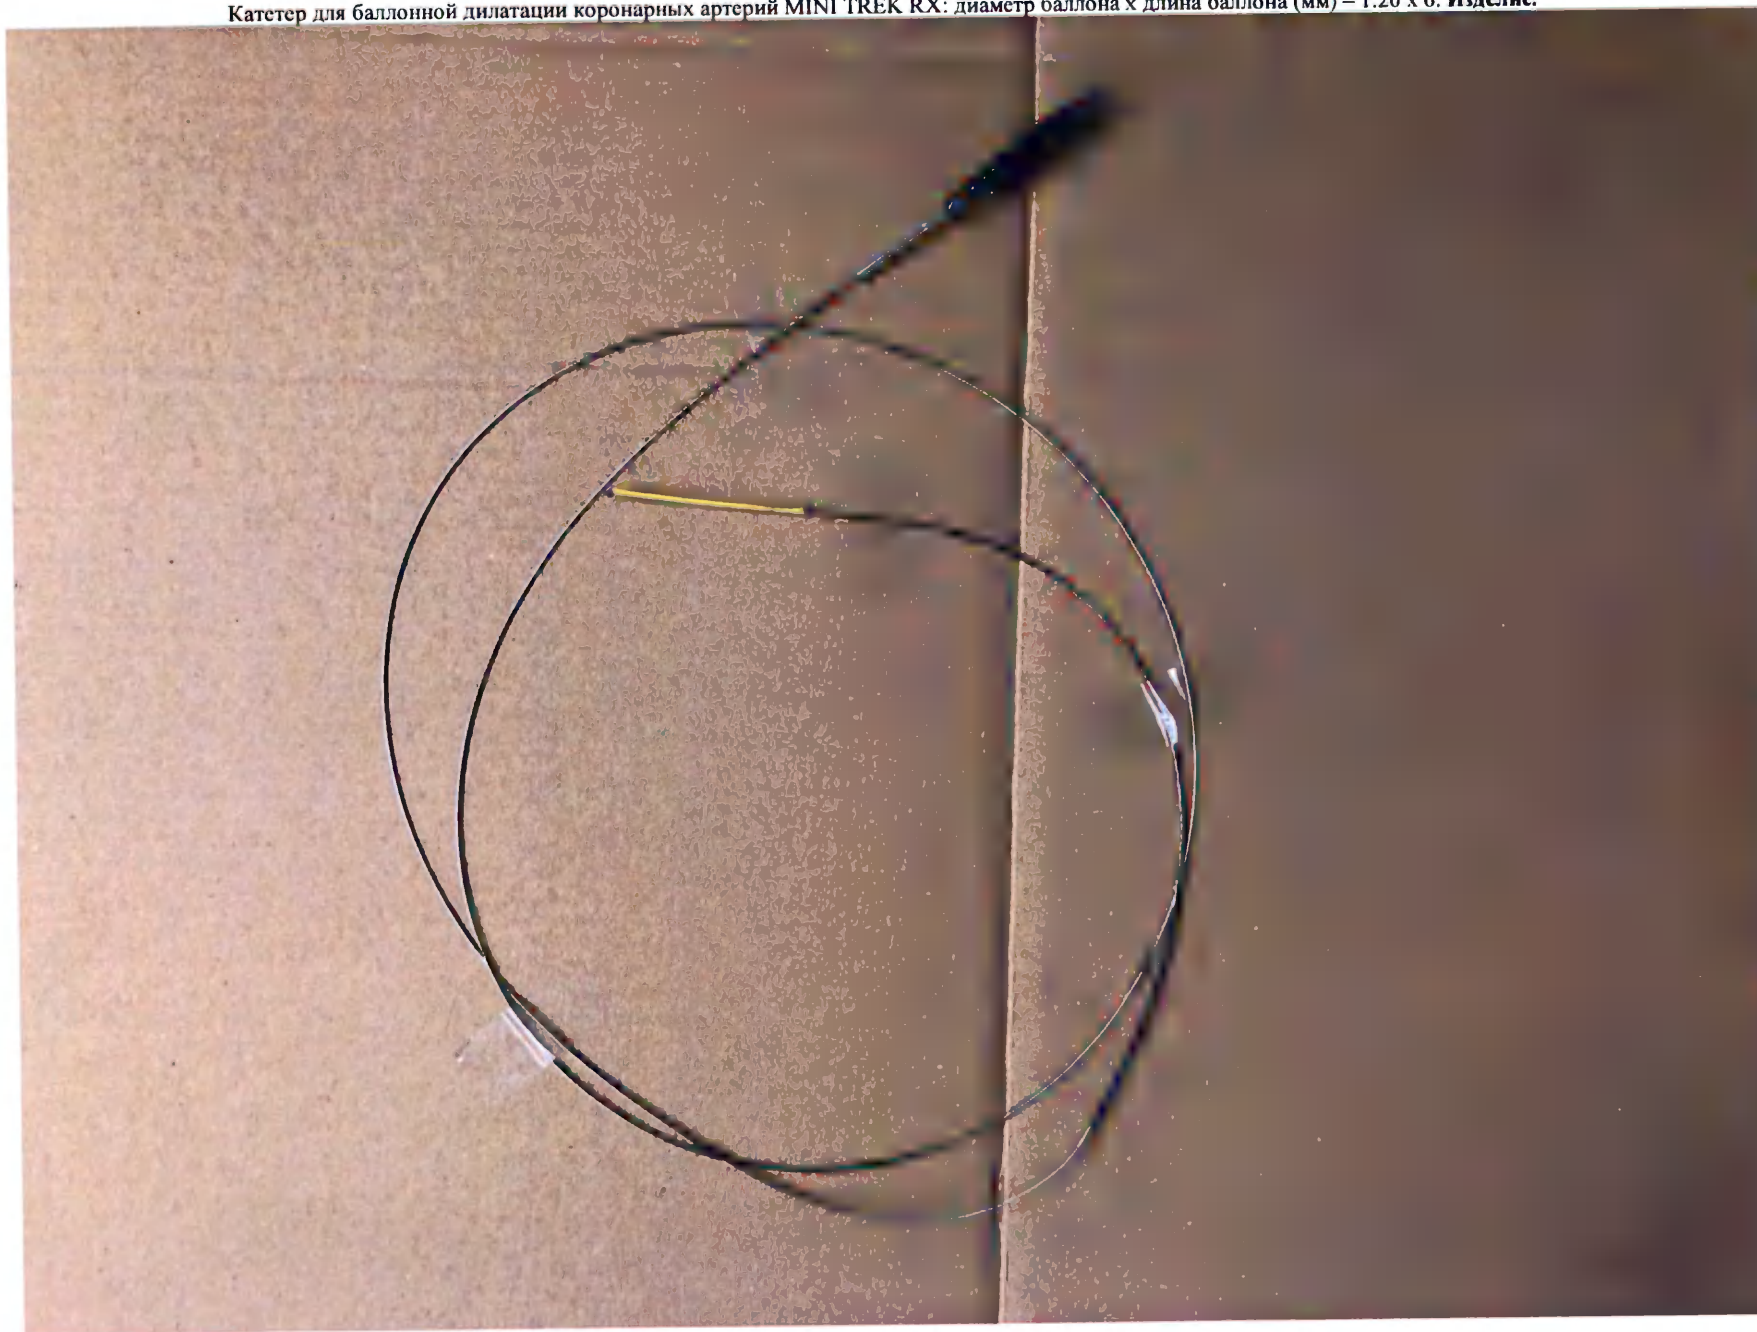

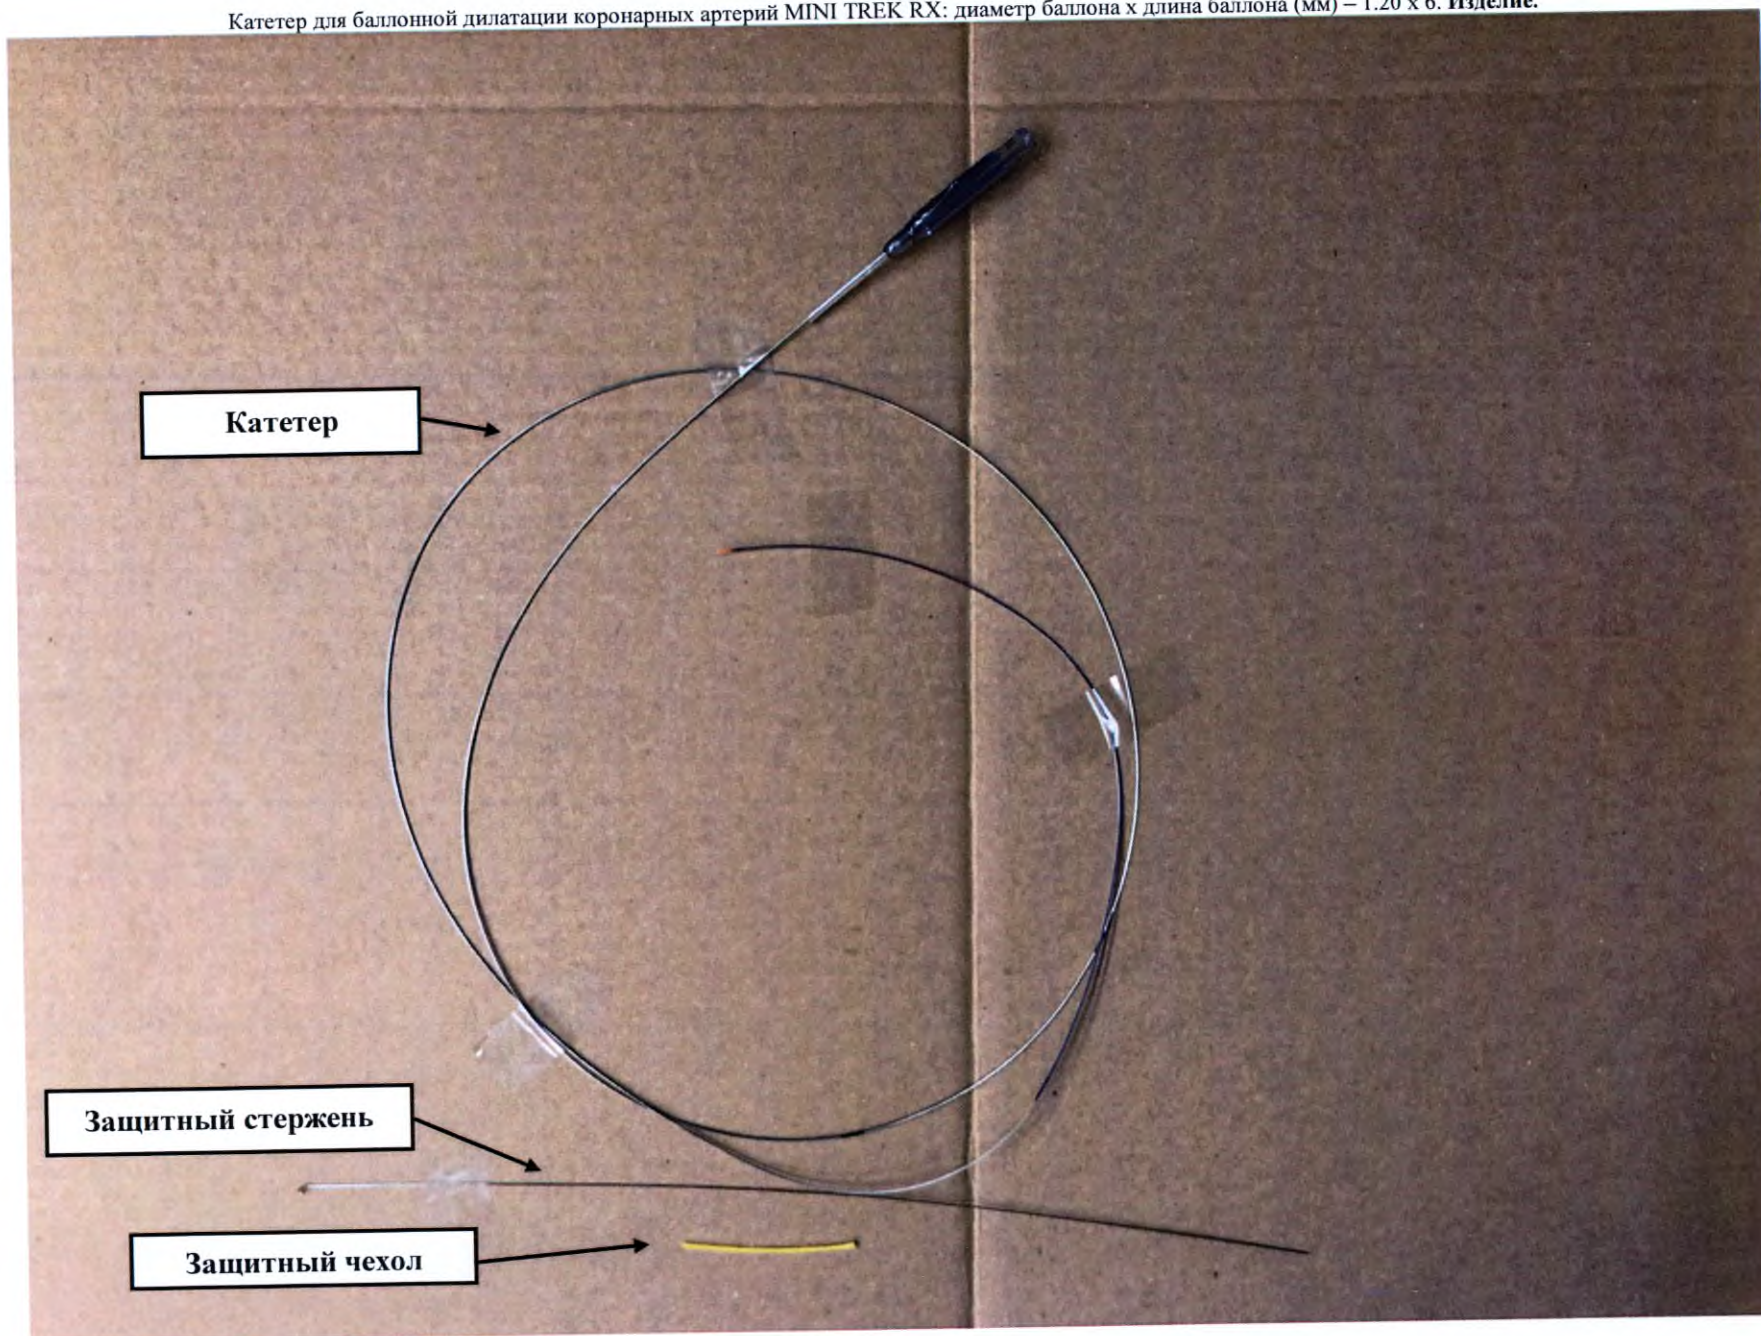

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Изделие (баллон катетера).

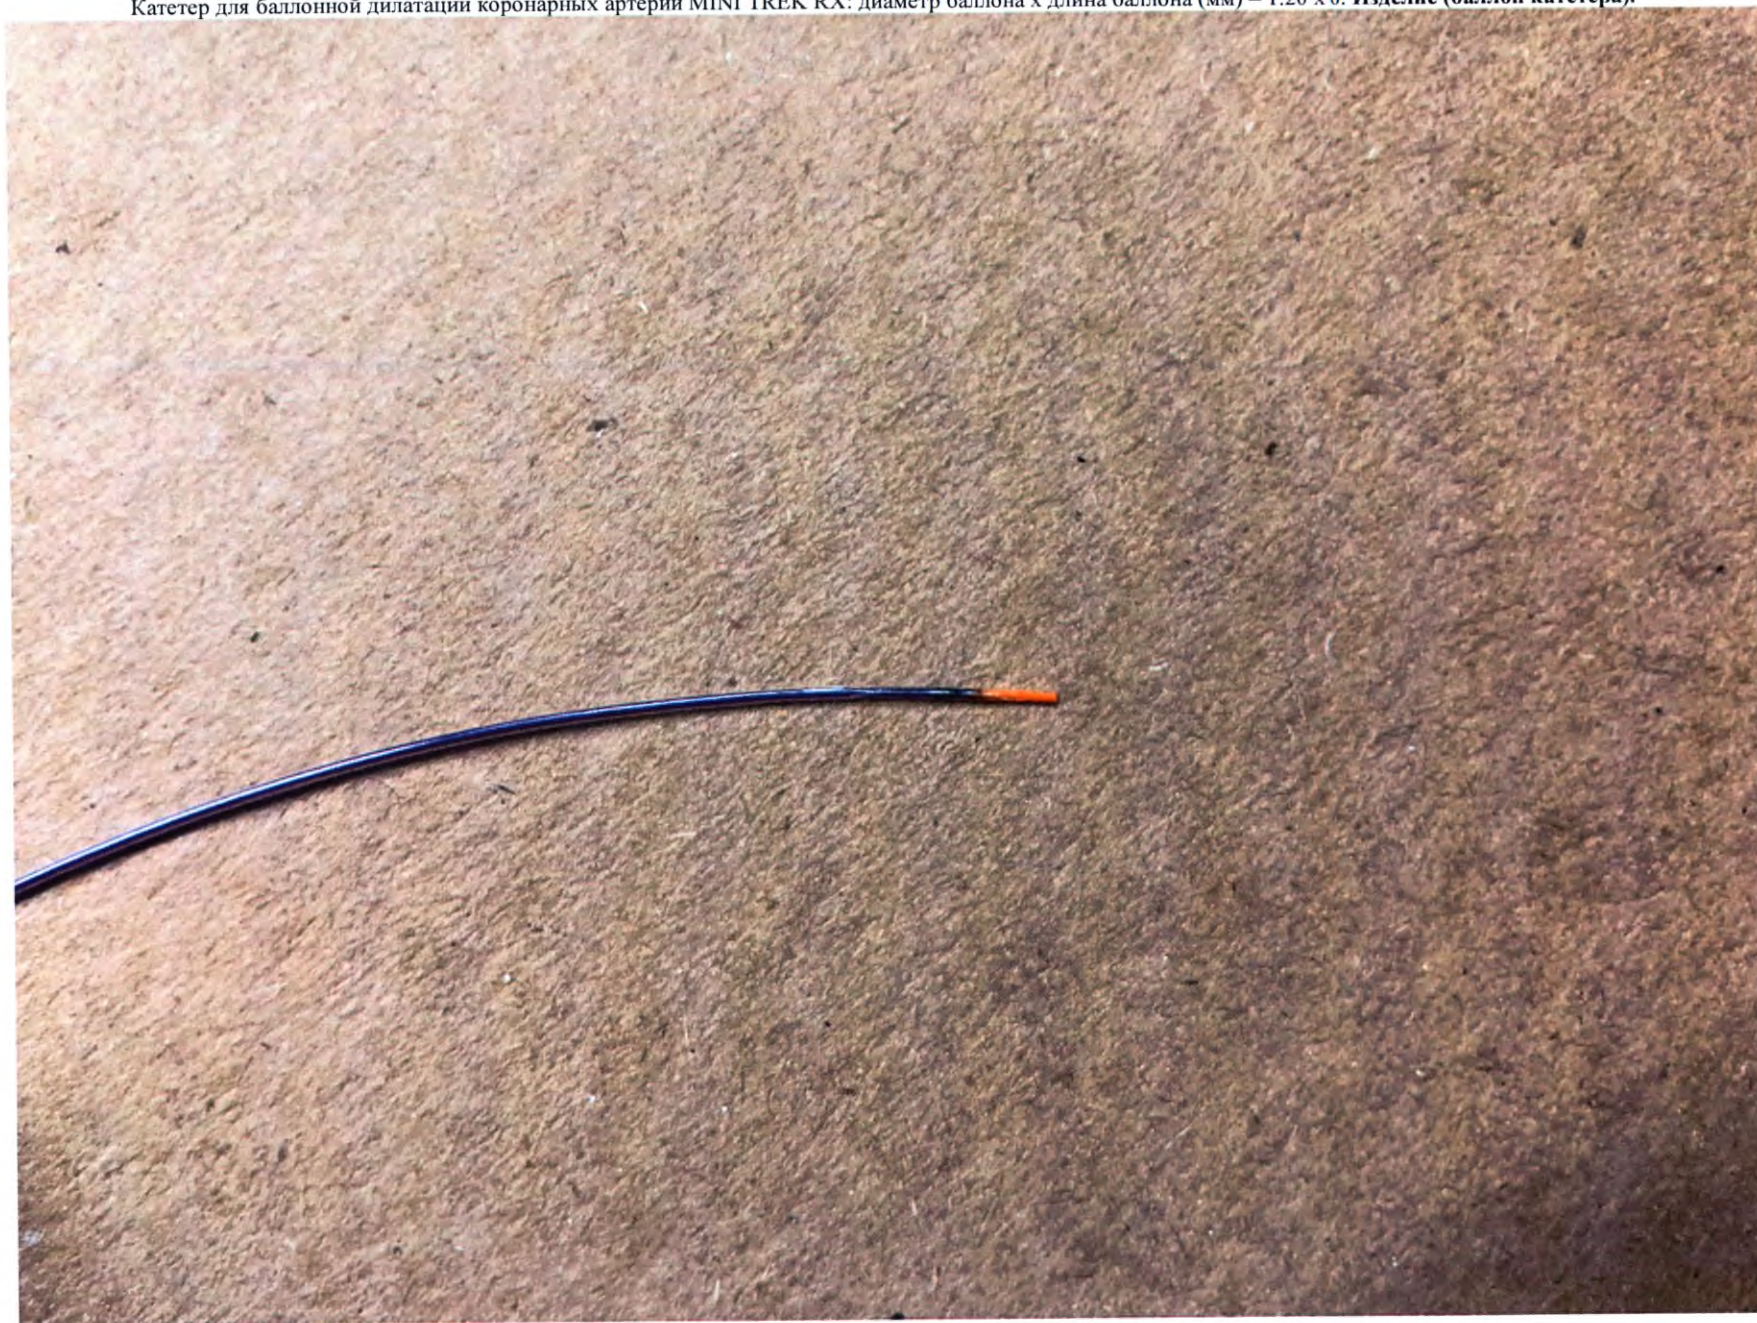


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK RX: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.20 х 6. Изделие (наконечник катетера).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 3.50 x 15. Общий вид потребительской упаковки (картонная коробка).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 3.50 x 15. Общий вид потребительской упаковки (картонная коробка).

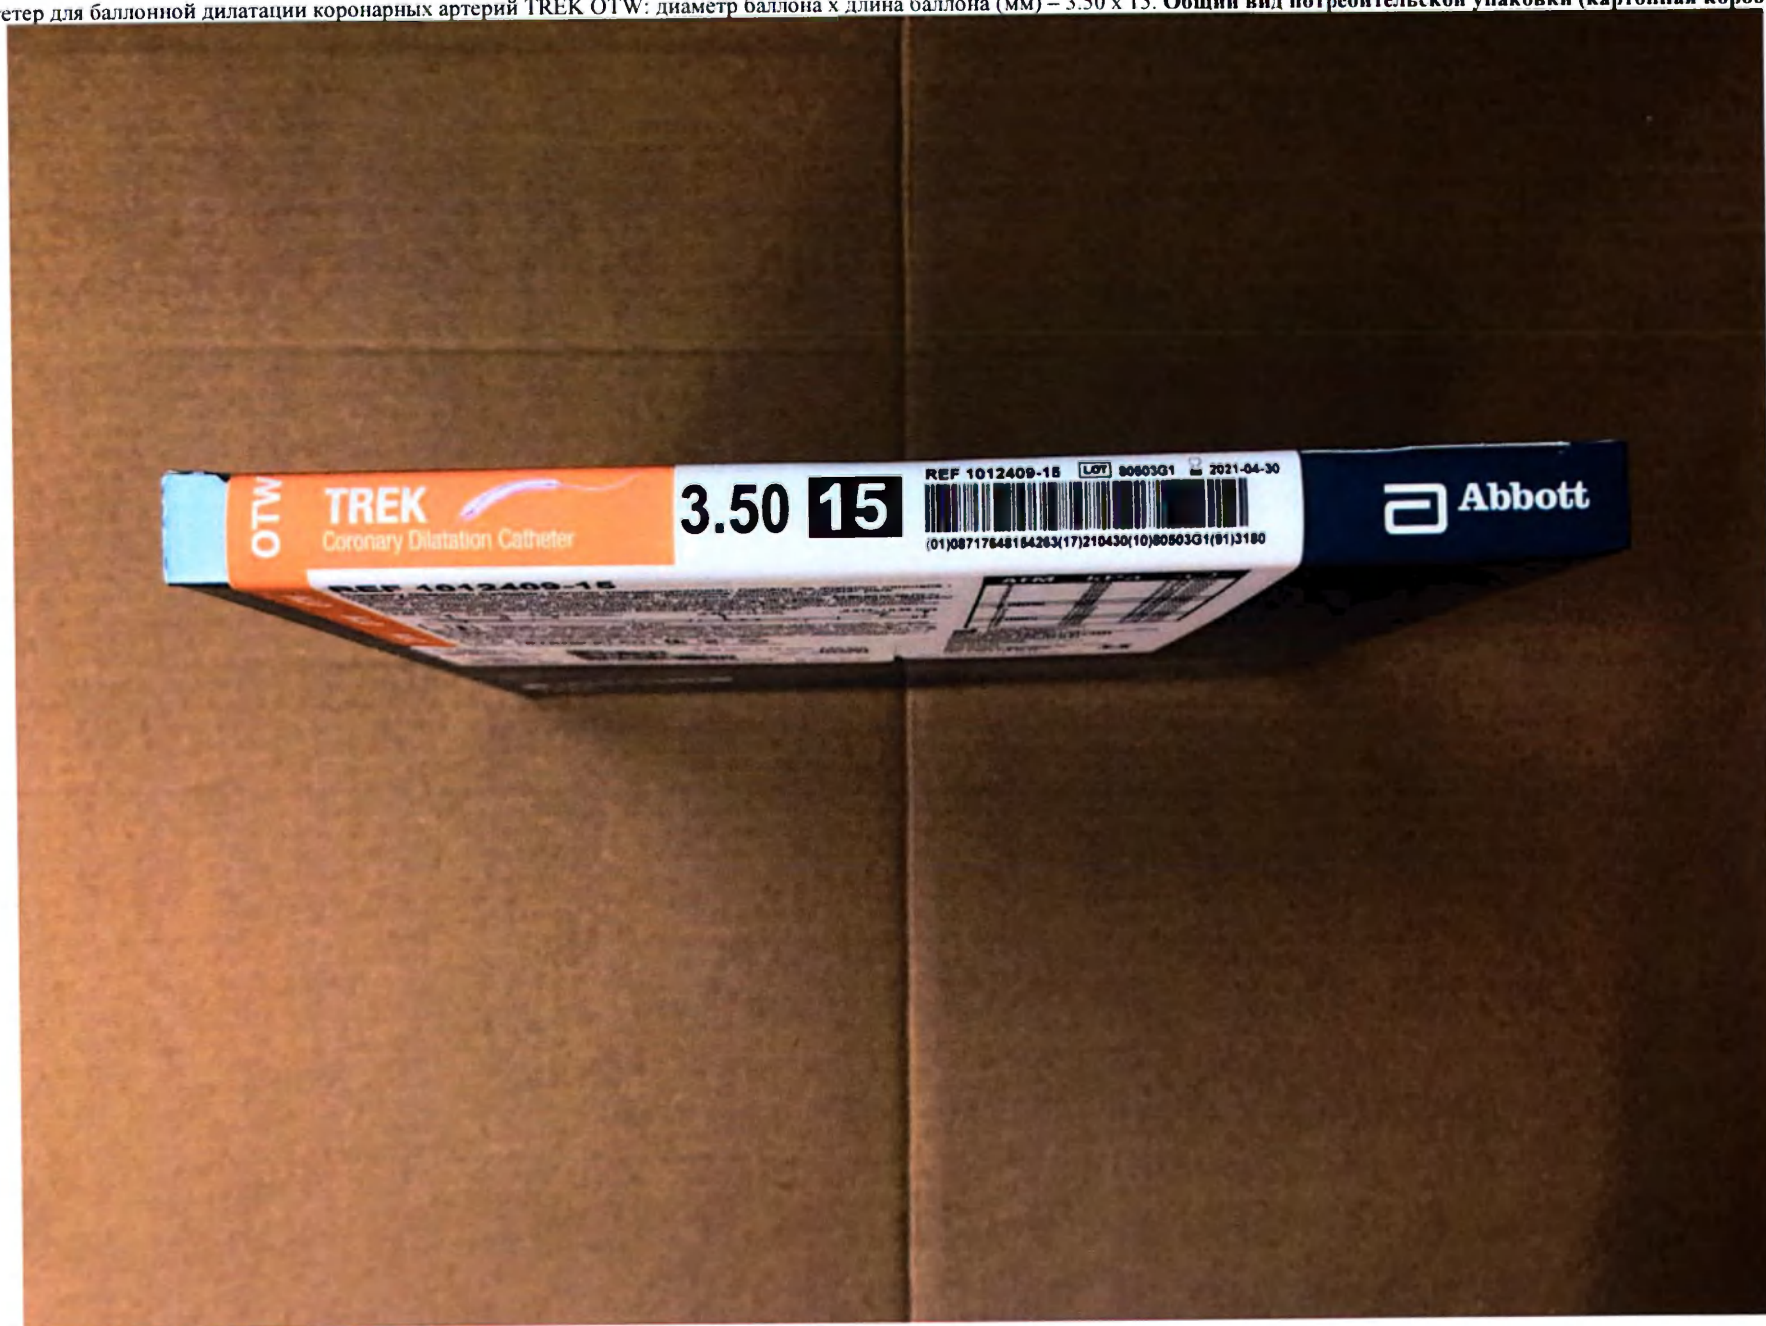


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) — 3.50 x 15. Комплект поставки.



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) — 3.50 x 15. Общий вид индивидуальной упаковки (фото 1).

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 3.50 x 15. Общий вид индивидуальной упаковки (пакет).

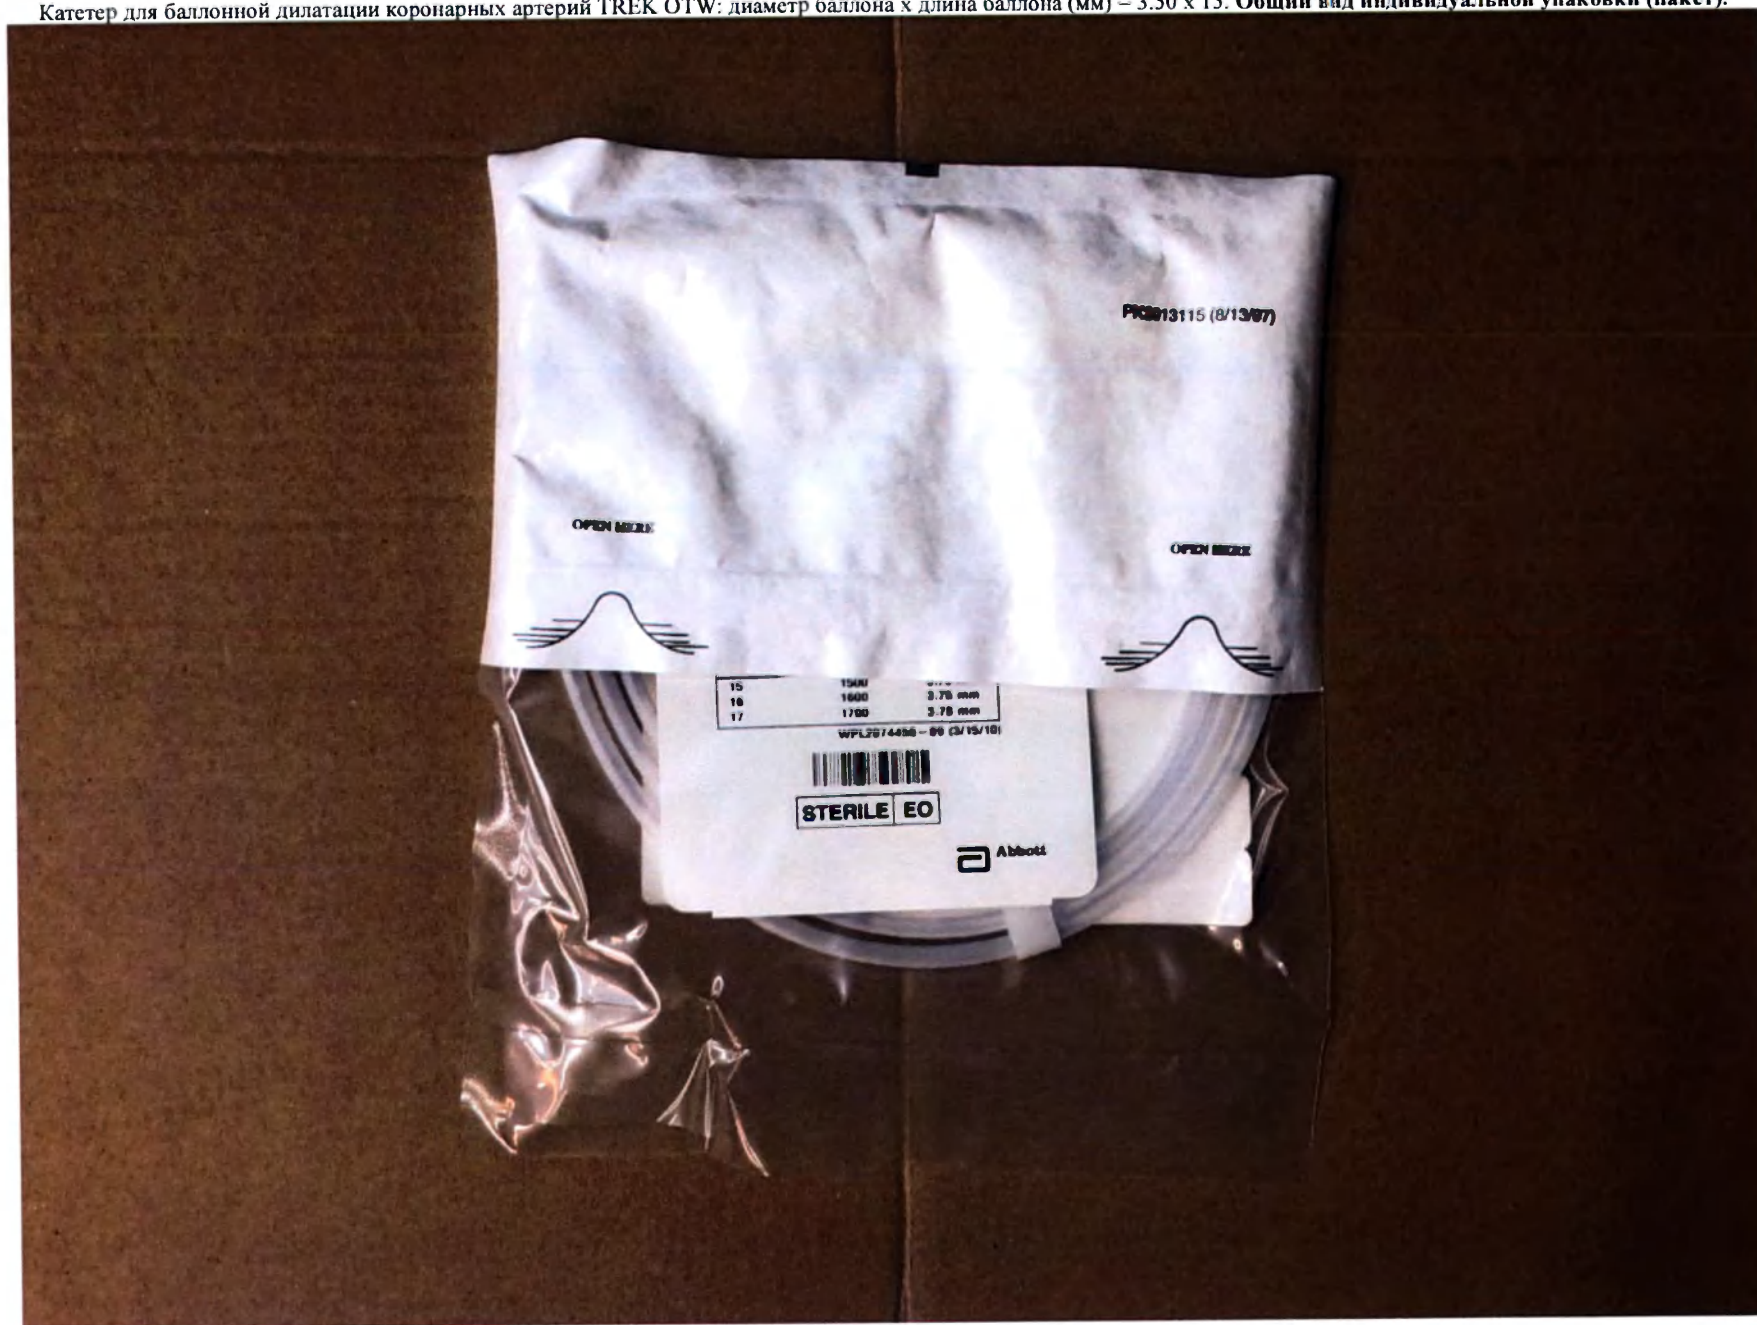


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 3.50 x 15. Изделие в спиральной оплетке.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 3.50 х 15. Изделие в спиральной оплетке.



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 3.50 x 15. Изделие.

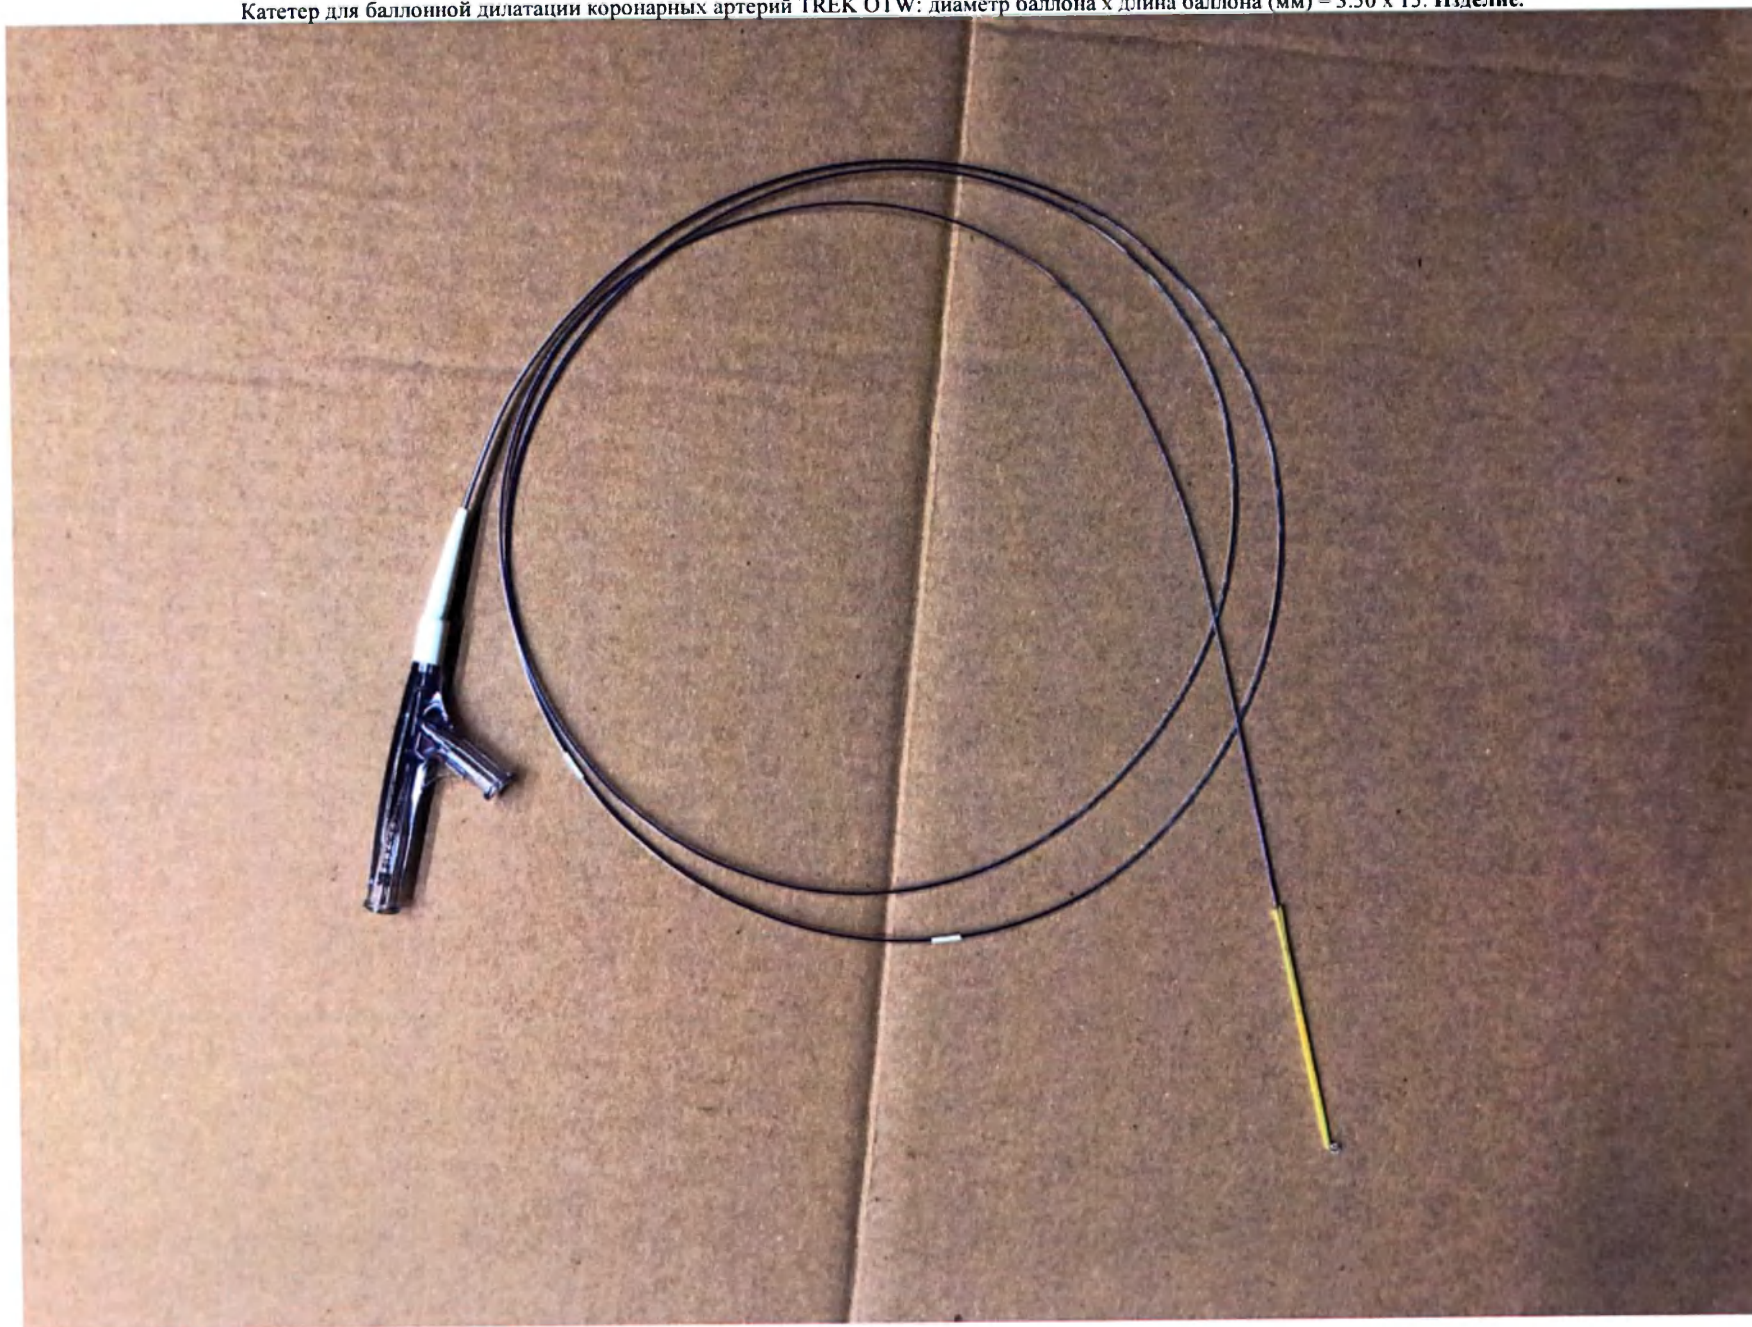

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 3.50 x 15. Изделие.

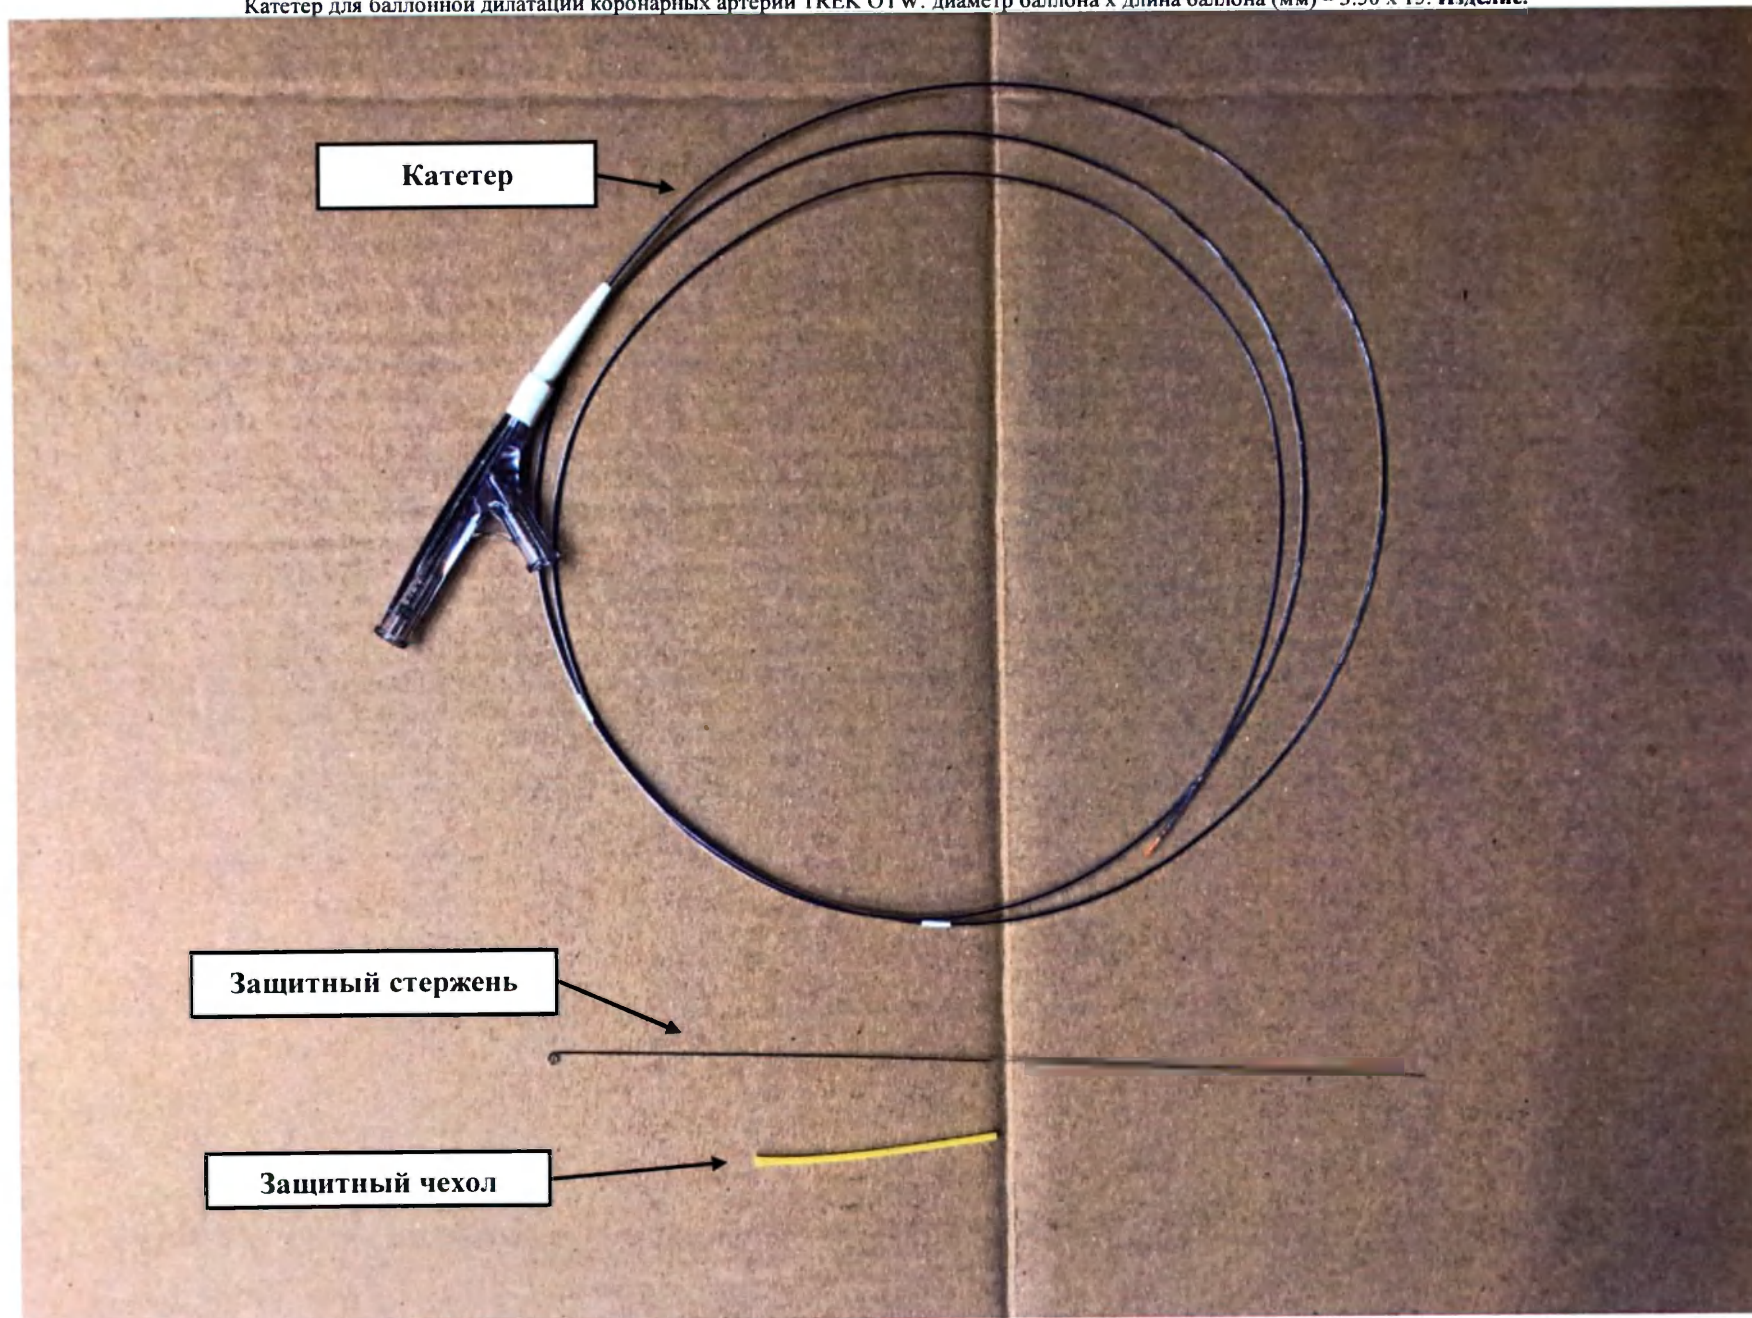

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 3.50 x 15. Изделие (баллон катетера).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий TREK OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 3.50 x 15. Изделие (наконечник катетера).






Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Общий вид потребительской упаковки (картонная коробка).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II OTW: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.20 х 6. Комплект поставки.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Общий вид индивидуальной упаковки (пакет).

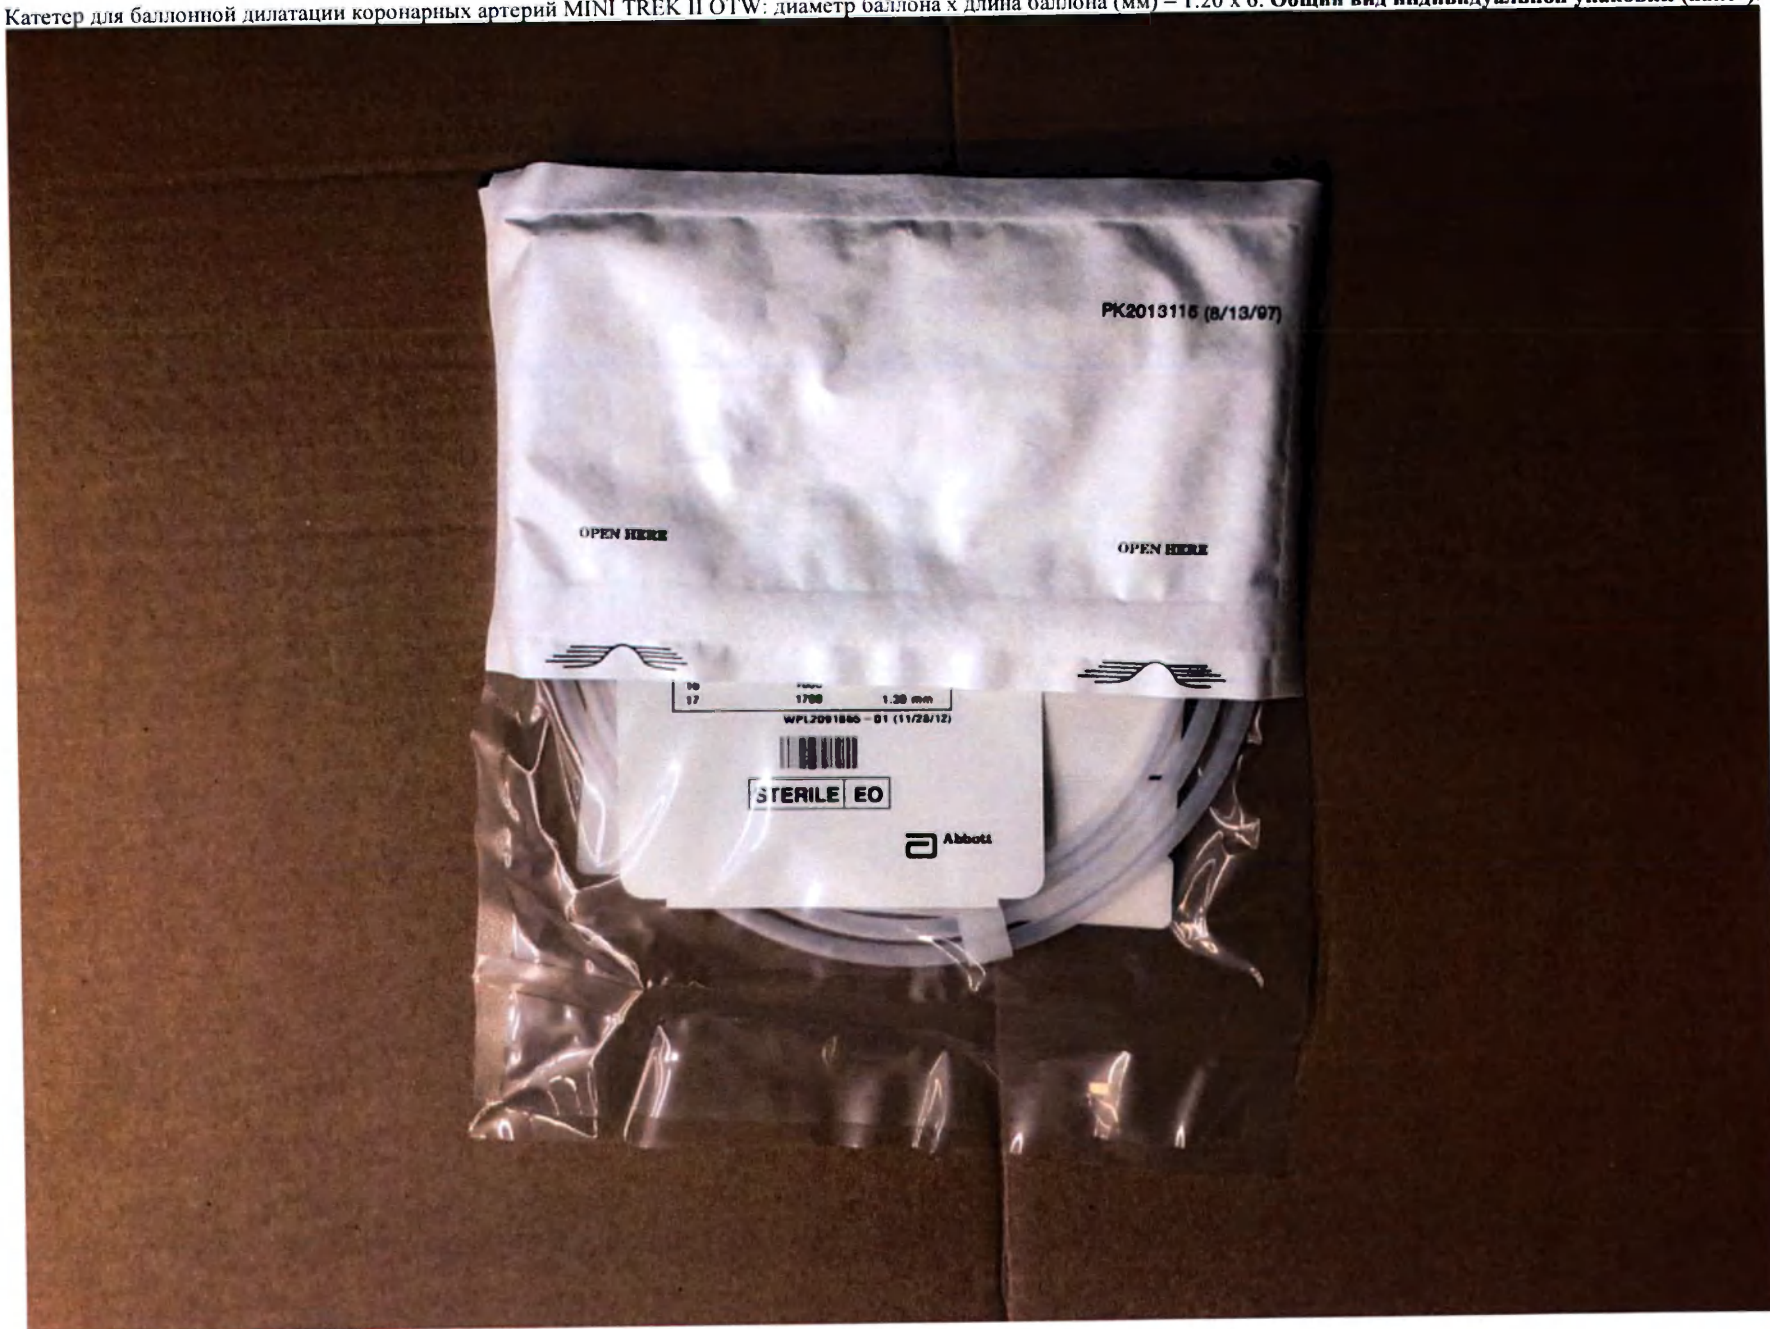


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Изделие в спиральной оплетке.




Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II OTW: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.20 х 6. Изделие в спиральной оплетке.

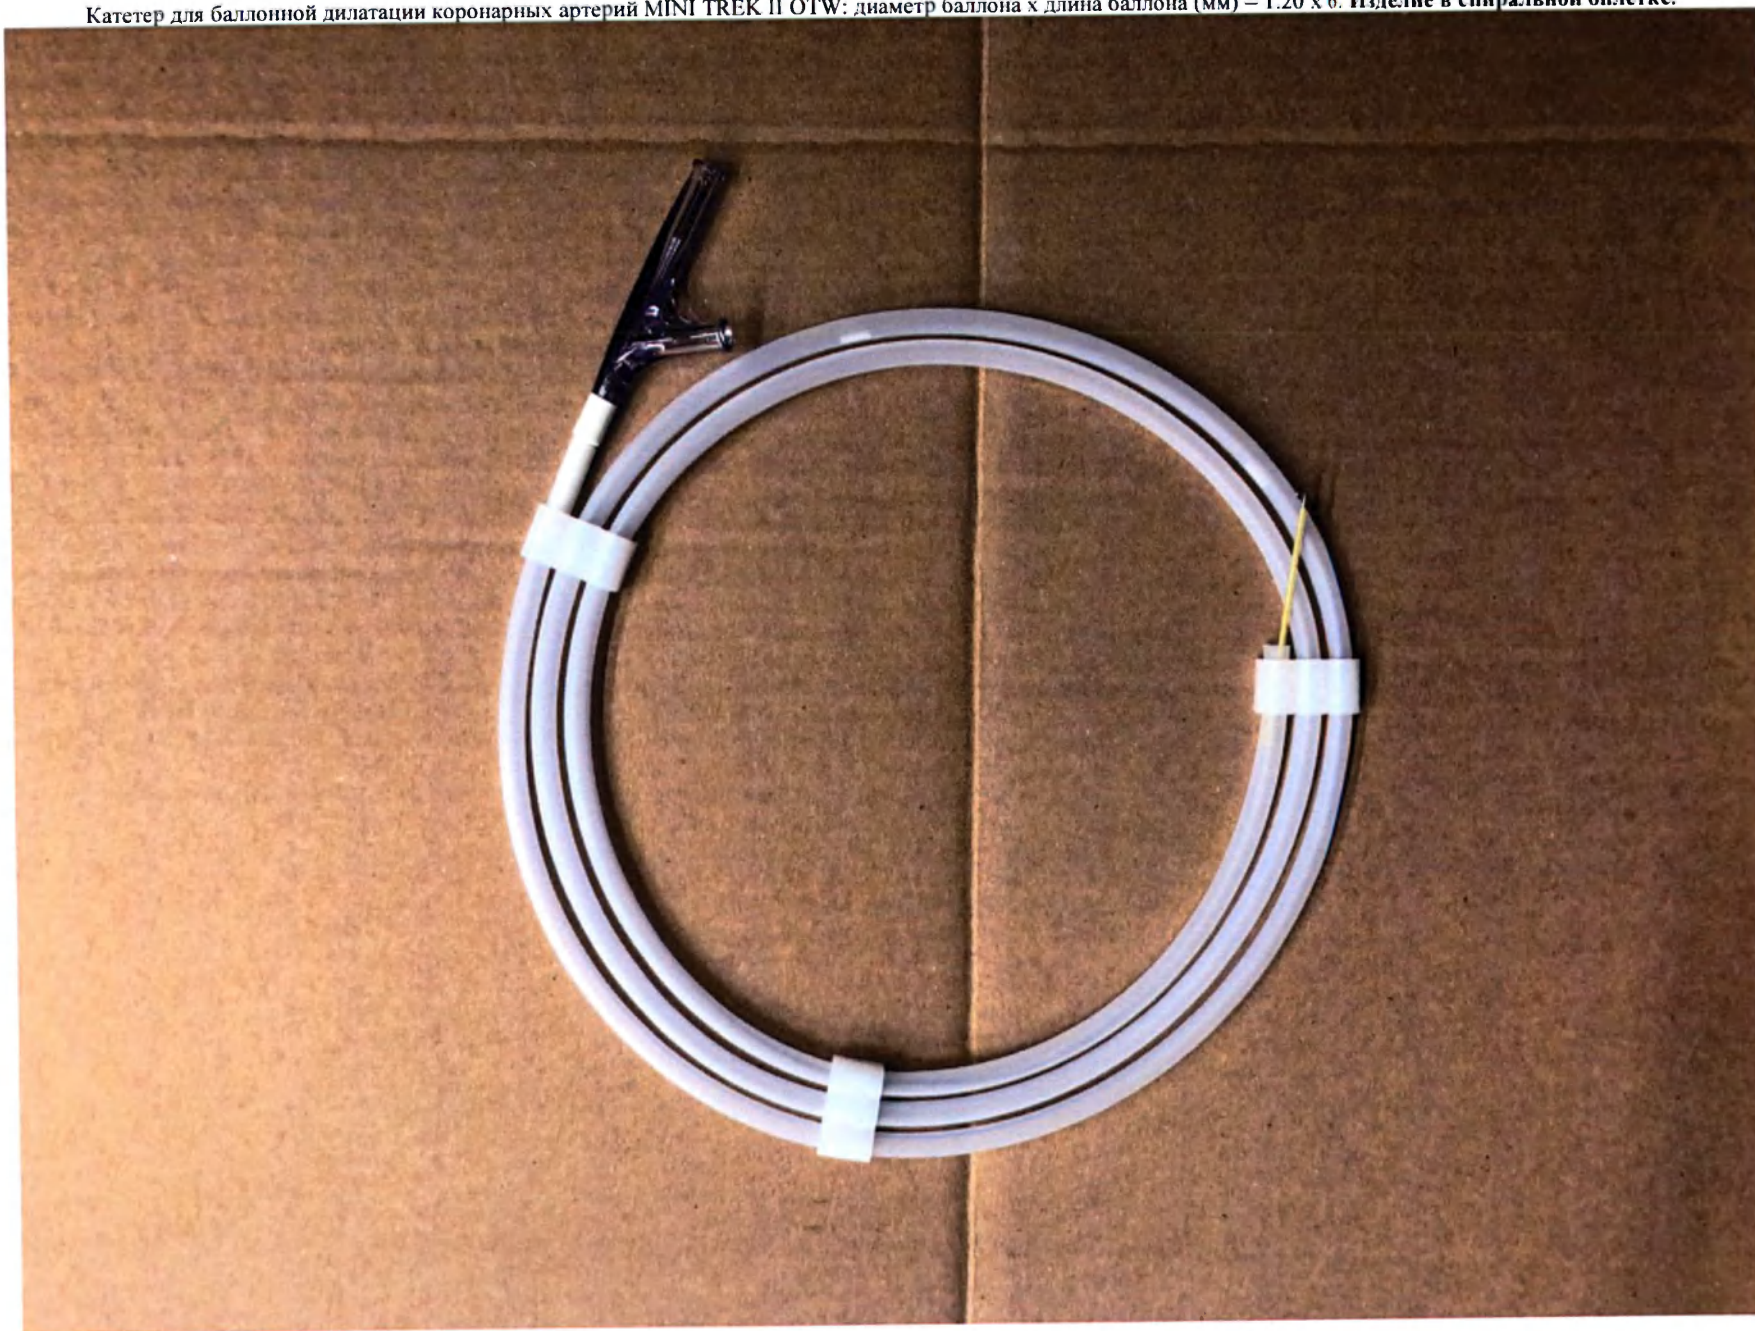

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Изделие.

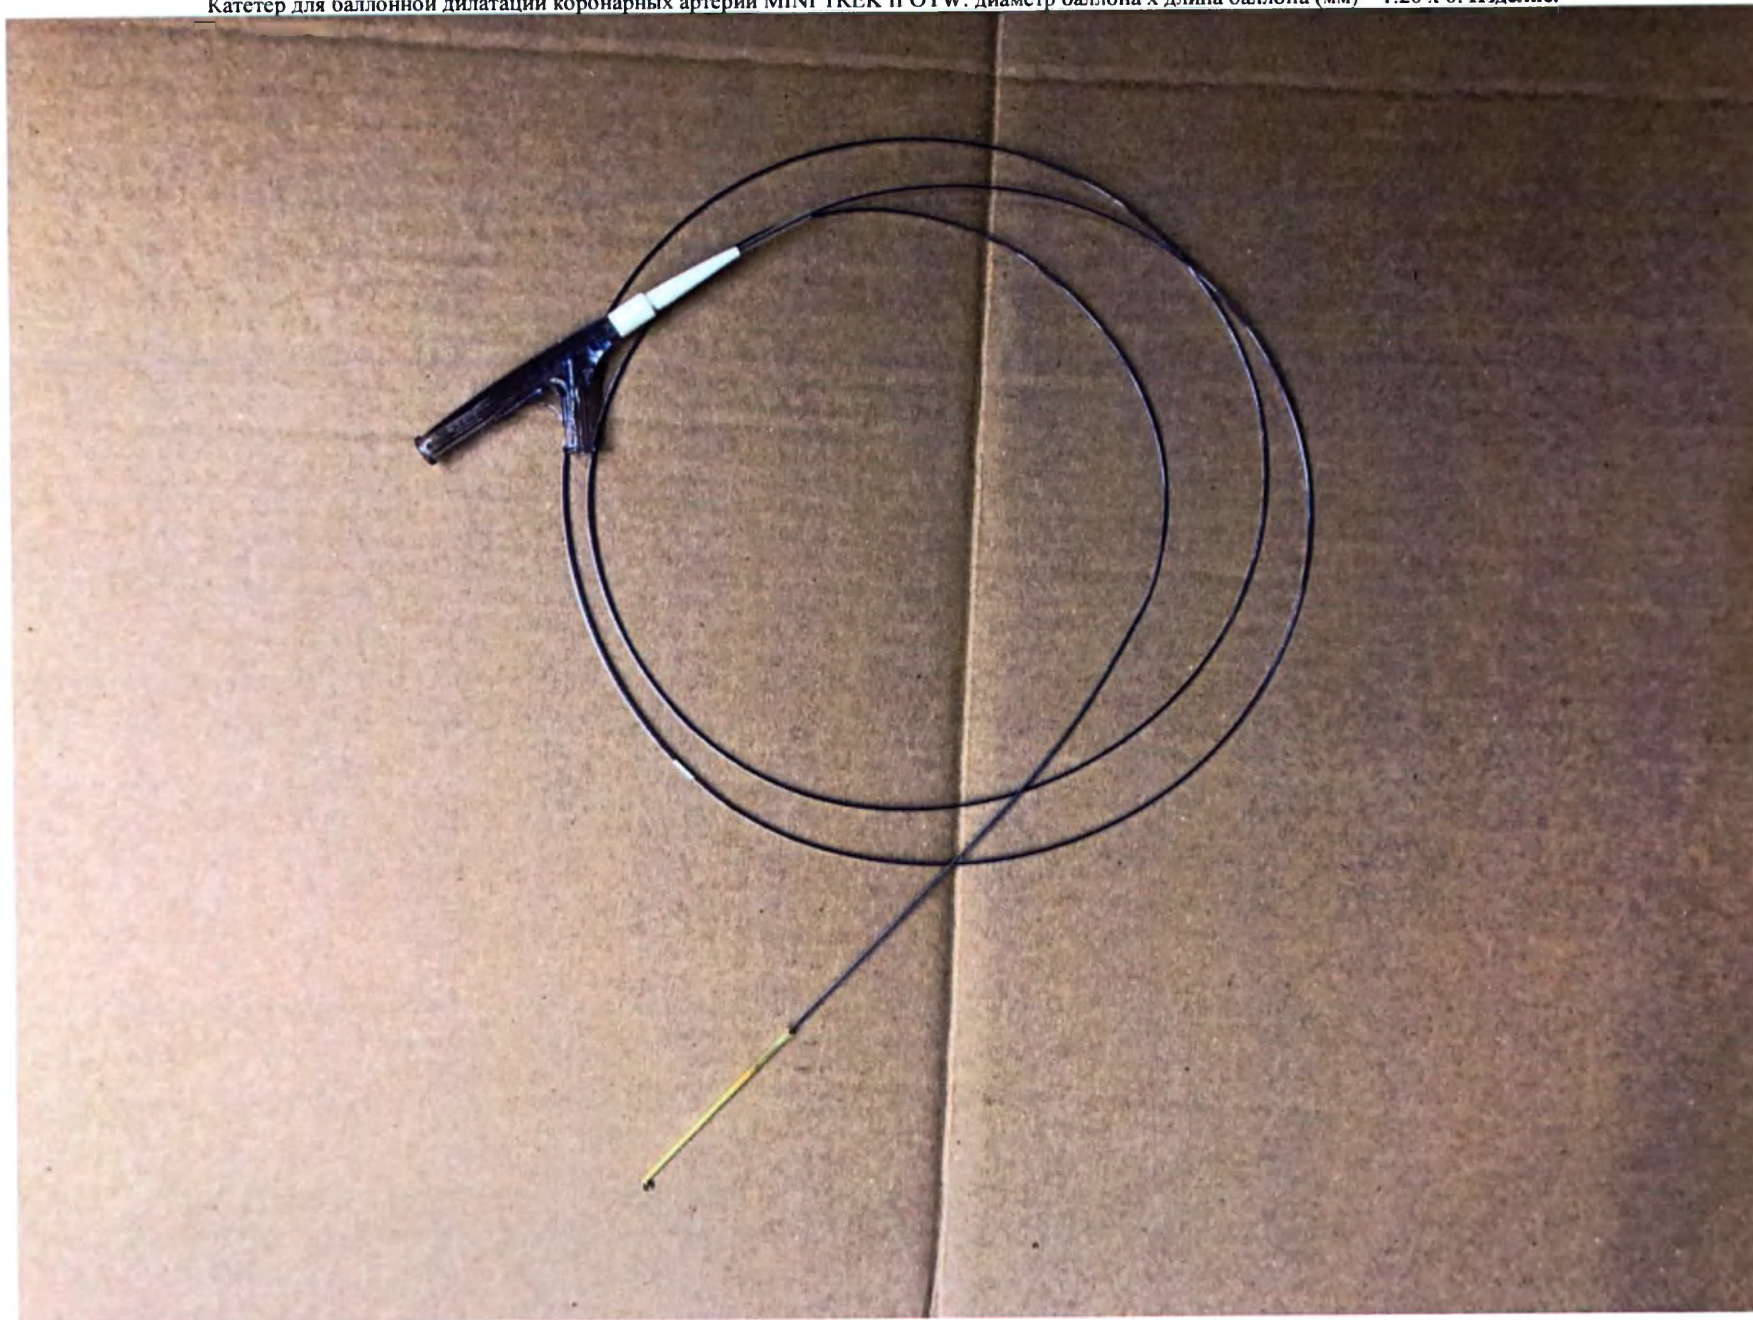

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Изделие.

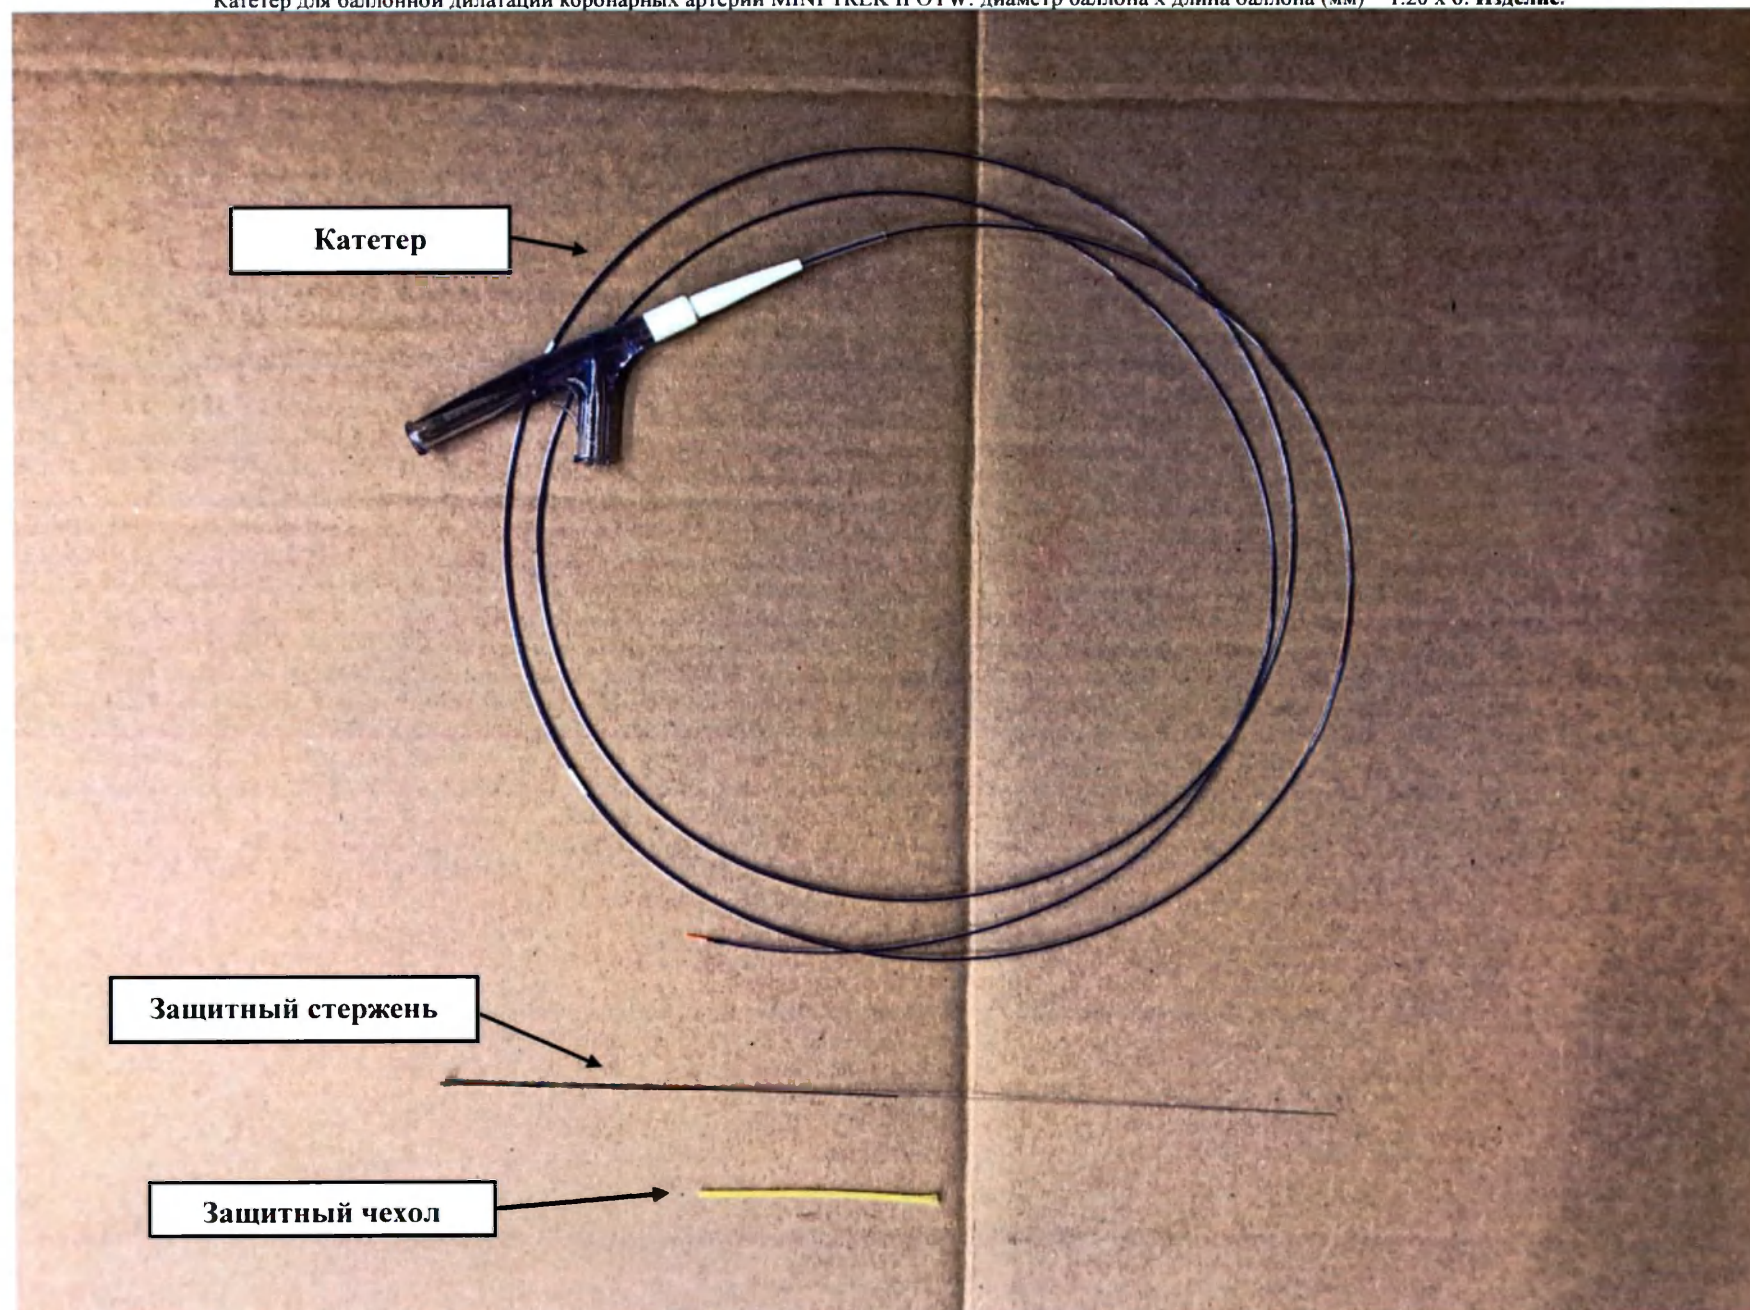

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II OTW: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.20 x 6. Изделие (баллон катетера).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий MINI TREK II ОТВ: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.20 х 6. Изделие (наконечник катетера).



REF 1012444-06

Coronary Dilatation Catheter; Koronar-Dilatationskatheter; Cathéter de dilatation coronaire; Cathéter para dilatación coronaria; Coronar per dilatazione coronarica; Cathéter para Dilatação Coronária; Koronar dilatationskatheter; Coronars dilatationskatheter; Koronar-dilatationskatheter; Kolletriğacı biyotrikajlı ortofosfolisiz; артритис; कोरोнадилатационный катетер; Włocowy cewnik rozszerzający; Szukozsonvár lágió katéter; Koronári dilatációs katór; Koronar Dilatasjon Kateter; Koronar-dilatasjonskateter; Koronarper dilatatsionen katetrig; Cathéter de dilatare coronarică; Kurenoo pze šarknovode gubrtseuer koropaspuea; Sepevutkenon lajennuskatein; Koronární dilatčný katéter; Párgarten dilatatsioonkateter; epraeel; Sepevutkenon lajennuskatein; Koronární dilatčný katéter; Párgarten dilatatsioonkateter; Koronárs dilatációs katór; Vaskines arterios išplėtimo katetris; Kateter za razširitev koronarnih arterij

Consult instructions for use; Gebrauchsanweisung lesen; Consulter le mode d'emploi;
Consultar las instrucciones de uso; Consultare le istruzioni per l'uso; Consultar as instruções
de utilização; Se bruksanvisningen; Raadpleeg gebruiksaanwijzing; Lees bruiksaanvi-
sen; Szűzőleírásról tud először érteni; 添付文書を参照下さい。; Zapoznaj się z instrukcją
obuży; Léed a használati utasítást; Viz návod k použití; Kullarmm talimallarina bakun; Lees bruksan-
visningen; Вкесте інструкції за употреба; Consultaj instrucțiunile de utilizare; Ознакомьтесь с
инструкциями по применению; Käsko käyttöohjeita; Pozn návod na použitie; Vaadake teavet kasutus-
juhetest; Skatiet lietošanas instrukciju; Zr. naučojmo instrukcijas; Glejte navodila za uporabo

ATM	kPa	-O-
2	203	1.36 mm
3	304	1.37 mm
4	406	1.38 mm
5	507	1.39 mm
6	608	1.41 mm
7	709	1.42 mm
8	811	1.43 mm
9	912	1.45 mm
10	1013	1.46 mm
11	1116	1.47 mm
12 (NOM)	1216	1.49 mm
13	1317	1.50 mm
14	1419	1.51 mm
15	1520	1.52 mm
16	1620	1.53 mm
17	1723	1.53 mm
18 (RBP)	1824	1.54 mm
19	1925	1.55 mm
20	2027	1.56 mm
21	2128	1.57 mm
22	2229	1.58 mm

STERILE EO **FLUSHING TOOL**

NC TREK is a trademark of the Abbott Group of Companies.

NC TREK 1.50 mm x 6 mm, 143 cm
REF 1012444-06
 (01) 0 8717648 16127 6

NC TREK 1.50 mm x 6 mm, 143 cm
REF 1012444-06
 (17) 201231 (10) 80102G1 (01) 2166

Legal Manufacturer
Abbott Vascular
3300 Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054 USA
TEL: (800) 327-9925 FAX: (800) 421-8874
Outside USA TEL: (951) 914-4669
Outside USA FAX: (951) 914-2631

(MANUFACTURED BY)
Abbott Vascular
Croyal Free Zone
El Croyal Atiquia, Costa Rica


(EC REP)
Abbott Vascular International BVBA
Park Lane, Culliganpark 2B, 1831 Stogen, BELGIUM
TEL: +32 2 714 14 15 FAX: +32 2 714 14 12

WPL2102770-01 (11/7/14)

NC TREK
Coronary Dilatation Catheter

PPL3074351 (3/3/10)

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.50 x 20. Общий вид потребительской упаковки (картонная коробка).

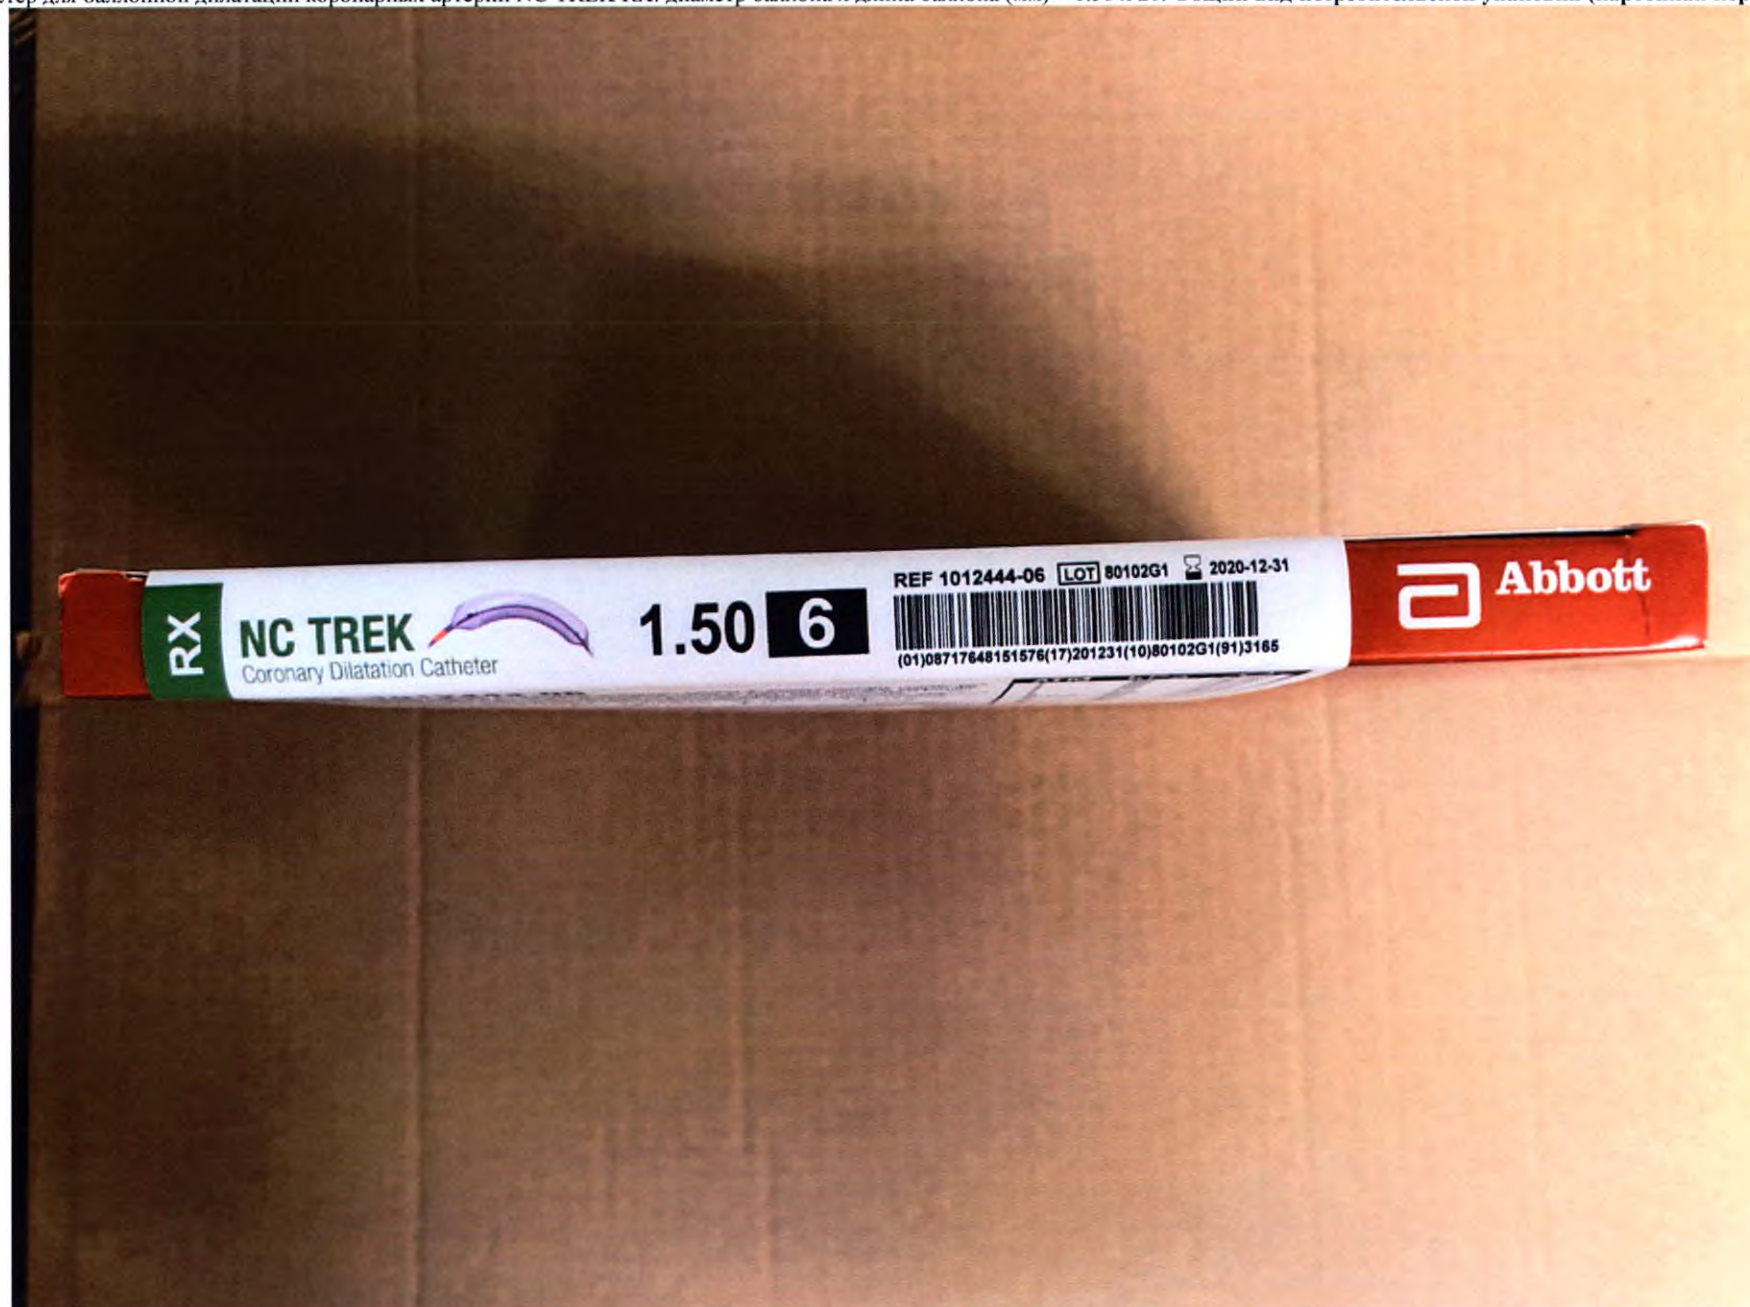

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1,50 x 20. Общий вид индивидуальной упаковки (пакет).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.50 х 20. Изделие в спиральной оплетке.



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.50 х 20. Изделие в спиральной оплетке.



Устройство для
первичного промывания


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.50 x 20. Фиксатор для катетера для баллонной дилатации.



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.50 x 20. Фиксатор для катетера для баллонной дилатации.



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона х длина баллона (мм) – 1.50 х 20. Устройство для первичного промывания.

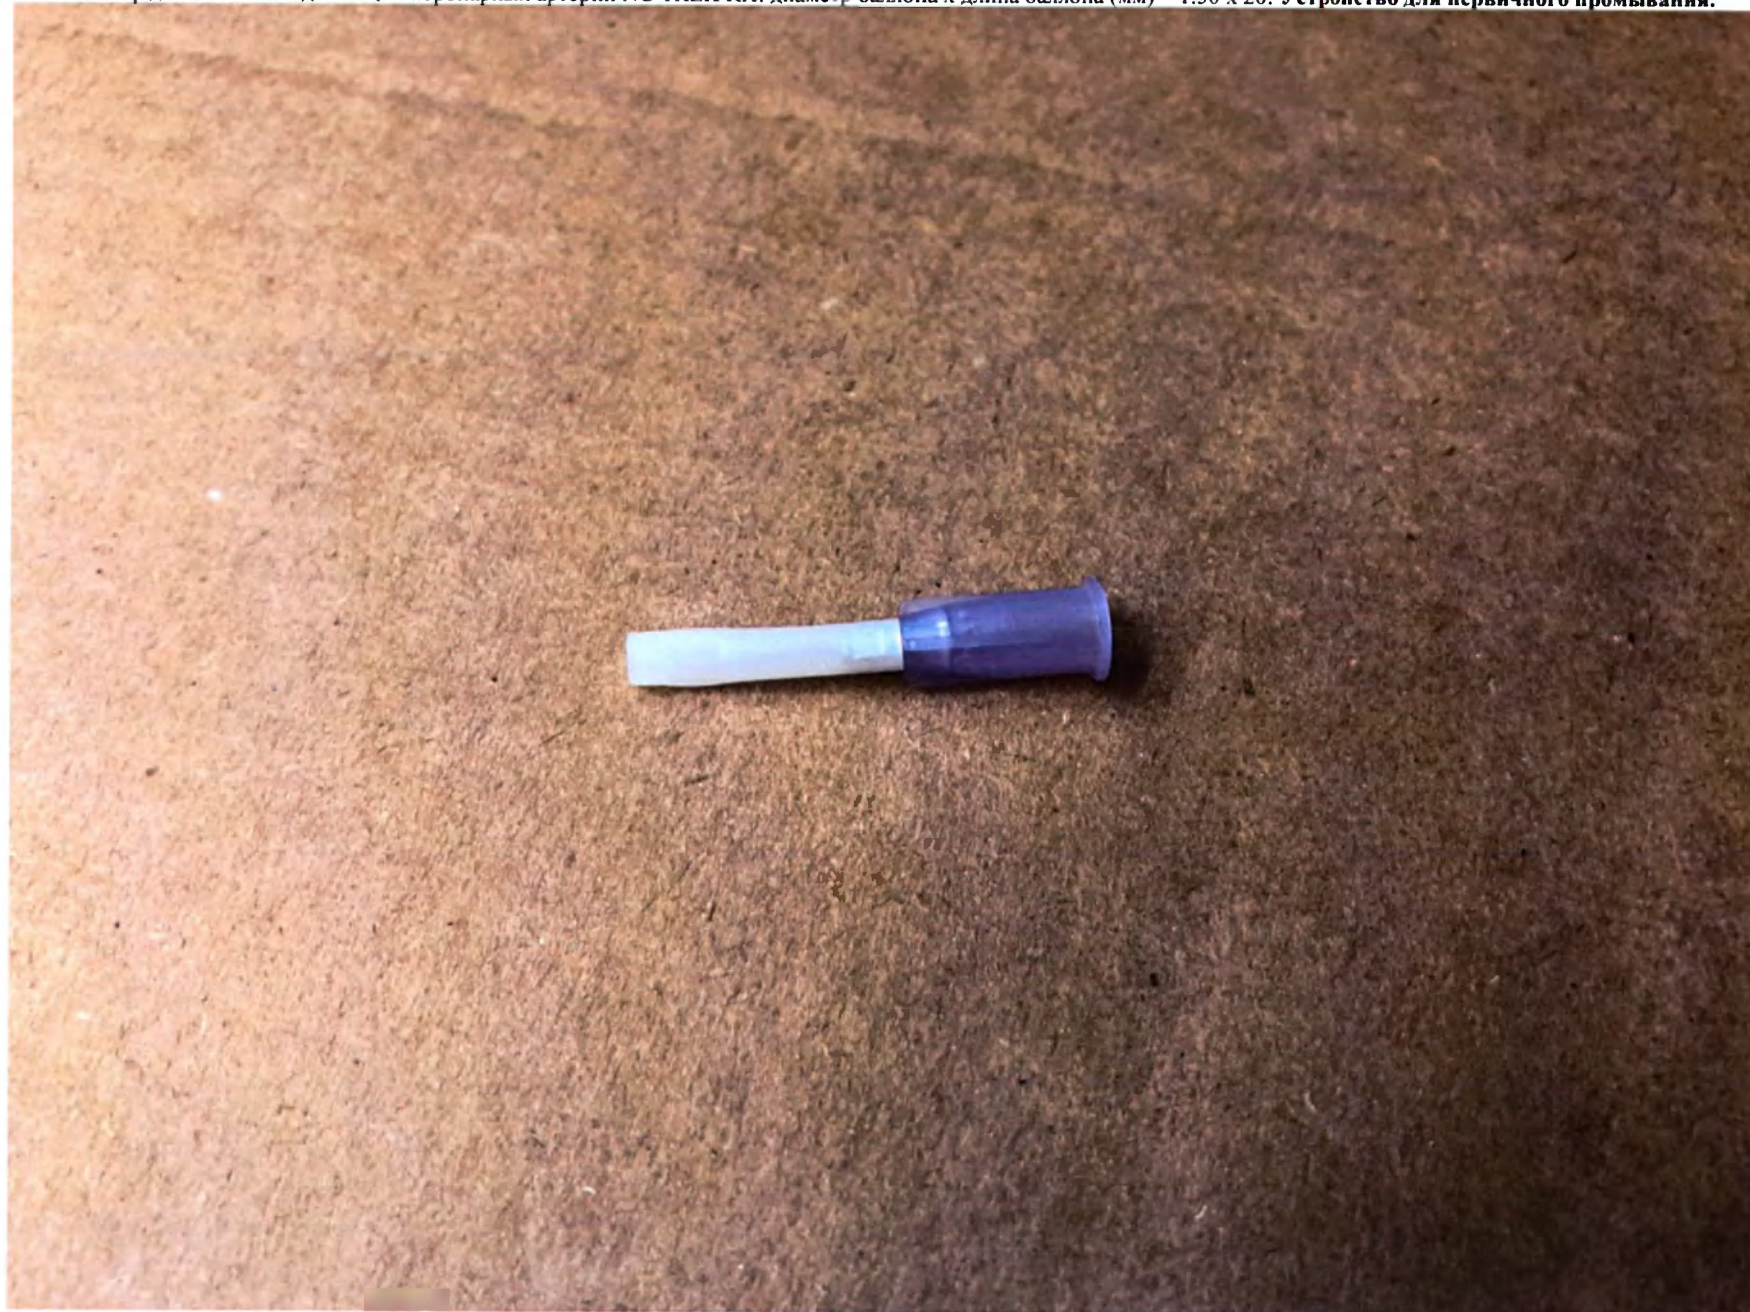


Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.50 x 20. Устройство для первичного промывания.



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.50 x 20. Изделие.




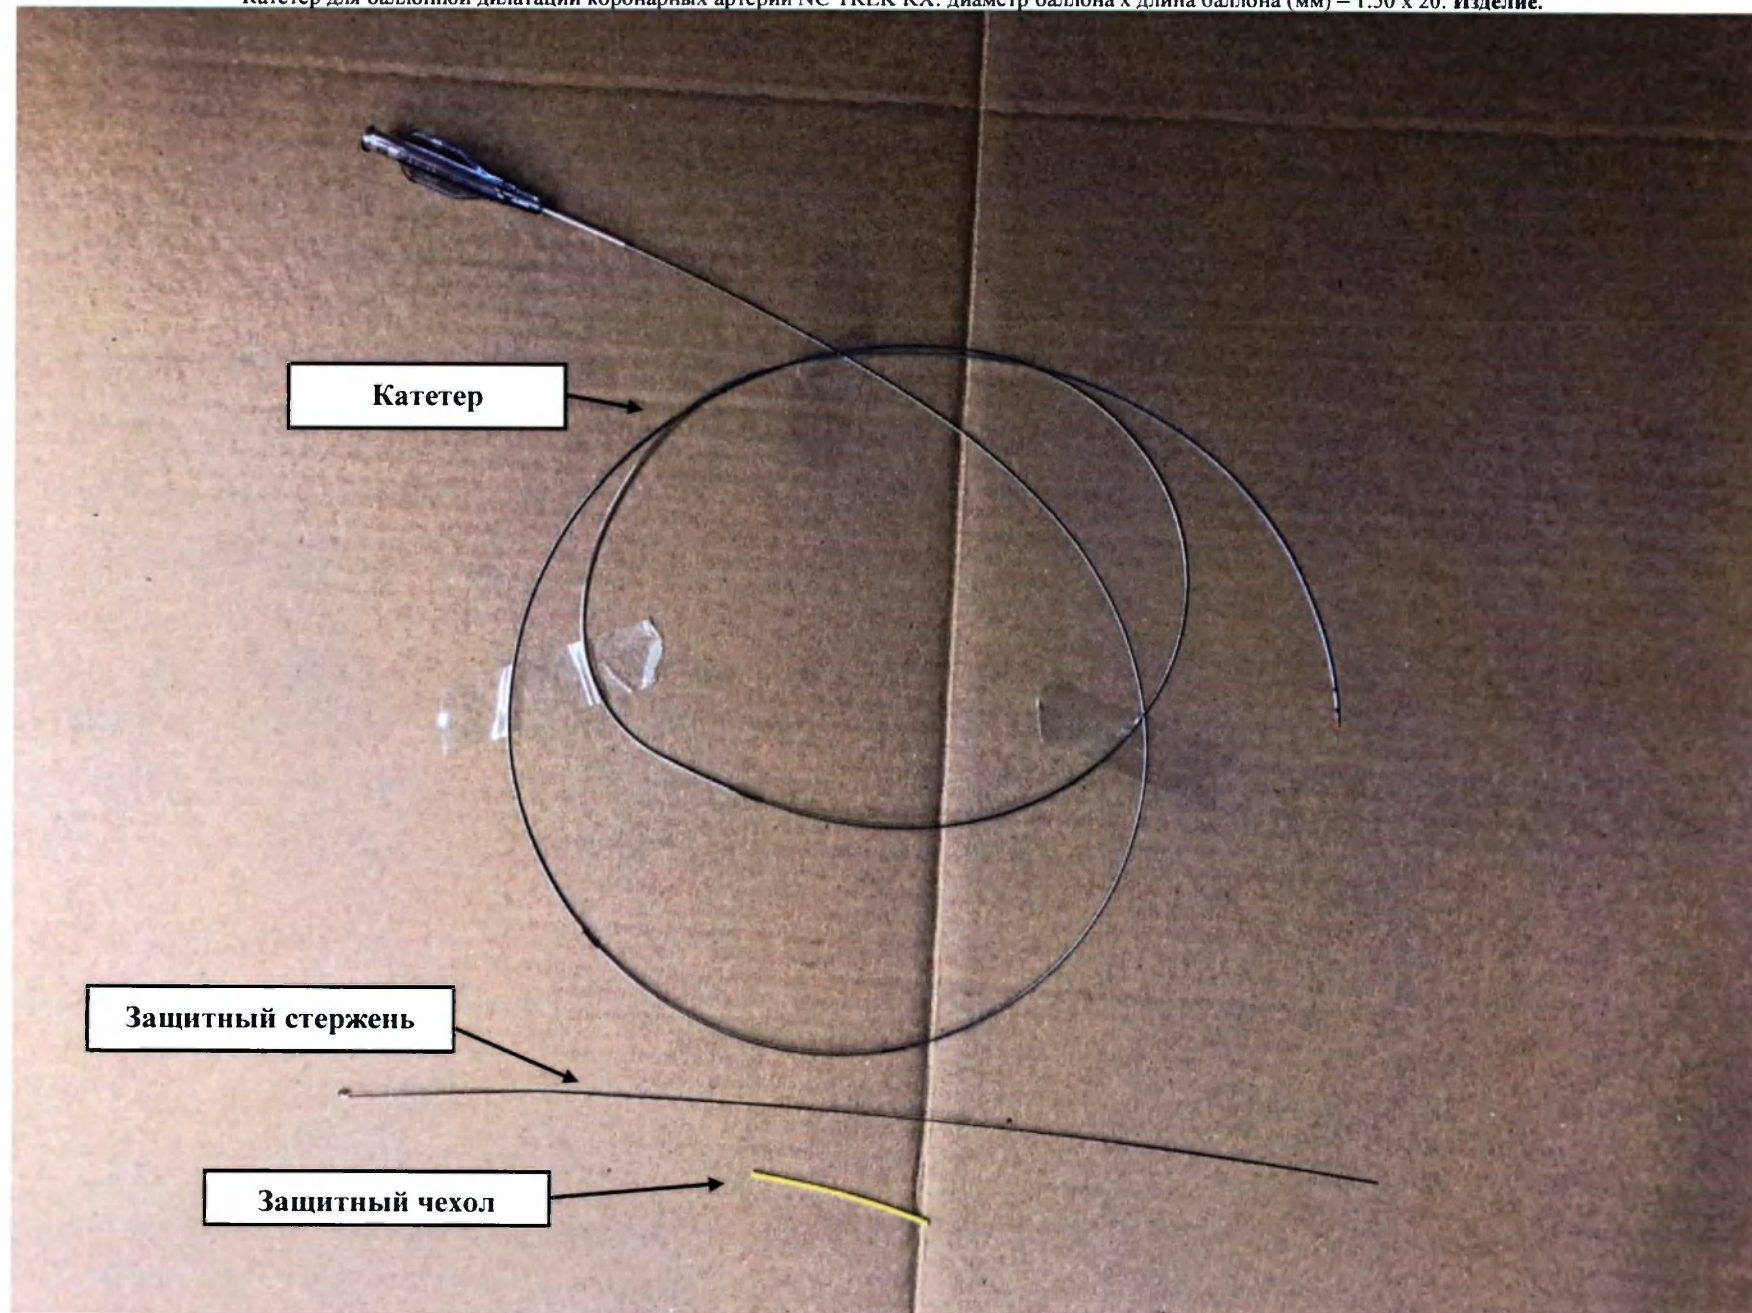

Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.50 x 20. Изделие (баллон катетера).



Катетер для баллонной дилатации коронарных артерий NC TREK RX: диаметр баллона x длина баллона (мм) – 1.50 x 20. Изделие (наконечник катетера).

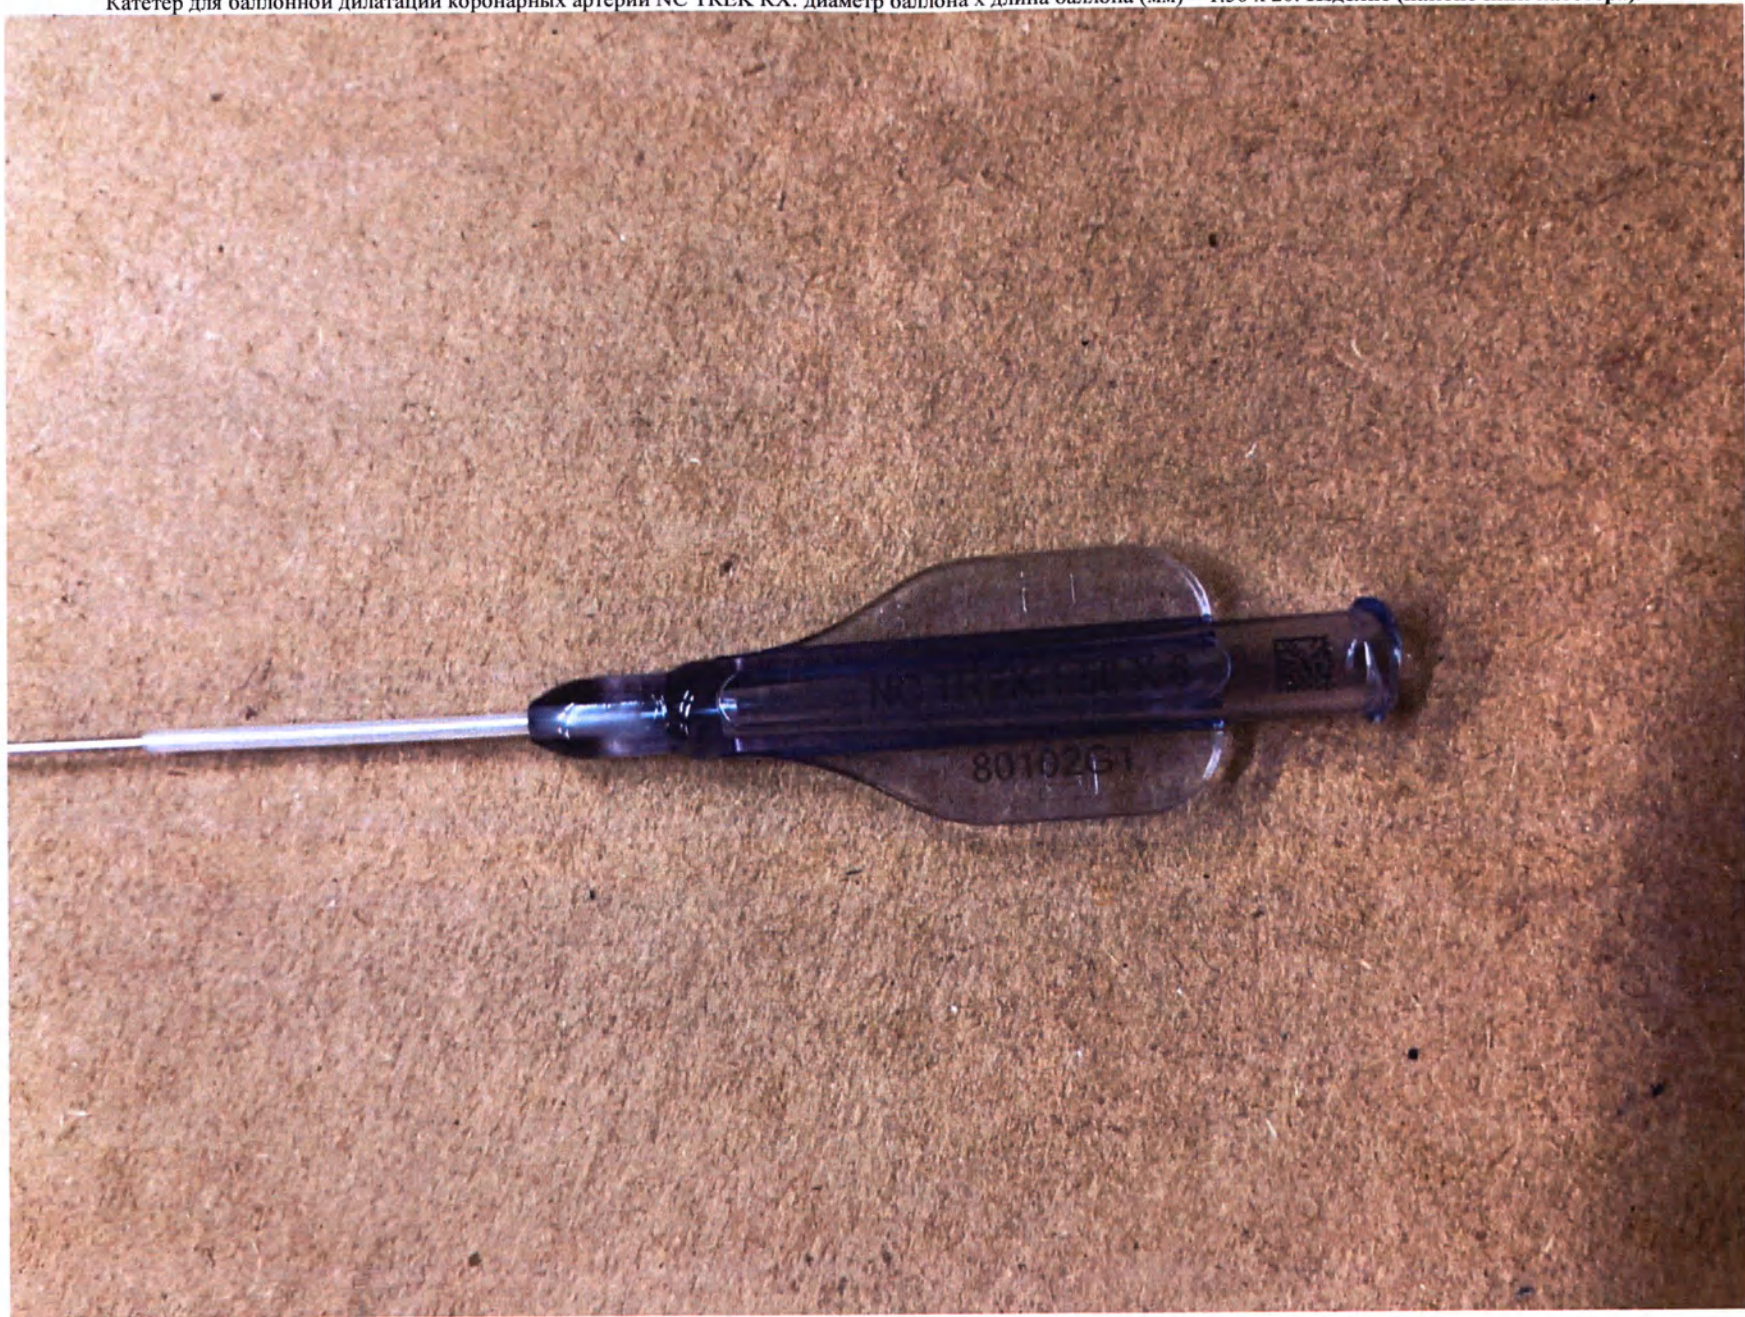

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

69 (шестьдесят девять) листов

ООО «Эбботт Лэбораториз»



Руководитель подразделения
Байгельдинова Д.Ш.