

Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»
Заводовский Д. В.



«28» февраля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Микротом-криостат для гистологических исследований серии М с принадлежностями, в вариантах исполнения (M-series Cryostats)

1. Основной состав


Основной блок с системой охлаждения, арт. 10160000 и арт. 10150700 (MEV и MEV+)



Основной блок с системой охлаждения, арт. 10160000 (MNT)



Полуавтоматический ротационный микротом, арт. 32001000 и арт. 32001001 (MEV и MEV+)

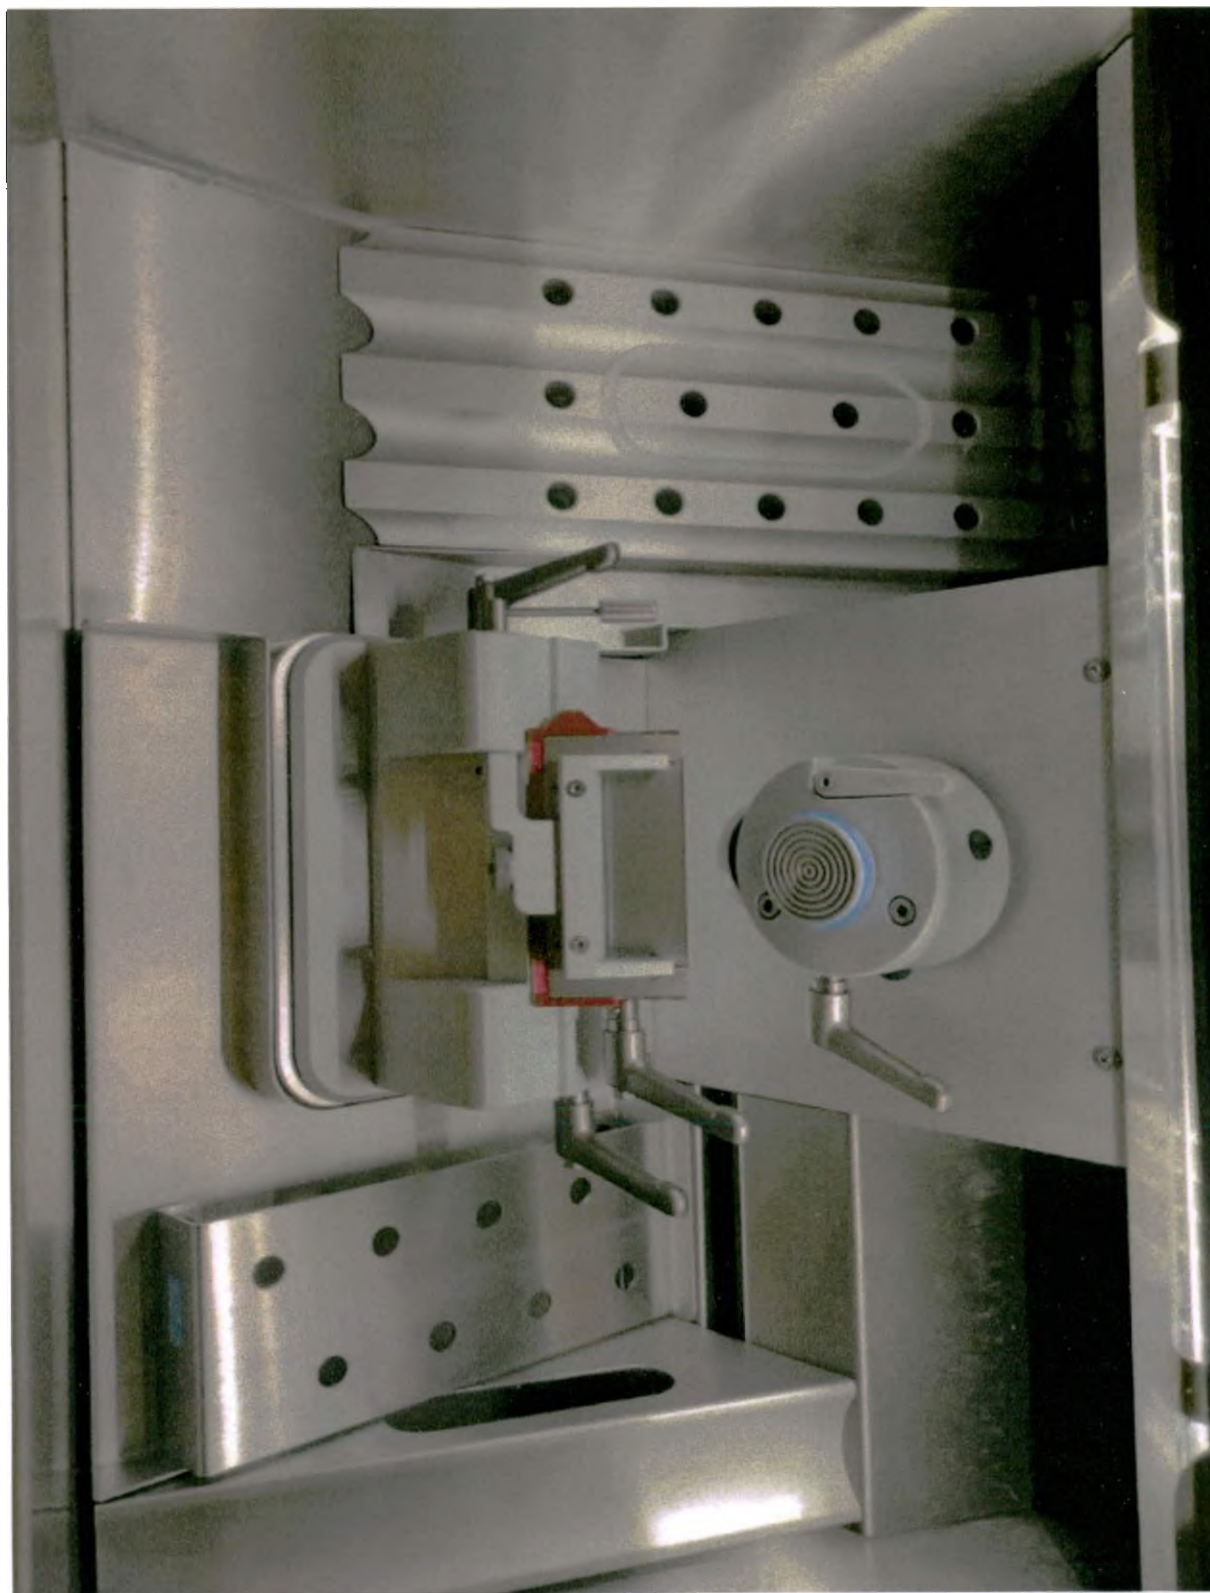

Автоматический ротационный микротом, арт. 32001002 (MNT)



Система охлаждения образцов, арт. 10164000



Низкотемпературное масло для криостата, объем 50 мл., арт. 30001011




Заливочная среда CryoGlue, объем 125 мл., 4 шт./уп., арт. 30001100




Одноразовые микротомные лезвия, низкий профиль, 50 шт./уп., арт. 28407000




Ножная педаль, арт. 34001500 (только для MNT)

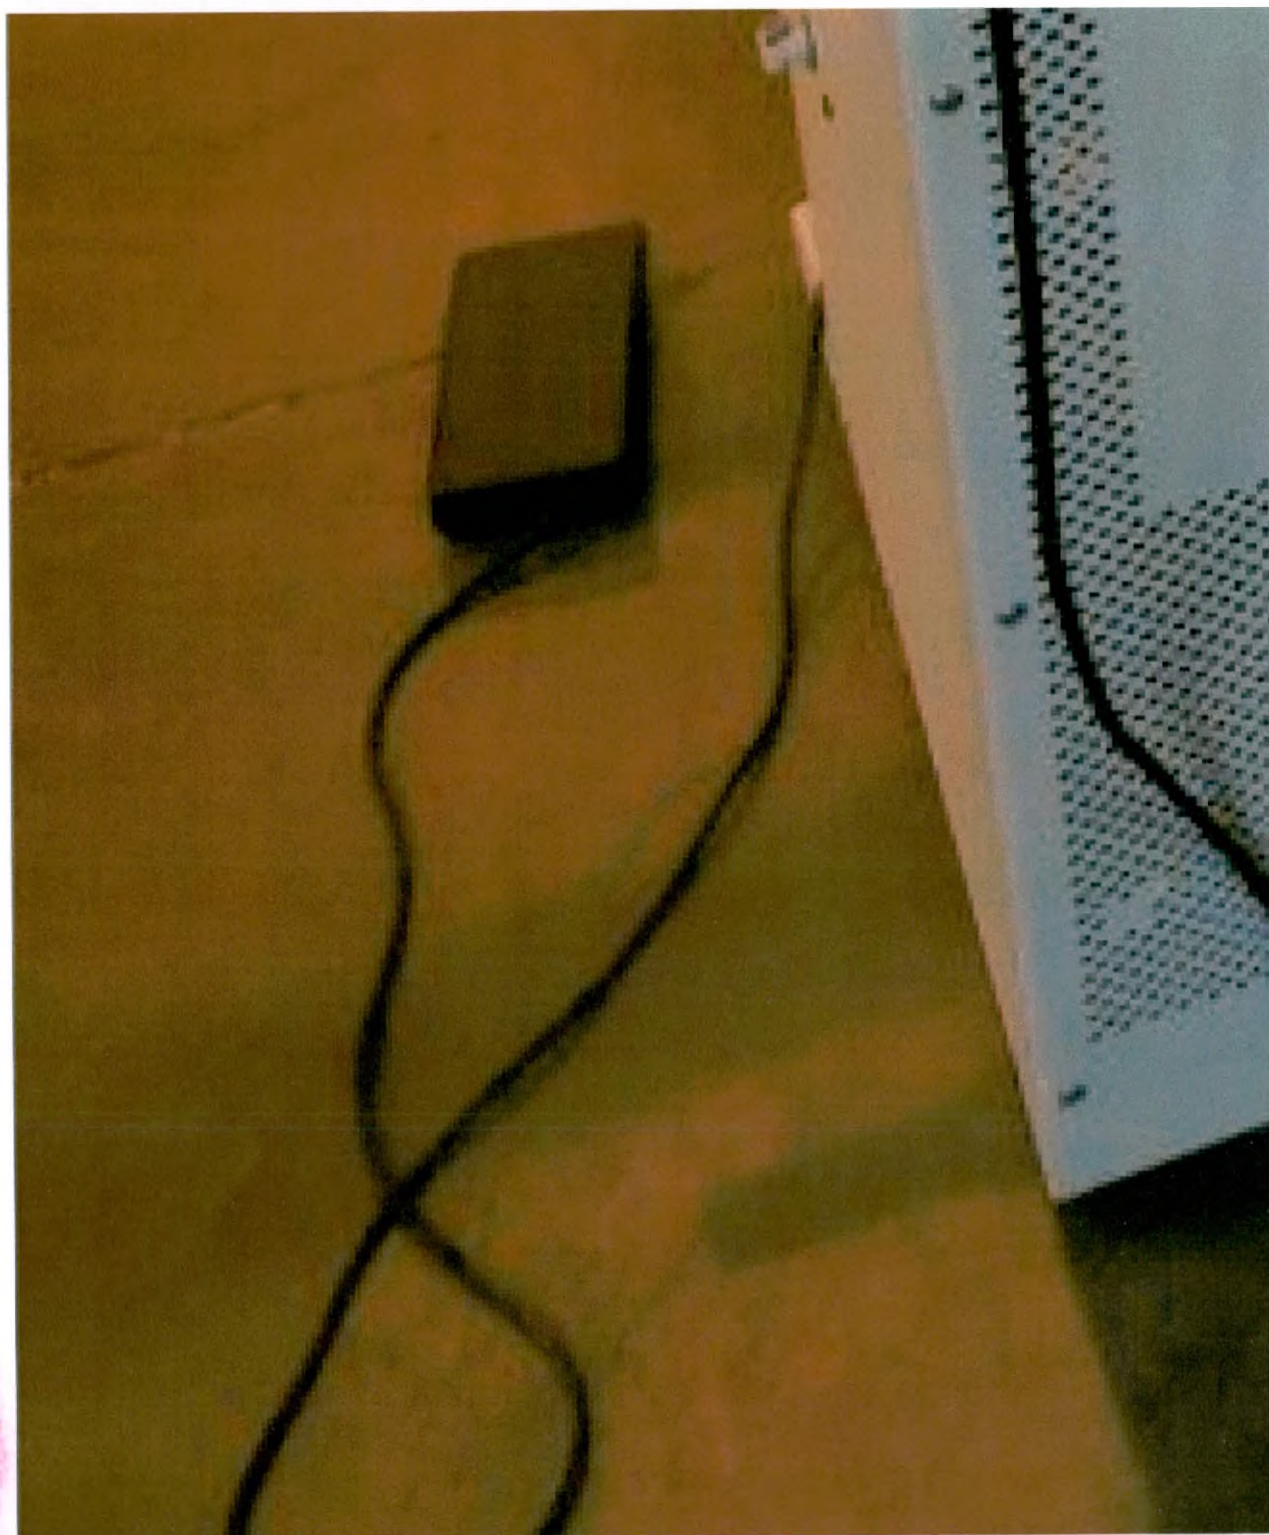

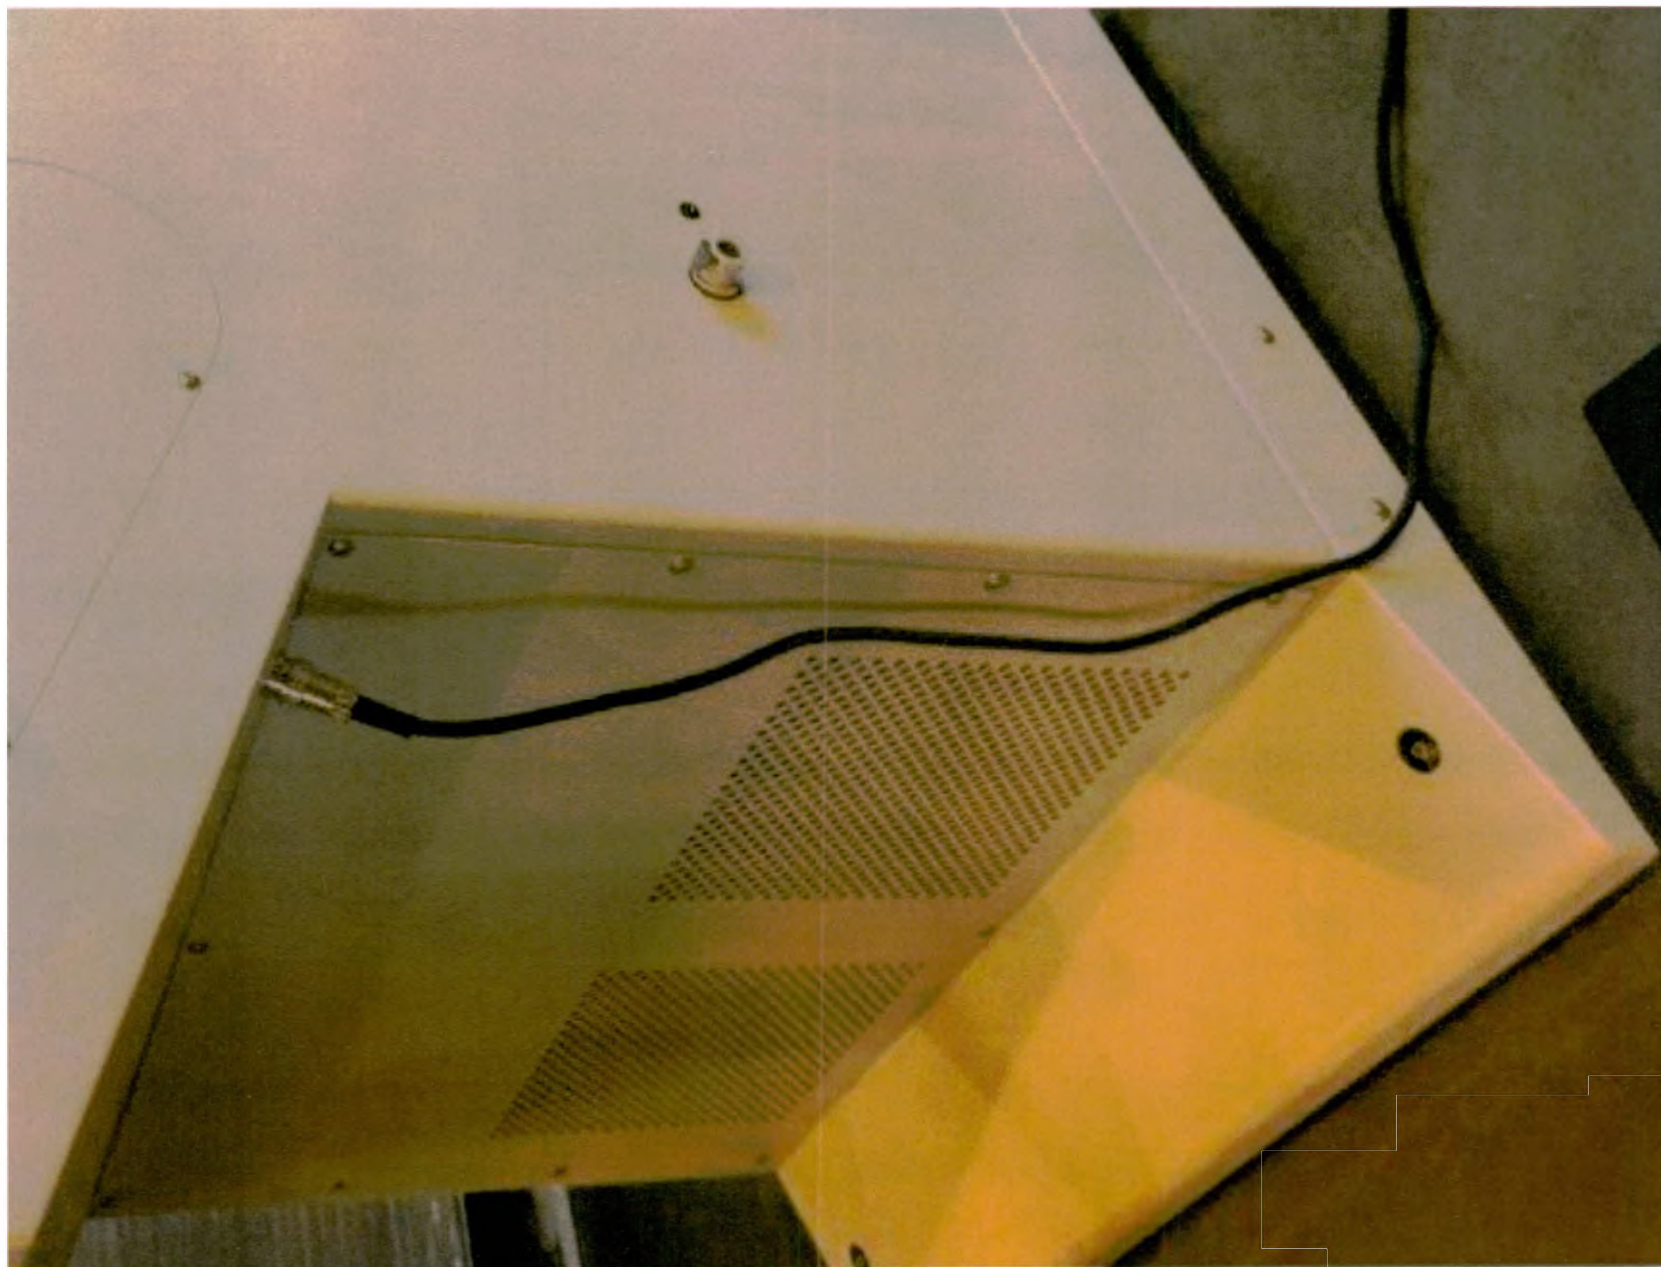


УФ лампа для дезинфекции, арт. 10169000

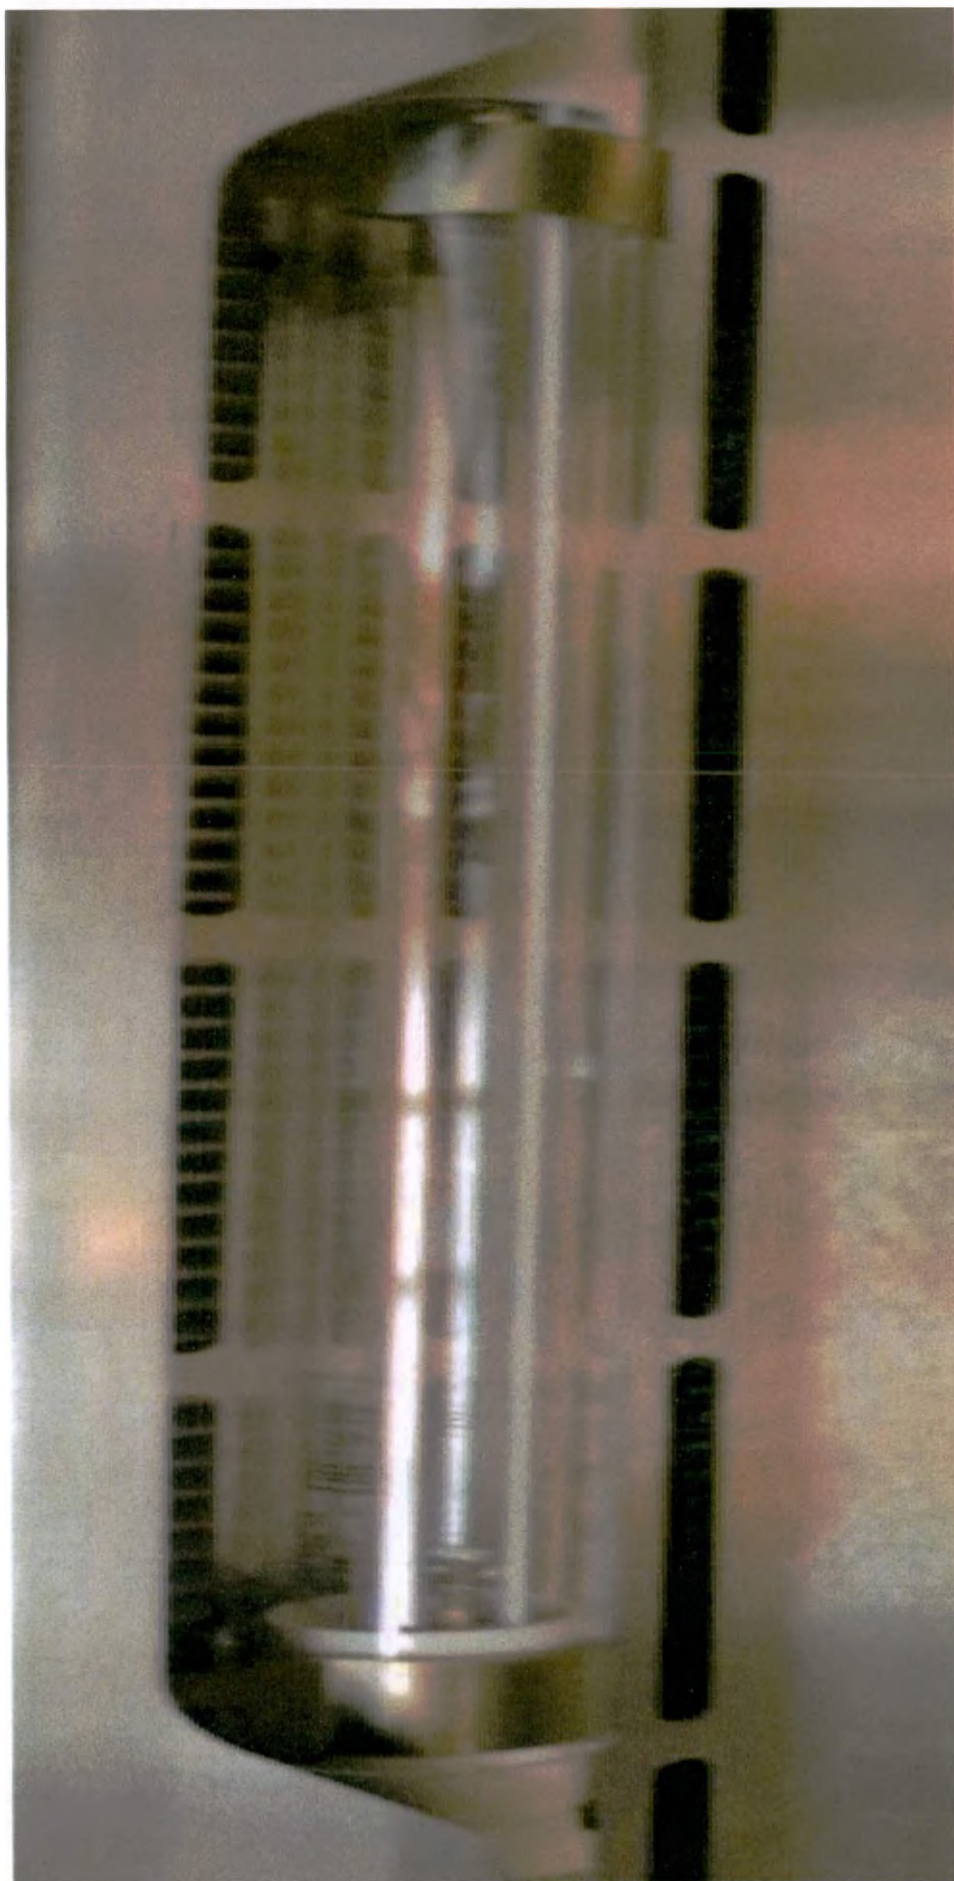

Кабель питания, арт. 70361052



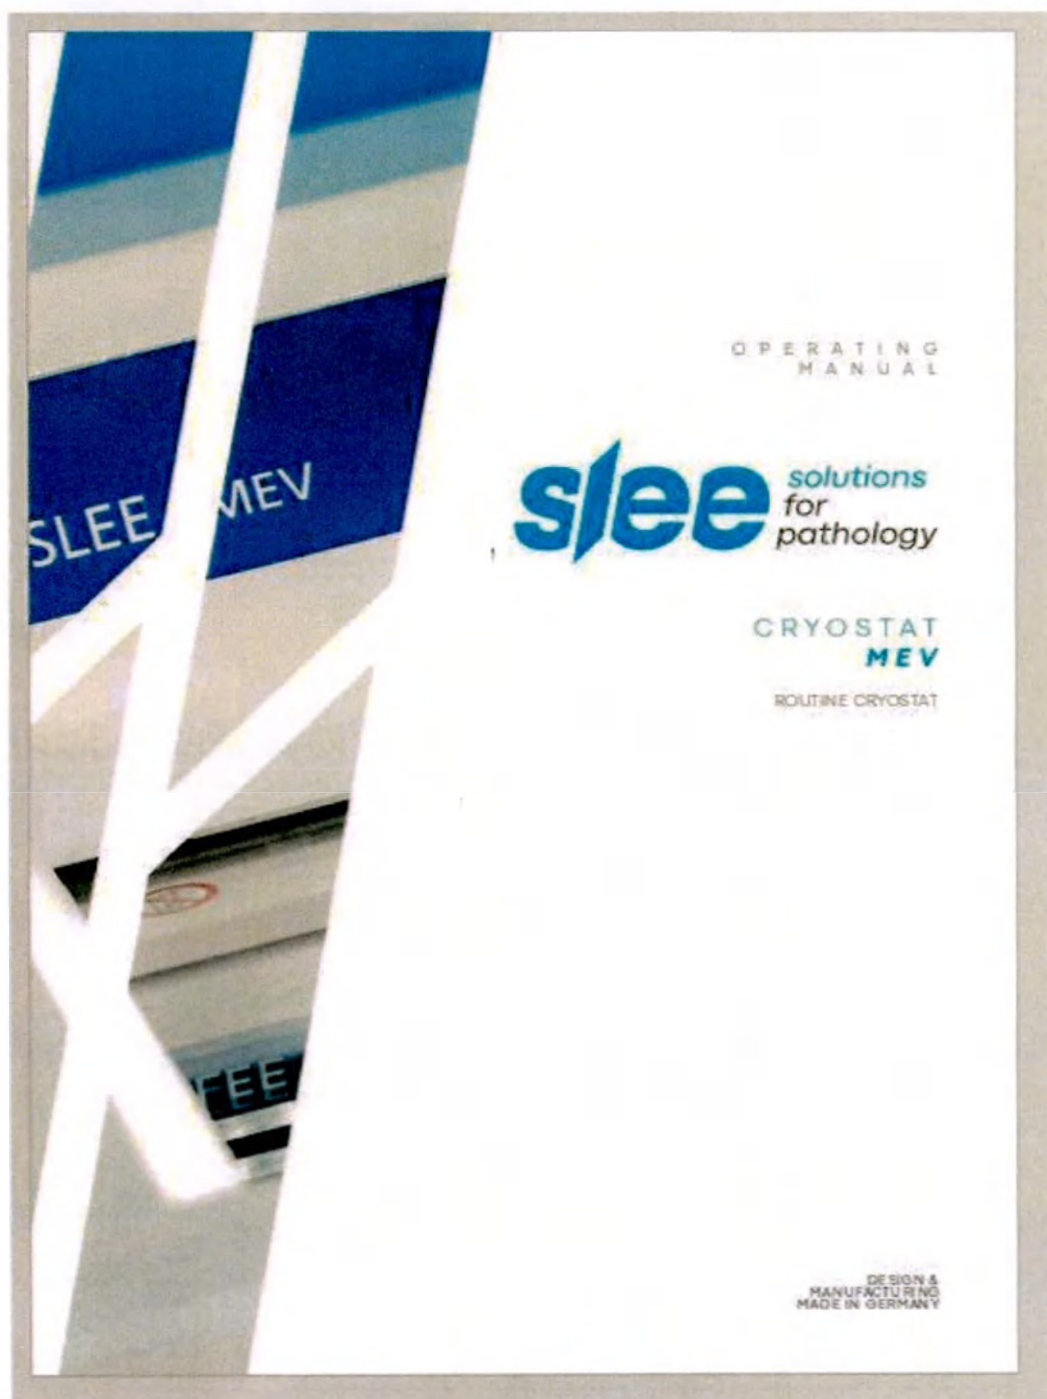







2. Принадлежности

Кисточка для очистки, арт. 30001030

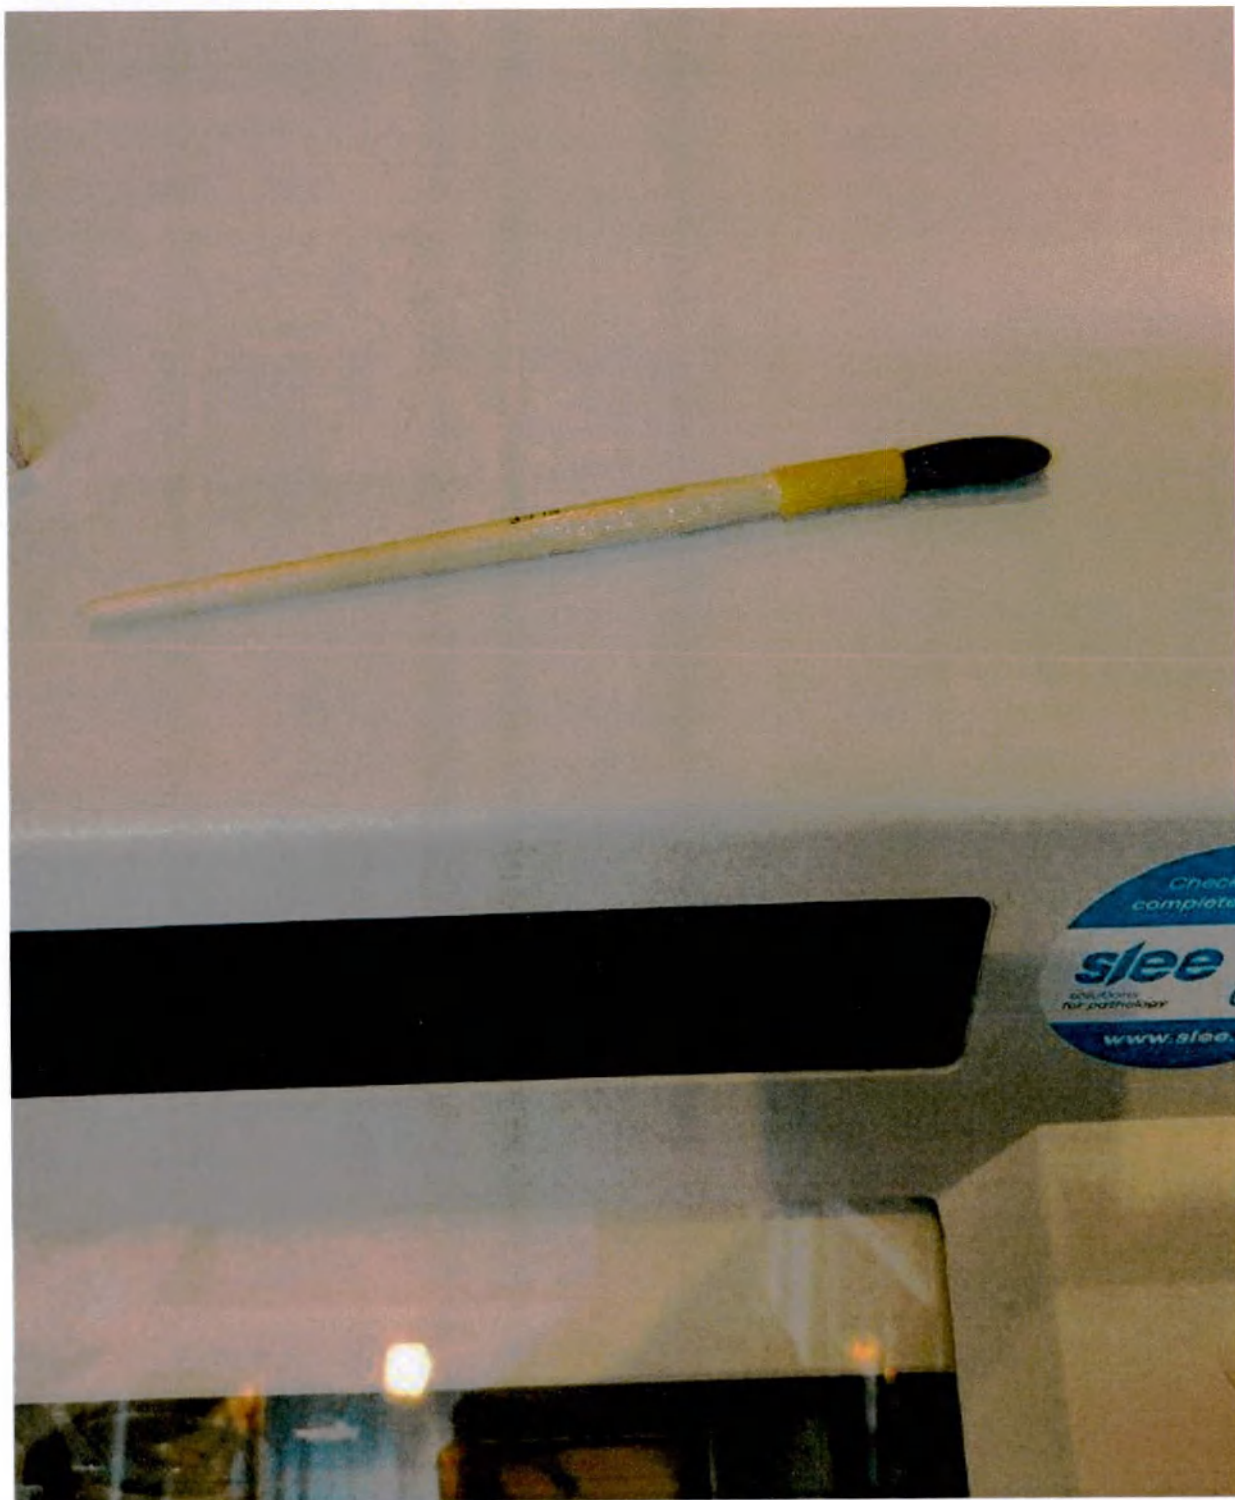

2х-позиционная полка для быстрой заморозки, арт. 10159000

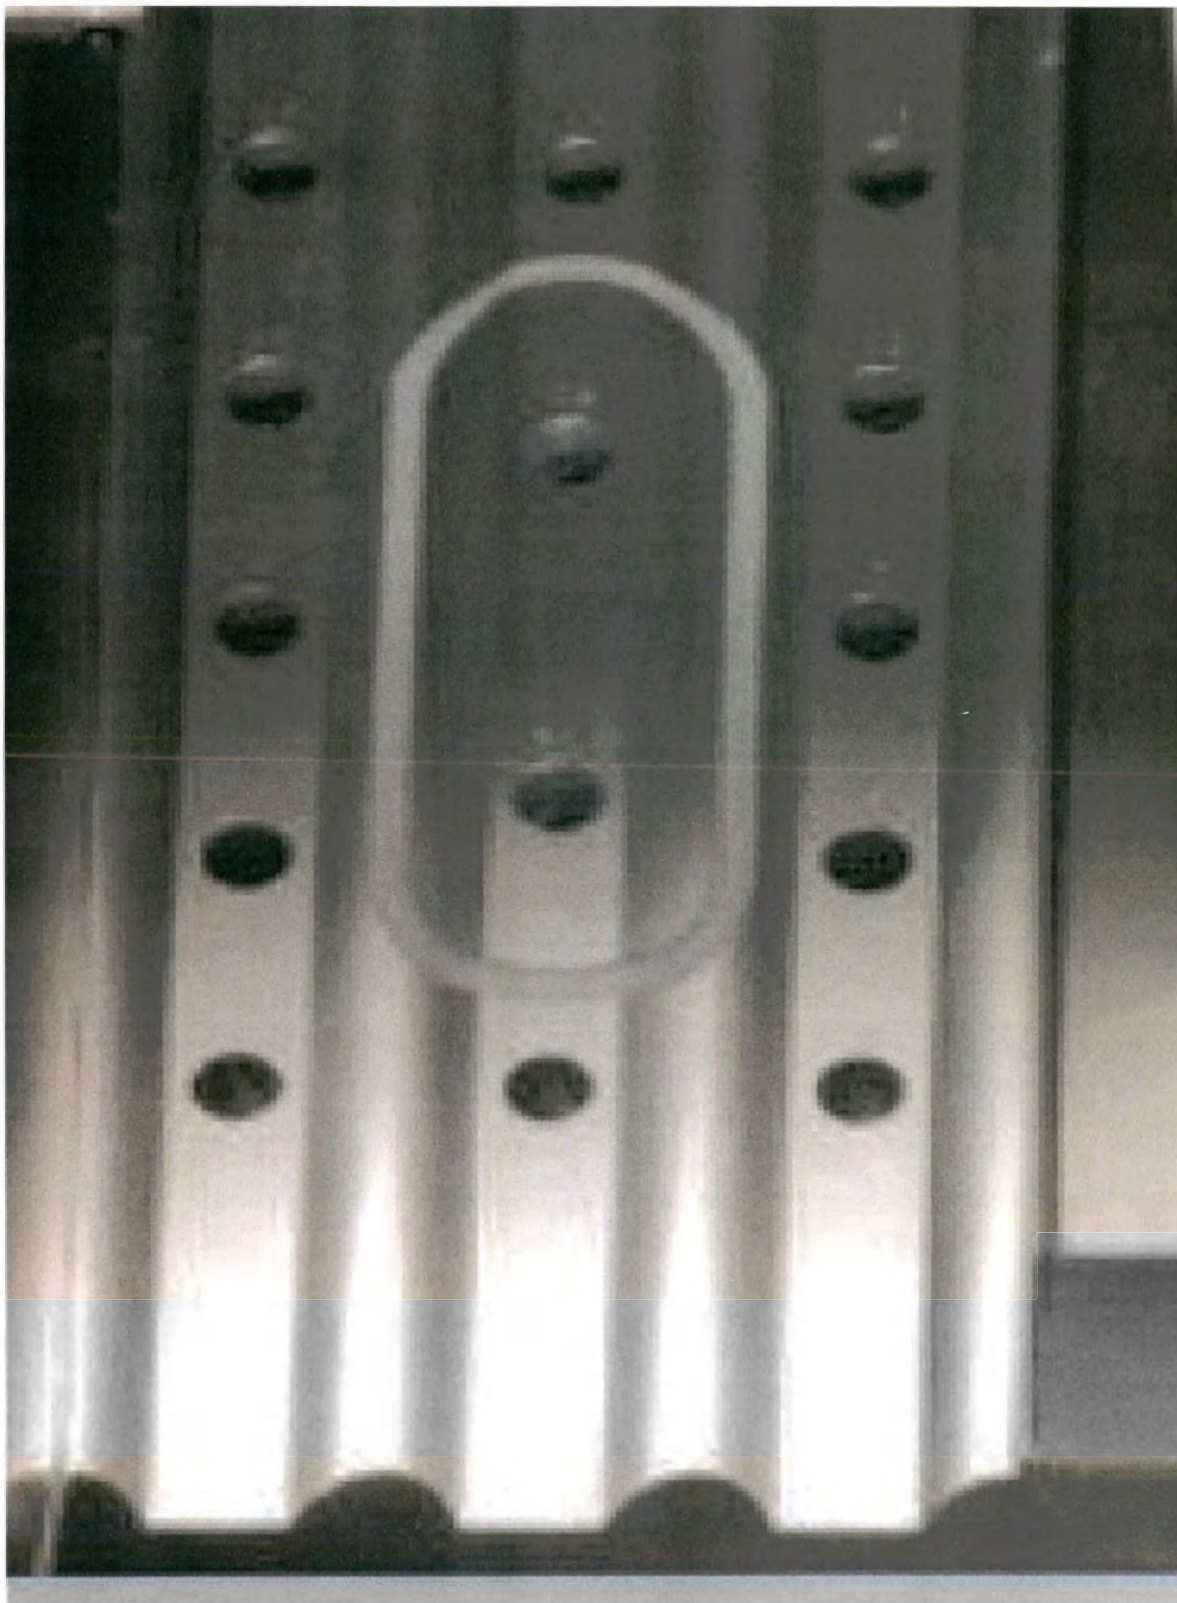

Теплоотвод, арт. 31000253



Держатель образцов, диаметр 22 мм., арт. 30000002




Держатель образцов, диаметр 35 мм., арт. 30000000




Держатель образцов, диаметр 28 мм., арт. 30000017




Держатель образцов, диаметр 50 мм., арт. 30000003

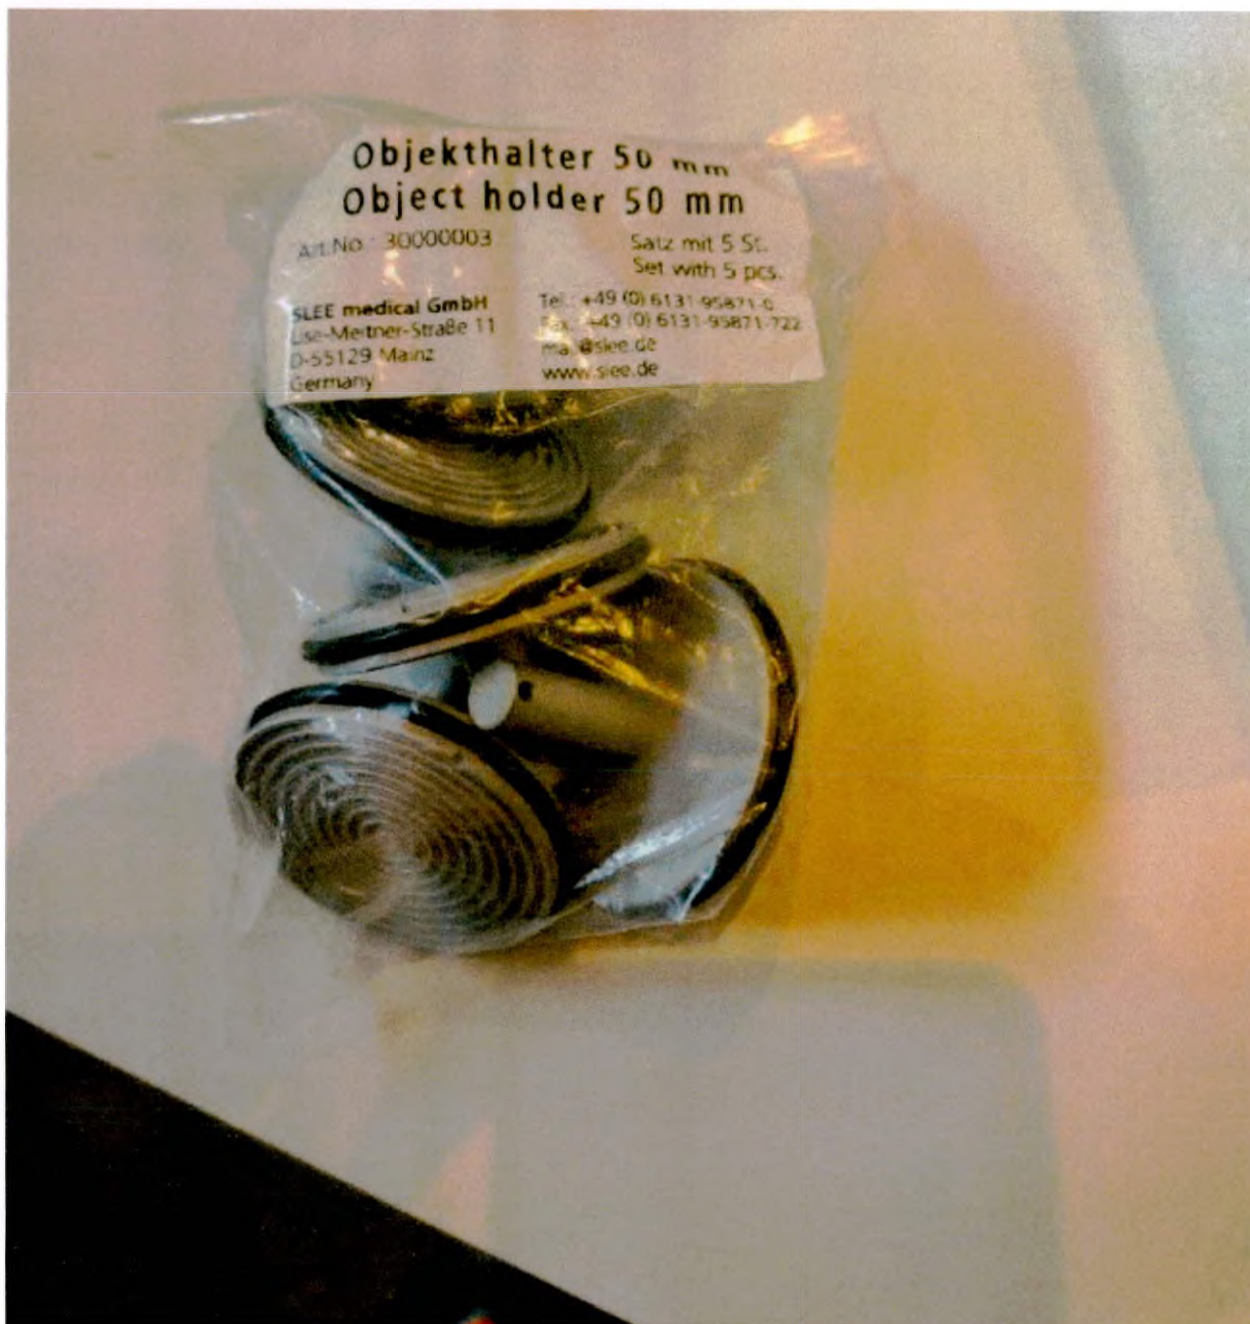

Держатель одноразовых микротомных лезвий, низкий профиль, арт. 10157005

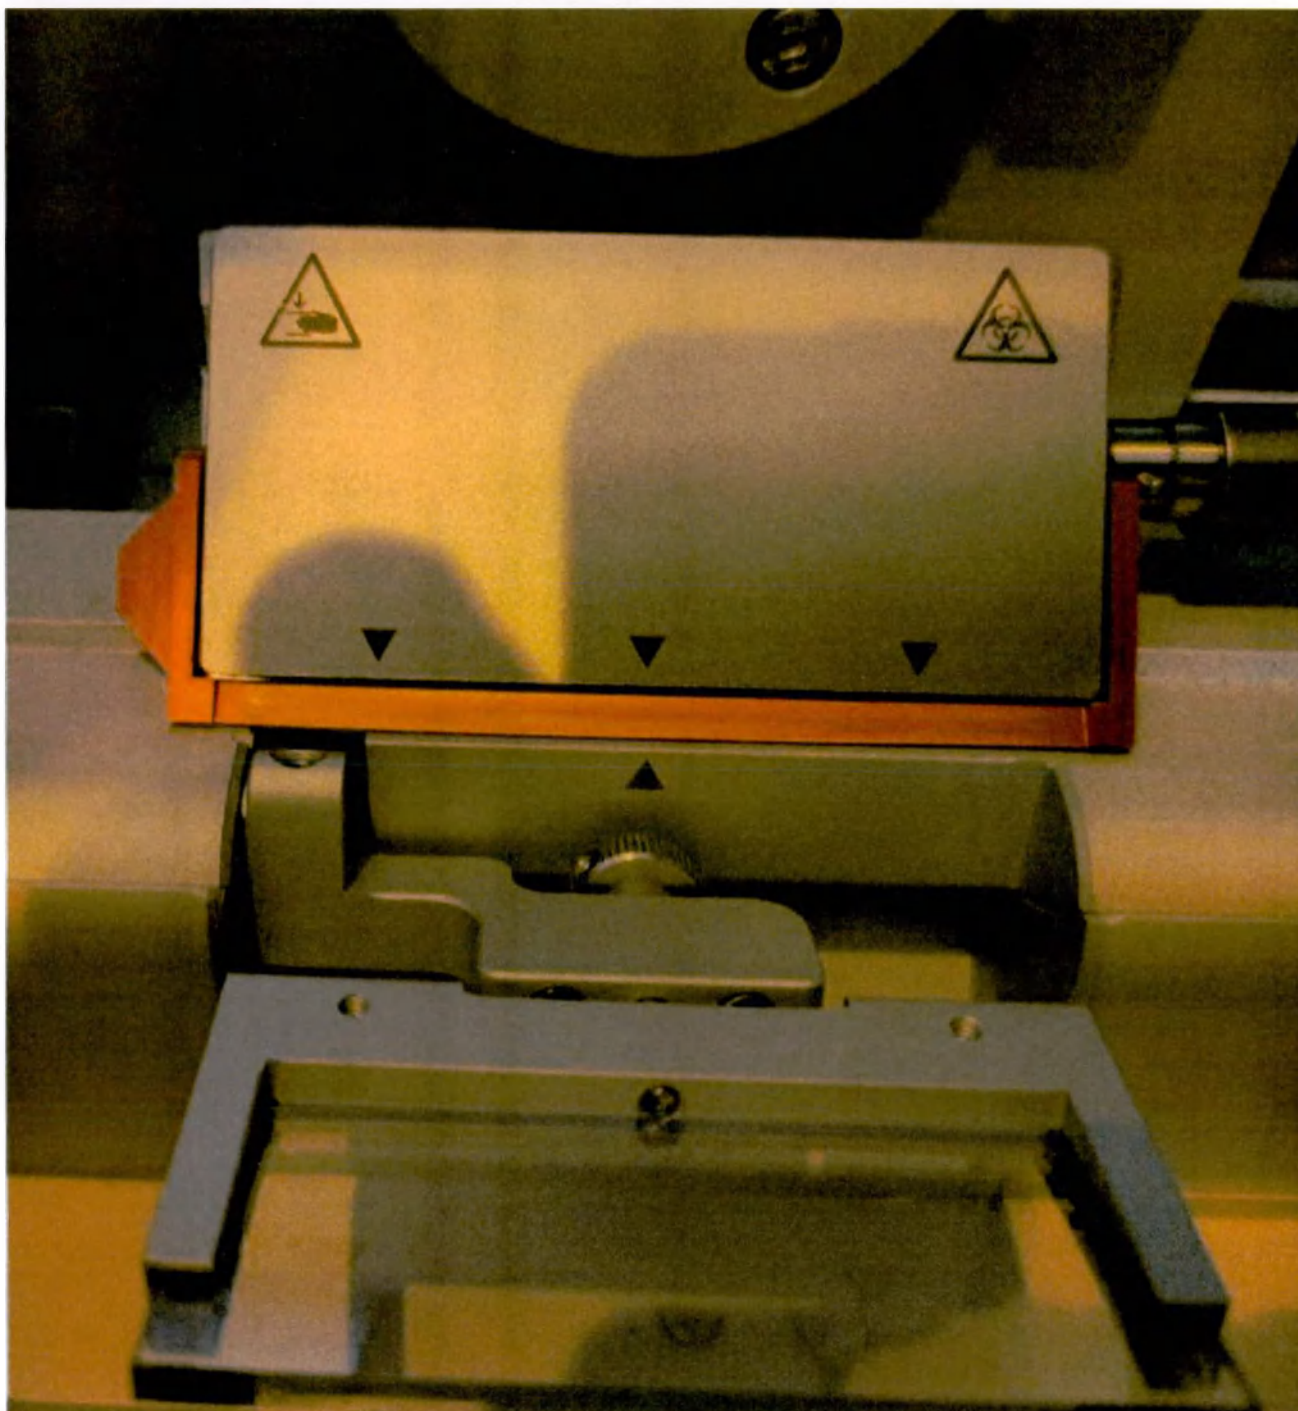


Пластина для предотвращения сворачивания среза, для одноразовых микротомных лезвий, арт. 32001050

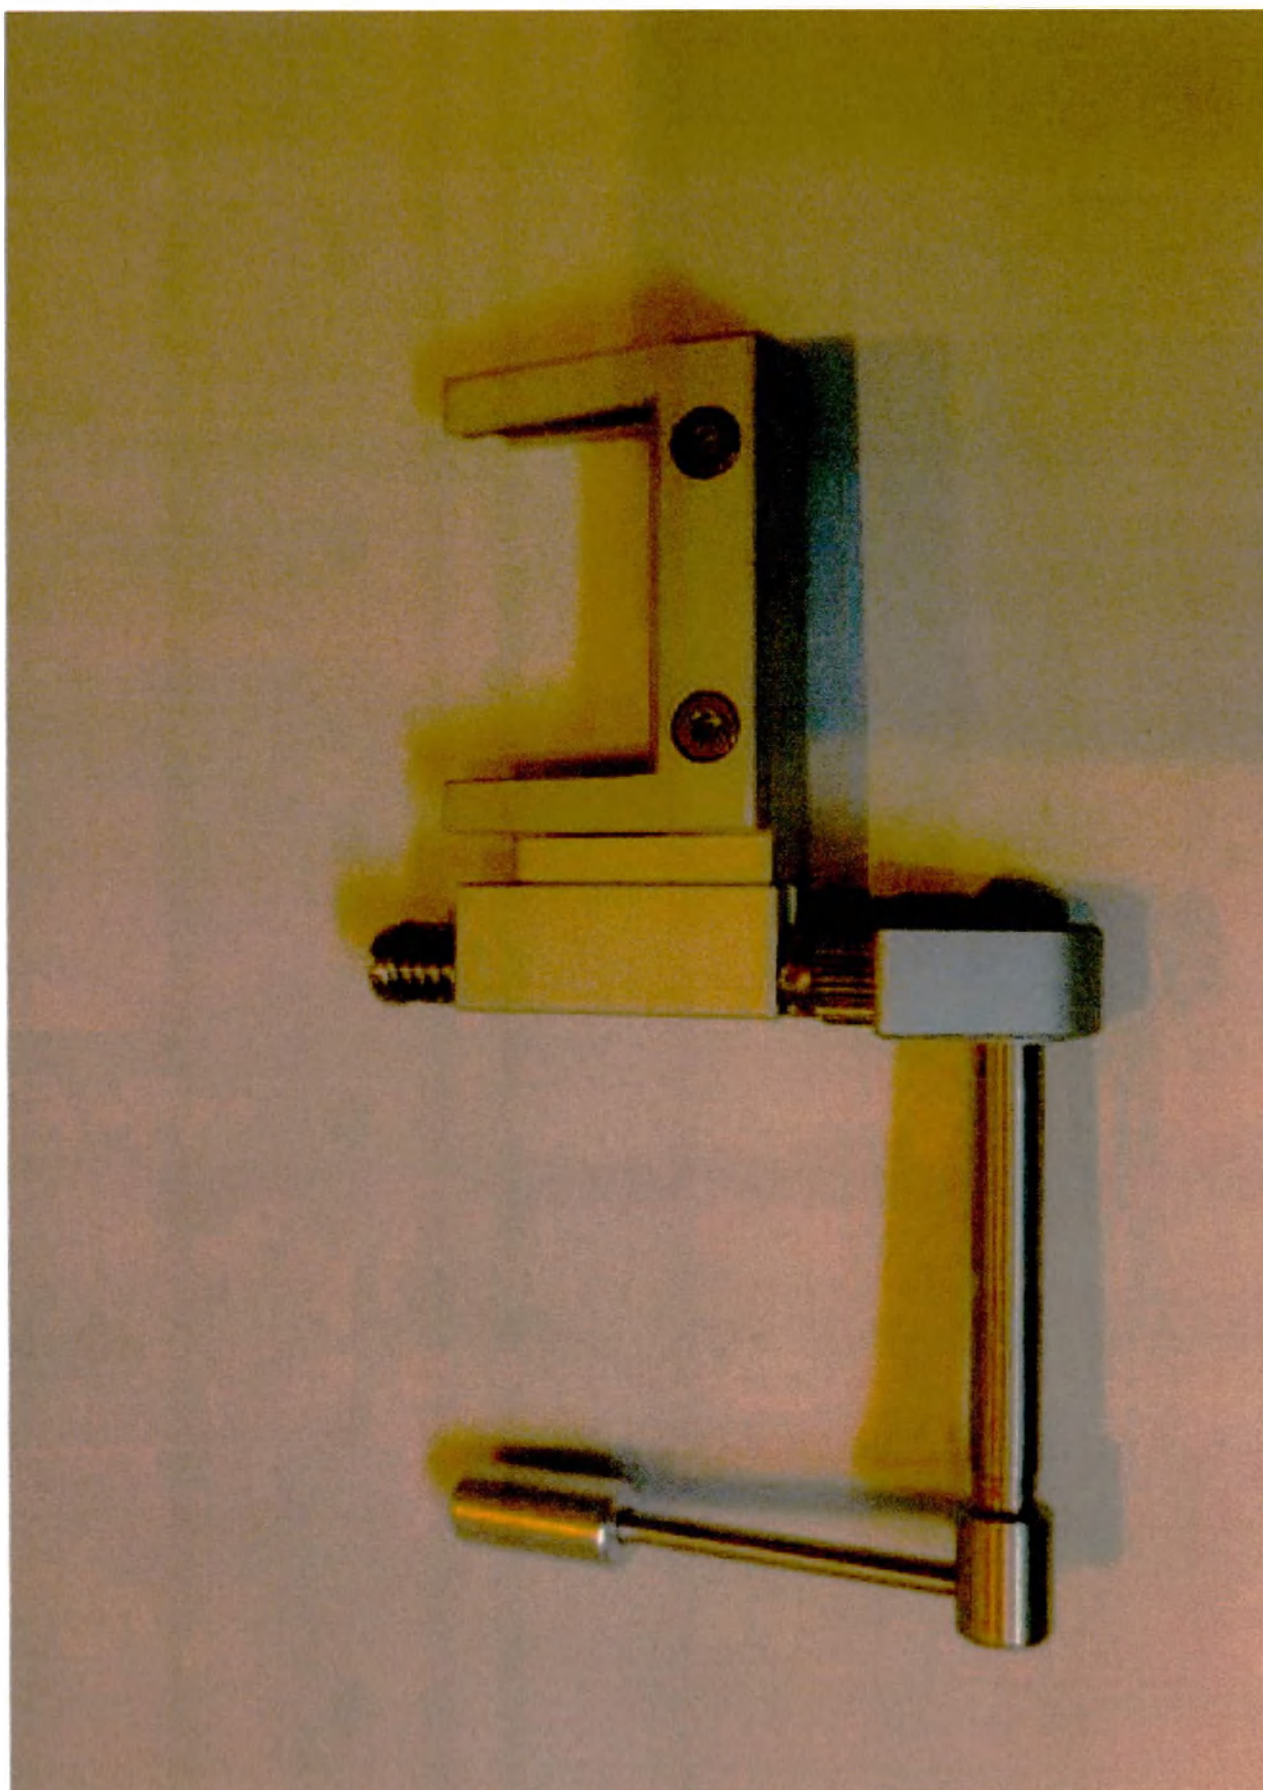


3. Шильдик

Вариант исполнения: Микротом-криостат для гистологических исследований MEV+ (MEV+ Cryostat)

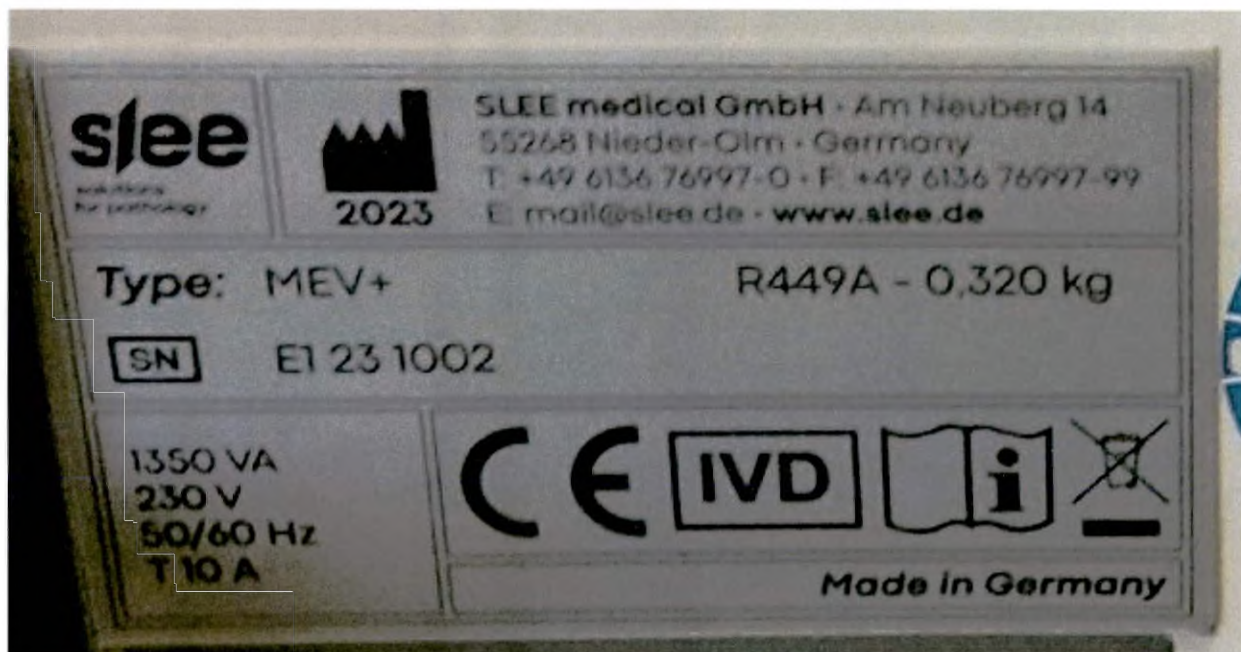

Вариант исполнения: Микротом-криостат для гистологических исследований MNT (MNT Cryostat)

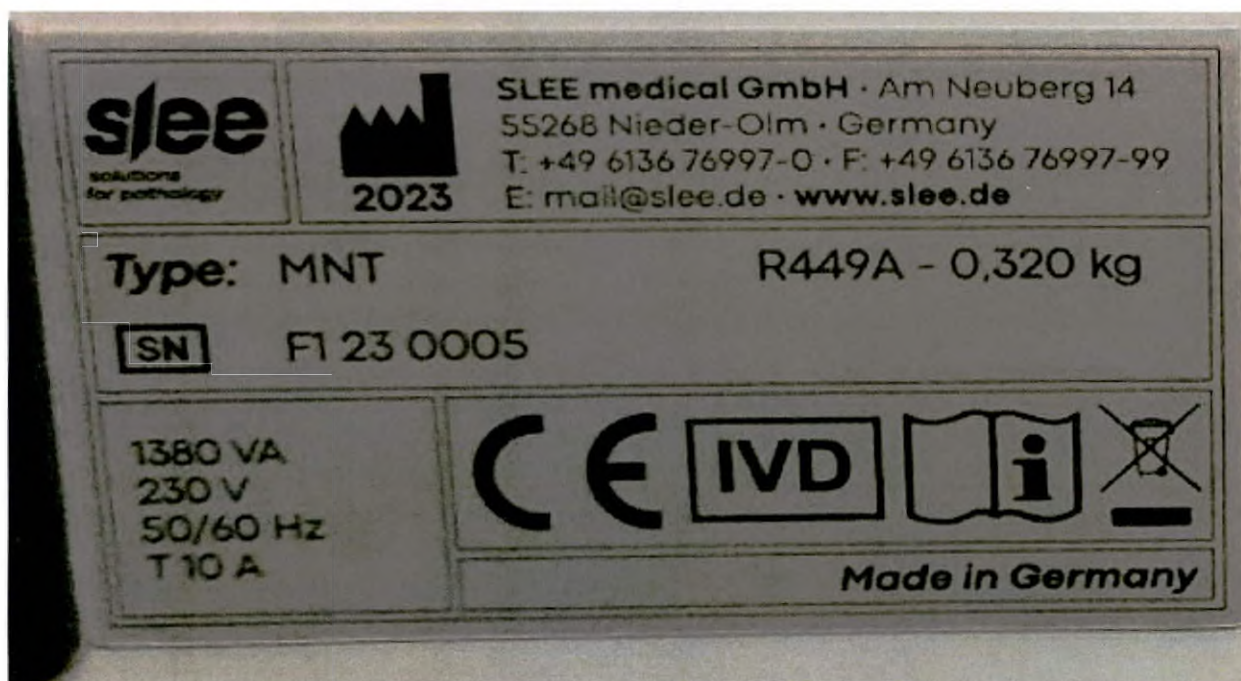

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
26 ЛИСТА(ОВ)

Генеральный директор
ООО "БиоВитрум"
Заводовский Д.В.

