

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр сертификации и регистрации медицинских изделий»



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЦСРМИ»,


Зарубина Е.А.
М.П.

«27» ноября 2018 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex в различных вариантах исполнения (Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., China)


2018

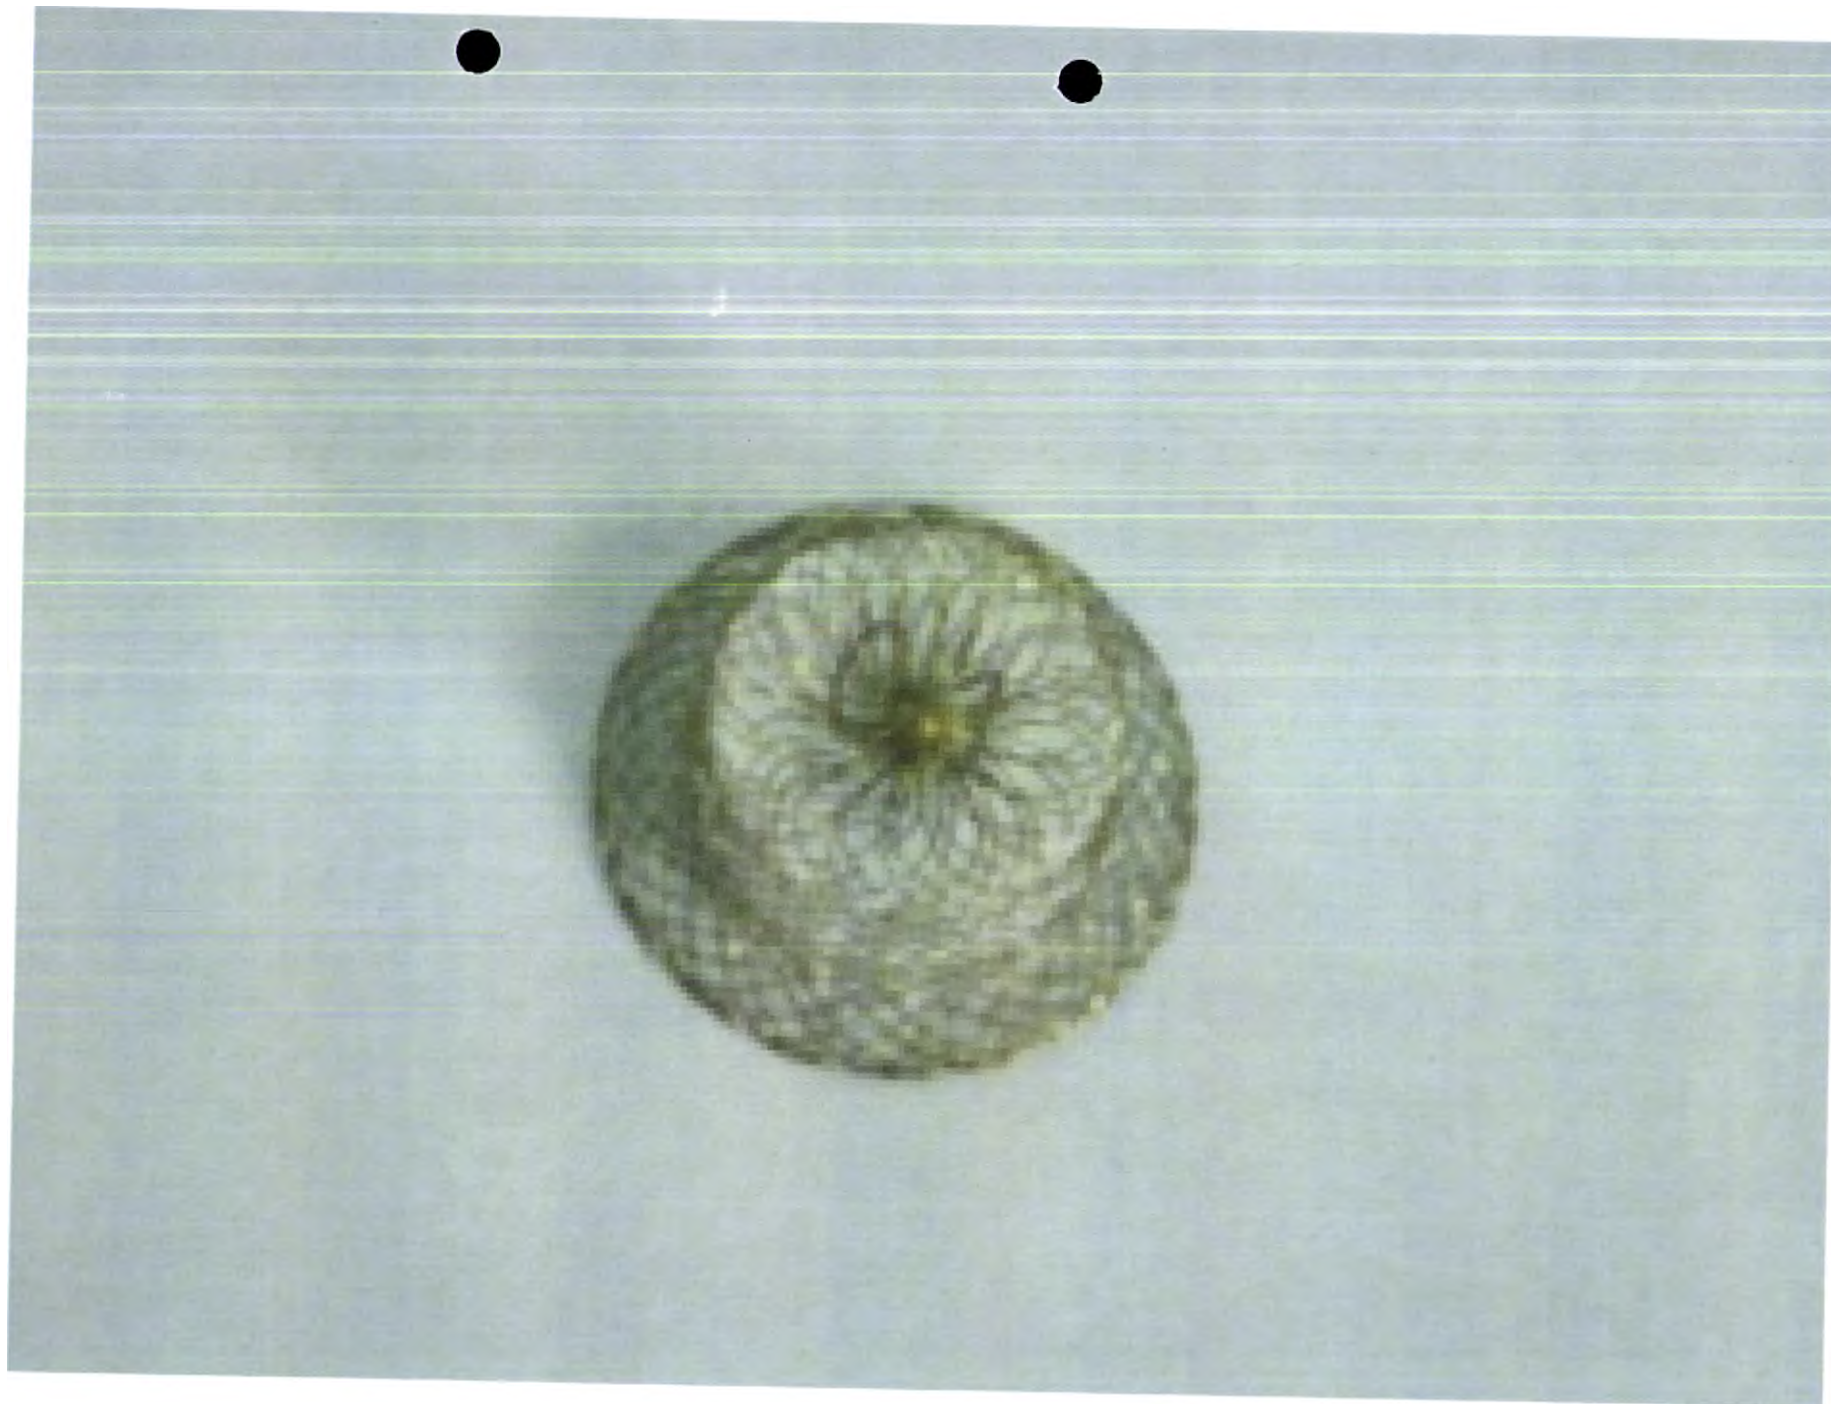


Окклюдер CeraFlex (вид спереди).

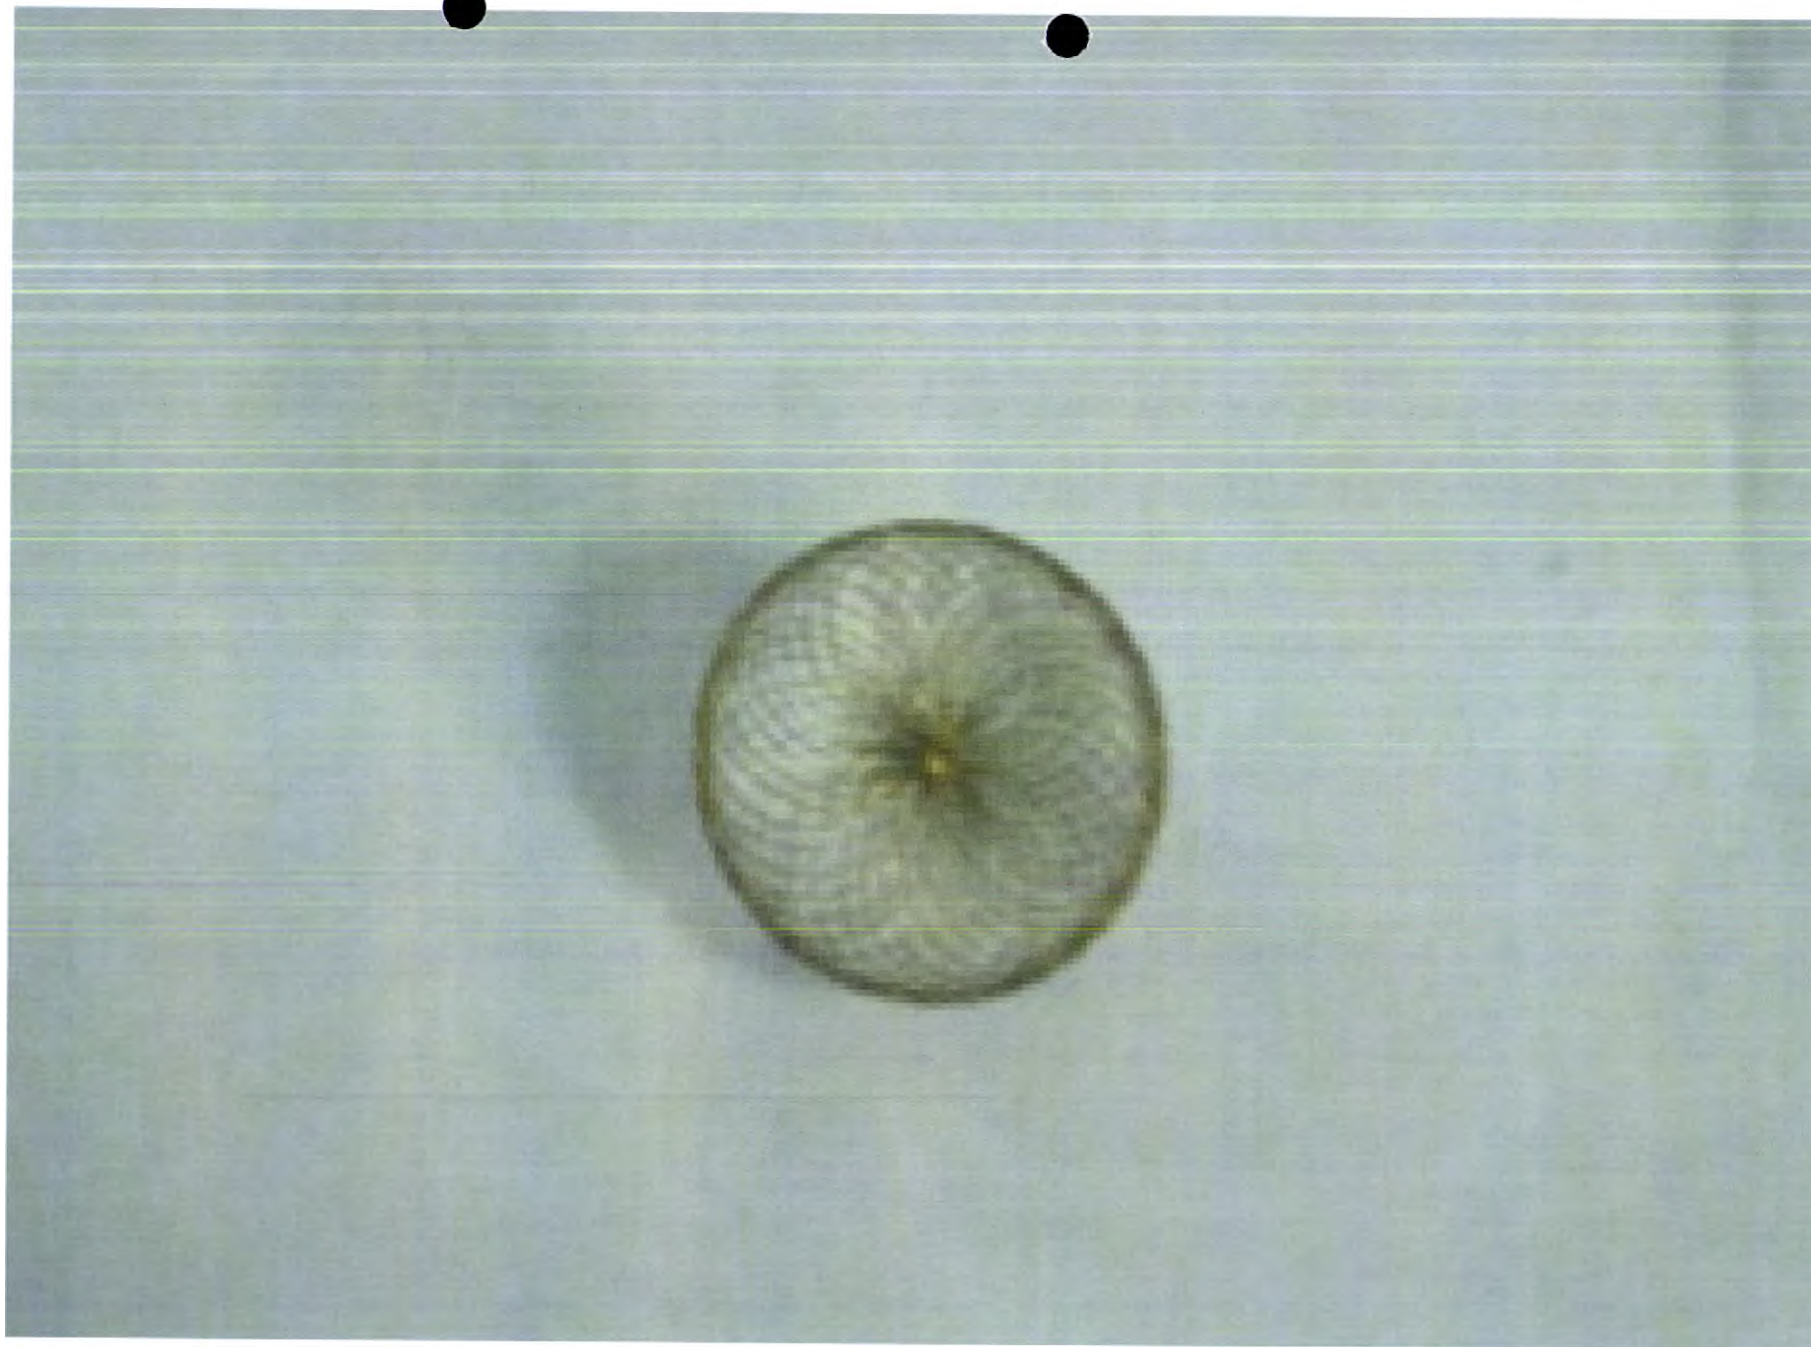


Окклюдер CeraFlex (вид сзади).

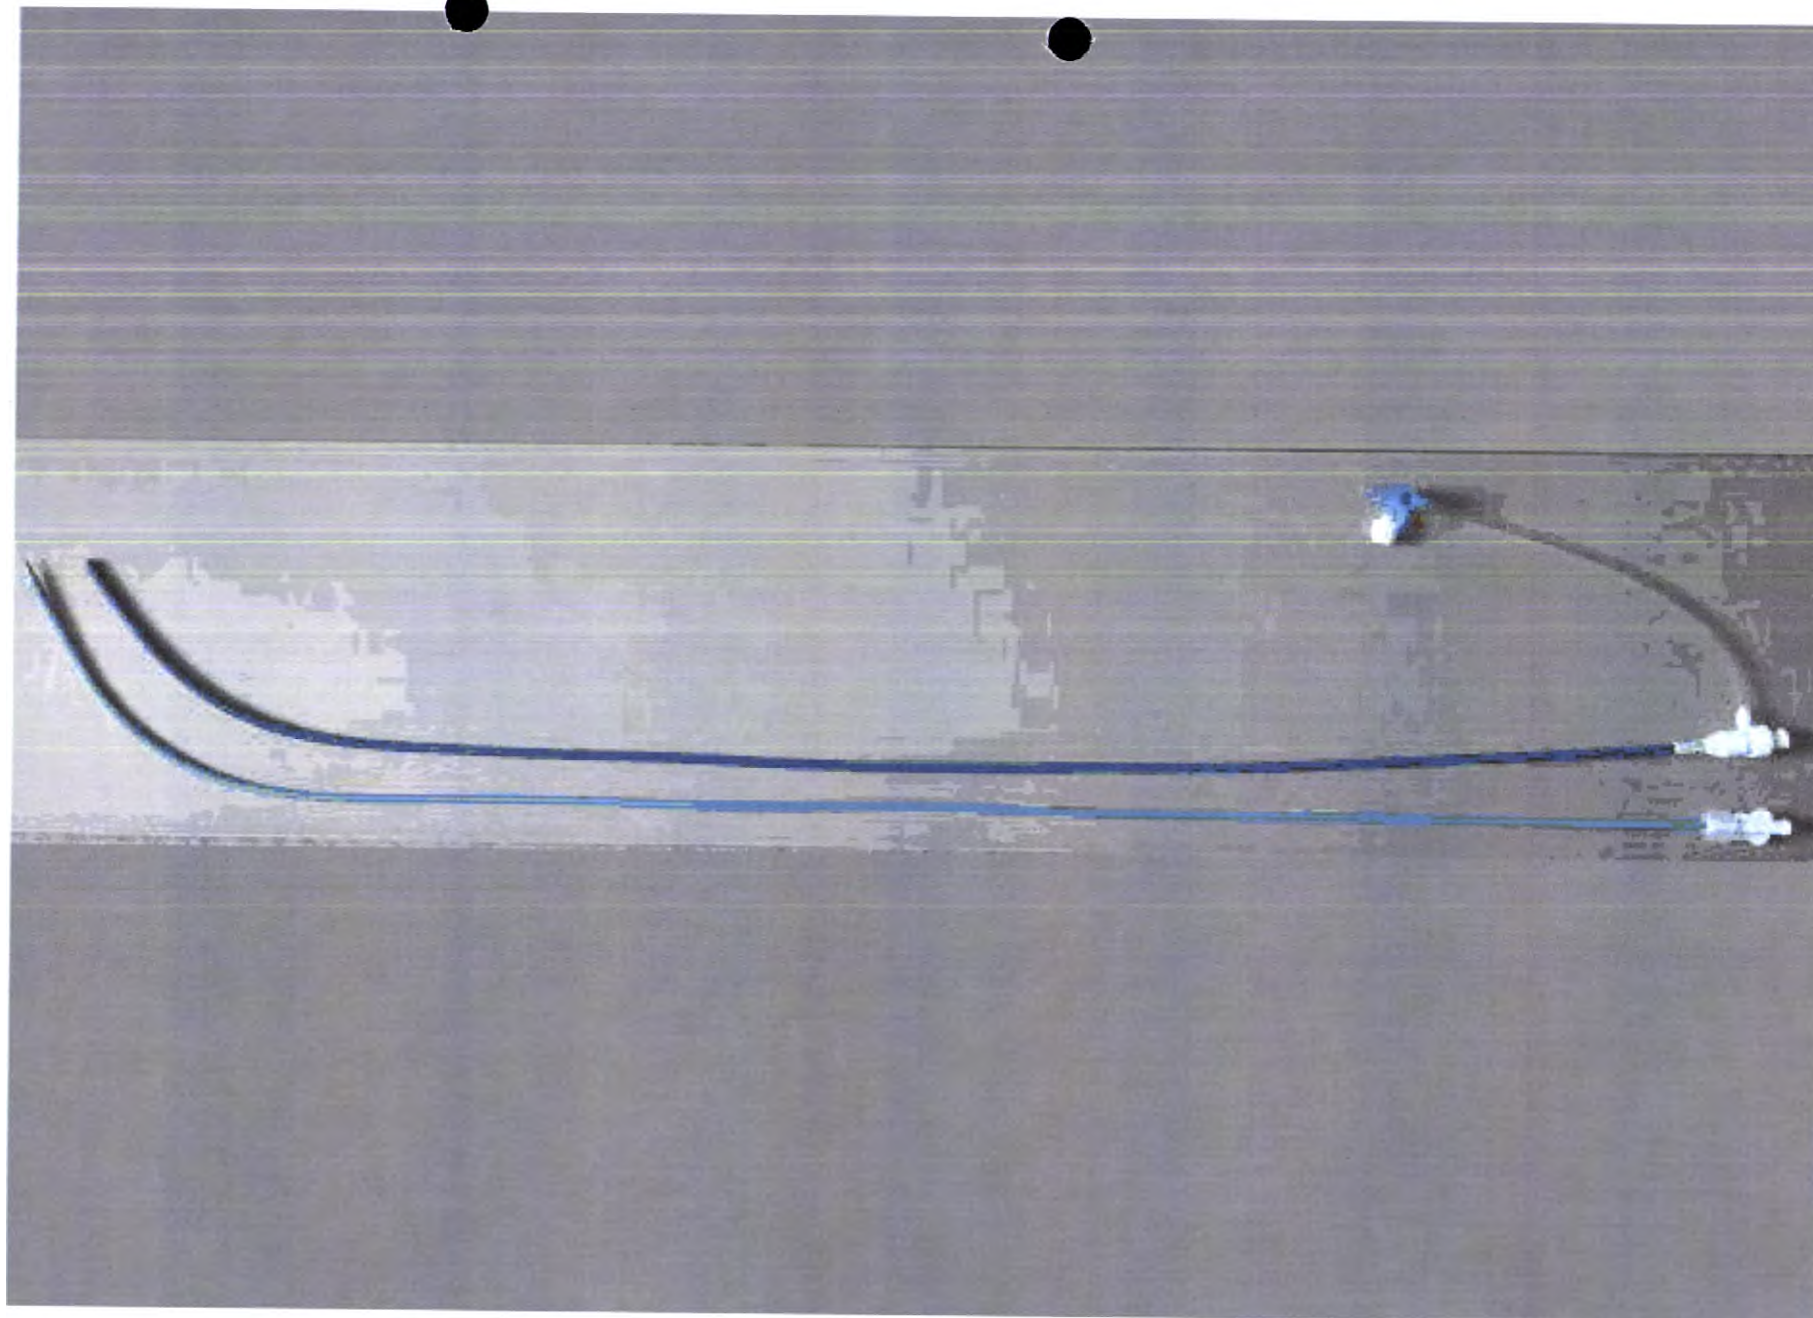


Интродьюсер SteerEase; Расширитель.

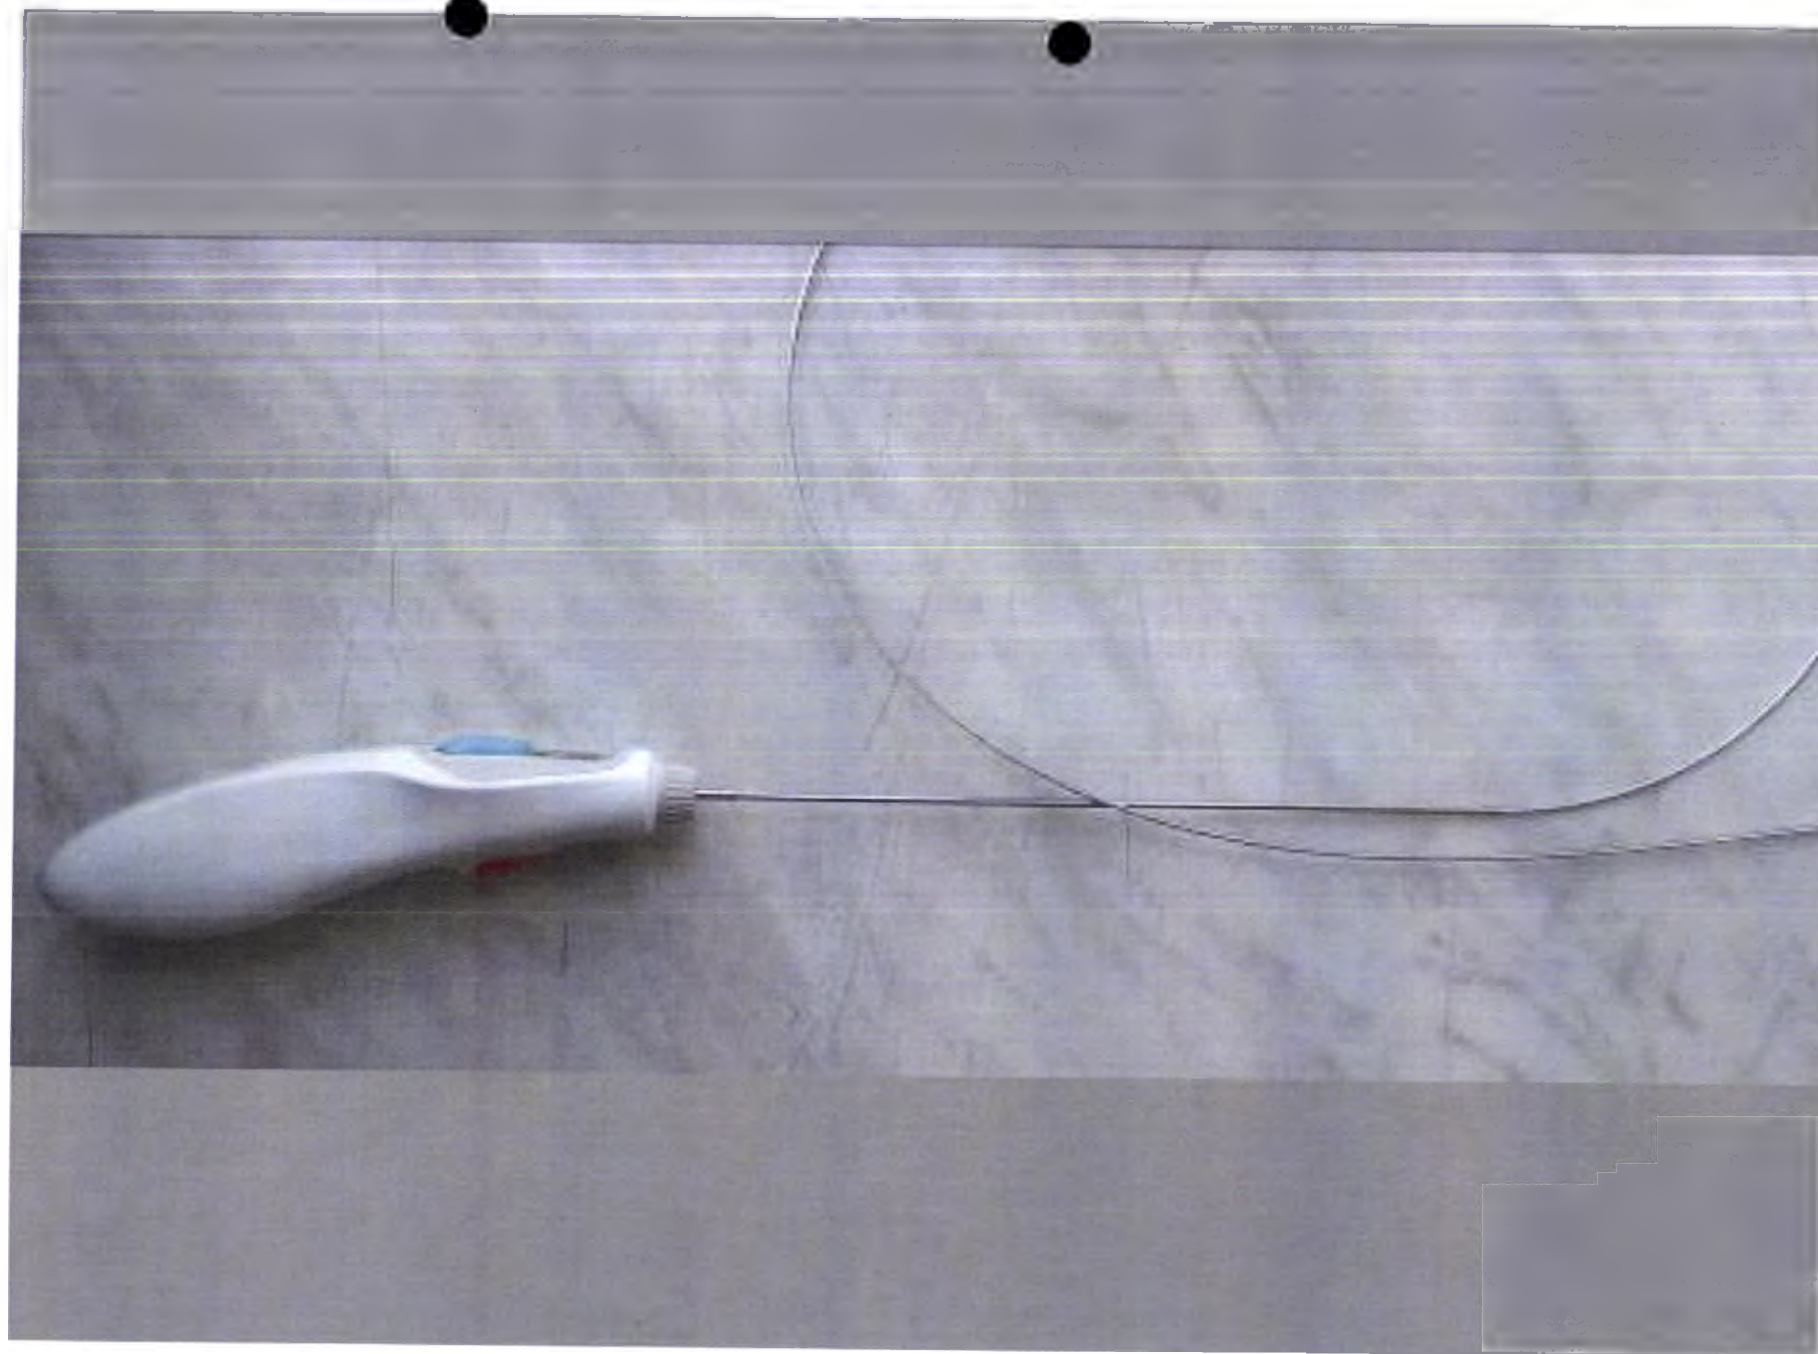

Кабель доставки с пластиковыми тисками/рукояткой (проксимально).

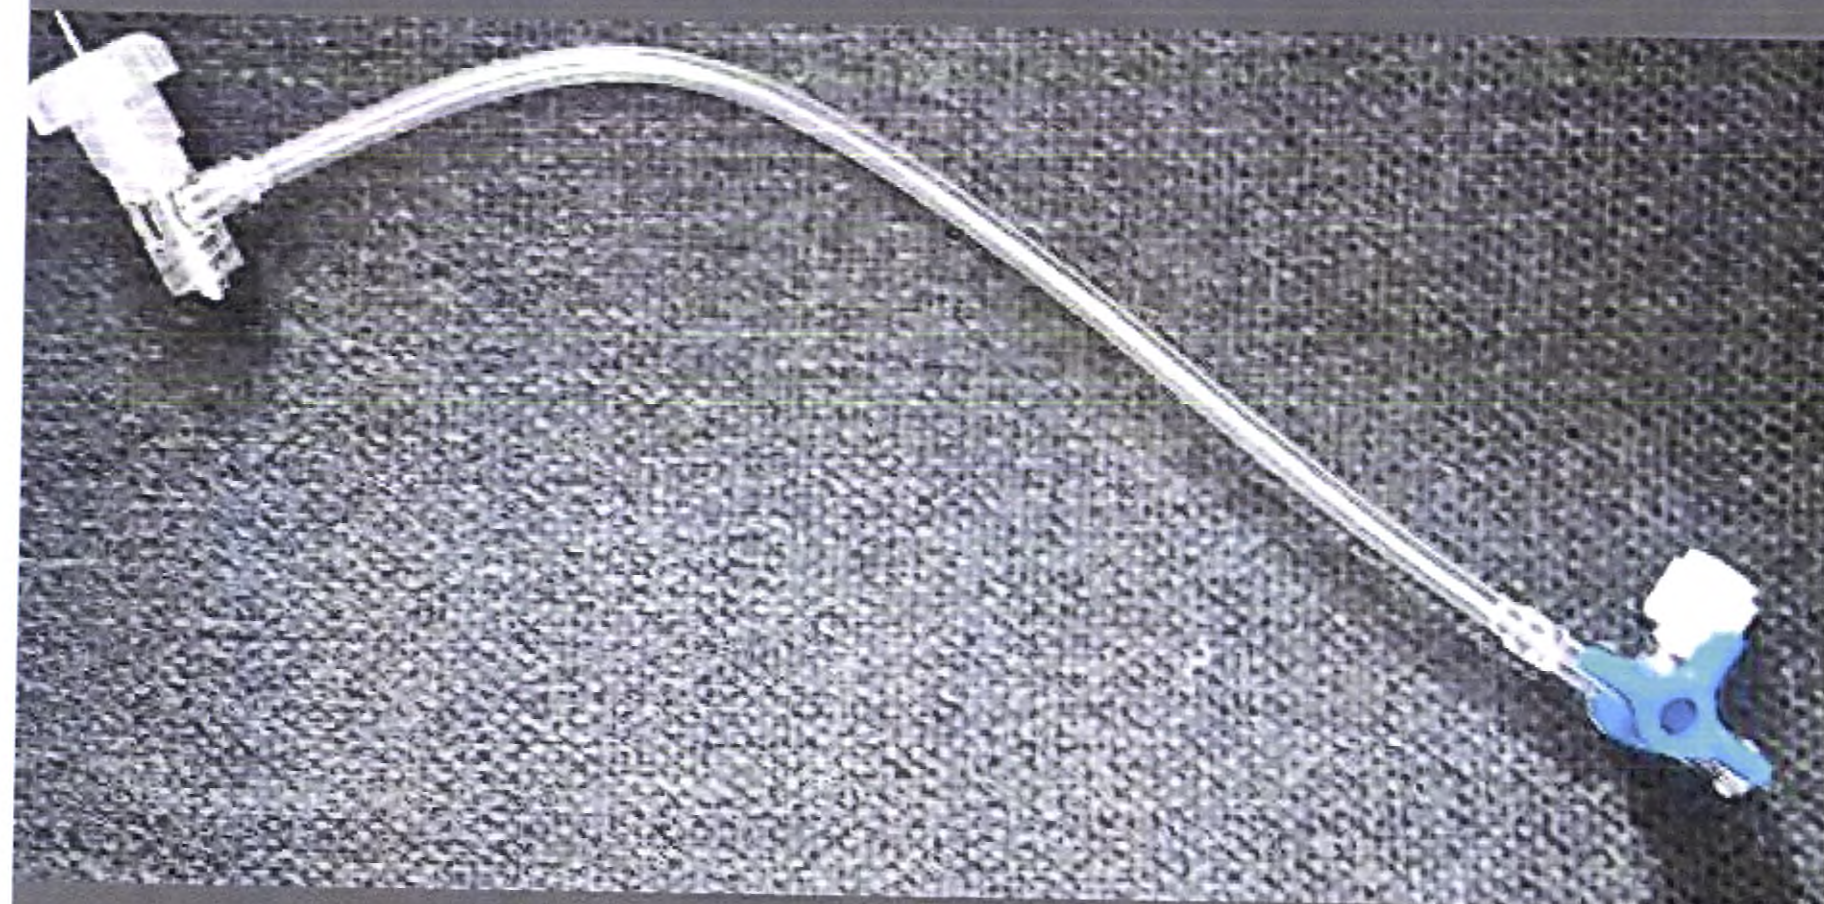

Гемостатический клапан.

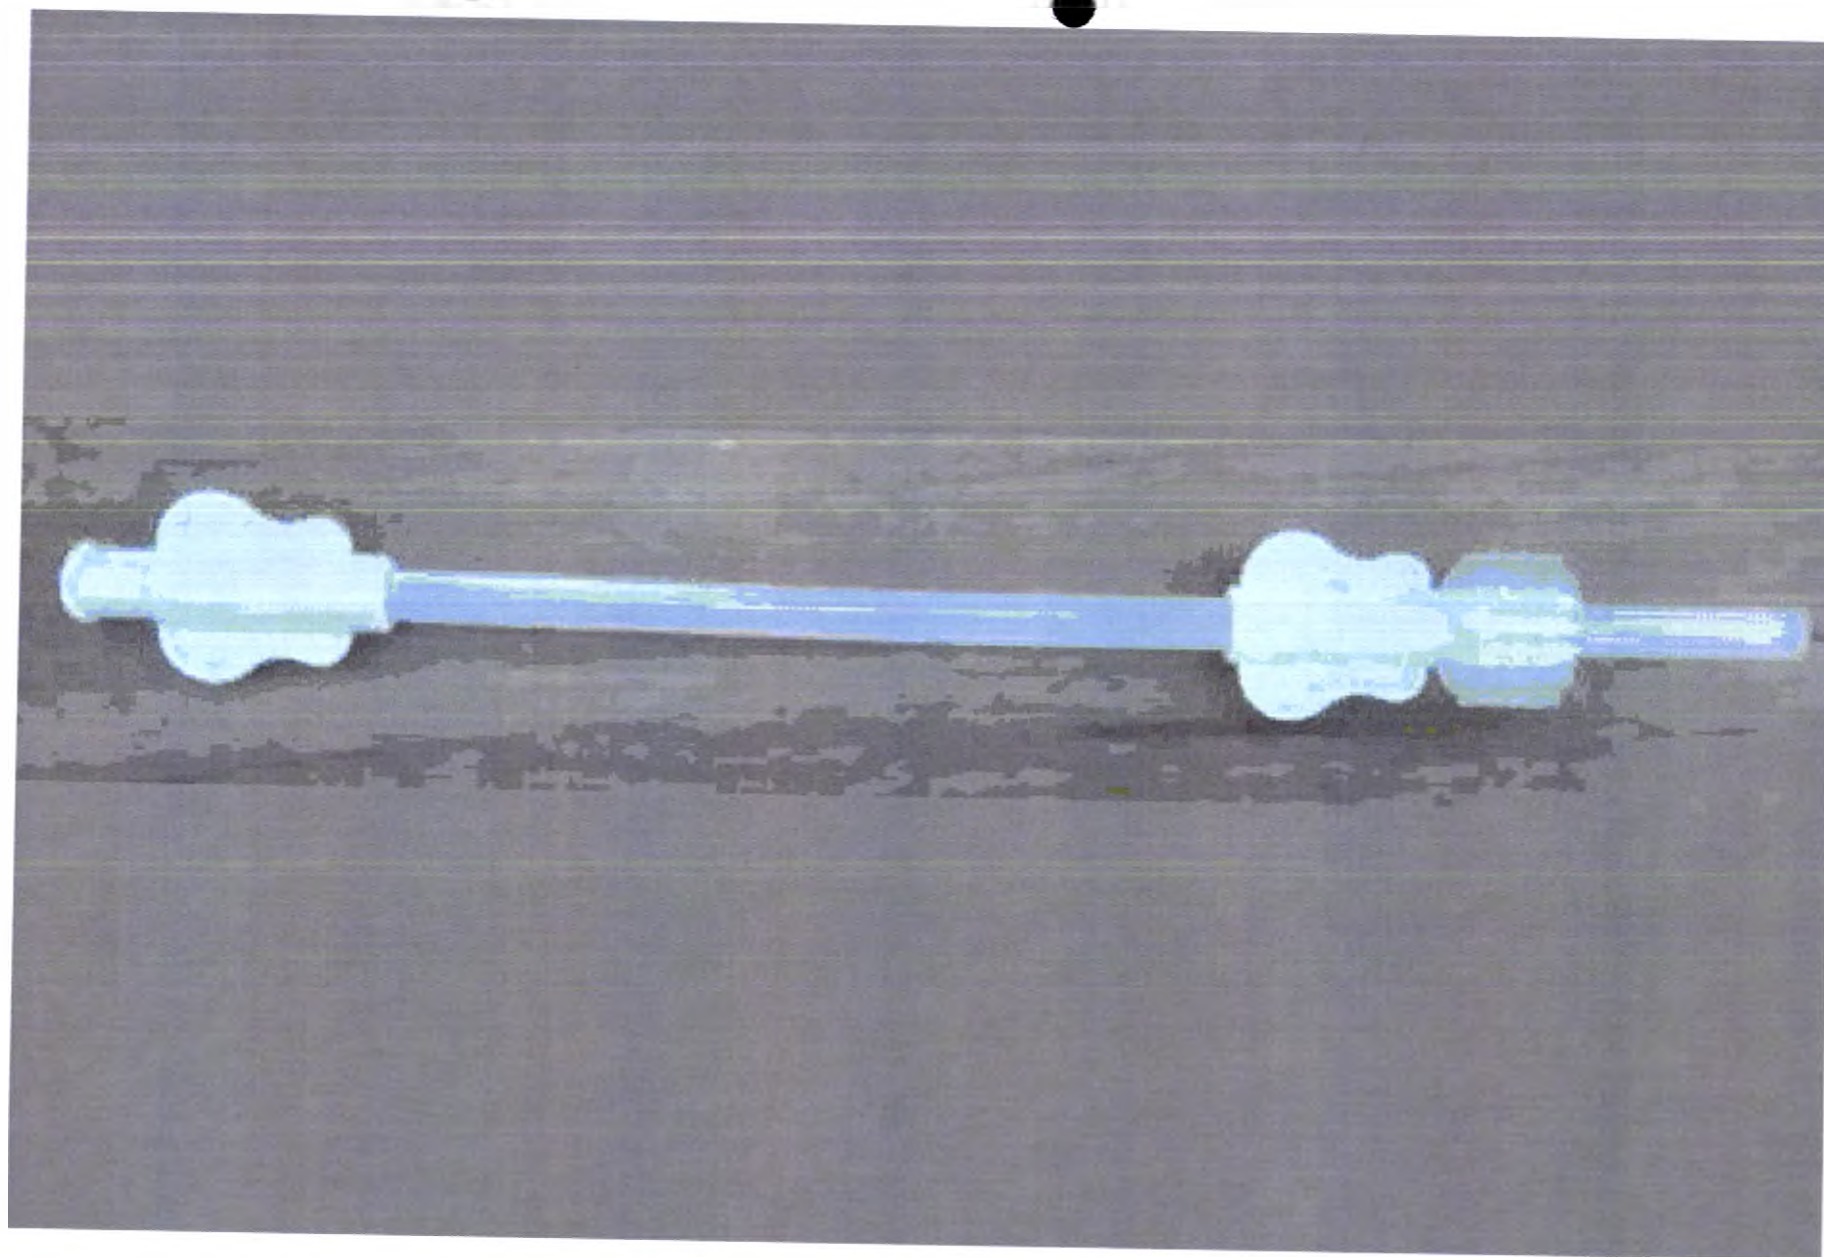


Загрузчик.



Ceraflex 24
Atrial Septal Defect Occluder

[illegible]

LT-ASD-24	171037	1710379389
2017-10-26	2017-10-26	
10mm	10mm	

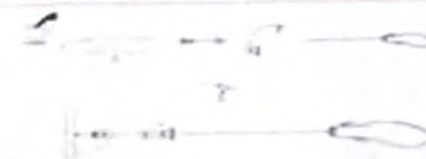

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1710370389), (упаковка вторичная, вид спереди).

Lifetech

Atrial Septal Defect Occluder

Ceraflex™


REF

LT-ASDf-24




2020-10-25

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1710370389), (упаковка вторичная, вид сбоку).

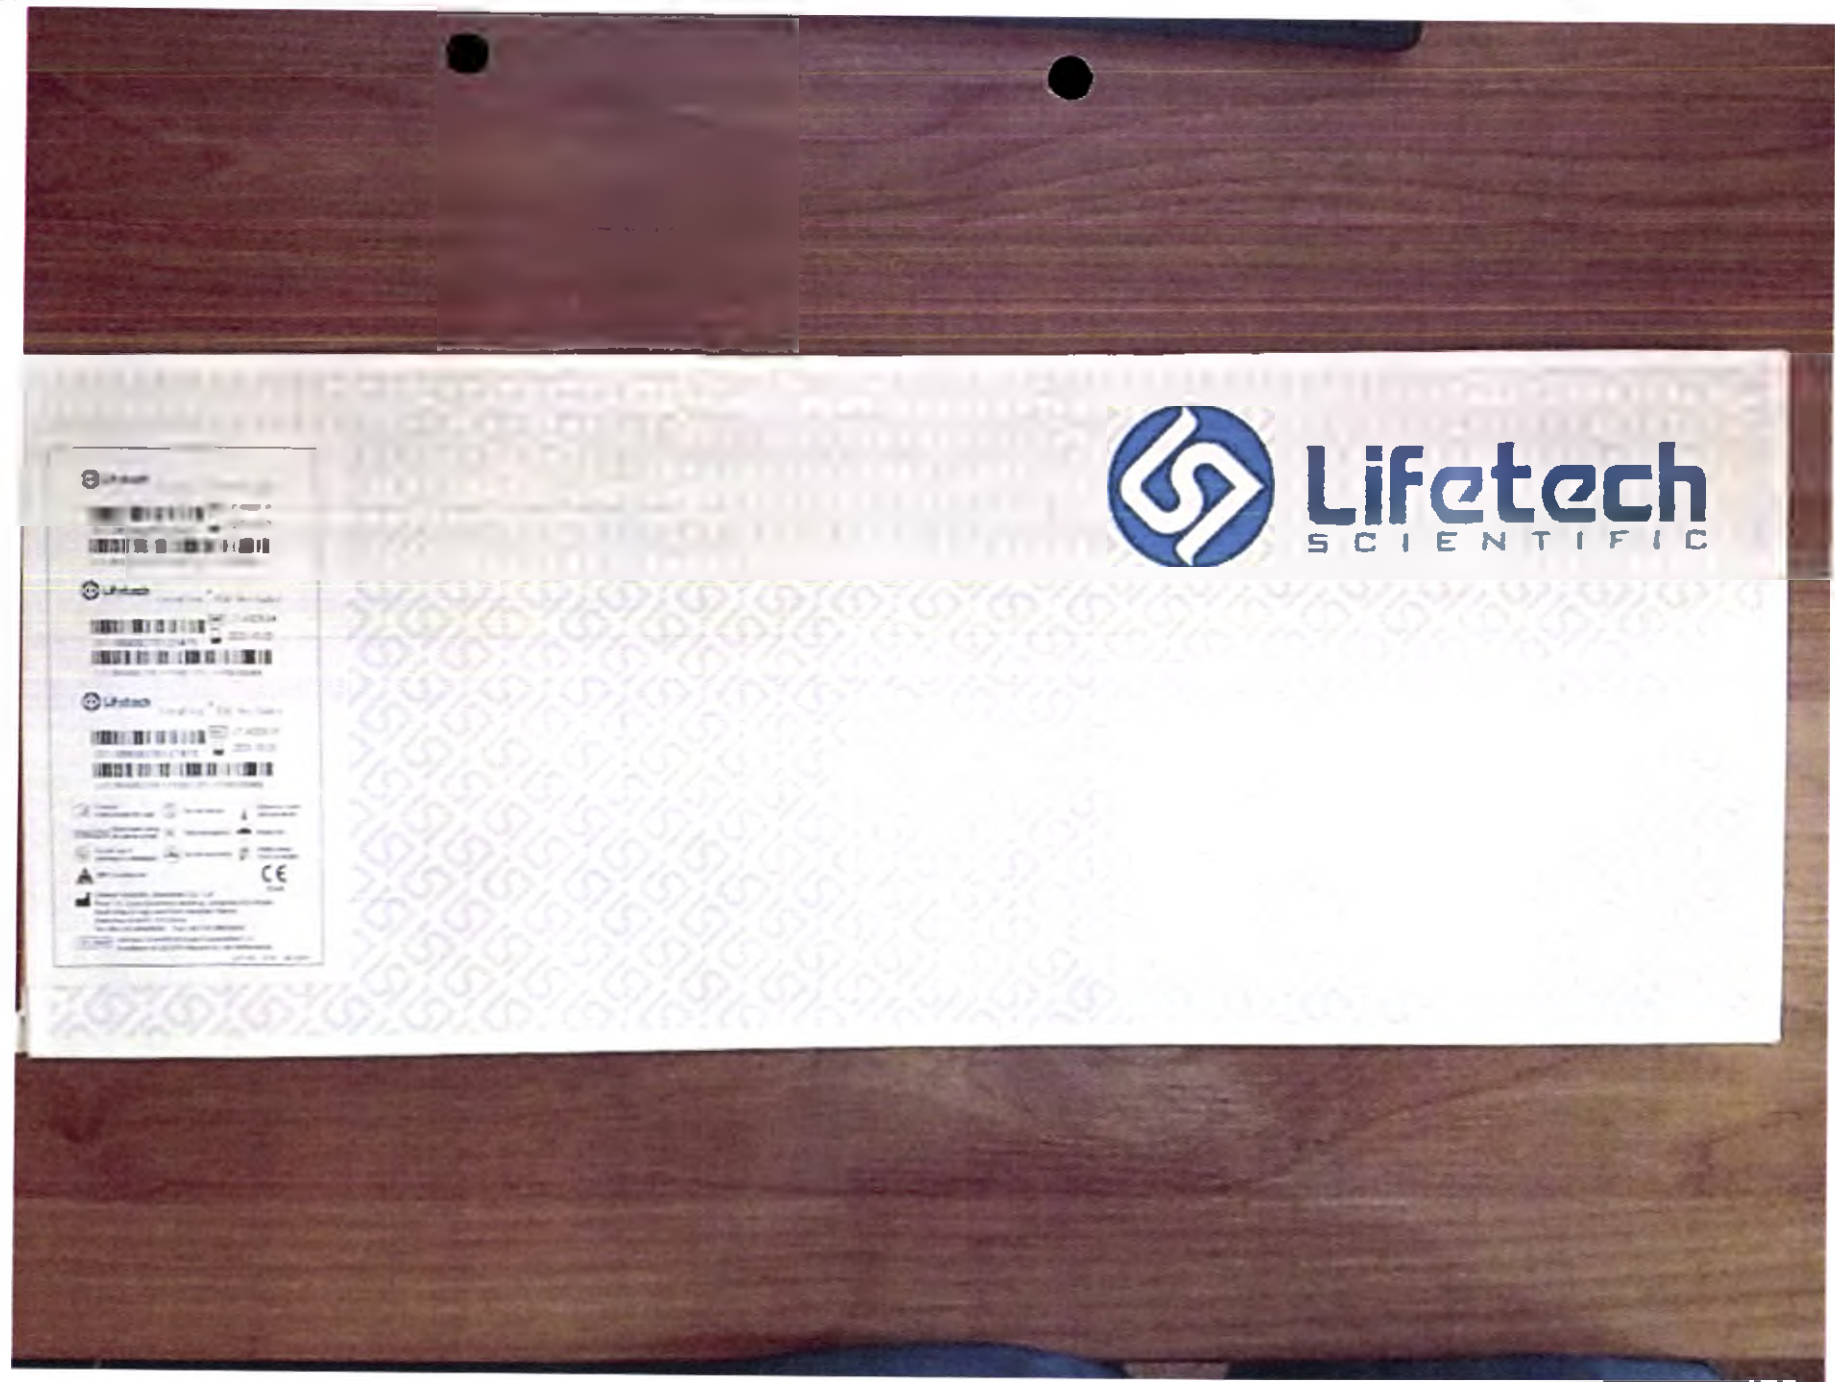

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1710370389), (упаковка вторичная, вид сзади)

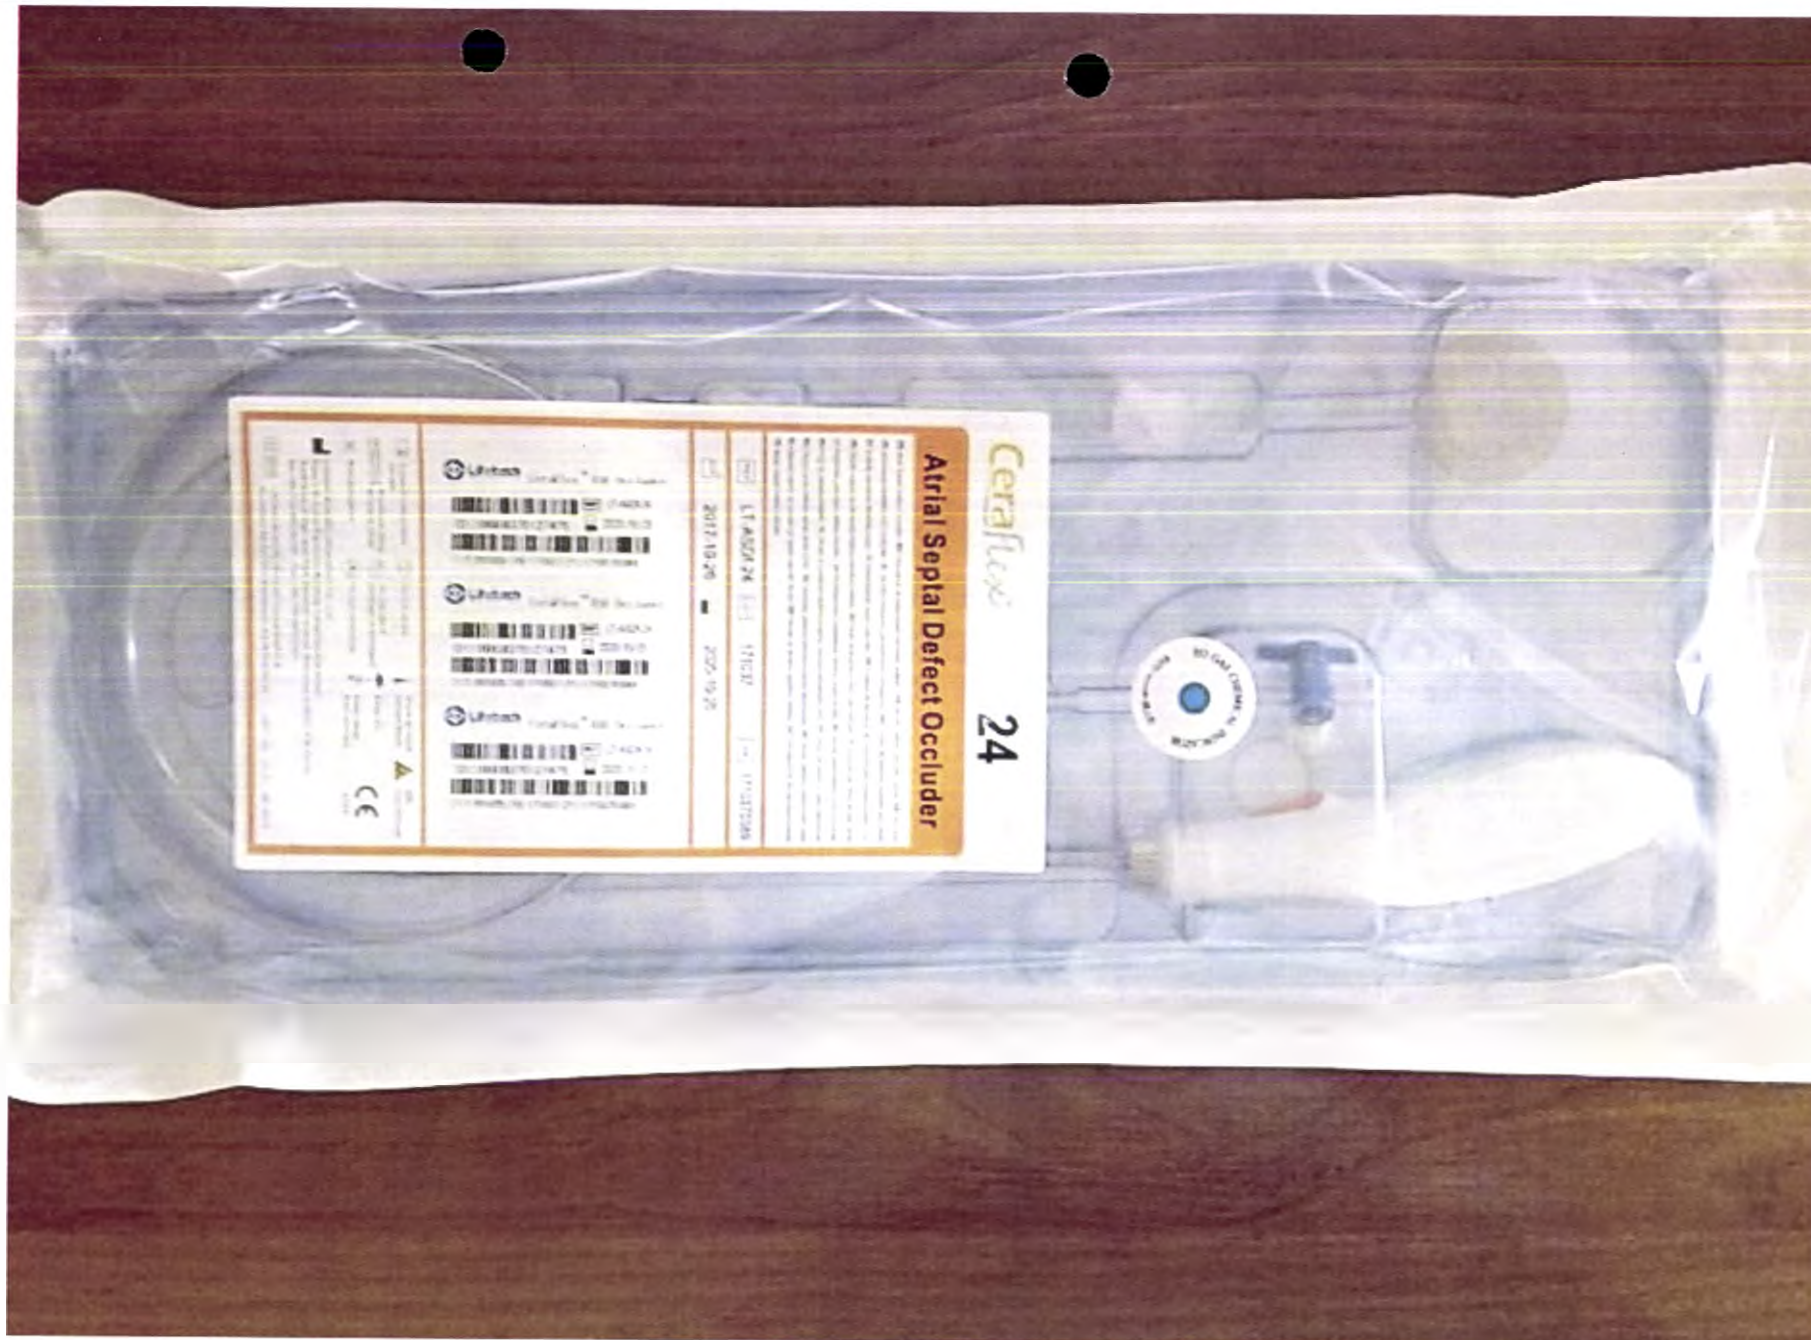

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1710370389),
(упаковка первичная, внешний вид изделия).



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1710370389), (руководство пользователя).

SteerEase™ SFA12F-f

Introducer

EN Introducer / BG Въвеждащ / CS Zaváděč / DA Indfører / DE Einführung / EL Εισαγωγέας / ES Introducir
ET Sisestaja / FI Sisäläinviija / FR Introducteur / HR Uvođnica / HU Bevezető / IT Introduuttore / LT Įvedimo įrenginys
LV Ievadišanas ierīce / NL Introducer / NO Innfører / PL Introduktor / PT Introduzidor / RO Introducator / RU Введущий
SK Zavádzáč / SL Uvedjalo / SR Uvođnik / SV Införare / TR Introduktör

REF SFA12F-f LOT 170933 SN 1709330104

2017-09-30 2020-09-29

800mm 4.8mm 4.1mm



LifeTech SteerEase™ Introducer

SFA12F-f
(01) 06938370125273 2020-09-29
(17) 200929 (10) 170933 (21) 1709330104

LifeTech SteerEase™ Introducer

SFA12F-f
(01) 06938370125273 2020-09-29
(17) 200929 (10) 170933 (21) 1709330104

LifeTech SteerEase™ Introducer

SFA12F-f
(01) 06938370125273 2020-09-29
(17) 200929 (10) 170933 (21) 1709330104

LifeTech SteerEase™ Introducer

SFA12F-f
(01) 06938370125273 2020-09-29
(17) 200929 (10) 170933 (21) 1709330104

Consult instructions for use

Sterilized using ethylene oxide

Non-pyrogenic

Do not reuse

Do not use if package is damaged

Do not resterilize

Store at room temperature

Keep dry

Keep away from sunlight


CE 0344

LifeTech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.
Floor 3-4, Cyto Electronic Building, Langshan 2nd Street, Nantian Area of High-Tech Park,
Nantian District, Shenzhen 518007, P.R. China
Tel: +86-755-85038250 Fax: +86-755-85028281

LifeTech Scientific Europe GmbH
Kraibitzweg 84, 82229 Pfaffenhofen, Germany

LS5-69 V1.7 08-2014

Интродьюсер SteerEase, модель SFA12F-f (LOT 1709330104), (маркировка вторичной упаковки)

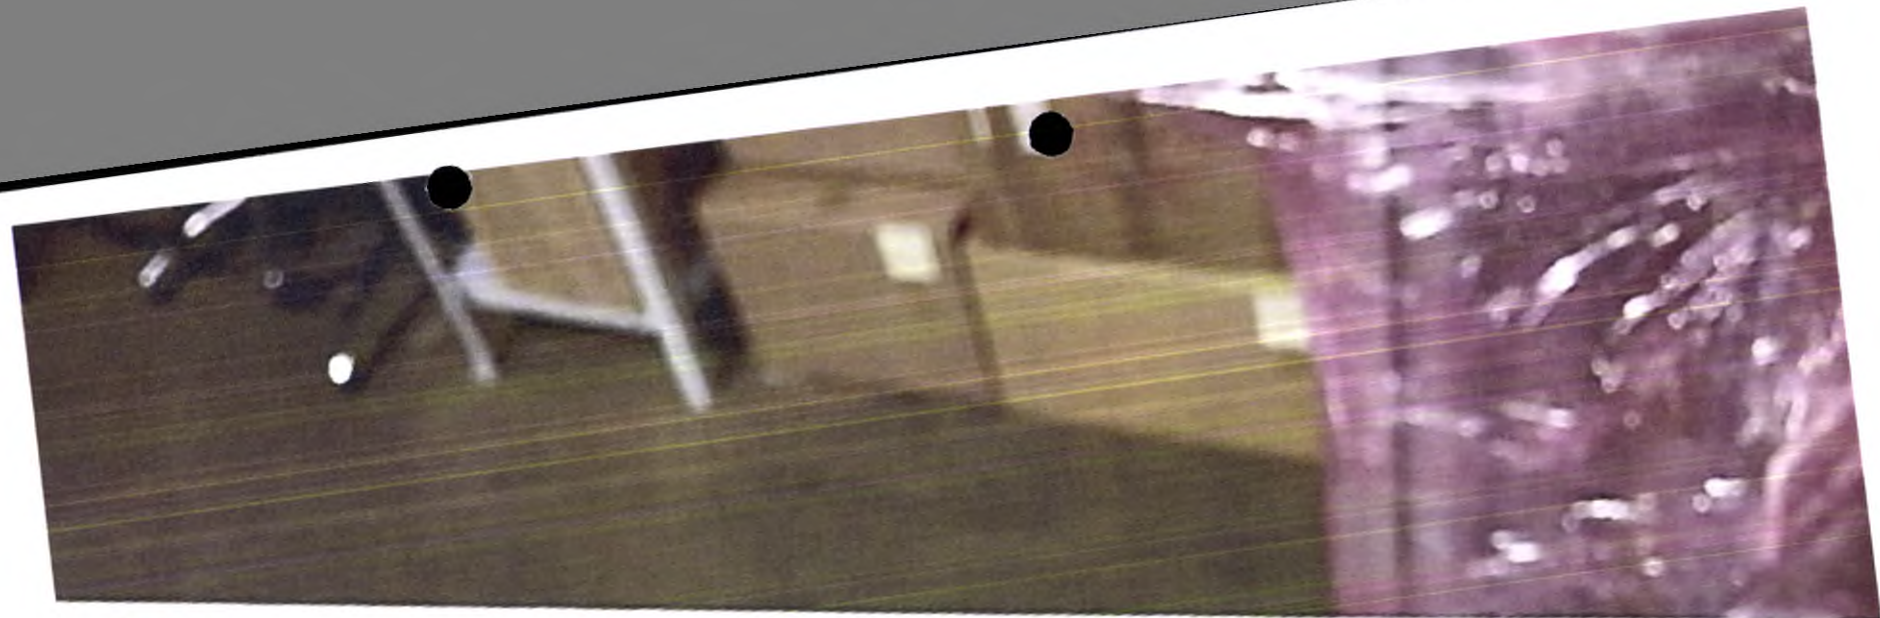


SteerEase™
Introducer

REF SFA12F-f

LOT 170933

2020-09-29

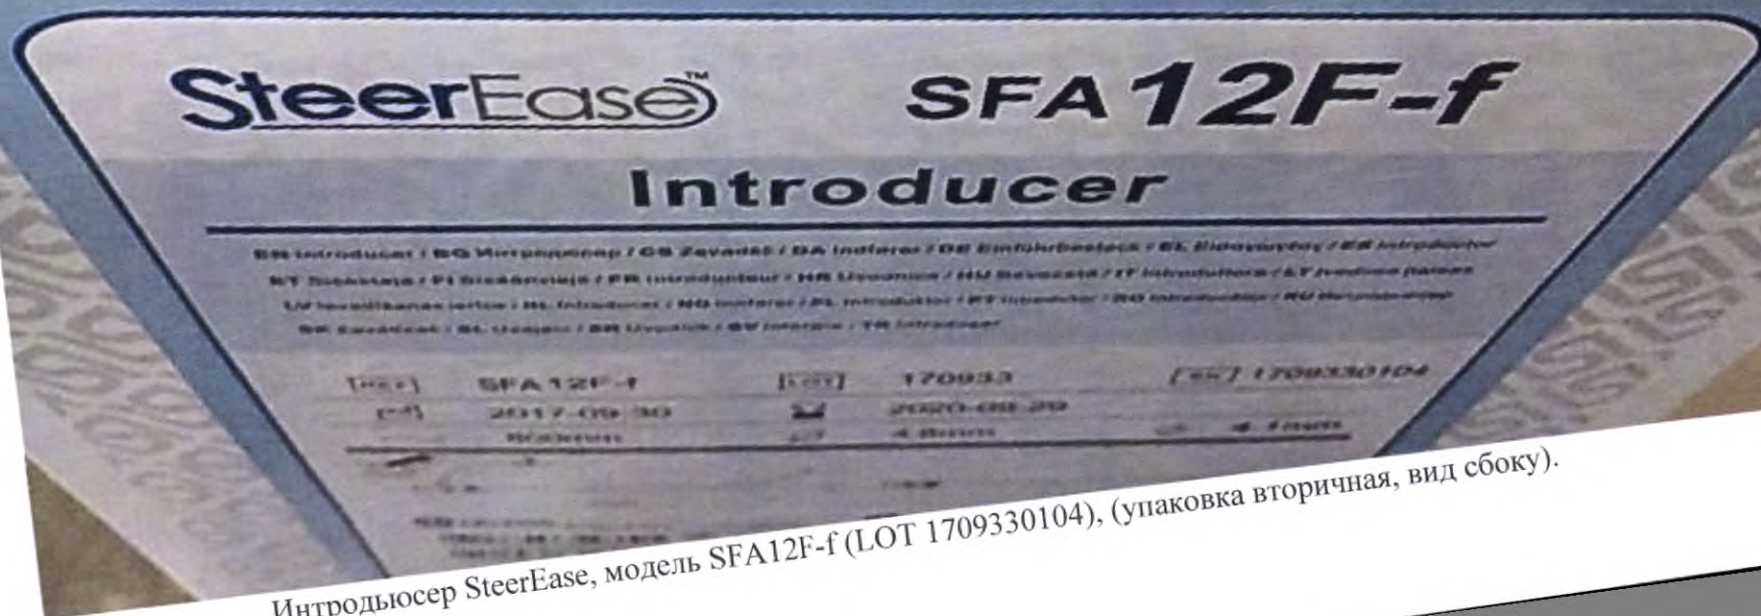

Интродьюсер SteerEase, модель SFA12F-f (LOT 1709330104), (упаковка вторичная, вид сбоку).



Ceraflex 26
Atrial Septal Defect Occluder

LT-ASDF-26 161009 1036
2016-10-09 2019-10-08
26mm 8mm



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1036), (упаковка вторичная, вид спереди).

etech

Atrial Septal Defect Occluder

Ceraflex™

REF

LT-ASDf-26



2019-10-08

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1036), (упаковка вторичная, вид сбоку)



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1036), (упаковка вторичная, вид сзади).



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOI 1036), (упаковка первичная, внешний вид изделия).



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1036), (руководство пользователя).

Интродуцер SteerEase, модель SFA12F-f (LOT 1709330116), (вспомогательный инструмент)

SteerEase™

SFA12F-f

Introducer

N Introducer / BG Вспомогателен / CS Zavěšák / DA Indfører / DE Einführbesteck / EL Εισαγωγέας / ES Introducir
ET Sisestaja / FI Sisäinvieja / FR Introducteur / HR Uvodnica / HU Bevezető / IT Introduzione / LT Įvedimo įrankis
LV Ievadišanas ierīce / NL Introducer / NO Innfører / PL Introduktor / PT Introduutor / RO Introducător / RU Вспомогатель
SK Zavěšák / SL Uvajalo / SR Uvodnik / SV Införare / TR



SFA12F-f



170933



1709330116



2017-09-30



2020-09-29



800mm



4.6mm



4.1mm



LFotech SteerEase™ Introducer

1709330116
(01) 00038370125273
2020-09-29
(17) 200929 (10) 170933 (2) 1709330116

LFotech SteerEase™ Introducer

1709330116
(01) 00038370125273
2020-09-29
(17) 200929 (10) 170933 (2) 1709330116


LFotech SteerEase™ Introducer

1709330116
(01) 00038370125273
2020-09-29
(17) 200929 (10) 170933 (2) 1709330116

LFotech SteerEase™ Introducer

1709330116
(01) 00038370125273
2020-09-29
(17) 200929 (10) 170933 (2) 1709330116



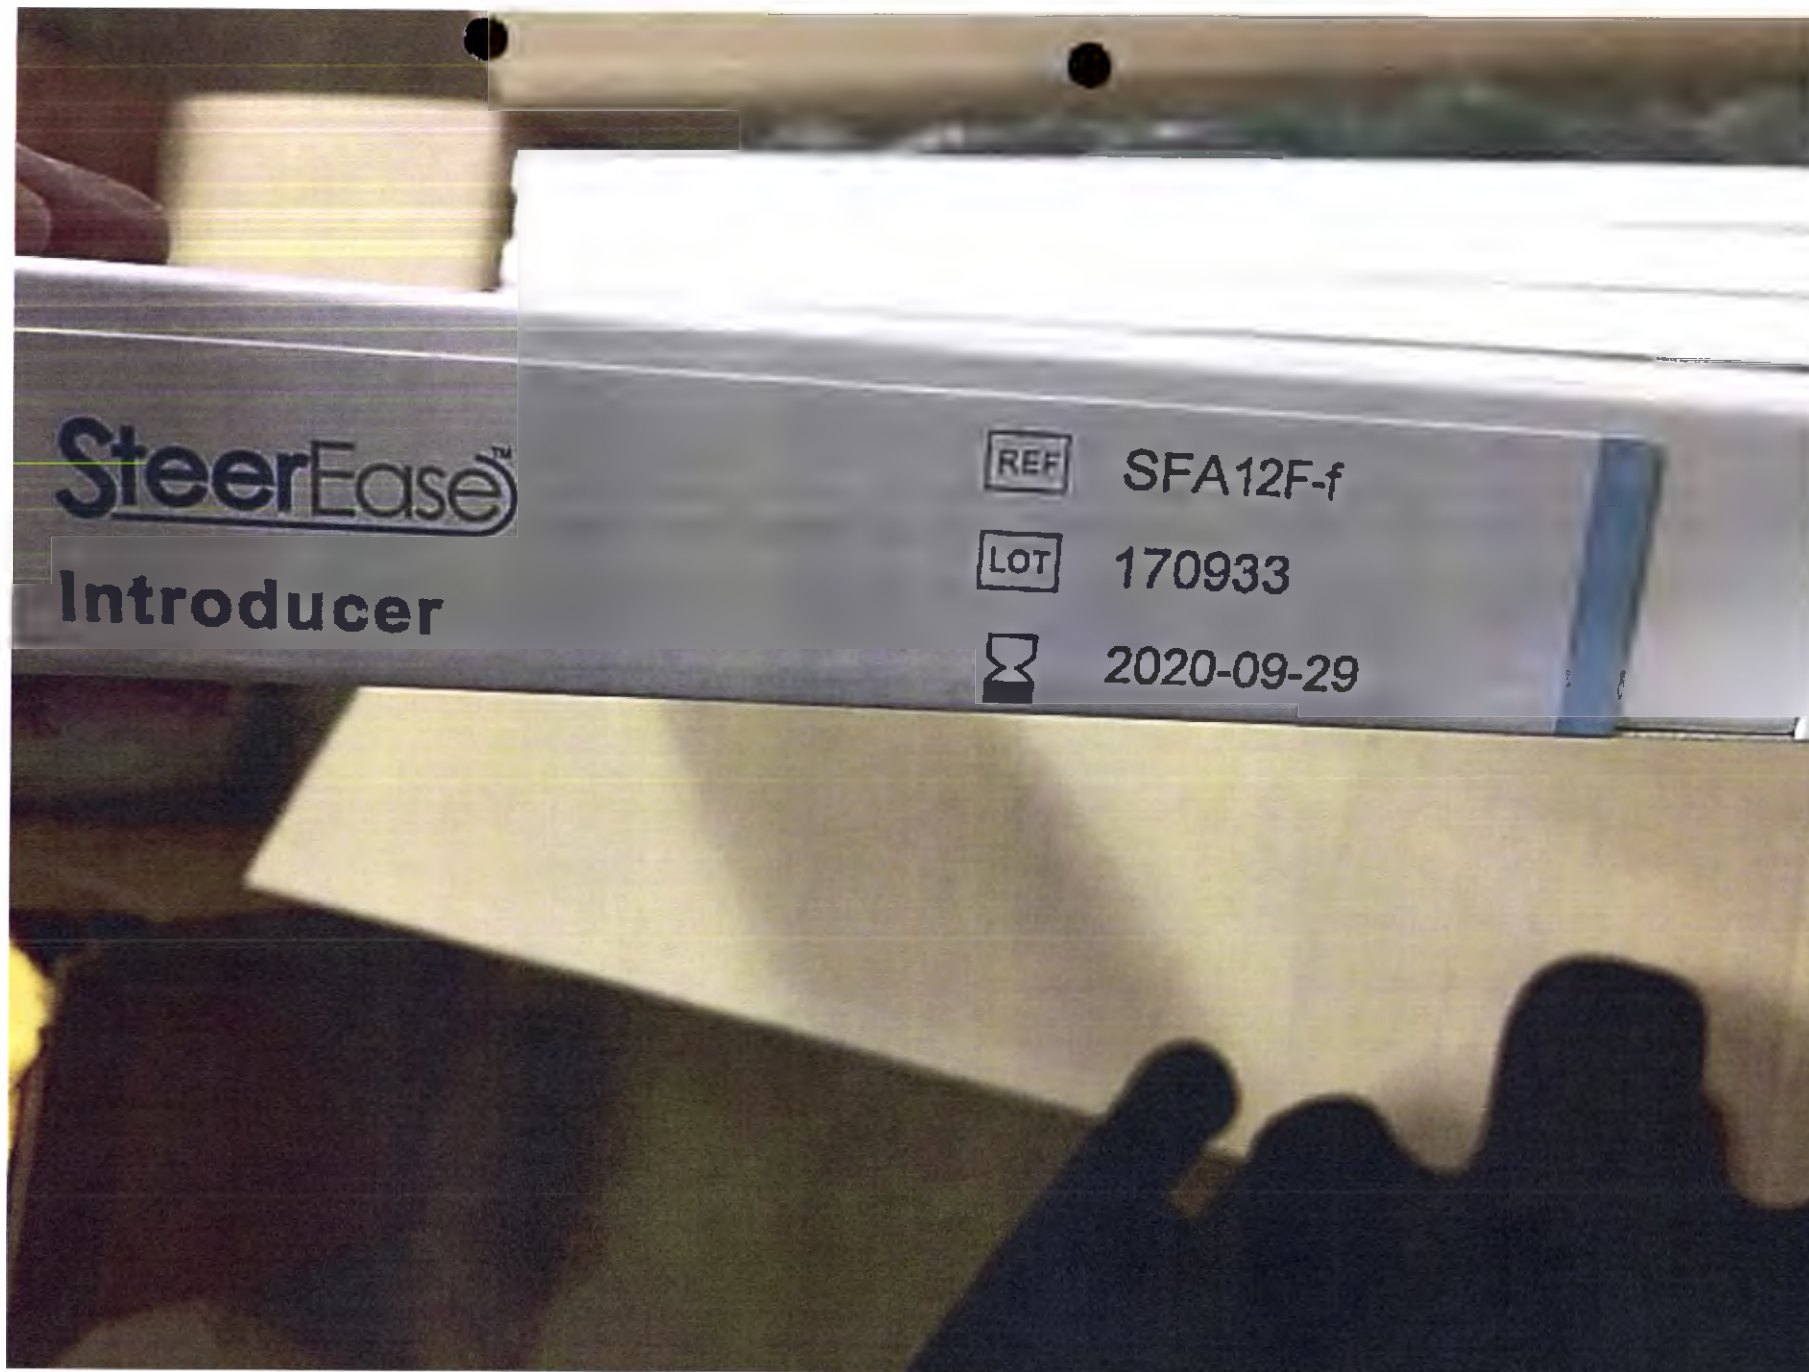

Интродьюсер SteerEase, модель SFA12F-f (LOT 1709330116), (упаковка вторичная, вид сбоку).



Ceraflex 30
Atrial Septal Defect Occluder

LT-ASDF-30 151005 1024
D 30mm L 40mm



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1024), (упаковка вторичная, вид спереди).

ctech

Atrial Septal Defect Occluder

Ceraflex™

REF

LT-ASDf-30



2019-10-08

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1024), (упаковка вторичная, вид сбоку)




Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1024), (упаковка вторичная, вид сзади).



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1024), (упаковка первичная, внешний вид изделия).




Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 1024), (руководство пользователя).

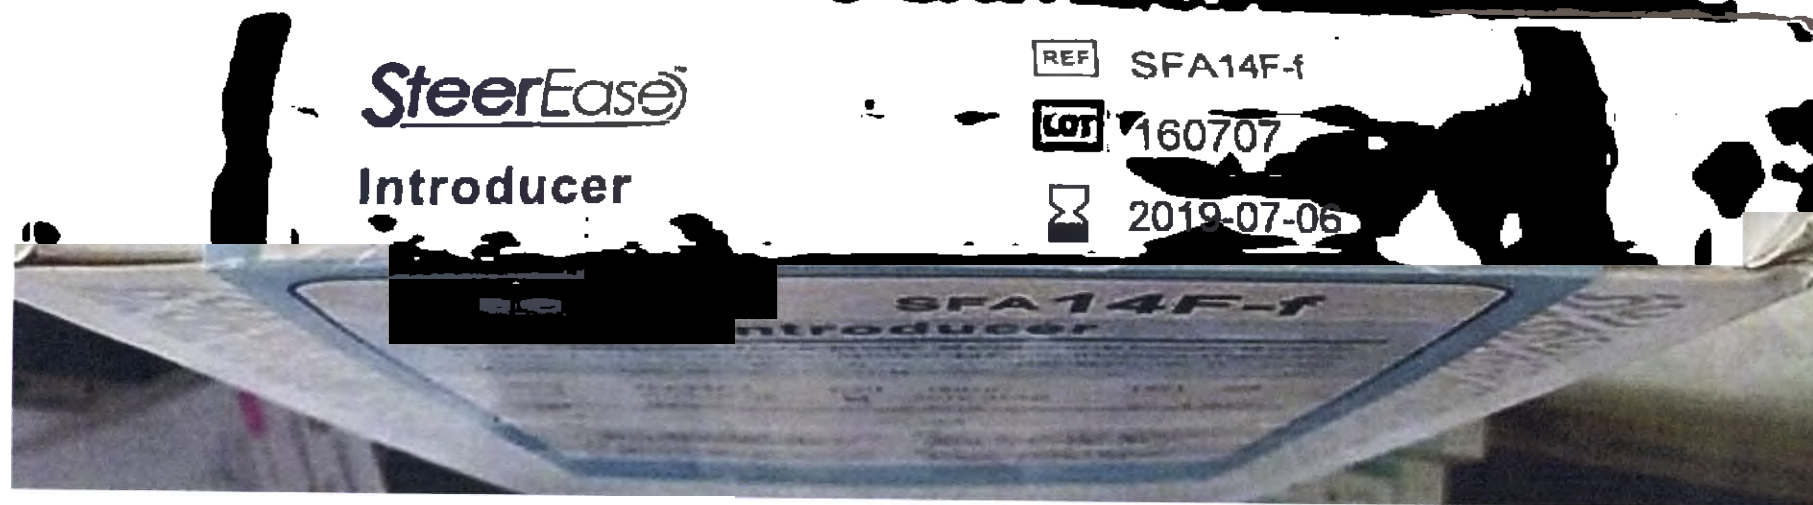

Интродьюсер SteerEase, модель SFA14F-f (LOT 335), (упаковка вторичная, вид сбоку)



Интродьюсер SteerEase, модель SFA14F-f (LOT 335), (упаковка вторичная, вид спереди).

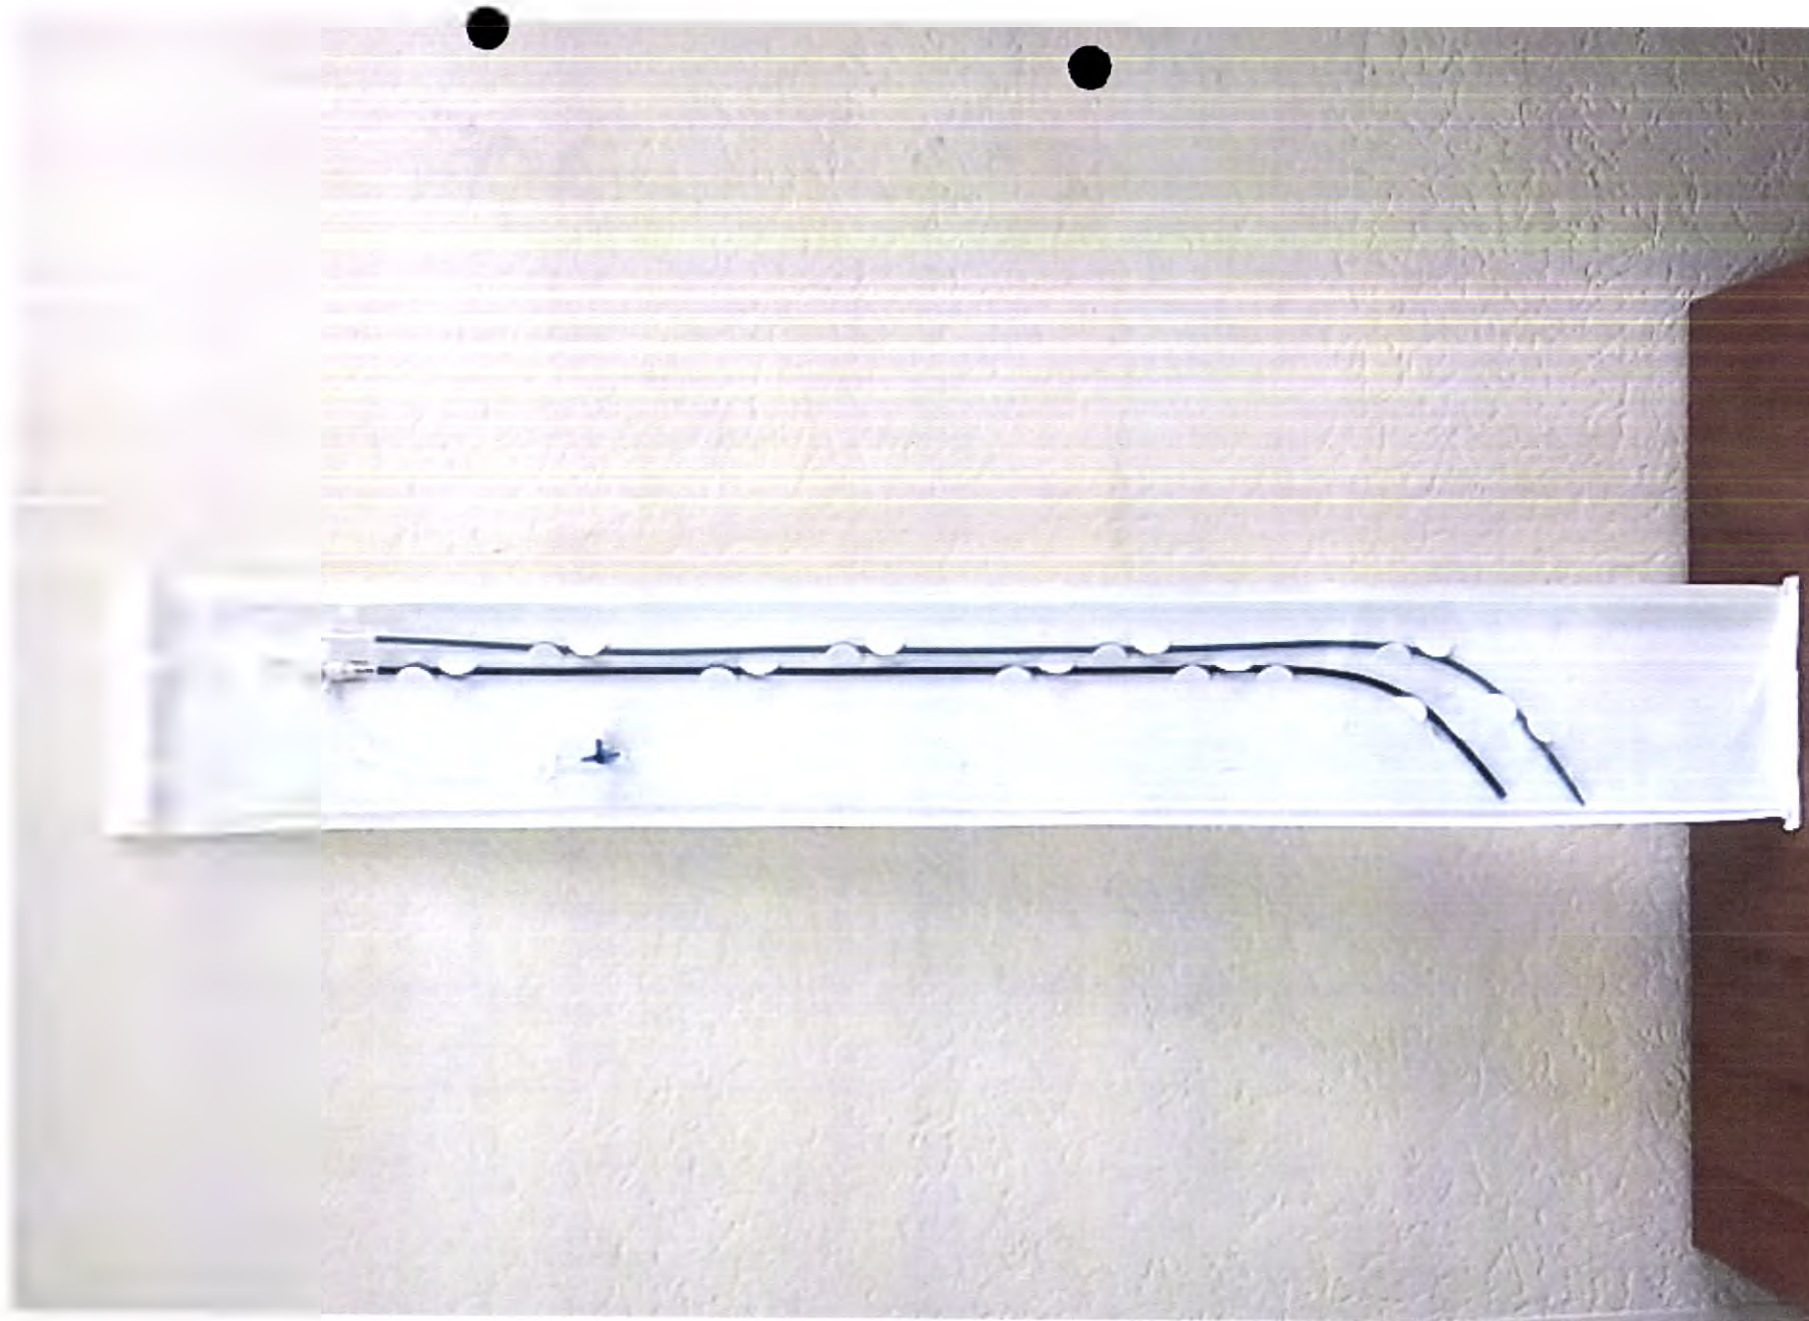


Интродьюсер SteerEase, модель SFA14F-f (LOT 335), (упаковка первичная, внешний вид изделия).



Интродьюсер SteerEase, модель SFA14F-f (I.O.T 335), (руководство пользователя).



Ceraflex[®] 1818
Multi-Fenestrated ASD Occluder

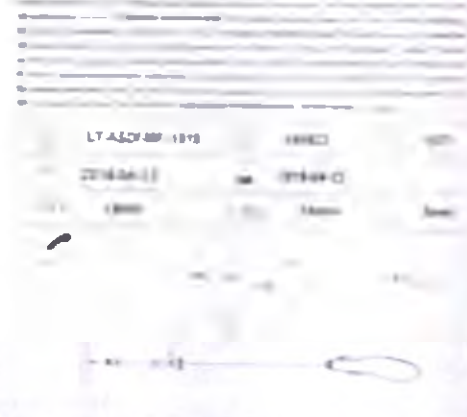

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 307), (упаковка вторичная, вид спереди).

.ifetech

Multi-Fenestrated ASD Occluder

Ceraflex


REF

LT-ASDf-MF-1818




2019-04-22

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 307), (упаковка вторичная, вид сбоку).

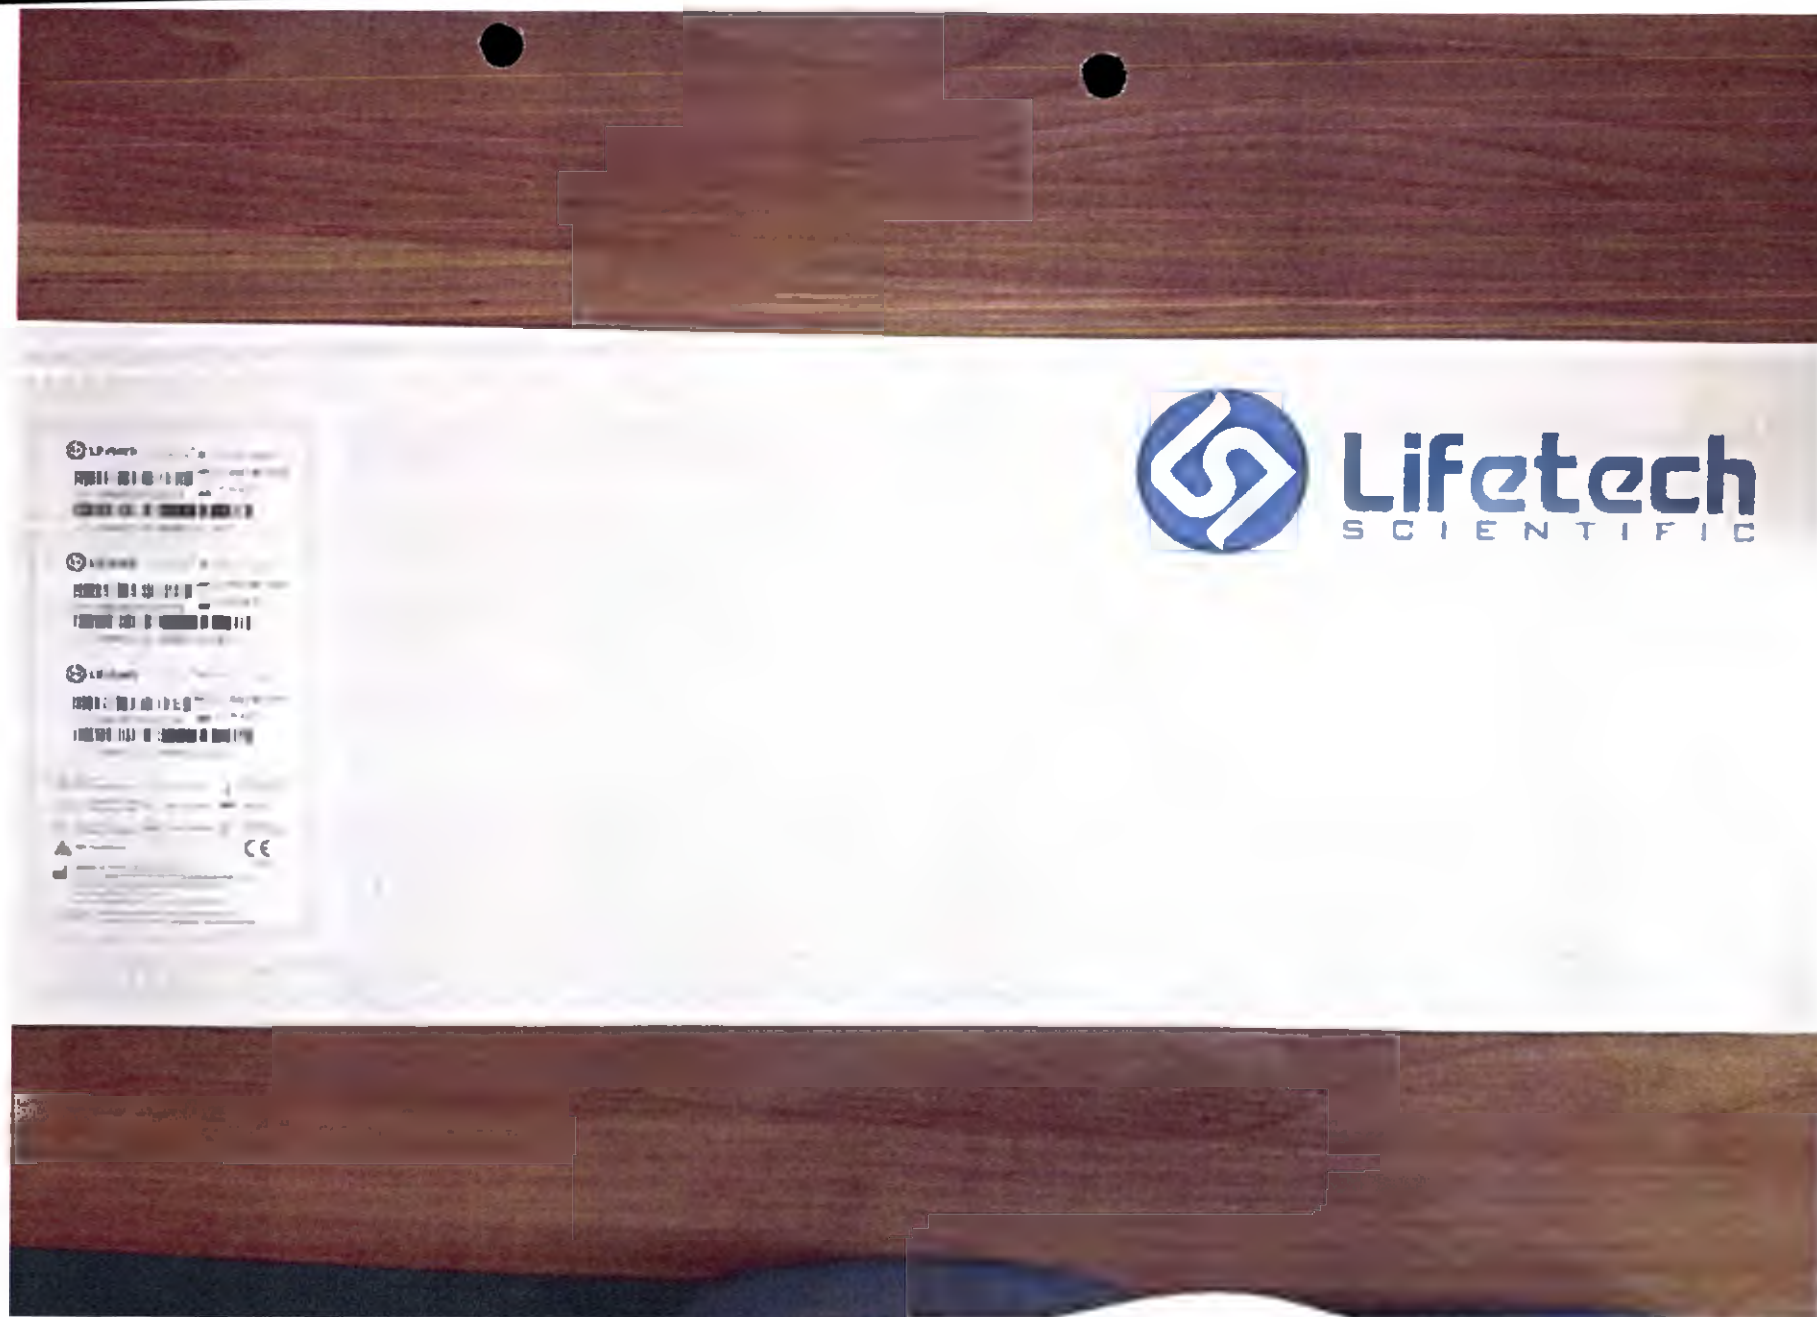

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 307), (упаковка вторичная, вид сзади).

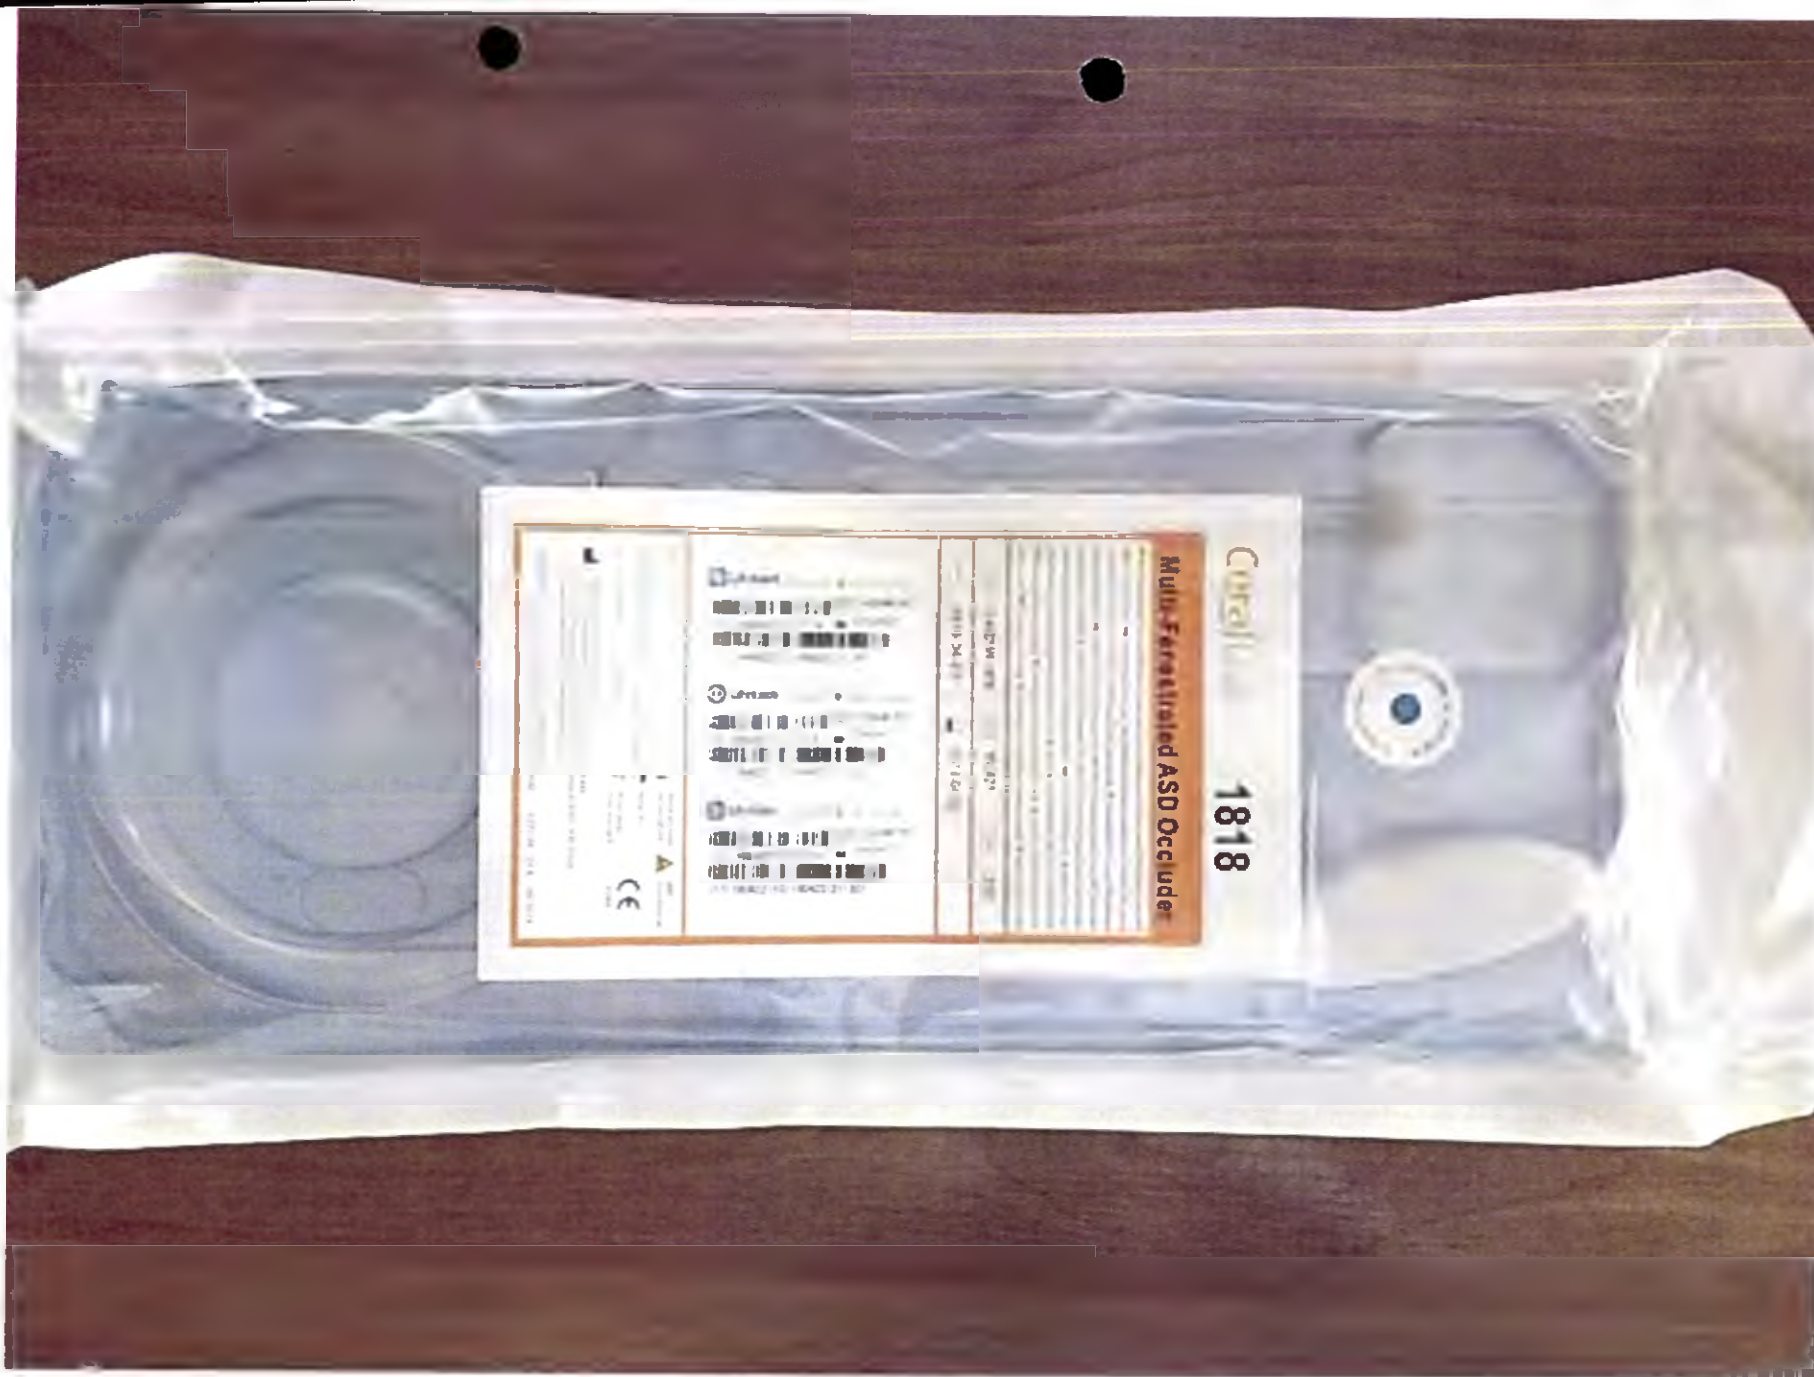

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 307), (упаковка первичная, внешний вид изделия).



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 307). (руководство пользователя).



CeraFlexi

2518


Multi-Fenestrated ASD Occluder

LT-ASOI-MF-2518

LT-ASOI-MF-2518 163423 304

2016-04-23 2019-04-23

D1 26mm D2 18mm L 3mm

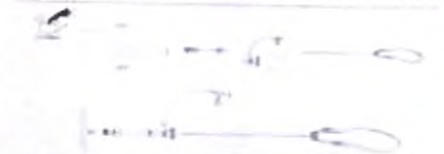

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (I.OT 304), (упаковка вторичная, вид спереди).

Multi-Fenestrated ASD Occluder


CeraFlex

REF


LT-ASD-MF-2518

2019-04-22

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 304), (упаковка вторичная, вид сбоку).

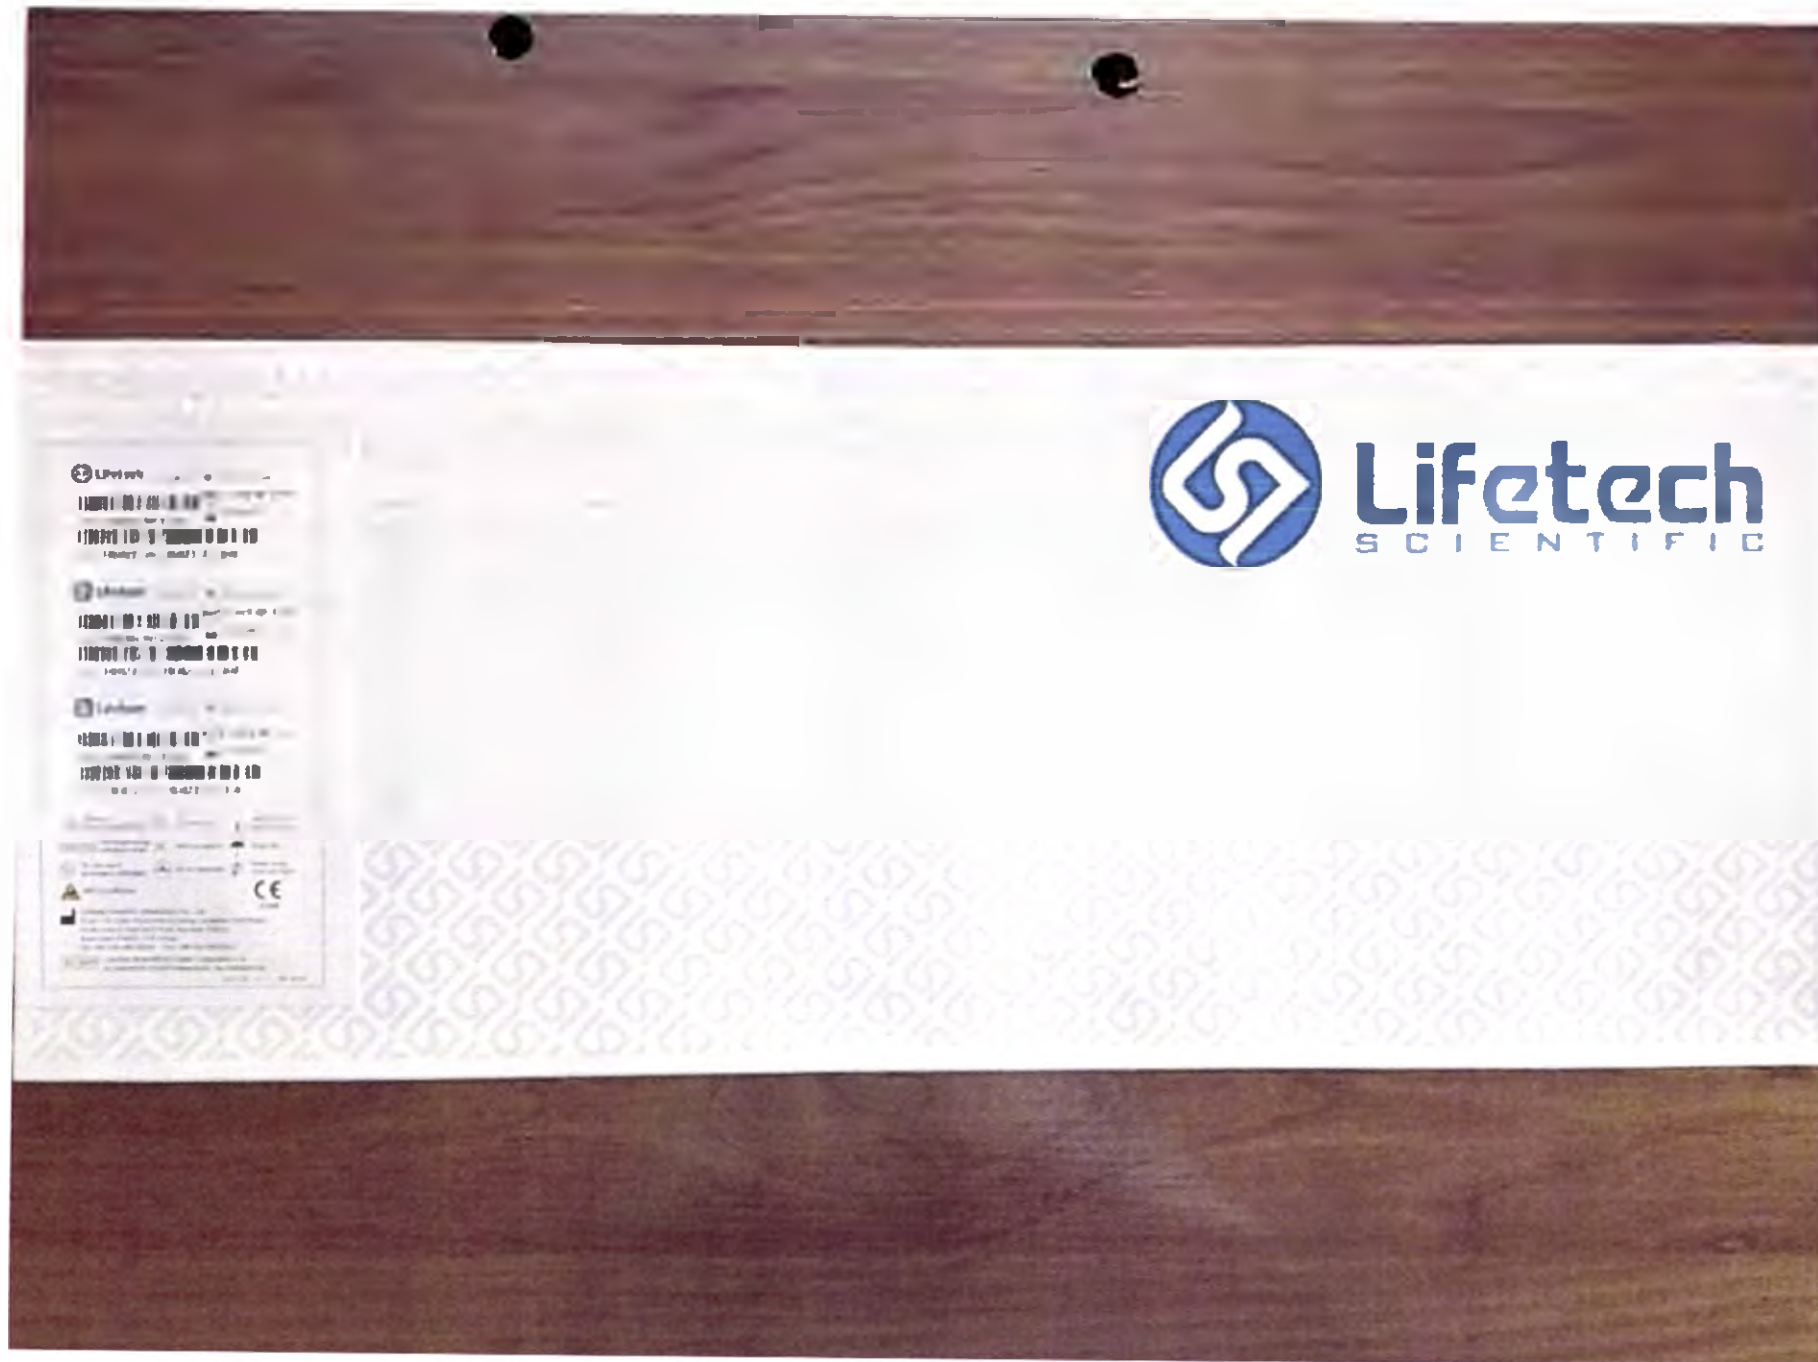

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 304), (упаковка вторичная, вид сзади).

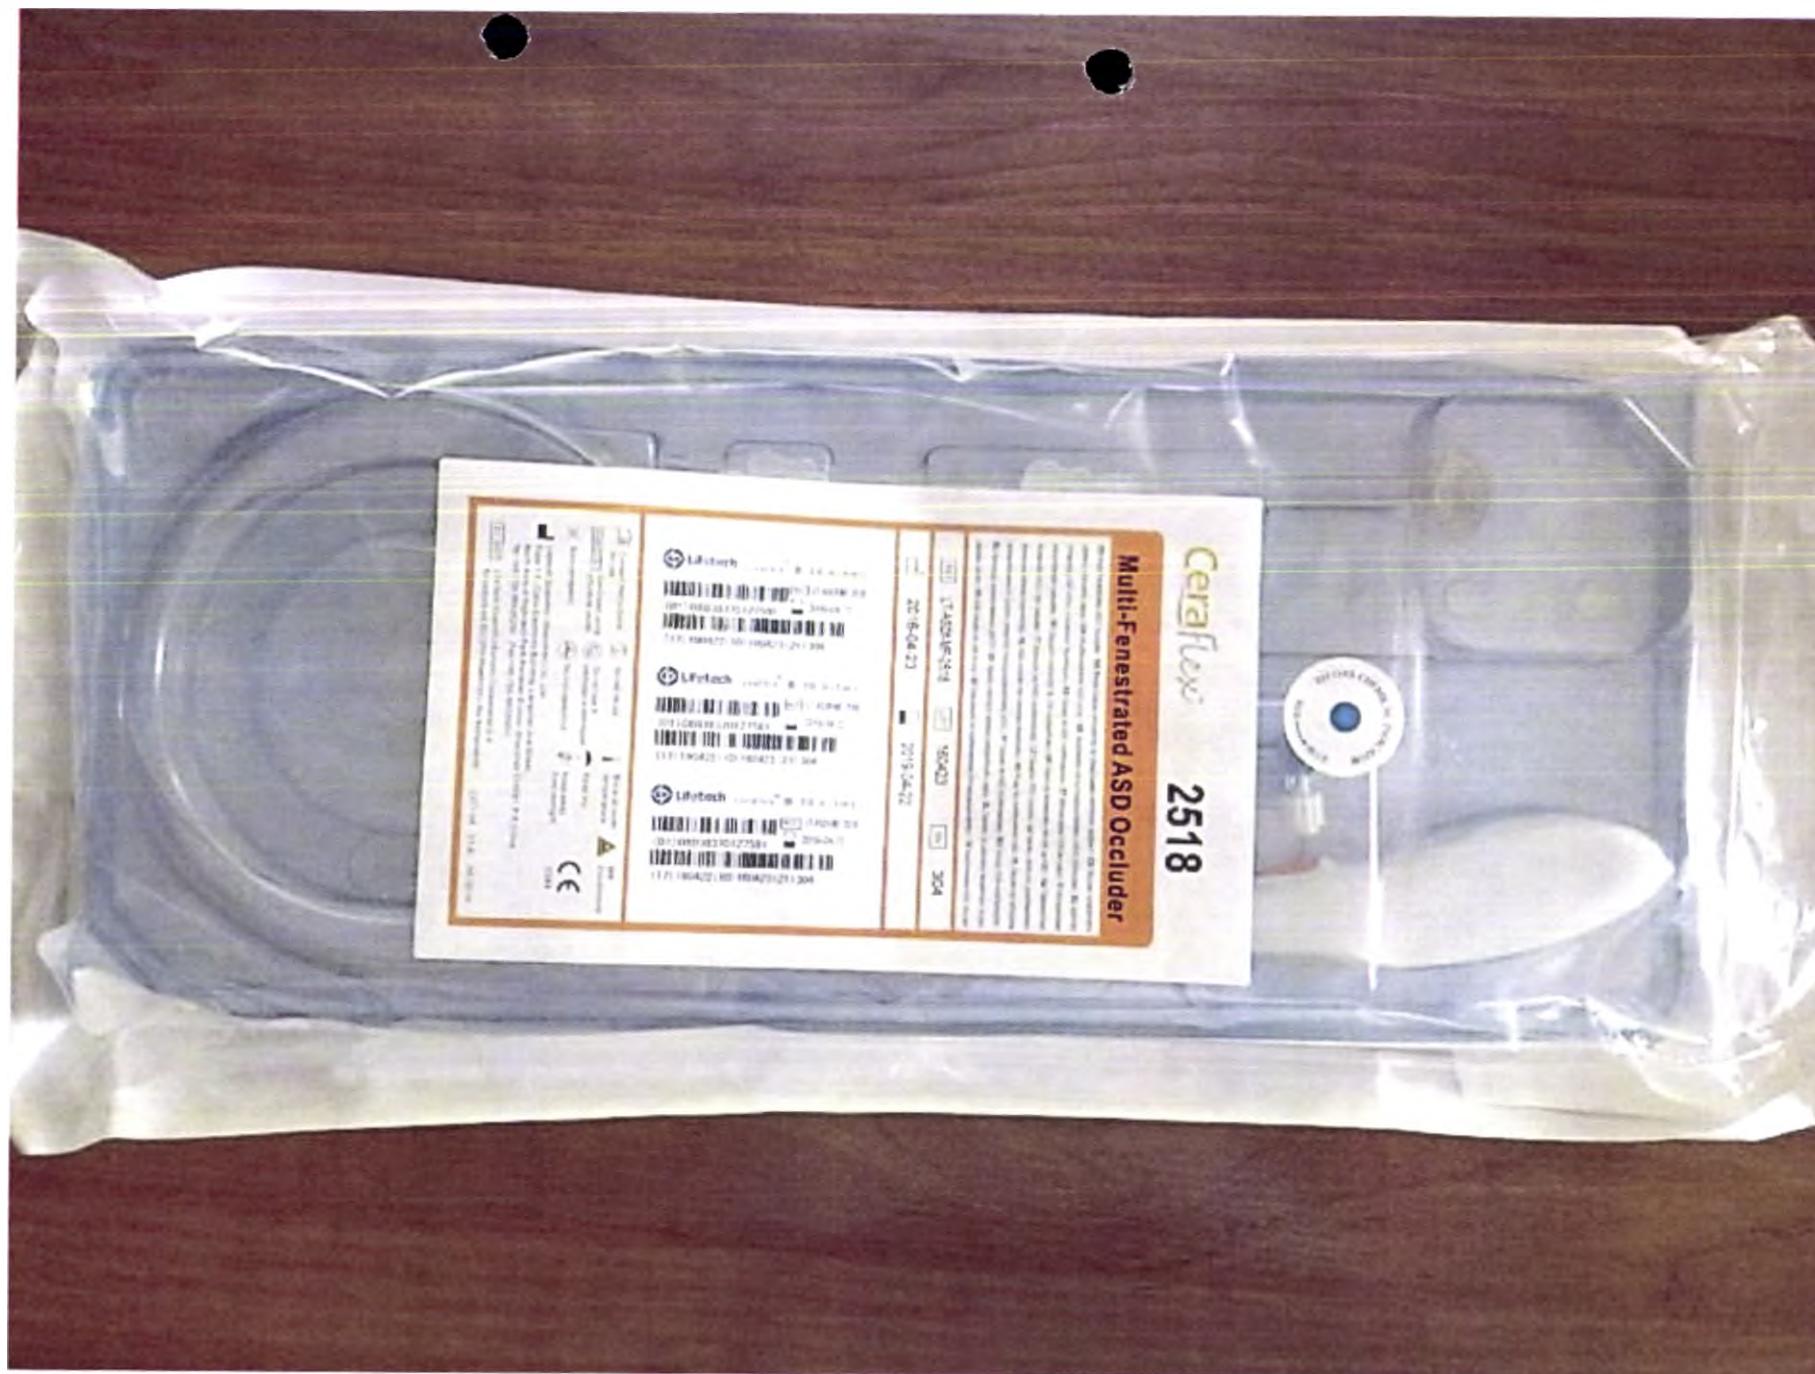

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 304), (упаковка первичная, внешний вид изделия).



Система для закрытия дсфектов межпредсрдной перегородки (ДМП) CeraFlex (LOT 304), (руководство пользователя)




28. *Staphylococcus aureus* 29. *Staphylococcus aureus* 30. *Staphylococcus aureus* 31. *Staphylococcus aureus* 32. *Staphylococcus aureus* 33. *Staphylococcus aureus* 34. *Staphylococcus aureus* 35. *Staphylococcus aureus* 36. *Staphylococcus aureus* 37. *Staphylococcus aureus* 38. *Staphylococcus aureus* 39. *Staphylococcus aureus* 40. *Staphylococcus aureus* 41. *Staphylococcus aureus* 42. *Staphylococcus aureus* 43. *Staphylococcus aureus* 44. *Staphylococcus aureus* 45. *Staphylococcus aureus* 46. *Staphylococcus aureus* 47. *Staphylococcus aureus* 48. *Staphylococcus aureus* 49. *Staphylococcus aureus* 50. *Staphylococcus aureus* 51. *Staphylococcus aureus* 52. *Staphylococcus aureus* 53. *Staphylococcus aureus* 54. *Staphylococcus aureus* 55. *Staphylococcus aureus* 56. *Staphylococcus aureus* 57. *Staphylococcus aureus* 58. *Staphylococcus aureus* 59. *Staphylococcus aureus* 60. *Staphylococcus aureus* 61. *Staphylococcus aureus* 62. *Staphylococcus aureus* 63. *Staphylococcus aureus* 64. *Staphylococcus aureus* 65. *Staphylococcus aureus* 66. *Staphylococcus aureus* 67. *Staphylococcus aureus* 68. *Staphylococcus aureus* 69. *Staphylococcus aureus* 70. *Staphylococcus aureus* 71. *Staphylococcus aureus* 72. *Staphylococcus aureus* 73. *Staphylococcus aureus* 74. *Staphylococcus aureus* 75. *Staphylococcus aureus* 76. *Staphylococcus aureus* 77. *Staphylococcus aureus* 78. *Staphylococcus aureus* 79. *Staphylococcus aureus* 80. *Staphylococcus aureus* 81. *Staphylococcus aureus* 82. *Staphylococcus aureus* 83. *Staphylococcus aureus* 84. *Staphylococcus aureus* 85. *Staphylococcus aureus* 86. *Staphylococcus aureus* 87. *Staphylococcus aureus* 88. *Staphylococcus aureus* 89. *Staphylococcus aureus* 90. *Staphylococcus aureus* 91. *Staphylococcus aureus* 92. *Staphylococcus aureus* 93. *Staphylococcus aureus* 94. *Staphylococcus aureus* 95. *Staphylococcus aureus* 96. *Staphylococcus aureus* 97. *Staphylococcus aureus* 98. *Staphylococcus aureus* 99. *Staphylococcus aureus* 100. *Staphylococcus aureus*

LT-ASOM MF-2030 160309 509

2016-06-09 2013-03-06

D1	30mm	D2	30mm	L	3mm
----	------	----	------	---	-----

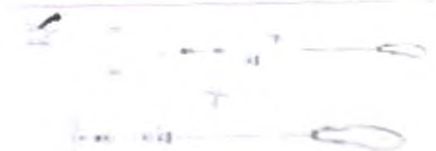

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 509), (упаковка вторичная, вид спереди).

Multi-Fenestrated ASD Occluder

CeraFlex™

REF

LT-ASDf-MF-3030




2019-05-08

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 509), (упаковка вторичная, вид сбоку).



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 509), (упаковка вторичная, вид сзади).

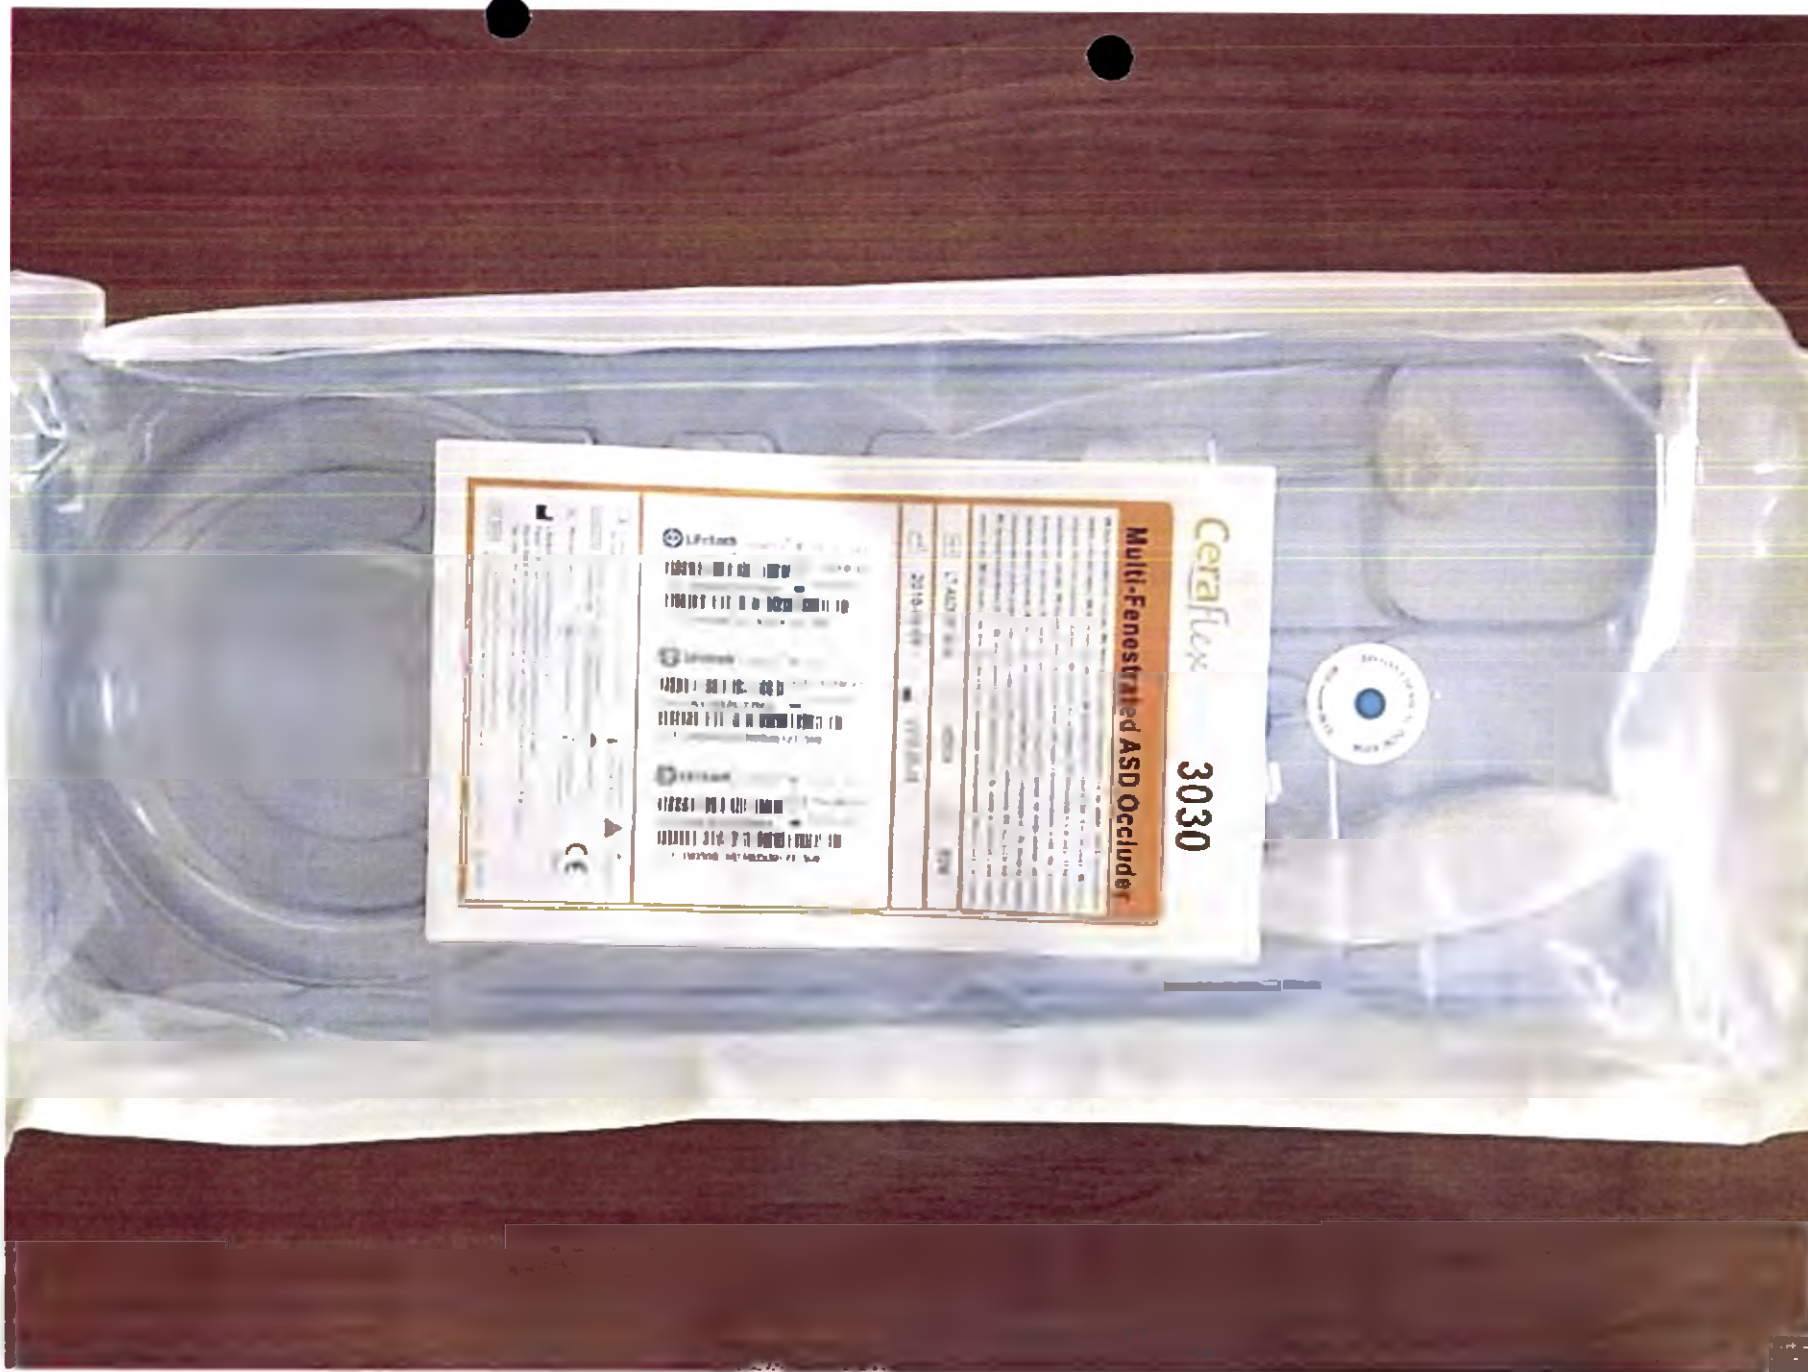

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 509), (упаковка первичная, внешний вид изделия).



Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex (LOT 509), (руководство пользователя).

Окклюдер CeraFlex для закрытия одиночного ДМПП (LT-ASDf)

Окклюдер CeraFlex для множественных ДМПП (LT-ASDf-MF)

CeraFlex

10

Atrial Septal Defect Occluder

EN Atrial Septal Defect Occluder / BG Atrijalni septalni defektni zatvarač / CS Okludér defektu síňového septa / DA ASD-åbner
DE Atriumseptumdefekt-ASD-Occluder / EL Ατρίτις εμβολιστής / UK Atrijalni defektni zatvarač / ES Ocluzor de defectos septales auriculares
ET Atriatõõli väikesed defektid sulgur / FI Atriseiväikesten aukien sulku / FR Système de fermeture de communication interauriculaire (CIA)
HR Okluder sustava za zatvaranje atipijoj septalnog defekta / HU Páros szívszeptális (ASD) zárt okkluder / IT Occlusore per difetti del setto atriale
LT Plėtinėjimo pėdaras defekto kamėlio / LV Plėstināmbars starpsienas defekta nospēstotājs / NL Atrial septumdefect (ASD)-occluder
NO Propp for atriseptumdefekt / PL Okluder do zamykania ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) / PT Occlusor de defeitos do septo interaural
RO Ocluzor pentru defecte septale atriale (OSA) / RU Оклюзер дефекта межпредсердной перегородки / SK Okludér defektu predšedňového septa
SL Zaprtniki sistem za uporabo pri atipiji septalnih okludir / SR Okluder za zatvaranje septalne defekta / SV Ocludare för förmaksseptumdefekt
TR Atrial Septal Defekt Okküzör

REF LT-ASDf-10 LOT 101216 SN 001

2010-12-16 2013-12-15



Consult instructions for use
STERILE EO Sterilized using ethylene oxide
Non-pyrogenic
Do not reuse
Do not use if package is damaged
Do not resterilize
Store at room temperature
Keep dry
Keep away from sunlight
MR Conditional
CE 0344
LifeTech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.
Floor 1-5, Cybio Electronic Building, Langshan 2nd Street,
North Area of High-tech Park, Nanshan District, Shenzhen 518057, P.R.China
Tel: +86-755-86026250 Fax: +86-755-86026251
EC REP LifeTech Scientific(Europe) Coöperatief U.A.
Kruisendijk 64, 6222PH Maastricht, the Netherlands L271-02 V1.7 09/2014

CeraFlex

2518

Multi-Fenestrated ASD Occluder

EN Multi-Fenestrated ASD Occluder / BG Многоотворен аtriален затварач / CS Okludér víceokenného defektu síňového septa / DA Multifenestret ASD-åbner
DE Multifenestriertes ASD-Prop / EL Μultifενεστρημένο ΚΥΟ-αbner / FI Monioaukosen ommatähtäinen sulku / FR Ocluseur d'occlusion de CIA multiple / HR Višestran fenestrirani okluder za ASD / HU Többnyílású fenestrit ASD zárt okkluder / IT Occlusore per ASD multifenestrato / LT Daugias PPJ kamėlio / LV Vairāku atverumu priekšliedams starpsienas defekta nospēstotājs / NL ASD-occluder met meerdere fenestries / NO Propp for multifenestret ASD / PL Okluder do zamykania wielopierścieniowych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) / PT Occlusor de ASD multifenestrado / RO Ocluzor OSA multifenestrat / RU Оклюзер многоотверстиевого ДМПП / SK Okludér viacerých defektov predšedňového septa / SL Zaprtniki za večkratno fenestrirano atipijo septalne ommre / SR ASD okluder za više otvara / SV Ocludare för multifenestrat förmaksseptumdefekt / TR MultiFenestre ASD Okküzör

REF LT-ASDf-MF-2518 LOT 101216 SN 001

2010-12-16 2013-12-15



Consult instructions for use
STERILE EO Sterilized using ethylene oxide
Non-pyrogenic
Do not reuse
Do not use if package is damaged
Do not resterilize
Store at room temperature
Keep dry
Keep away from sunlight
MR Conditional
CE 0344
LifeTech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.
Floor 1-5, Cybio Electronic Building, Langshan 2nd Street,
North Area of High-tech Park, Nanshan District, Shenzhen 518057, P.R.China
Tel: +86-755-86026250 Fax: +86-755-86026251
EC REP LifeTech Scientific(Europe) Coöperatief U.A.
Kruisendijk 64, 6222PH Maastricht, the Netherlands L271-04 V1.6 09/2014

Маркировка стерильный упаковки окклюдера.


10

Atrial Septal Defect Occluder

EN Atrial Septal	OCcluder / BG Огдулятор за предсептален септален дефект / CS Occluder defect: atrial septal / DA
DE Atriumseptumdefekt (ASD)-Klappherz / EL	ατρητογενής μεμβρανικός ελάττωμας / ES Occluder de defectos septales auriculares
ET Atrialise klappherz / FR Encl. atrial / GB septal defect / FR SY système de fermeture de communication intra auriculaire / GU	
HR Occluder sustava za zatvaranje	defekta / HU Párta lezárórendszer (ASD) zárt okkluder / IT Occluder per difetti del setto atriale
LT Priešardio pertvaros defekto kamienis / LT Prieškamienio septalinis defekto nosprendimo / NL Atrial septumclosure (ASD)-occluder	
NO Propp for atrialseptumdefekt / PL Occluder do zamykania ubytków przegrody przedsieniowej (ASD) / PT Occluder de defeitos do septo atrial/auricular	
RO Occluder pentru defect septala atriale (OSA) / RU Огдулятор закрытия межпредсерочной перегородки / SR Occluder defekata predseptalnog septa	
BE Zatrappere systeem za opvullen van atriale septale openingen / SR Occluder za zatvaranje septalnog defekta / SV Occludersystem för förmåns septumdefekt	
TR Atrial Septal	Occluder

2012-12-10 2015-12-09

ØD 10 mm L 4 mm

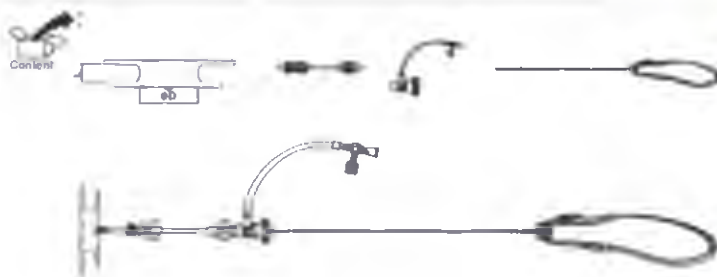

Atrial Septal Defect Occluder

2015-12-09



REF ID: A50110

CeraFlex



Copyright © ASO Occultation



LT-ASDP-10



Conflict: ASD Occulder



LI-ASDI-10



Coraltek ASD Computer



LT-ASD1-10



L277-01 v1.0 09/2011

Маркировка пользовательской коробки окклюдера (Окклюдер CeraFlex для закрытия одиночного ДМПП (LT-ASDf)).

Ceraflex

2518


Multi-Fenestrated ASD Occluder

EN Multi-Fenestrated ASD Occluder / BG Многостранен оклюдер за предсърпен септан дефект / CS Occluder viciated into defectu septalis septa
 QA Multifenestrated / DE Multidefelt: Atrialseptumdefekt-(ASD-)Occluder / EL Ατριοζγυ αμφογυγ ASC οκλυσσιν «μολοκιστρυκιν»
 ES Ocluser de ASD multifenestrado / ET Atrialseptaalse KVD-de sulgur / FI Mononaukkoisen atriseptaleman sulustite / FR Dispositif d'occlusion de CIA multiporale
 HR Višestruko fenestrirani ocluder za ASD / HU Többnyílású atrium-fenestrikelt ASD-t záró ocluder / IT Occlusore per ASD multifenestrato / LT Daugiasis PPD kamtis
 LV Atvlinamu priekšsienāru starplātnas defekta nosprostotājs / NL ASD-occluder met meerdere fenestraties / NO Propp for multifenestret ASD
 PL Zamykacz wielonastawiany ubytku przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) / PT Occlusor de ASD multifenestrado / RO Occluder DSA multi-fenestrat
 RU Окклюдер ДМПП / SK Oclúder viacerých defektov predšepčového septa / SL Zapiralo za večkratno fenestrirano ar(s)ko septalno okvaro
 SR ASD ocluder za više otvora / SV Ocludare för multifenestrerad atrialseptumdefekt / TR Multi-Fenestral ASD Occluder

REF LT-ASDf-MF-2518 LOT 121210 SN 001

2012-12-10 2015-12-09

ØD1 25 mm ØD2 18 mm L 3 mm

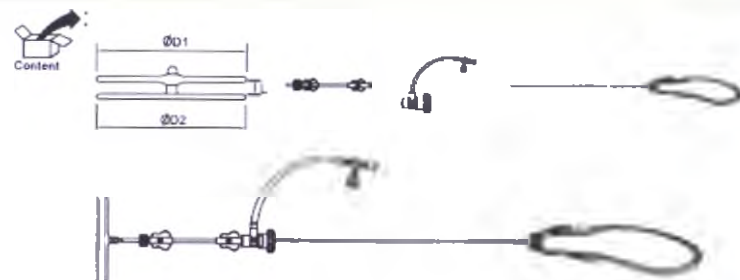

Multi-Fenestrated ASD Occluder

REF LT-ASDf-MF-2518 2015-12-09

Ceraflex

Lifetech

Ceraflex™ MF ASD Occluder

REF LT-ASDf-MF-2518 2015-12-09

Lifetech

Ceraflex™ MF ASD Occluder

REF LT-ASDf-MF-2518 2015-12-09

Lifetech

Ceraflex™ MF ASD Occluder

REF LT-ASDf-MF-2518 2015-12-09

Consult instructions for use Do not reuse Store at room temperature
 Keep dry
 MR Conditional
 Lifetech Scientific () Co., Ltd.
 Floor 1-8, Cybio Electronic Building, Langham 2nd
 North Area of High-tech Park, Nanshan District
 Shenzhen, P.R. China
 Tel.: 86-755-86026250 Fax: 86-755-86026251
 Lifetech Scientific () Co., Ltd.
 Kruisdonk 64, 6222PH Maastricht, the Netherlands
 L271-02 V1.7 09/2014

Маркировка пользовательской коробки окклюдера (Окклюдер CeraFlex для множественных ДМПП (LT-ASDf-MF)).

Артикул: см. на упаковке

Лот номер: см. на упаковке

Годен до: см. на упаковке

Система для закрытия дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) CeraFlex в различных вариантах исполнения

Размер: -

Номер и дата РУ:

Назначение: Система предназначена для окклюзии вторичных дефектов межпредсердной перегородки (ДМПП) и множественных вторичных дефектов межпредсердной перегородки, а также для пациентов, перенесших операцию Фонтана с фенестрацией и в настоящее время нуждающихся в закрытии фенестрации.

Дата изготовления: см. на упаковке



«Лайфтек Сайнтифик (Шэньчжэнь)», Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., Floor 1-5, Cybio Electronic Building, Langshan 2nd Street, North Area of High-tech Park, Nanshan District, Shenzhen, 518057, P.R. China

Представитель производителя в РФ: ООО «ЦСРМИ», Россия, 123308, Москва, ул. Мневники, д. 3, корп. 1

Место производства:

«Лайфтек Сайнтифик (Шэньчжэнь)», Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., Floor 1-5, Cybio Electronic Building, Langshan 2nd Street, North Area of High-tech Park, Nanshan District, Shenzhen, 518057, P.R. China

**АПИРОГЕННО
НЕТОКСИЧНО**



Проект стикера на русском языке.



Всего пронумеровано,
прошнупазано и
напечатано
50 листа (ов)