



**Инструкция по применению
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая
по ТУ 32.50.13-010-65614693-2023**

Наименование медицинского изделия.

Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 (далее по тексту – «изделие»).

Варианты исполнения:

1. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 15G длиной 150 мм в составе:

- 1.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 15G – 1 шт.
- 1.2. Протектор фистульной иглы – 1 шт.
- 1.3. Магистраль пластиковая 150 мм -1 шт.
- 1.4. Зажим красный - 1 шт.
- 1.5. Коннектор FLL - 1 шт.
- 1.6. Колпачок защитный MLL – 1 шт.
- 1.7. Инструкция по применению – 1 шт.
- 1.8. Паспорт – 1 шт.
- 1.9. Упаковочный лист – 1 шт.

2. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 16G длиной 150 мм в составе:

- 2.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 16G -1 шт.
- 2.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.
- 2.3. Магистраль пластиковая 150 мм -1 шт.
- 2.4. Зажим красный - 1 шт.
- 2.5. Коннектор FLL - 1 шт.
- 2.6. Колпачок защитный MLL – 1 шт.
- 2.7. Инструкция по применению – 1 шт.
- 2.8. Паспорт – 1 шт.
- 2.9. Упаковочный лист – 1 шт.

3. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 17G длиной 150 мм в составе:

- 3.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 17G – 1 шт.
- 3.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.
- 3.3. Магистраль пластиковая 150 мм -1 шт.
- 3.4. Зажим красный - 1 шт.
- 3.5. Коннектор FLL - 1 шт.
- 3.6. Колпачок защитный MLL - 1 шт.
- 3.7. Инструкция по применению – 1 шт.
- 3.8. Паспорт – 1 шт.
- 3.9. Упаковочный лист – 1 шт.

4. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 15G длиной 300 мм в составе:

- 4.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 15G – 1 шт.
- 4.2. Протектор фистульной иглы 1 шт.
- 4.3. Магистраль пластиковая 300 мм -1 шт.

- 4.4. Зажим красный 1 шт.
- 4.5. Коннектор FLL - 1 шт.
- 4.6. Колпачок защитный MLL – 1 шт.
- 4.7. Инструкция по применению – 1 шт.
- 4.8. Паспорт – 1 шт.
- 4.9. Упаковочный лист – 1 шт.

5. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 16G длиной 300 мм в составе:

- 5.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 16G – 1 шт.
- 5.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.
- 5.3. Магистраль пластиковая 300 мм -1 шт.
- 5.4. Зажим красный - 1 шт.
- 5.5. Коннектор FLL - 1 шт.
- 5.6. Колпачок защитный MLL – 1 шт.
- 5.7. Инструкция по применению – 1 шт.
- 5.8. Паспорт – 1 шт.
- 5.9. Упаковочный лист – 1 шт.

6. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 17G длиной 300 мм в составе:

- 6.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 17G – 1 шт.
- 6.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.
- 6.3. Магистраль пластиковая 300 мм -1 шт.
- 6.4. Зажим красный - 1 шт.
- 6.5. Коннектор FLL - 1 шт.
- 6.6. Колпачок защитный MLL – 1 шт.
- 6.7. Инструкция по применению – 1 шт.
- 6.8. Паспорт – 1 шт.
- 6.9. Упаковочный лист – 1 шт.

7. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 15G длиной 150 мм в составе:

- 7.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 15G – 1 шт.
- 7.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.
- 7.3. Магистраль пластиковая 150 мм - 1 шт.
- 7.4. Зажим синий - 1 шт.
- 7.5. Коннектор FLL - 1 шт.
- 7.6. Колпачок защитный MLL - 1 шт.
- 7.7. Инструкция по применению – 1 шт.
- 7.8. Паспорт – 1 шт.
- 7.9. Упаковочный лист – 1 шт.

8. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 16G длиной 150 мм в составе:

- 8.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 16G – 1 шт.
- 8.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.
- 8.3. Магистраль пластиковая 150 мм - 1 шт.
- 8.4. Зажим синий - 1 шт.
- 8.5. Коннектор FLL - 1 шт.
- 8.6. Колпачок защитный MLL – 1 шт.

8.7. Инструкция по применению – 1 шт.

8.8. Паспорт – 1 шт.

8.9. Упаковочный лист – 1 шт.

9. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 17G длиной 150 мм в составе:

9.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 17G – 1 шт.

9.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.

9.3. Магистраль пластиковая 150 мм - 1 шт.

9.4. Зажим синий - 1 шт.

9.5. Коннектор FLL – 1 шт.

9.6. Колпачок защитный MLL - 1 шт.

9.7. Инструкция по применению – 1 шт.

9.8. Паспорт – 1 шт.

9.9. Упаковочный лист – 1 шт.

10. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 15G длиной 300 мм в составе:

10.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 15G – 1 шт.

10.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.

10.3. Магистраль пластиковая 300 мм - 1 шт.

10.4. Зажим синий - 1 шт.

10.5. Коннектор FLL - 1 шт.

10.6. Колпачок защитный MLL - 1 шт.

10.7. Инструкция по применению – 1 шт.

10.8. Паспорт – 1 шт.

10.9. Упаковочный лист – 1 шт.

11. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 16G длиной 300 мм в составе:

11.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 16G – 1 шт.

11.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.

11.3. Магистраль пластиковая 300 мм - 1 шт.

11.4. Зажим синий - 1 шт.

11.5. Коннектор FLL - 1 шт.

11.6. Колпачок защитный MLL - 1 шт.

11.7. Инструкция по применению – 1 шт.

11.8. Паспорт – 1 шт.

11.9. Упаковочный лист – 1 шт.

12. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 17G длиной 300 мм в составе:

12.1. Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием исполнение: 17G – 1 шт.

12.2. Протектор фистульной иглы - 1 шт.

12.3. Магистраль пластиковая 300 мм - 1 шт.

12.4. Зажим синий - 1 шт.

12.5. Коннектор FLL - 1 шт.

12.6. Колпачок защитный MLL - 1 шт.

12.7. Инструкция по применению – 1 шт.

12.8. Паспорт – 1 шт.

12.9. Упаковочный лист – 1 шт.

Назначение медицинского изделия.

Изделие используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Принцип действия медицинского изделия.

Игла фистульная является связующим звеном, между пациентом и кровопроводящей магистралью. Посредством Фистульных игл осуществляется забор и возврат крови пациента. Фистульная игла вводится пациенту в фистулу, которая формируется у пациентов Хронической почечной недостаточностью. С другой стороны посредством соединителя типа "луер лок" соединяется с кровопроводящей магистралью. Протектор иглы защищает соединение магистрали непосредственно с иглой, посредством которой осуществляется забор и возврат крови пациента

Характер контакта с организмом человека:

Кратковременный контакт (менее 24 часов) с циркулирующей кровью.

Область применения медицинского изделия.

Изделие используется в условиях клиник и больниц, в службах скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Область медицинского применения - трансфузиология.

Потенциальный потребитель медицинского изделия.

Потребителями являются медицинские работники, проводящие процедуры экстракорпоральной циркуляции крови.

Показания для применения медицинского изделия.

Фистульная игла показана больным с заболеванием почек, а именно с хронической почечной недостаточностью. Фистульная игла необходима для проведения процедуры гемодиализа.

Противопоказания для применения медицинского изделия.

Противопоказаний нет. Процедура должна производиться по назначению врача.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

- легкое головокружение;
- индивидуальная непереносимость.

Описание медицинского изделия.

Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, используемый для дренирования фистулы. Через фистульные иглы осуществляется забор и возврат крови пациента во время процедуры гемодиализа. Это изделие для одноразового использования.

Технические характеристики, общая схема изделия, характеристики расходных материалов (по применимости).

Масса изделий в потребительской упаковке должна соответствовать таблице ниже с допуском ± 15 %.

№	Вариант исполнения изделия	Масса, г
1	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 15G длиной 150 мм	10
2	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 16G длиной 150 мм	10
3	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 17G длиной 150 мм	10
4	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 15G длиной 300 мм	12
5	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 16G длиной 300 мм	12

	ния артериальная 16G длиной 300 мм	
6	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 17G длиной 300 мм	12
7	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 15G длиной 150 мм	10
8	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 16G длиной 150 мм	10
9	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 17G длиной 150 мм	10
10	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 15G длиной 300 мм	12
11	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 16G длиной 300 мм	12
12	Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 17G длиной 300 мм	12

Схема изделия «Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, артериальная»

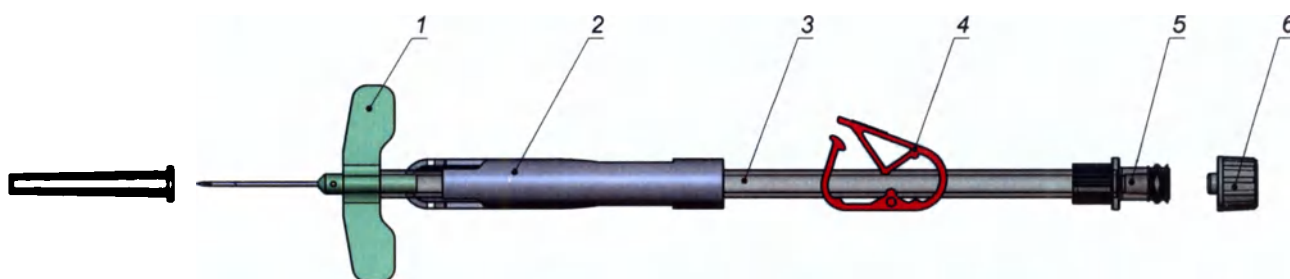


Рисунок 1. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, артериальная

Поз.	Наименование	Характеристики						Материал
		15G/150	16G/150	17G/150	15G/300	16G/300	17G/300	
1	Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием	Толщина стенки 0,2 мм $\pm 10\%$; угол заточки $17 \pm 2^\circ$; радиус наконечника $0,03 \pm 0,01$ мм; длина в сборе с колпачком 57 ± 10 мм, длина трубки иглы $25^{+1,5}_{-2,5}$ мм						Нержавеющая сталь X5CrNi18-9
			$D_{\text{внеш}}=1,65$ мм $\pm 10\%$ $D_{\text{внутр}}=1,45$ мм $\pm 10\%$ $L_{\text{острия}}=5,2$ мм $\pm 10\%$ Цвет – зеленый					Полиэтилен Mirason M 60 (GM1600E) (колпачок)
		$D_{\text{внеш}}=1,8$ мм $\pm 10\%$ $D_{\text{внутр}}=1,6$ мм $\pm 10\%$ $L_{\text{острия}}=5,7$ мм $\pm 10\%$ Цвет – синий или белый		$D_{\text{внеш}}=1,47$ мм $\pm 10\%$ $D_{\text{внутр}}=1,27$ мм $\pm 10\%$ $L_{\text{острия}}=4,7$ мм $\pm 10\%$ Цвет – оранжевый	$D_{\text{внеш}}=1,8$ мм $\pm 10\%$ $D_{\text{внутр}}=1,6$ мм $\pm 10\%$ $L_{\text{острия}}=5,7$ мм $\pm 10\%$ Цвет – синий или белый	$D_{\text{внеш}}=1,65$ мм $\pm 10\%$ $D_{\text{внутр}}=1,45$ мм $\pm 10\%$ $L_{\text{острия}}=5,2$ мм $\pm 10\%$ Цвет – зеленый	$D_{\text{внеш}}=1,47$ мм $\pm 10\%$ $D_{\text{внутр}}=1,27$ мм $\pm 10\%$ $L_{\text{острия}}=4,7$ мм $\pm 10\%$ Цвет – оранжевый	Поликарбонат Makrolon 2858 (держатель)
								Полиэтилен M 60 (GM1600E) / Краситель голубой (BlueDYE Liquid 8536000000) (крылышки – синие)
								Полиэтилен M 60 (GM1600E) / Краситель зеленый (TRACER DYE – GREEN) (крылышки – зеленые)
								Полиэтилен M 60

								(GM1600E) / Краситель оранжевый (SPEC- TRUM ORANGE DYE) (крылышки – оранже- вые)
								J-A2324, медицинская жидкость (силиконовое покрытие)
2	Протек- тор фи- стуль- ной иглы	D _{нар} =10 мм ±10%, d _{внутр} =7,4 мм ±10%, H=65,2 мм ±10%						Поливинилхлорид гра- нулированный меди- цинский PVC FMM931NT01
3	Маги- страль пласти- ковая	D _{внеш} =4,3 мм ±10% D _{внутр} =3,2 мм ±10% L=150±15 мм			D _{внеш} =4,3 мм ±10% D _{внутр} =3,2 мм ±10% L=300±9 мм			Поливинилхлорид пластифицированный медицинский экструзионный (RB3)
4	Зажим крас- ный	Длина 25,5±1 мм						Полипропилен (HP371P)) Краситель красный (RED MASTERDYE)
5	Кон- нектор FLL	Диаметр соединения 4,1 мм ±10%. Длина 20±1мм						Поливинилхлорид грану- лированный медицинский (PVCAM 88 W 17)
6	Колпа- чок защит- ный MLL	Диаметр соединения 7,45 мм ±10%. Длина 11,7±1мм						Акрилонитрилбутадиен- стирол (ABSHI 121H)

Схема изделия «Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, венозная»

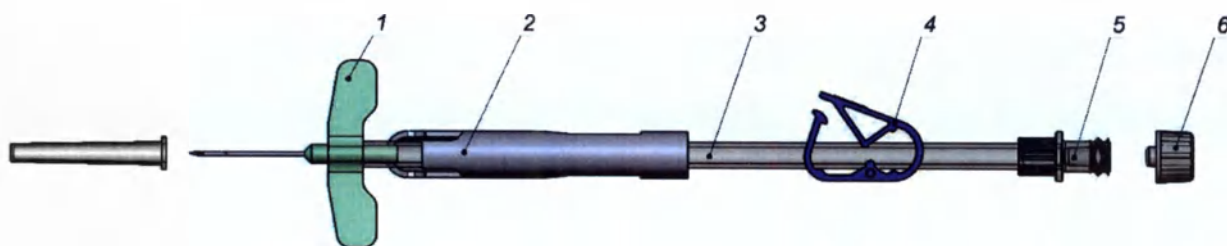


Рисунок 2. Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, венозная

Поз.	Наименование	Характеристики						Материал
		15G/150	16G/150	17G/150	15G/300	16G/300	17G/300	
1	Игла фистульная с колпачком защитным и боковым отверстием	Толщина стенки 0,2 мм ±10%; угол заточки 17±2°; радиус наконечника 0,03±0,01 мм; длина в сборе с колпачком 57±10 мм, длина трубки иглы 25 ^{+1,5} _{-2,5} мм						Нержавеющая сталь X5CrNi18-9
		D _{внеш} =1,8 мм ±10% D _{внутр} =1,6 мм ±10% L _{острия} =5,7 мм ±10% Цвет – синий или белый	D _{внеш} =1,65 мм ±10% D _{внутр} =1,45 мм ±10% L _{острия} =5,2 мм ±10% Цвет – зеленый	D _{внеш} =1,47 мм ±10% D _{внутр} =1,27 мм ±10% L _{острия} =4,7 мм ±10% Цвет – оранжевый	D _{внеш} =1,8 мм ±10% D _{внутр} =1,6 мм ±10% L _{острия} =5,7 мм ±10% Цвет – синий или белый	D _{внеш} =1,65 мм ±10% D _{внутр} =1,45 мм ±10% L _{острия} =5,2 мм ±10% Цвет – зеленый	D _{внеш} =1,47 мм ±10% D _{внутр} =1,27 мм ±10% L _{острия} =4,7 мм ±10% Цвет – оранжевый	
								Полиэтилен Mirason M 60 (GM1600E) (колпачок)
								Поликарбонат Makrolon 2858 (держатель)
								Полиэтилен М 60

								(GM1600E) / Краситель голубой (BlueDYE Liquid 8536000000) (крылышки – синие)
								Полиэтилен М 60 (GM1600E) / Краситель зеленый (TRACER DYE – GREEN) (крылышки – зеленые)
								Полиэтилен М 60 (GM1600E) / Краситель оранжевый (SPECTRUM ORANGE DYE) (крылышки – оранжевые)
								J-A2324, медицинская жидкость (силиконовое покрытие)
2	Протектор фистульной иглы	D _{нар} =10 мм ±10%, d _{внутр} =7,4 мм ±10%, H=65,2 мм ±10%						Поливинилхлорид гранулированный медицинский PVC FMM931NT01
3	Магистраль пластиковая	D _{внеш} =4,3 мм ±10% D _{внутр} =3,2 мм ±10% L=150±15 мм			D _{внеш} =4,3 мм ±10% D _{внутр} =3,2 мм ±10% L=300±9 мм			Поливинилхлорид пластифицированный медицинский экструзионный (RB3)
4	Зажим синий	Длина 25,5±1 мм						Полипропилен (HP371P)) Краситель синий (MASTER BLUE 66696)
5	Коннектор FLL	Диаметр соединения 4,1 мм ±10%. Длина 20±1мм						Поливинилхлорид гранулированный медицинский (PVCAM 88 W 17)
6	Колпачок защитный MLL	Диаметр соединения 7,45 мм ±10%. Длина 11,7±1мм						Акрилонитрилбутадиенстирол (ABSHI 121H)

ВНИМАНИЕ!




- Соблюдать правила асептики
- Не применять при нарушении целостности потребительской тары
- Однократного применения
- Повторному использованию и стерилизации не подлежит
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не менее 24 часов перед применением.
- Внимательно ознакомиться с инструкцией перед применением

Порядок работы изделия

1. Убедиться, что упаковка не повреждена. Извлечь изделие из упаковки.
2. Закрепить зажим.
3. Снять с коннектора защитный колпачок.
4. Подсоединить коннектор к основной магистрали.
5. Аккуратно снять защитный колпачок, не касаясь кончика иглы фистульной.

6. Ввести иглу фистульную в вену или фистулу пациента. Пластиковые крылышки должны быть расположены плоской стороной к коже пациента.
7. Открыть зажим, провести процедуру.
8. В конце процедуры закрыть зажим.
9. Удалить наконечник фистульной иглы из вены пациента.

Транспортирование и хранение



Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха до 98% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред и коррозионно-активных примесей при температуре воздуха от $+5$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения. Гарантийный срок годности изделия – 5 лет с даты стерилизации.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения.

После использования изделие должно быть утилизировано. Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б.

Утилизация отходов в процессе производства, неиспользованных по назначению игл и игл с истекшим сроком годности осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А по методикам утилизации отходов и 4 класса опасности (малоопасные) по степени воздействия на окружающую среду согласно Приказу Минприроды России № 536.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.

Изделие, имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту.

Стерилизация.

Изделие стерильно, нетоксично и апиrogenно в течение назначенного срока годности. Стерилизация газовая – окисью этилена по ГОСТ 7568.

Меры предосторожности.

Вскрывать упаковку с осторожностью, исключая повреждение изделия.

Соблюдать общие меры предосторожности при обращении с острыми предметами.

Избегать перегибов и запутывания трубок.


Использовать средства индивидуальной защиты.

Соблюдать правила техники безопасности в медицинских учреждениях

Критерии непригодности.

1. Не использовать изделие при поврежденной упаковке.
2. Не использовать изделие если истек срок годности.
3. Не использовать изделие при наличии на нем механических повреждений и/или загрязнений.

Символы и маркировка

	Использовать до указанной даты		Код партии
	Обратитесь к инструкции по применению		Температурный диапазон хранения изделия
	Не использовать при повреждении упаковки		Запрет на повторное применение
	Апирогенно		Стерилизация оксидом этилена
	Температурный диапазон при транспортировке изделия		Хрупкое. Обращаться осторожно
	Беречь от влаги		Штабелирование ограничено
	Количество изделий в таре транспортной или таре промежуточной		Изготовитель

надпись: «Нетоксично»

Упаковка.

Изделие упаковано в:

- индивидуальную упаковку («Материал упаковочный для стерилизации: рулоны комбинированные плоские и со складками «СтериТ» по ТУ 9398-083-11764404-2011» РУ № РЗН 2013/110, производитель ООО "НПФ "ВИНАР") размером 100х300±20% или 100х450±20%;
 - групповую упаковку, изготовленную из мелованного картона по ГОСТ 7933-89, размером 520х185х95±20%, в кол-ве 15-50 (300 мм) или 70 шт. (150 мм) в упаковке;
 - транспортную тару - ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142 размером 540х390х300 ±20%, в кол-ве 15-300 (300 мм) или 15-420 (150 мм) шт. в упаковке.
- Предельная масса брутто ящика с изделиями – 12 кг.

Перечень применяемых производителем (изготовителем) национальных стандартов

Обозначение	Наименование
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 5556-2022	Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия
ГОСТ Р 58144-2018	Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 7568-2018	Этилена окись. Технические условия.
ГОСТ 19126-2007	Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.
ГОСТ 10782-85	Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов. Технические условия.
ГОСТ 12026-76	Фильтровальная бумага лабораторная.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 25047-87	Устройства комплектные инфузионные, эксфузионные и трансфузионные однократного применения. Технические условия.
ГОСТ 25706-83	Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требо-

	вания
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Оценка биологического действия медицинских изделий. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными
ГОСТ ISO 10993-4-2020	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», применимом к медицинскому изделию
ГОСТ ИСО 10993-7-2016	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7 Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследование общетоксического действия
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Приготовление проб и контрольные образцы
ГОСТ ISO 11135-2017	Стерилизация медицинской продукции. Этиленоксид. Требования к разработке, валидации и текущему управлению процессом стерилизации медицинских изделий.
ТУ 25-1894.003-90	Секундомер механический однострелочный.
Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012г.	Номенклатурная классификация медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска применения (Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012г. N 4н, зарегистрированным в Минюсте России 09.07.2012 N 24852)
ГОСТ 12.1.004 - 91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ТУ 64-1-789-83	Шприц инъекционный многократного применения разборный
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ГОСТ ISO 11607-1-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам.
МУ 25.1-001-86	Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировке медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной доку-

	ментации. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. Общие технические условия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «ЛИДКОР», 620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ., СТР. 23, ОФИС 204

тел: 8 800 500 71 28

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Адрес места производства медицинского изделия:

ООО «ЛИДКОР», 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.3а

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
11 (одинадцать) л.



[Signature]
/Е. Ю. Гохгут/

ЛИДКОР

ООО «Лидкор»
Тел.: 8 (800) 500-71-28
marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Паспорта
на медицинское изделие**

Игла фистульная артериовенозная, стерильная по ТУ 32.50.13-010-65614693-2023



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Наименование изделия: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС

Назначение:

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 15G длиной 150 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!



Транспортирование и хранение:



Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид исполнения: артериальная 15G длиной 150 мм

партия №: _____ в количестве _____ шт.
соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для применения


М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от _____. ____ г.

Наименование изделия: **Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС**Назначение:**

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 15G длиной 300 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!**Транспортирование и хранение:**

+50°C
-50°C
Транспортировка

+40°C
+5°C
Хранение

Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид исполнения артериальная 15G длиной 300 мм

партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения


М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от _____. ____ г.

Наименование изделия: **Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС

Назначение:

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 16G длиной 150 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применения	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**


Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!



Транспортирование и хранение:



Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид исполнения артериальная 16G длиной 150 мм

партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения

М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата _____

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата _____
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от ____ . ____ . ____ г.

Наименование **Игла фистульная артериовенозная, стерильная,**
изделия: **одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС

Назначение:

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 16G длиной 300 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применения	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!



Транспортирование и хранение:



Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид артериальная 16G длиной 300 мм

исполнения

партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения


М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата _____

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата _____
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от ____-____-____ Г.

Наименование изделия: **Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС**Назначение:**

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 17G длиной 150 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!**Транспортирование и хранение:**

+50°C
-50°C
Транспортировка

+40°C
+5°C
Хранение

Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид исполнения артериальная 17G длиной 150 мм

партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения

М.П. Контролер ОКК

(подпись)

ф.и.о.

дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела

управления качеством

(подпись)

ф.и.о.

дата

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Наименование изделия: **Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС

Назначение:

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения артериальная 17G длиной 300 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**


Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!



Транспортирование и хранение:



Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид исполнения артериальная 17G длиной 300 мм

партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения


М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от ____ . ____ . ____ Г.

Наименование изделия: **Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС**Назначение:**

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 15G длиной 150 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!**Транспортирование и хранение:**

Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид исполнения венозная 15G длиной 150 мм

партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения


М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Наименование изделия: **Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС**Назначение:**

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.


Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 15G длиной 300 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!**Транспортирование и хранение:**

Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид исполнения: венозная 15G длиной 300 мм

партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения

М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Наименование **Игла фистульная артериовенозная, стерильная,**
изделия: **одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС**Назначение:**

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 16G длиной 150 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!**Транспортирование и хранение:**

+50°C
-50°C
Транспортировка

+40°C
+5°C
Хранение

Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид венозная 16G длиной 150 мм

исполнения
партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения


М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от ____ г.

Наименование **Игла фистульная артериовенозная, стерильная,**
изделия: **одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС**Назначение:**

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.


Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 16G длиной 300 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!**Транспортирование и хранение:**

Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид венозная 16G длиной 300 мм

исполнения
партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения

М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____/____ от _____. г.

Наименование изделия: **Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС

Назначение:

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 17G длиной 150 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применения	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**

Примечание: *-на партию, **- на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!



Транспортирование и хранение:



Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид исполнения венозная 17G длиной 150 мм

партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения

М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022



ООО «ЛИДКОР»

620102, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О.,
ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ПОСАДСКАЯ УЛ.,
СТР. 23, ОФИС 204
тел: 8 800 500 71 28
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

ОКПД2 32.50.13.110

РУ № РЗН ____ / ____ от ____ . ____ . ____ г.

Наименование **Игла фистульная артериовенозная, стерильная,**
изделия: **одноразовая**

ПАСПОРТ ЛДКР.0026.0000 ПС

Назначение:

Игла фистульная артериовенозная, стерильная (в дальнейшем – изделие), используется для доступа к кровеносным сосудам при проведении процедур, требующих экстракорпоральной циркуляции больших объемов крови, таких как плазмаферез и диализ.

Устройство используется в условиях клиник и больниц, в службе скорой помощи и в учреждениях службы крови.

Комплектность:

Наименование	Документ	Кол-во, шт.
Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая, вариант исполнения венозная 17G длиной 300 мм	ТУ 32.50.13-010-65614693-2023	1 шт.
Документация		
Инструкция по применению	ЛДКР.0026.1000 ИП	1 шт.**
Паспорт	ЛДКР.0026.0000 ПС	1 шт.*
Лист упаковочный	ЛДКР.0026.0000 ЛУ	1 шт.**


Примечание: *-на партию, ** - на 1 ящик

- Соблюдать правила асептики.
- Не использовать при нарушении целостности пакета потребительской тары.
- Однократного применения.
- Перед использованием ознакомится с инструкцией по применению.
- После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны при нормальных климатических условиях не 24 часов перед применением.
- Утилизировать после использования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, применительно к отходам класса Б

ВНИМАНИЕ!



Транспортирование и хранение:



Изделие в упаковке производителя транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, при температуре от -50 до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом отапливаемом помещении на стеллажах на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов в местах, защищенных от агрессивных сред при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности до 80% при +25°C.

Хранение в упаковке производителя 5 лет с даты стерилизации.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности изделий – 5 лет с даты стерилизации

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Свидетельство приемки:

Изделие: Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая

Вид венозная 17G длиной 300 мм

исполнения
партия №: _____ в количестве _____ шт.

соответствует требованиям ТУ 32.50.13-010-65614693-2023 и признано годным для

применения

М.П. Контролер ОКК _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата

Заключение: Изделие соответствует требованиям и безопасно для использования

Начальник отдела _____ (подпись) _____ ф.и.о. _____ дата
управления качеством

Место производства:

141981, Россия,
Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А,
тел: (49621) 28861, 28862
факс: (49621) 29022

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

лидкор

ООО «Лидкор»

Тел.: 8 (800) 500-71-28

marketing@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Упаковочные листы
на медицинское изделие**

Игла фистульная артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ 32.50.13-010-65614693-2023

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 15G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 16G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
артериальная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 150 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____

(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

ООО «Лидкор»

ЛИСТ УПАКОВОЧНЫЙ

Наименование изделия: Игла фистульная
артериовенозная, стерильная, одноразовая по ТУ
32.50.13-010-65614693-2023, вариант исполнения:
венозная 17G длиной 300 мм

Обозначение: _____

Партия №:

Количество:

Упаковщица _____
(подпись или №, дата)

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
13 (тринадцать) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/