ОМНИМЕД®

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»

_____ А.В.Лаврентьев

«_05_» _апреля_ 202_3_г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ СКЛАДНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

СТОЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ СКЛАДНОЙ СП

ПАСПОРТ

БВТГ 942818.001 ПС

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20649 от 19.07.2023 года

Внимание!
Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом

г. Нижний Новгород
Россия

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики медицинского изделия: Стол медицинский складной терапевтический с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023:

Стол перевязочный складной СП, далее – стол.

Паспорт предназначен для ознакомления с устройством стола и его правильной эксплуатации.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделия

Стол предназначен для размещения(лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

1.2 Область применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.3 Условия применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Потенциальный потребитель:

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.5 Показания к применению:

Стол предназначен для размещения(лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

1.6 Противопоказания к применению:

Противопоказания не выявлены.
Не применять не по назначению.

1.7 Побочные эффекты:

При правильном использовании изделий побочные эффекты не выявлены

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики стола приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя		Значение
2.1.1 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:		(1900x570) ±10 x (735…1025) ±10
2.1.2 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:		(1080x570x210) ±10
2.1.3 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-21		(1120x210x540) ±20
2.1.4 Угол поворота боковых панелей: - вниз: - вверх с фиксацией в пяти положениях:		90° (от 0 до 25°) ±2°
2.1.5 Максимальная распределенная нагрузка, кг		250
2.1.6 Материал:	- стол: алюминиевый, сталь нержавеющая; - чехлы матраса: клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием; внутренний состав – материал «Пенолон	
2.1.7 Условия эксплуатации (температура)		от минус 50 до плюс 45 °С
2.1.8 Средний срок службы, лет		5
2.1.9 Масса, кг		18,0±1,3
в том числе масса:		
2.1.10 Сумка транспортировочная СУ-21		1,5±0,3

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол., шт.
Стол перевязочный складной СП	БВТГ 942818.001	1
Сумка транспортировочная СУ-21	БВТГ 6.830.111-02	1
Паспорт	БВТГ 942818.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.001 РЭ	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4 Устройство

4.1 Общий вид стола приведен на рисунке 1.

4.2 Стол состоит из ложа, состоящего из средней панели (1) и двух откидных боковых панелей (2); двух складных рам опорных (3 и 4) с телескопическими опорами (5), установленных на средней панели (1).

Боковые панели (2) в рабочем положении поддерживаются разъемными опорами (6) и имеют возможность поворачиваться дискретно вверх от горизонтального положения на угол (от 0 до 25°) ±2° или вниз на угол 90° - при разъединении разъемных опор. Соединение разъемной опоры (6) производится с помощью фиксатора (9).

Опорные рамы (3 и 4) в рабочем положении фиксируются крючками (7).

Телескопические опоры (5) – выдвижные и стопорятся в выбранном положении фиксаторами (9).

4.3 Матрас (10) – съемный, состоит из трех частей и крепится на панелях стола с помощью текстильных застежек. Толщина матраса – 30 мм.Для выравнивания положения стола служат шаровые опоры (11).

4.4 Стол в сложенном виде приведен на рисунке 2.

4.5 Конструкция стола позволяет устанавливать на него санитарные носилки (рисунок 3).

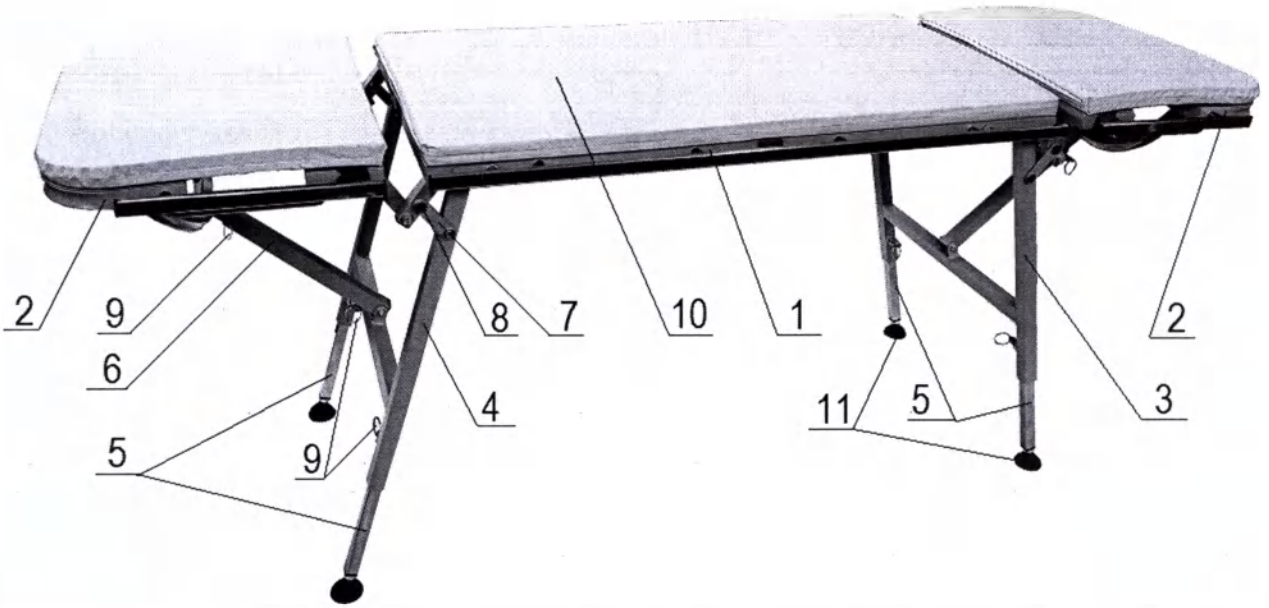

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора телескопическая; 6 – опора разъемная; 7 – крючок; 8 – втулка; 9 – фиксатор; 10 – матрас; 11 – опора шаровая.

Рисунок 1

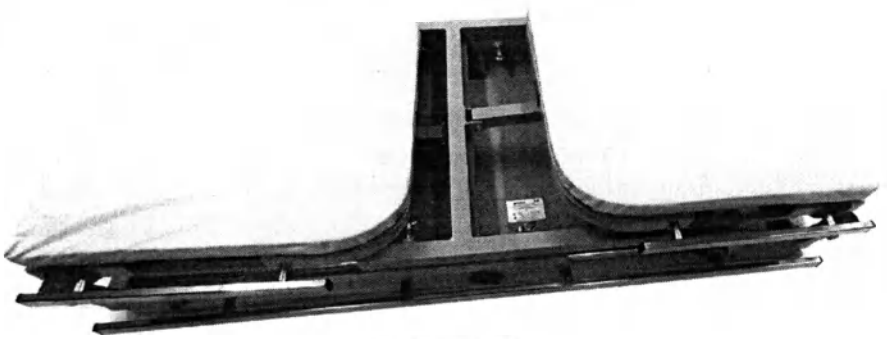

Рисунок 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 3
Установка санитарных носилок на столе перевязочном

5 Порядок работы

5.1 Установку стола в рабочее положение (рисунок 4) производить в следующей последовательности:
- извлечь стол из сумки транспортировочной и положить его на бок;
- разложить боковые панели (2);
- разложить рамы опорные до предельного положения: вначале раму опорную (4), затем раму опорную (3);
- разъемные опоры (6), поддерживающие боковые панели (2), соединить фиксаторами (9);
- рамы опорные (3 и 4) зафиксировать крючками (7), зацепив их за втулки (8);
- выдвинуть телескопические опоры (5) на нужную длину и застопорить фиксаторами (9);
- проверить устойчивость стола, отрегулировав при необходимости высоту шаровых опор (11).

5.2 **При необходимости:**
- поднять боковую панель (2) на угол (0…5…10…15…20…25) °, зафиксировав ее в нужном положении фиксатором (9);
- опустить боковую панель (2) вниз на угол 90°, разъединив разъемные опоры (6).
- для установки носилок – привести боковые панели (2) стола в горизонтальное положение и снять матрас (10);

5.3 Перевод стола из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:
- привести боковые панели (2) стола в горизонтальное положение;
- расфиксировать крючки (7) и положить стол на бок;
- расфиксировав фиксаторы (9) – задвинуть телескопические опоры (5) до упора;
- расфиксировав фиксаторы (9) – разъединить разъемные опоры (6);
- сложить опорные рамы: вначале раму опорную (3), затем раму опорную (4);
- сложить боковые панели (2);
- уложить стол в сумку транспортировочную.

ВНИМАНИЕ:
При переводе стола в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

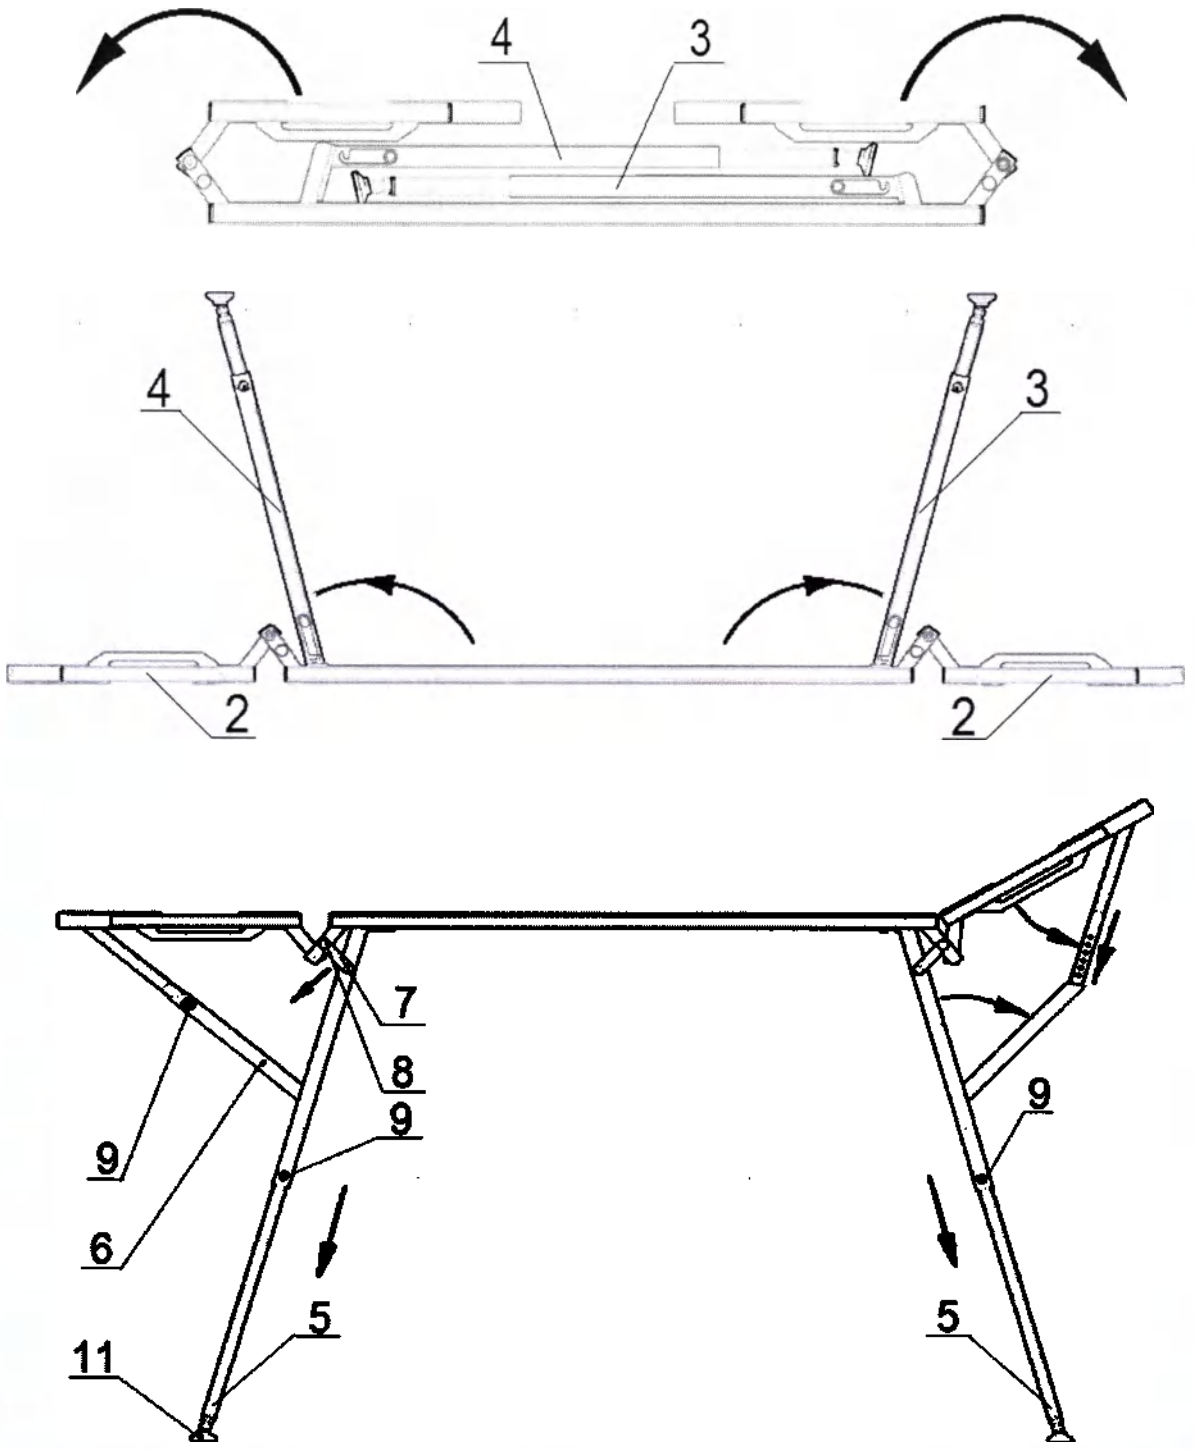

2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора телескопическая; 6 – опора разъемная; 7 – крючок; 8 – втулка; 9 – фиксатор; 11 – опора шаровая

Рисунок 4

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6 Меры безопасности

6.1 Стол предназначен для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации.

6.2 Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с эксплуатационной документацией.

6.3 При эксплуатации изделий необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.

6.4 Медицинские работники должны работать в перчатках.

6.5 При транспортировке стола и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.

6.6 Не нагружайте стол более, чем на 250 кг.

6.7 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего паспорта.

Внимание! Запрещается:

- Эксплуатировать стол с видимыми дефектами, а также с нарушениями структуры материалов;

- Использовать стол не по назначению.

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.

7.2 Перед применением должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.

7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование столов может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.

8.2 Стол может храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован).

8.3 При хранении столов допускается штабелирование в два яруса.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9 Сведения о маркировке

9.1 При маркировании стола (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
LOT	**Код партии**		**Изготовитель**		**Дата изготовления**
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз		**Диапазон влажности** Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз		
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны.				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги		**Верх** Указывает правильное вертикальное положение груза		**Хрупкое. Осторожно.** Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
2	**Предел по количеству ярусов в штабеле** Штабелировать не более 2 ярусов				

9.2 Внешний вид маркировки стола приведен на рисунке 5.

9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 6.

Рисунок 5

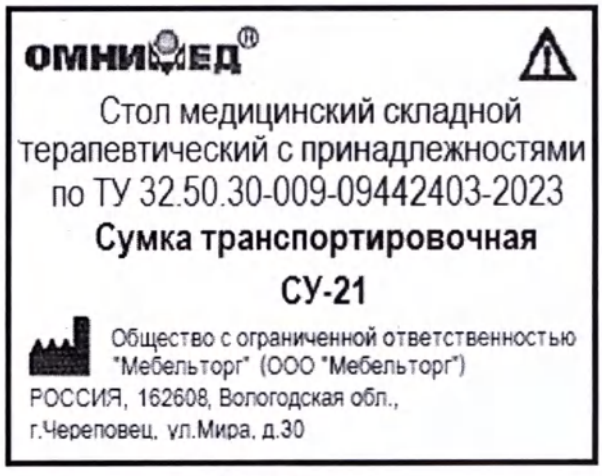

Рисунок 6

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.4 Внешний вид маркировки на сумке транспортировочной – рисунок 7.

Рисунок 7

10 Утилизация

10.1 Столы не содержат в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.

10.2 При нормальной эксплуатации столы не оказывают негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе стол не содержит драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.

10.3 Утилизация стола и его частей осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Стол после окончания использования может утилизироваться как отходы класса А в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов.

10.4 Неиспользованные столы специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Стол не взрывоопасен, не способен самовозгораться, при поднесении открытого огня горит без взрыва.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11 Гарантии изготовителя

11.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
11.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
11.3 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
11.4 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.
11.5 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего паспорта, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
11.6 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

12 Информация о производителе

12.1 Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3 Свидетельство о приемке

13.1 Стол медицинский складной терапевтический с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

Стол перевязочный складной СП Код партии _____

соответствует ТУ 32.50.30-009-09442403-2023 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Начальник ОТК _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 11 листов.
Генеральный директор
ООО «Омнимед-НН»

А.В. Лаврентьев

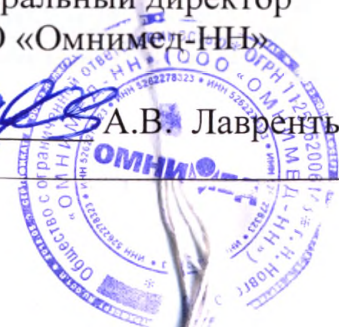

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОМНИМЕД®

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»

_____ А.В.Лаврентьев

«05» апреля 2023 г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ СКЛАДНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

СТОЛ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ СКЛАДНОЙ СП С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ПАСПОРТ

БВТГ 942818.001-01 ПС

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20649 от 19.07.2023 года

Внимание!
Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом

г. Нижний Новгород
Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики медицинского изделия: Стол медицинский складной терапевтический с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023:

Стол перевязочный складной СП с принадлежностями, далее – стол.

Паспорт предназначен для ознакомления с устройством стола и его правильной эксплуатации.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделия

Стол предназначен для размещения(лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

1.2 Область применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.3 Условия применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Потенциальный потребитель:

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.5 Показания к применению:

Предназначен для размещения(лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

1.6 Противопоказания к применению:

Противопоказания не выявлены.

Не применять не по назначению.

1.7 Побочные эффекты:

При правильном использовании изделий побочные эффекты не выявлены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики стола и принадлежностей приведены в таблицах 1, 1.1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение
2.1.1 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	(1900x570) ±10 x(735…1025)±10
2.1.2 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	(1080x570x210) ±10
2.1.3 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-20	(1100x300x640) ±20
2.1.4 Угол поворота боковых панелей: - вниз: - вверх с фиксацией в пяти положениях:	 90° (от 0 до 25°) ±2°
2.1.5 Максимальная распределенная нагрузка, кг	250
2.1.6 Материал	- стол: алюминиевый, сталь нержавеющая; - чехлы матраса: клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием; внутренний состав – материал «Пенолон
2.1.7 Условия эксплуатации (температура)	от минус 50 до плюс 45 °С
2.1.8 Средний срок службы, лет	5
2.1.9 Масса, кг	28,7±1,9
в том числе масса:	
2.1.10 Стойка для вливаний с креплением	0,8±0,1
2.1.11 Опора для руки с креплением (2 шт.)	2,4±0,2
2.1.12 Опора для ноги с креплением (2 шт.)	5,4±0,2
2.1.13 Дуга наркозная с креплением	1,4±0,1
2.1.14 Сумка транспортировочная СУ-20	2,2±0,3

Таблица 1.1

Параметры		Значения для 1 шт.	
		Размеры, мм	Масса, кг
Стойка для вливаний с креплением			
Диаметр под флаконы (внутренний)		(80/42) ±3,0	0,8±0,1
Максимальная высота крючка относительно панели стола		920±20	
Опора для руки с креплением			
Габаритные размеры опоры		(600x150x220) ±10	1,2±0,1
Максимальная высота относительно панели стола		150±10	
Опора для ноги с креплением			
Габаритные размеры опоры		(600x195x290) ±10	2,7±0,1
Максимальная высота относительно панели стола		515±10	
Дуга наркозная с креплением			
Габаритные размеры центральной секции	длина	725±10	1,4±0,1
	размер	(20x10) ±0,2	
Максимальная высота относительно панели стола		540±10	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол., шт.
Стол перевязочный складной СП с принадлежностями, БВТГ 942818.001-01:		
Стол перевязочный складной СП	БВТГ 942818.001	1
Сумка транспортировочная СУ-20	БВТГ 6.830.111-01	1
Стойка для вливаний с креплением	БВТГ 6.150.126	1
Паспорт	БВТГ 942818.001-01 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.001 РЭ	1
Принадлежности:		
Опоры для руки с креплениями	БВТГ 6.126.079	2
Опоры для ноги с креплениями	БВТГ 6.126.085	2
Дуга наркозная с креплением	БВТГ 6.139.001	1

4 Устройство

4.1 Общий вид стола приведен на рисунке 1.

4.2 Стол состоит из ложа, состоящего из средней панели (1) и двух откидных боковых панелей (2); двух складных рам опорных (3 и 4) с телескопическими опорами (5), установленных на средней панели (1).

Боковые панели (2) в рабочем положении поддерживаются разъемными опорами (6) и имеют возможность поворачиваться дискретно вверх от горизонтального положения на угол (от 0 до 25°) ±2°или вниз на угол 90° - при разъединении разъемных опор. Соединение разъемной опоры (6) производится с помощью фиксатора (9).

Опорные рамы (3 и 4) в рабочем положении фиксируются крючками (7).

Телескопические опоры (5) – выдвижные и стопорятся в выбранном положении фиксаторами (9).

4.3 Матрас (10) – съемный, состоит из трех частей и крепится на панелях стола с помощью текстильных застежек. Толщина матраса – 30 мм.

4.4 Для выравнивания положения стола служат шаровые опоры (11).

На боковых сторонах панелей (1, 2) предусмотрены направляющие, служащие для крепления стойки для вливаний с креплением (15) и принадлежностей:

- опоры для рук с креплениями (12);
- опоры для ног с креплениями (13);
- дуга наркозная с креплением (14).

Крепления представляют собой струбцины (16), при помощи которых стойка для вливаний и принадлежности крепятся к направляющим

4.5 **Стойка для вливаний с креплением** (15) предназначена для размещения флаконов и (или) полимерных контейнеров с растворами при проведении инфузионной терапии. Стойка для вливаний представляет собой колено с держателями флаконов для размещения флаконов и (или) полимерных контейнеров с инфузионными растворами и держателя с крючками для размещения полимерных контейнеров.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

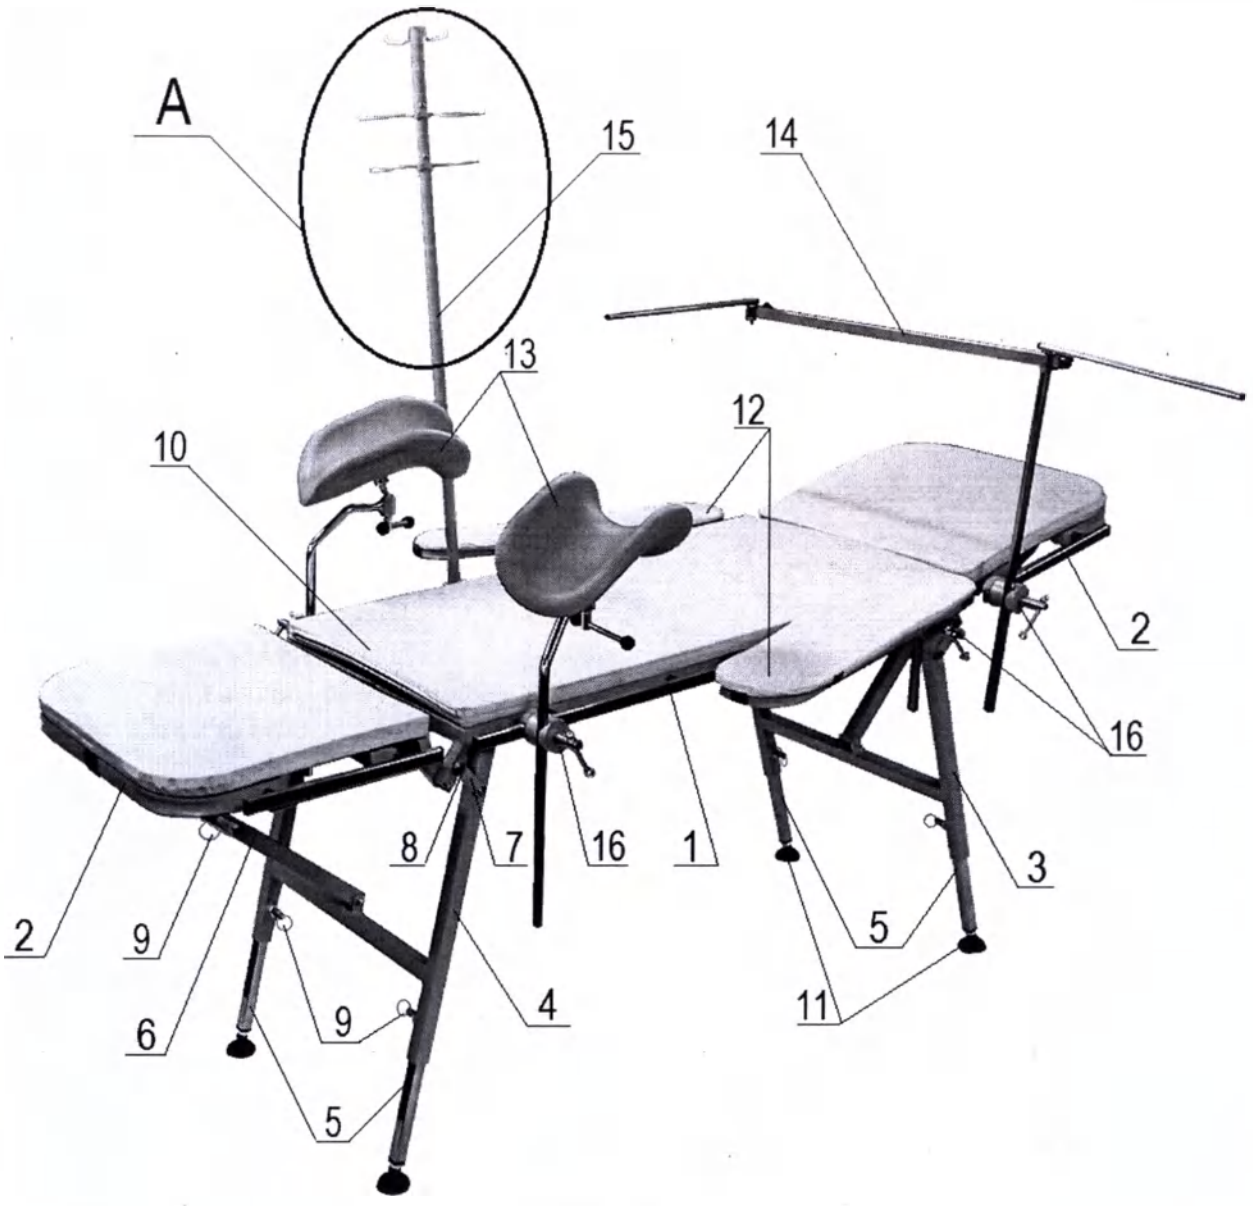

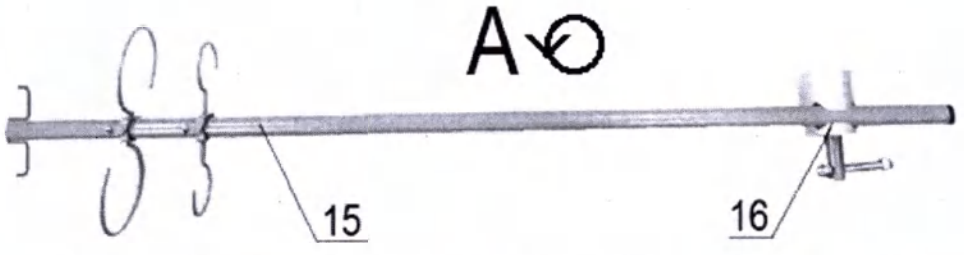

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные;
5 – опора телескопическая; 6 – опора разъемная; 7 – крючок; 8 – втулка;
9 – фиксатор; 10 – матрас; 11 – опора шаровая;
12 – опора для руки с креплением (струбцина 16);
13 – опора для ноги с креплением (струбцина 16);
14 – дуга наркозная с креплением (струбцина 16);
15 – стойка для вливаний с креплением (струбцина 16)

Рисунок 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.6 Принадлежности приведены на рисунке 2.

4.6.1 **Опоры для рук с креплениями** (12) предназначены для размещения рук пациента при проведении перевязок и несложных хирургических операций на руках, и для внутривенных вливаний. Опора для руки представляет собой площадку с мягкой накладкой, закрепленной при помощи текстильных застежек. Опора регулируется по высоте с помощью струбцины (16), расположенной на стойке опоры.

4.6.2 **Опоры для ног с креплениями** (13) предназначены для проведения перевязок и несложных хирургических операций пациентам в литотомическом положении. Элементы для размещения ног – подвижные, шарнирно закреплены на стойках – что позволяет вращать их вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Опора регулируется по высоте с помощью струбцины (16).

4.6.3 **Дуга наркозная с креплением** (14) предназначена для размещения простыни, отделяющей стерильную зону. Регулируется по высоте с помощью струбцины (16), наклоняется, имеет два боковых удлинителя.

4.6.4 Принадлежности (рисунок 2) крепятся к направляющим стола при помощи струбцин (16), расположенных на стойках.

ВНИМАНИЕ:
При установке принадлежностей проверьте надежность крепления их на панели стола.

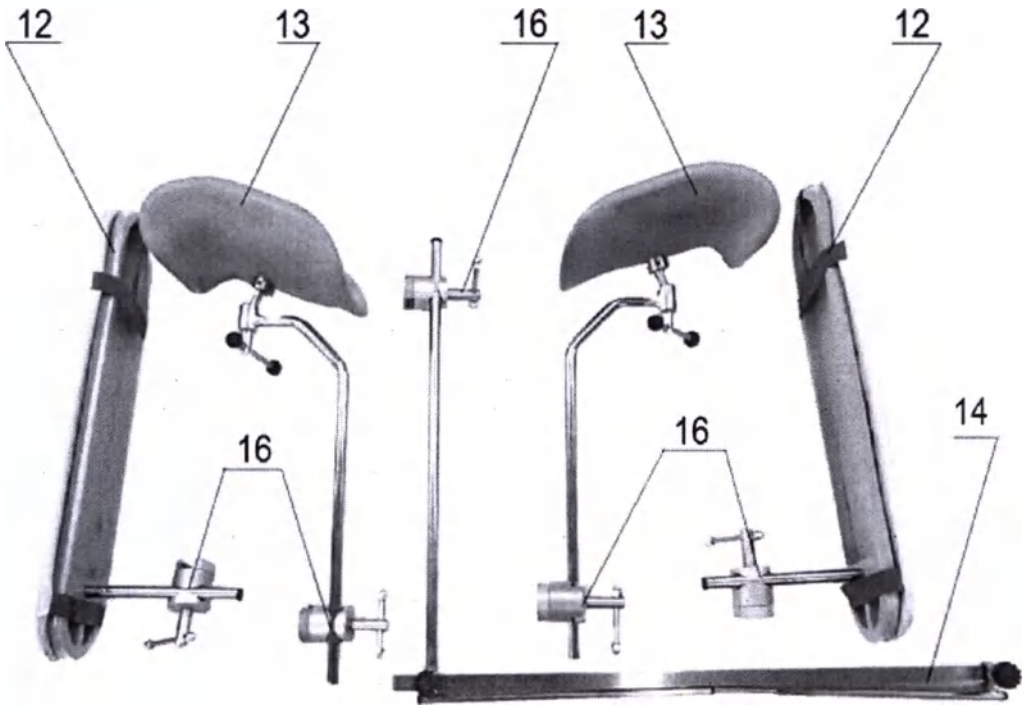

Струбцина

12 – опора для руки с креплением (струбцина 16);
13 – опора для ноги с креплением (струбцина 16);
14 – дуга наркозная с креплением (струбцина 16).

Рисунок 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.7 Стол в сложенном виде приведен на рисунке 3.

4.8 Конструкция стола позволяет устанавливать на него санитарные носилки (рисунок 4).

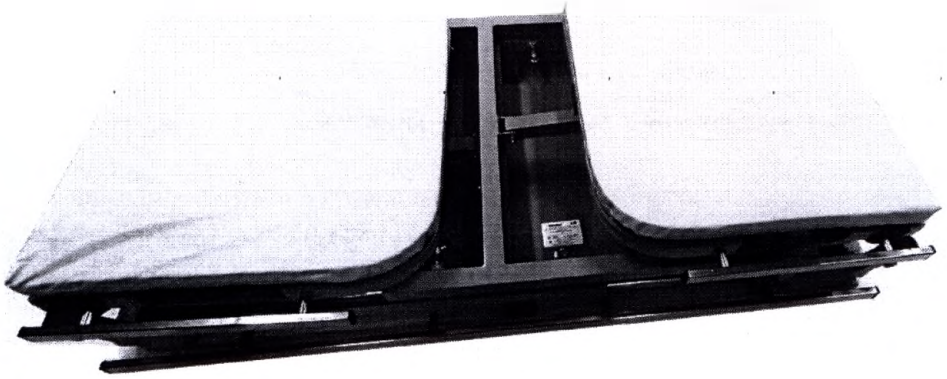

Рисунок 3

Рисунок 4 – Установка санитарных носилок на столе перевязочном

5 Порядок работы

5.1 Установку стола в рабочее положение (рисунок 5) производить в следующей последовательности:

- извлечь стол из сумки транспортировочной и положить его на бок;
- разложить боковые панели (2);
- разложить рамы опорные до предельного положения: вначале раму опорную (4), затем раму опорную (3);
- разъемные опоры (6), поддерживающие боковые панели (2), соединить фиксаторами (9);
- рамы опорные (3 и 4) зафиксировать крючками (7), зацепив их за втулки (8);
- выдвинуть телескопические опоры (5) на нужную длину и застопорить фиксаторами (9);
- проверить устойчивость стола, отрегулировав при необходимости высоту шаровых опор (11).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5.2 **При необходимости:**

- поднять боковую панель (2) на угол (0…5…10…15…20…25) °, зафиксировав ее в нужном положении фиксатором (9);
- опустить боковую панель (2) вниз на угол 90°, разъединив разъемные опоры (6);
- для установки носилок – привести боковые панели (2) стола в горизонтальное положение и снять матрас (10);
- установить стойку для вливаний с креплением (15);
- установить принадлежности (рисунок 2).

5.3 Перевод стола из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- привести боковые панели (2) стола в горизонтальное положение;
- снять стойку для вливаний с креплением (15);
- снять принадлежности (рисунок 2);
- расфиксировать крючки (7) и положить стол на бок;
- расфиксировав фиксаторы (9) – задвинуть телескопические опоры (5) до упора;
- расфиксировав фиксаторы (9) – разъединить разъемные опоры (6);
- сложить опорные рамы: вначале раму опорную (3), затем раму опорную (4);
- сложить боковые панели (2);
- уложить стол в сумку транспортировочную.

ВНИМАНИЕ:
При переводе стола в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления.

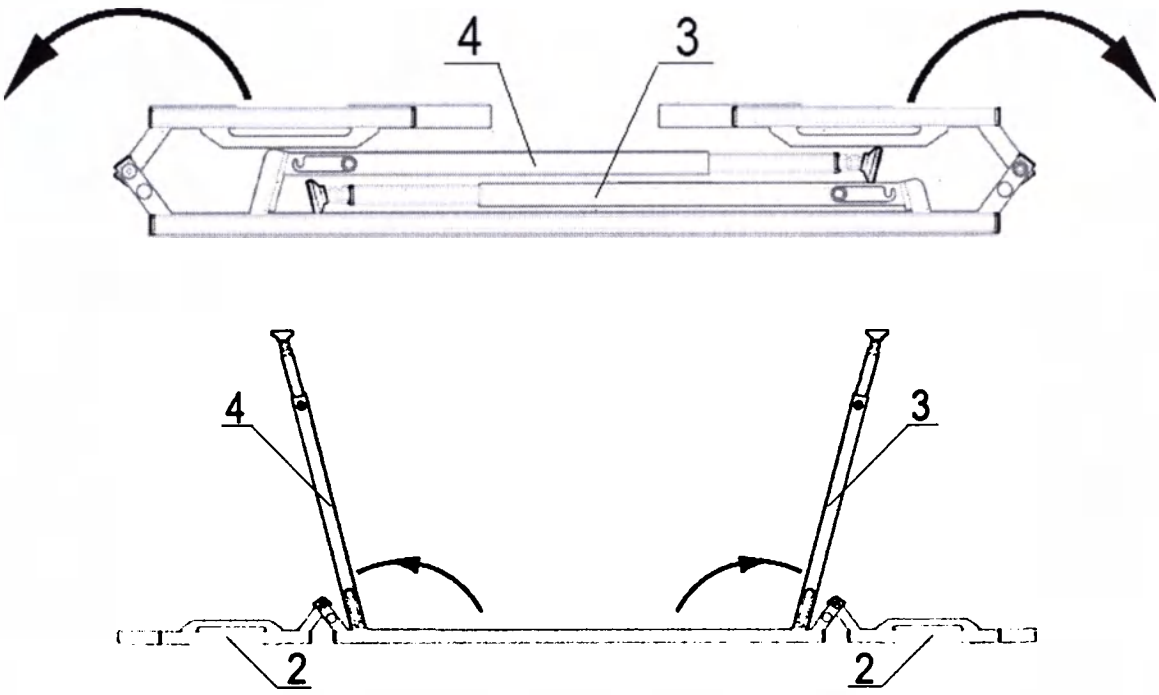

2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные
Рисунок 5 (лист 1 из 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

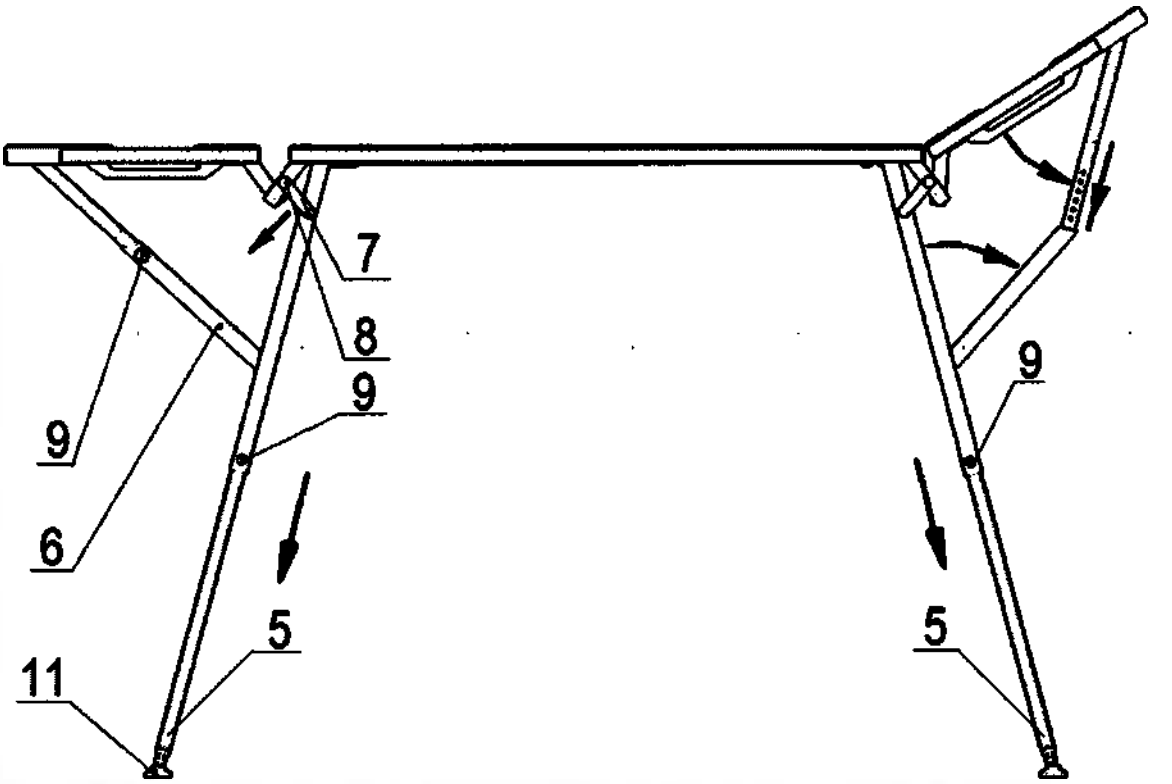

2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора телескопическая;
6 – опора разъемная; 7 – крючок; 8 – втулка; 9 – фиксатор; 11 – опора шаровая

Рисунок 5 (лист 2 из 2)

6 Меры безопасности

6.1 Стол предназначен для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации.

6.2 Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с эксплуатационной документацией.

6.3 При эксплуатации изделий необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.

6.4 Медицинские работники должны работать в перчатках.

6.5 При транспортировке стола и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.

6.6 Не нагружайте стол более, чем на 250 кг.

6.7 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего паспорта.

Внимание! Запрещается:

- Эксплуатировать стол с видимыми дефектами, а также с нарушениями структуры материалов;

- Использовать стол не по назначению.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.

7.2 Перед применением должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.

7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование столов может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.

8.2 Стол может храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован).

8.3 При хранении столов допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

9.1 При маркировании стола (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

9.2 Внешний вид маркировки стола приведен на рисунке 6. Внешний вид маркировки стойки для вливаний – рисунок 7, внешний вид маркировки принадлежностей – рисунок 8.

9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 9.

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
LOT	**Код партии**		**Изготовитель**		**Дата изготовления**
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз		**Диапазон влажности** Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз		
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны.				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги		**Верх** Указывает правильное вертикальное положение груза		**Хрупкое. Осторожно.** Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
2	**Предел по количеству ярусов в штабеле** Штабелировать не более 2 ярусов				

9.4 Внешний вид маркировки на сумке транспортировочной – рисунок 10.

Рисунок 9

Рисунок 10

10 Утилизация

10.1 Столы не содержат в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.

10.2 При нормальной эксплуатации столы не оказывают негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе стол не содержит драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.

10.3 Утилизация стола и его частей осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Стол после окончания использования может утилизироваться как отходы класса А в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10.4 Неиспользованные столы специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Стол не взрывоопасен, не способен самовозгораться, при поднесении открытого огня горит без взрыва.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
11.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
11.3 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
11.4 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.
11.5 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего паспорта, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
11.6 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

12 Информация о производителе

12.1 Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

13 Свидетельство о приемке

13.1 Стол медицинский складной терапевтический с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023:

Стол перевязочный складной СП с принадлежностями Код партии _____

соответствует ТУ 32.50.30-009-09442403-2023 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Начальник ОТК _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 12 листов.
Генеральный директор
ООО «Омнимед-НН»

А.В. Лаврентьев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОМНИМЕД®

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»

_____ А.В.Лаврентьев

«05» апреля 2023 г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ СКЛАДНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ПО ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

КУШЕТКА СМОТРОВАЯ СКЛАДНАЯ КС

ПАСПОРТ

БВТГ 942818.002 ПС

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20649 от 19.07.2023 года

Внимание!
Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом

г. Нижний Новгород
Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики медицинского изделия: Стол медицинский складной терапевтический с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023:

Кушетка смотровая складная КС, далее – кушетка.

Паспорт предназначен для ознакомления с устройством кушетки и ее правильной эксплуатации.

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделия

Кушетка предназначена для размещения (лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

1.2 Область применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.3 Условия применения:

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Потенциальный потребитель:

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.5 Показания к применению:

Предназначена для размещения (лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

1.6 Противопоказания к применению:

Противопоказания не выявлены.
Не применять не по назначению.

1.7 Побочные эффекты:

При правильном использовании изделий побочные эффекты не выявлены.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики кушетки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя		Значение
2.1.1 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:		(1900x515x580) ±10
2.1.2 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:		(1080x515x210) ±10
2.1.3 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-21		(1120x210x540) ±20
2.1.4 Угол наклона (подъема) боковых панелей с фиксацией в пяти положениях:		(от 0 до 25°) ±2°
2.1.5 Максимальная распределенная нагрузка, кг		250
2.1.6 Материал	- кушетка: алюминиевый; - чехлы матраса: клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием; внутренний состав – материал «Пенолон	
2.1.7 Условия эксплуатации (температура)		от минус 50 до плюс 45 °С
2.1.8 Средний срок службы, лет		5
2.1.9 Масса, кг		14,0±1,3
в том числе масса:		
2.1.10 Сумка транспортировочная СУ-21		1,5±0,3

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол., шт.
Кушетка смотровая складная КС	БВТГ 942818.002	1
Сумка транспортировочная СУ-21	БВТГ 6.830.111-02	1
Паспорт	БВТГ 942818.002 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.001 РЭ	1

4 Устройство

4.1 Общий вид кушетки приведен на рисунке 1.

Кушетка состоит из ложа, состоящего из средней панели (1) и двух откидных боковых панелей (2); двух складных рам опорных (3 и 4), установленных на средней панели (1).

Боковые панели (2) в рабочем положении поддерживаются разъемными опорами (5) и имеют возможность поворачиваться дискретно вверх от горизонтального положения на угол (от 0 до 25°) ±2° или вниз на угол 90° - при разъединении разъемных опор (5). Соединение разъемной опоры (5) производится с помощью фиксатора (8).

4.2 Опорные рамы (3 и 4) в рабочем положении фиксируются крючками (6).

4.3 Матрас (9) – съемный, состоит из трех частей и крепится на панелях кушетки с помощью текстильных застежек. Толщина матраса – 30 мм.

4.4 Для выравнивания положения кушетки служат шаровые опоры (10).

4.5 Кушетка в сложенном виде приведена на рисунке 2.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

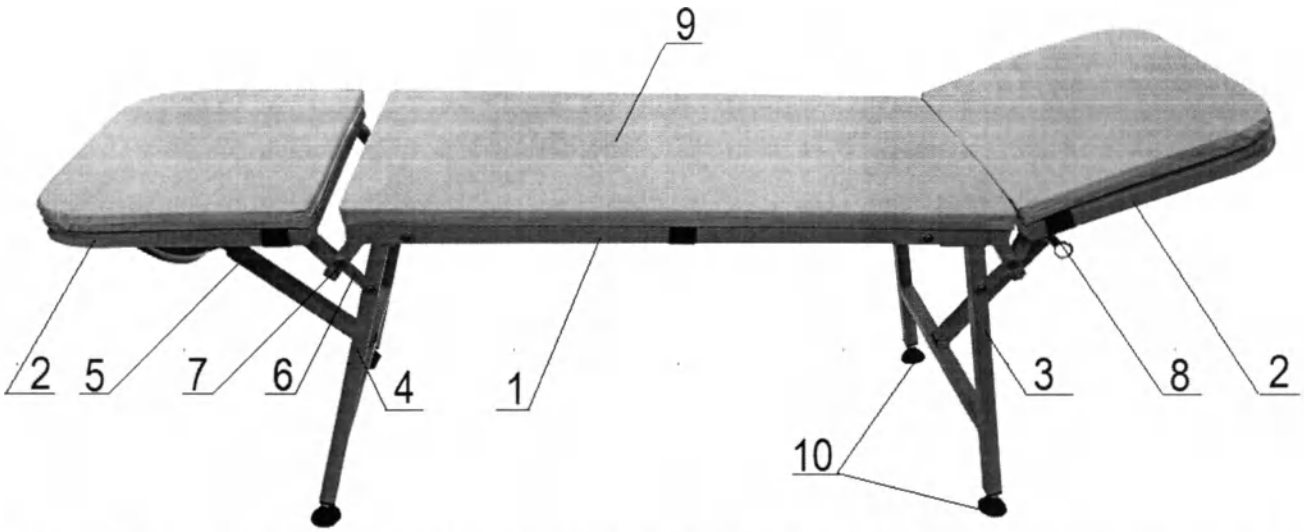

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора разъемная; 6 – крючок; 7 – втулка; 8 – фиксатор; 9 – матрас; 10 – опора шаровая.

Рисунок 1

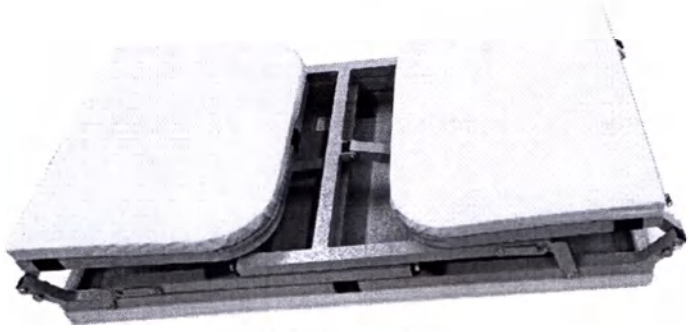

Рисунок 2

5 Порядок работы

5.1 Установку кушетки в рабочее положение (рисунок 3) производить в следующей последовательности:

- извлечь кушетку из сумки транспортировочной и положить ее на бок;
- разложить боковые панели (2);
- разложить рамы опорные до предельного положения: вначале раму опорную (4), затем раму опорную (3);
- разъемные опоры (5), поддерживающие боковые панели (2), соединить фиксаторами (8);
- рамы опорные (3 и 4) зафиксировать крючками (6), зацепив их за втулки (7);
- проверить устойчивость кушетки, отрегулировав при необходимости высоту шаровых опор (10).

5.2 **При необходимости:**

- поднять боковую панель (2) на угол (0…5…10…15…20…25) °, зафиксировав ее в нужном положении фиксатором (8);
- опустить боковую панель (2) вниз на угол 90°, разъединив разъемные опоры (5).

5.3 Перевод кушетки из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- привести боковые панели (2) в горизонтальное положение;
- расфиксировать крючки (6) и положить кушетку на бок;
- расфиксировав фиксаторы (8) – разъединить разъемные опоры (5);
- сложить опорные рамы: вначале раму опорную (3), затем раму опорную (4);
- сложить боковые панели (2);
- уложить кушетку в сумку транспортировочную.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ВНИМАНИЕ:

При переводе кушетки в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления.

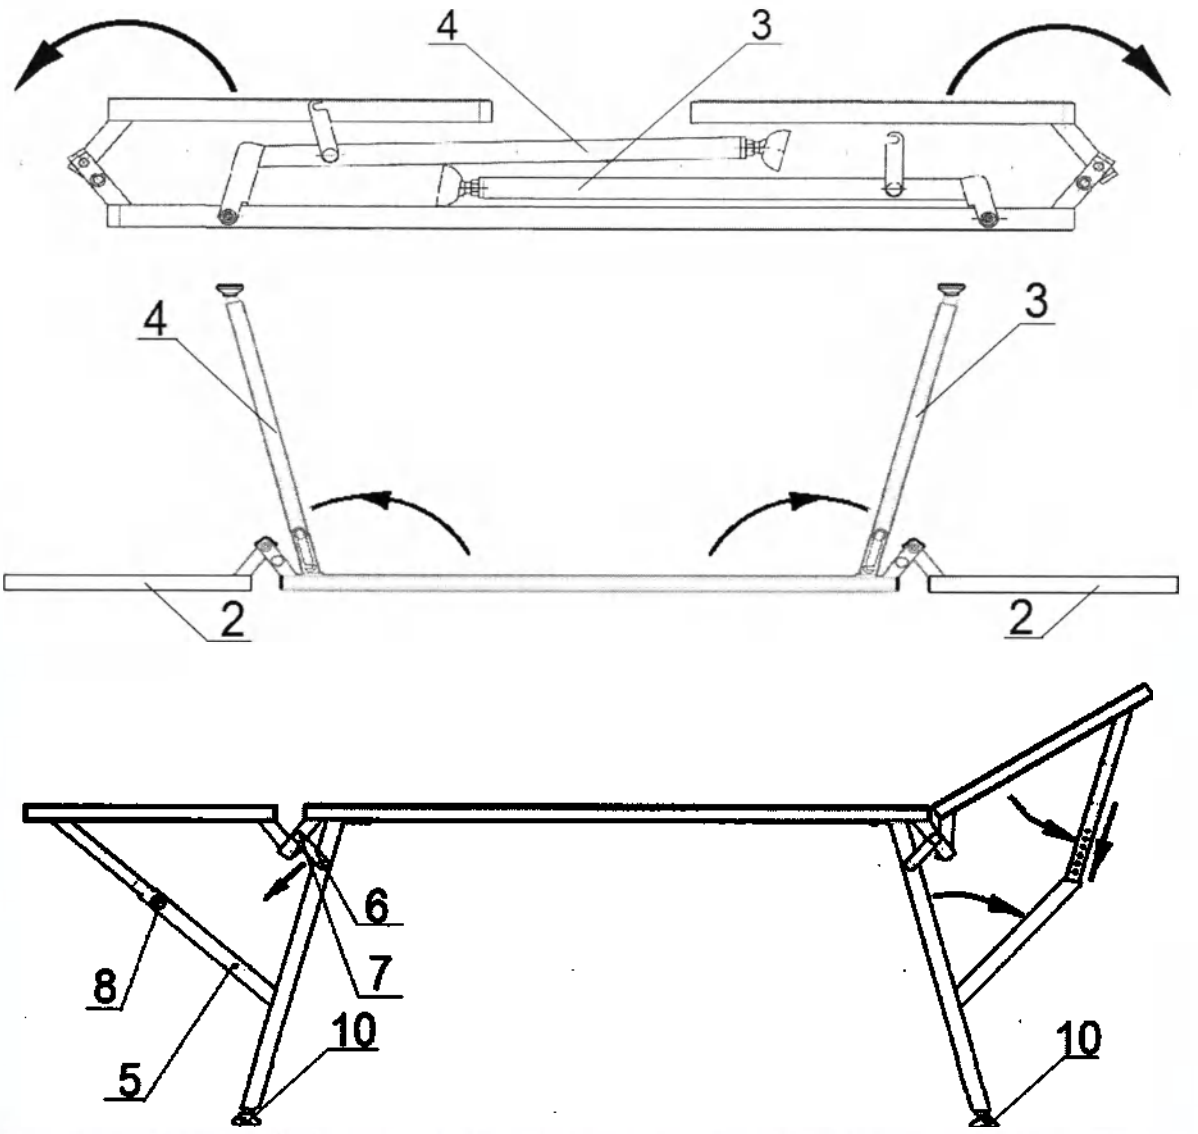

2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора разъемная; 6 – крючок; 7 – втулка; 8 – фиксатор; 10 – опора шаровая

Рисунок 3

6 Меры безопасности

6.1 Кушетка предназначена для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации.

6.2 Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

6.3 При эксплуатации изделий необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.

6.4 Медицинские работники должны работать в перчатках

6.5 При транспортировке кушеток и работе с ними избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделия.

6.6 Не нагружайте кушетку более, чем на 250 кг.

6.7 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего паспорта.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Внимание! Запрещается:

- Эксплуатировать кушетку с видимыми дефектами, а также с нарушениями структуры материалов;

- Использовать кушетку не по назначению.

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.

7.2 Перед применением должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий.

7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование кушеток может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.

8.2 Кушетка может храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 25 °С. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован).

8.3 При хранении кушеток допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

9.1 При маркировании кушетки (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 3.

9.2 Внешний вид маркировки кушетки приведен на рисунке 4.

9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 5.

Рисунок 4

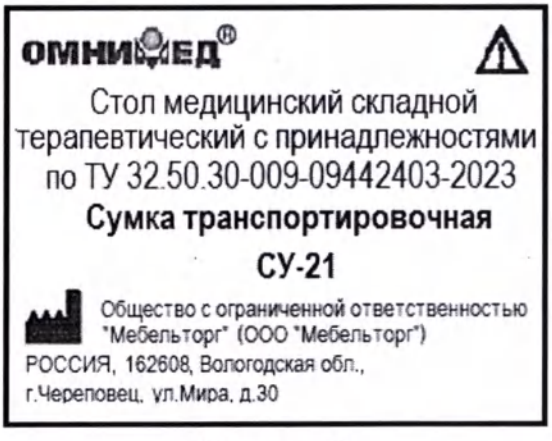

Рисунок 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 3

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
LOT	Код партии		Изготовитель		Дата изготовления
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз		**Диапазон влажности** Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз		
	Осторожно! Указывает на необходимость соблюдения мер предосторожности при обращении с изделием или элементом управления вблизи расположения символа, или что требуется особая осведомленность пользователя, либо необходимы некоторые действия с его стороны.				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги		**Верх** Указывает правильное вертикальное положение груза		**Хрупкое. Осторожно.** Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом
	Предел по количеству ярусов в штабеле Штабелировать не более 2 ярусов				

9.4 Внешний вид маркировки на сумке транспортировочной – рисунок 6.

Рисунок 6

10 Утилизация

10.1 Кушетки не содержат в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.

10.2 При нормальной эксплуатации кушетки не оказывают негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе кушетка не содержит драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье.

10.3 Утилизация кушеток и их частей осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Кушетка после окончания использования может утилизироваться как отходы класса А в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10.4 Неиспользованные кушетки специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Кушетка не взрывоопасна, не способна самовозгораться, при поднесении открытого огня горит без взрыва.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
11.2 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
11.3 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.
11.4 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.
11.5 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего паспорта, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.
11.6 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

12 Информация о производителе

12.1 Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

13 Свидетельство о приемке

13.1 Стол медицинский складной терапевтический с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

Кушетка смотровая складная КС Код партии _____

соответствует ТУ 32.50.30-009-09442403-2023 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Начальник ОТК _____ _____
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Штамп ОТК

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 8 листов.
Генеральный директор
ООО «Омнимед-НН»

А.В. Лаврентьев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Омнимед-НН»

_____ А.В.Лаврентьев

«_05_» _апреля_ 2023 г.

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ СКЛАДНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ПО ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БВТГ 942810.001 РЭ

ООО «Омнимед-НН»
г. Нижний Новгород
Россия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Содержание

1 Основные сведения и технические данные 4

1.1 Наименование изделий в зависимости от исполнения 4

1.2 Назначение 4

1.3 Область применения 4

1.4 Условия применения 4

1.5 Потенциальный потребитель 4

1.6 Показания к применению 4

1.7 Противопоказания к применению 4

1.8 Побочные эффекты 4

2 Основные технические характеристики 5

3 Комплектность 7

4 Варианты исполнения изделий 8

5 Меры безопасности 17

6 Указания по эксплуатации 17

7 Техническое обслуживание 17

8 Транспортирование и хранение 17

9 Сведения о маркировке 18

10 Упаковка 19

11 Утилизация 20

12 Гарантии изготовителя 20

13 Послегарантийное техническое обслуживание 20

Приложение А (справочное) Перечень ссылочных документов 21

Приложение Б (справочное) Устройство и внешний вид изделий 22

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Руководство по эксплуатации, далее – РЭ, предназначено для ознакомления с медицинским изделием «Стол медицинский складной терапевтический с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023», далее – изделия:

Стол перевязочный складной СП, в составе:
Стол перевязочный складной СП – 1шт.
Сумка транспортировочная СУ-21 – 1шт.
Паспорт – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Стол перевязочный складной СП с принадлежностями, в составе:
Стол перевязочный складной СП – 1шт.
Стойка для вливаний с креплением – 1шт.
Сумка транспортировочная СУ-20 – 1шт.
Паспорт – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Принадлежности:
Опора для руки с креплением – 2шт.
Опора для ноги с креплением – 2шт.
Дуга наркозная с креплением – 1шт.

Кушетка смотровая складная, в составе:
Кушетка смотровая складная КС – 1шт.
Сумка транспортировочная СУ-21 – 1шт.
Паспорт – 1шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Информация о производителе

Контактная информация:

Производитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мебельторг» (ООО «Мебельторг»)
Юридический адрес:	162626, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская, д.24, корпус А, этаж цокольный
Место производства:	ООО «Мебельторг» 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, д.30
Тел.:	8 (8202) 54-10-54
e-mail:	info@mebeltorg.org
Уполномоченный представитель производителя	Общество с ограниченной Ответственностью «Омнимед-НН» (ООО «Омнимед-НН») Россия, 603054, г. Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, 5А, корп. 2 Тел. 8 (831) 282-60-68, e-mail: info@omnimed.ru

РЭ содержит описание изделий, их устройство, принцип работы, и устанавливает привила эксплуатации (транспортирования и хранения, применения, утилизации и пр.).

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией.

- При эксплуатации изделий необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.

- Медицинские работники должны работать в перчатках в соответствии с СанПиН 2.1.3678.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1 Основные сведения и технические данные

1.1 Наименование изделий в зависимости от исполнения:

Стол перевязочный складной СП по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

Стол перевязочный складной СП с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

Кушетка смотровая складная КС по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

1.2 Назначение

Изделия предназначены для размещения (лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

1.3 Область применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.4 Условия применения

Подразделения медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, стационарные и полевые медицинские комплексы различного профиля, другие медицинские организации.

1.5 Потенциальный потребитель

Медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

1.6 Показания к применению

Изделия предназначены для размещения (лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

1.7 Противопоказания к применению

Противопоказания не выявлены.

Не применять не по назначению.

1.8 Побочные эффекты

При правильном использовании изделий побочные эффекты не выявлены.

Климатическое исполнение У категории 1 по ГОСТ 15150.

Изделия в зависимости от потенциального риска применения относится к классу 1 по ГОСТ 31508 и Приказу МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г.

Вид медицинского изделия 370500 «Стол для осмотра/терапевтических процедур складной для оснащения медицинских объектов в полевых условиях».

Изделия в зависимости от воспринимаемых механических воздействий относятся к группе 5 по ГОСТ Р 50444.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2 Основные технические характеристики

2.1 Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации, приведенному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и условное обозначение	Обозначение документа
Стол перевязочный складной СП	БВТГ 942818.001
Стол перевязочный складной СП с принадлежностями	БВТГ 942818.001-01
Кушетка смотровая складная КС	БВТГ 942818.002

2.1.1 Габаритные размеры должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 2, 2.1 и приложению Б.

2.1.2 Масса приведена в таблицах 2, 2.1.

2.1.3 Максимальная распределенная нагрузка – 250 кг. При этом 10% нагрузки на головную часть, 70% нагрузки на центральную часть, 20% нагрузки на ножную часть.

2.1.4 Материалы: Стол перевязочный складной СП и Стол перевязочный складной СП с принадлежностями – сплав алюминиевый, сталь нержавеющая: Кушетка смотровая складная КС – сплав алюминиевый. Материал чехлов матрасов – клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием; внутренний состав – материал «Пенолон».

2.1.5 Условия эксплуатации (температура): от минус 50 до плюс 45 °С

2.1.6 Средний срок службы изделий – пять лет. Критерием предельного состояния изделий является технико-экономическая нецелесообразность их восстановления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 2

Наименование показателя	Значение
Стол перевязочный складной СП	
2.1.7 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	(1900х570) ±10 х (735…1025) ±10
2.1.8 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	(1080х570х210) ±10
2.1.9 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-21	(1120х210х540) ±20
2.1.10 Масса, кг	18,0±1,3
в том числе масса:	
2.1.11 Сумка транспортировочная СУ-21	1,5±0,3
Стол перевязочный складной СП с принадлежностями	
2.1.12 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	(1900х570) ±10 х(735…1025)±10
2.1.13 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	(1080х570х210) ±10
2.1.14 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-20	(1100х300х640) ±20
2.1.15 Масса, кг	28,7±1,9
в том числе масса:	
2.1.16 Стойка для вливаний с креплением	0,8±0,1
2.1.17 Опора для руки с креплением (2 шт.)	2,4±0,2
2.1.18 Опора для ноги с креплением (2 шт.)	5,4±0,2
2.1.19 Дуга наркозная с креплением	1,4±0,1
2.1.20 Сумка транспортировочная СУ-20	2,2±0,3
Кушетка смотровая складная КС	
2.1.21 Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	(1900х515х580) ±10
2.1.22 Габаритные размеры в сложенном виде, мм:	(1080х515х210) ±10
2.1.23 Габаритные размеры сумки транспортировочной СУ-21	(1120х210х540) ±20
2.1.24 Масса, кг	14,0±1,3
в том числе масса:	
2.1.25 Масса сумки транспортировочной СУ-21	1,5±0,3

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Таблица 2.1

Параметры		Значения для 1 шт.	
		Размеры, мм	Масса, кг
Стойка для вливаний с креплением			
Диаметр под флаконы (внутренний)		(80/42) ±3,0	0,8±0,1
Максимальная высота крючка относительно панели стола		920±20	
Опора для руки с креплением			
Габаритные размеры опоры		(600x150x220) ±10	1,2±0,1
Максимальная высота относительно панели стола		150±10	
Опора для ноги с креплением			
Габаритные размеры опоры		(600x195x290) ±10	2,7±0,1
Максимальная высота относительно панели стола		515±10	
Дуга наркозная с креплением			
Габаритные размеры центральной секции	длина	725±10	1,4±0,1
	размер	(20x10) ±0,2	
Максимальная высота относительно панели стола		540±10	

3 Комплектность

3.1 Комплектность должна соответствовать приведенной таблице 3.

Таблица 3

Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол. шт.
Стол перевязочный складной СП		
Стол перевязочный складной СП	БВТГ 942818.001	1
Сумка транспортировочная СУ-21	БВТГ 6.830.111-02	1
Паспорт	БВТГ 942818.001 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.001 РЭ	1
Стол перевязочный складной СП с принадлежностями		
Стол перевязочный складной СП	БВТГ 942818.001	1
Сумка транспортировочная СУ-20	БВТГ 6.830.111-01	1
Стойка для вливаний с креплением	БВТГ 6.150.126	1
Паспорт	БВТГ 942818.001-01 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.001 РЭ	1
Принадлежности:		
Опора для руки с креплением	БВТГ 6.126.079	2
Опора для ноги с креплением	БВТГ 6.126.085	2
Дуга наркозная с креплением	БВТГ 6.139.001	1
Кушетка смотровая складная КС		
Кушетка смотровая складная КС	БВТГ 942818.002	1
Сумка транспортировочная СУ-21	БВТГ 6.830.111-02	1
Паспорт	БВТГ 942818.002 ПС	1
Руководство по эксплуатации	БВТГ 942810.001 РЭ	1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4 Варианты исполнения изделий

4.1 Стол перевязочный складной СП по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023 и Стол перевязочный складной СП с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023:

Стол перевязочный складной СП;

Стол перевязочный складной СП с принадлежностями, далее – стол, предназначен для размещения(лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

4.1.1 Устройство

Общий вид стола приведен на рисунках 1, 3.

Стол состоит из ложа, состоящего из средней панели (1) и двух откидных боковых панелей (2); двух складных рам опорных (3 и 4) с телескопическими опорами (5), установленных на средней панели (1).

Боковые панели (2) в рабочем положении поддерживаются разъемными опорами (6) и имеют возможность поворачиваться дискретно вверх от горизонтального положения на угол (от 0 до 25°) ±2°, или вниз на угол 90° - при разъединении разъемных опор. Соединение разъемной опоры (6) производится с помощью фиксатора (9).

Опорные рамы (3 и 4) в рабочем положении фиксируются крючками (7).

Телескопические опоры (5) – выдвижные и стопорятся в выбранном положении фиксаторами (9).

Матрас (10) – съемный, состоит из трех частей и крепится на панелях стола с помощью текстильных застежек. Толщина матраса – 30 мм.

Для выравнивания положения стола служат шаровые опоры (11).

Стол перевязочный складной СП с принадлежностями:

На боковых сторонах панелей (1, 2) предусмотрены направляющие, служащие для крепления стойки для вливаний с креплением (15) и принадлежностей:

- опоры для рук с креплениями (12);
- опоры для ног с креплениями (13);
- дуга наркозная с креплением (14).

Крепления представляют собой струбцины (16), при помощи которых принадлежности крепятся к направляющим.

Стойка для вливаний с креплением (15) предназначена для размещения флаконов и (или) полимерных контейнеров с растворами при проведении инфузионной терапии. Стойка для вливаний представляет собой колено с держателями флаконов для размещения флаконов и (или) полимерных контейнеров с инфузионными растворами и держателя с крючками для размещения полимерных контейнеров.

Принадлежности приведены на рисунке 4.

- **Опоры для рук с креплениями** (12) предназначены для размещения рук пациента при проведении перевязок и несложных хирургических операций на руках, и для внутривенных вливаний. Опора для руки представляет собой площадку с мягкой накладкой, закрепленной при помощи текстильных застежек. Опора регулируется по высоте с помощью струбцины (16), расположенной на стойке опоры.
- **Опоры для ног с креплениями** (13) предназначены для проведения перевязок и несложных хирургических операций пациентам в литотомическом положении. Элементы для размещения ног – подвижные, шарнирно закреплены на стойках – что позволяет вращать их вокруг вертикальной и горизонтальной оси. Опора регулируется по высоте с помощью струбцины (16).
- **Дуга наркозная с креплением** (14) предназначена для размещения простыни, отделяющей стерильную зону. Регулируется по высоте с помощью струбцины (16), наклоняется, имеет два боковых удлинителя.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принадлежности крепятся к направляющим стола при помощи струбцин (16), расположенных на стойках.

Столы в сложенном виде приведены на рисунках 2, 5.

Конструкция стола позволяет устанавливать на него санитарные носилки (рисунок 6).

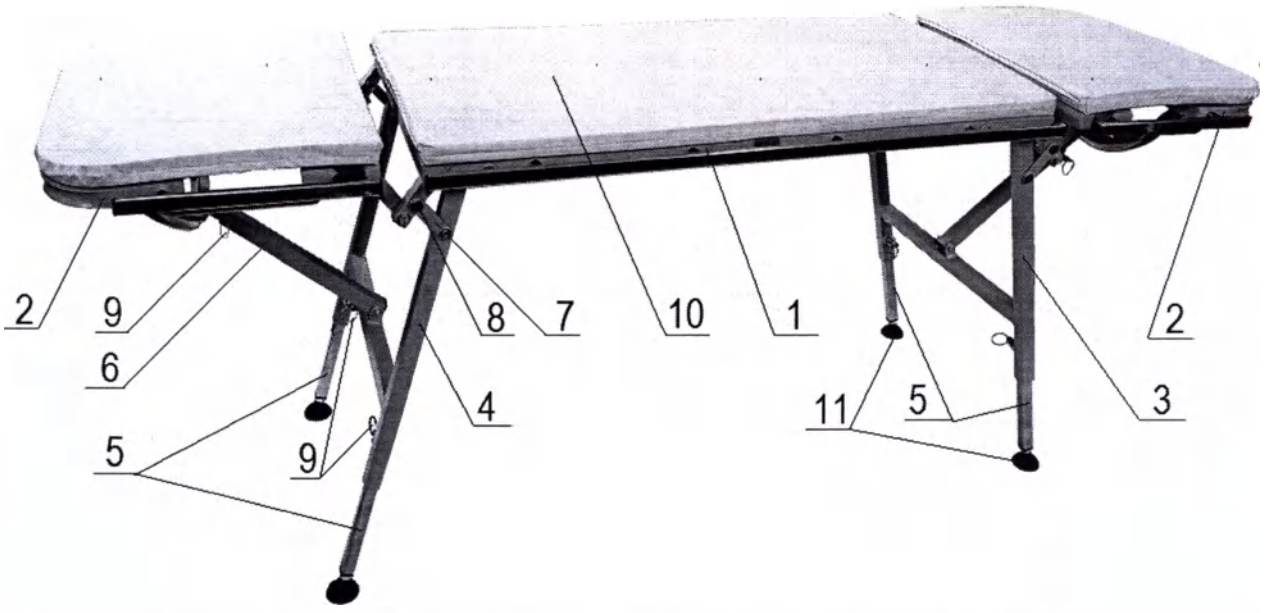

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора телескопическая; 6 – опора разъемная; 7 – крючок; 8 – втулка; 9 – фиксатор; 10 – матрас; 11 – опора шаровая

Рисунок 1 – Стол перевязочный складной СП

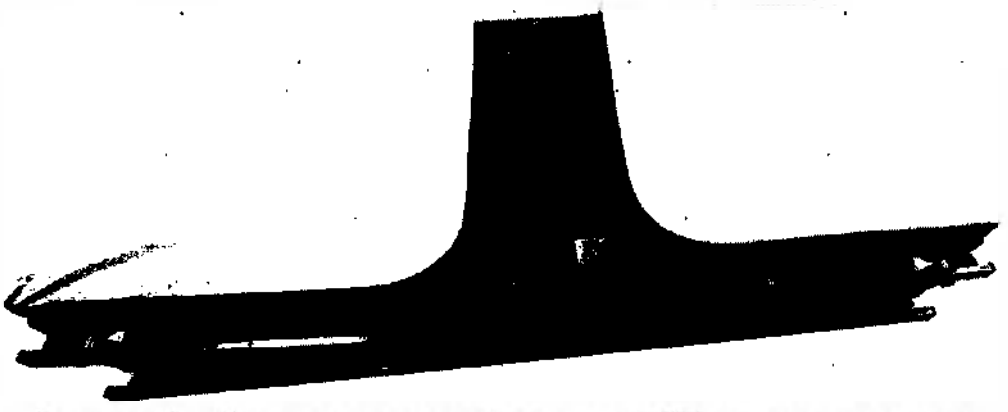

Рисунок 2 – Стол перевязочный складной СП в сложенном виде

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

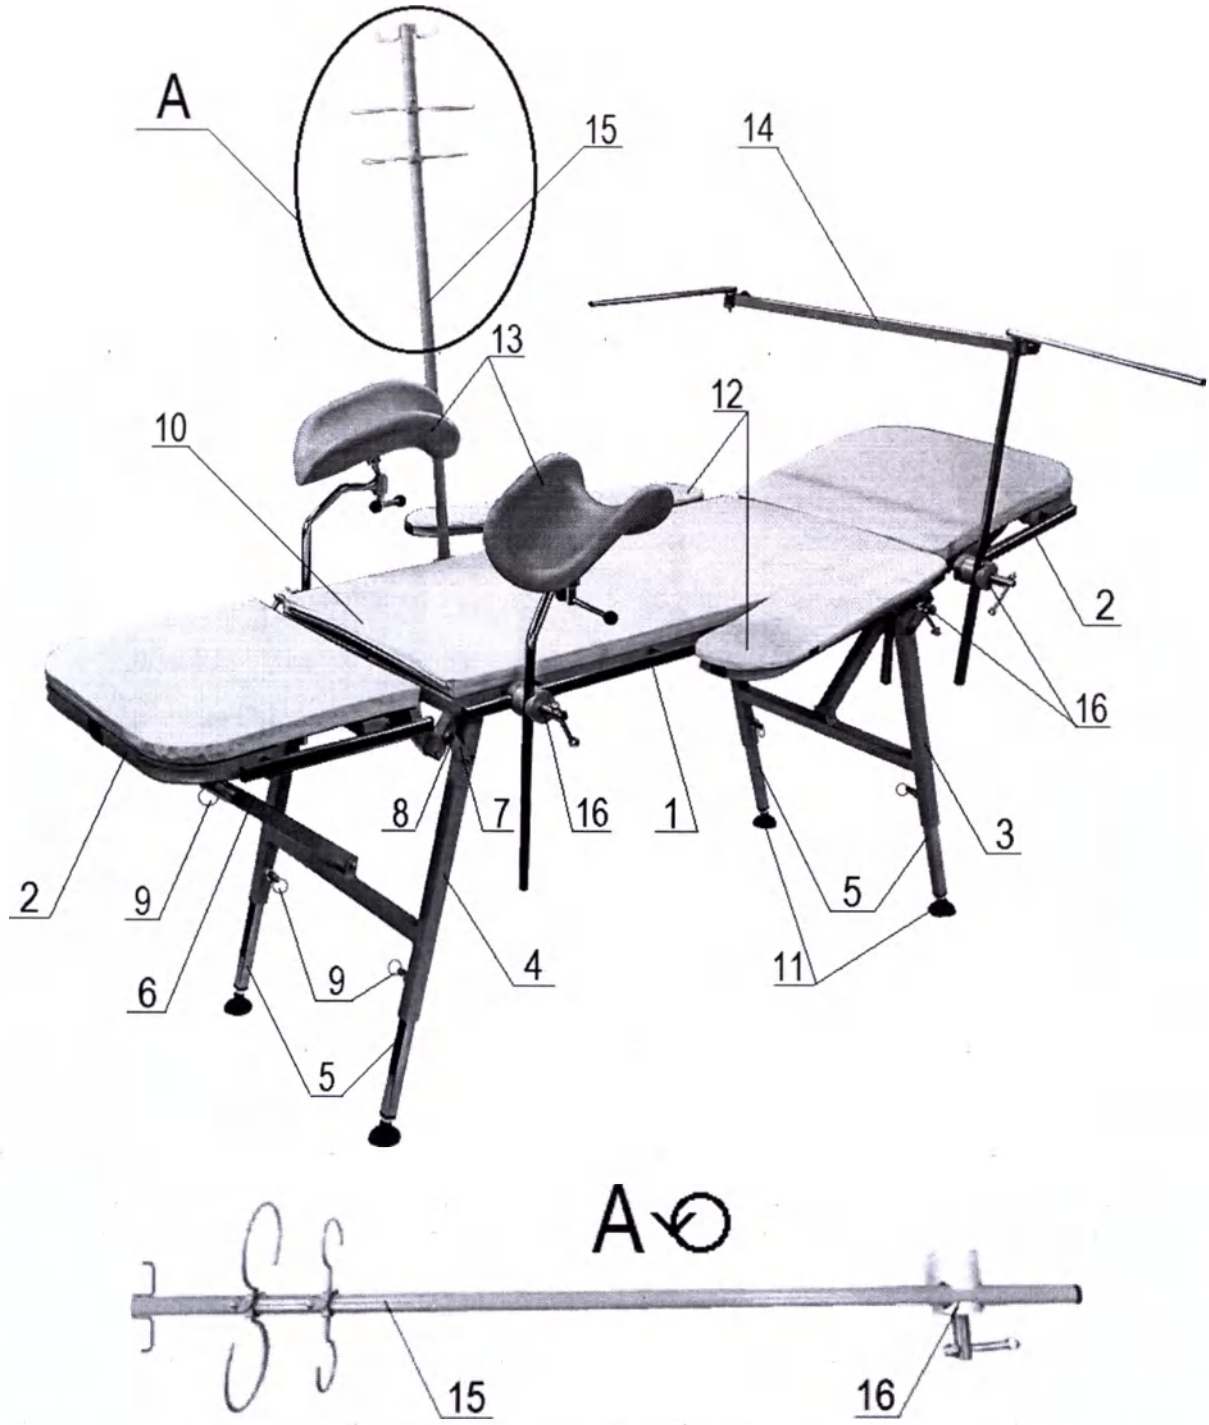

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные;
5 – опора телескопическая; 6 – опора разъемная; 7 – крючок; 8 – втулка;
9 – фиксатор; 10 – матрас; 11 – опора шаровая;
12 – опора для руки с креплением (струбцина 16);
13 – опора для ноги с креплением (струбцина 16);
14 – дуга наркозная с креплением (струбцина 16);
15 – стойка для вливаний с креплением (струбцина 16)

Рисунок 3 – Стол перевязочный складной СП с принадлежностями

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

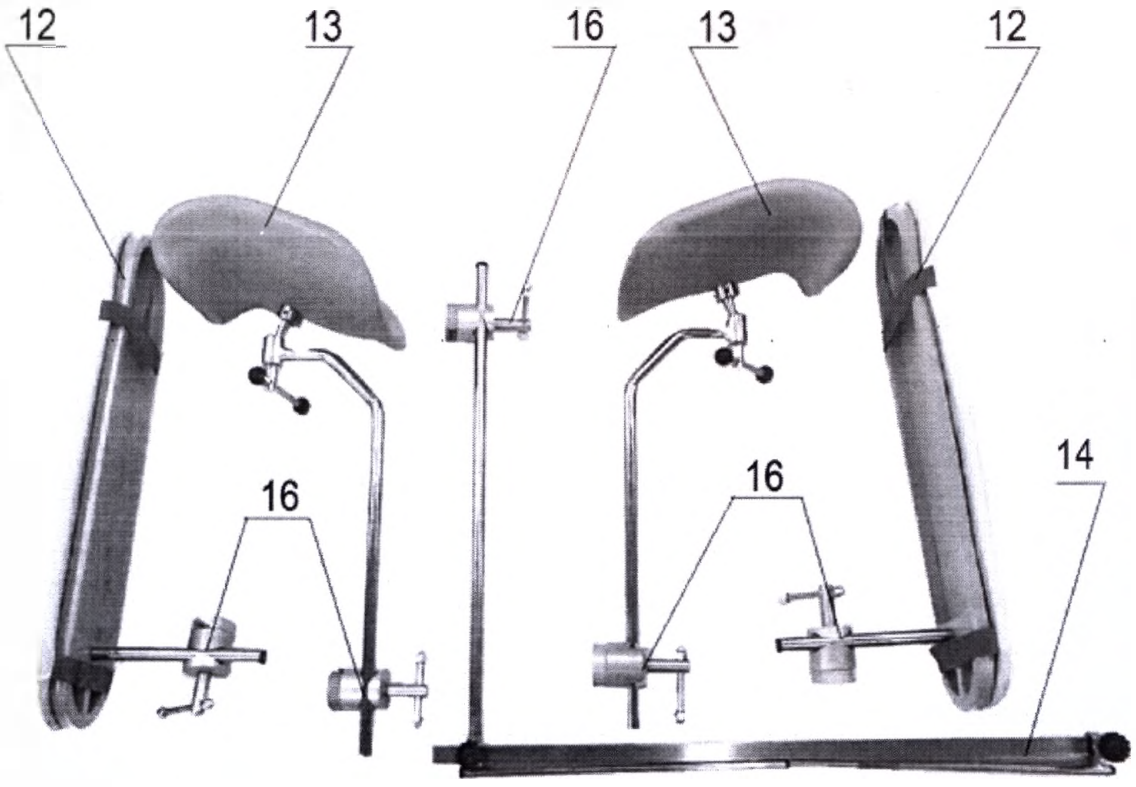

Струбцина

12 – опора для руки с креплением (струбцина 16);
13 – опора для ноги с креплением (струбцина 16);
14 – дуга наркозная с креплением (струбцина 16).

Рисунок 4 – Принадлежности (для: Стол перевязочный складной СП с принадлежностями)

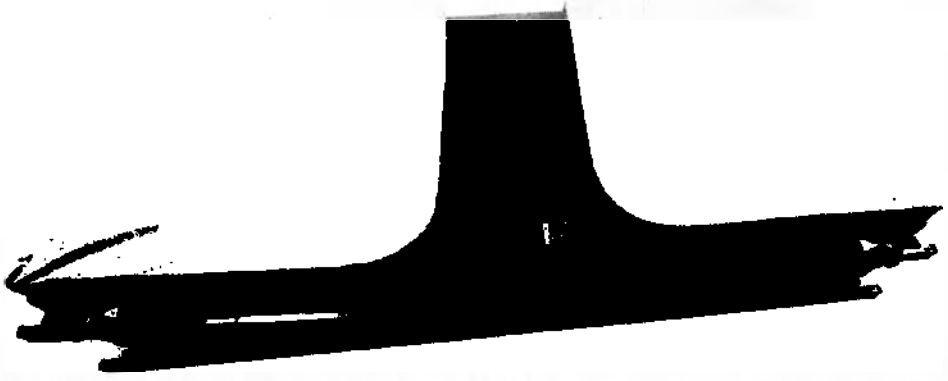

Рисунок 5 – Стол перевязочный складной СП с принадлежностями сложенном виде

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 6 – Установка санитарных носилок на столе перевязочном

4.1.2 Порядок работы

Установку стола в рабочее положение (рисунок 7) производить в следующей последовательности:
- извлечь стол из сумки транспортировочной и положить его на бок;
- разложить боковые панели (2);
- разложить рамы опорные до предельного положения: вначале раму опорную (4), затем раму опорную (3);
- разъемные опоры (6), поддерживающие боковые панели (2), соединить фиксаторами (9);
- рамы опорные (3 и 4) зафиксировать крючками (7), зацепив их за втулки (8);
- выдвинуть телескопические опоры (5) на нужную длину и застопорить фиксаторами (9);
- проверить устойчивость стола, отрегулировав при необходимости высоту шаровых опор (11).

При необходимости:
- поднять боковую панель (2) на угол (0…5…10…15…20…25) °, зафиксировав ее в нужном положении фиксатором (9);
- опустить боковую панель (2) вниз на угол 90°, разъединив разъемные опоры (6);
- для установки носилок (рисунок 6) – привести боковые панели (2) стола в горизонтальное положение и снять матрас (10);

Для **Стол перевязочный складной СП с принадлежностями –** установить стойку для вливаний (15) и принадлежности (рисунок 4) при помощи струбцин (16).

Перевод стола из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:
- привести боковые панели (2) стола в горизонтальное положение;
- снять стойку для вливаний (15) и принадлежности (рисунок 4) – (только для: **Стол перевязочный складной СП с принадлежностями)**;
- расфиксировать крючки (7) и положить стол на бок;
- расфиксировав фиксаторы (9) – задвинуть телескопические опоры (5) до упора;
- расфиксировав фиксаторы (9) – разъединить разъемные опоры (6);
- сложить опорные рамы: вначале раму опорную (3), затем раму опорную (4);
- сложить боковые панели (2);
- уложить стол в сумку транспортировочную.

ВНИМАНИЕ:
При переводе стола в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

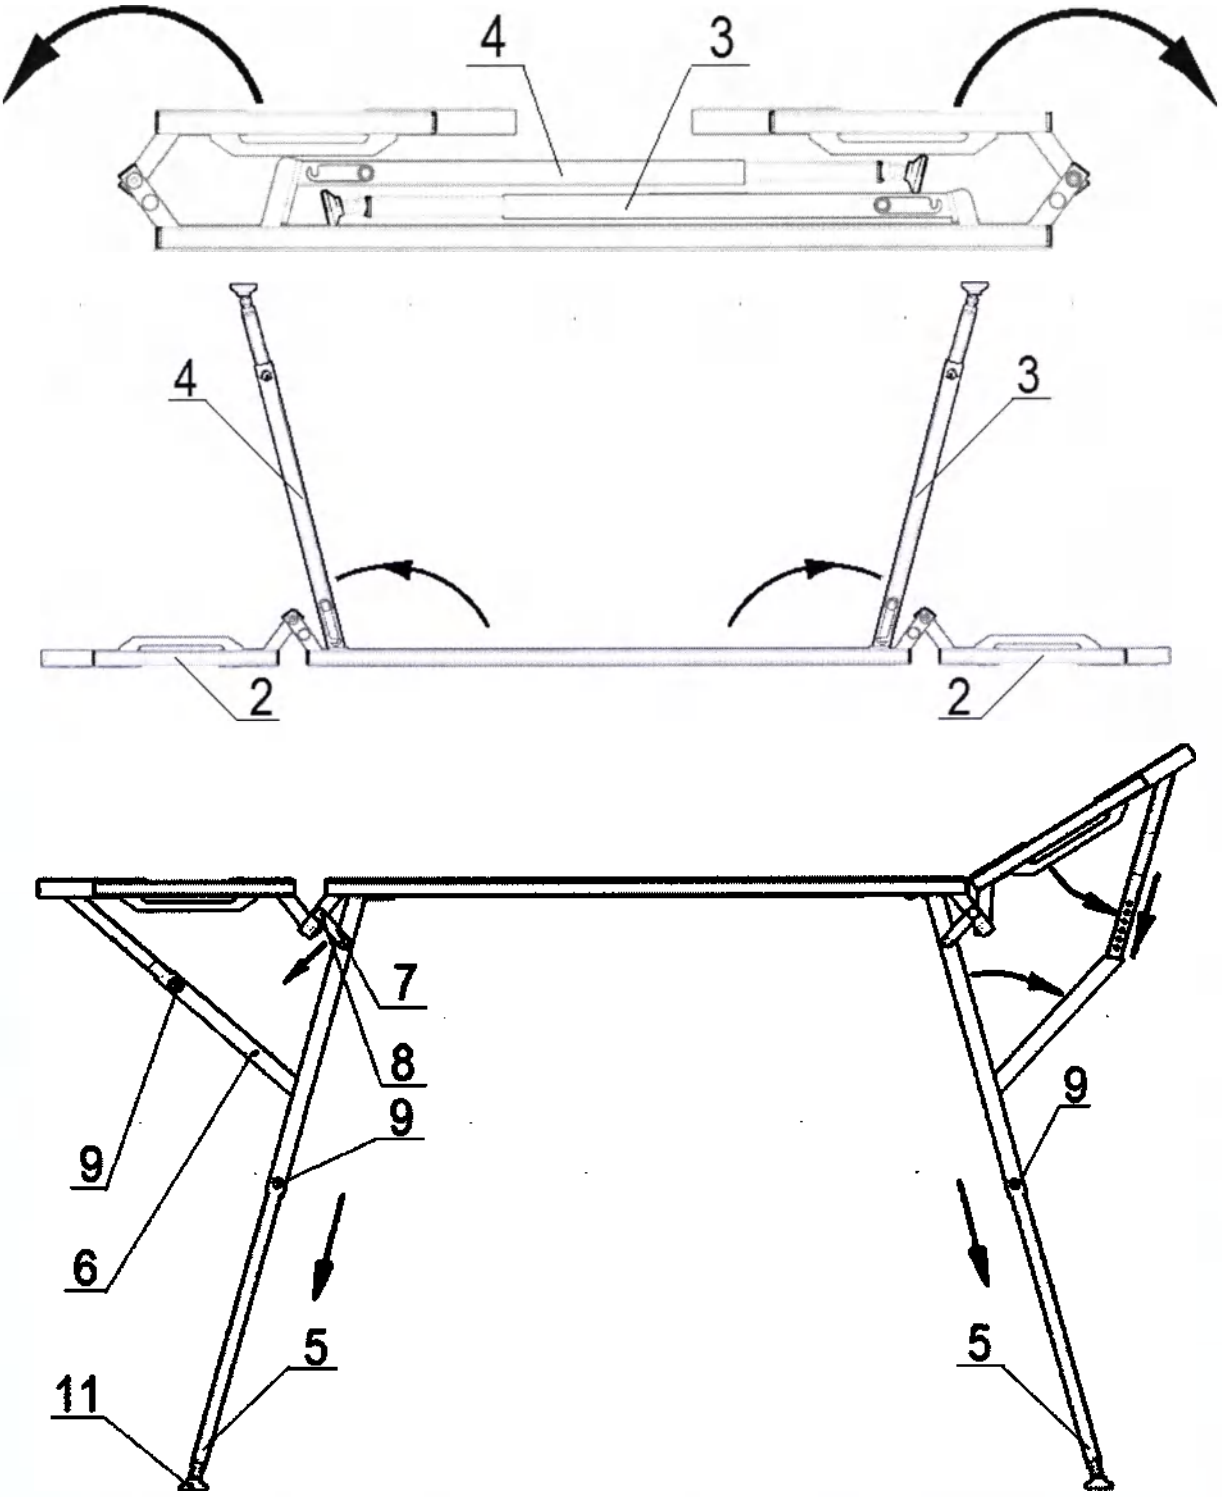

2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора телескопическая;
6 – опора разъемная; 7 – крючок; 8 – втулка; 9 – фиксатор; 11 – опора шаровая

Рисунок 7 – Установка стола в рабочее положение

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.2 Кушетка смотровая складная КС по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023

Кушетка смотровая складная КС, далее – кушетка, предназначена размещения (лежания) пациентов при проведении общих осмотров и других медицинских процедур для оснащения медицинских объектов в полевых условиях.

4.2.1 Устройство

Общий вид кушетки приведен на рисунке 8.

Кушетка состоит из ложа, состоящего из средней панели (1) и двух откидных боковых панелей (2); двух складных рам опорных (3 и 4), установленных на средней панели (1).

Боковые панели (2) в рабочем положении поддерживаются разъемными опорами (5) и имеют возможность поворачиваться дискретно вверх от горизонтального положения на угол (от 0 до 25°) ±2° или вниз на угол 90° - при разъединении разъемных опор (5). Соединение разъемной опоры (5) производится с помощью фиксатора (8).

Опорные рамы (3 и 4) в рабочем положении фиксируются крючками (6).

Матрас (9) – съемный, состоит из трех частей и крепится на панелях кушетки с помощью текстильных застежек. Толщина матраса – 30 мм.

Для выравнивания положения кушетки служат шаровые опоры (10).

Кушетка в сложенном виде приведена на рисунке 9.

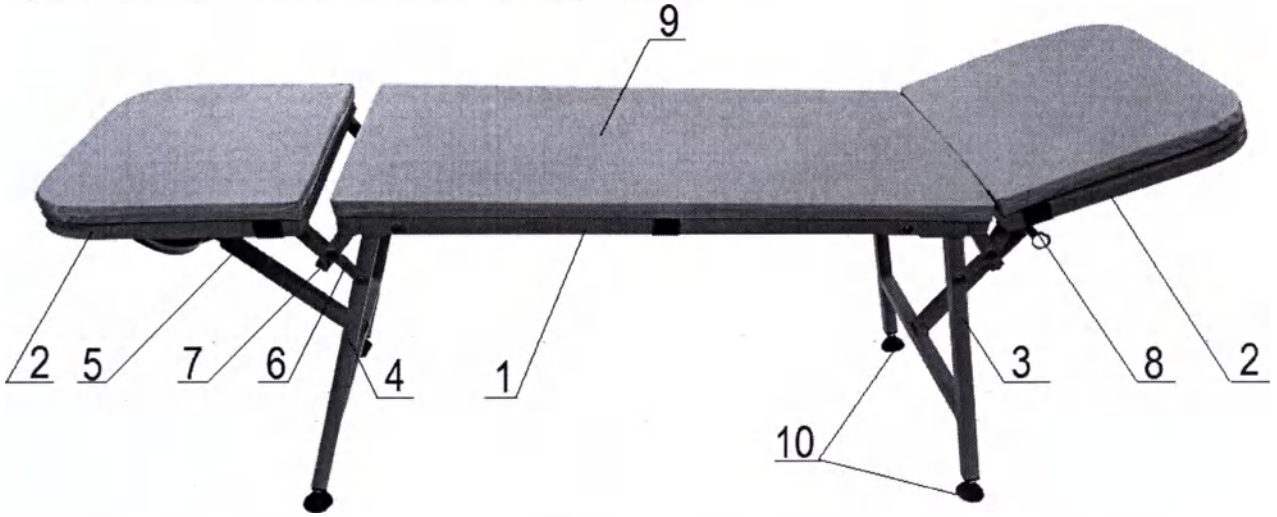

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора разъемная; 6 – крючок; 7 – втулка; 8 – фиксатор; 9 – матрас; 10 – опора шаровая

Рисунок 8

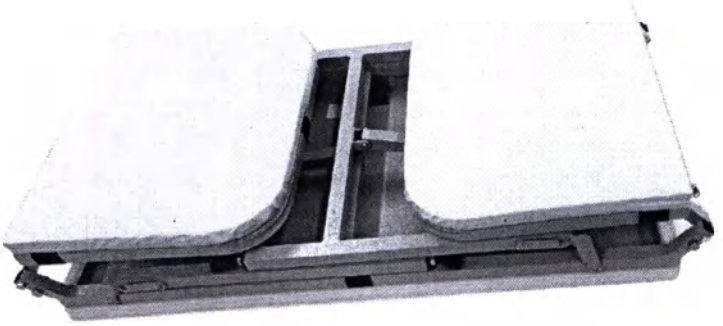

Рисунок 9 – Кушетка в сложенном виде

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4.2.2 Порядок работы

Установку кушетки в рабочее положение (рисунок 10) производить в следующей последовательности:

- извлечь кушетку из сумки транспортировочной и положить ее на бок;
- разложить боковые панели (2);
- разложить рамы опорные до предельного положения: вначале раму опорную (4), затем раму опорную (3);
- разъемные опоры (5), поддерживающие боковые панели (2), соединить фиксаторами (8);
- рамы опорные (3 и 4) зафиксировать крючками (6), зацепив их за втулки (7);
- проверить устойчивость кушетки, отрегулировав при необходимости высоту шаровых опор (10).

При необходимости:

- поднять боковую панель (2) на угол (0…5…10…15…20…25) °, зафиксировав ее в нужном положении фиксатором (8);
- опустить боковую панель (2) вниз на угол 90°, разъединив разъемные опоры (5).

Перевод кушетки из рабочего положения в сложенное производить в следующей последовательности:

- привести боковые панели (2) горизонтальное положение;
- расфиксировать крючки (6) и положить кушетку на бок;
- расфиксировав фиксаторы (8) – разъединить разъемные опоры (5);
- сложить опорные рамы: вначале раму опорную (3), затем раму опорную (4);
- сложить боковые панели (2);
- уложить кушетку в сумку транспортировочную.

ВНИМАНИЕ:

При переводе кушетки в рабочее положение из сложенного и обратно, беречь руки от защемления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

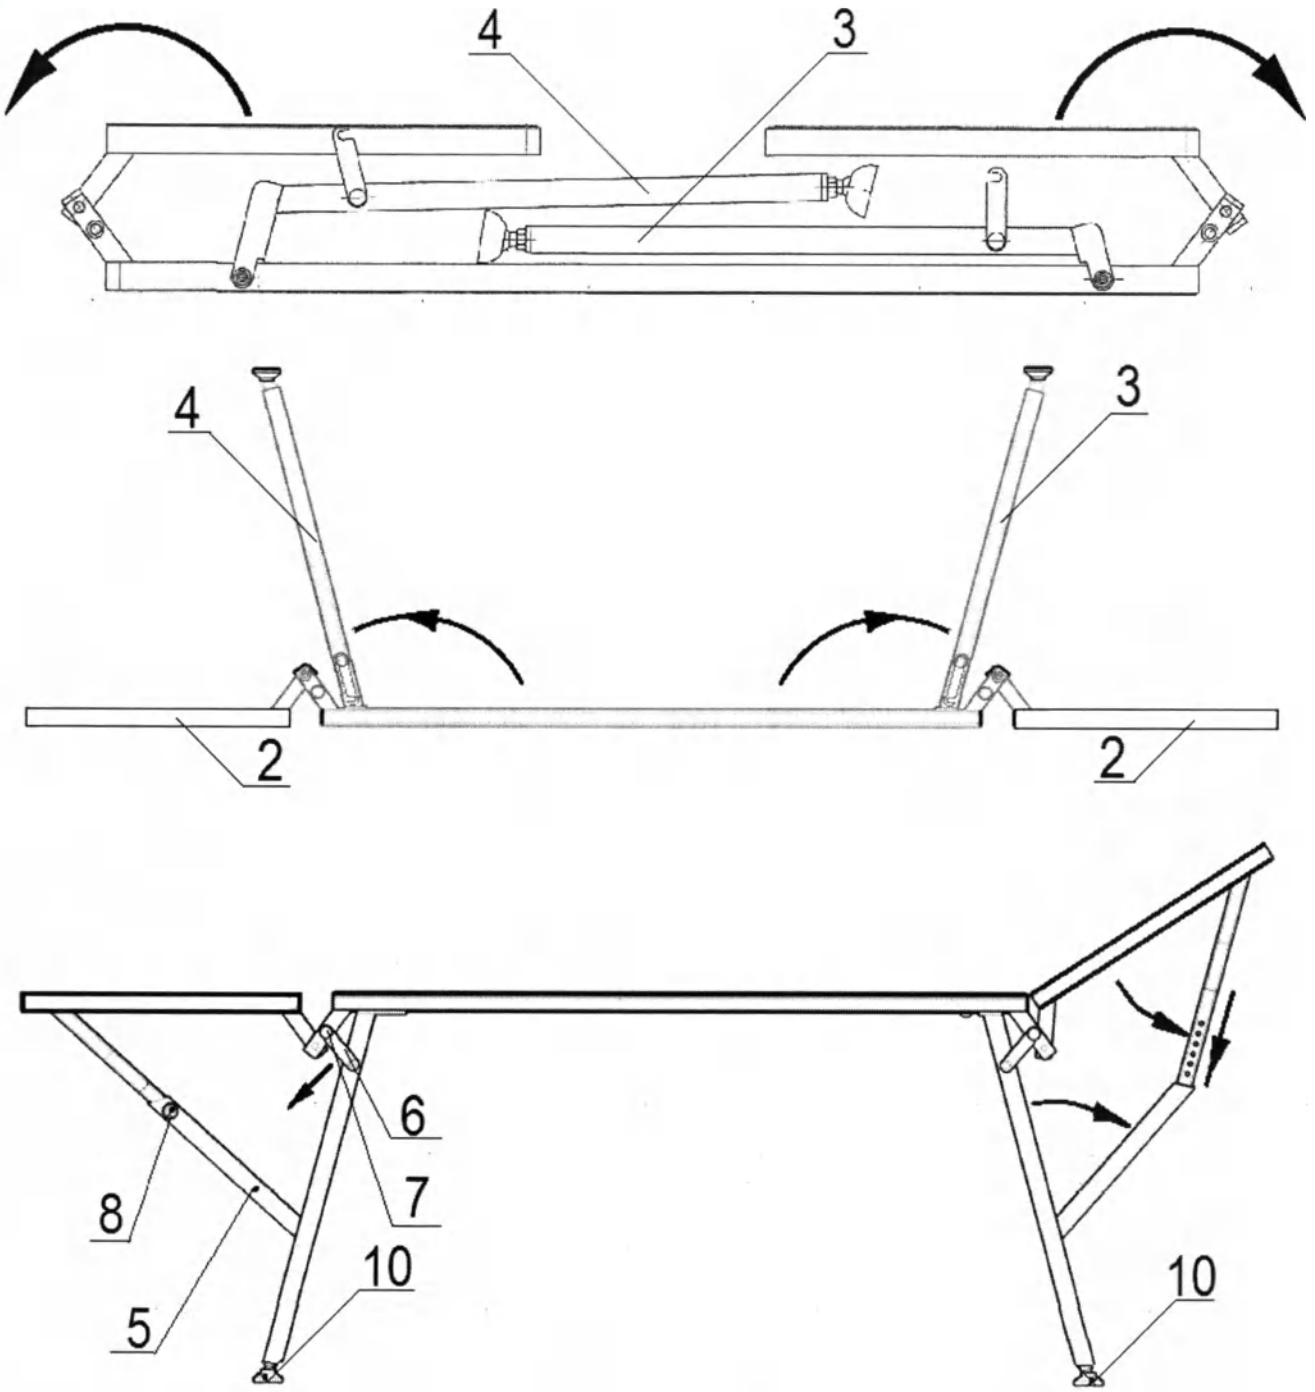

2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – опора разъемная; 6 – крючок; 7 – втулка; 8 – фиксатор; 10 – опора шаровая

Рисунок 10 – Установка кушетки в рабочее положение

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5 Меры безопасности

5.1 Изделия в зависимости от степени потенциального риска применения относятся к классу 1 согласно ГОСТ 31508 и Приказу МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г.

5.2 Изделия предназначены для многократного использования медицинскими работниками, внимательно ознакомившимися с эксплуатационной документацией, освоившими правила эксплуатации. При работе с изделиями соблюдайте правила транспортировки пациента, принятые в медицине.

5.3 Перед началом работы с изделиями внимательно ознакомьтесь с настоящим РЭ.

5.4 При транспортировке изделий и работе с ними избегайте резких ударов, которые могут привести к повреждению изделий.

5.5 Техническое обслуживание – в соответствии с разделом 7 настоящего РЭ.

5.6 Убирайте изделия в сумки только после их обработки и сушки.

Запрещается:

- Эксплуатировать изделия без ознакомления с эксплуатационной документацией;

- Использовать изделия не по назначению.

6 Указания по эксплуатации

6.1 При эксплуатации изделий должны учитываться эксплуатационные ограничения и соблюдаться правила безопасности, изложенные в эксплуатационной документации.

6.2 К эксплуатации допускаются медицинские работники, внимательно ознакомившиеся с эксплуатационной документацией, освоившие правила эксплуатации.

6.3 При эксплуатации изделий необходимо применять покрытия для обеспечения ограничения передачи инфекционных агентов, зарегистрированные в установленном порядке.

6.4 Медицинские работники должны работать в перчатках в соответствии с СанПиН 2.1.3678

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в осмотре целостности покрытий, в проверке надежности соединений и складывающихся механизмов. Техническое обслуживание осуществляется не реже одного раза в год для изделий, находящихся в стационарных медицинских учреждениях, и после каждого свертывания/развертывания – для изделий, используемых в мобильных медицинских формированиях.

7.2 Перед применением изделий должны быть выполнены работы по дезинфекции и бактерицидной очистке изделий

7.3 Дезинфекция осуществляется химическим методом по МУ-287-113 путем протирания. В качестве дезинфицирующего средства допускается использовать средства на основе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177 с 0,5% добавлением моющего средства ГОСТ 25644. Протрите поверхности марлевым тампоном или губкой. Для очистки поверхностей не используйте отбеливающие и абразивные средства. После дезинфекции изделия необходимо тщательно просушить.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование изделий может производиться всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2 Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8.3 Изделия могут храниться на складах по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Назначенный срок хранения составляет пять лет (технической документацией не регламентирован).

При хранении изделий допускается штабелирование в два яруса.

9 Сведения о маркировке

9.1 При маркировании изделий (на изделии, сумке транспортировочной и в эксплуатационной документации) применяются знаки и символы, в соответствии с действующей нормативной документацией, указанные в таблице 4.

Таблица 4

Изображение	Назначение	Изображение	Назначение	Изображение	Назначение
	Код партии (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		**Изготовитель** (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		**Дата изготовления** (ГОСТ Р ИСО 15223-1)
	Пределы температуры Диапазон температур, при которых следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		**Диапазон влажности.** Диапазон влажности, при которой следует транспортировать и хранить груз (ГОСТ Р ИСО 15223-1)		
	Осторожно! Указывает на необходимость для пользователя ознакомиться с важной информацией эксплуатационной документации, такой как предупреждения и меры предосторожности, которые не могут по разным причинам быть размещены на медицинском изделии. (ГОСТ Р ИСО 15223-1)				
Манипуляционные знаки					
	Беречь от влаги Необходимость защиты груза от воздействия влаги (ГОСТ 14192)		**Верх** Указывает правильное вертикальное положение груза (ГОСТ 14192)		**Хрупкое. Осторожно.** Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом (ГОСТ 14192)		**Предел по количеству ярусов в штабеле** Штабелировать не более 2 ярусов (ГОСТ 14192)

9.2 Внешний вид маркировки изделий приведен на рисунке 11. Внешний вид маркировки стойки для вливаний – рисунок 12, внешний вид маркировки принадлежностей – рисунок 13.

9.3 Каждая сумка транспортировочная должна иметь внутреннюю этикетку, вшитую в шов сумки – рисунок 14.

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9.4 Внешний вид маркировки на сумке транспортировочной приведен на рисунке 15.

Рисунок 14

Рисунок 15

10 Упаковка

10.1 В качестве упаковки используются сумки транспортировочные, изготовленные в соответствии с комплектом конструкторской документации.

10.2 Изделия помещаются в сумки транспортировочные.

10.3 Каждая сумка имеет ярлык (рисунок 12), на котором указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;
- адрес и номер телефона предприятия-изготовителя;
- товарный знак уполномоченного представителя производителя;
- наименование и обозначение технических условий;
- наименование изделия;
- номер регистрационного удостоверения;
- масса;
- число изделий в упаковке;
- месяц и год упаковывания;
- штамп ОТК;
- знаки и символы, приведенные в таблице 4.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11 Утилизация

11.1 Изделия не содержат в своем составе компонентов и материалов, способствующих загрязнению окружающей среды.

11.2 При нормальной эксплуатации изделий не оказывают негативного влияния на окружающую среду, здоровье персонала и пациентов. В своём составе изделия не содержат драгоценных металлов, веществ, токсичных для человека, или веществ, которые могут оказать влияние на здоровье

11.3 Утилизация изделий осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Изделия после окончания использования могут утилизироваться как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 и действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации твердых бытовых отходов

11.4 Неиспользованные изделия специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как твердые бытовые отходы. Изделия не взрывоопасны, не способны самовозгораться, при поднесении открытого огня горят без взрыва.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

12.3 Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

12.4 Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.

12.5 Срок предъявления претензий по разделу «Комплектность» 14 дней с момента получения изделия заказчиком.

12.6 Гарантийные требования реализуются при предъявлении эксплуатационной документации, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках, акта ввода изделия в эксплуатацию.

12.7 Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов, в случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

13 Послегарантийное техническое обслуживание

13.1 Послегарантийное техническое обслуживание проводится производителем или обслуживающими организациями, уполномоченными на это производителем (имеющими письменное разрешение).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение А
(справочное)

Перечень ссылочных документов

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
Приказ МЗ РФ №4Н от 06.06.2012 г	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
СанПиН 2.1.3678-20	Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ТУ 32.50.30-009-09442403-2023	Стол медицинский складной терапевтический с принадлежностями. Технические условия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение Б

(справочное)

Устройство и внешний вид изделий

Б.1 Устройство и внешний вид изделий приведены на рисунках Б.1 – Б.3.

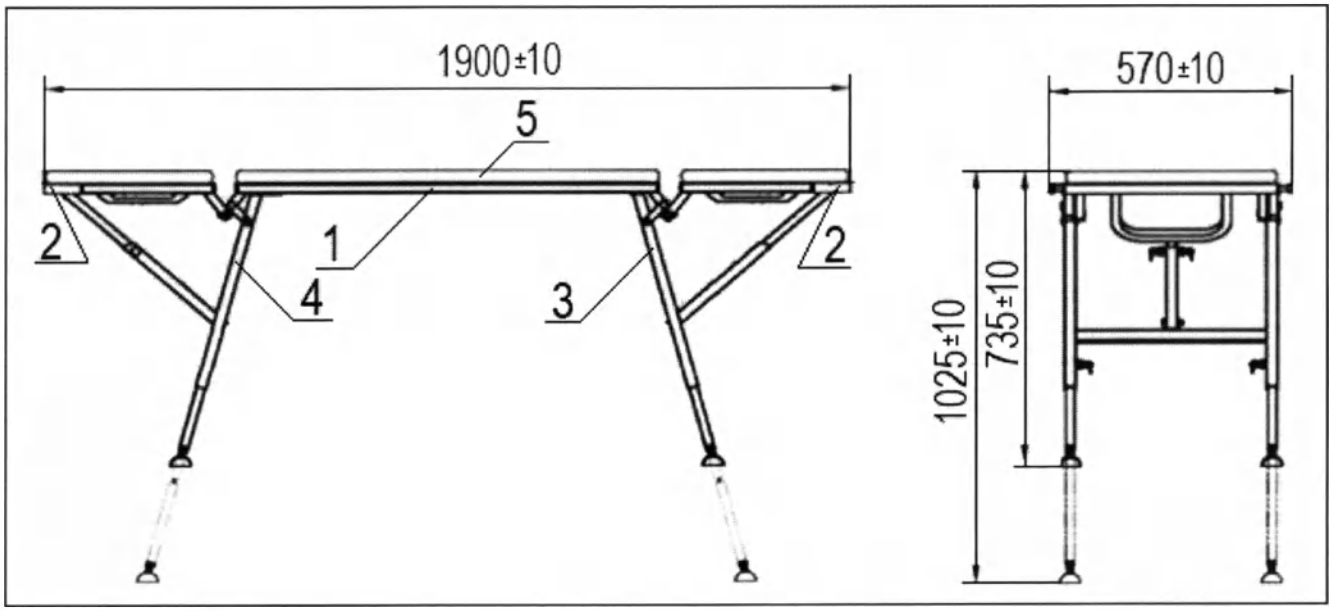

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – матрас

Рисунок Б.1

Стол перевязочный складной СП по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023
БВТГ 942818.001

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

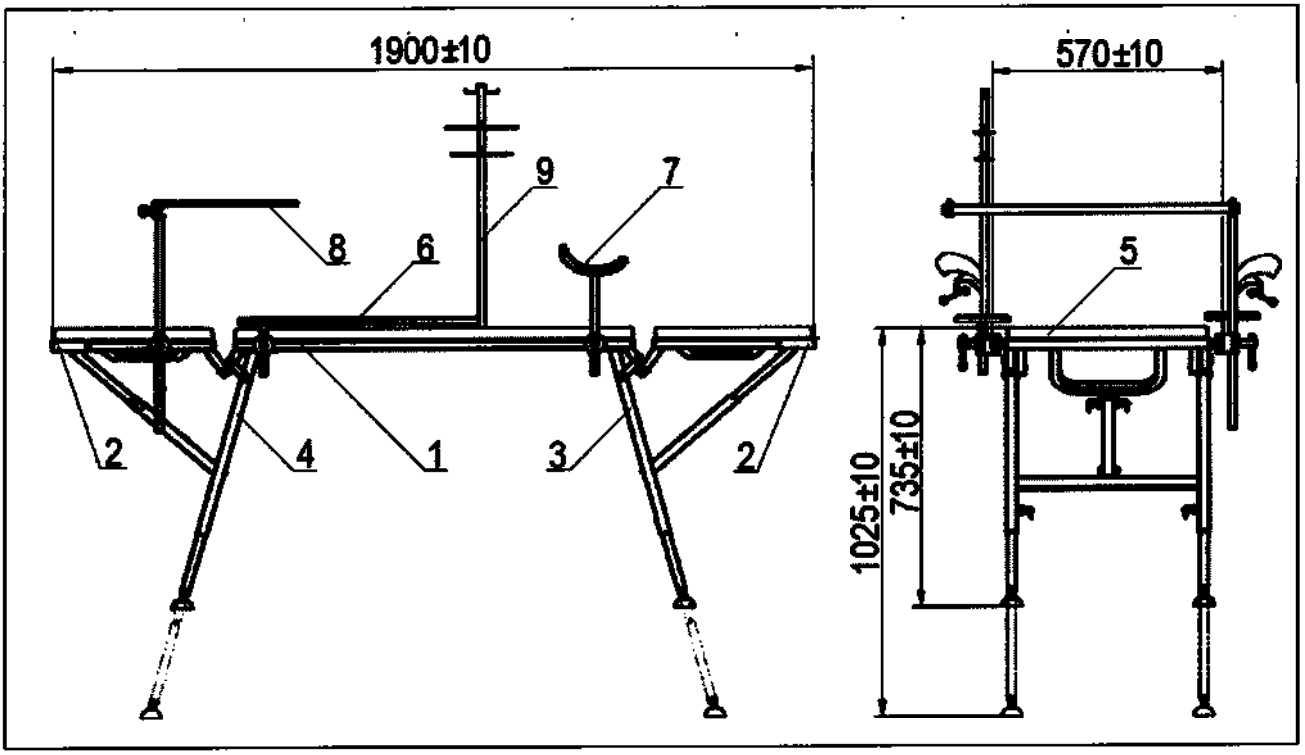

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – матрас;
6 – опора для руки с креплением; 7 – опора для ноги с креплением;
8 – дуга наркозная с креплением; 9 – стойка для вливаний с креплением

Рисунок Б.2

Стол перевязочный складной СП с принадлежностями по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023 **БВТГ 942818.001-01**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

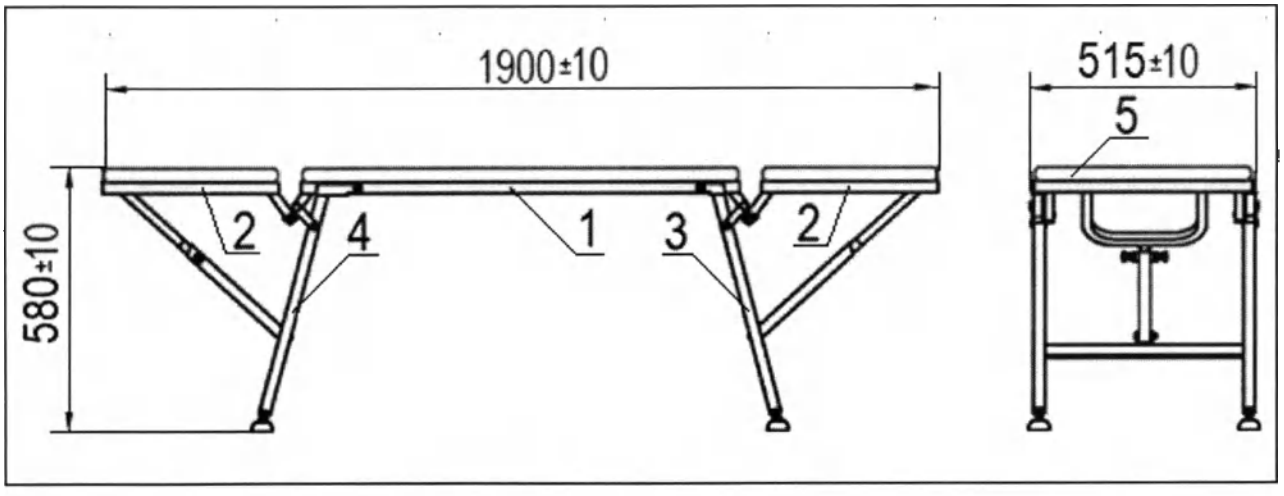

1 – панель средняя; 2 – панель боковая; 3, 4 – рамы опорные; 5 – матрас

Рисунок Б.3

Кушетка смотровая складная КС по ТУ 32.50.30-009-09442403-2023 БВТГ 942818.002

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего пронумеровано,
сброшюровано и скреплено
печатью 24 листов.
Генеральный директор
ООО «Омнимед-НН»

А.В. Лаврентьев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU