

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2018 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

**«Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные,
нестерильные»**

(Hartalega SDN. BHD. («Харталега СДН. БХД.»), Малайзия.)



Рис. 1 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Black).



Рис. 2 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Cobalt Blue)



Рис. 3 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Orange)



Рис. 4 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные с расширенной манжетой (Orange)



Рис.5 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Green)



Рис.6 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Aqua Blue)



Рис.7 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные с расширенной манжетой (Aqua Blue)



Рис.8 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Violet Blue)



Рис.9 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные с расширенной манжетой (Violet Blue)



Рис.10 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные с расширенной манжетой (Sky Blue)



Рис.11 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (White)



Рис.12 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Pink)



Рис.13 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (White) с покрытием Oatmeal



Рис. 14 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Dawn Blue) с покрытием Oatmeal



Рис.15 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Violet Blue)-ACF



Рис.16 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Translucent Blue)



Рис.17 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Ocean Blue)



Рис.18 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Dark Cobalt Blue)



Рис.19 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Dark Blue)



Рис.20 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Tiffany Blue)



Рис.21 – Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Light Sky Blue)

Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (Orange)

Размер: М

Материал: нитрильный латекс

Количество перчаток в
диспенсере: 100 шт.

Маркировка выполнена по
ГОСТ Р 52239-2004

AQL 1.5



Hartalega SDN. BHD.

C-G-9, Jalan Dataran SD1, Dataran SD PJU 9,
Bandar Sri, Damansara, 52200 Kuala Lumpur,
Malaysia

Тел: (603) 6277-17-33

Факс: (603) 6280-25-33

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

ООО "Компания "БиВи"

129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17

Тел: +7 (499) 281-67-68



Рис.22 – маркировка передней части диспенсера перчаток нитриловых медицинских диагностических неопудренных, нестерильных (Orange)

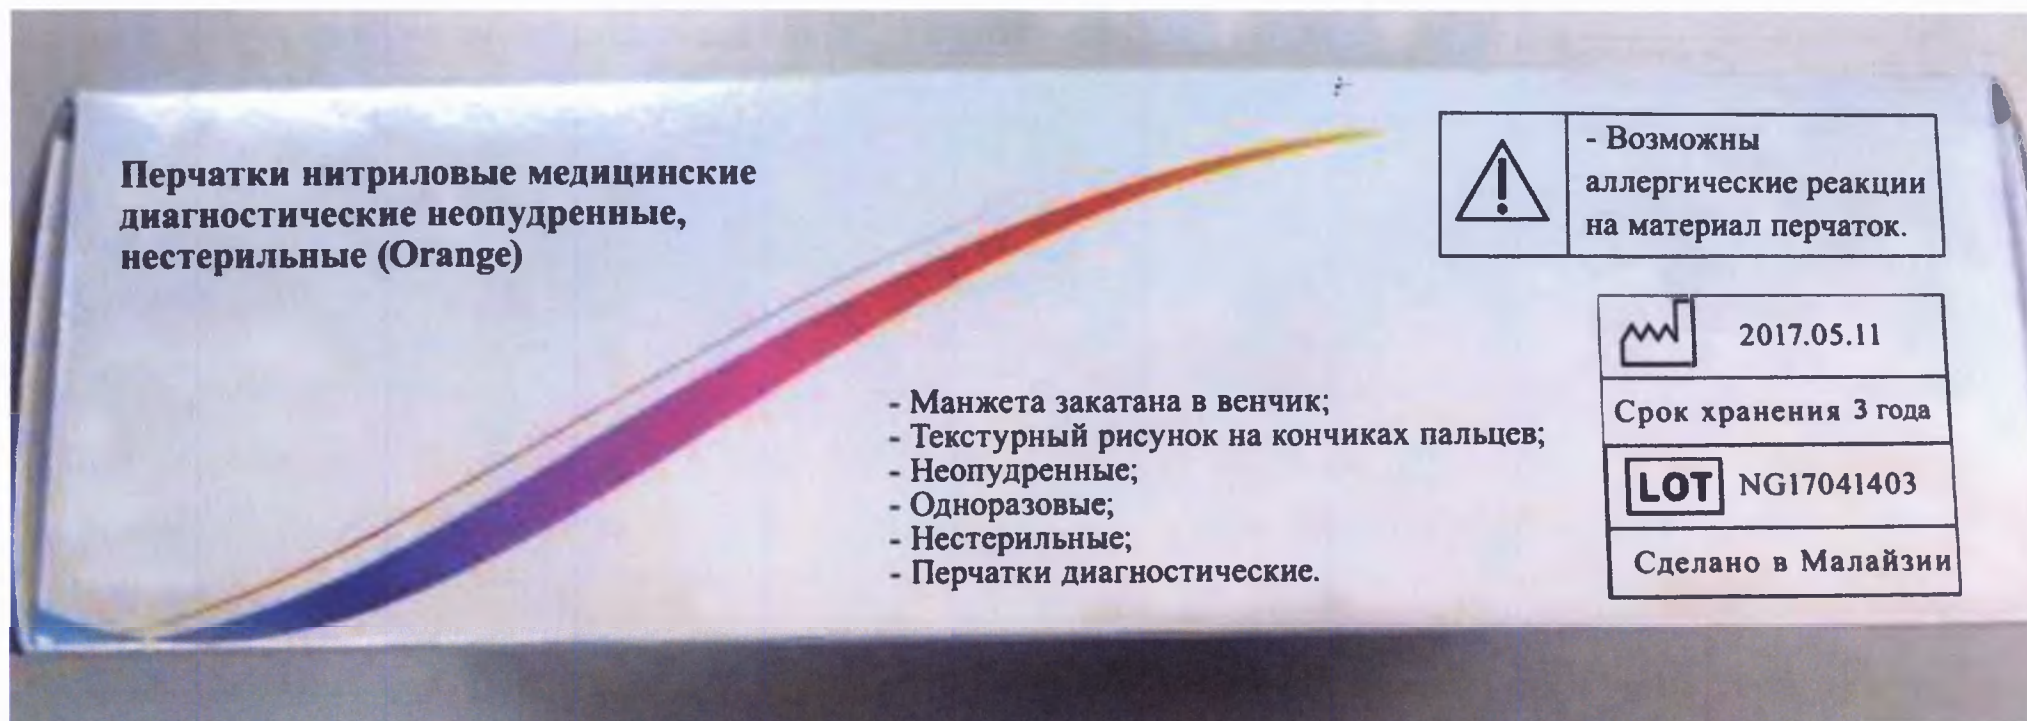


Рис.23 – маркировка боковой части диспенсера перчаток нитриловых медицинских диагностических неопудренных, нестерильных (Orange)

Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (White) с покрытием Oatmeal

Размер: M

Материал: нитрильный латекс

Количество перчаток в
диспенсере: 100 шт.

Маркировка выполнена по
ГОСТ Р 52239-2004



AQL 1.5



Hartalega SDN. BHD.
C-G-9, Jalan Dataran SD1, Dataran SD PJU 9,
Bandar Sri, Damansara, 52200 Kuala Lumpur,
Malaysia
Тел: (603) 6277-17-33
Факс: (603) 6280-25-33

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО "Компания "БиВи"
129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
Тел: +7 (499) 281-67-68



Рис.24 – маркировка передней части диспенсера перчаток нитриловых медицинских диагностических неопудренных, нестерильных (White) с покрытием Oatmeal

Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные (White) с покрытием Oatmeal

- Манжета закатана в венчик;
- Текстурный рисунок на кончиках пальцев;
- Неопудренные;
- Одноразовые;
- Нестерильные;
- Перчатки диагностические.



- Возможны
аллергические реакции
на материал перчаток.



2017.05.11

Срок хранения 3 года

LOT

NG17041403

Сделано в Малайзии

Рис.25 – маркировка боковой части диспенсера перчаток нитриловых медицинских диагностических неопудренных, нестерильных (White) с покрытием Oatmeal

Перчатки нитриловые медицинские диагностические неопудренные, нестерильные

Содержимое: 10 диспенсеров по 100 перчаток размера М;

Материал: нитрильный латекс

Количество перчаток в
диспенсере: 100 шт.

Маркировка выполнена по ГОСТ
Р 52239-2004




Hartalega SDN. BHD.
C-G-9, Jalan Dataran SD1, Dataran SD PJU 9,
Bandar Sri, Damansara, 52200 Kuala Lumpur,
Malaysia
Тел: (603) 6277-17-33
Факс: (603) 6280-25-33

Уполномоченный представитель производителя в РФ:
ООО "Компания "БиВи"
129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1, пом. 17
Тел: +7 (499) 281-67-68



Рис.26 – маркировка транспортной упаковки перчаток нитриловых медицинских диагностических неопудренных, нестерильных

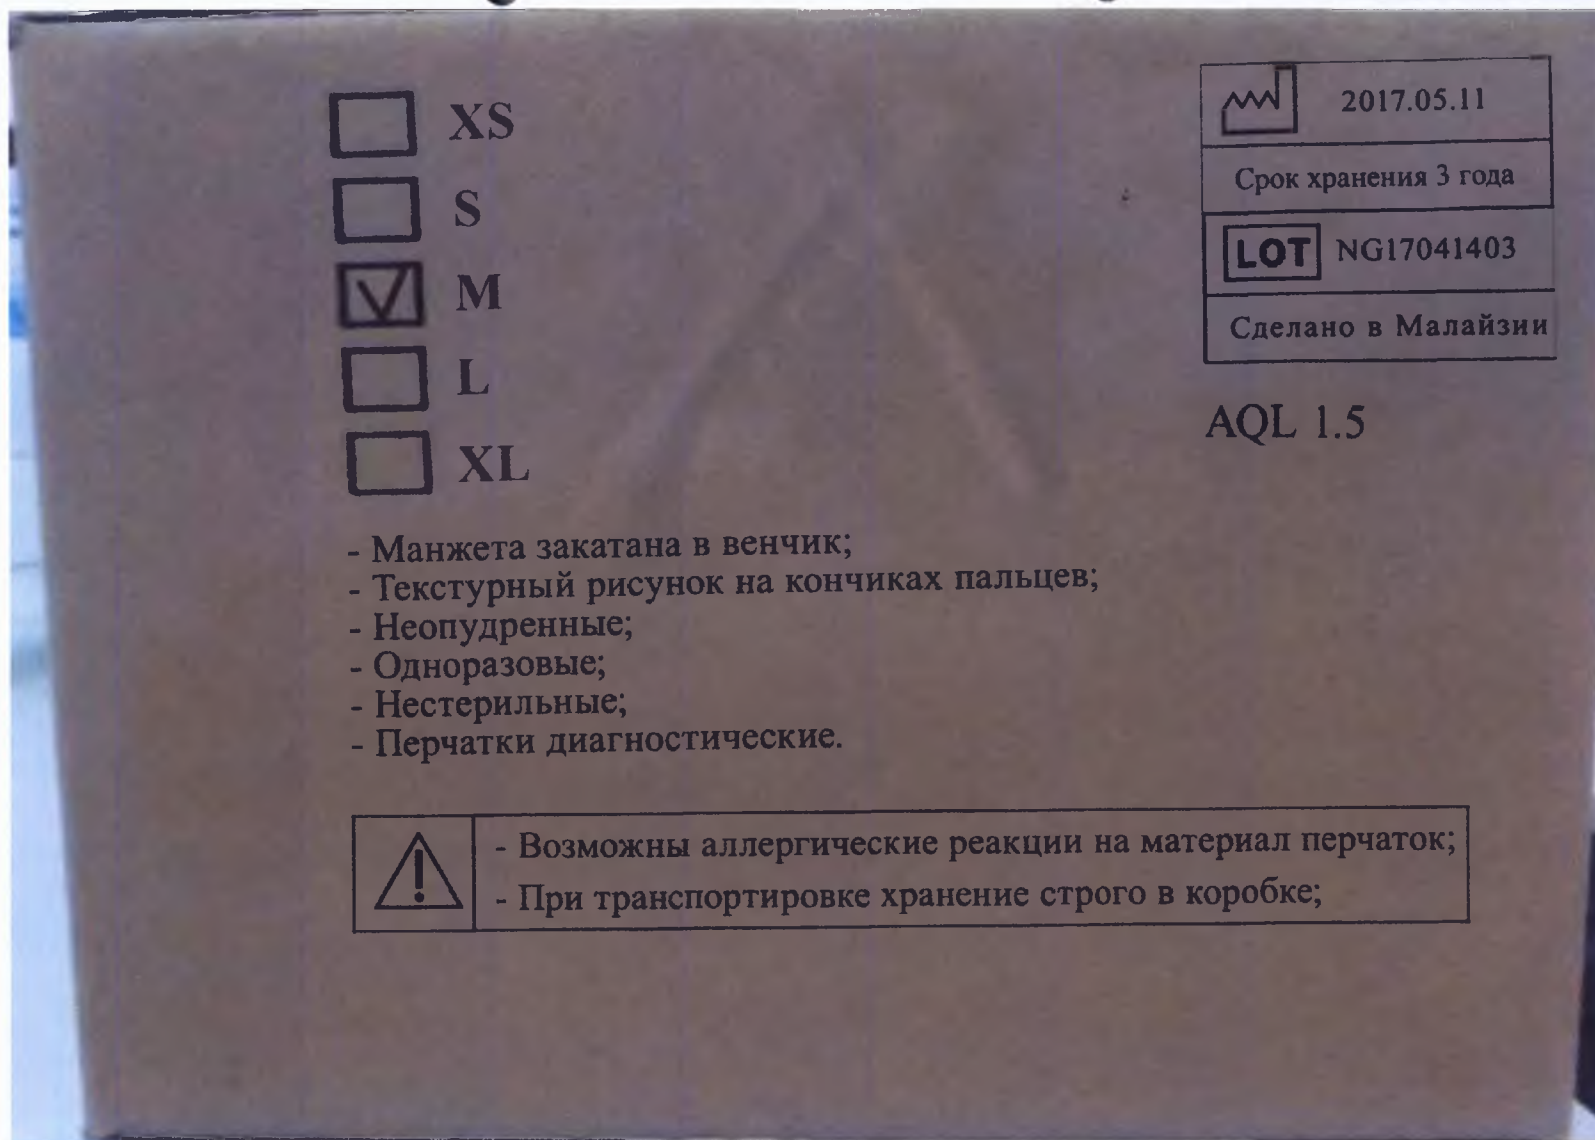

- ☐ XS
- ☐ S
- ☒ M
- ☐ L
- ☐ XL

 2017.05.11

Срок хранения 3 года

LOT NG17041403

Сделано в Малайзии

AQL 1.5

- Манжета закатана в венчик;
- Текстурный рисунок на кончиках пальцев;
- Неопудренные;
- Одноразовые;
- Нестерильные;
- Перчатки диагностические.

 - Возможны аллергические реакции на материал перчаток;
- При транспортировке хранение строго в коробке;

Рис.27 – маркировка транспортной упаковки перчаток нитриловых медицинских диагностических неопудренных, нестерильных

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 28 листа (-ов)

Генеральный Директор
М.П. / Носова Т.А.

